


Макет упаковки медицинского изделия «Набор калибровочных плазм для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Гепарин-калибратор)» по ТУ 21.20.23-103-42349142-2021.

Комплектация № 1

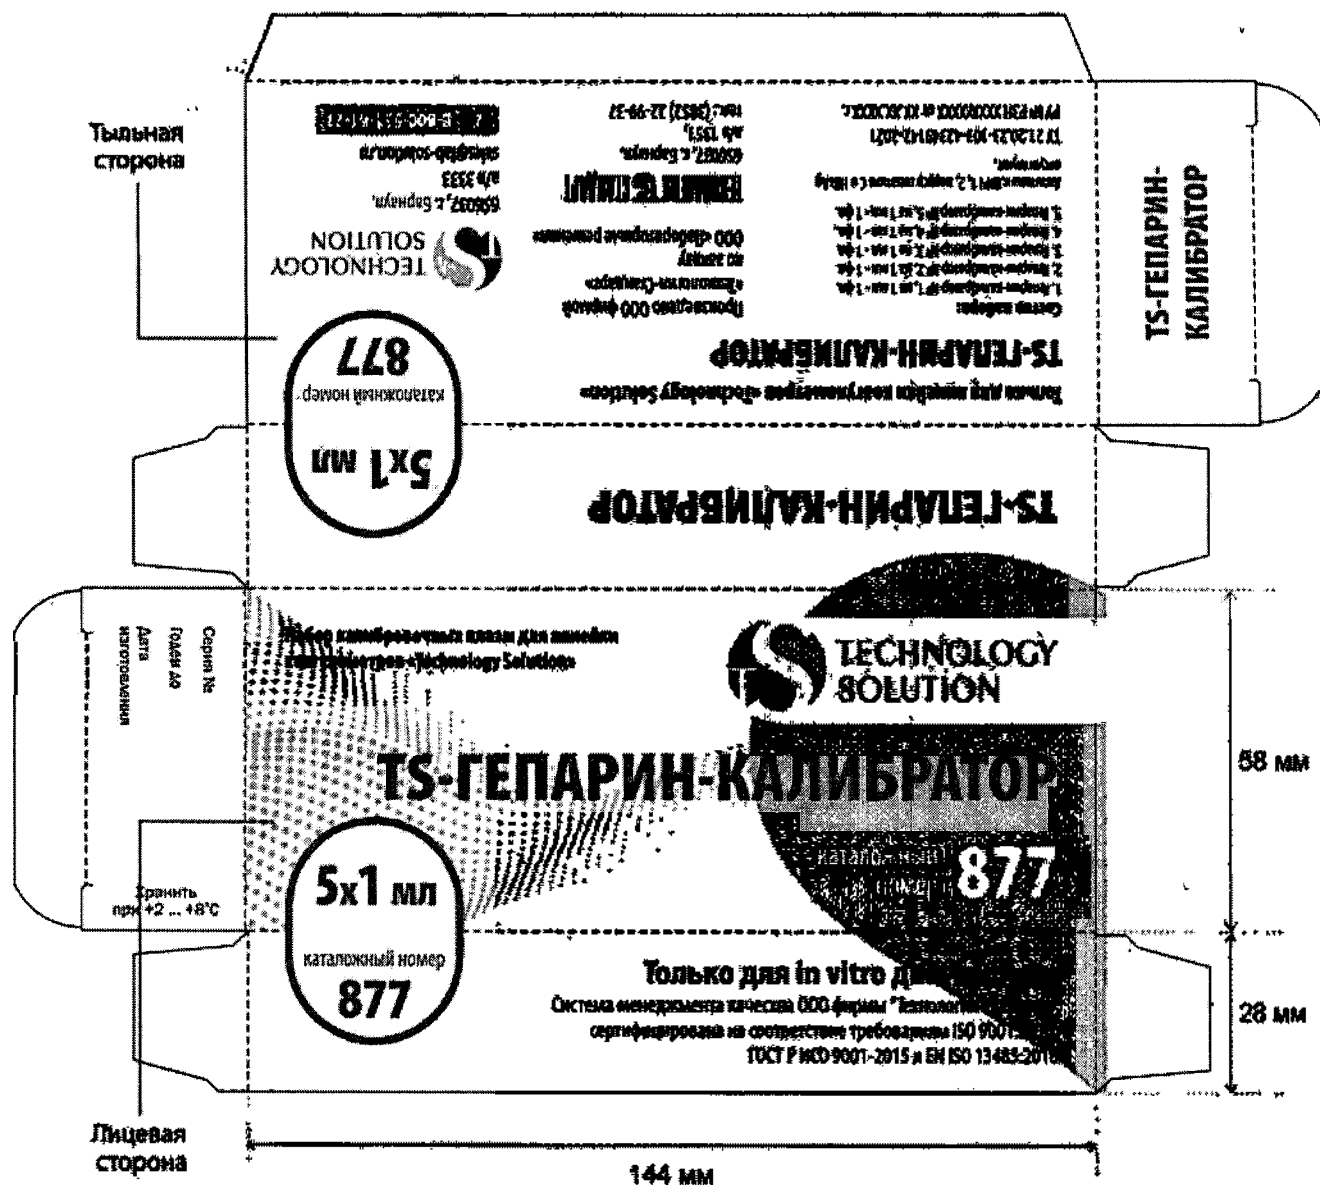

Красочная группа: СМУК

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28

Комплектация № 2



Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 2

(два) листов

«20» июня 2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



Макет этикеток медицинского изделия «Набор калибровочных плазм для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Гепарин-калибратор)» по ТУ 21.20.23-103-42349142-2021.

Комплектация № 1:

Макет этикетки реагента «Гепарин-калибратор № 1»



Макет этикетки реагента «Гепарин-калибратор № 2»



Макет этикетки реагента «Гепарин-калибратор № 3»



Макет этикетки реагента «Гепарин-калибратор № 4»



Макет этикетки реагента «Гепарин-калибратор № 5»



Комплектация № 2:

Макет этикетки реагента «Гепарин-калибратор № 1»



Макет этикетки реагента «Гепарин-калибратор № 2»



Макет этикетки реагента «Гепарин-калибратор № 3»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью д

(два) листов

«30» июня 2011 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО фирмы



«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2021 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор калибровочных плазм для линейки коагулометров «Technology
Solution» (TS-Гепарин-калибратор)» по ТУ 21.20.23-103-42349142-2021**

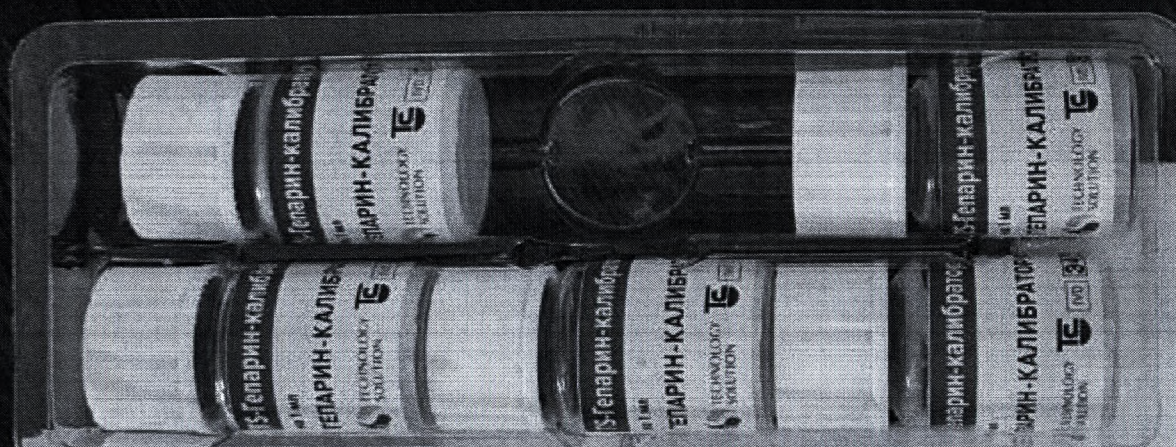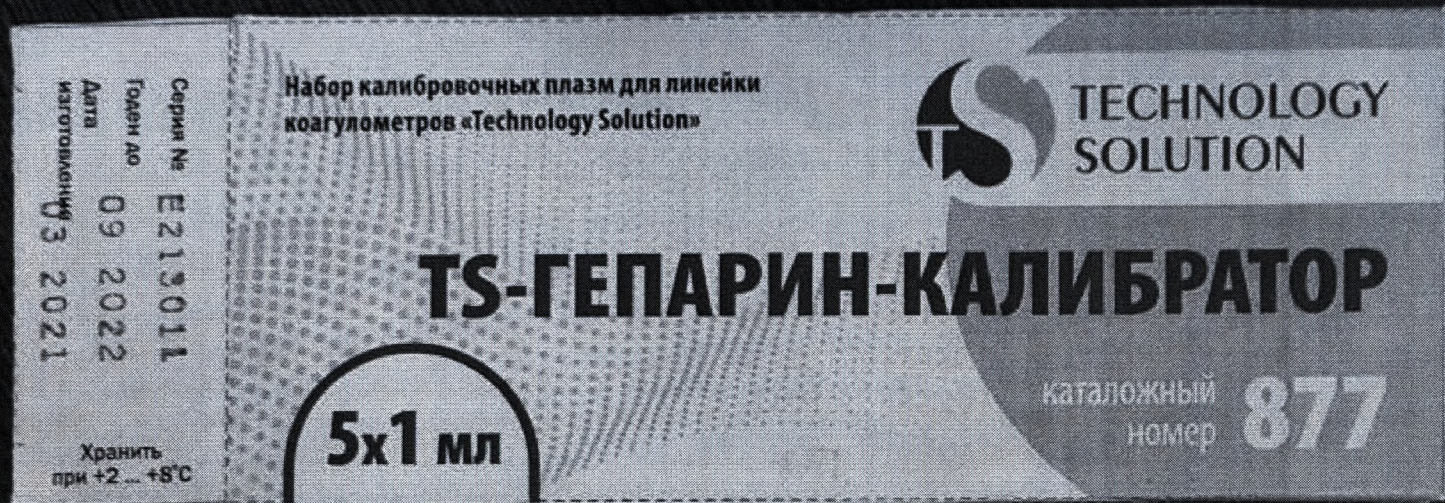

ООО фирма «Технология Стандарт»

ПАСПОРТ № 877

Набор калибровочных плазм для линейки коагулометров

«Technology Solution»

(TS-Гепарин-калибратор)

ТУ 21.20.23-103-42349142-2021

Серия E213011

Годен до 09.2022



TS-Гепарин-калибратор

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора калибровочных плазм
для линейки коагулометров «Technology Solution»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Гепарин-калибратор» предназначено для получения калибровочных значений при определении активности тромбин-антикоагуляторов (низкомолекулярный и высокомолекулярный гепарин) в плазме крови хронометрическим методом на линейке коагулометров «Technology Solution». Медицинское изделие «TS-Гепарин-калибратор» предназначено также для набора «TS-Анти-Ха».

Набор предназначен только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики, медицинскими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими сестрами.

Область применения набора: клиническая лабораторная диагностика.

TS-ГЕПАРИН-КАЛИБРАТОР

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ГЕПАРИН-КАЛИБРАТОР

Состав набора:

1. Гепарин-калибратор № 1, на 1 мл - 1 фл.
2. Гепарин-калибратор № 2, на 1 мл - 1 фл.
3. Гепарин-калибратор № 3, на 1 мл - 1 фл.
4. Гепарин-калибратор № 4, на 1 мл - 1 фл.
5. Гепарин-калибратор № 5, на 1 мл - 1 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-103-42349142-2021

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕ СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,

а/я 1351,

тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

877




TECHNOLOGY
SOLUTION

656037, г. Барнаул,

а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71

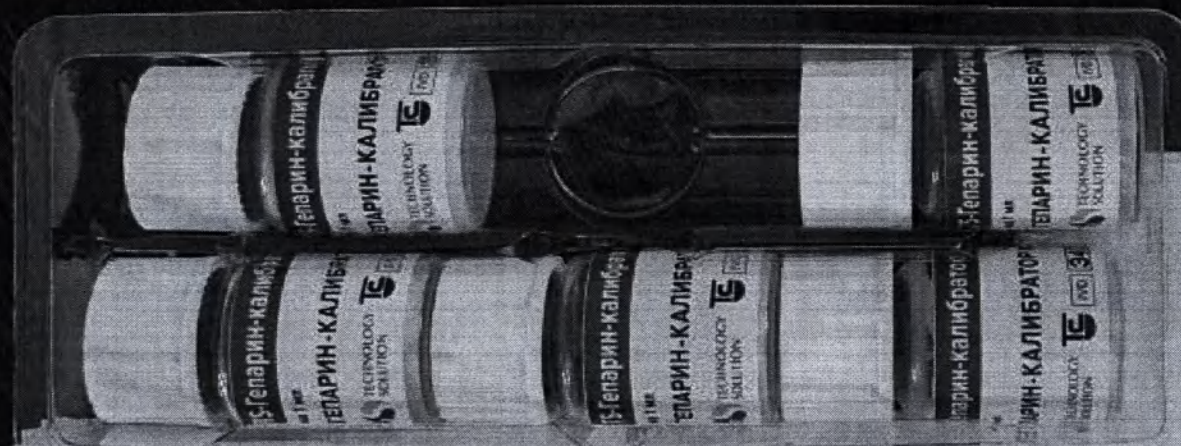

ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 877

Набор калибровочных плазм для линейки коагулометров

«Technology Solution»

(TS-Гепарин-калибратор)

ТУ 21.20.23-103-42349142-2021

Серия E213011

Годен до 09.2022

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-Гепарин-калибратор

ИНСТРУКЦИЯ


по применению набора калибровочных плазм
для линейки коагулометров «Technology Solution»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Гепарин-калибратор» предназначено для получения калибровочных значений при определении активности фактора антикоагулянт (нефракционированный и низкомолекулярный гепарин) в плазме крови крестообразным методом на линейке коагулометров «Technology Solution». Медицинское изделие «TS-Гепарин-калибратор» предназначено только для набора «TS-Анти-Ха».

Набор предназначен только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: медицинскими лабораториями, врачами КЛА, врачами-лаборантами, медицинскими лабораториями (фельдшер-лаборатория), лабораториями, медицинскими учреждениями.

Область применения набора: клиническая лабораторная диагностика.

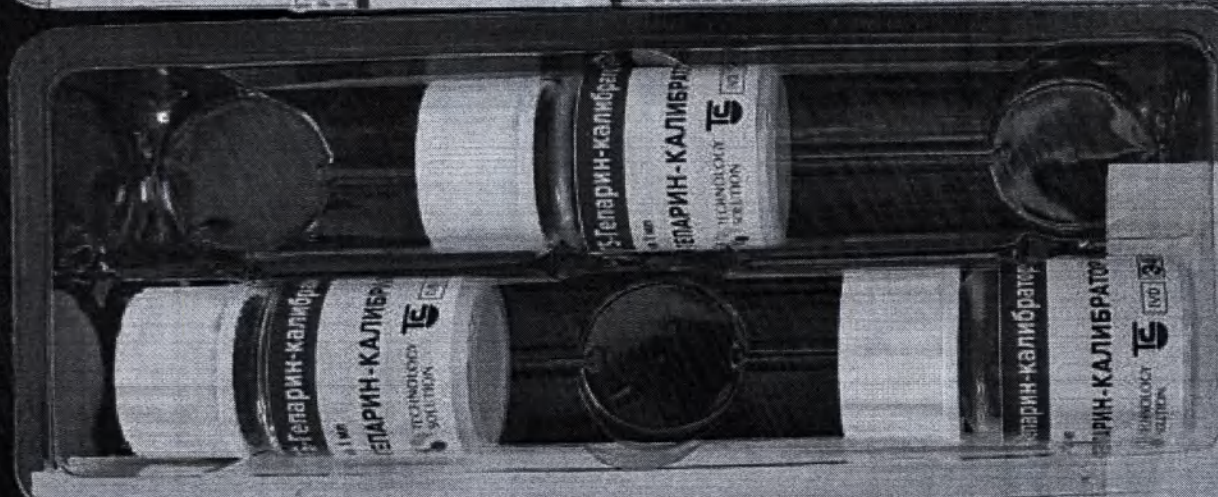

ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 913

Набор калибровочных плазм для линейки коагулометров
«Technology Solution»
(TS-Гепарин-калибратор)
ТУ 21.20.23-103-42349142-2021

Серия E213013

Годен до 09.2022



TS-Гепарин-калибратор

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора калибровочных плазм
для линейки коагулометров «Technology Solution»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Гепарин-калибратор» предназначено для получения калибровочных значений при определении анти-Ха активности плазмы антикоагулянтов (дофракционированный и низкомолекулярные гепарины) в плазме крови хромогенным методом на линейке коагулометров «Technology Solution». Медицинское изделие «TS-Гепарин-калибратор» предназначено только для набора «TS-Анти-Ха».

Набор предназначен только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: ведущими лабораторными врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения набора: клиническая лабораторная диагностика, клиническая медицина.

TS-ГЕПАРИН-КАЛИБРАТОР

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ГЕПАРИН-КАЛИБРАТОР

Состав набора:

1. Гепарин-калибратор № 1, на 1 мл - 1 фл.
2. Гепарин-калибратор № 2, на 1 мл - 1 фл.
3. Гепарин-калибратор № 3, на 1 мл - 1 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

TU 21.20.23-103-42349142-2021

ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,

а/я 1351,

тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

913




TECHNOLOGY
SOLUTION

656037, г. Барнаул,

а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71

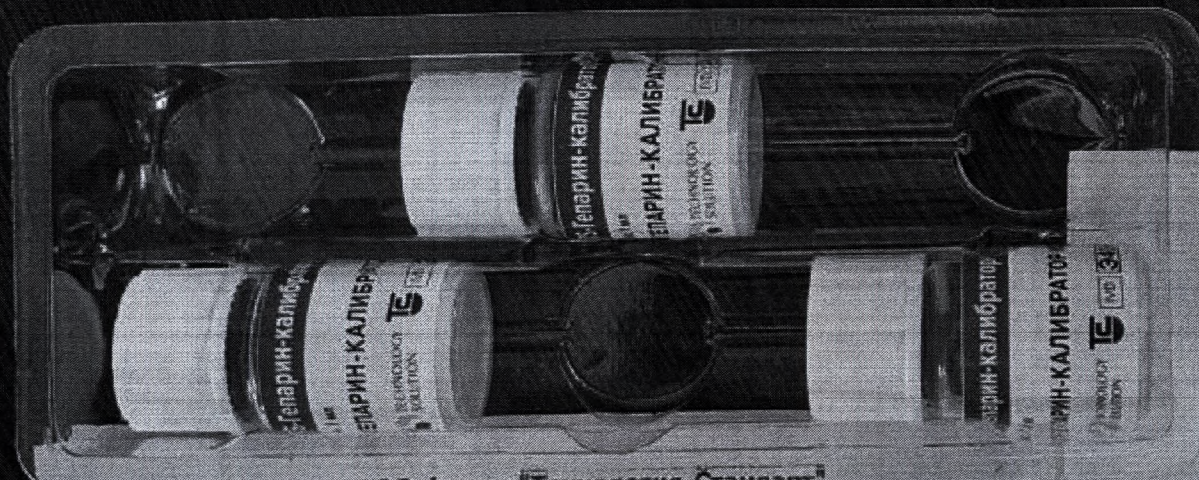

ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 913

Набор калибровочных плазм для линейки коагулометров

«Technology Solution»

(TS-Гепарин-калибратор)

TU 21.20.23-103-42349142-2021

Серия E213013

Годен до 09.2022



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-Гепарин-калибратор

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора калибровочных плазм
для линейки коагулометров «Technology Solution»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Гепарин-калибратор» предназначено для получения калибровочных значений при определении анти-Ха активности ириксаз антикоагулянтов (микрофракционированный и низкомолекулярный гепарин) в плазме крови хромогенным методом на линейке коагулометров «Technology Solution». Медицинское изделие «TS-Гепарин-калибратор» предназначено только для набора «TS-Анти-Ха».

Набор предназначен только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заводскими лабораториями, врачами ИЦД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными точечными (фалдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологиями.

Область применения набора: клиническая лабораторная диагностика, количественная оценка.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 5
(неть) листов

20 » июня 2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот
А.П. Момот

