



**Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6)
иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на
анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS IL-6)**

Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки (Вариант исполнения 1)

	Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS IL-6)		
	Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru		
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.			
LOT		REF SMFP-74	
РУ Дата регистрации			
        			

Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки короба 1 (Вариант исполнения 2)

	Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS IL-6)		
	Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru		
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.			
LOT	REF	SMFP-74-CFPO-296-CFPO-297	
РУ	Дата регистрации		
			
			
			

Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки короба 2 (Вариант исполнения 2)

Контроль Boditech IL-6	
1 мл x 2 флакона Произведено в Корее	
LOT	REF
	CFPO-296
	
	
	
	

Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки короба 3 (Вариант исполнения 2)

Калибратор Boditech IL-6	
1 мл x 2 флакона Произведено в Корее	
LOT  	REF CFPO-297
CE  IVD  UDI 	

Макет русскоязычного стикера транспортной упаковки (Вариант исполнения 1)


	Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS IL-6) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru
Для профессионального применения 1. Картридж – 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт. 40 шт	
LOT REF SMFP-74 	
RU Дата регистрации 	
         	

Макет русскоязычного стикера транспортной упаковки (Вариант исполнения 2)

	Набор реагентов для количественного определения пиптерлейкина-6 (IL-6) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS IL-6) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru				
Для профессионального применения 1. Картридж - 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Контроль Boditech IL-6 уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 6. Контроль Boditech IL-6 уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 7. Калибратор Boditech IL-6 уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 8. Калибратор Boditech IL-6 уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 9. Инструкция по применению - 1 шт. После поставки Набора внешнюю упаковку необходимо вскрыть и поместить реагенты на хранение в соответствии с указанным на внутренней упаковке температурным режимом					
<table border="0"> <tr> <td>LOT</td> <td>REF</td> <td>SMFP-74-CFPO-296-CFPO-297</td> <td></td> </tr> </table>		LOT	REF	SMFP-74-CFPO-296-CFPO-297	
LOT	REF	SMFP-74-CFPO-296-CFPO-297			
<table border="0"> <tr> <td>РУ</td> <td>Дата регистрации</td> <td></td> </tr> </table>		РУ	Дата регистрации		
РУ	Дата регистрации				
         					

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 листов.

Генеральный директор
ООО «АВИВИР»

 Куркин Ф.Г.



Генеральный директор

ООО «Авивир»

Куркин Ф.Г.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F.G. Kurkin', written over a horizontal line.


Фотографические изображения

**Набор реагентов для количественного определения
интерлейкина-6 (IL-6) иммунофлуоресцентным методом в
цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе
иммунофлуоресцентном AFIAS
(AFIAS IL-6)**

Общий вид набора




Макет русскоязычного стикера

	Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS IL-6) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.	
LOT ILUAA11G	REF SMFP-74  15.09.2025
РУ	Дата регистрации 
    IVD   UDI	

Транспортная упаковка (для варианта исполнения 1)



Макет русскоязычного стикера

	Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS IL-6) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru
Для профессионального применения 1. Картридж – 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт. 40 шт	
LOT ILUAA11G	REF SMFP-74 15.09.2025
РУ	Дата регистрации 
          	

Вариант исполнения 2

Общий вид набора




Фото короба 1

Макет русскоязычного стикера короба 1

	Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS IL-6) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.	
LOT ILUEA12G REF SMFP-74-CFPO-296-CFPO-297  21.01.2026	
РУ	Дата регистрации  30°C 2°C
        	

Фото контролей - короб 2


(только для варианта исполнения 2)

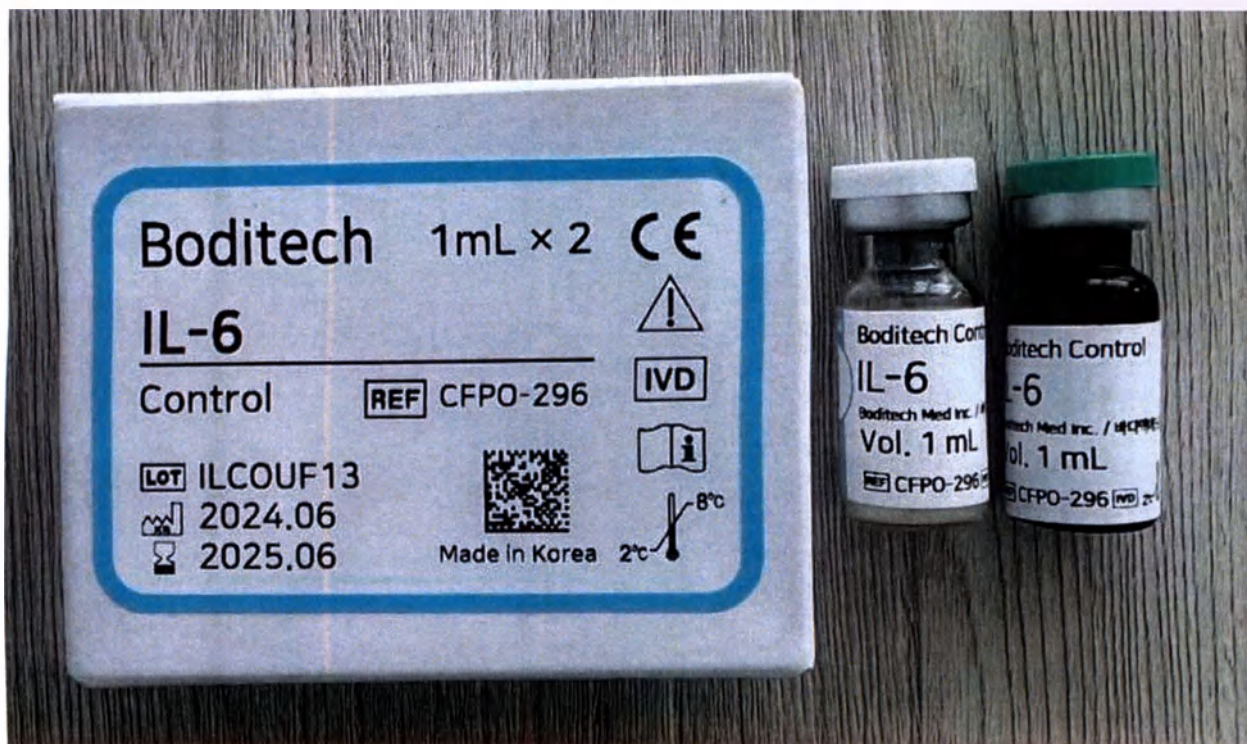

Макет русскоязычного стикера короба 2

Контроль Boditech IL-6	
1 мл x 2 флакона Произведено в Корее	
LOT ILCOUF13 06.2024 06.2025	REF CFPO-296
CE IVD UDI 2°C-8°C	

Фото калибраторов - короб 3
(только для варианта исполнения 2)

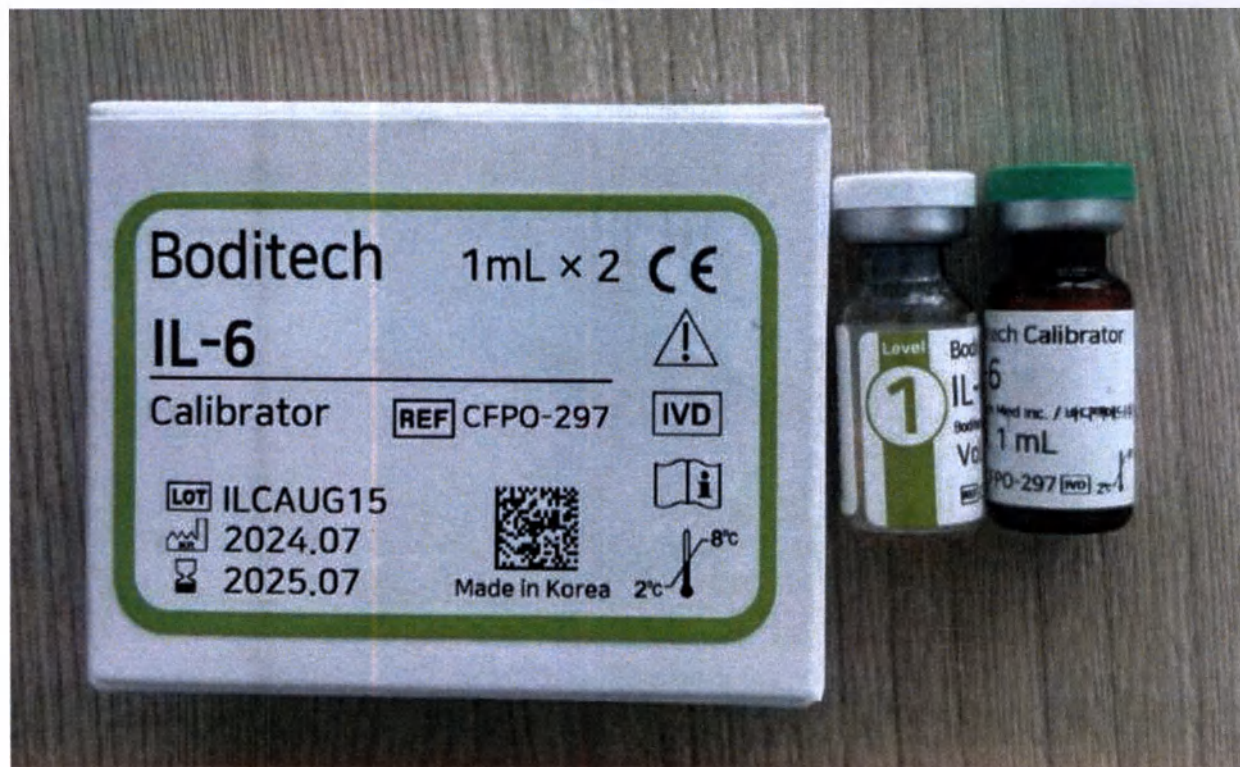

Макет русскоязычного стикера короба 3

Калибратор Boditech IL-6	
1 мл x 2 флакона Произведено в Корее	
LOT ILCAUG15 07.2024 07.2025	REF CFPO-297
CE IVD UDI 2°C - 8°C	

Транспортная упаковка (для варианта исполнения 2)





Макет русскоязычного стикера

	Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS IL-6) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru			
Для профессионального применения 1. Картридж - 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Контроль Boditech IL-6 уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 6. Контроль Boditech IL-6 уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 7. Калибратор Boditech IL-6 уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 8. Калибратор Boditech IL-6 уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 9. Инструкция по применению - 1 шт. После поставки Набора внешнюю упаковку необходимо вскрыть и поместить реагенты на хранение в соответствии с указанным на внутренней упаковке температурным режимом				
<table border="0"> <tr> <td>LOT ILUAA11G</td> <td>REF SMFP-74-CFPO-296-CFPO-297</td> <td> 30.06.2025</td> </tr> </table>		LOT ILUAA11G	REF SMFP-74-CFPO-296-CFPO-297	30.06.2025
LOT ILUAA11G	REF SMFP-74-CFPO-296-CFPO-297	30.06.2025		
РУ	Дата регистрации 2°C - 8°C			

Компоненты набора

Картридж



Наконечник пипетки

Чип идентификационный

Пакет для картриджа с застежкой