




Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS PCT Plus G)


Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки (Вариант исполнения 1)

	Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS PCT Plus G) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.	
LOT	REF SMFP-112 
РУ Дата регистрации	
        	

Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки короба 1 (Вариант исполнения 2)

	Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS PCT Plus G)	
	Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru	
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.		
LOT	REF SMFP-112-CFPO-97-CFPO-223	
РУ	Дата регистрации	
        		


Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки короба 2 (Вариант исполнения 2)

Контроль Boditech PCT Plus	
1 мл x 2 флакона Произведено в Корее	
LOT	REF CFPO-225
 	
     	




Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки короба 3 (Вариант исполнения 2)

Калибратор Boditech PCT Plus	
1 мл x 2 флакона Произведено в Корее	
LOT 	REF CFPO-223
     	

Макет русскоязычного стикера транспортной упаковки (Вариант исполнения 1)

	Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS PCT Plus G)	
	Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr	
	Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru	
Для профессионального применения		
1. Картридж – 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.		
60 шт		
LOT	REF SMFP-112	
PV	Дата регистрации	
         		

Макет русскоязычного стикера транспортной упаковки (Вариант исполнения 2)

	Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS PCT Plus G) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru
Для профессионального применения 1. Картридж - 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Контроль Boditech PCT Plus уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 6. Контроль Boditech PCT Plus уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 7. Калибратор Boditech PCT Plus уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 8. Калибратор Boditech PCT Plus уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 9. Инструкция по применению - 1 шт. После поставки Набора внешнюю упаковку необходимо вскрыть и поместить реагенты на хранение в соответствии с указанным на внутренней упаковке температурным режимом	
LOT	REF SMFP-112-CFPO-97-CFPO-223 ⌚
РУ	Дата регистрации 
          	



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов.

Генеральный директор
ООО «АВИР»

 Куркин Ф.Г.

Генеральный директор

ООО «Авивир»

Куркин Ф.Г.



Фотографические изображения

**Набор реагентов для количественного определения
прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом в
цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе
иммунофлуоресцентном AFIAS
(AFIAS PCT Plus G)**

Вариант исполнения 1

Общий вид набора



Потребительская упаковка**(для варианта исполнения 1)**

Макет русскоязычного стикера

	Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS PCT Plus G) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru	
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.		
LOT PPUCB18X	REF SMFP-112	 08.11.2025
РУ Дата регистрации		
CE Σ 24   IVD   UDI		

Транспортная упаковка

(для варианта исполнения 1)



Макет русскоязычного стикера

	Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS PCT Plus G) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru
Для профессионального применения 1. Картридж – 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт. 40 шт	
LOT PPUCB18X	REF SMFP-112 08.11.2025
РУ Дата регистрации	
CE Σ₂₄ ⊗ ⚠ IVD 📖 ♻️ ☔ 🍷 ⬆️⬆️	

Вариант исполнения 2

Общий вид набора



**Потребительская упаковка
Фото короба 1**




Макет русскоязычного стикера короба 1

	Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS PCT Plus G) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru	
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.		
LOT PPUDB21X	REF SMFP-112-CFPO-97-CFPO-223	 25.12.2025
РУ	Дата регистрации	
        		

Фото контролей - короб 2

(только для варианта исполнения 2)

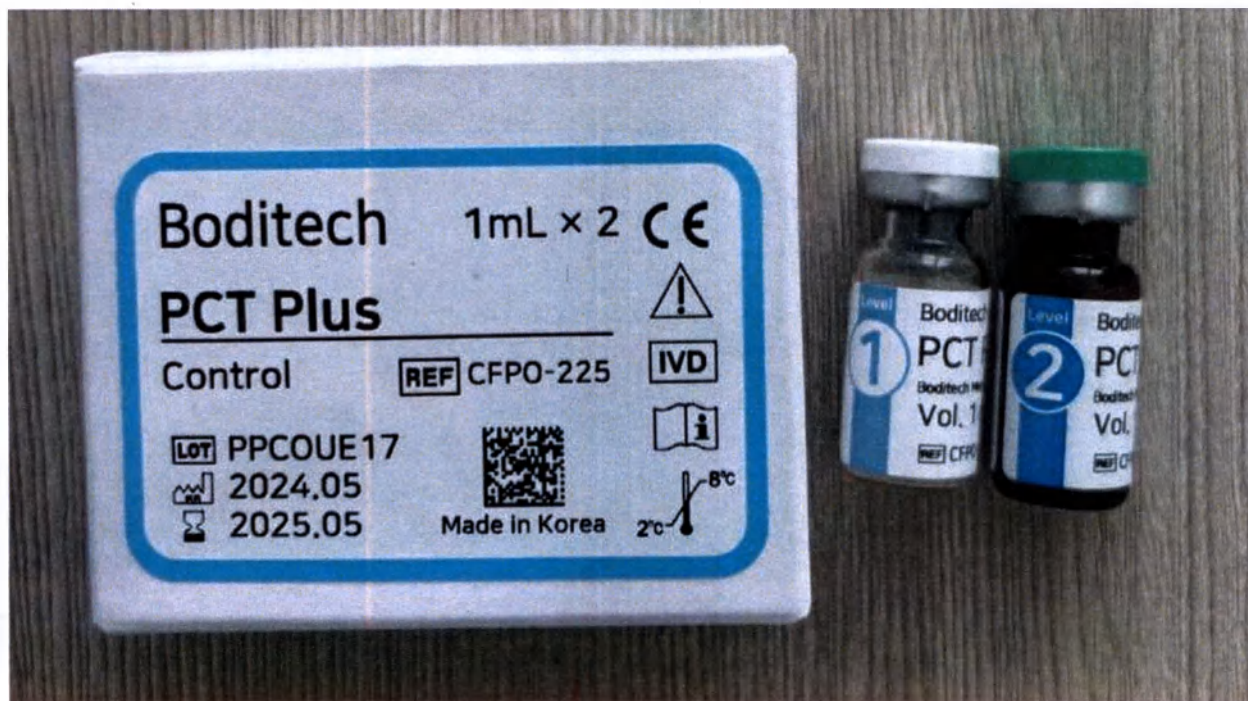


Макет русскоязычного стикера короба 2

Контроль Boditech PCT Plus	
1 мл x 2 флакона Произведено в Корее	
LOT PPCOUE17 05.2024 05.2025	REF CFPO-225
CE IVD UDI 2°C	

Фото калибраторов - короб 3

(только для варианта исполнения 2)

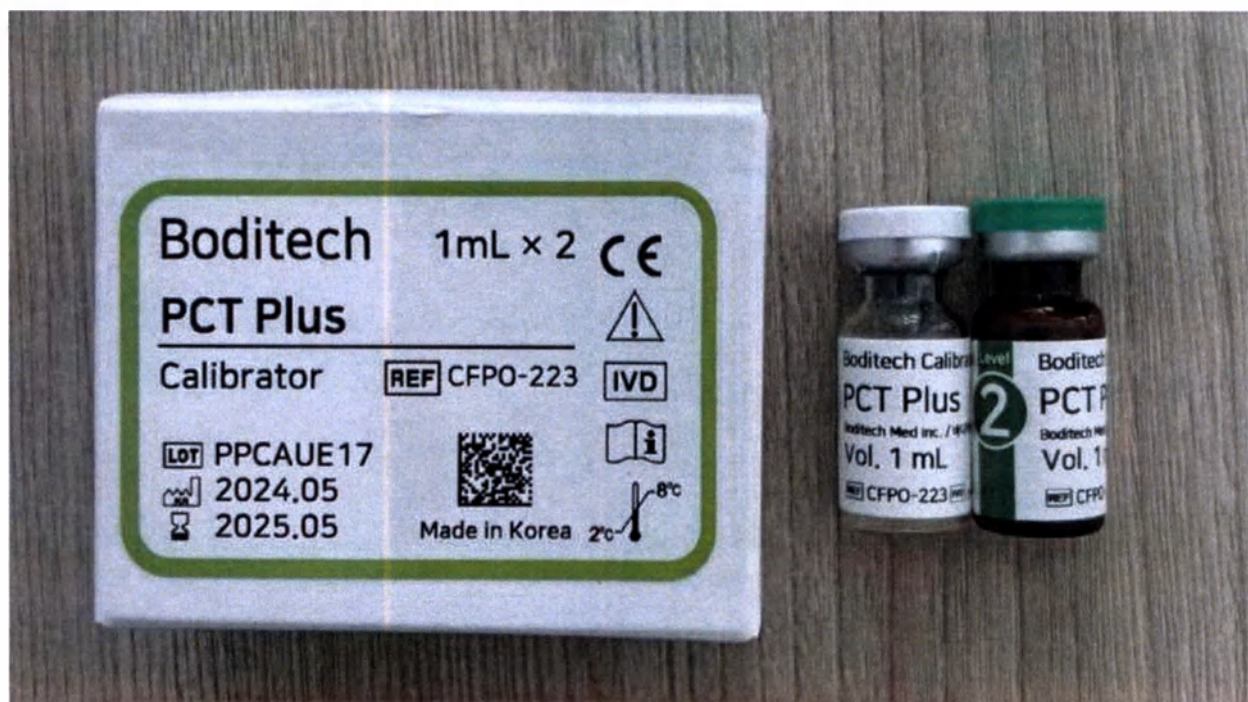

Макет русскоязычного стикера короба 3

Калибратор Boditech PCT Plus	
1 мл x 2 флакона Произведено в Корее	
LOT PPCAUE17	REF CFPO-223
05.2024	
05.2025	
CE IVD UDI 2°C - 8°C	

Транспортная упаковка (для варианта исполнения 2)



Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS PCT Plus G)

Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.)
43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea
Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr

Представитель производителя в РФ:
ООО «Авивир»
141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7
Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru

Для профессионального применения

1. Карtridge - 24 шт.;
2. Наконечник пипетки - 24 шт.;
3. Чип идентификационный - 1 шт.;
4. Пакет для cartridge с застёжкой - 1 шт.;
5. Контроль Boditech PCT Plus уровень 1 (1 мл) - 1 шт.;
6. Контроль Boditech PCT Plus уровень 2 (1 мл) - 1 шт.;
7. Калибратор Boditech PCT Plus уровень 1 (1 мл) - 1 шт.;
8. Калибратор Boditech PCT Plus уровень 2 (1 мл) - 1 шт.;
9. Инструкция по применению - 1 шт.

После поставки Набора внешнюю упаковку необходимо вскрыть и поместить реагенты на хранение в соответствии с указанным на внутренней упаковке температурным режимом

LOT: RPU01021X REF: SMIF-112-CFPO-97-CFPO-223 31.05.2025

RU Дата регистрации

CE V 24 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Макет русскоязычного стикера

	Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS PCT Plus G) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru						
Для профессионального применения 1. Картридж - 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Контроль Boditech PCT Plus уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 6. Контроль Boditech PCT Plus уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 7. Калибратор Boditech PCT Plus уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 8. Калибратор Boditech PCT Plus уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 9. Инструкция по применению - 1 шт. После поставки Набора внешнюю упаковку необходимо вскрыть и поместить реагенты на хранение в соответствии с указанным на внутренней упаковке температурным режимом							
<table border="0"> <tr> <td>LOT</td> <td>PPUDB21X</td> <td>REF</td> <td>SMFP-112-CFPO-97-CFPO-223</td> <td></td> <td>31.05.2025</td> </tr> </table>		LOT	PPUDB21X	REF	SMFP-112-CFPO-97-CFPO-223		31.05.2025
LOT	PPUDB21X	REF	SMFP-112-CFPO-97-CFPO-223		31.05.2025		
<table border="0"> <tr> <td>РУ</td> <td>Дата регистрации</td> <td> 2°C - 8°C</td> </tr> </table>		РУ	Дата регистрации	2°C - 8°C			
РУ	Дата регистрации	2°C - 8°C					

Компоненты набора

Картридж



Наконечник пипетки

Чип идентификационный

Пакет для картриджа с застежкой





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 18 листов.

Генеральный директор
ООО «АВИВИР»

 Куркин Ф.Г.