

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ


НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс" (Assu-Chek® Softclix) к устройству для прокалывания кожи.

Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс" (Accu-Chek® Softclix), 25 шт.




Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс" (Accu-Chek® Softclix), 25 шт.

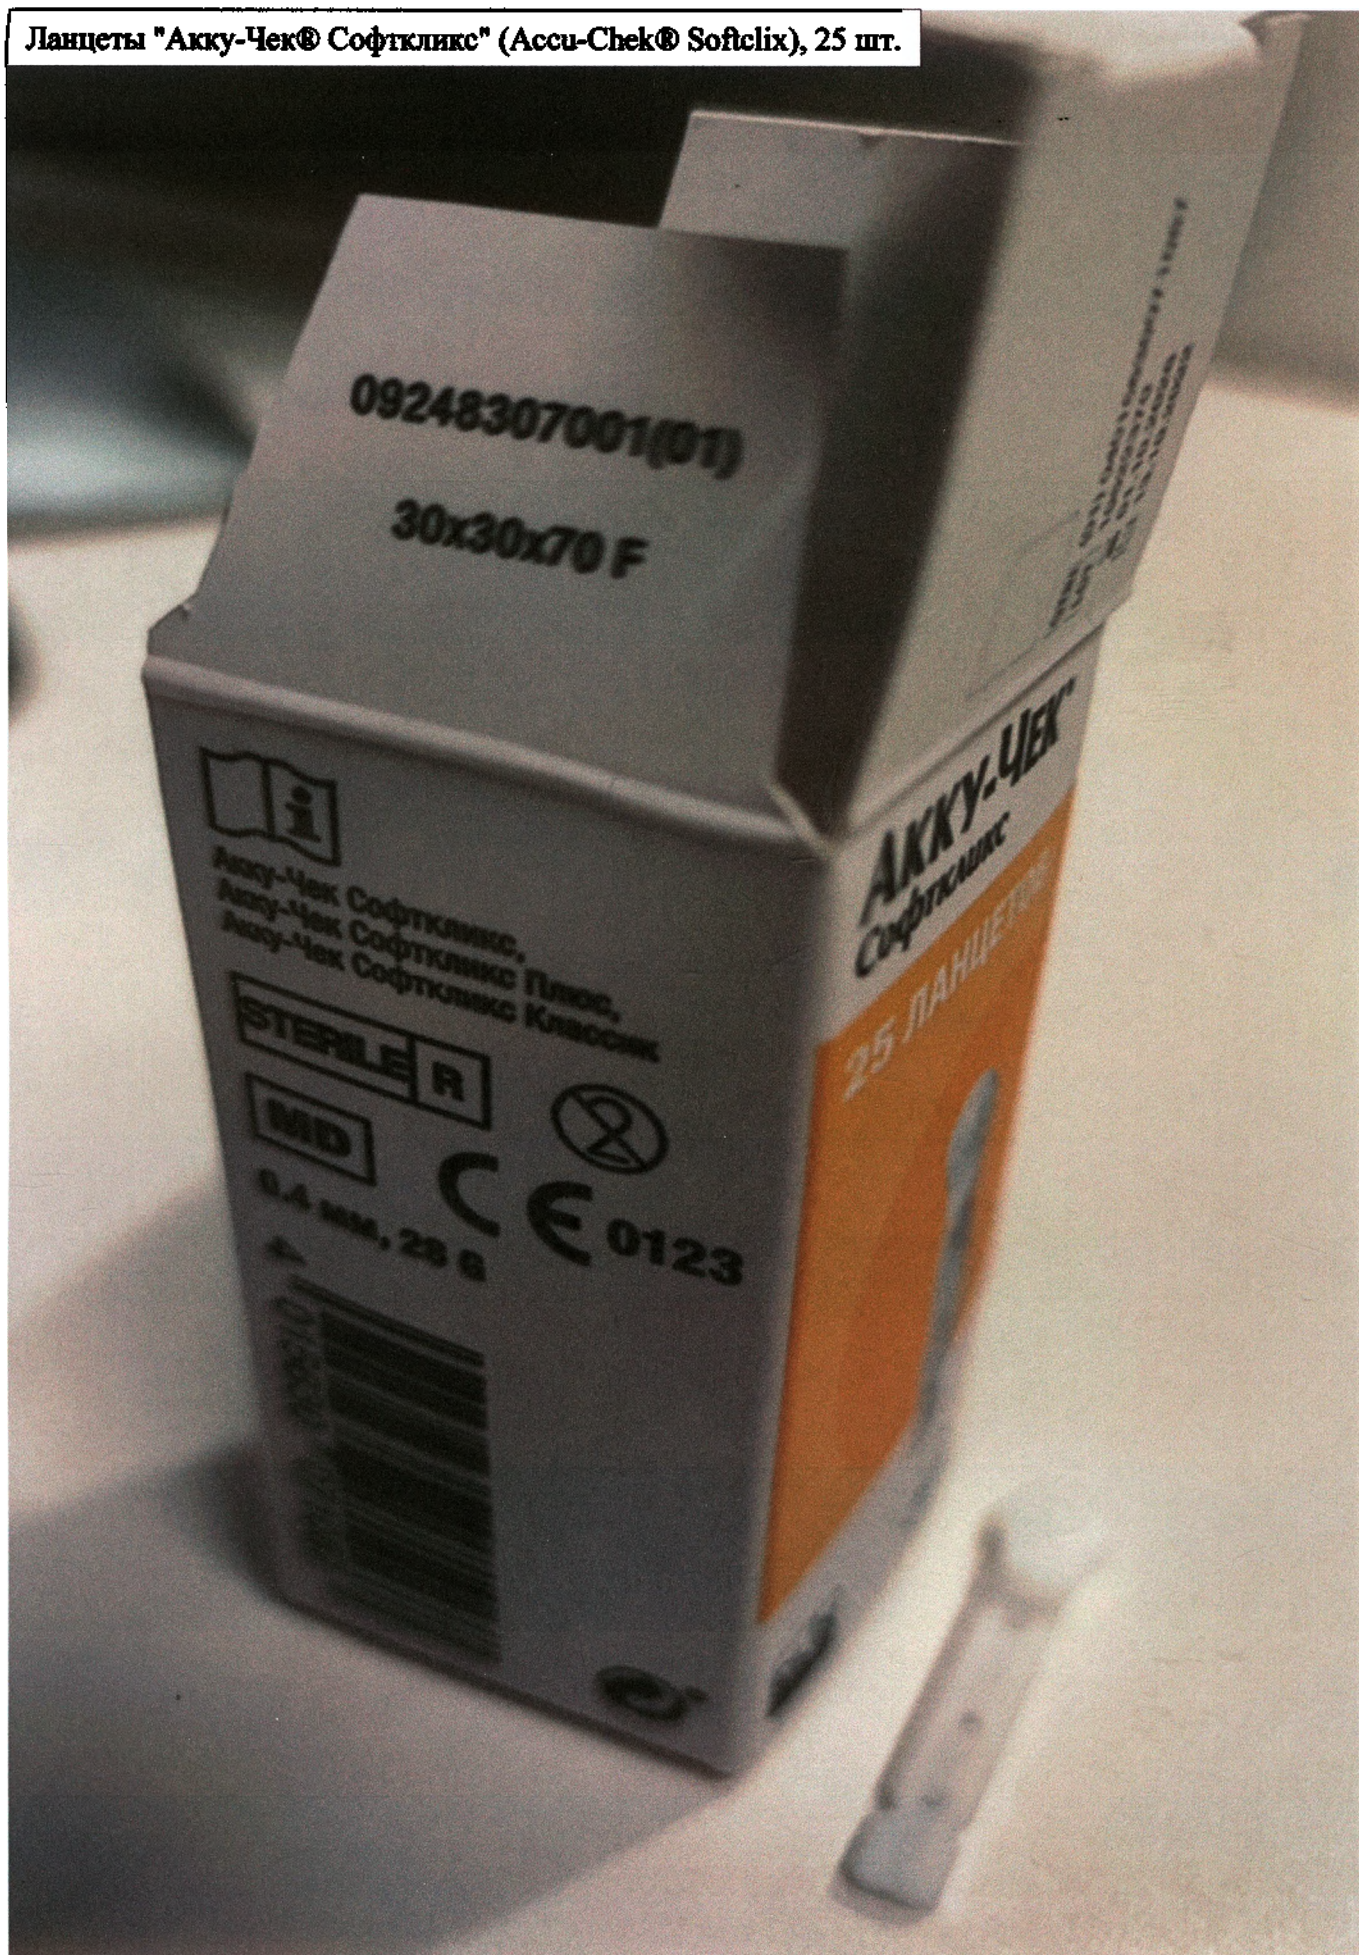


Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс" (Accu-Chek® Softclix), 25 шт.



Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс" (Accu-Chek® Softclix), 25 шт.

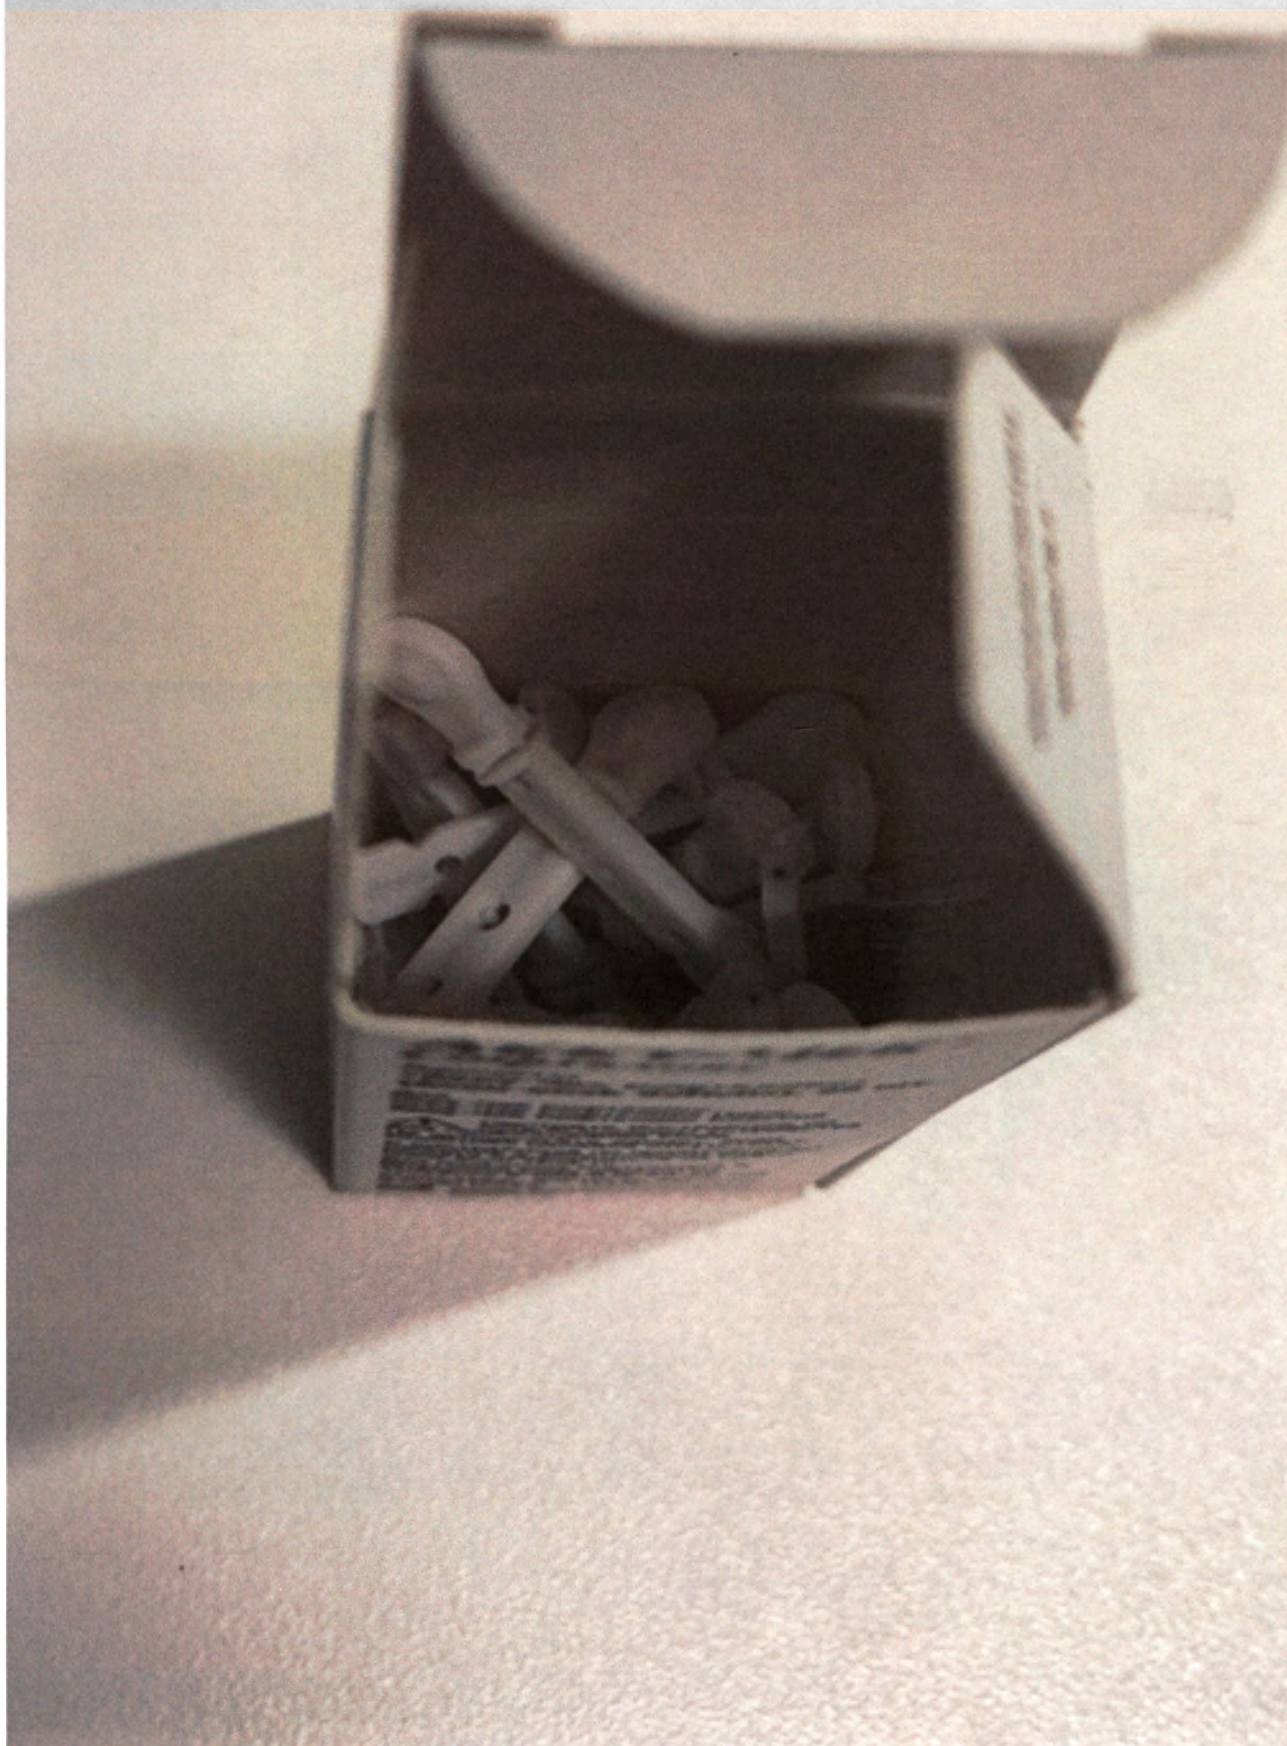

Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс" (Accu-Chek® Softclix), 25 шт.

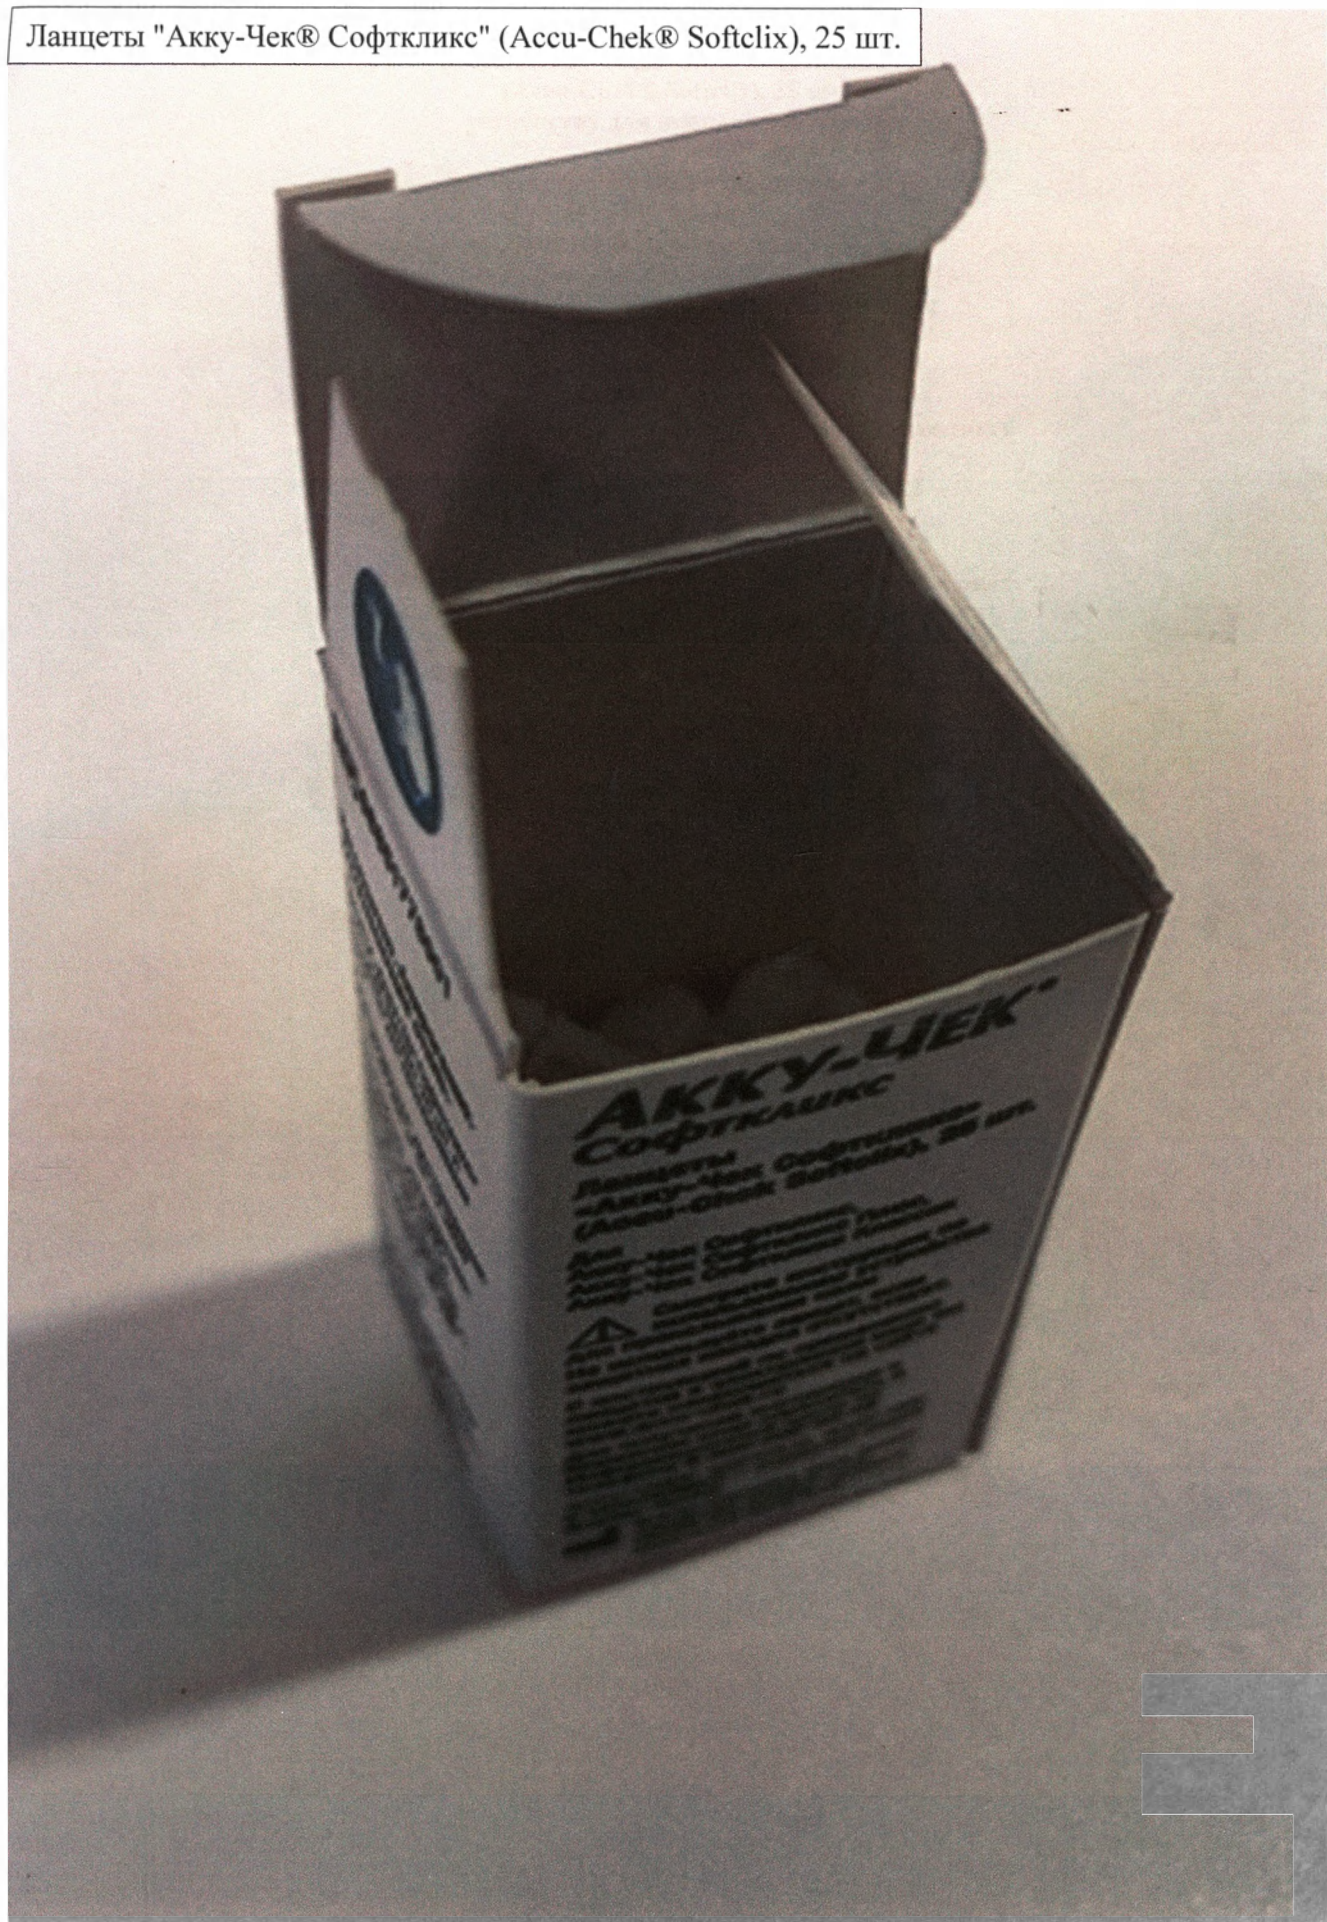

Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс"
(Accu-Chek® Softclix), 25 шт. к
устройству для прокалывания кожи

Регистрационное удостоверение:

№РЗН 2018/7200 от _____

Производитель, изготовитель:

"Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Сандхофер
Штрассе 116, 68305, Мангейм, Германия;

"Эйч Ти Эль-Стрефа Эс. Эй.", улица
Адамовек 7, 95-035, Озорков, Польша

Сделано в Польше

Импортер, уполномоченная организация (претензии):

ООО «Рош Диагностика Рус»,
107031, Москва, Трубная площадь, д.2

Тел: 8-800-200-88-99

Е-mail: info@accu-chek.ru

С инструкциями по применению в электронном виде
вы можете ознакомиться на сайте www.accu-chek.ru


Инструкции по применению на русском языке
на бумажном носителе предоставляются отдельно по запросу.

Обратитесь в Информационный центр
по телефону 8-800-200-88-99.

Кат.номер: 08851778001 RU_098_PL_V1

Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс XL" (Accu-Chek® Softclix XL), 50 шт.



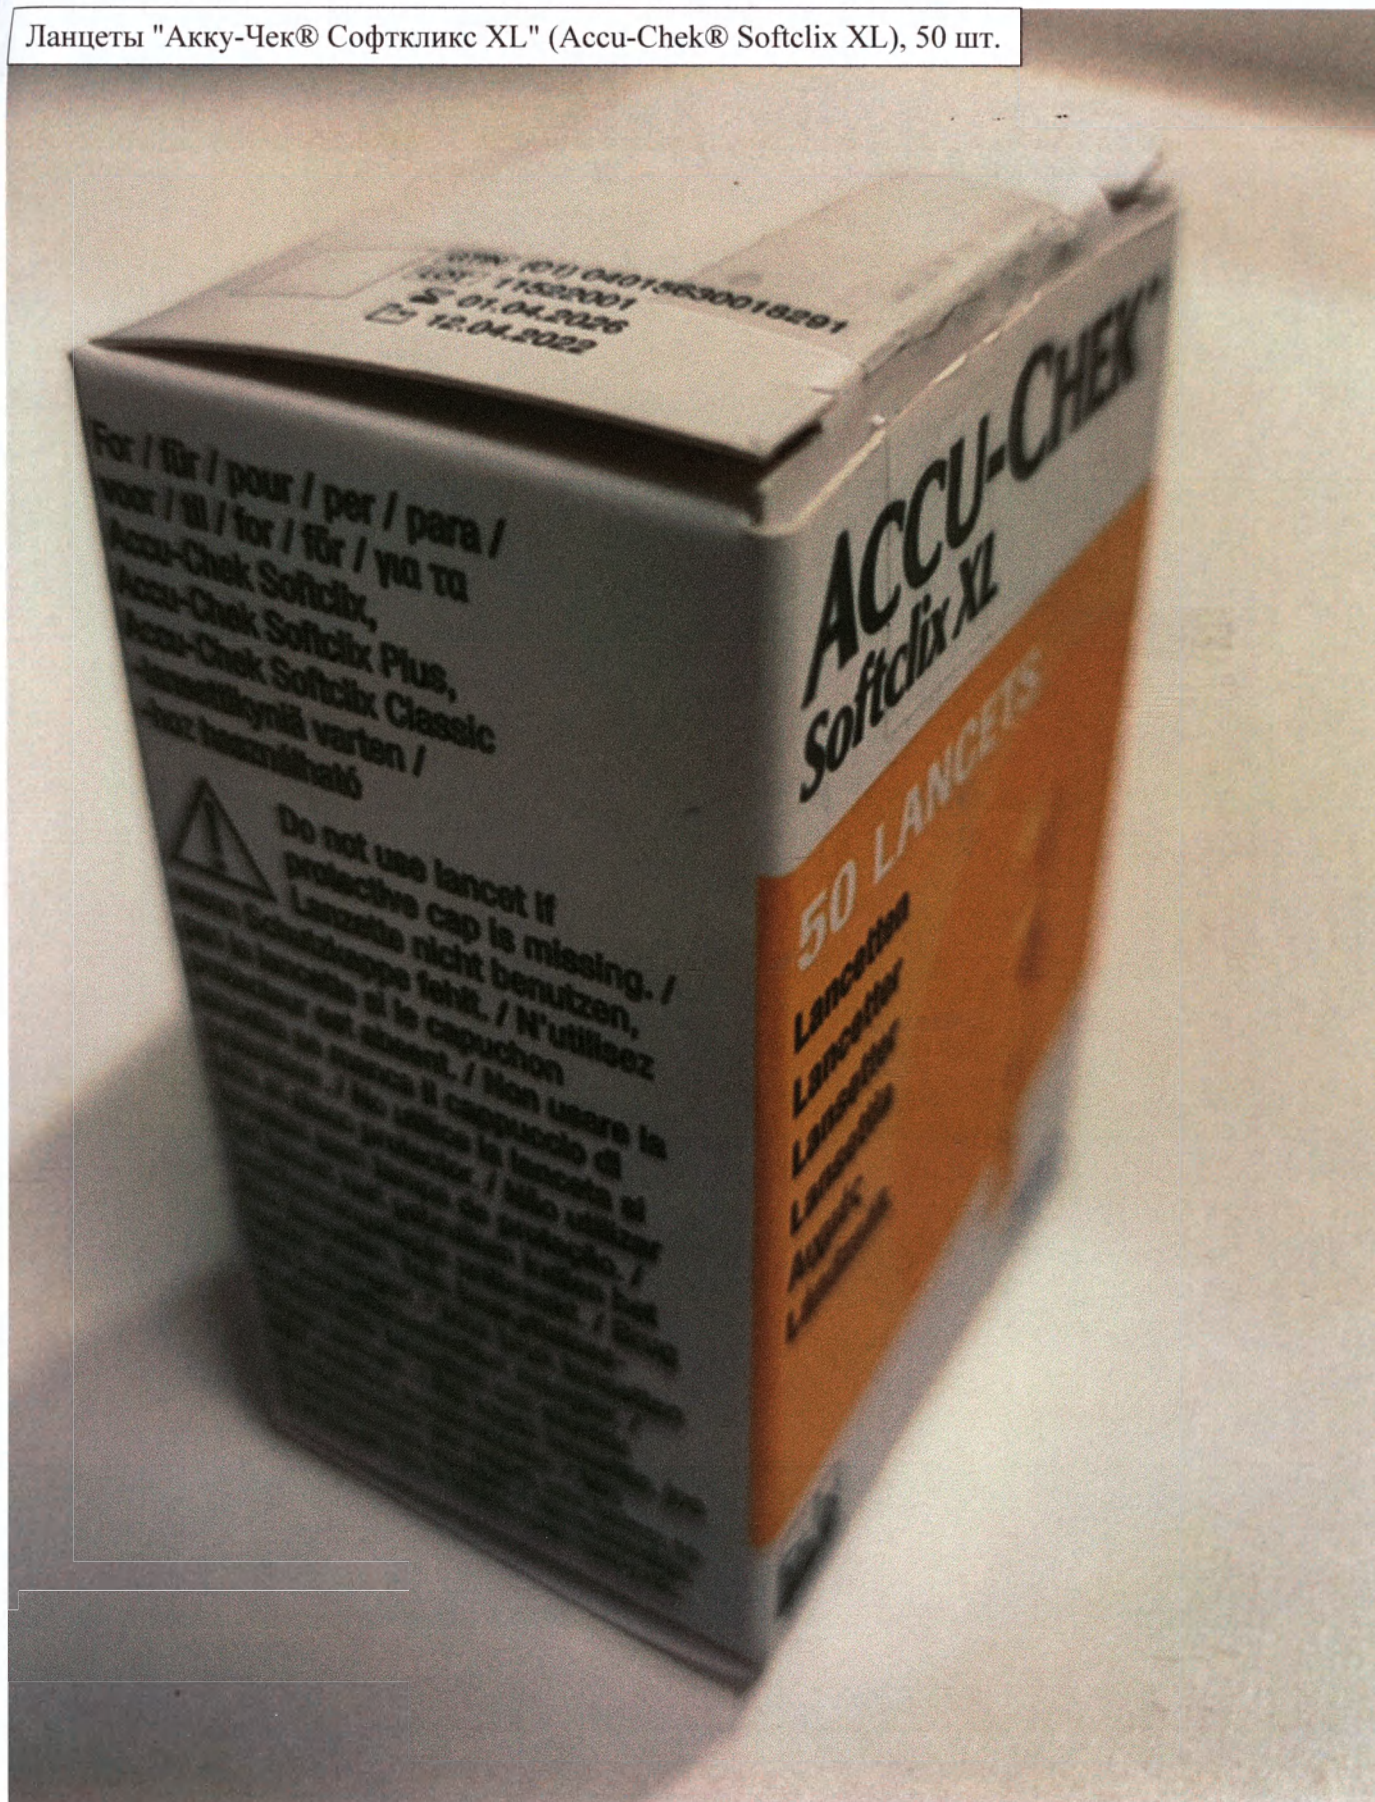

Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс XL" (Accu-Chek® Softclix XL), 50 шт.



Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс XL" (Accu-Chek® Softclix XL), 50 шт.





Макет стикера:

Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс XL"
(Accu-Chek® Softclix XL), 50 шт. к
устройству для прокалывания кожи
Смотрите инструкции по использованию
устройства для прокалывания кожи. Не
используйте ланцет, если защитная насадка
отсутствует. Нетоксично. Апиrogenно.

Нержавеющая сталь

Регистрационное удостоверение:

№РЗН 2018/7200 от _____

Производитель, изготовитель:

"Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Сандхофер
Штрассе 116, 68305, Мангейм, Германия;
"Эйч Ти Эль-Стрефа Эс. Эй.", улица
Адамовек 7, 95-035, Озорков, Польша

Сделано в Польше

С инструкциями по применению в электронном виде
вы можете ознакомиться на сайте www.accu-chek.ru

Инструкции по применению на русском языке
на бумажном носителе предоставляются отдельно по запросу.

Обратитесь в Информационный центр
по телефону 8-800-200-88-99

Импортер, уполномоченная организация (претензии):

ООО «Рош Диагностика Рус»,
107031, Москва, Трубная площадь, д.2
Тел: 8-800-200-88-99


Е-mail: info@accu-chek.ru

Год производства: XXXX

Кат.номер: 03307514001 RU_003_PL_V0

Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс" (Accu-Chek® Softclix), 200 шт.



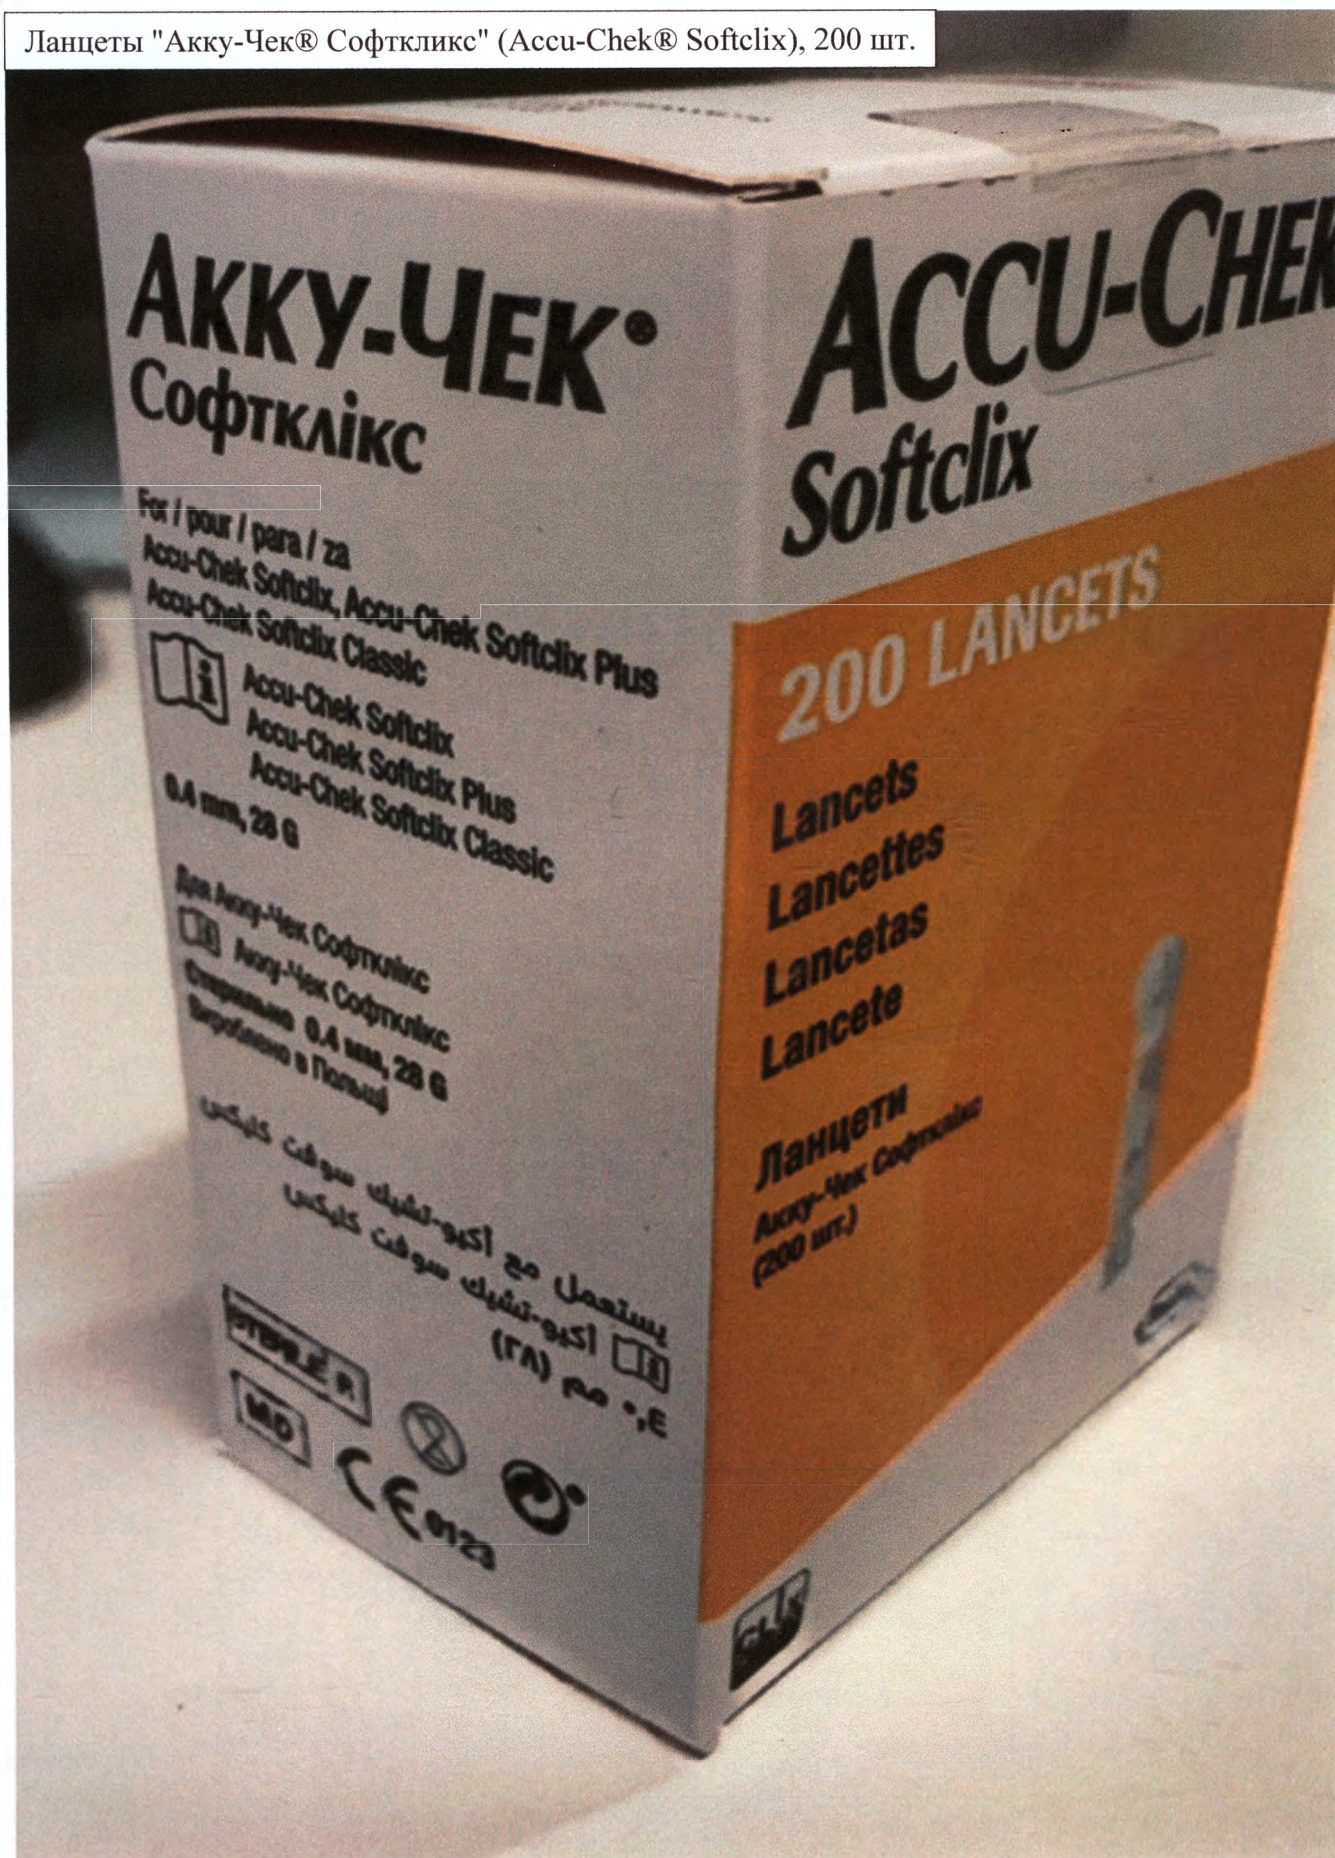

أكيو-تشيك سوفت كليक्स



Do not use lancet if protective cap is missing. / N'utilisez pas la lancette si le capuchon protecteur est absent. / No utilice la lanceta si falta el disco protector. / Não utilize lancetas sem tampa de proteção. / Ne koristite lancetu ako joj nedostaje zaštitna kapica. / Не використовуйте ланцет, якщо відсутній захисний ковпачок. /

لا تستخدم إبرة الوخز إذا كان الغطاء الواقى مفقوداً.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX, CLIXMOTION and AKKU-CHEK are trademarks of Roche.



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

Made in Poland

CLIXMOTION و SOFTCLIX و ACCU-CHEK
و AKKU-CHEK هي علامات تجارية تملكها Roche.
روش ديايبتيس كير جي إم بي إل
شارع ساندهوفر 116
68305 مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com
صنع في بولندا

Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс" (Accu-Chek® Softclix), 200 шт.

ACCU-CHEK

Softclix

200 LANCETS

Lancets

Lancettes

Lancetas

Lancete

إبر الوخز



Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс" (Accu-Chek® Softclix), 200 шт.



Макет стикера:

Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс"
(Accu-Chek®Softclix), 200 шт. к
Устройству для прокалывания кожи
Смотрите инструкции по использованию
Устройства для прокалывания кожи. Не
Используйте ланцет, если защитная насадка
Отсутствует. Нетоксично. Апирогенно.

Нержавеющая сталь

Регистрационное удостоверение:

№РЗН 2018/7200 от _____

Производитель, изготовитель:

"Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Сандхофер
Штрассе 116, 68305, Мангейм, Германия;
"Асахи Полислайдер Компани, Лимитед",
Окаяма Кус Планта 860-2 Мисаки, Манива-ши,
Окаяма, 719-3226 Япония

Сделано в Японии

С инструкцией по применению ланцетов
в электронном виде вы можете ознакомиться
на сайте www.accu-chek.ru.

Для получения инструкции в бумажном виде
обратитесь в Информационный центр по
телефону 8-800-200-88-99

Импортер, уполномоченная организация (претензии):

ООО «Рош Диагностика Рус»,
107031, Москва, Трубная площадь, д.2
Тел: 8-800-200-88-99

E-mail: info@accu-chek.ru

Кат.номер: 03307484200

RU_002_JP_V0

**Ланцеты "Акку-Чек® Софткликс"
(Accu-Chek® Softclick), 200 шт. к
устройству для прокалывания кожи
Смотрите инструкции по использованию
устройства для прокалывания кожи. Не
используйте ланцет, если защитная насадка
отсутствует. Нетоксично. Апиrogenно.**

Нержавеющая сталь

Регистрационное удостоверение:

№РЗН 2018/7200 от _____

Производитель, изготовитель:

**"Рош Диабете Кеа ГмбХ", Сандхофер
Штрассе 116, 68305, Мангейм, Германия;**

**"Эйч Ти Эль-Стрефа Эс. Эй.", улица
Адамовек 7, 95-035, Озorkов, Польша**

Сделано в Польше

**С инструкцией по применению ланцетов
в электронном виде вы можете ознакомиться
на сайте www.accu-check.ru.**

**Для получения инструкции в бумажном виде
обратитесь в Информационный центр по
телефону 8-800-200-88-99**

Импортёр, уполномоченная организация (претензии):

ООО «Рош Диагностика Рус»,

107031, Москва, Трубная площадь, д.2

Тел: 8-800-200-88-99

E-mail: info@accu-check.ru

Год производства: XXXX

Кат.номер: 03307484200 RU_002_PL_V0

Всего пронумеровано,
гашено и
скреплено печатью
20
листа (ов)

На доверенности
от 30.01.2023 г.

