



УТВЕРЖДАЮ
Специалист по регистрации
ООО «Штрауманн»

М.А. Гребенкина
М.П.


2024 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия


«Компоненты ортопедические CF временные стерильные»


Заглушка CF стерильная NP



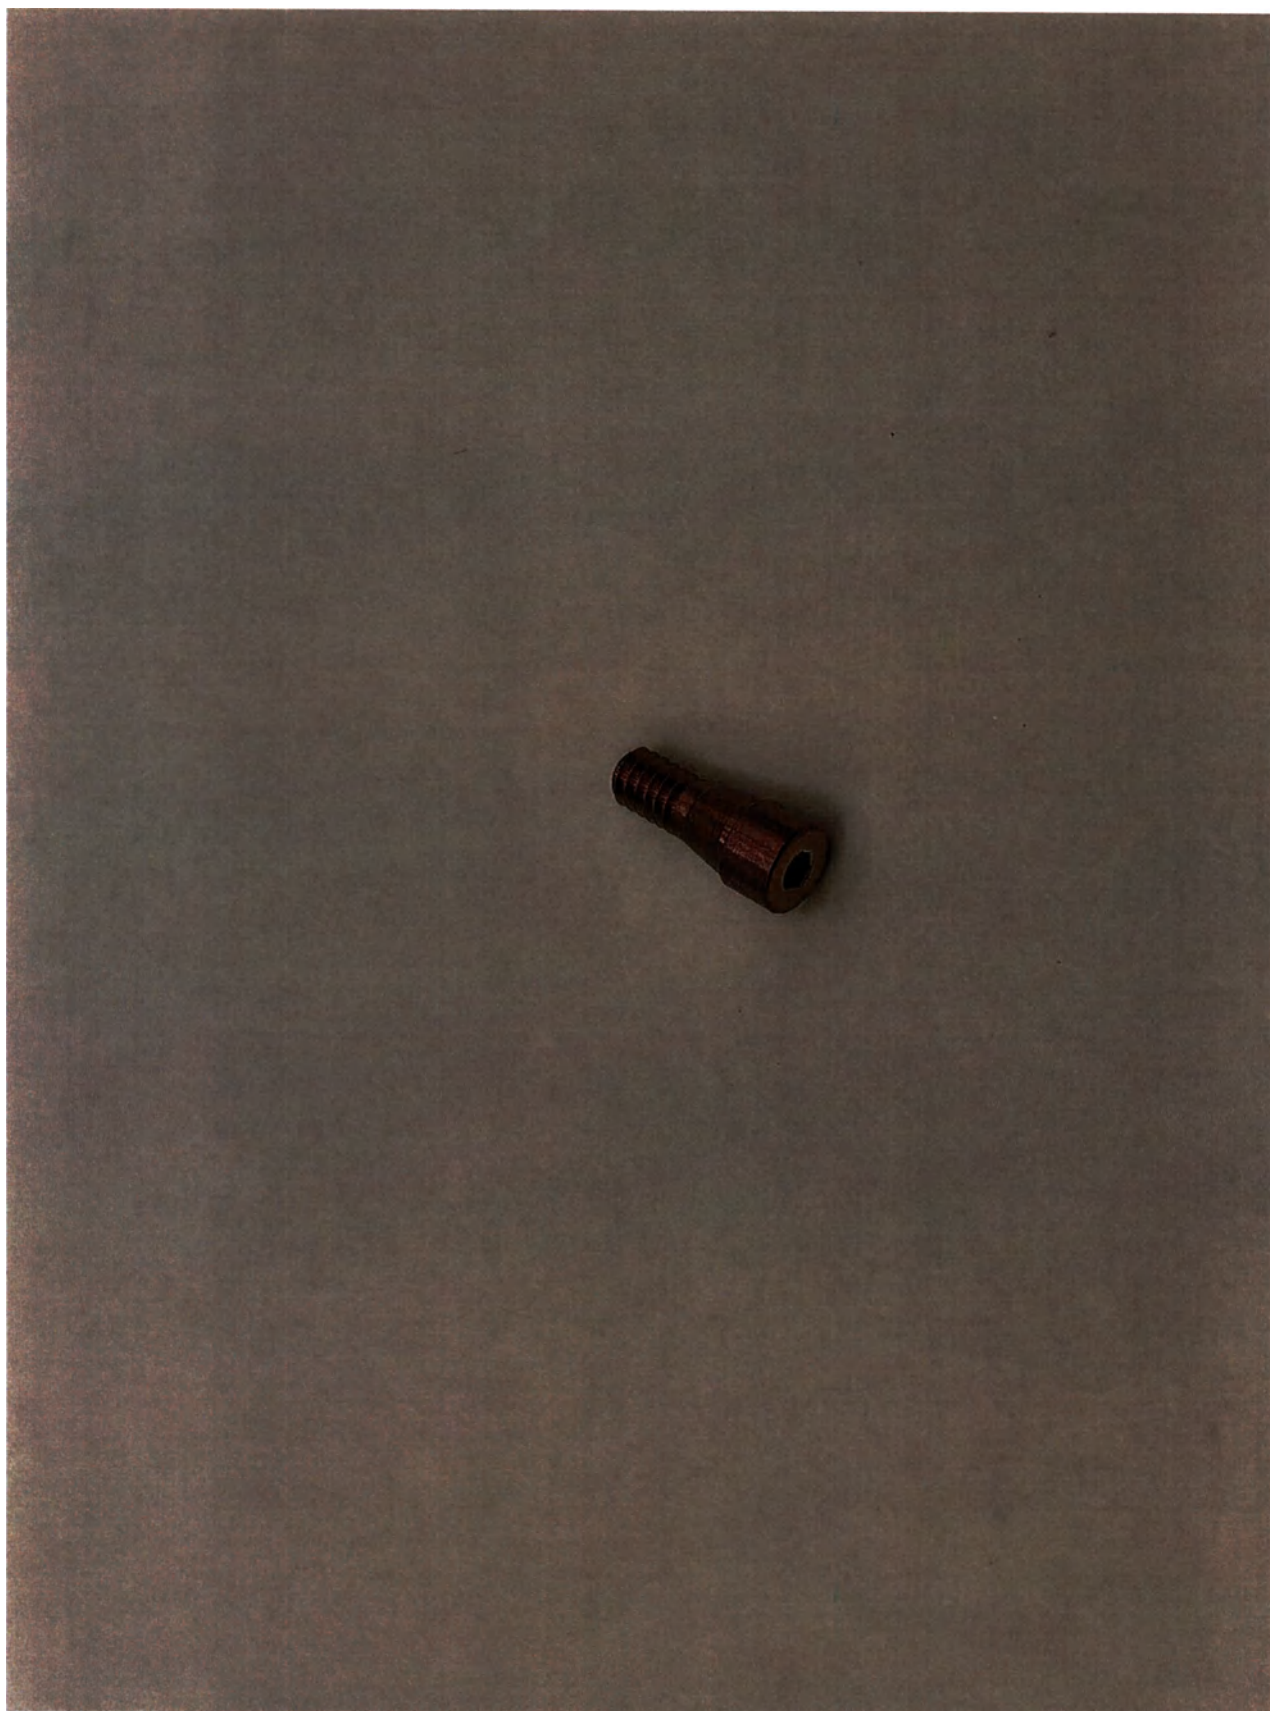


Заглушка CF стерильная NP, высота десны 2 мм

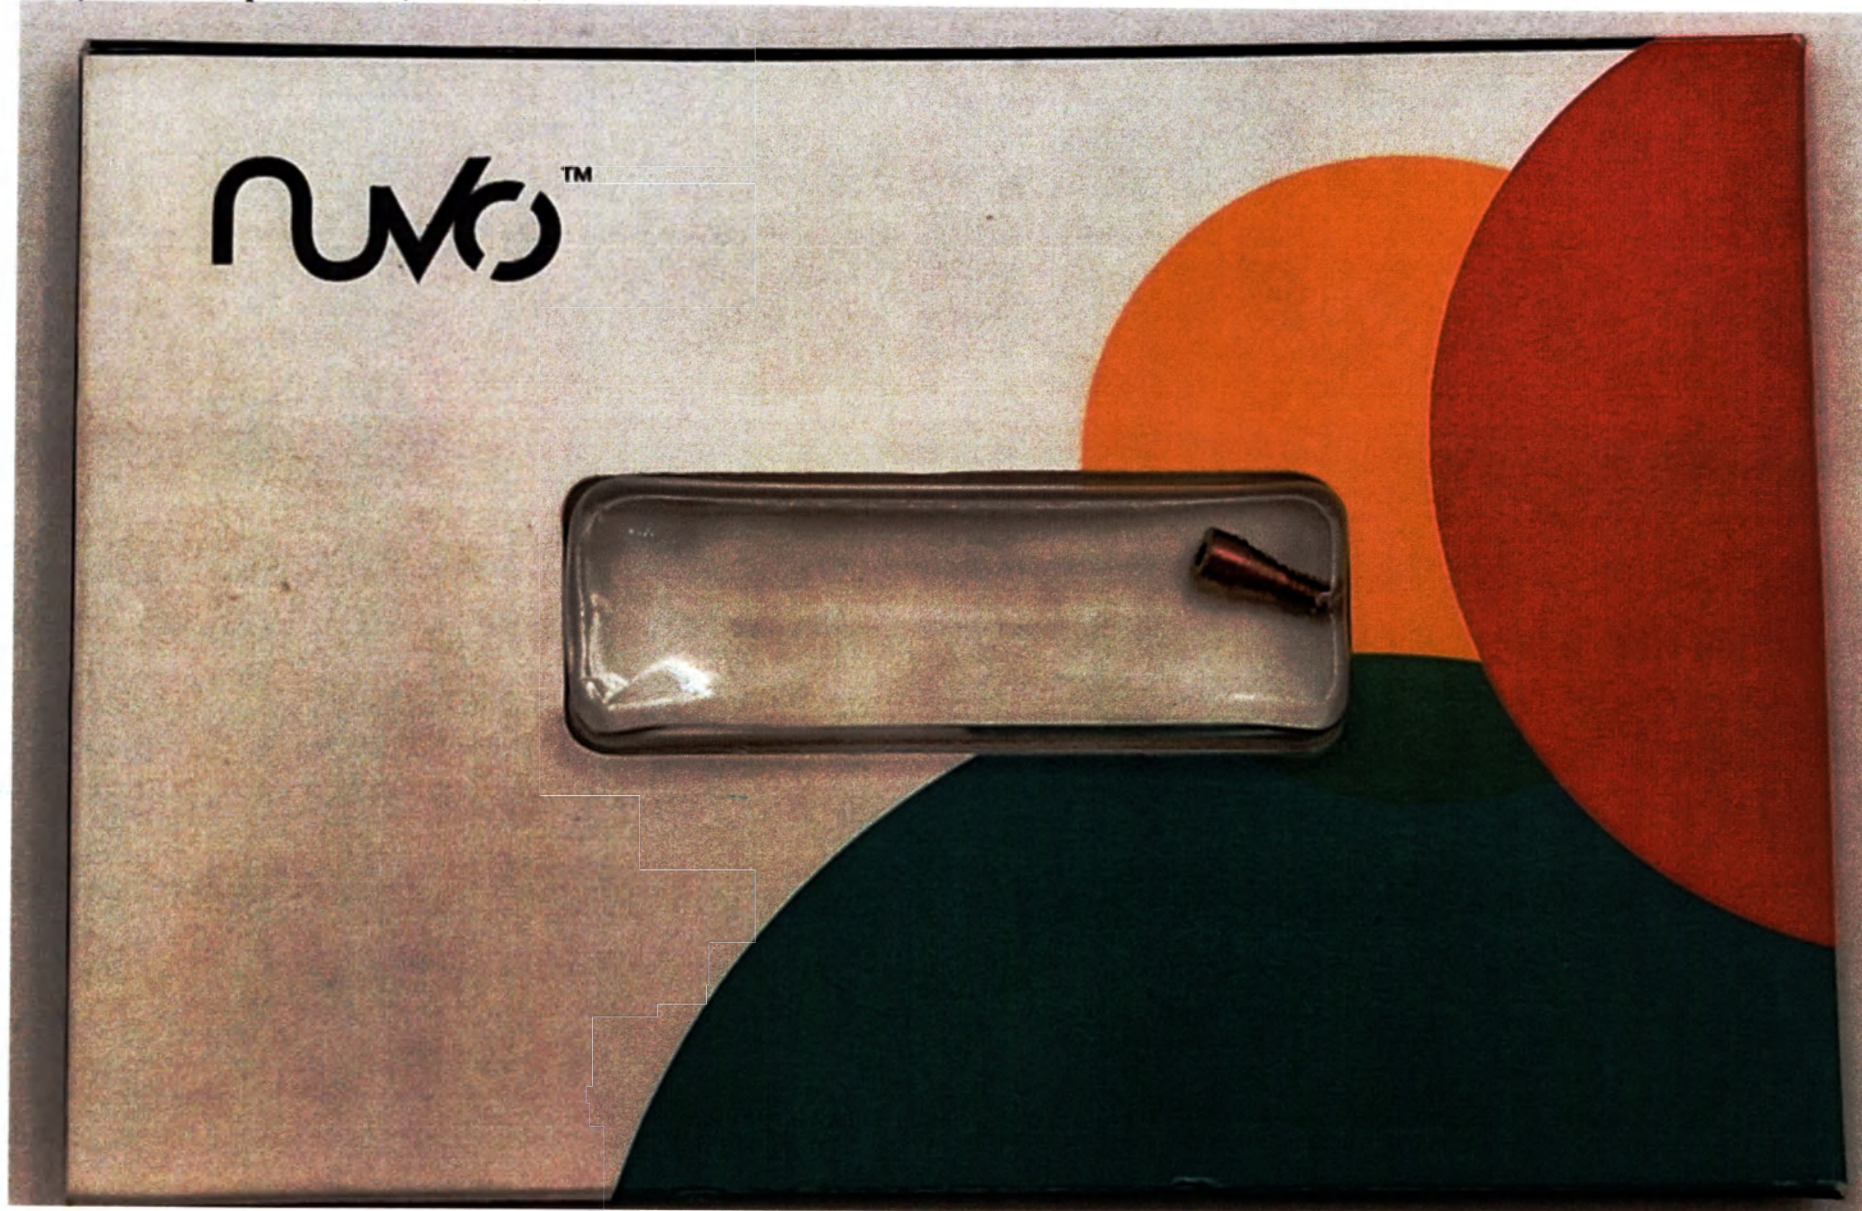

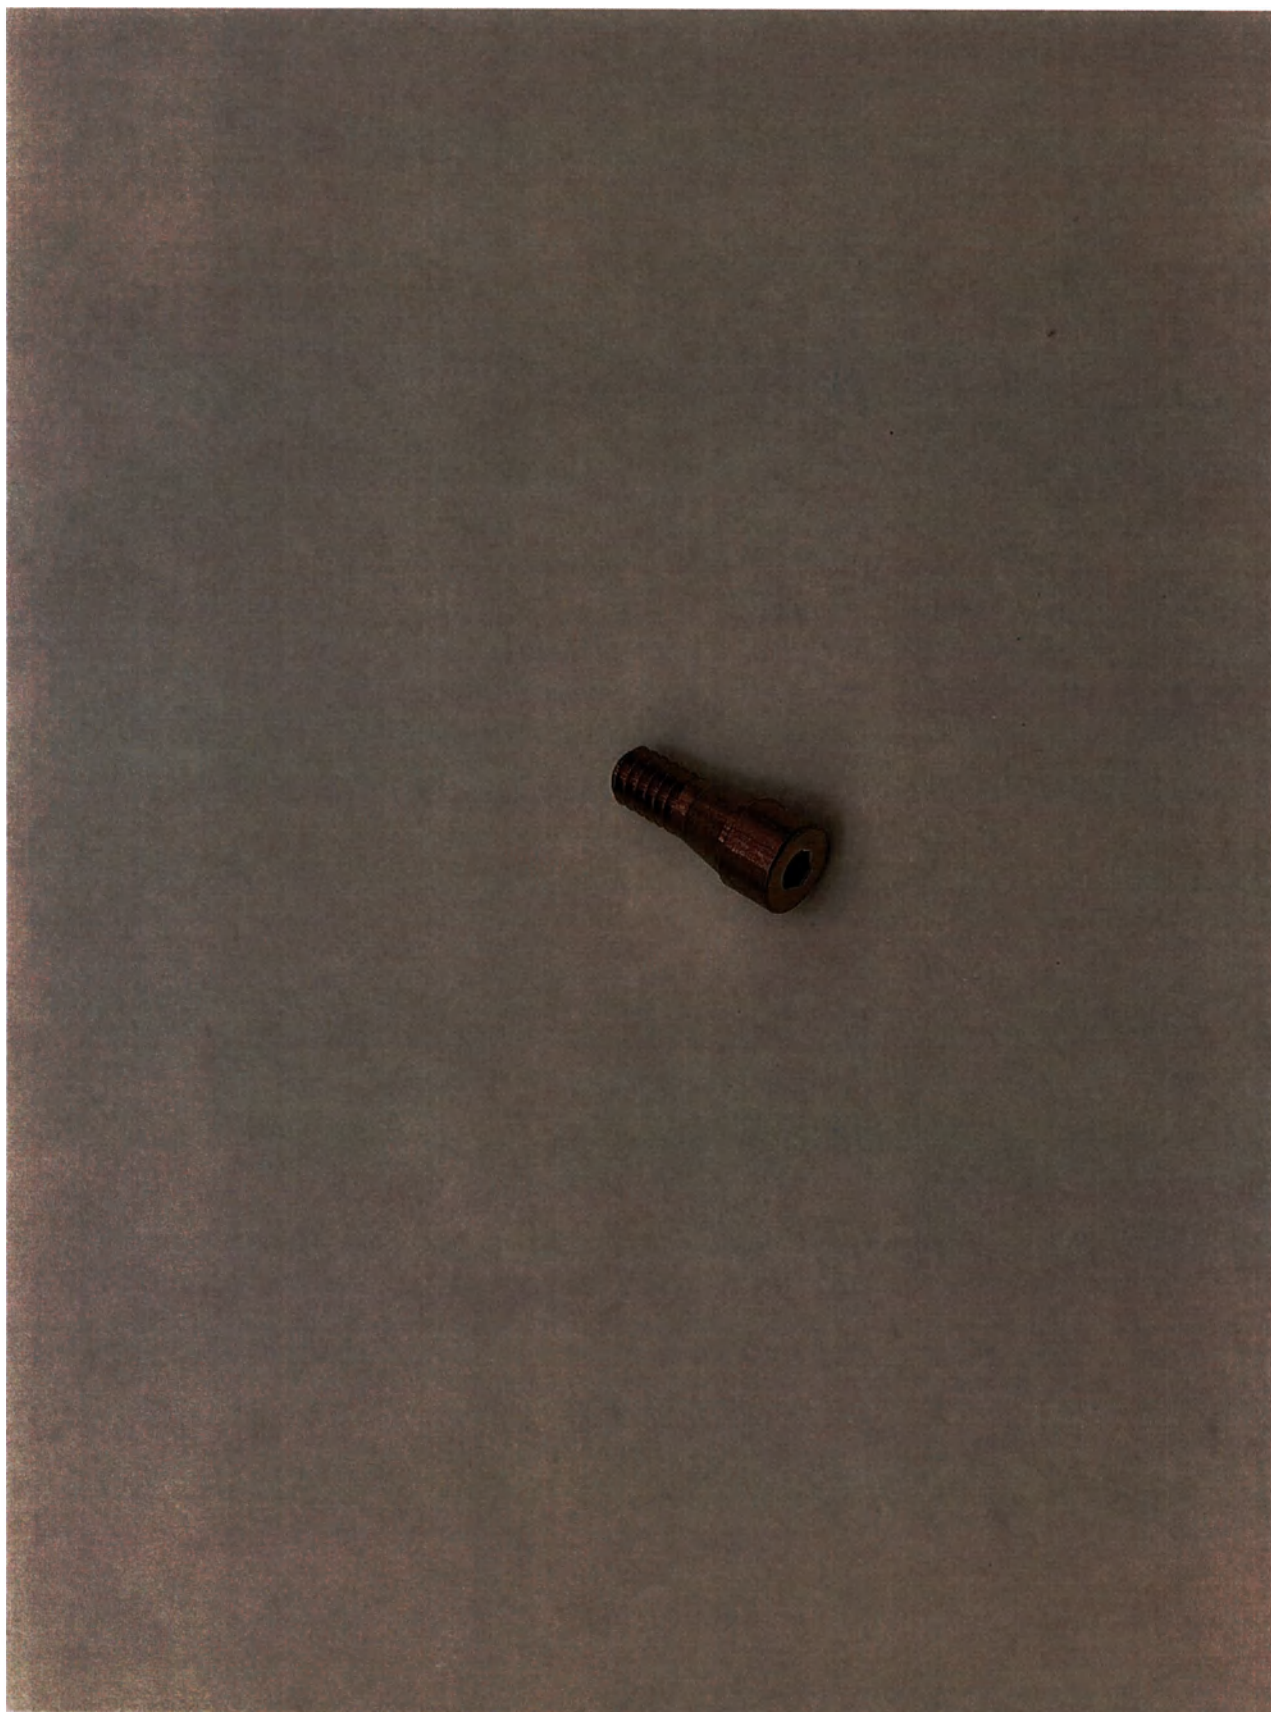


Заглушка CF стерильная SP

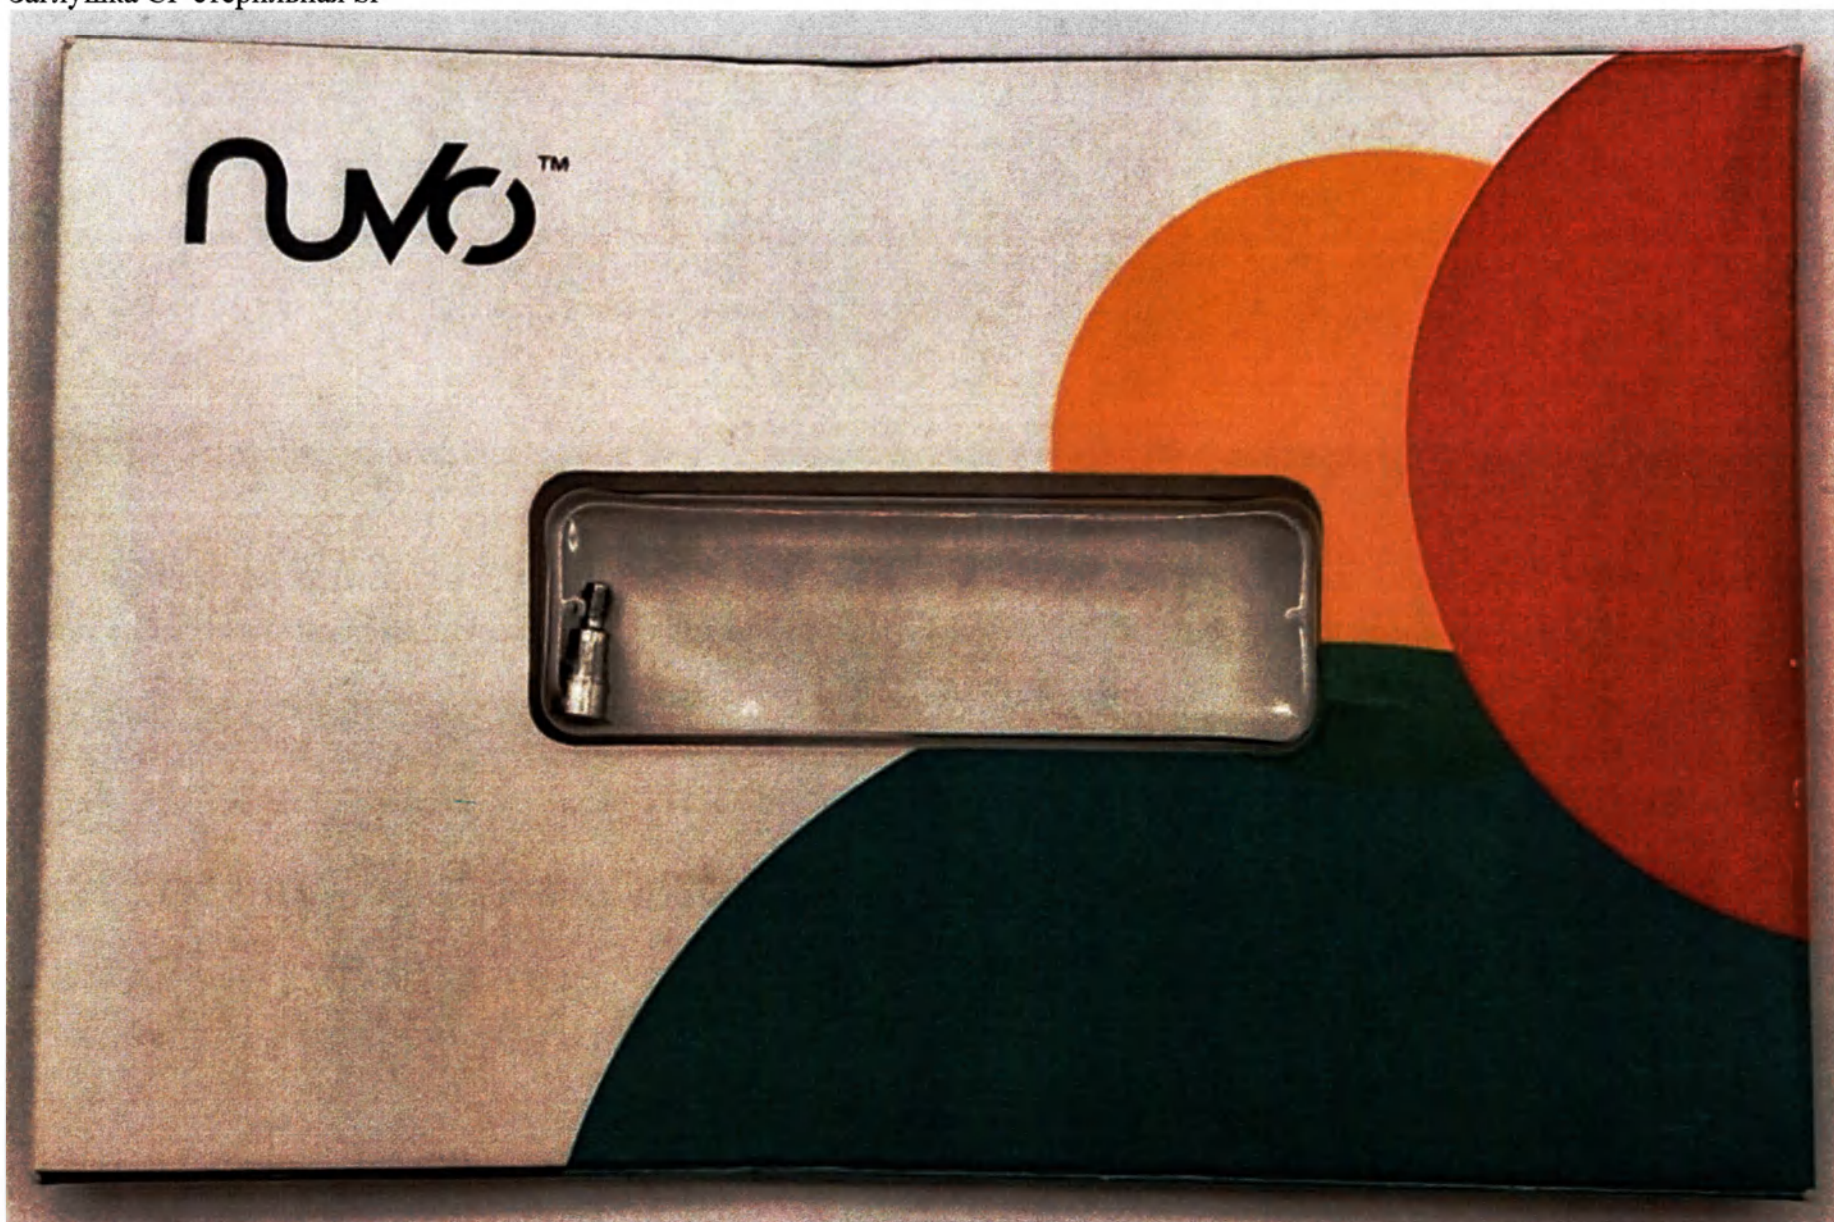



Заглушка CF стерильная SP, высота десны 2 мм

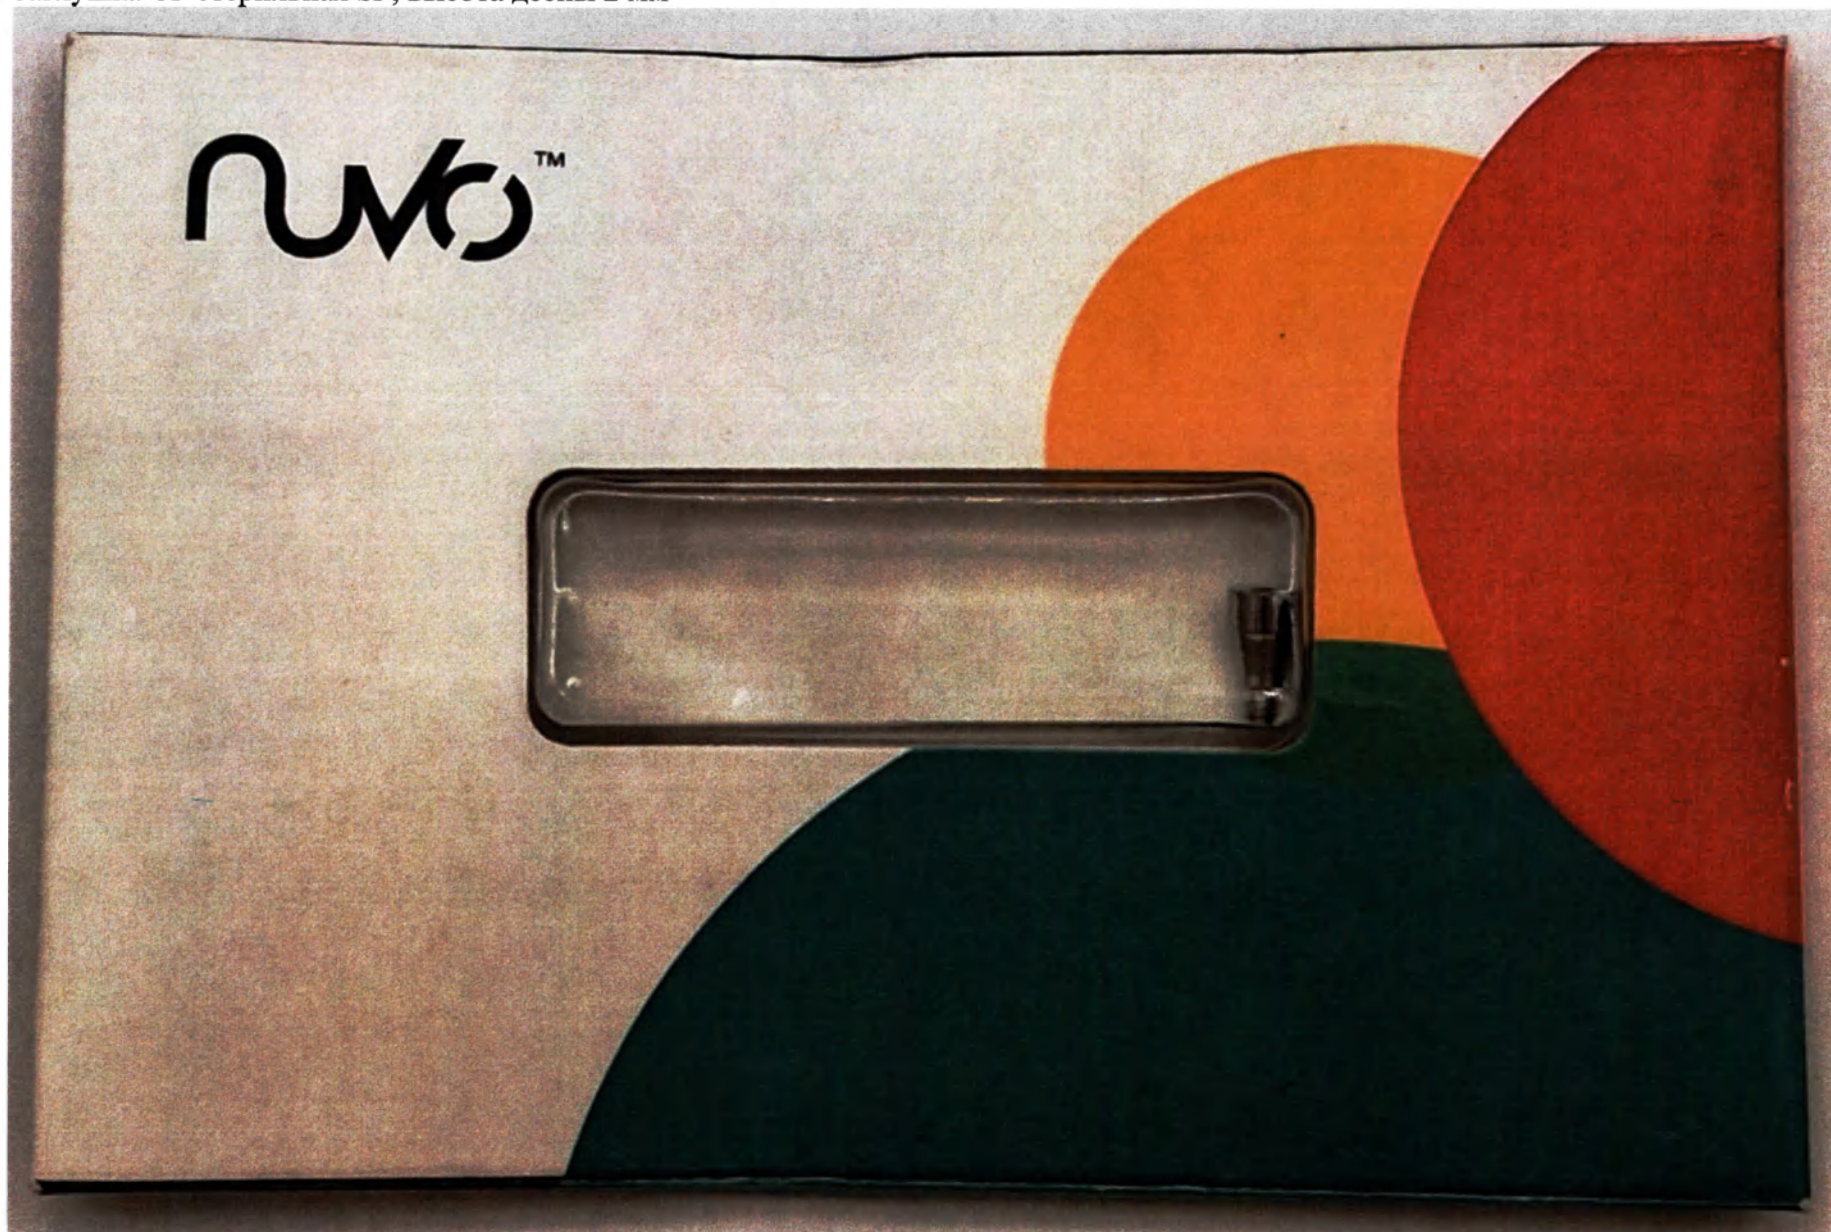




Формирователь десны CF стерильный NP диаметр 3,5 мм, высота десны 1 мм






Формирователь десны CF стерильный NP диаметр 3,5 мм, высота десны 2 мм

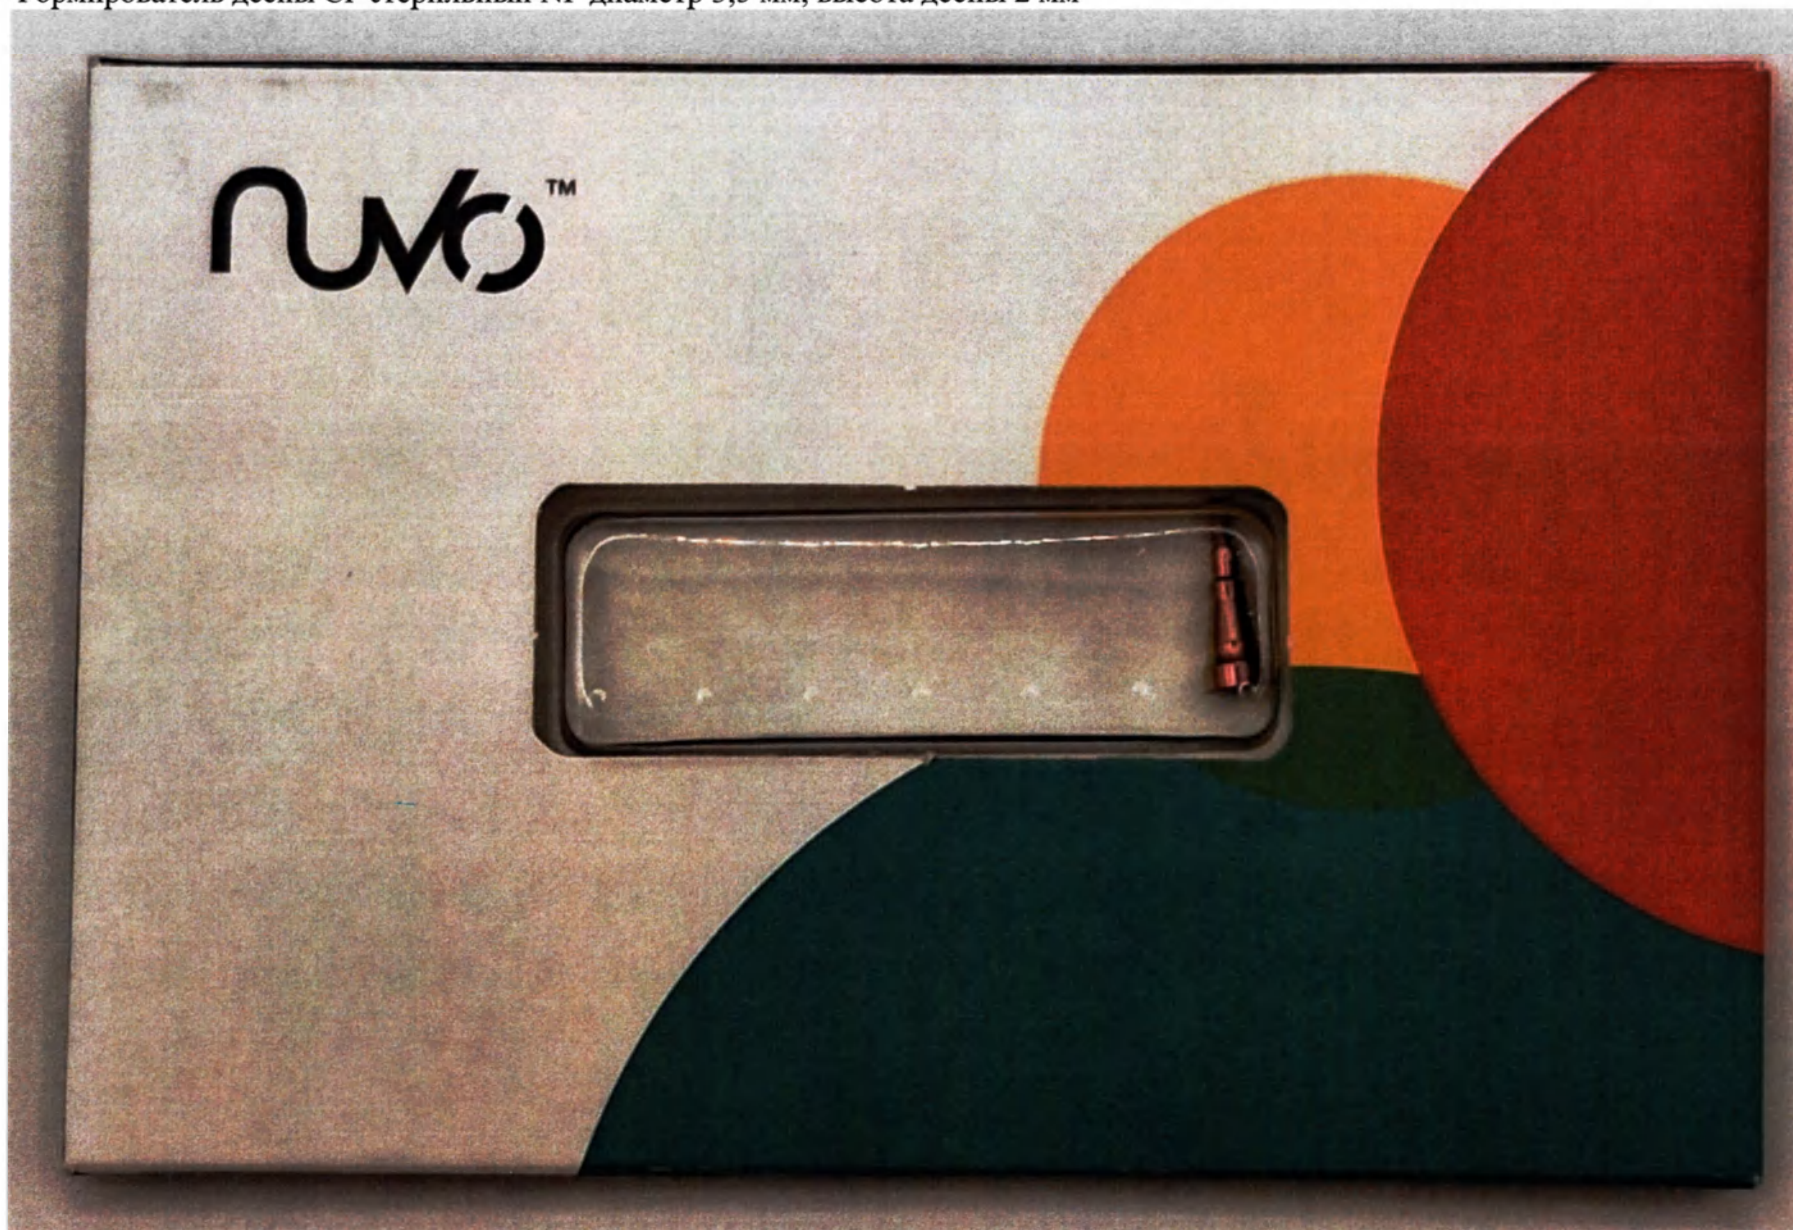




Формирователь десны CF стерильный NP диаметр 3,5 мм, высота десны 3 мм

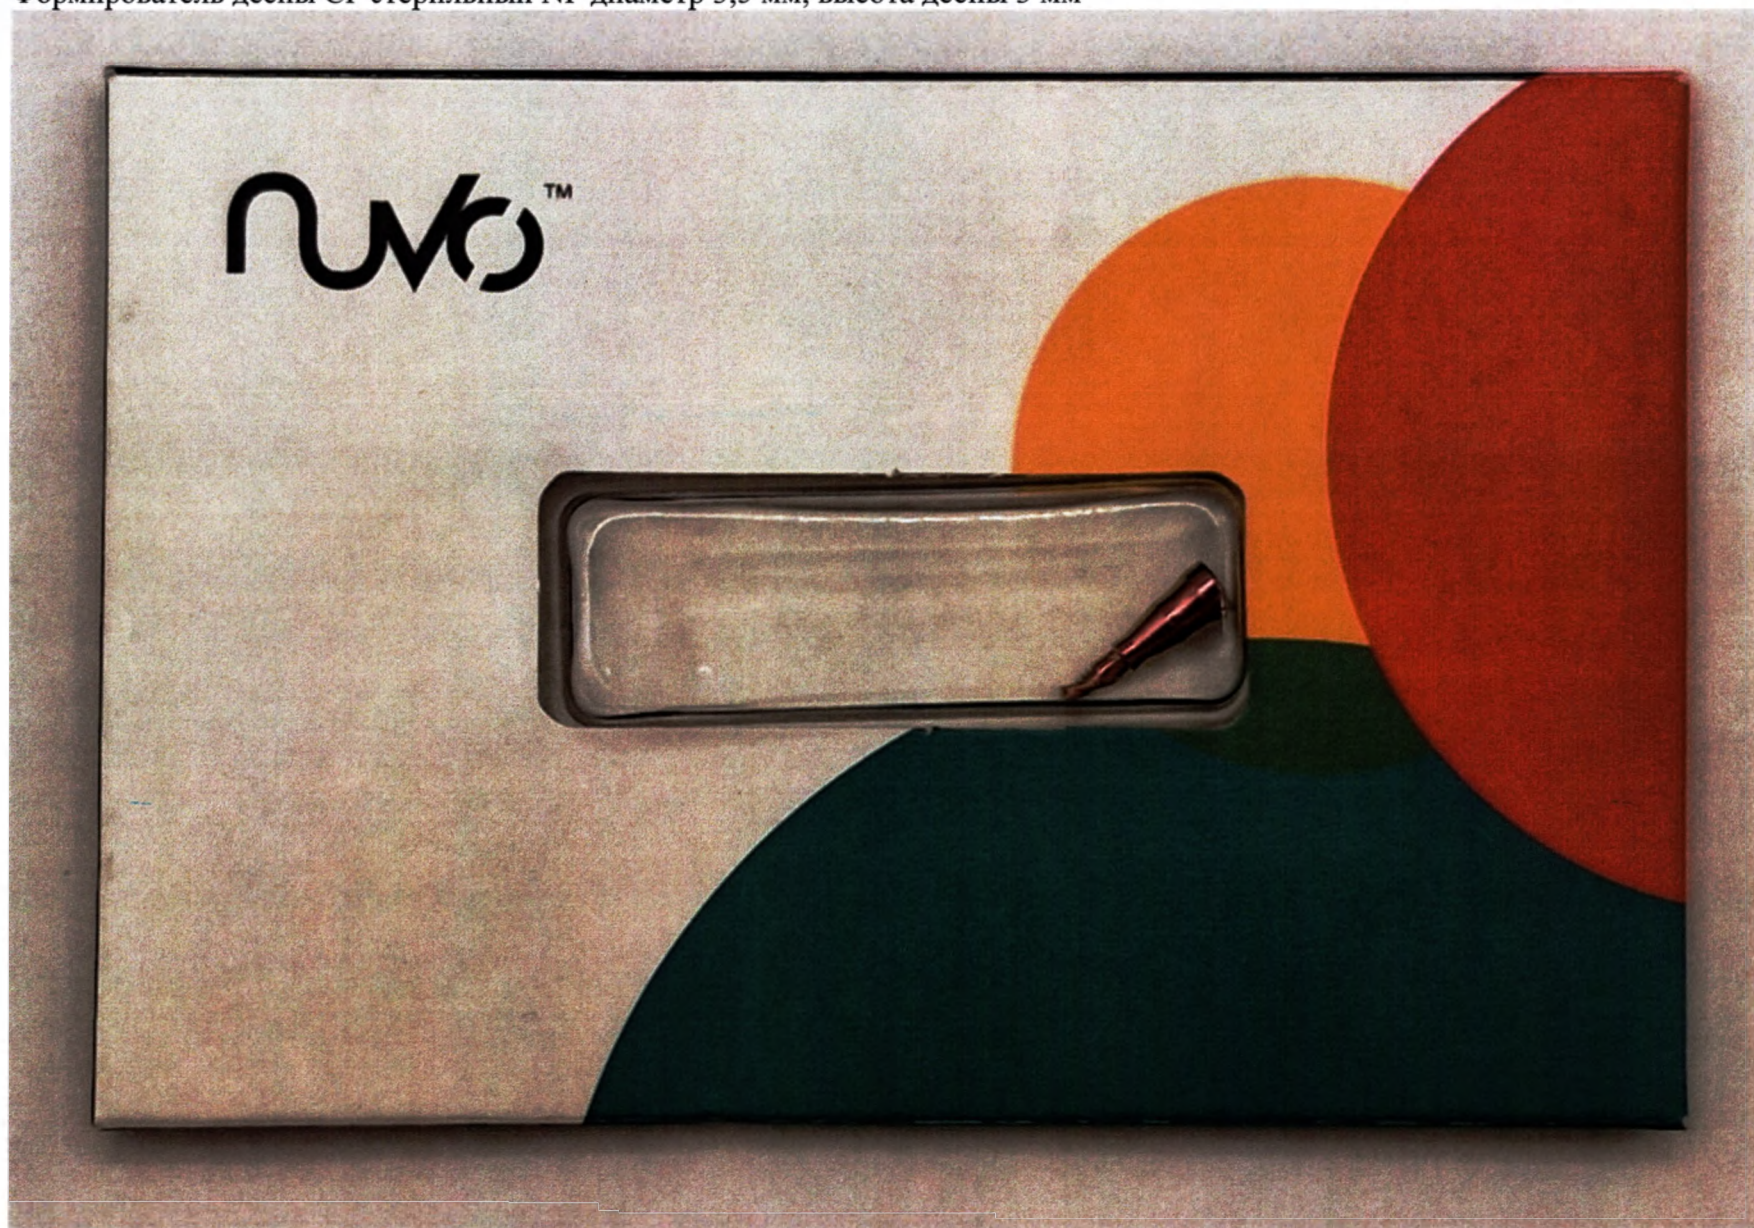



Формирователь десны CF стерильный NP диаметр 3,5 мм, высота десны 4 мм



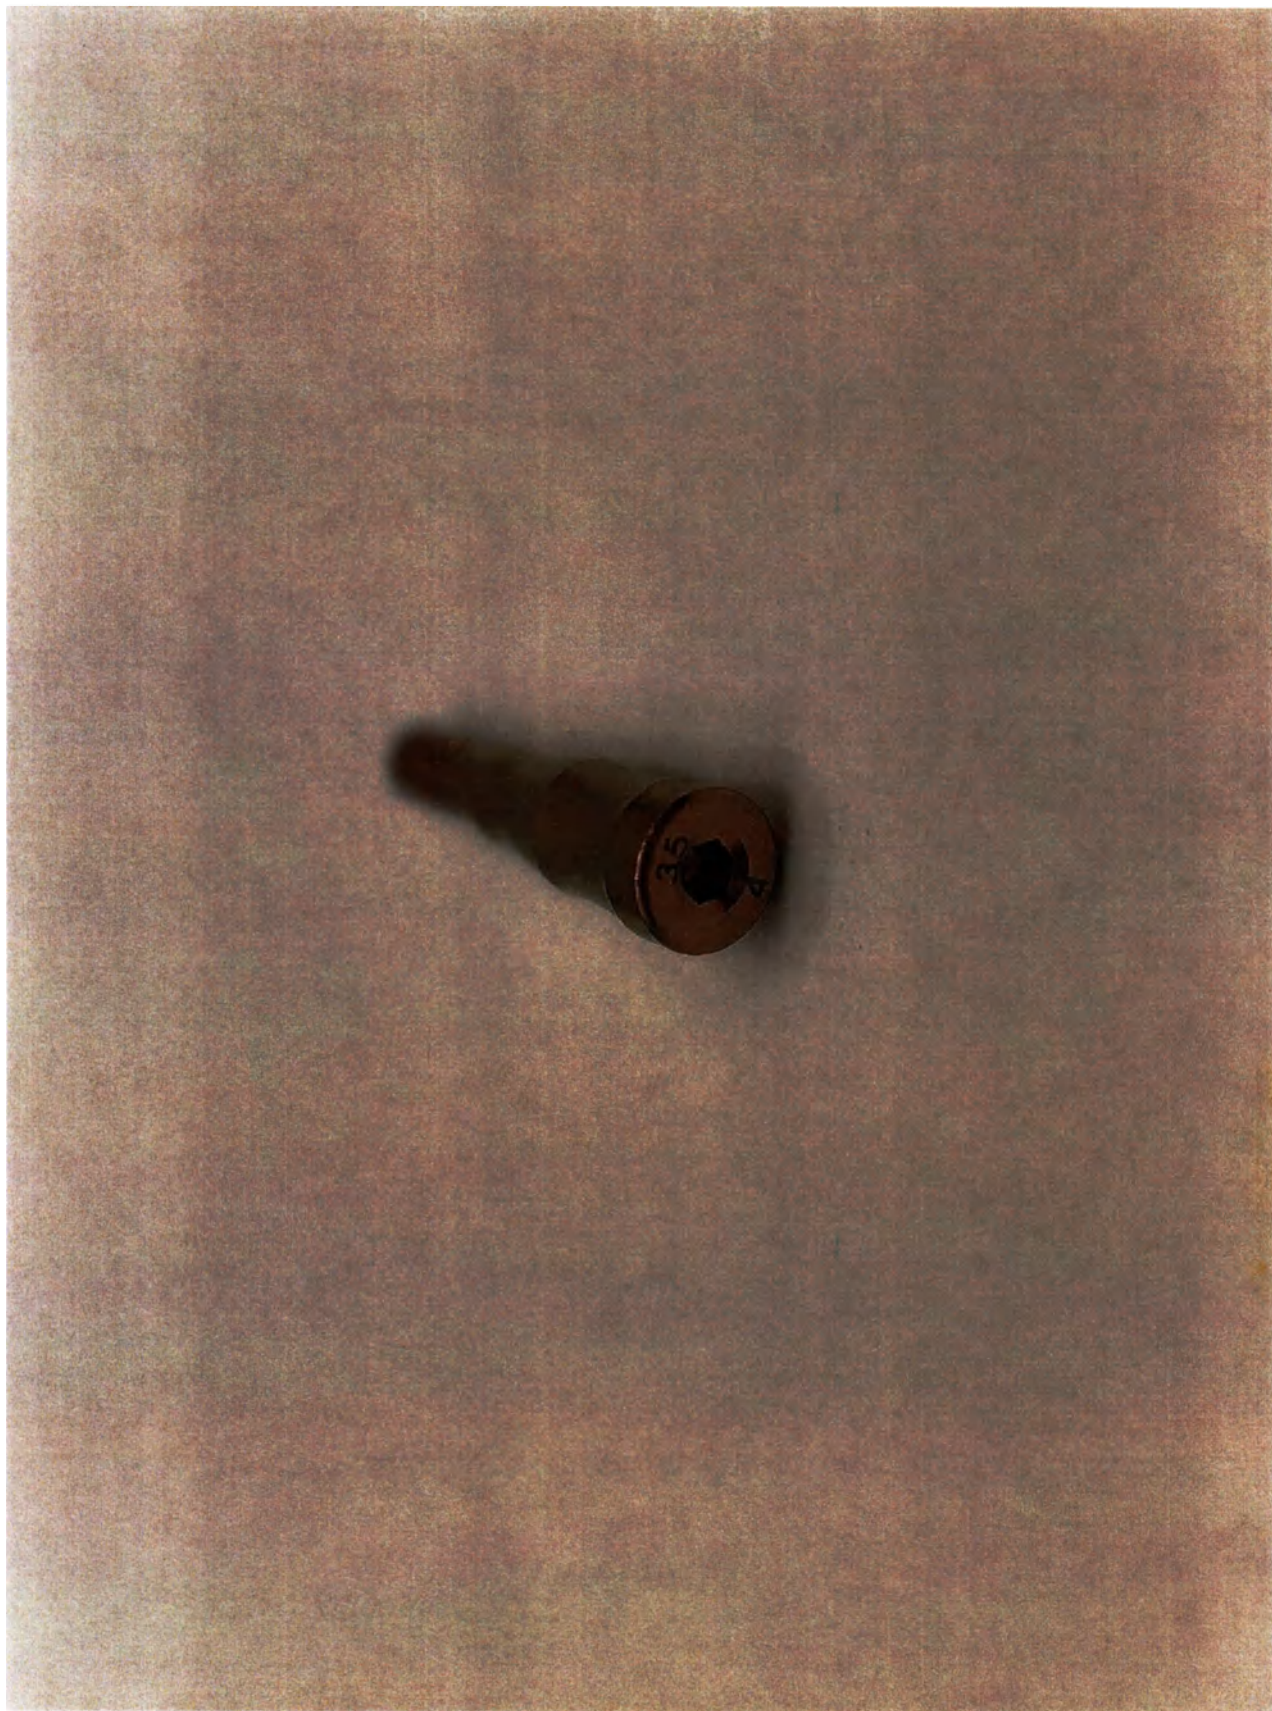

Формирователь десны CF стерильный NP диаметр 3,5 мм, высота десны 5 мм





Формирователь десны CF стерильный NP диаметр 4,5 мм, высота десны 1 мм






Формирователь десны CF стерильный NP диаметр 4,5 мм, высота десны 2 мм





Формирователь десны CF стерильный NP диаметр 4,5 мм, высота десны 3 мм

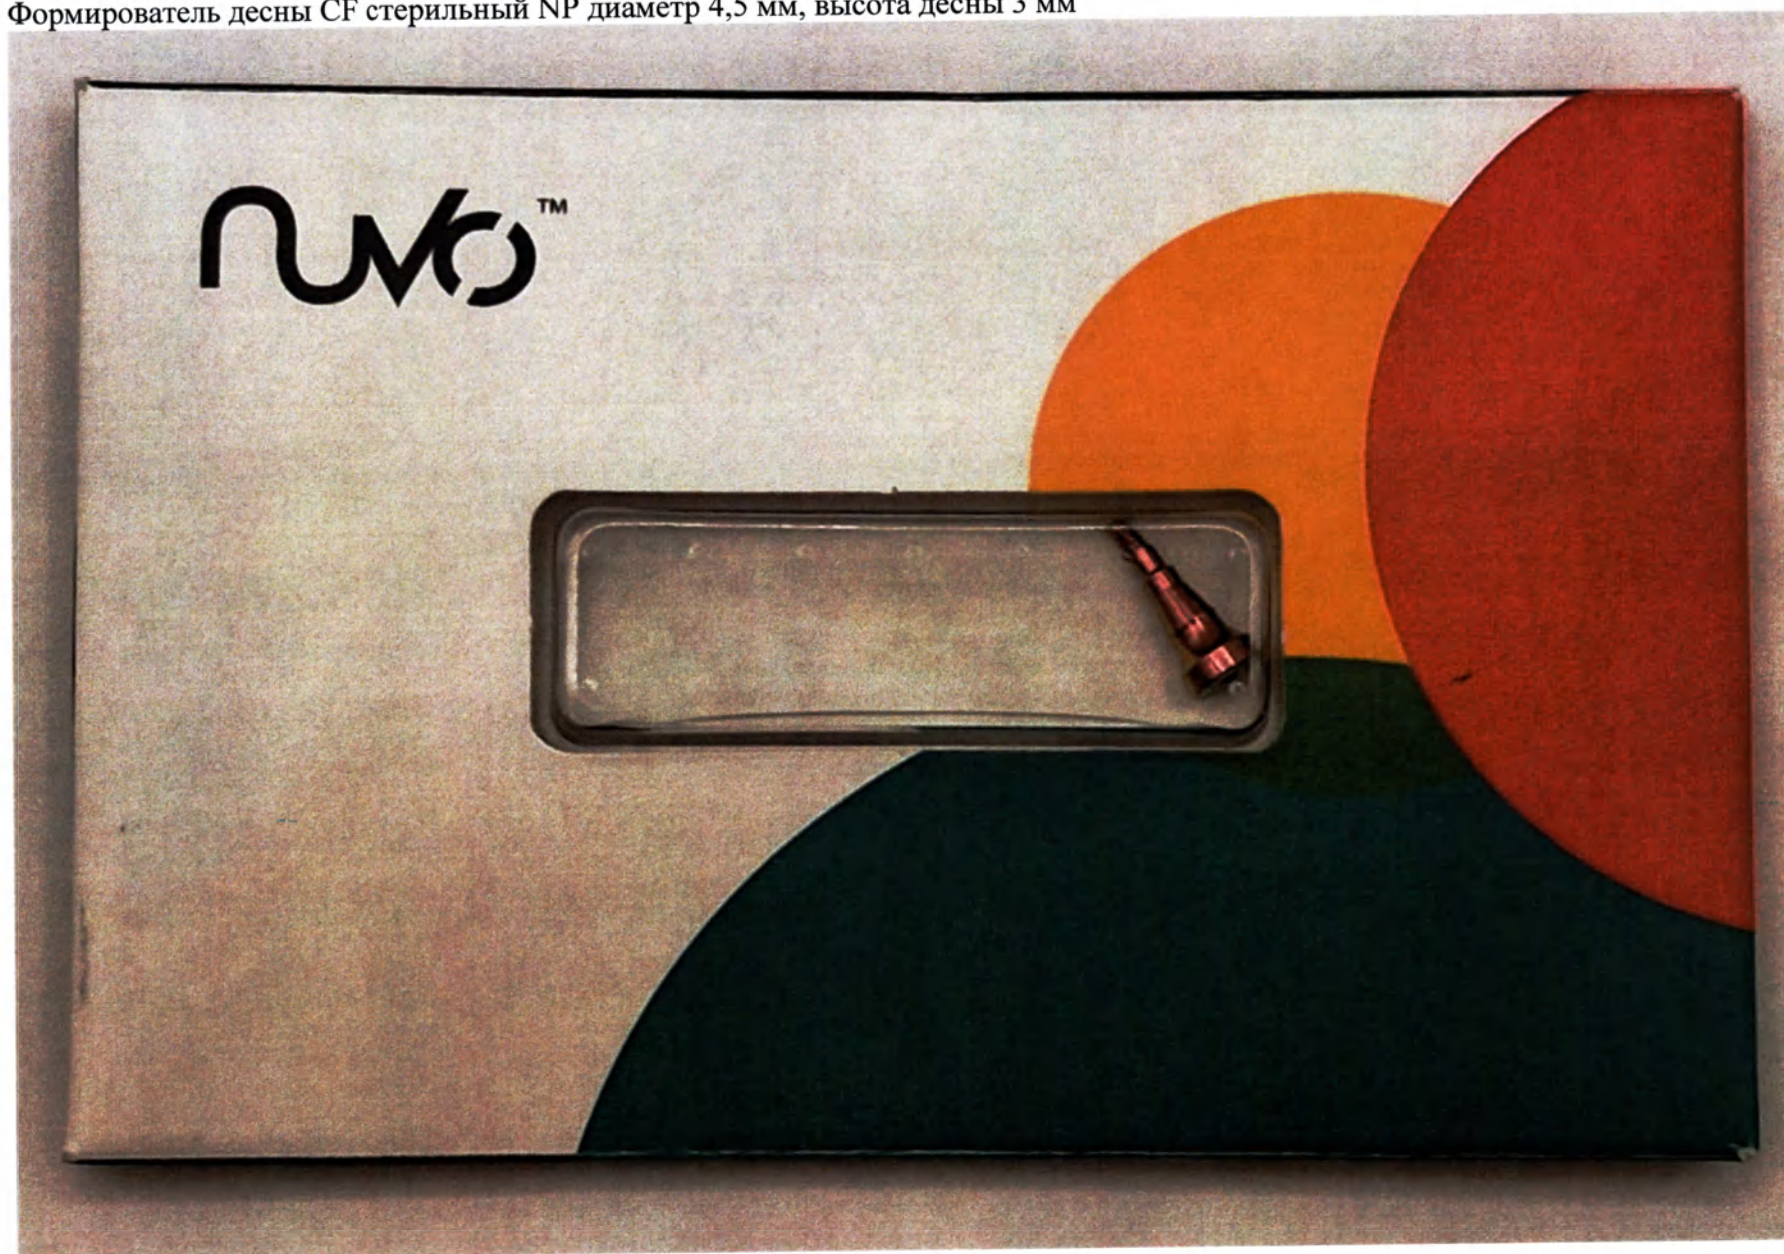



Формирователь десны CF стерильный NP диаметр 4,5 мм, высота десны 4 мм





Формирователь десны CF стерильный NP диаметр 4,5 мм, высота десны 5 мм






Формирователь десны CF стерильный SP диаметр 4,5 мм, высота десны 1 мм






Формирователь десны CF стерильный SP диаметр 4,5 мм, высота десны 2 мм

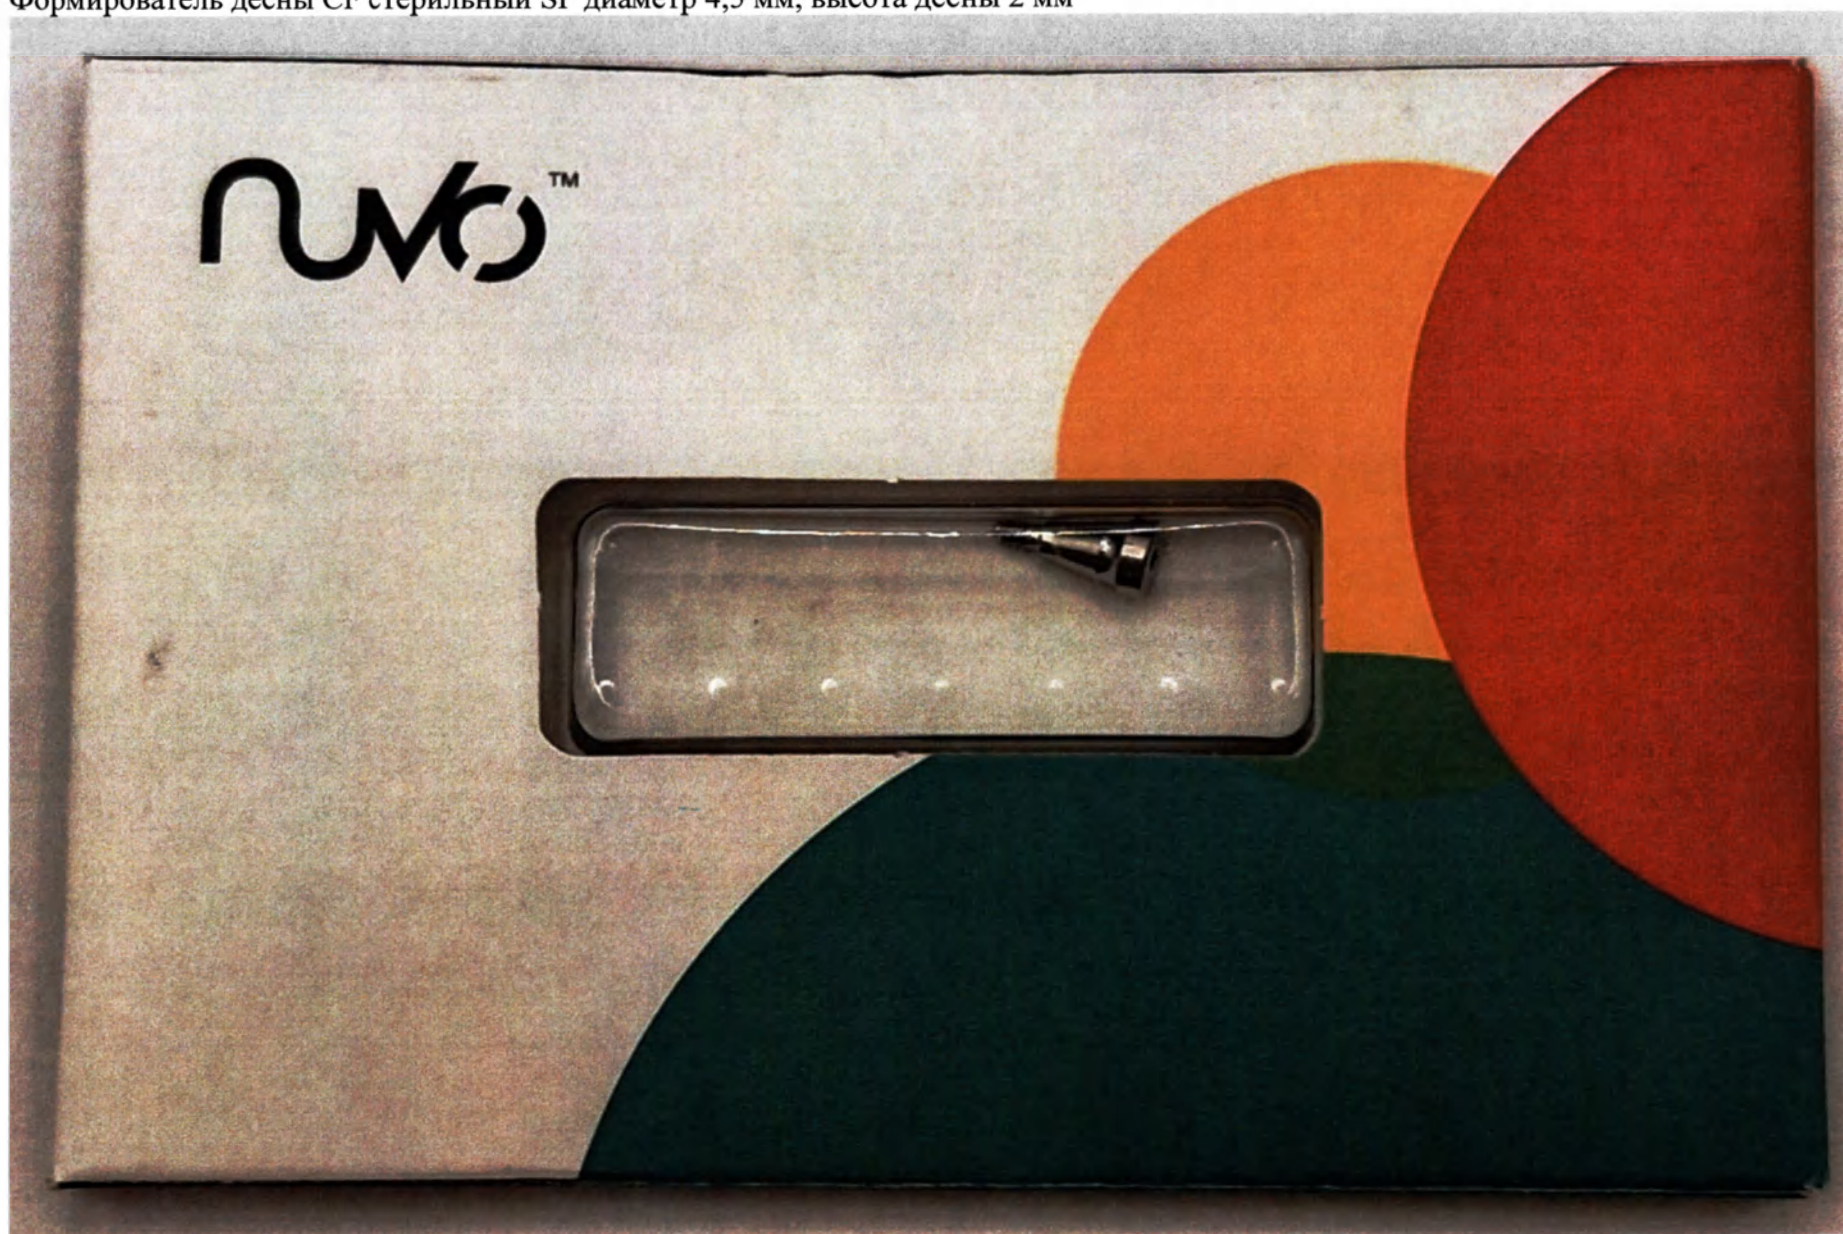



Формирователь десны CF стерильный SP диаметр 4,5 мм, высота десны 3 мм

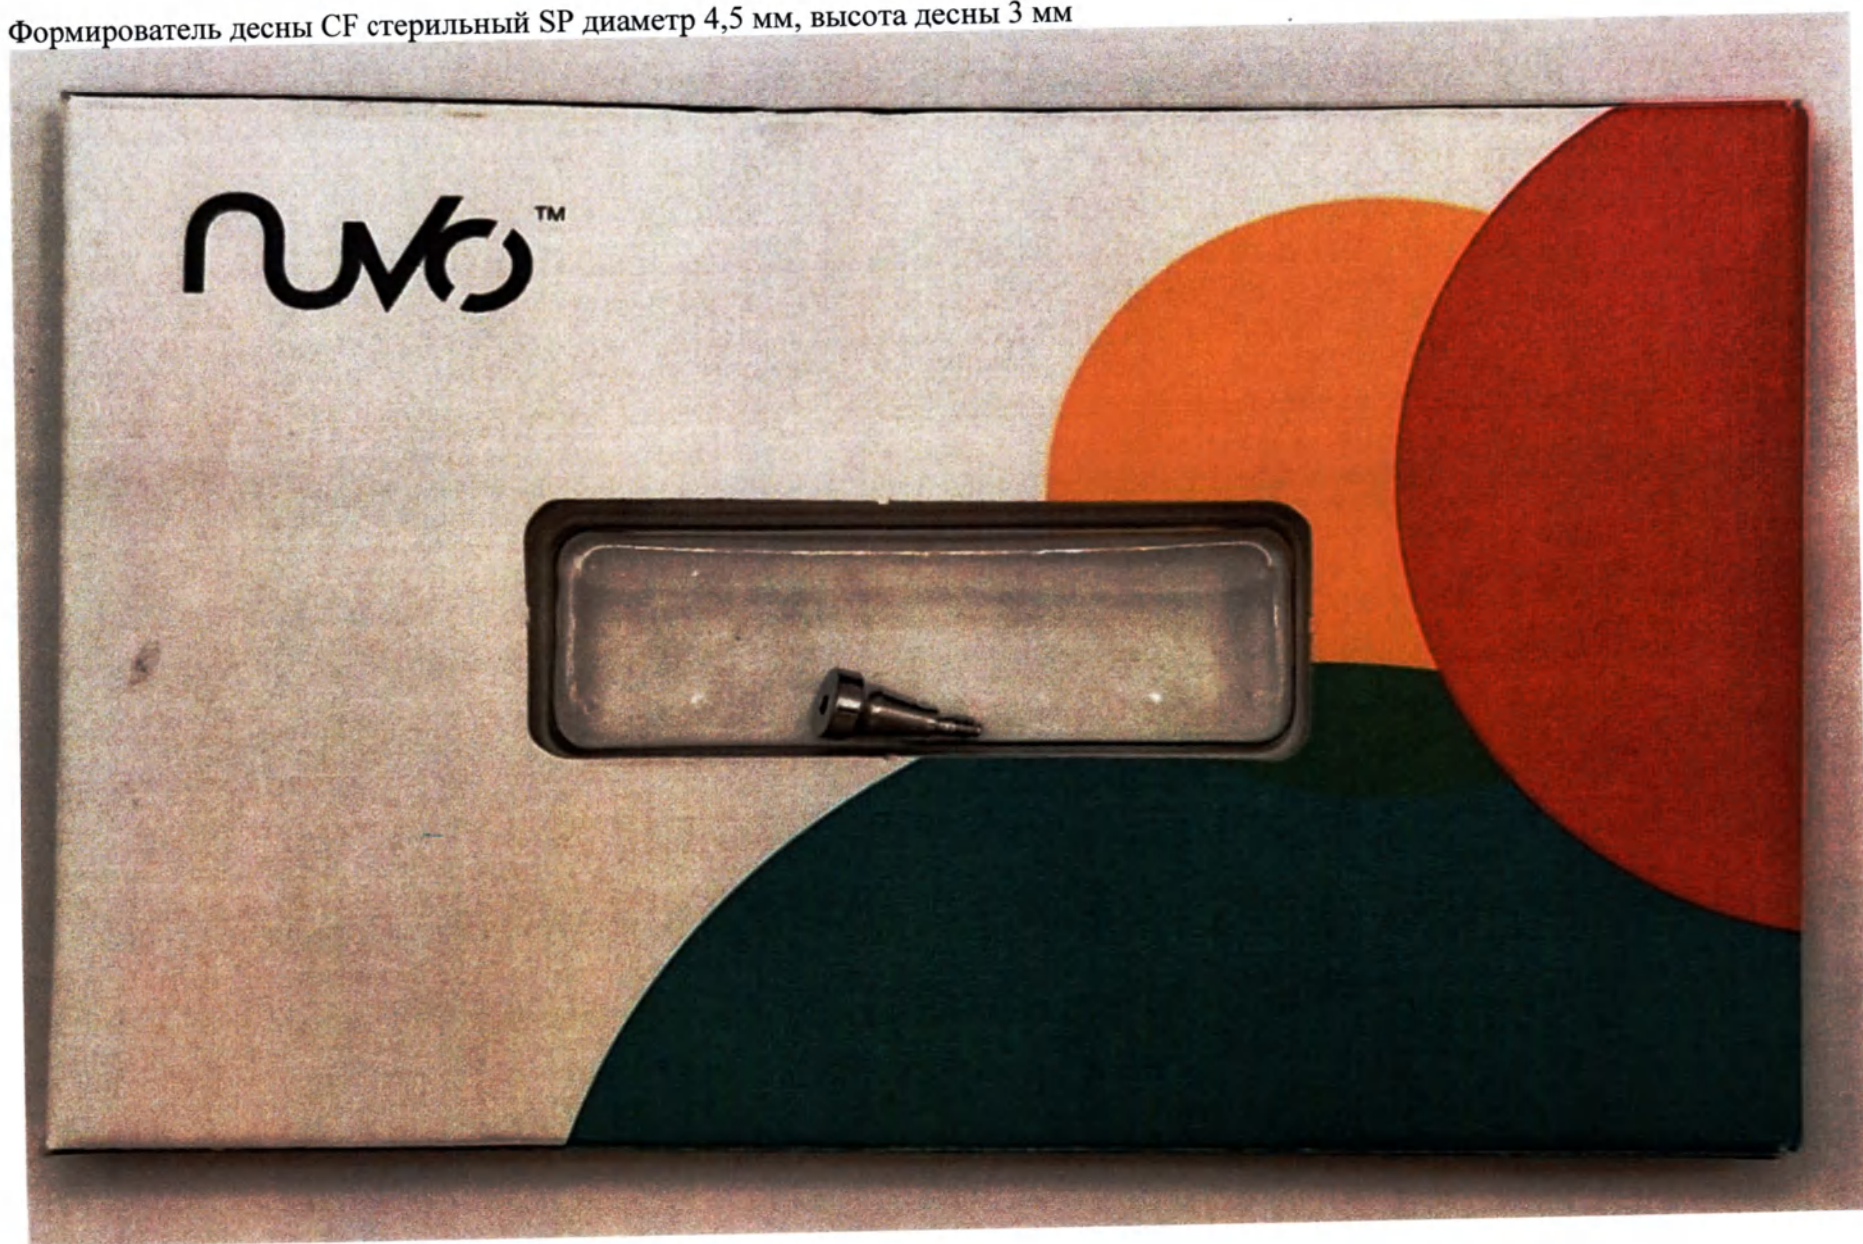




Формирователь десны CF стерильный SP диаметр 4,5 мм, высота десны 4 мм







Формирователь десны CF стерильный SP диаметр 4,5 мм, высота десны 5 мм



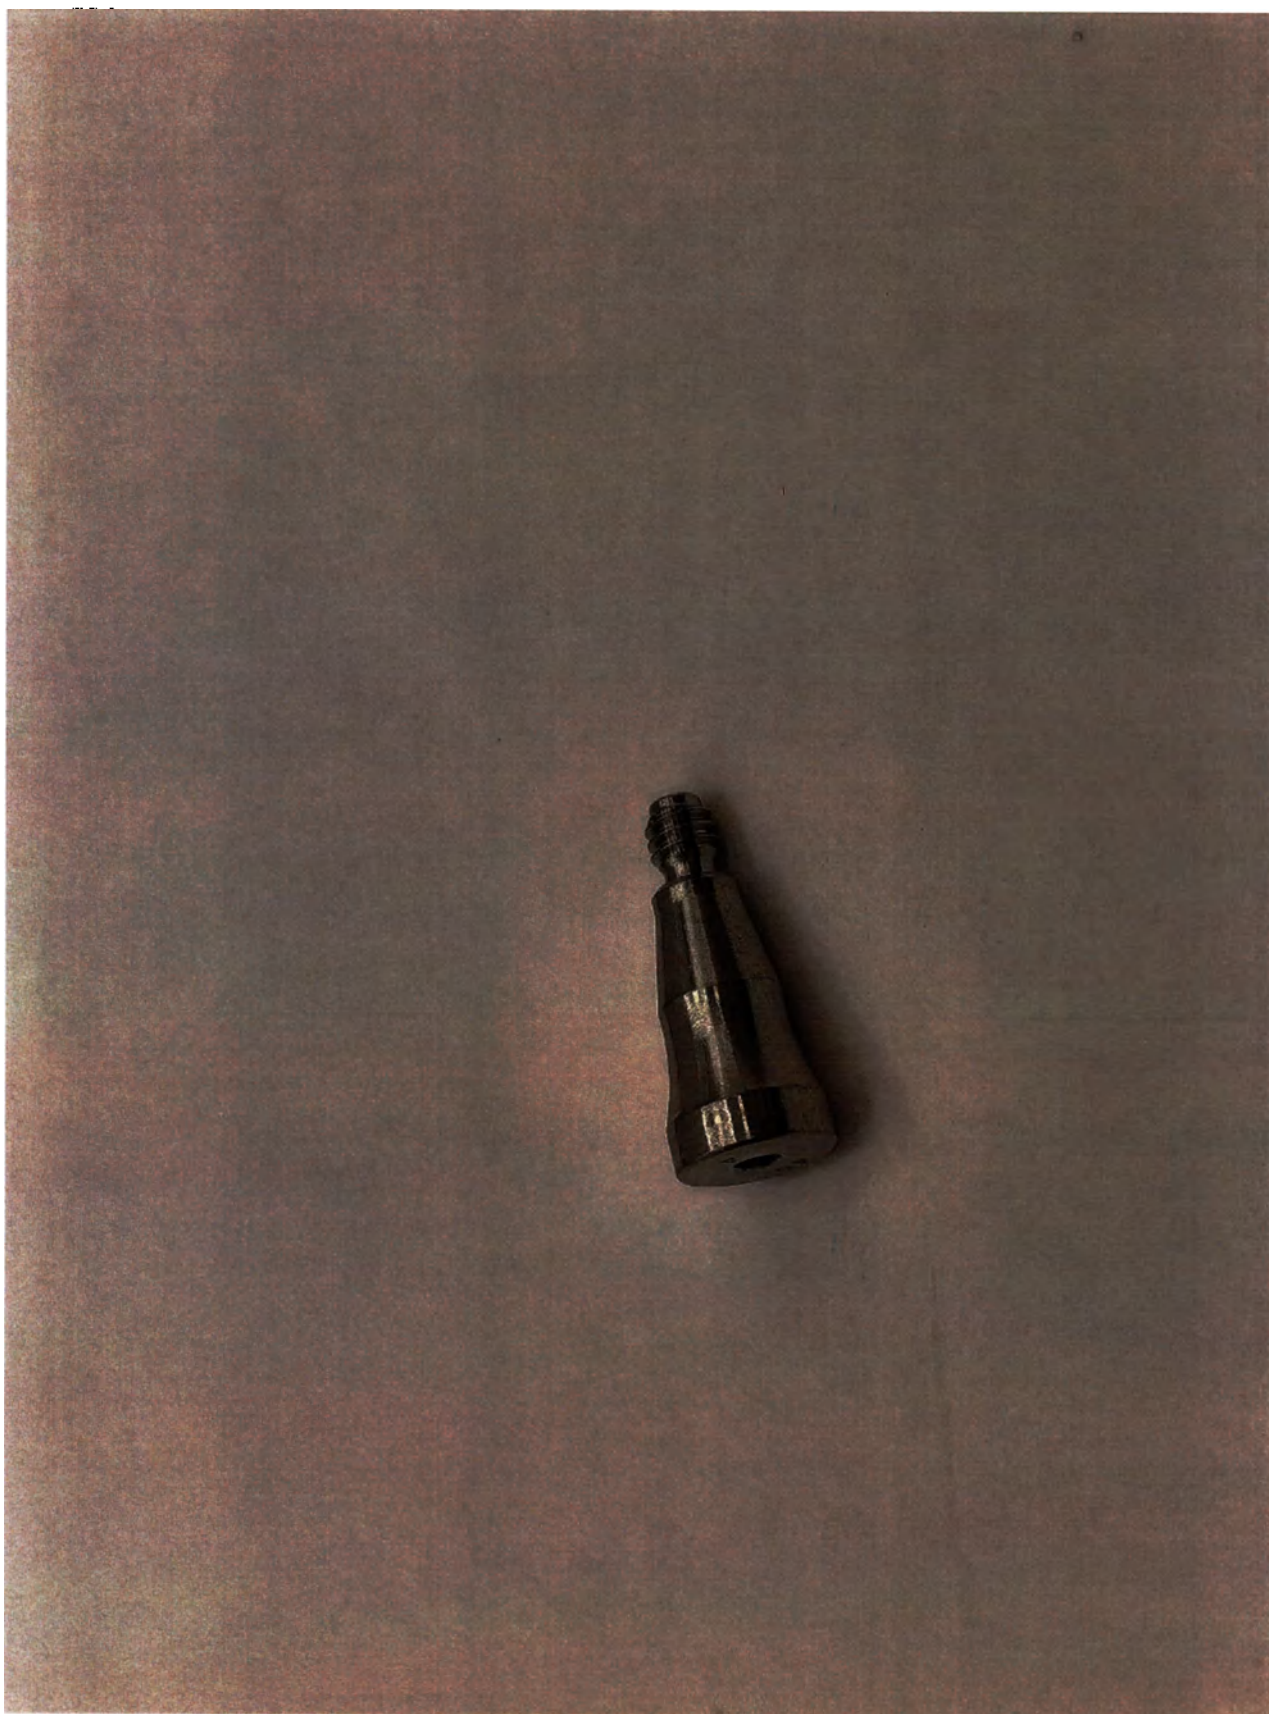


Формирователь десны CF стерильный SP диаметр 5,5 мм, высота десны 1 мм

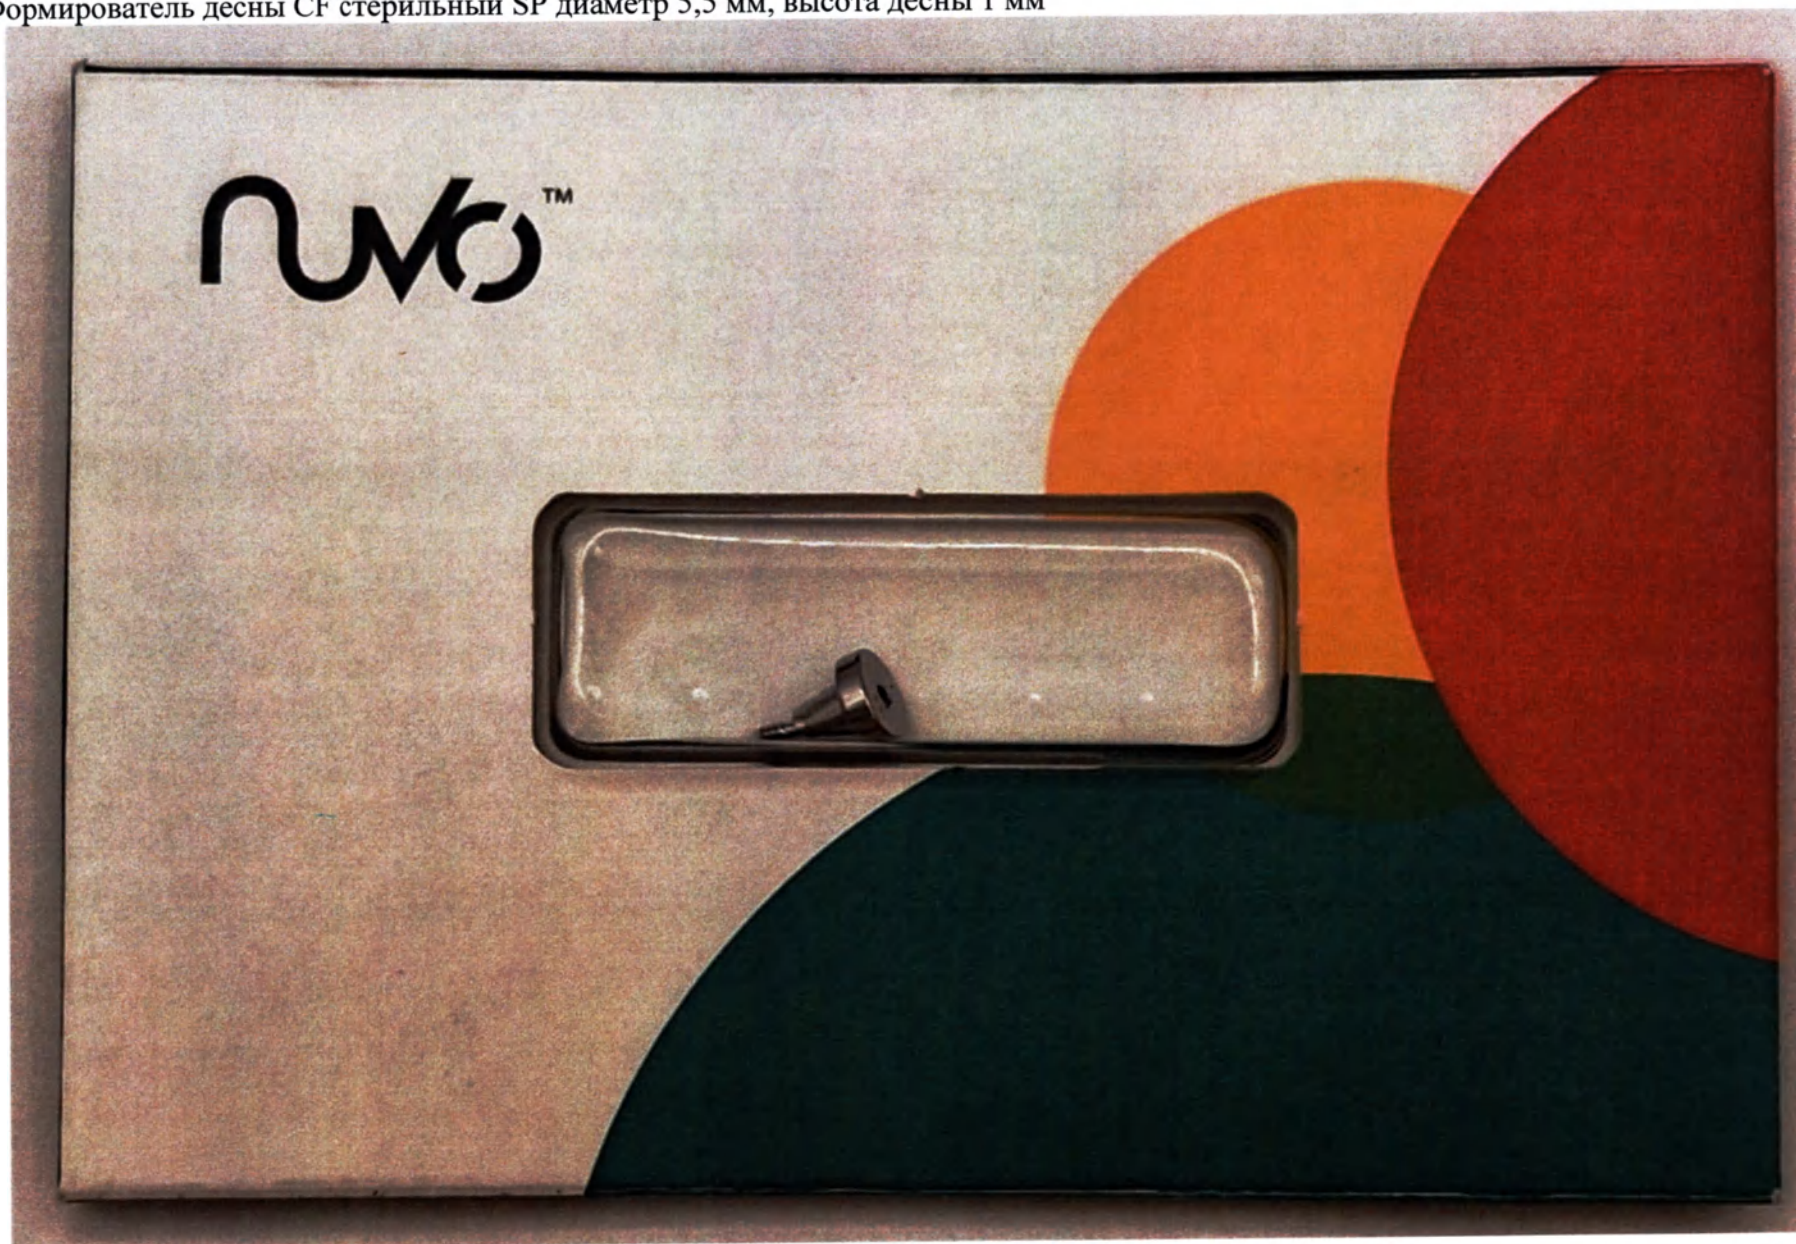

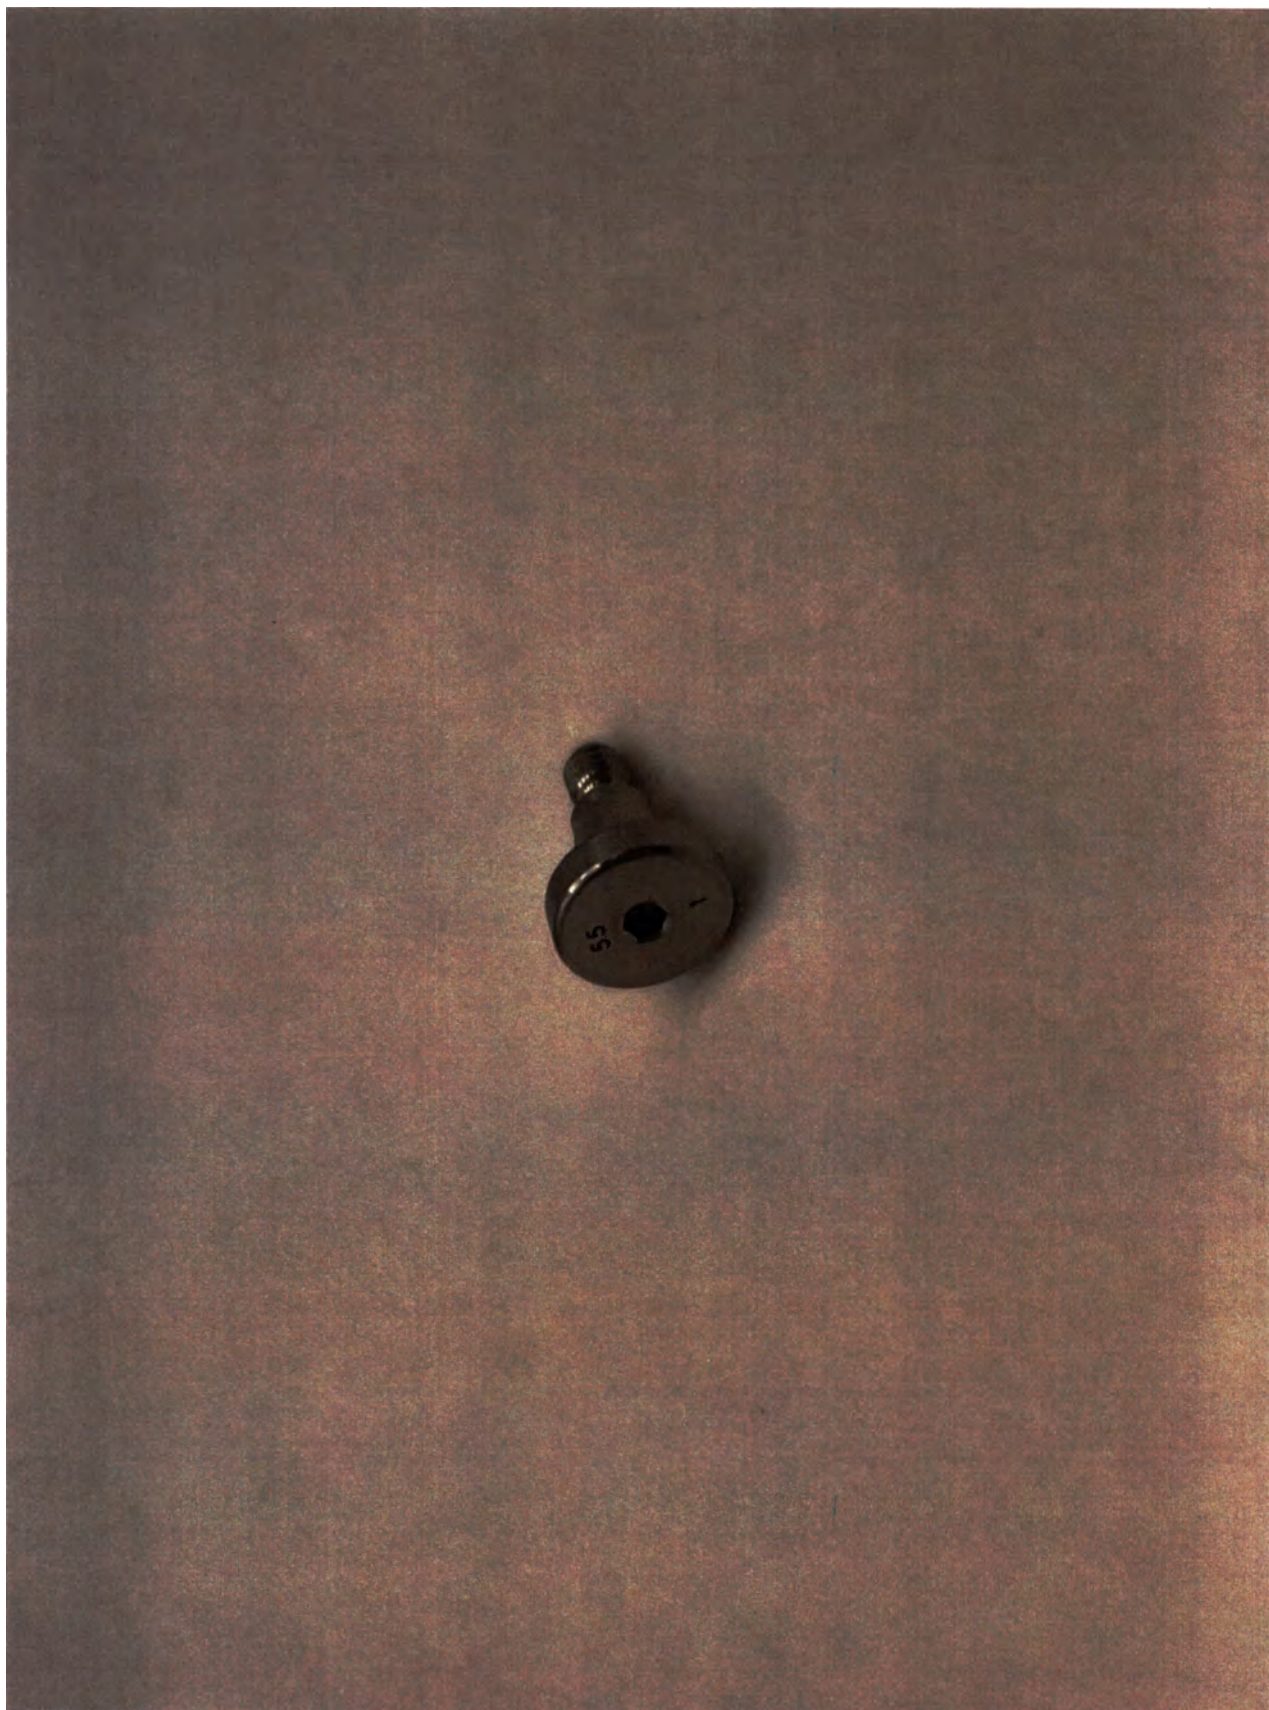


Формирователь десны CF стерильный SP диаметр 5,5 мм, высота десны 2 мм



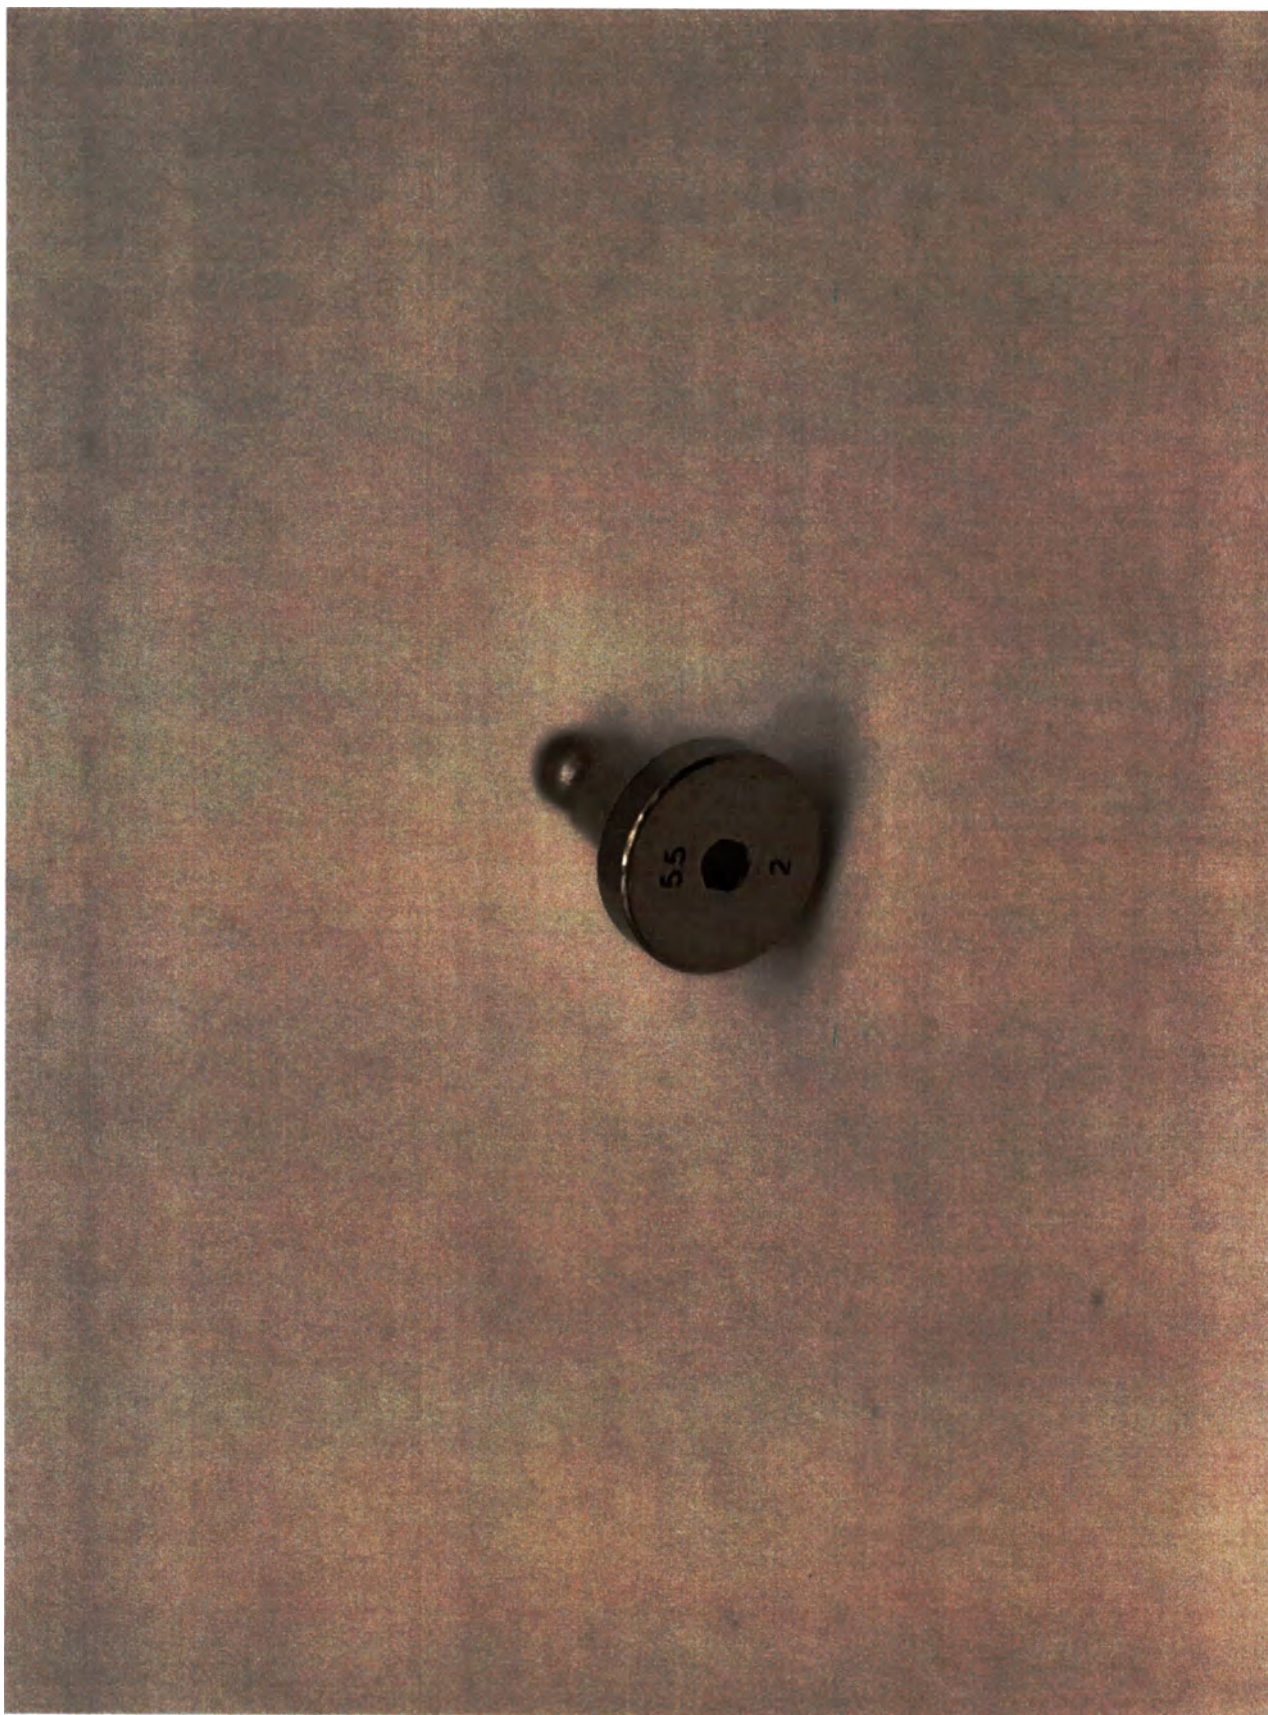



Формирователь десны CF стерильный SP диаметр 5,5 мм, высота десны 3 мм

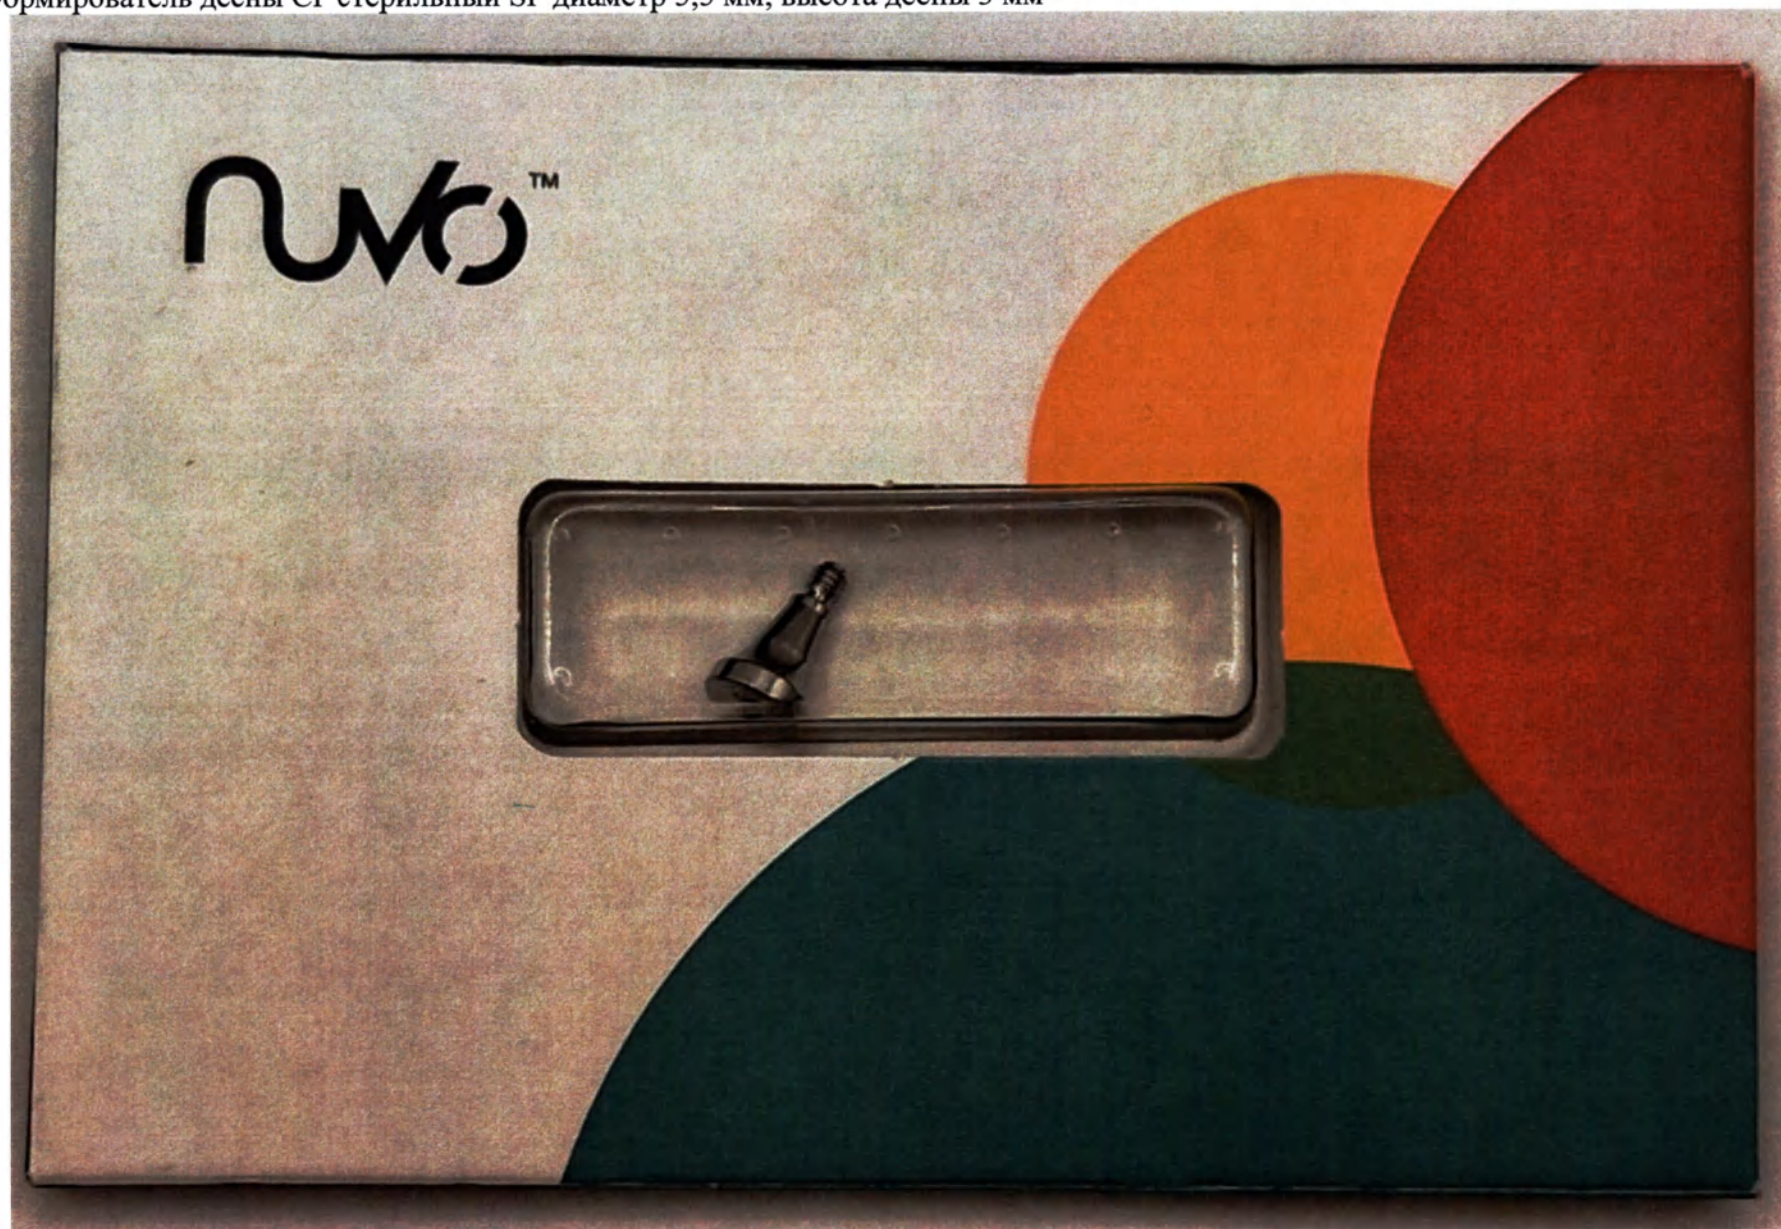





Формирователь десны CF стерильный SP диаметр 5,5 мм, высота десны 4 мм

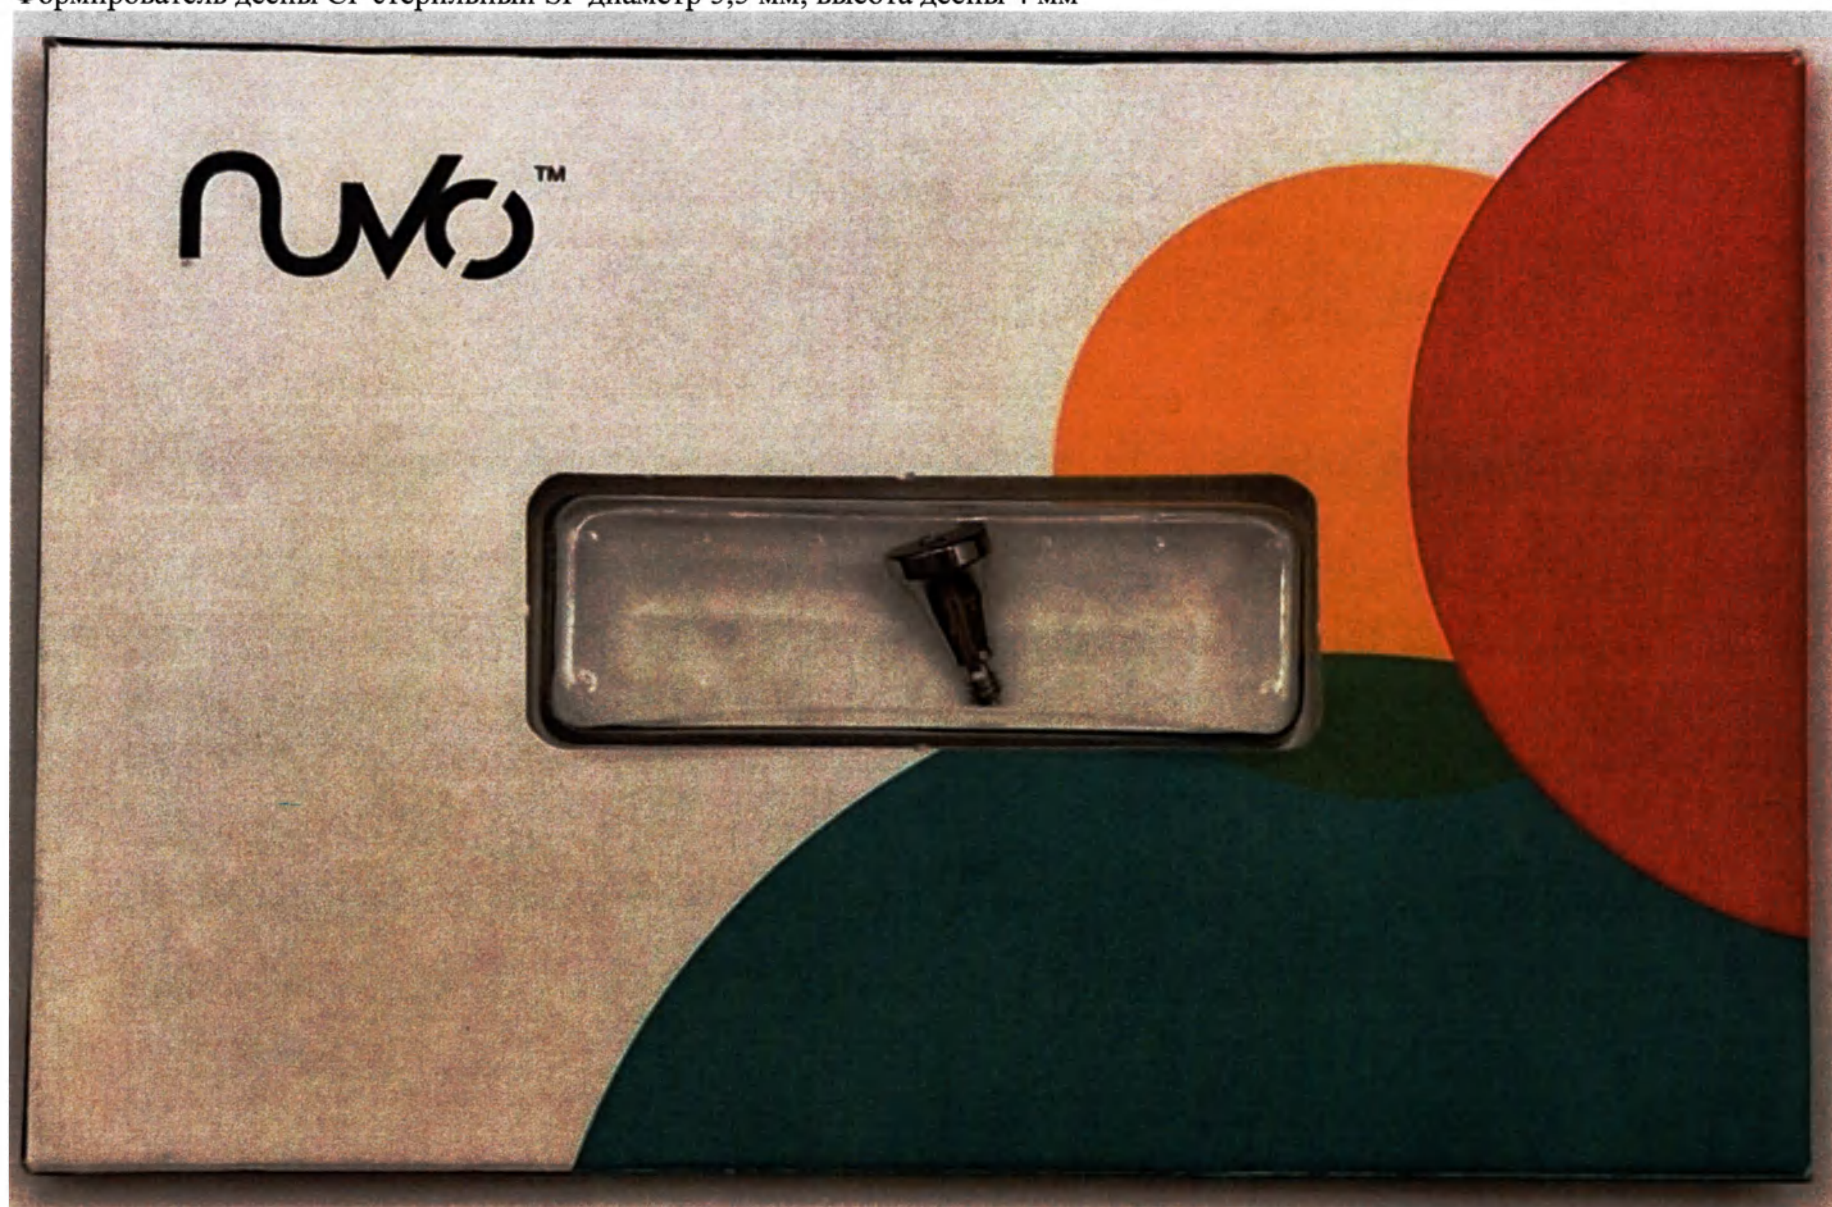

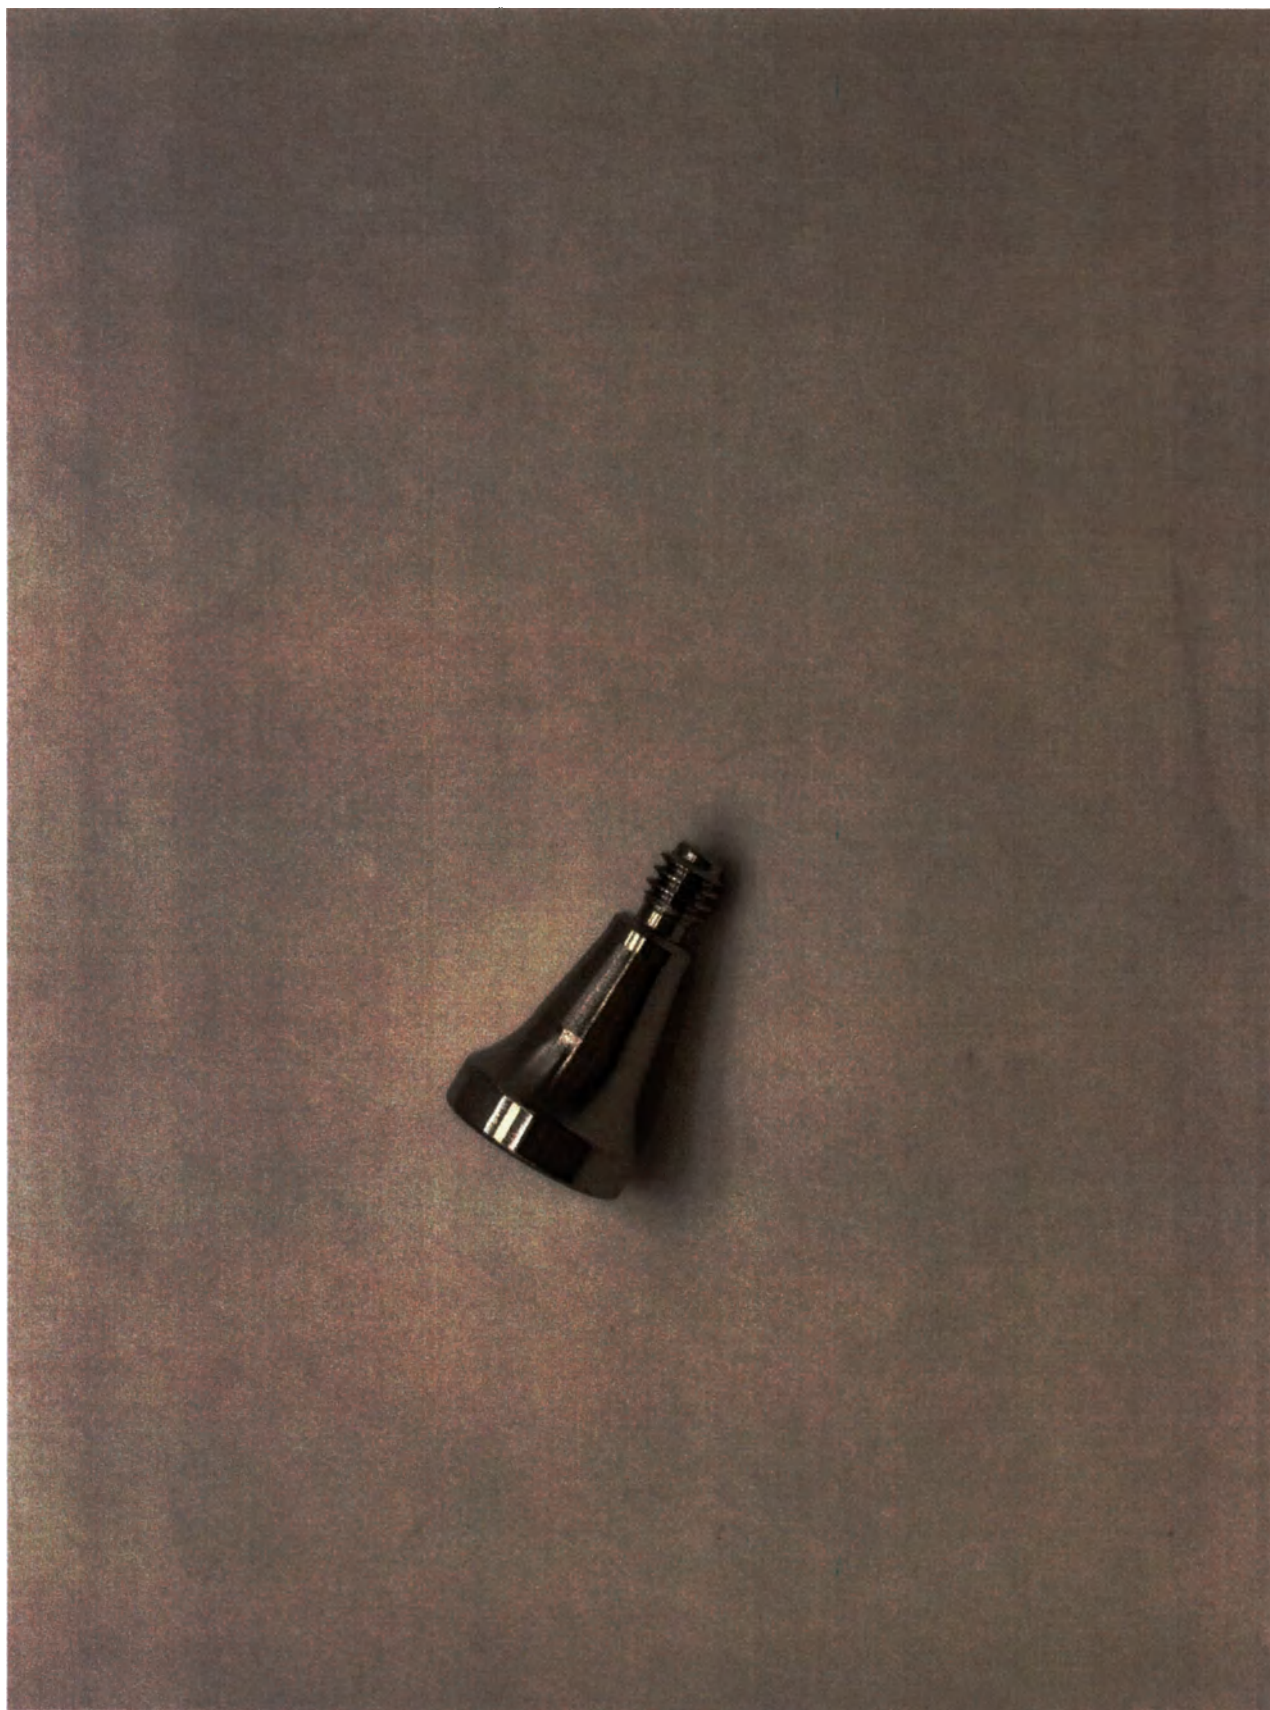


Формирователь десны CF стерильный SP диаметр 5,5 мм, высота десны 5 мм

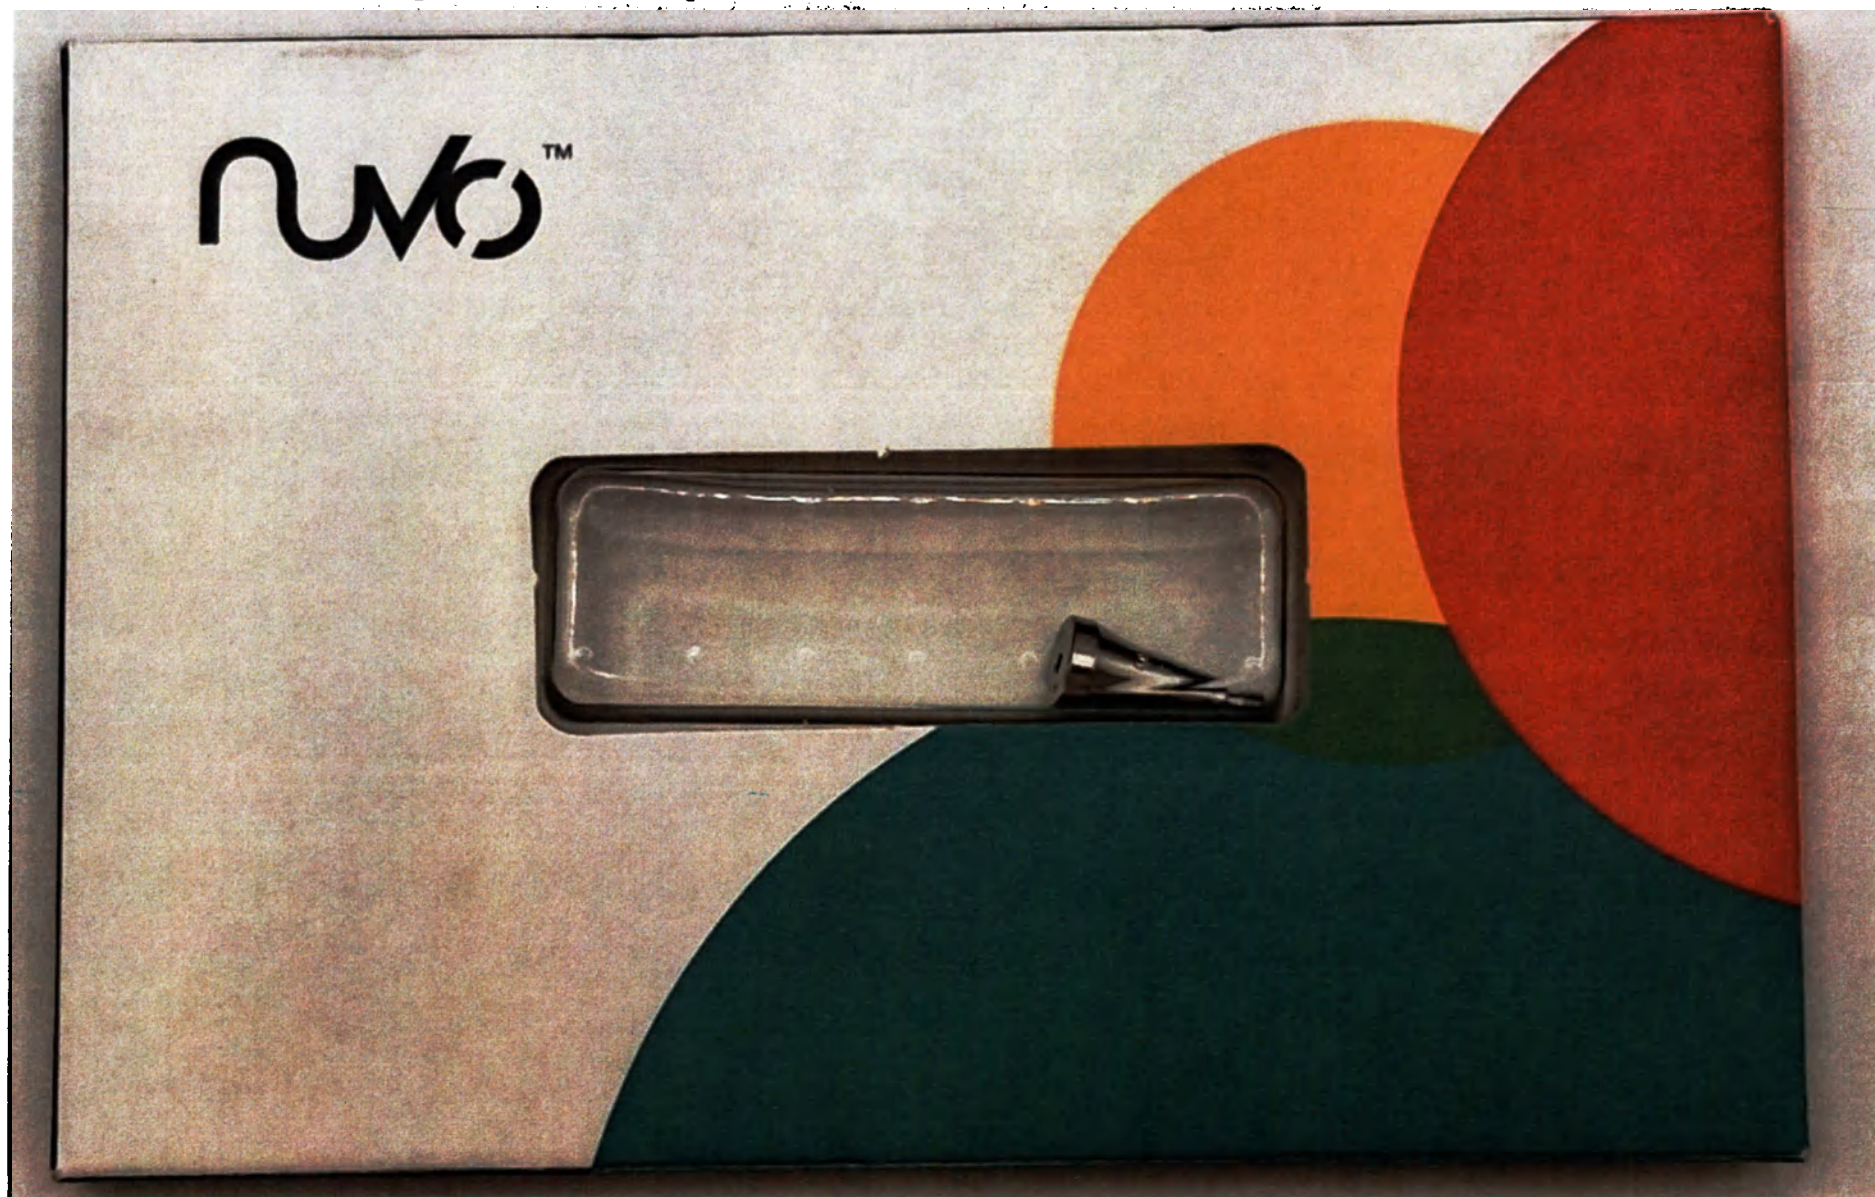

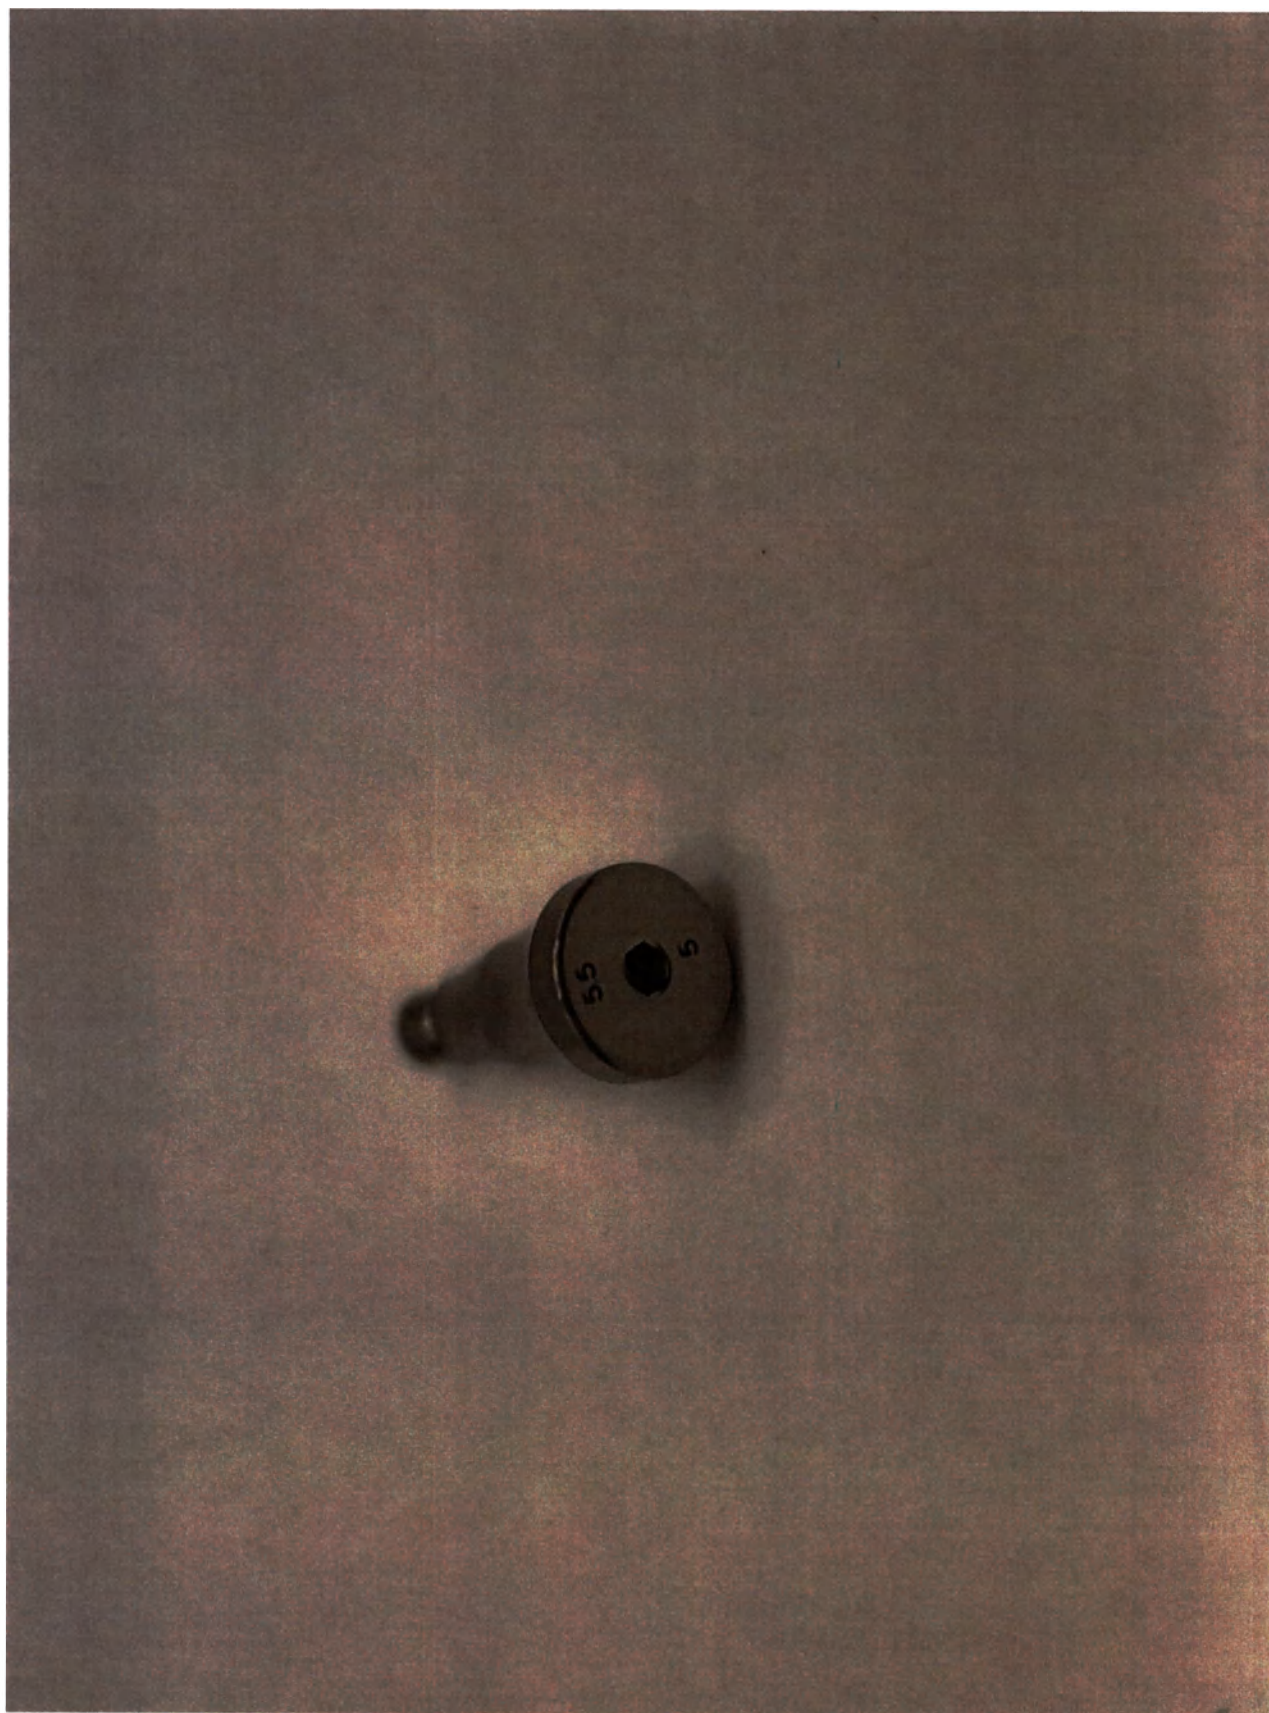

Маркировка на вторичной упаковке (на примере Формирователя десны CF стерильного NP диаметр 3,5 мм, высота десны 4 мм)

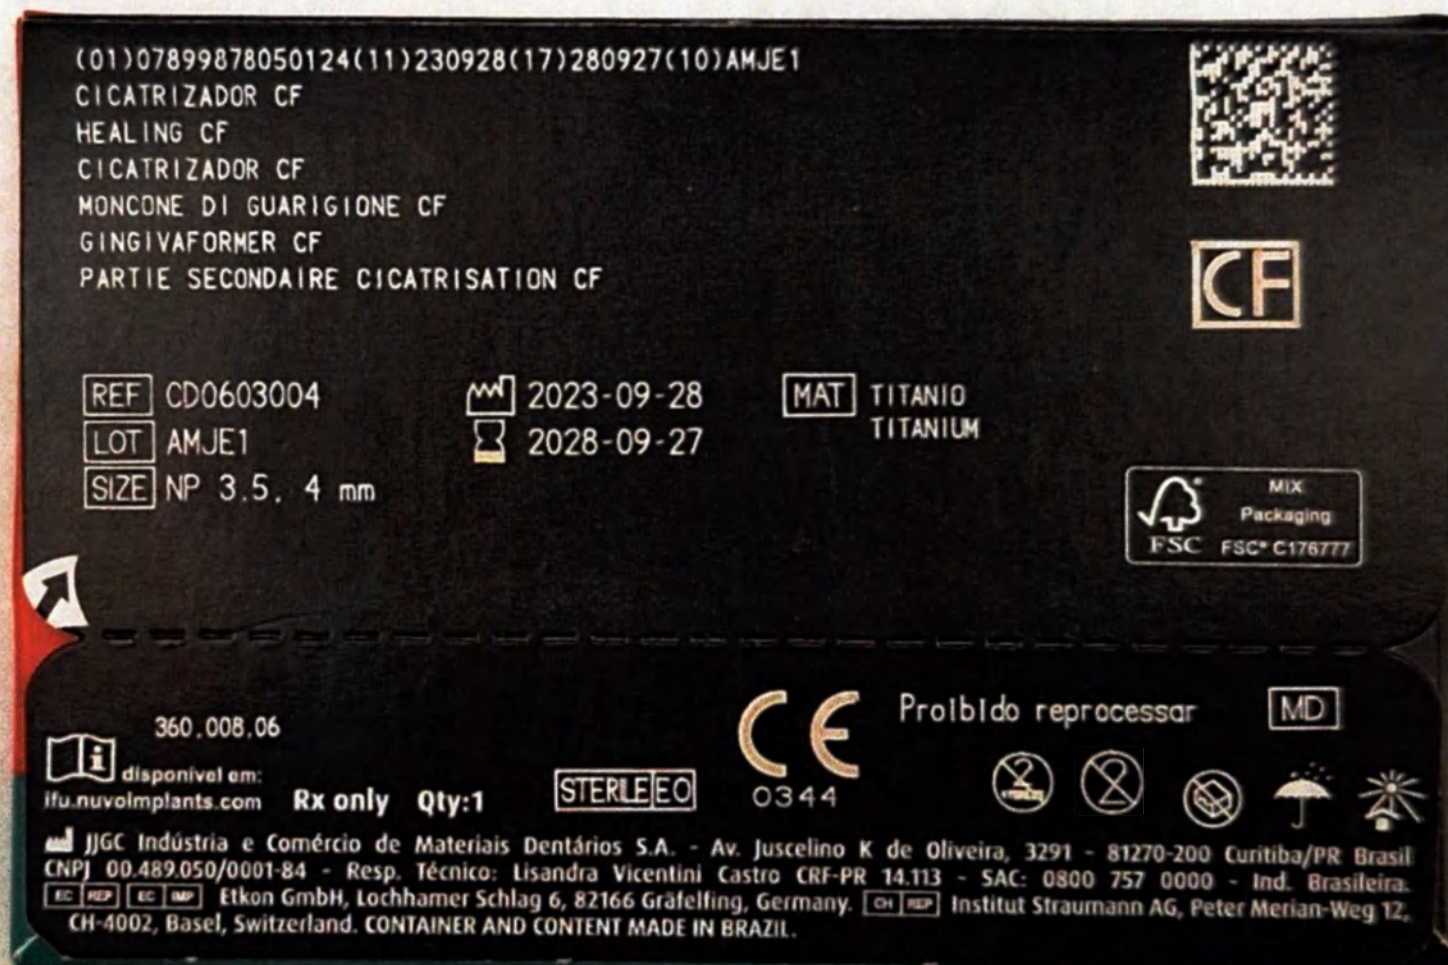

Маркировка на индивидуальной упаковке (на примере Формирователя десны CF стерильного NP диаметр 3,5 мм, высота десны 4 мм)



Пример макета русскоязычного стикера для Компонентов ортопедических CF временных стерильных:

Компоненты ортопедические CF временные стерильные		
Формирователь десны CF стерильный SP диаметр 5,5 мм, высота десны 5 мм		
Регистрационное удостоверение № ##### от ##.##.####		
	См. на упаковке 	www.straumann.ru/ifu
	JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. («Джей Джей Джи Си Индустриа э Комерсно Де Материанс Дентариос С.А.»), Av Juscelino Kubitschek de Oliveira 3291 Cidade Industrial 81270-200 Curitiba, PR, Brazil (Бразилия).	
Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью "Штрауманн" (ООО "Штрауманн"), Российская Федерация, Российская Федерация, 119571 г. Москва, Ленинский проспект, д.119А		

4
Прошнуровано 52 листа/ов

Специалист по регистрации
ООО «Штрауманн»



М.А. Гребенкина