





Набор реагентов для количественного определения СК-МВ (изофермента креатинкиназы МВ) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS СК-МВ Neo)

Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки (Вариант исполнения 1)

	Набор реагентов для количественного определения СК-МВ (изофермента креатинкиназы МВ) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS СК-МВ Neo) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.	
LOT	REF SMFP-128 
РУ Дата регистрации	
        	

Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки коробка 1 (Вариант исполнения 2)

	Набор реагентов для количественного определения СК-МВ (изофермента креатинкиназы МВ) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS СК-МВ Neo)		
	Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru		
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.			
LOT	REF	SMFP-128-CFPO-243-CFPO-269 	
Короб 1 из 3			
РУ Дата регистрации			
        			


Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки коробка 2 (Вариант исполнения 2)

Контроль Boditech СК-МВ	
1 мл x 2 флакона Короб 2 из 3 Произведено в Корее	
LOT  	REF CFPO-243
     	

Макет русскоязычного стикера потребительской упаковки короба 3 (Вариант исполнения 2)

Калибратор Boditech CK-MB	
1 мл x 2 флакона Короб 3 из 3 Произведено в Корее	
LOT	REF CFPO-269
 	
     	

Макет русскоязычного стикера транспортной упаковки (Вариант исполнения 1)


	Набор реагентов для количественного определения СК-МВ (изофермента креатинкиназы МВ) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS CK-MB Neo)	
	Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr	
	Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru	
Для профессионального применения		
1. Картридж – 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.		
40 шт.		
LOT	REF SMFP-128	
РУ	Дата регистрации	
         		

Макет русскоязычного стикера транспортной упаковки (Вариант исполнения 2)

	Набор реагентов для количественного определения СК-МВ (изофермента креатинкиназы МВ) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS СК-МВ Neo) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru				
Для профессионального применения 1. Картридж - 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Контроль Boditech СК-МВ уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 6. Контроль Boditech СК-МВ уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 7. Калибратор Boditech СК-МВ уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 8. Калибратор Boditech СК-МВ уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 9. Инструкция по применению - 1 шт. После поставки Набора внешнюю упаковку необходимо вскрыть и поместить реагенты на хранение в соответствии с указанным на внутренней упаковке температурным режимом					
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="261 1238 331 1290"> LOT </td> <td data-bbox="628 1238 699 1290"> REF </td> <td data-bbox="719 1263 1126 1294"> SMFP-128-CFPO-243-CFPO-269 </td> <td data-bbox="1246 1216 1278 1290">  </td> </tr> </table>		LOT	REF	SMFP-128-CFPO-243-CFPO-269	
LOT	REF	SMFP-128-CFPO-243-CFPO-269			
РУ	Дата регистрации  2°C — 8°C				
  24        					

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов.

Генеральный директор
ООО «АВИВИР»

 Куркин Ф.Г.



Генеральный директор

ООО «Авивир»


Куркин Ф.Г.



Фотографические изображения

**Набор реагентов для количественного определения СК-МВ
(изофермента креатинкиназы МВ) иммунофлуоресцентным
методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе
иммунофлуоресцентном AFIAS
(AFIAS CK-MB Neo)**

Общий вид набора

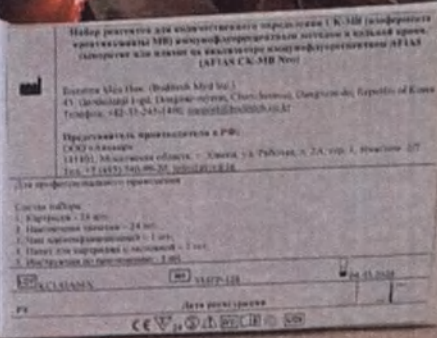

Макет русскоязычного стикера

	Набор реагентов для количественного определения СК-МВ (изофермента креатинкиназы МВ) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS CK-MB Neo) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru	
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.		
LOT KCUGA06X	REF SMFP-128	04.03.2026
РУ Дата регистрации		
CE Σ₂₄ ⊗ ! IVD i ♻️ UDI		

Транспортная упаковка



Макет русскоязычного стикера

	Набор реагентов для количественного определения СК-МВ (изофермента креатинкиназы МВ) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS СК-МВ Neo) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru
Для профессионального применения 1. Картридж – 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт. 40 шт	
LOT KCUGA06X	REF SMFP-128  04.03.2026
РУ Дата регистрации	
CE Σ 24   IVD     	

Вариант исполнения 2

Общий вид набора



Фото короба 1 из 3

Макет русскоязычного стикера короба 1

	Набор реагентов для количественного определения СК-МВ (изофермента креатинкиназы МВ) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS СК-МВ Neo) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82-33-243-1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 (495) 740-99-20, info@avivir.ru	
Для профессионального применения Состав набора: 1. Картридж - 24 шт; 2. Наконечник пипетки – 24 шт; 3. Чип идентификационный – 1 шт; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт; 5. Инструкция по применению - 1 шт.		
LOT KCTXA03X	REF SMFP-128-CFPO-243-CFPO-269	13.05.2025
Короб 1 из 3 РУ Дата регистрации		30°C 2°C
24		

Фото контролей (короб 2 из 3)

(только для варианта исполнения 2)




Макет русскоязычного стикера короба 2

Контроль Boditech CK-MB	
1 мл x 2 флакона Короб 2 из 3 Произведено в Корее	
LOT CKCOUC12 03.2024 03.2025	REF CFPO-243
CE IVD UDI 8°C 2°C	

Фото калибраторов (короб 3 из 3)

(только для варианта исполнения 2)

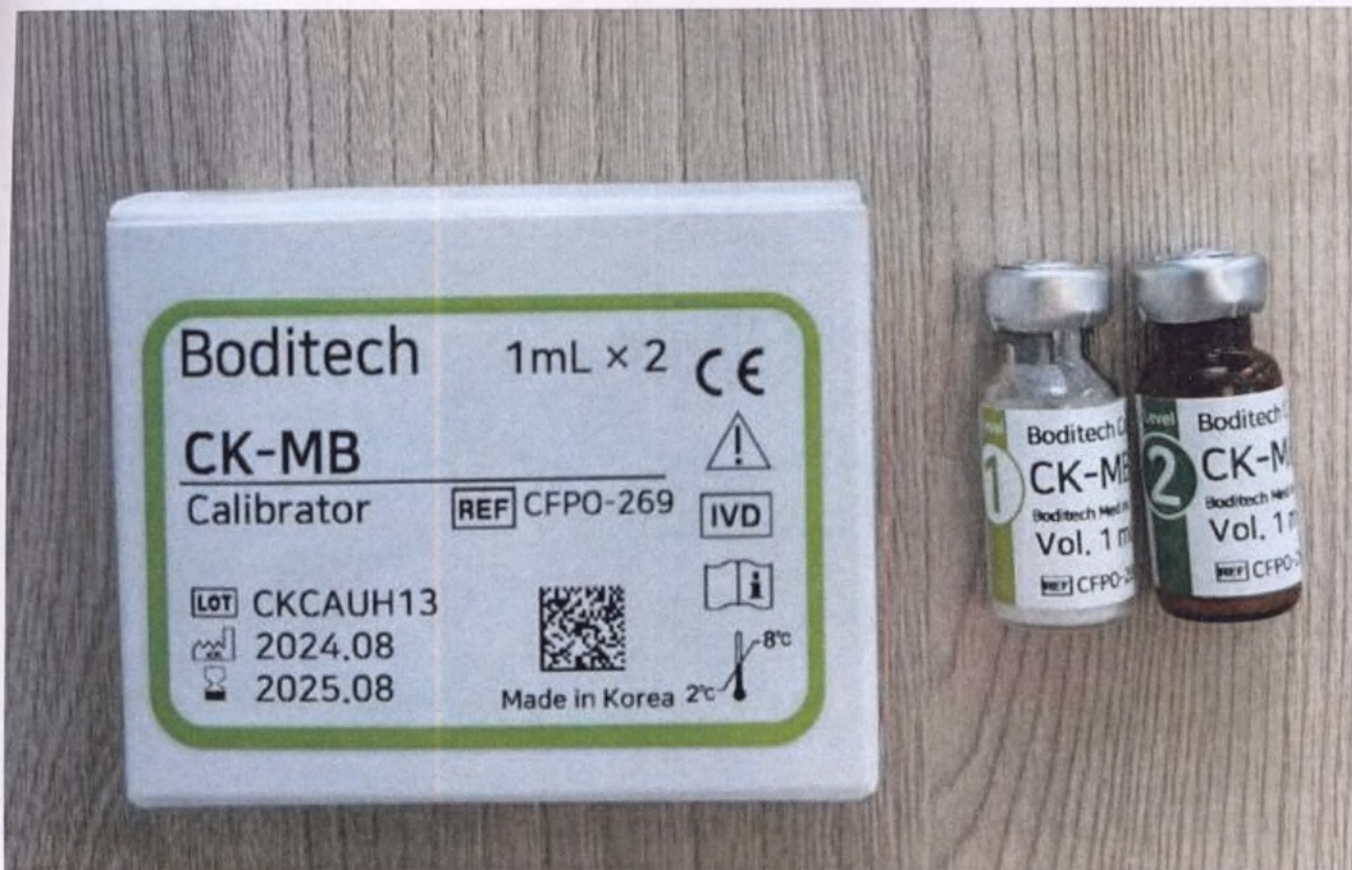

Макет русскоязычного стикера короба 3

Калибратор Boditech CK-MB	
1 мл x 2 флакона Короб 3 из 3 Произведено в Корее	
LOT CKCAUH13 08.2024 08.2025	REF CFPO-269
CE IVD UDI 2°C - 8°C	

Транспортная упаковка (для варианта исполнения 2)





Макет русскоязычного стикера

	Набор реагентов для количественного определения СК-МВ (изофермента креатинкиназы МВ) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе иммунофлуоресцентном AFIAS (AFIAS CK-MB Neo) Бодитек Мед Инк. (Boditech Med Inc.) 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea Телефон: +82 33 243 1400, support@boditech.co.kr Представитель производителя в РФ: ООО «Авивир» 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, этаж/пом. 2/7 Тел. +7 495 740-99-20, info@avivir.ru						
Для профессионального применения 1. Картридж - 24 шт.; 2. Наконечник пипетки – 24 шт.; 3. Чип идентификационный – 1 шт.; 4. Пакет для картриджа с застежкой – 1 шт.; 5. Контроль Boditech CK-MB уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 6. Контроль Boditech CK-MB уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 7. Калибратор Boditech CK-MB уровень 1 (1 мл) – 1 шт.; 8. Калибратор Boditech CK-MB уровень 2 (1 мл) – 1 шт.; 9. Инструкция по применению - 1 шт. После поставки Набора внешнюю упаковку необходимо вскрыть и поместить реагенты на хранение в соответствии с указанным на внутренней упаковке температурным режимом							
<table border="0"> <tr> <td>LOT</td> <td>KCTXA03X</td> <td>REF</td> <td>SMFP-128-CFPO-243-CFPO-269</td> <td></td> <td>31.03.2025</td> </tr> </table>		LOT	KCTXA03X	REF	SMFP-128-CFPO-243-CFPO-269		31.03.2025
LOT	KCTXA03X	REF	SMFP-128-CFPO-243-CFPO-269		31.03.2025		
РУ	Дата регистрации						

Компоненты набора

Картридж




Наконечник пипетки

Чип идентификационный

Пакет для картриджа с застежкой



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 17 листов.
Генеральный директор
ООО «АВИВИР»
 Куркин Ф.Г.

