

**«Наборы одноразовые для чрескожной лазерной абляции к аппарату ECHOLASER X4»,
производство: «Асклепион Лазер Технолоджис ГмбХ», Германия / Asclepion Laser Technologies GmbH, Germany**

1. Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-Y (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 20 см.
2. Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-Y (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции): переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода.
3. Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-Y (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции): игла, размер 21G, длина 20 см.
4. Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-B (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 20 см.
5. Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-R (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 20 см.
6. Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-G (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 20 см.

7. Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E-G (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 11 см.
8. Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E-G (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 11 см.
9. Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E-G (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции): игла, размер 21G, длина 11 см.
10. Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E- Y (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 11 см.
11. Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E-B (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 11 см.
12. Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E-R (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 11 см.
13. Фотография маркировки набора Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-R.
14. Фотография маркировки набора Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E-B.

Генеральный директор И.В.Королева

"17" декабря 2014 г.

М.П.  
(Подпись)



Рис. 1 Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-Y (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 20 см.

Рис. 2 Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-Y (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции):
(1)переходник типа ID; (2)переходник SMA 905;
(3)крышка защитная; (4)зажим световода;
(5)наконечник световода.

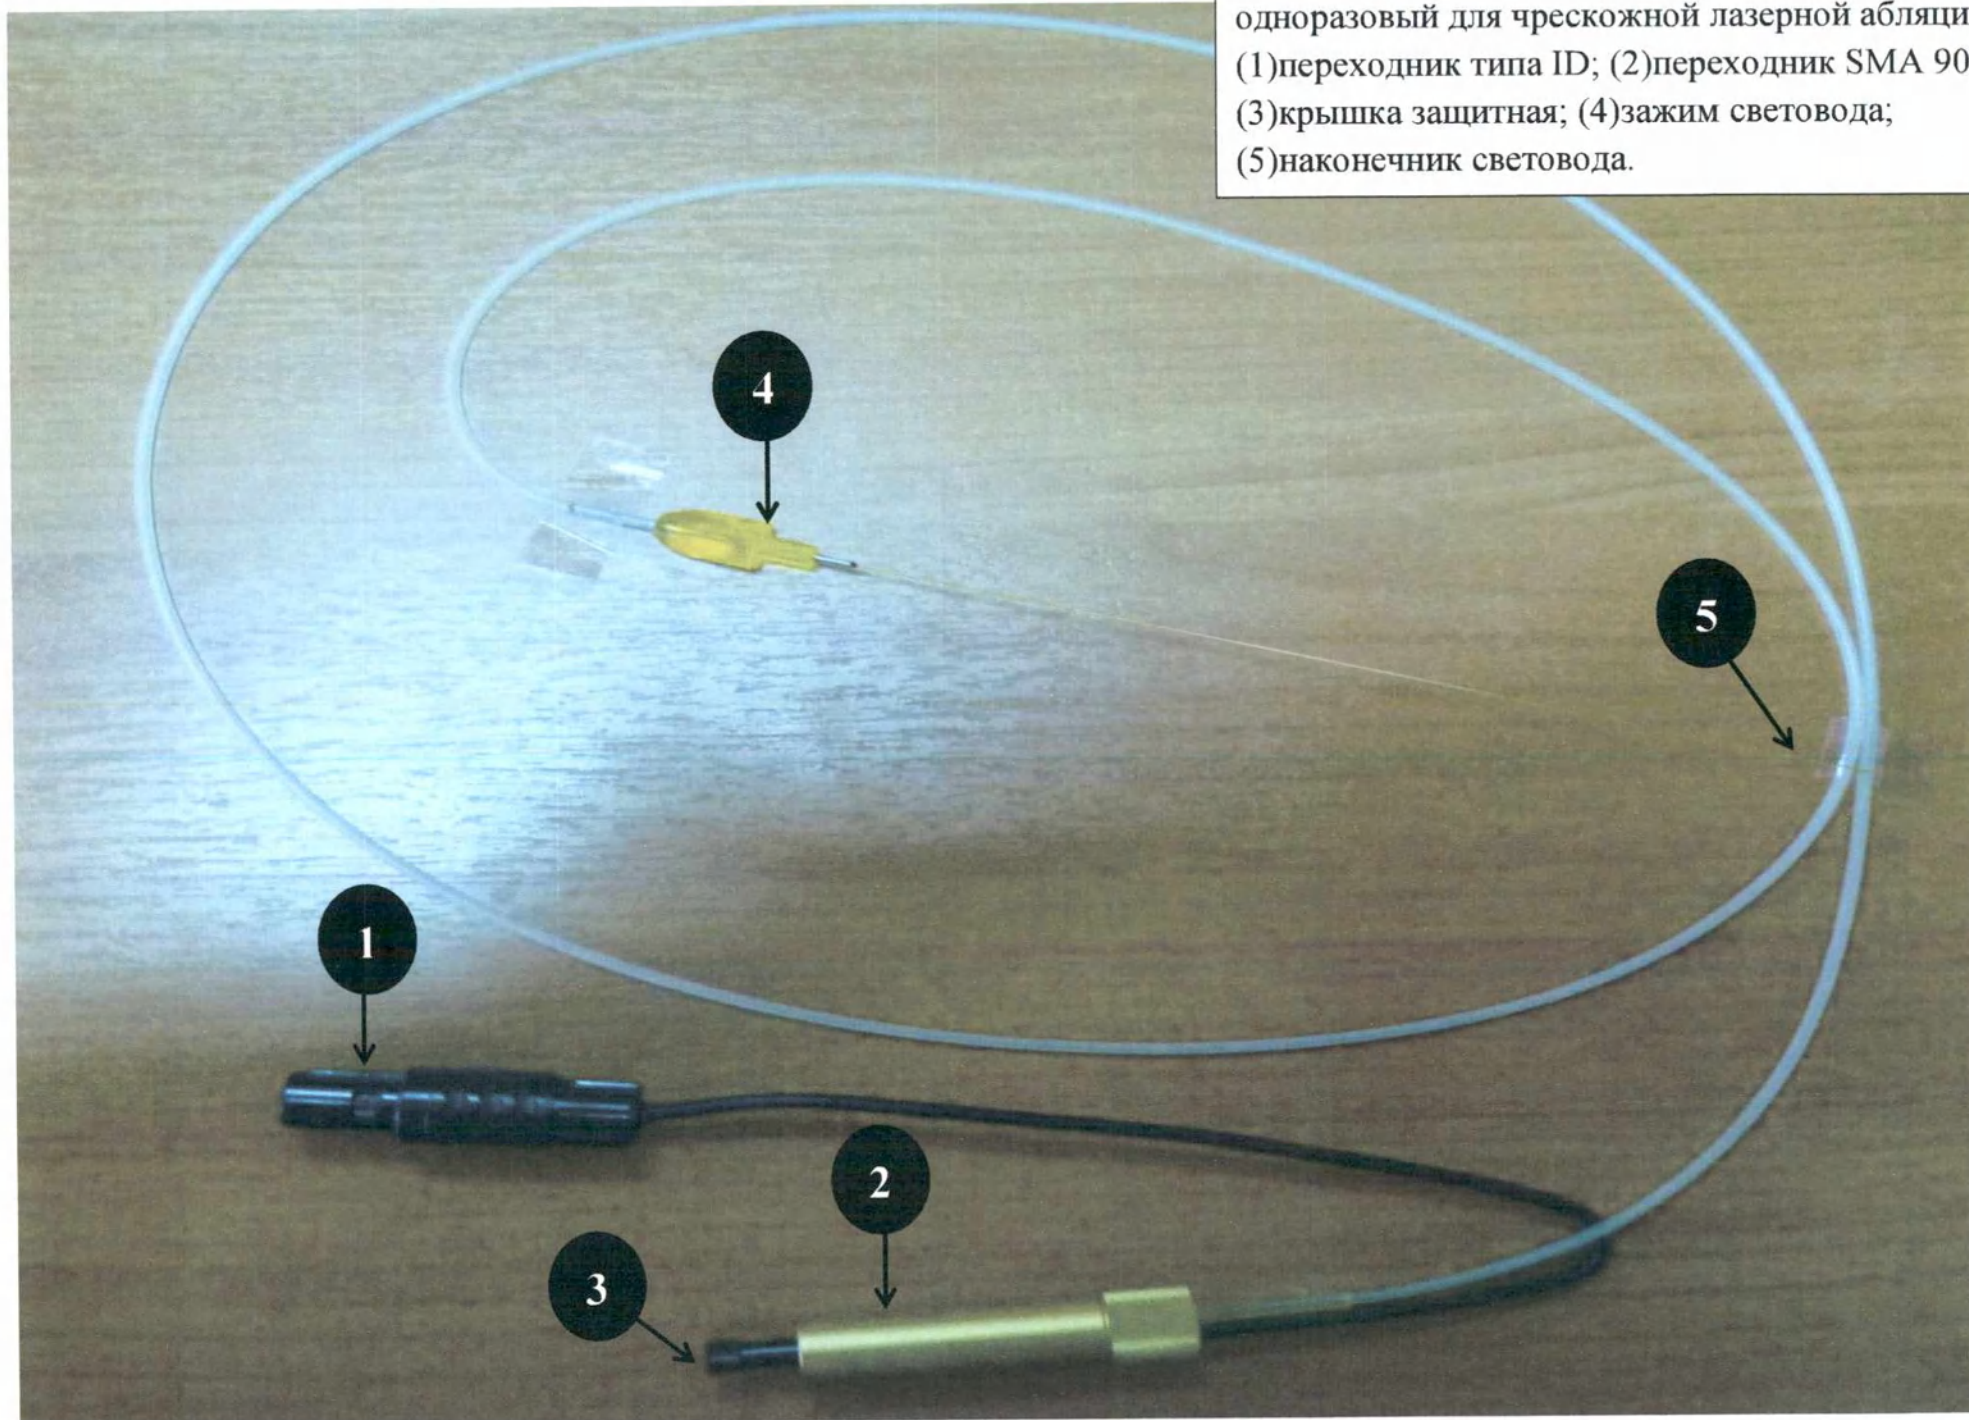




Рис. 3 Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-Y (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции): игла, размер 21G, длина 20 см.

Рис. 4 Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-B (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 20 см.



Рис. 5 Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-R (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 20 см.

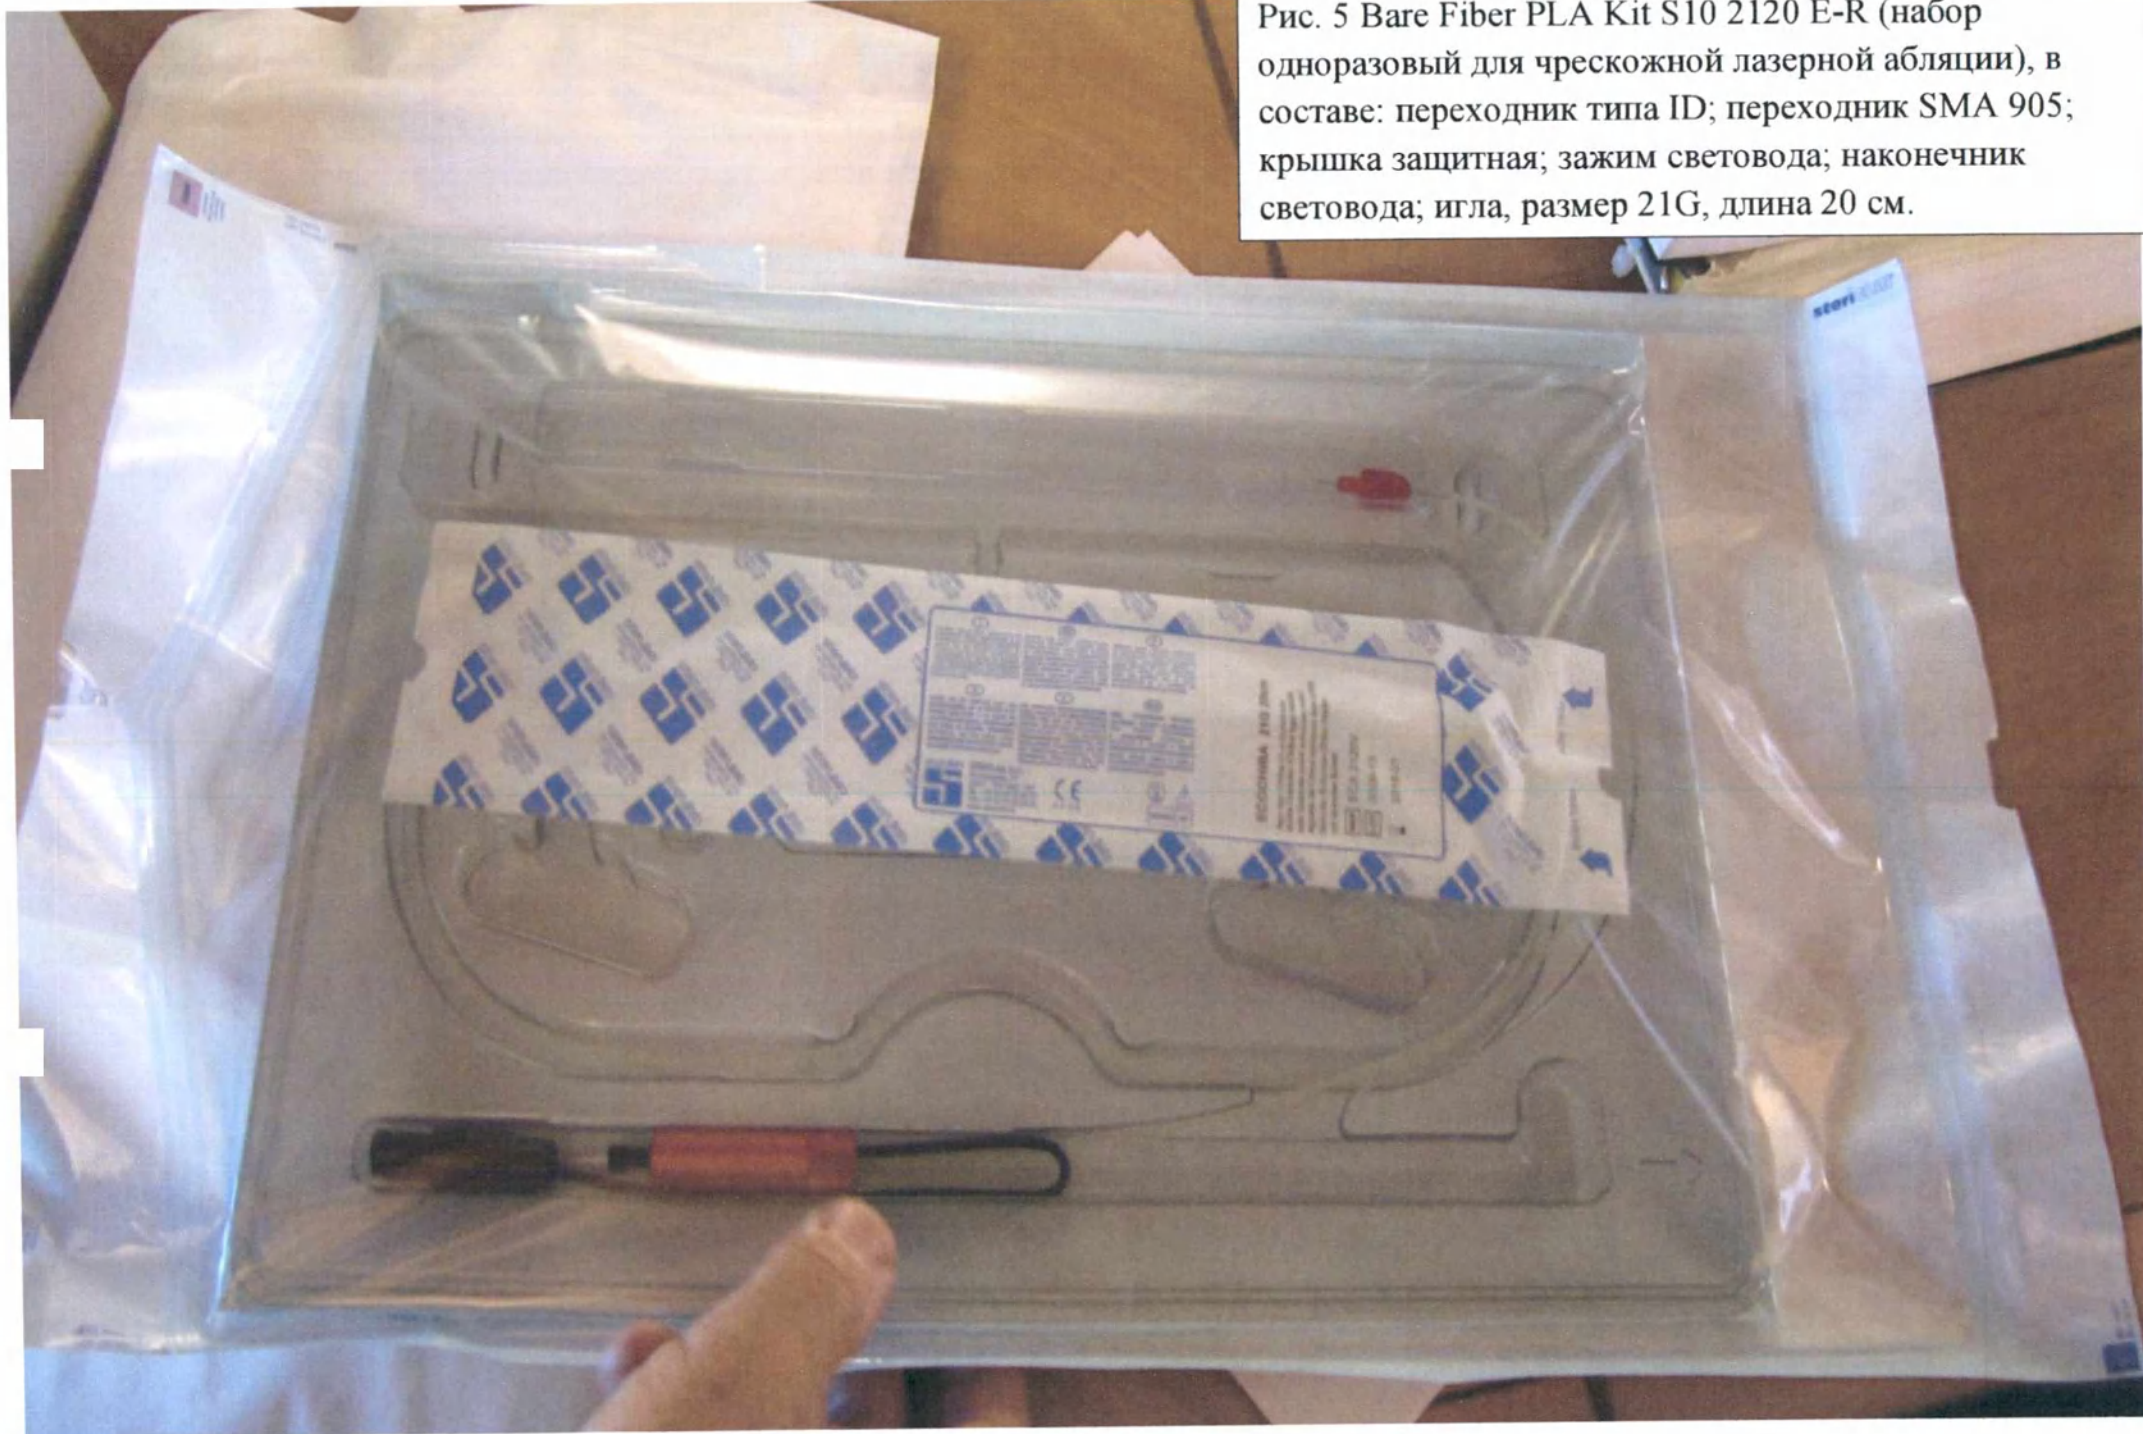


Рис. 6 Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-G (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 20 см.





Рис.7 Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E-G (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 11 см.

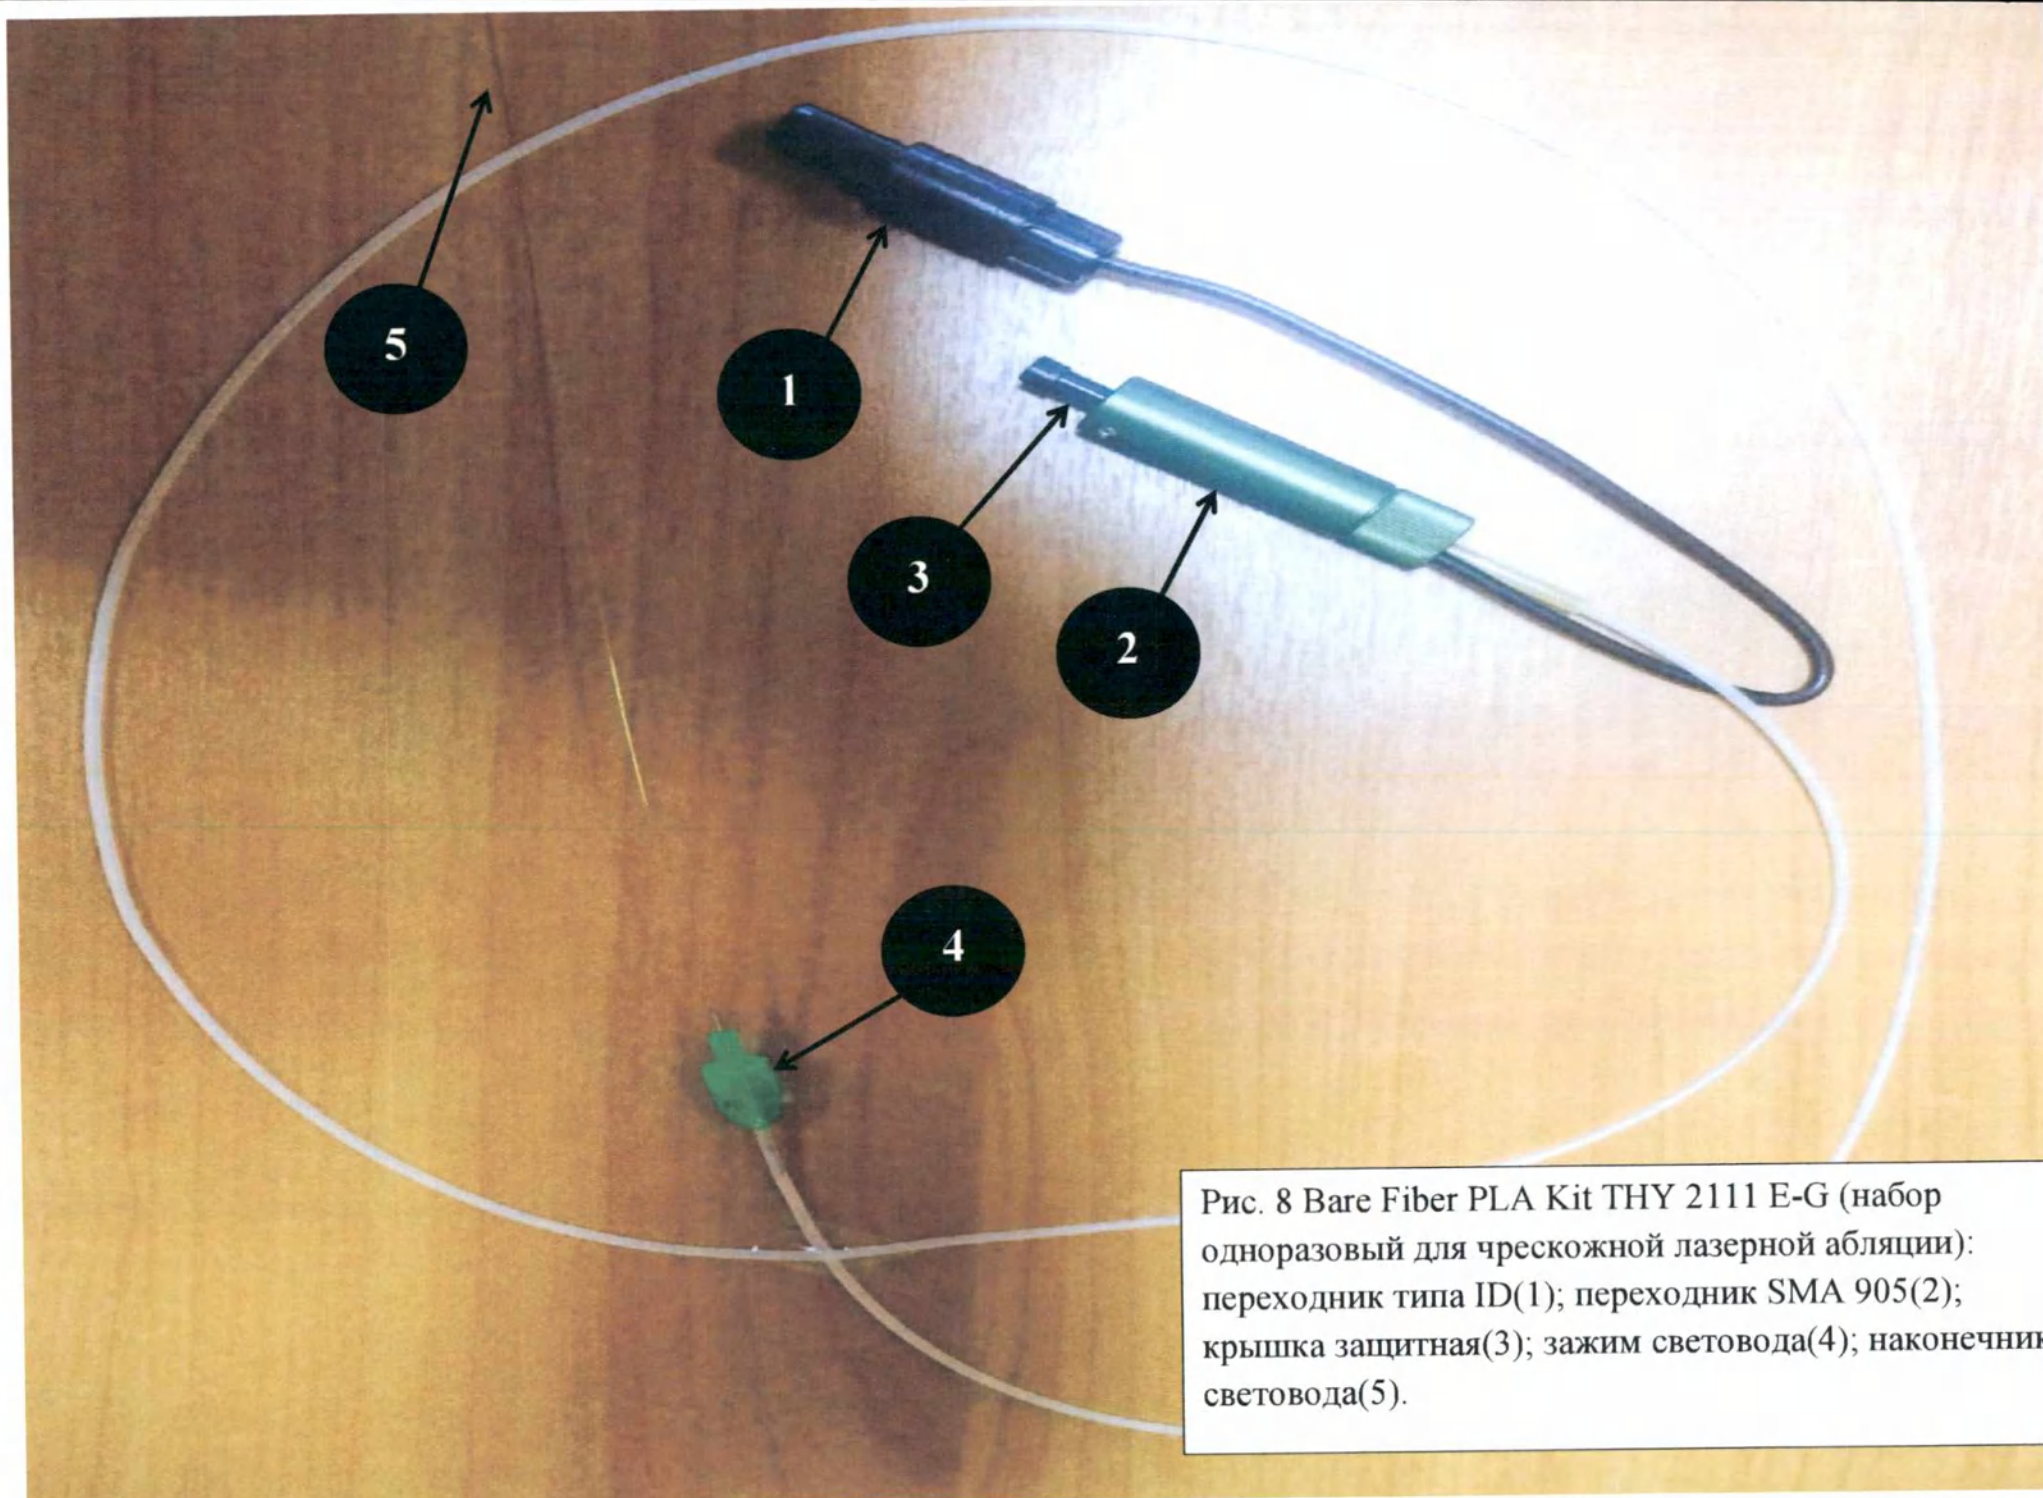


Рис. 8 Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E-G (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции): переходник типа ID(1); переходник SMA 905(2); крышка защитная(3); зажим световода(4); наконечник световода(5).



Рис.9 Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E-G (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции): игла, размер 21G, длина 11 см.




Рис.10 Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E- Y (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 11 см.



Рис. 11 Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E-B (набор одноразовый для чрескожной лазерной абляции), в составе: переходник типа ID; переходник SMA 905; крышка защитная; зажим световода; наконечник световода; игла, размер 21G, длина 11 см.

MANUFACTURED
EXCLUSIVELY FOR:
专为ELESTA制造



REF 产品编号

Bare Fiber PLA KIT S10 2120E R

Order number /

订单号:

2917

ELESTA S.R.L.
VIA BALDANZESE, 17
50041 CALENZANO (FI)
ITALY
TEL +39/055-8826807
FAX +39/055-8832884


Connector/ 连接器:	free standard SMA	Numerical aperture/ 孔径值:	0.22	Fiber length/ 光纤长度:	1.50 m
Wave length/ 波长:	800-1064 nm	Core diameter/ 纤芯直径:	300µm	Minimum bend radius/ 最小弯曲半径:	36 mm
		If individual pouch is not opened or damaged 如果独立的包装袋没有打开或损坏			
		for single use only 一次性使用			
		only for short term use according to EN ISO 10993 根据EN ISO 10993为短期使用			
		not for applications class III according to MDD 93/42/EEC 根据MDD 93/42/EEC不用于III类应用			
		Sterilizing date/ 灭菌日期:		Asclepion Laser Technologies GmbH Brüsseler Straße 10 07747 Jena, Germany Phone: +49 3641 7700 100 www.asclepion.com	
		16.02.2013			
		Expiration date/ 有效期截止日期:			
		16.02.2018			
		Lot-Nr / 批号:			
		08022013A			



ECHOLASER X4

Рис.13 Фотография маркировки набора Bare Fiber PLA Kit S10 2120 E-R

MANUFACTURED
EXCLUSIVELY FOR:
专为ELESTA制造





REF 产品编号

Bare Fiber PLA KIT THY 2111E B

Order number /

订单号: 2906

ELESTA S.R.L.
VIA BALDANZESE, 17
50041 CALENZANO (FI)
ITALY
TEL +39/055-8826807
FAX +39/055-8832884

Connector/ 连接器:	free standard SMA	Numerical aperture/ 孔径值:	0.22	Fiber length/ 光纤长度:	1.50 m
Wave length/ 波长:	800-1064 nm	Core diameter/ 纤芯直径:	300µm	Minimum bend radius/ 最小弯曲半径:	36 mm
		If individual pouch is not opened or damaged 如果独立的包装袋没有打开或损坏			
		for single use only 一次性使用			
		only for short term use according to EN ISO 10993 根据EN ISO 10993为短期使用			
		not for applications class III according to MDD 93/42/EEC 根据MDD 93/42/EEC不用于III类应用			
		Sterilizing date/ 灭菌日期:		16.02.2013	
		Expiration date/ 有效期截止日期:		16.02.2018	
		Lot.-Nr./ 批号:		07022013A	
				Asclepion Laser Technologies GmbH Brüsseler Straße 10 07747 Jena, Germany Phone: +49 3641 7700 100 www.asclepion.com	
					

ECHOLASER X4

Рис. 14 Фотография маркировки набора Bare Fiber PLA Kit THY 2111 E-B

Бюл. 14 фотобумага лаборатория №106 Бирю КИЛН. 5111Е-В

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ лист(ов)
Генеральный директор
ООО "МедТехКонсалт"
И.В. Королева

