



Руководитель группы


ООО «Сименс Здравоохранение»

Левитский И. И.

набore 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Система рентгенографическая MULTIX Impact с принадлежностями»

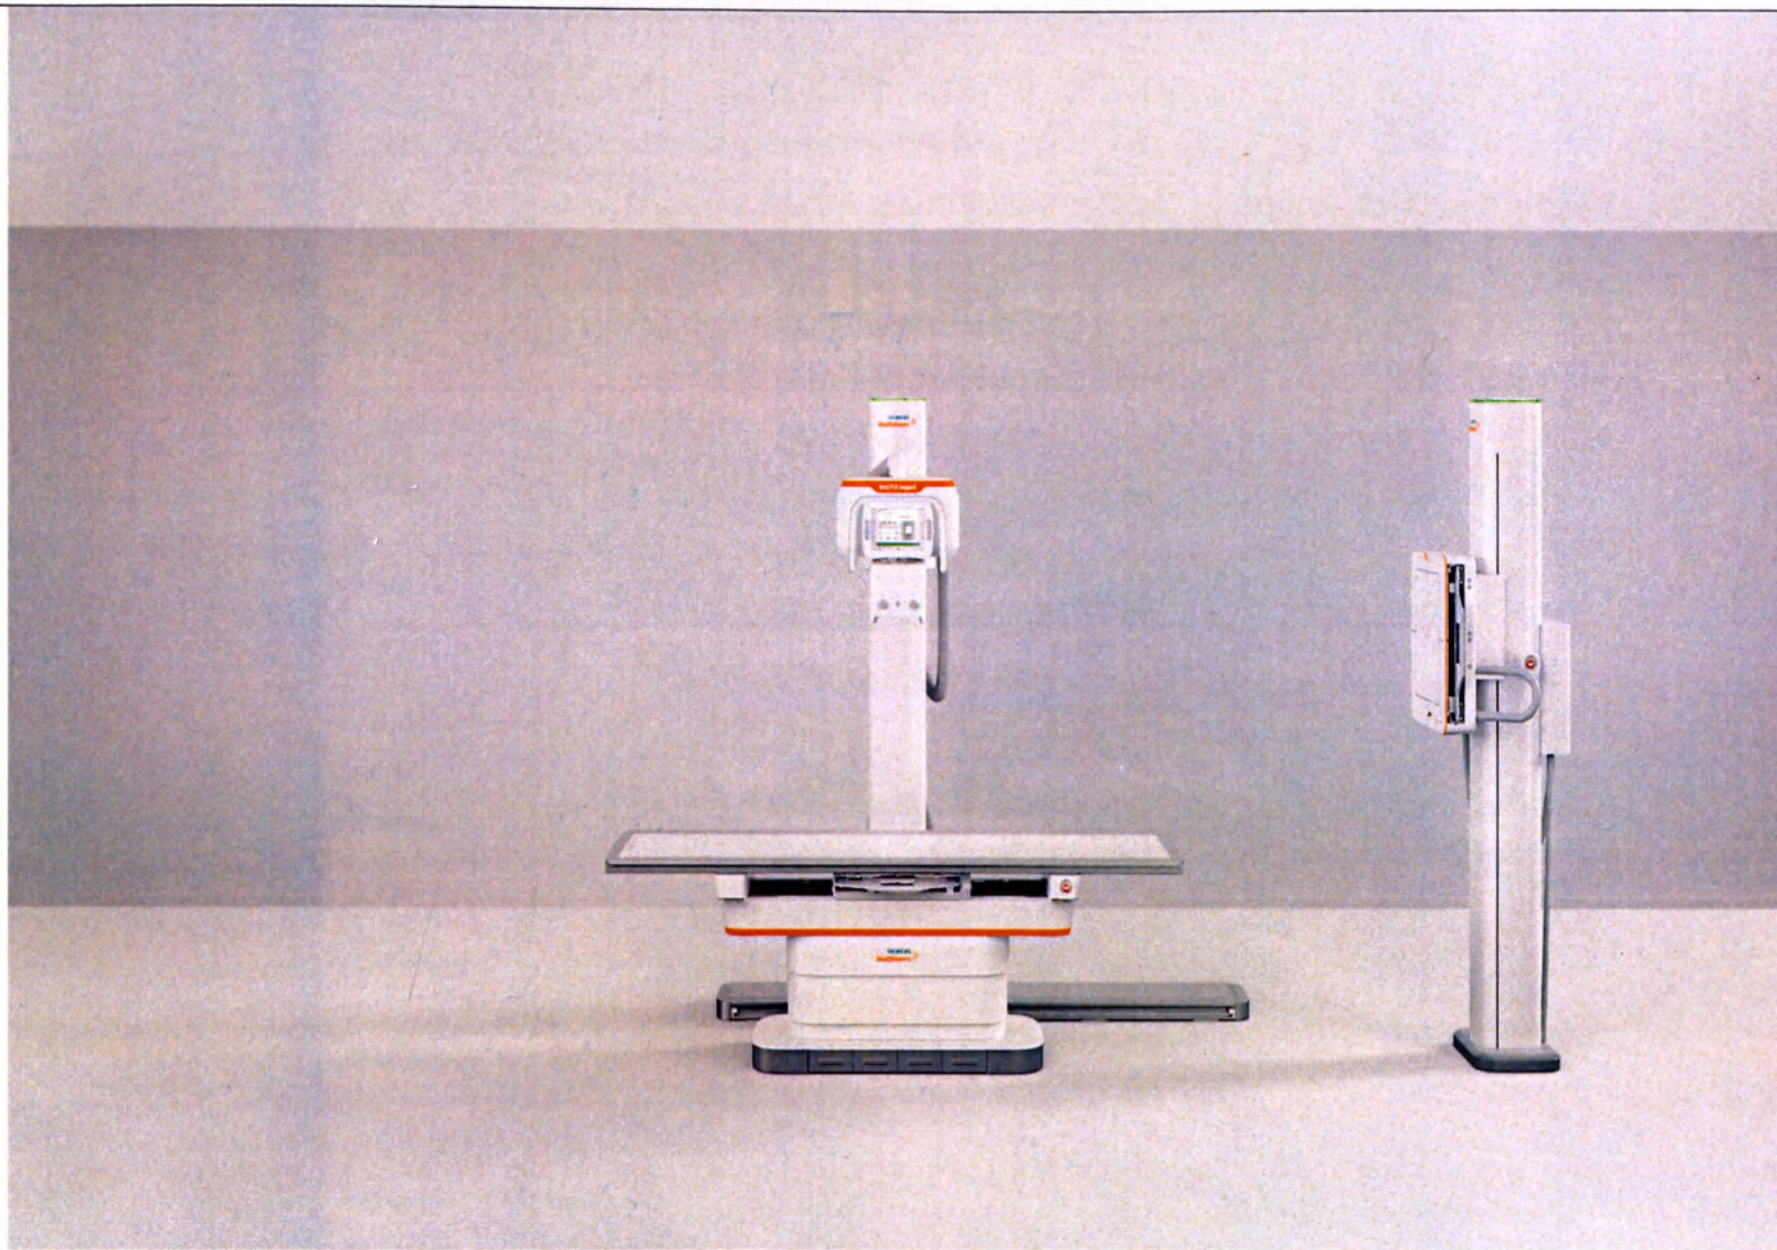


Общий вид медицинского изделия «Система рентгенографическая MULTIX Impact с принадлежностями»




1.1 Штатив напольный, варианты исполнения: - полуавтоматический; и/или - автоматический и/или - ручной, вид спереди
Стойка с трубкой, вид спереди




1.2 Штатив напольный, варианты исполнения: - полуавтоматический; и/или - автоматический и/или - ручной,
вид сзади
Стойка с трубкой, вид сзади

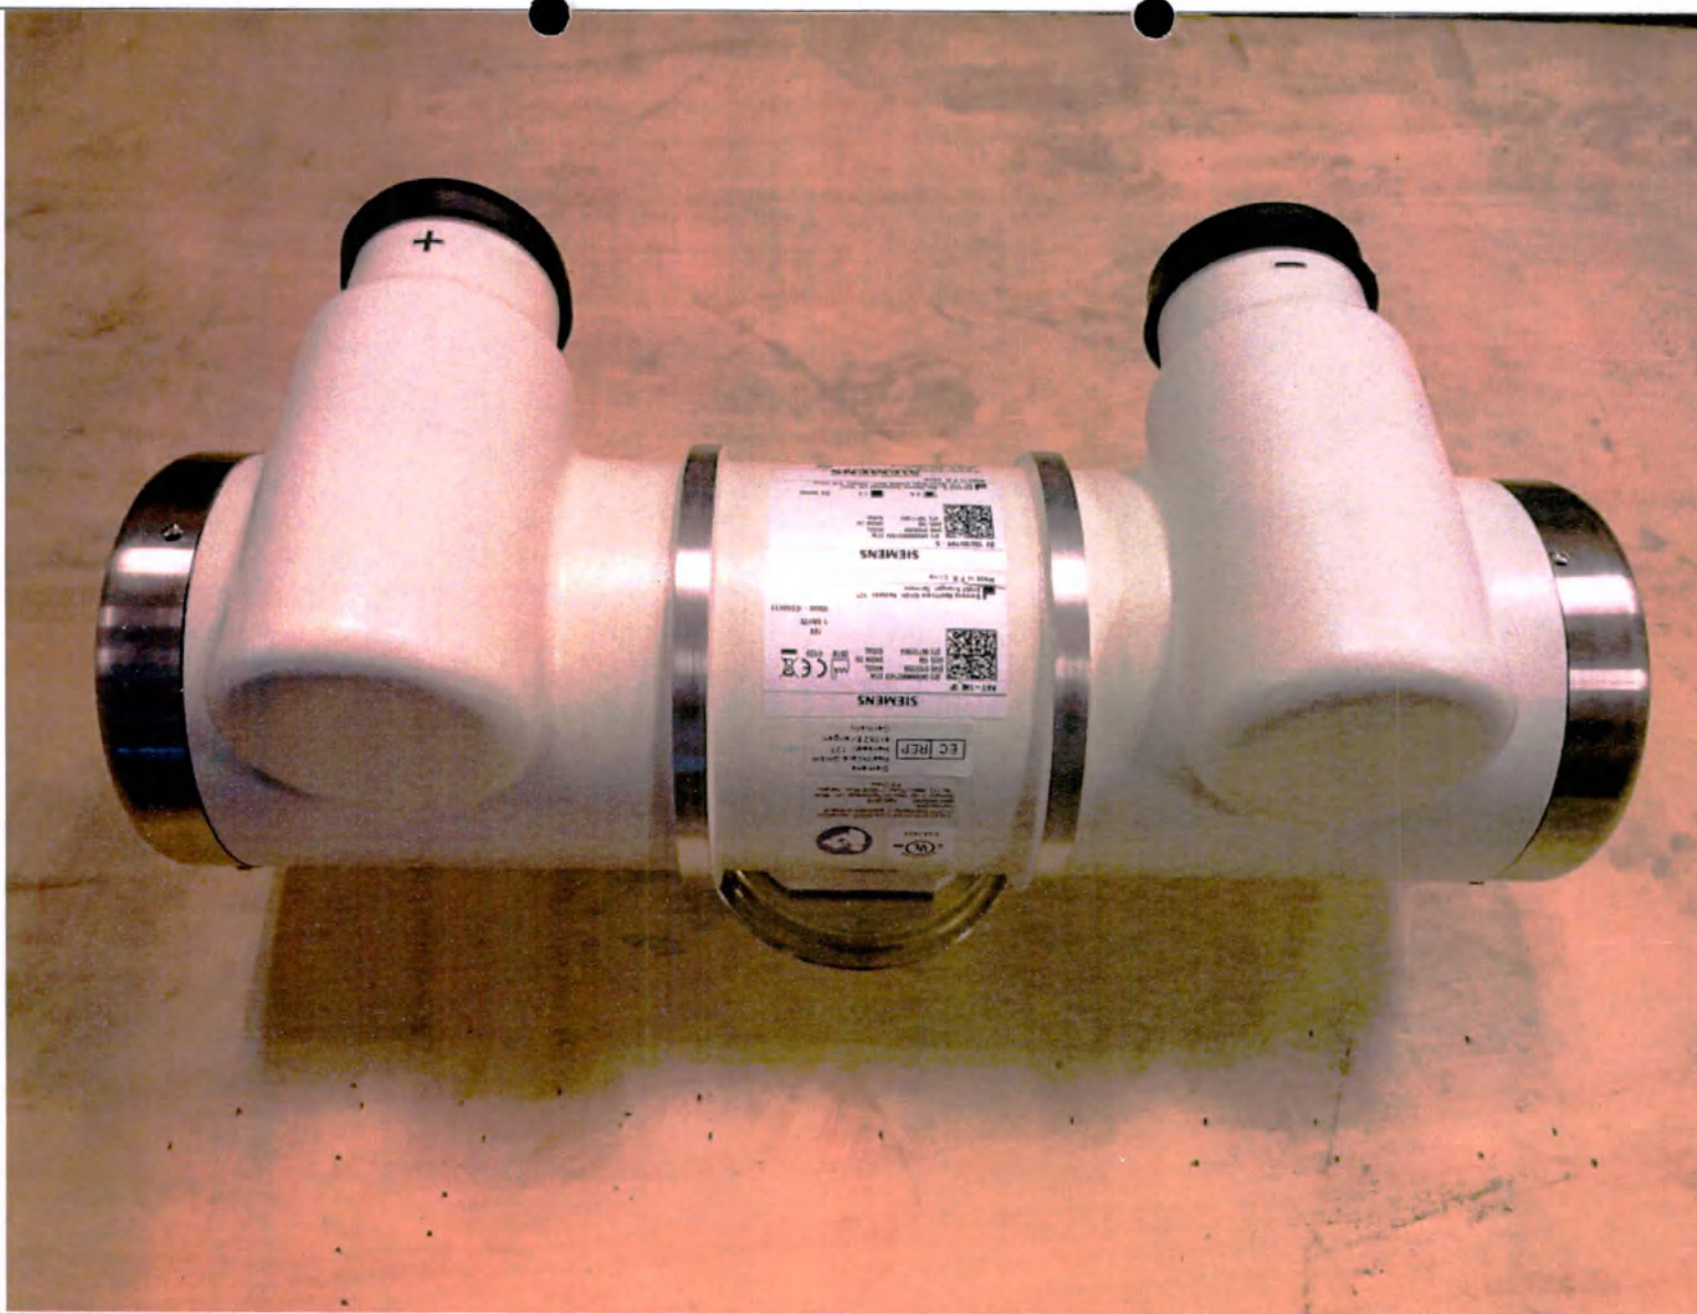


2. Трубка рентгеновая

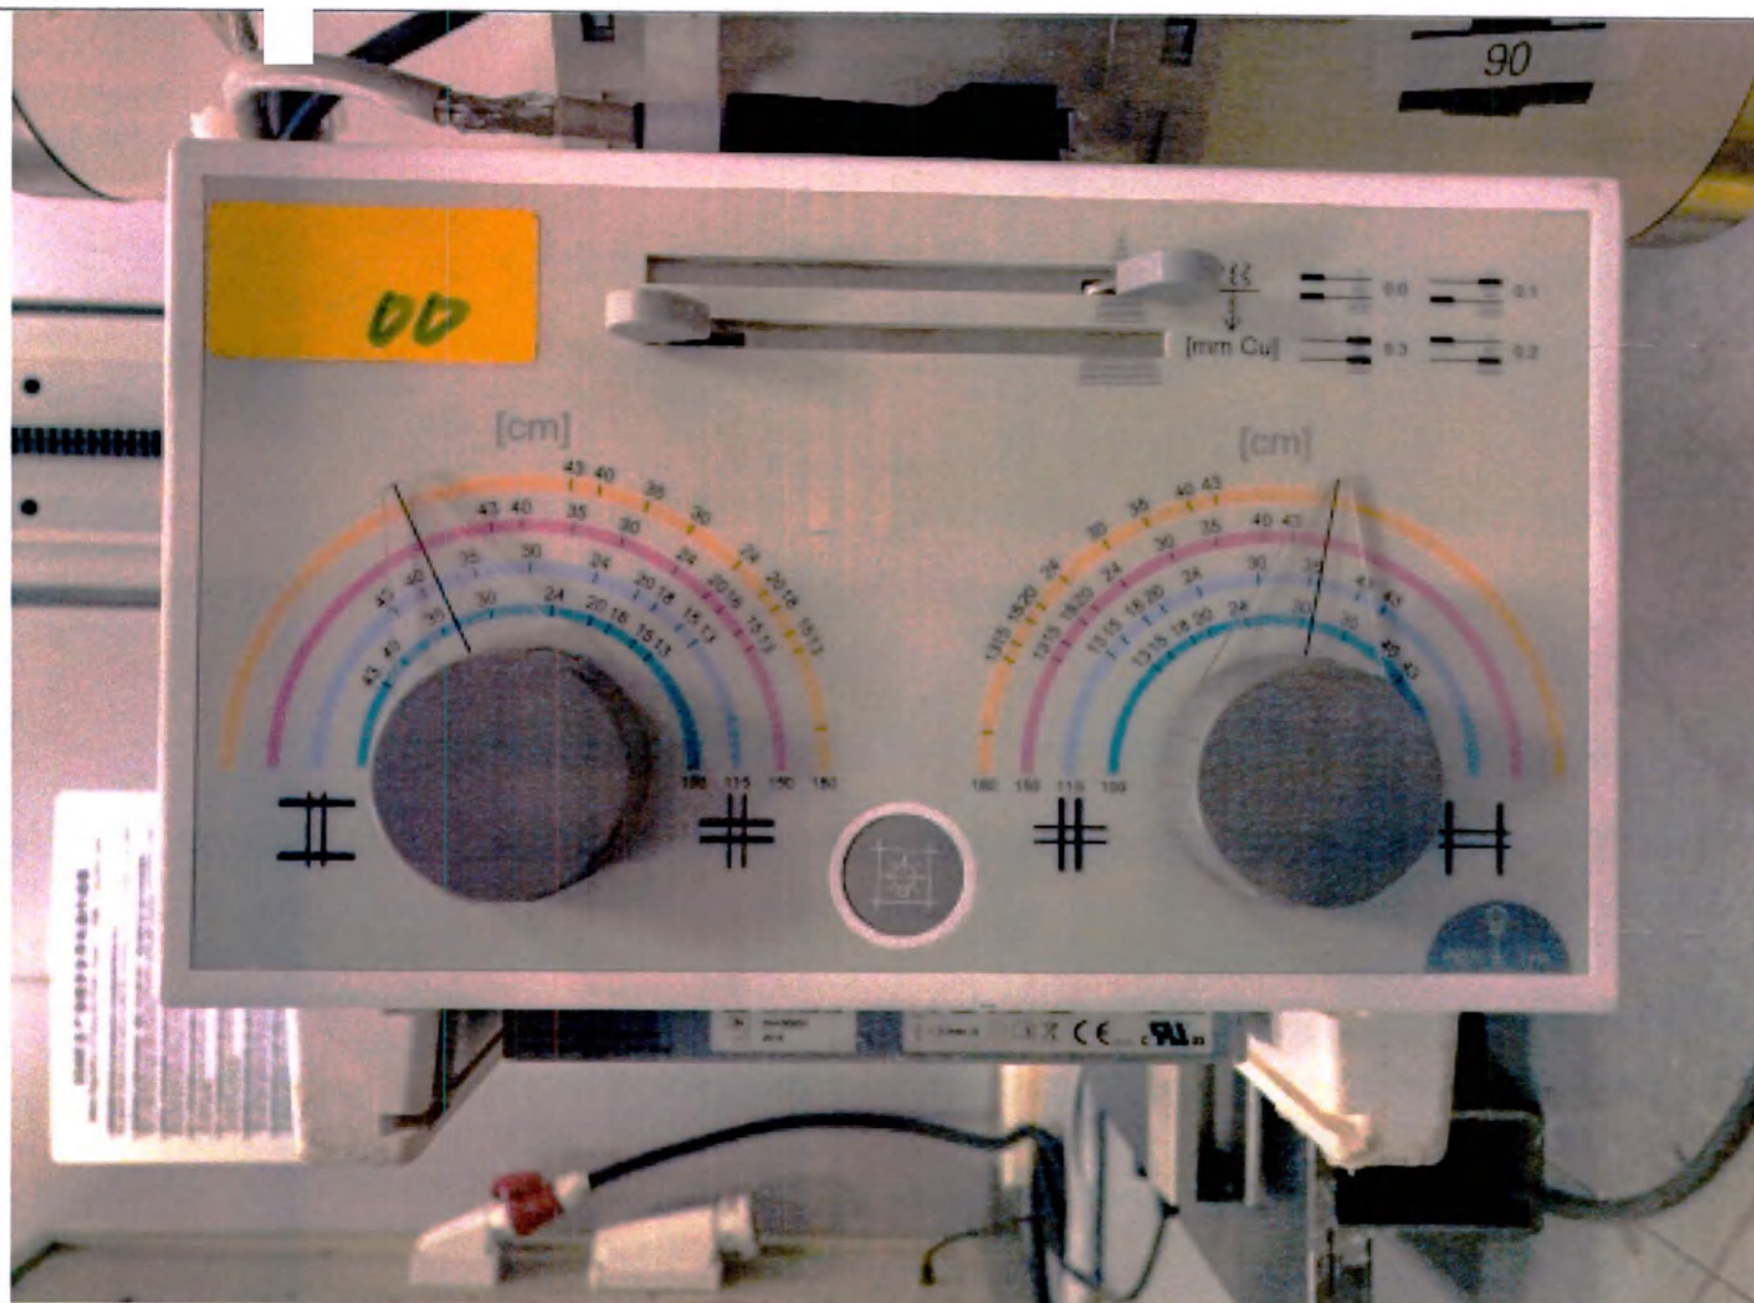


3.1 Коллиматор, вариант исполнения: ручной

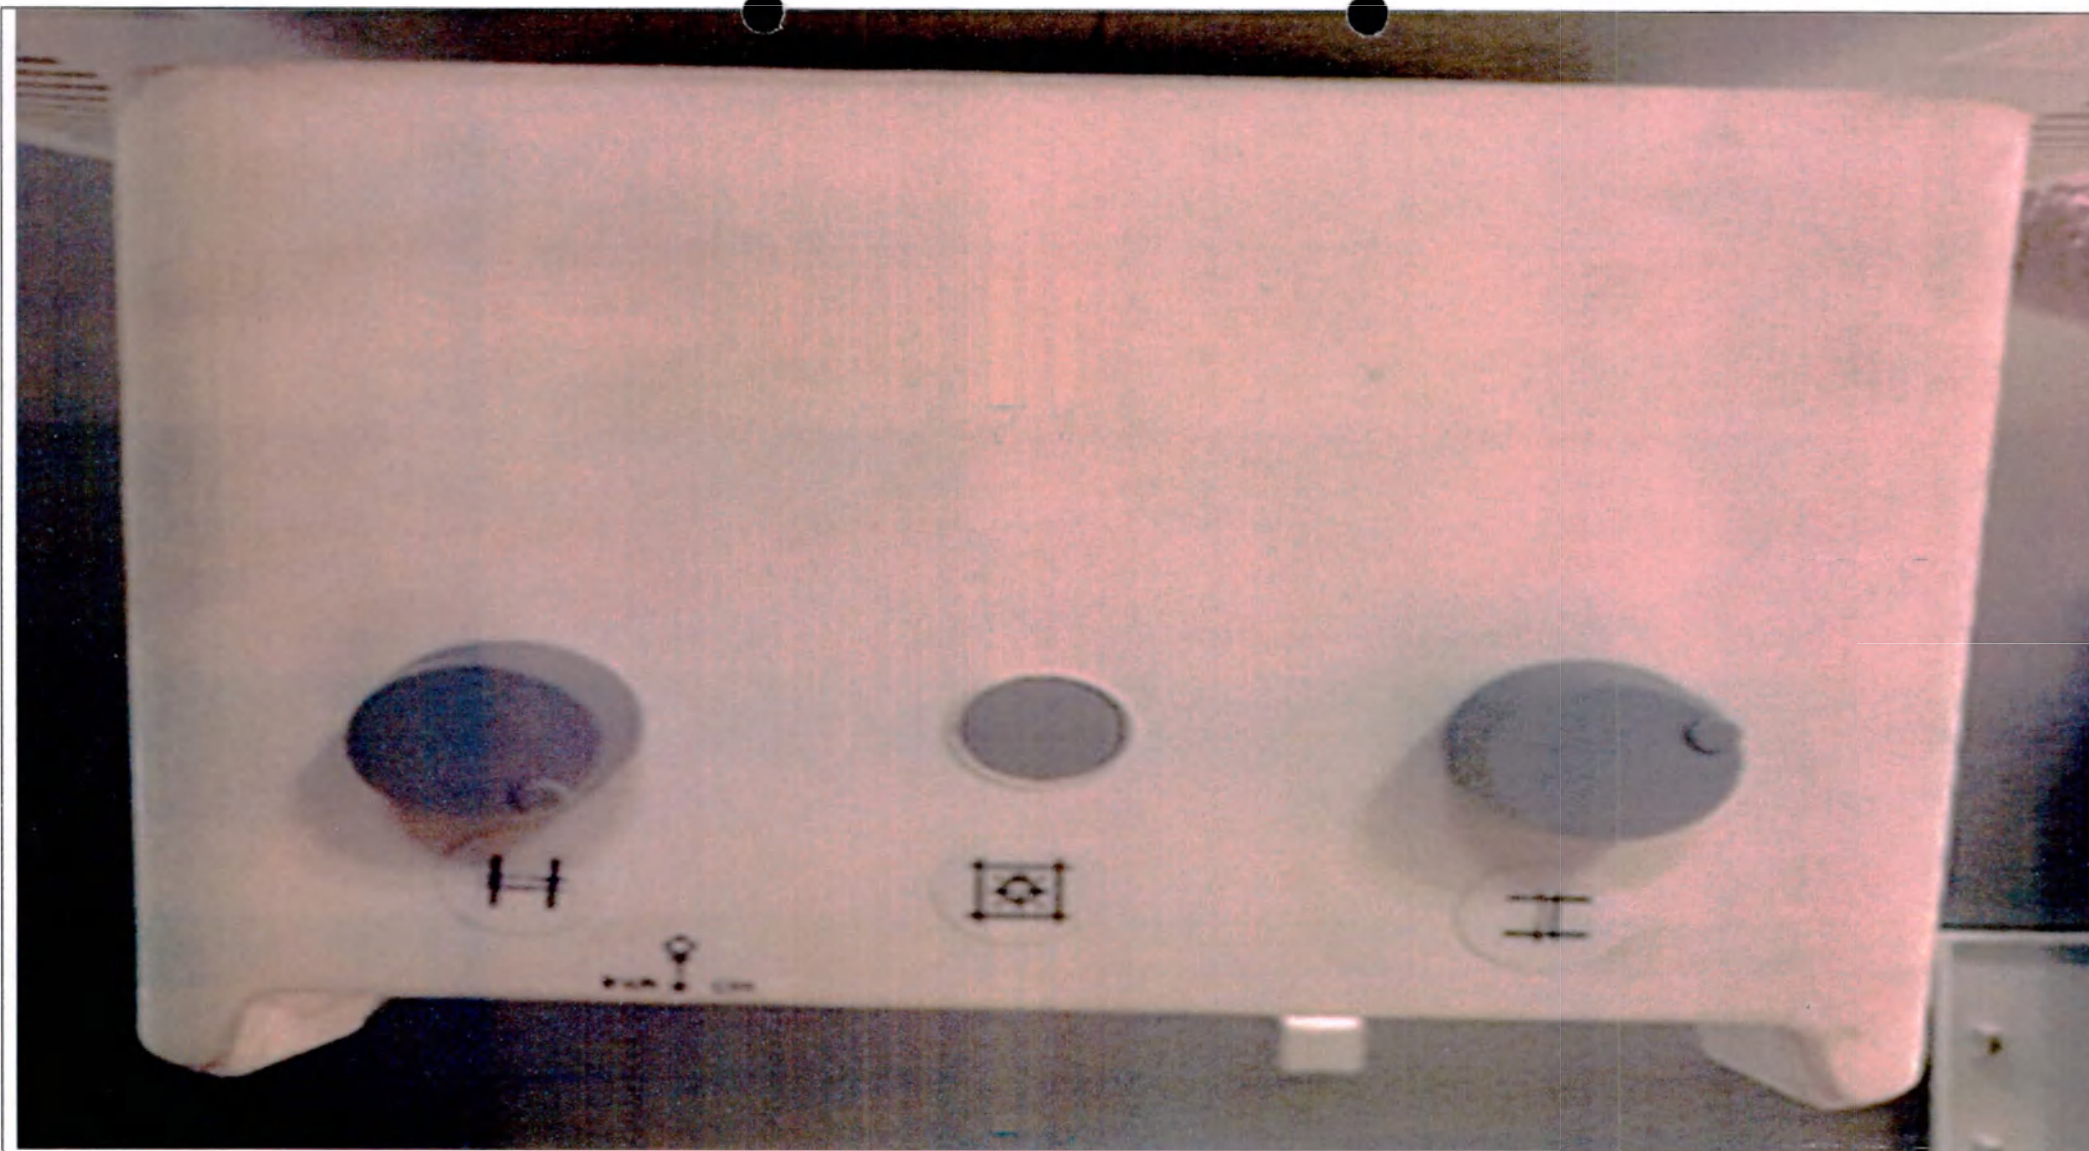


3.2 Коллиматор, вариант исполнения: автоматический

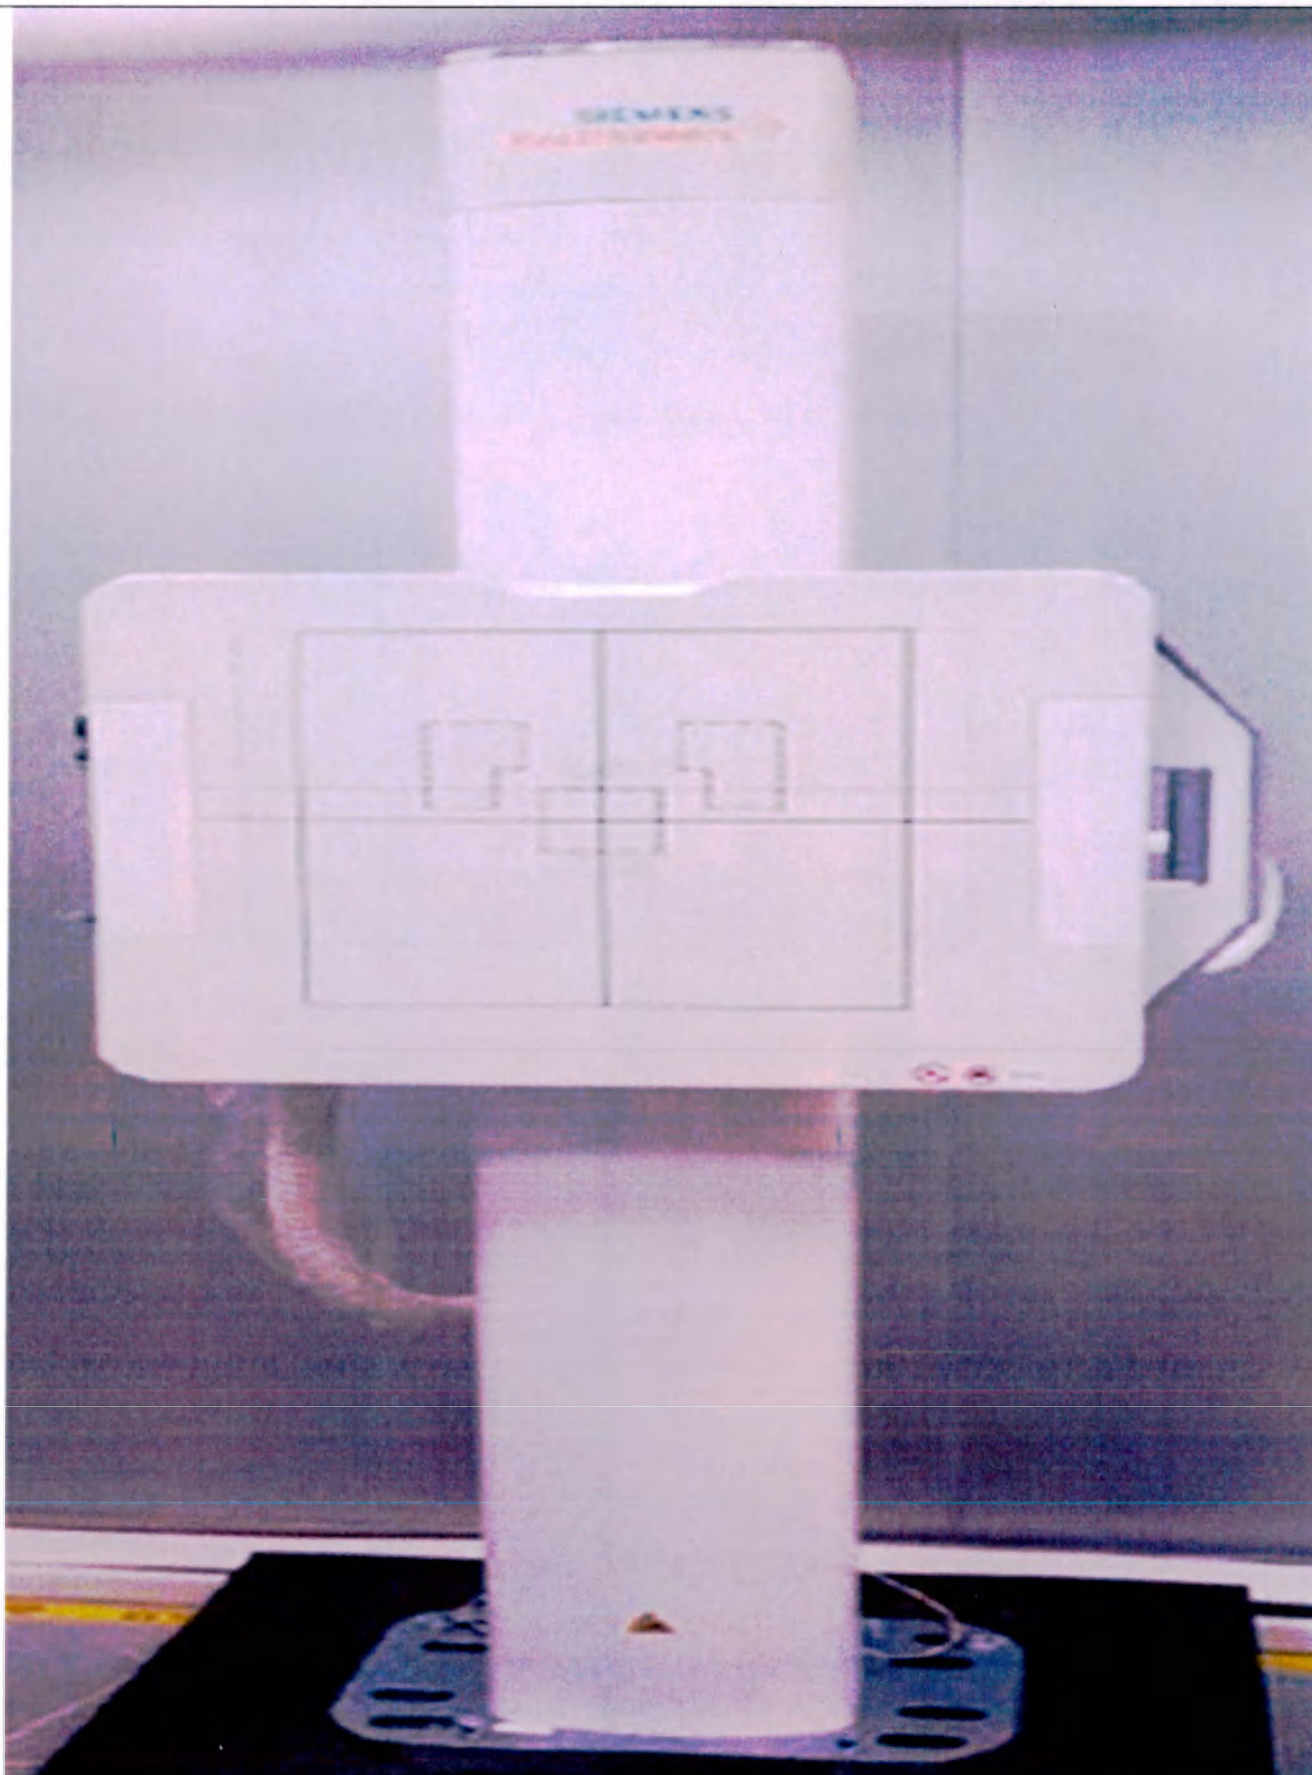

4.1 Стойка вертикальная, варианты исполнения: - для беспроводного детектора MAX wi-D (автоматическая) и/или - для беспроводного детектора Core XL (автоматическая) и/или - для беспроводного детектора Core XL (ручная) и/или - для детектора Core static, эксплуатируемая с правой стороны

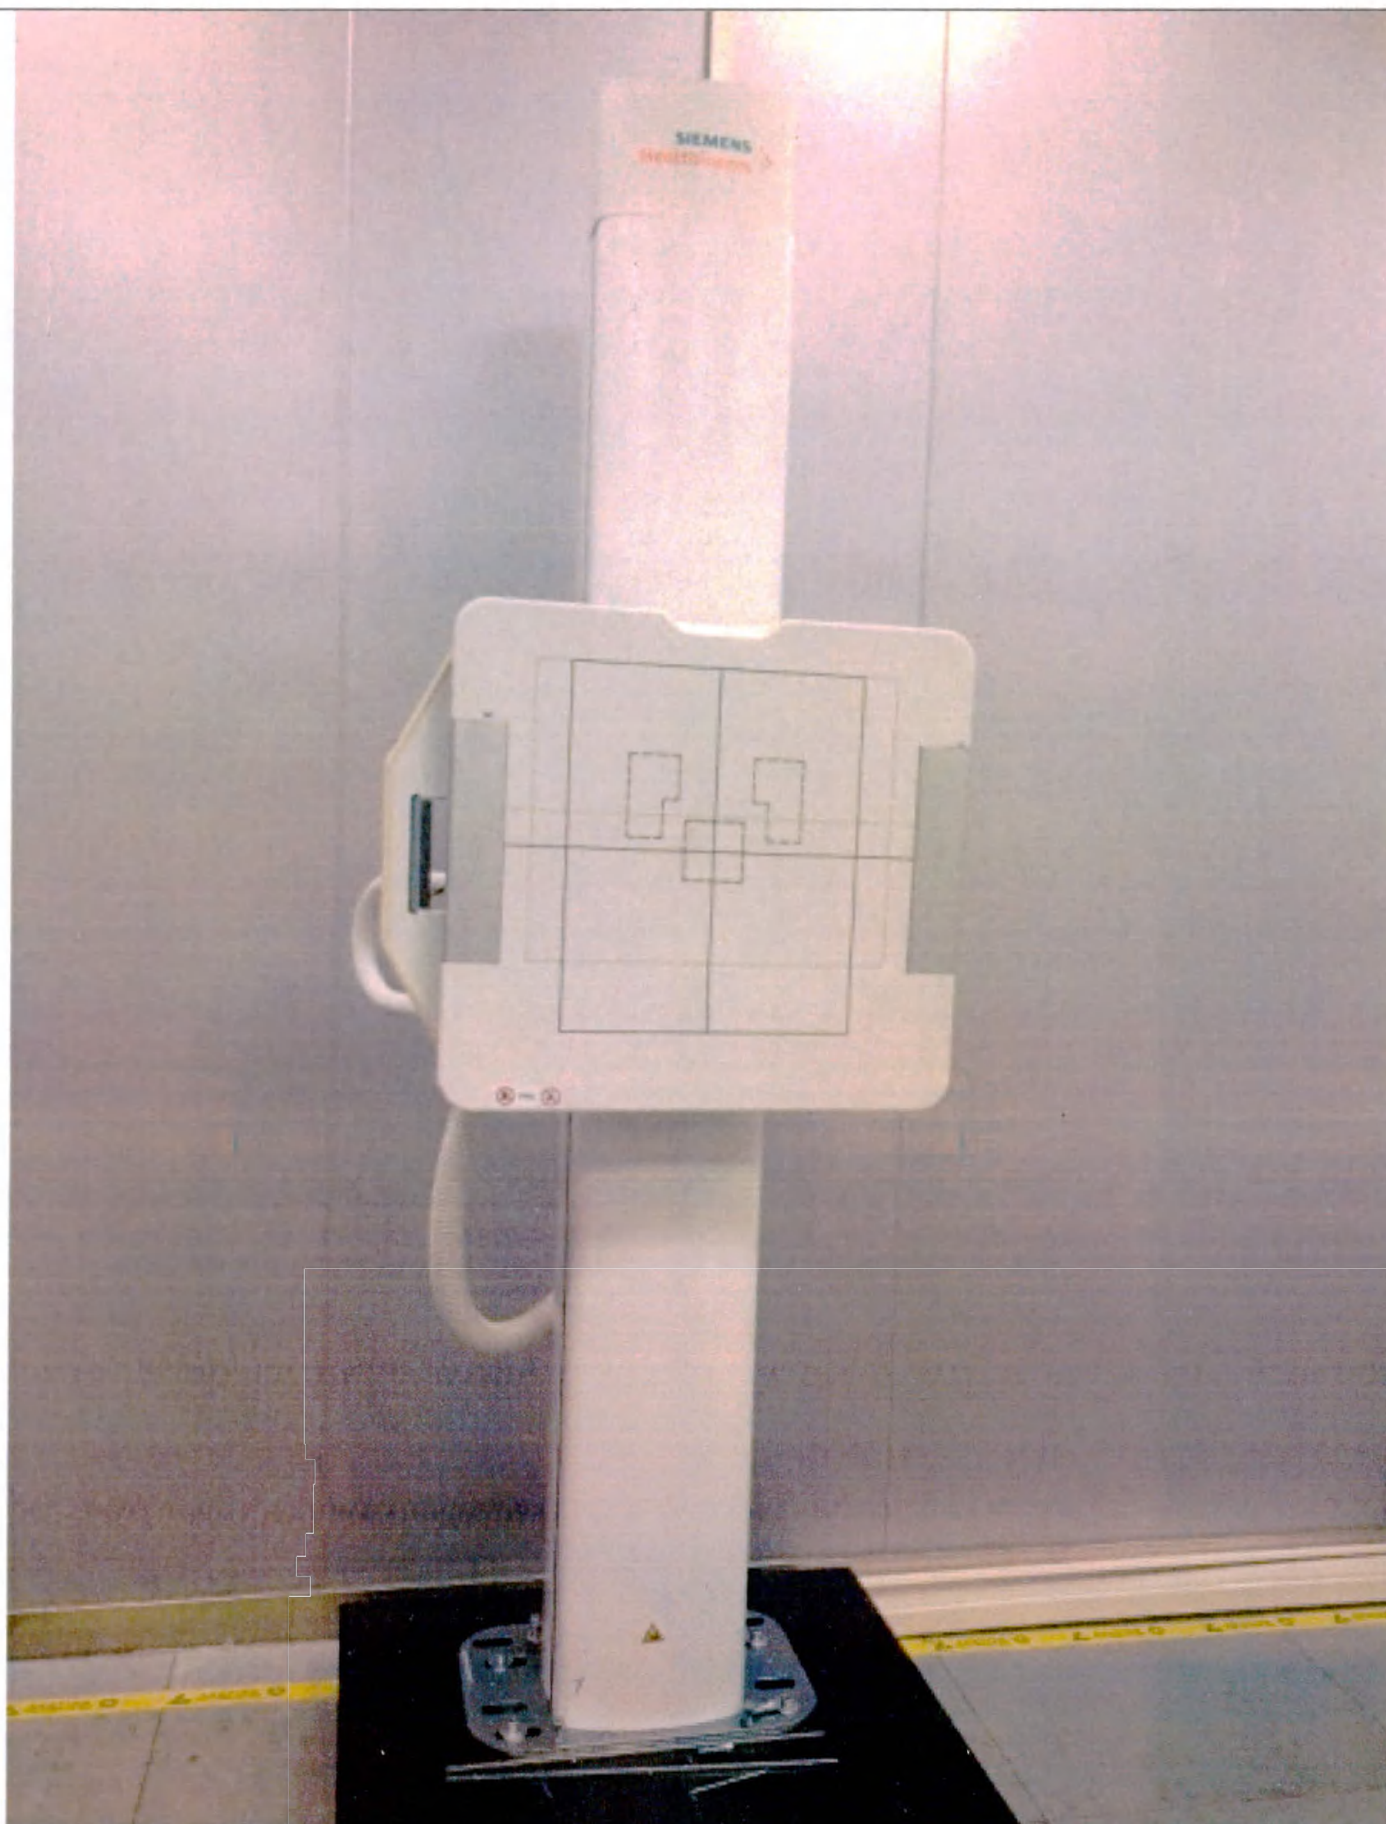


4.2 Стойка вертикальная, варианты исполнения: - для беспроводного детектора MAX wi-D (автоматическая) и/или - для беспроводного детектора Core XL (автоматическая) и/или - для беспроводного детектора Core XL (ручная) и/или - для детектора Core static, эксплуатируемая с левой стороны

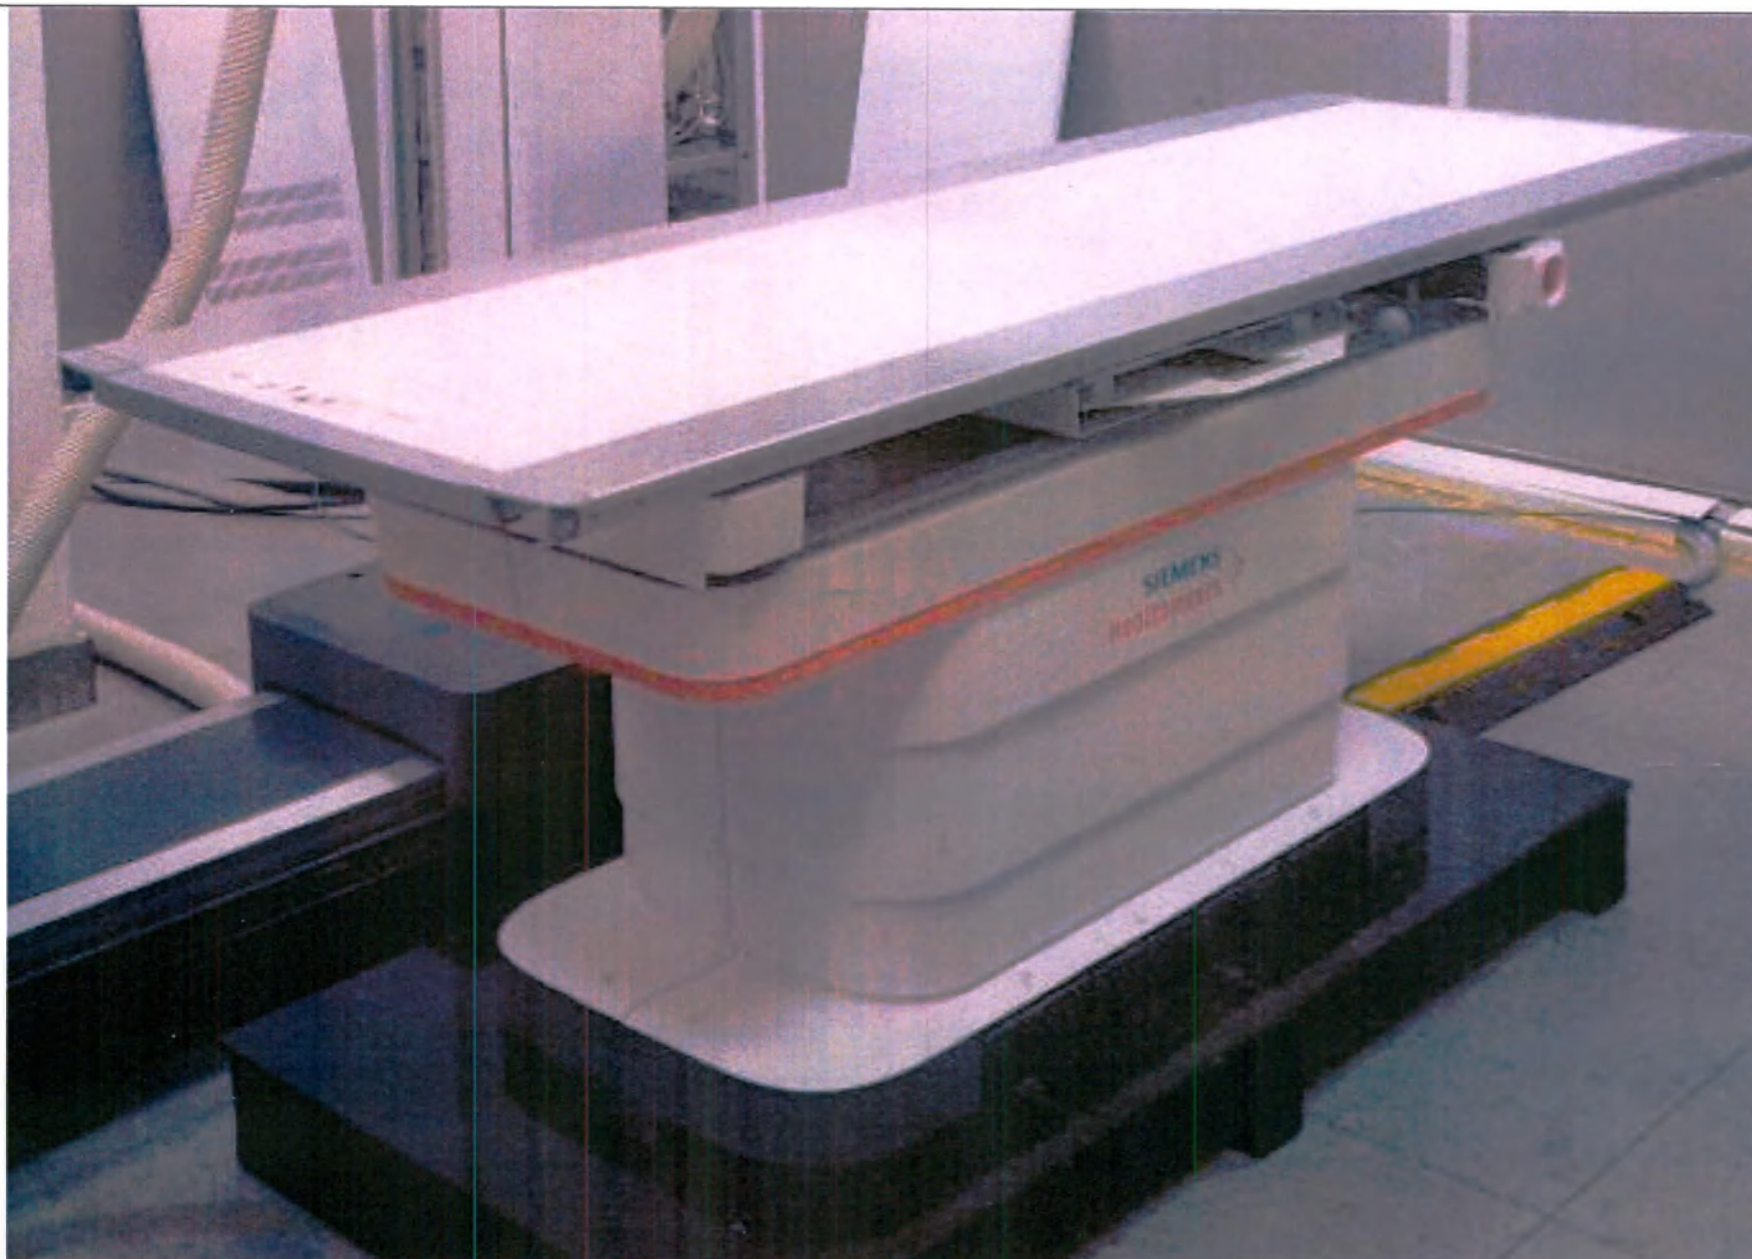

5.1 Стол пациента, варианты исполнения: - для беспроводного детектора MAX wi-D с изменяемой высотой; и/или - для беспроводного детектора Core XL с изменяемой высотой


Регулируемый по высоте стол для MAX wi-D и Core XL

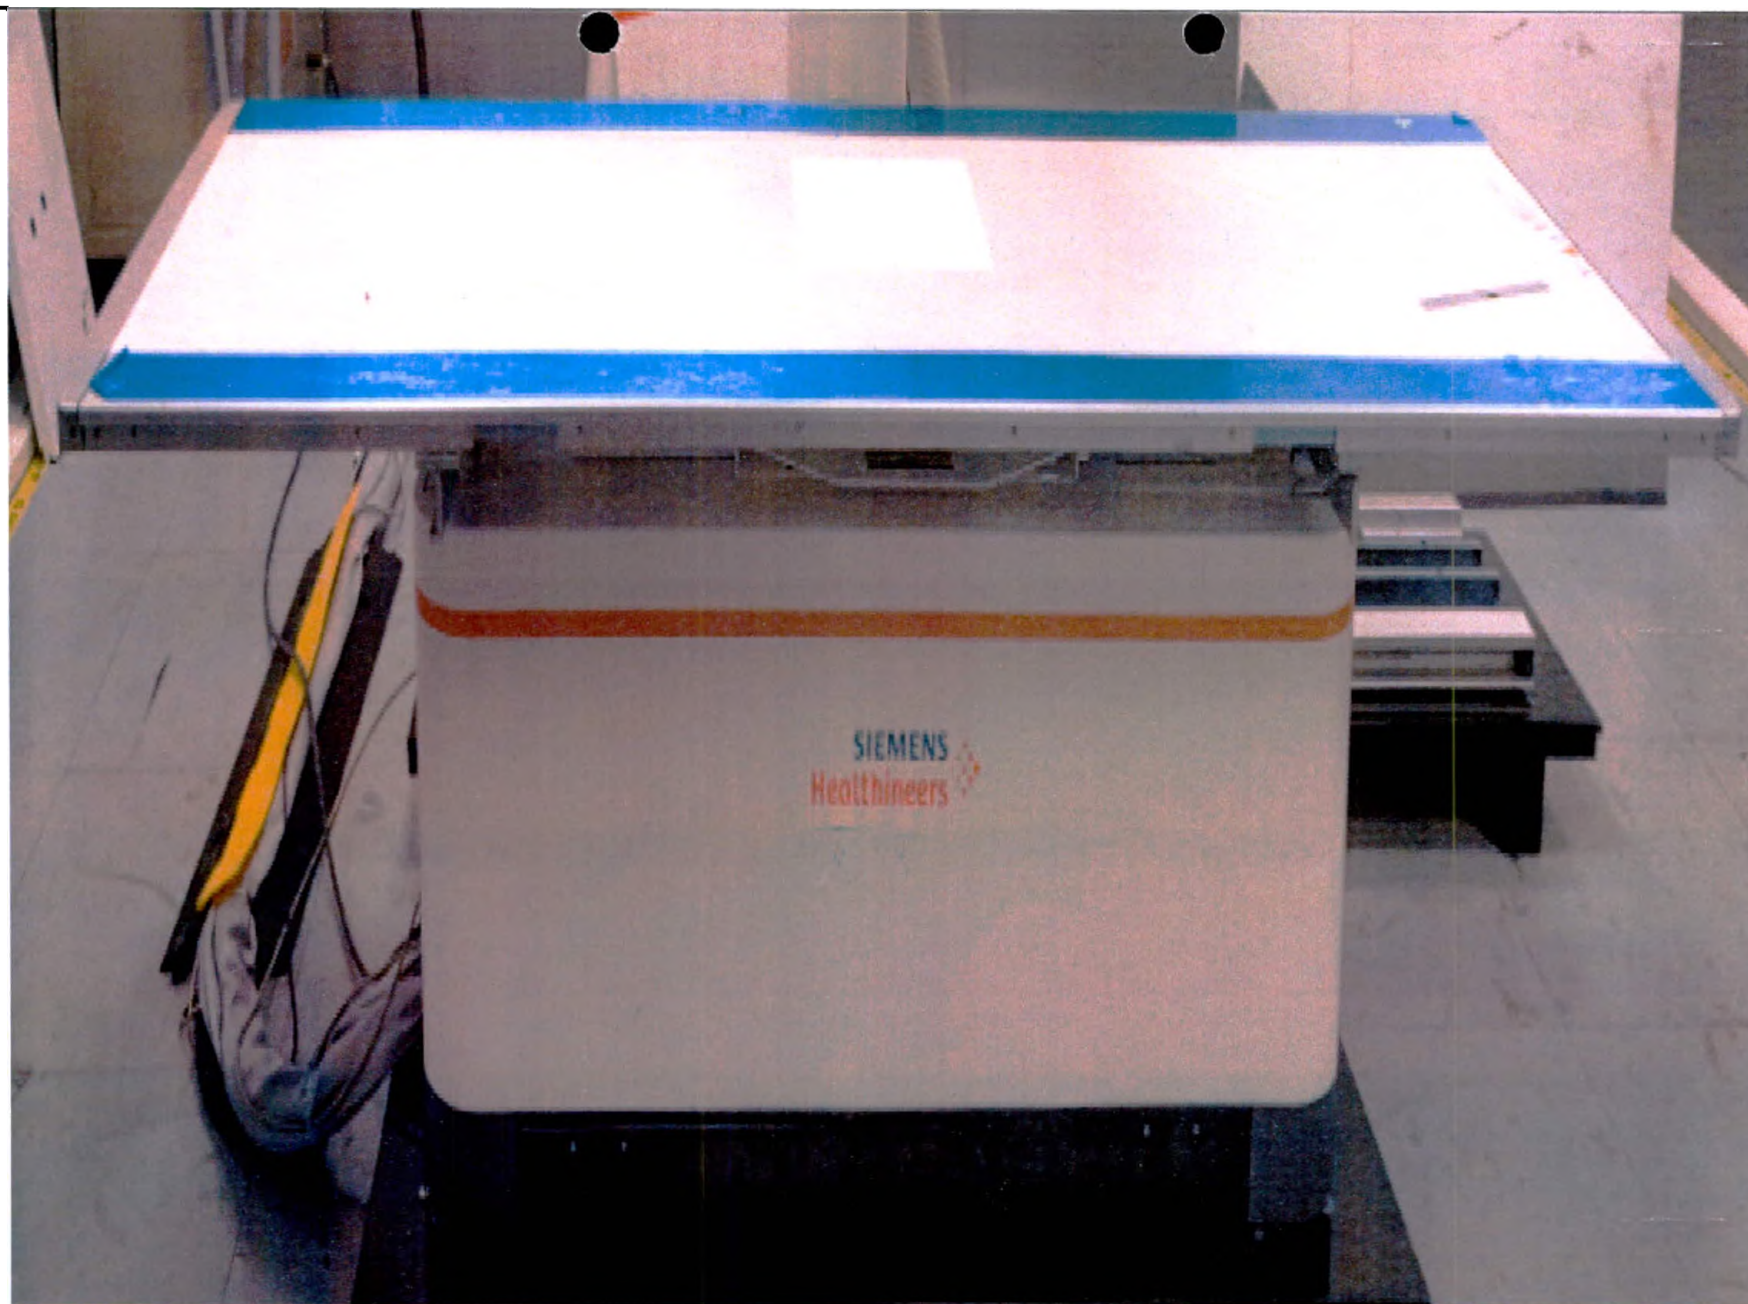


5.2 Стоп пациента, варианты исполнения: - для беспроводного детектора Core XL с фиксированной высотой.



6.1 Детектор беспроводной, варианты исполнения: детектор беспроводной MAX wi-D

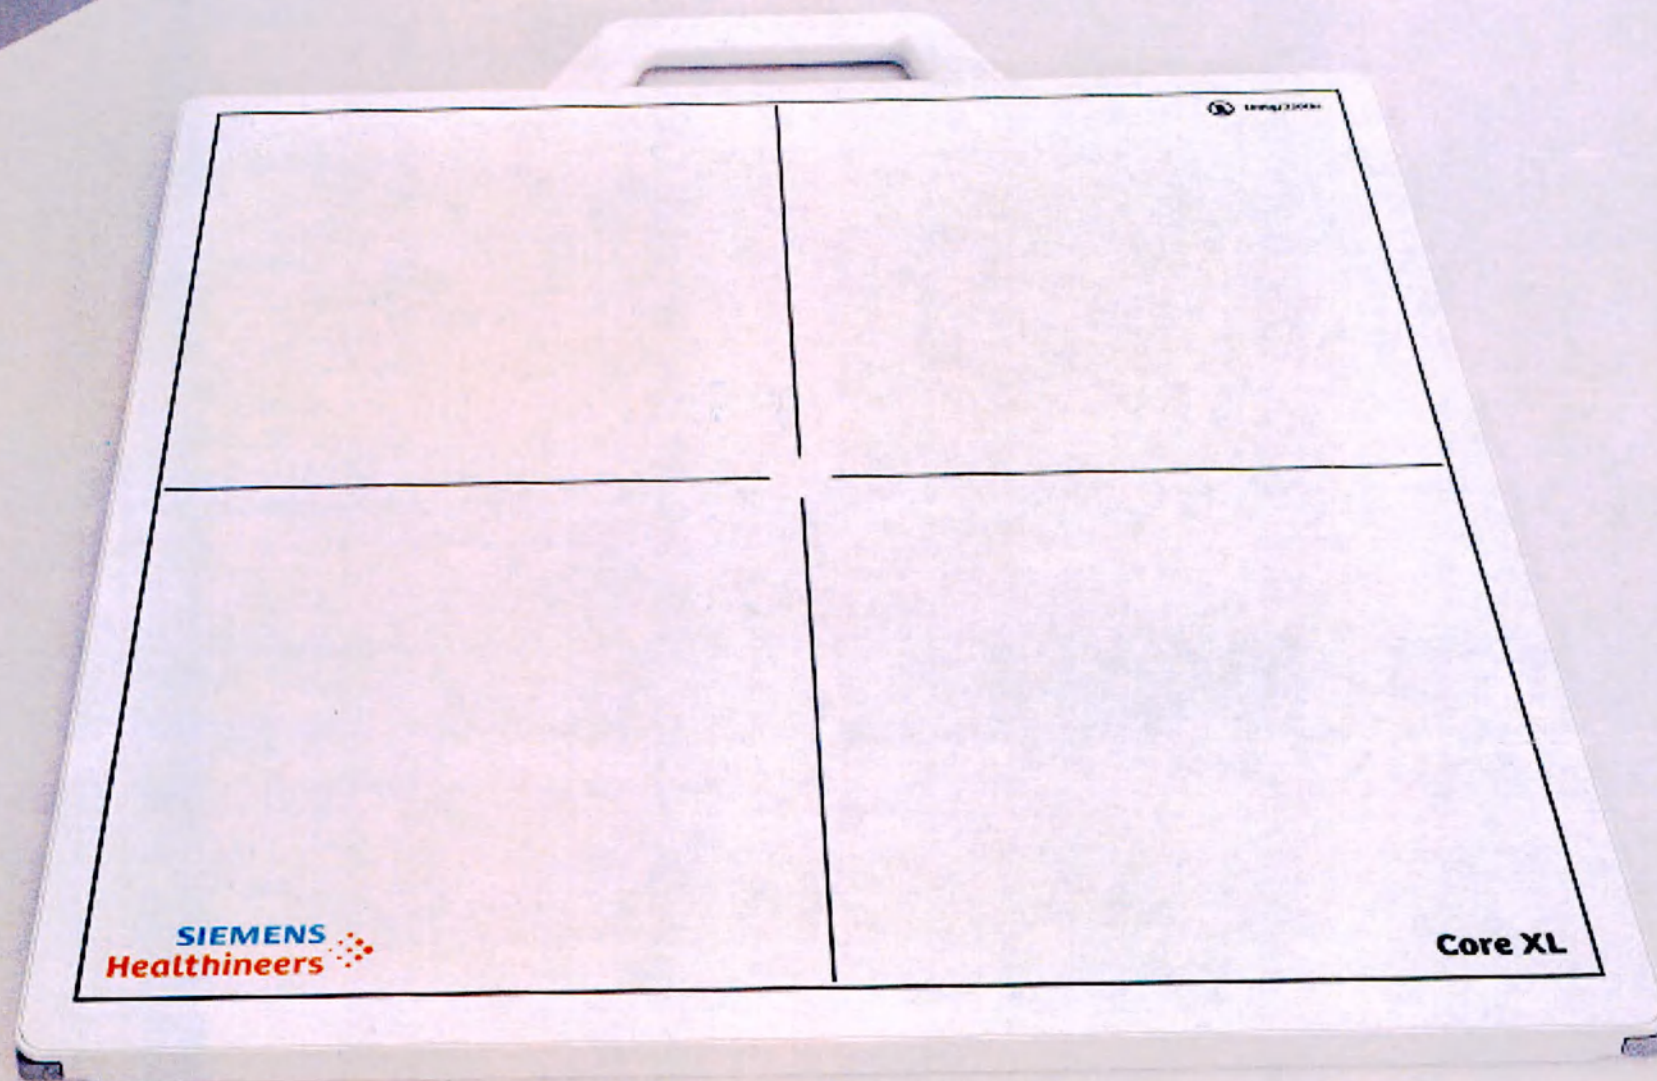

6.2 Детектор беспроводной, варианты исполнения: - детектор беспроводной Core XL

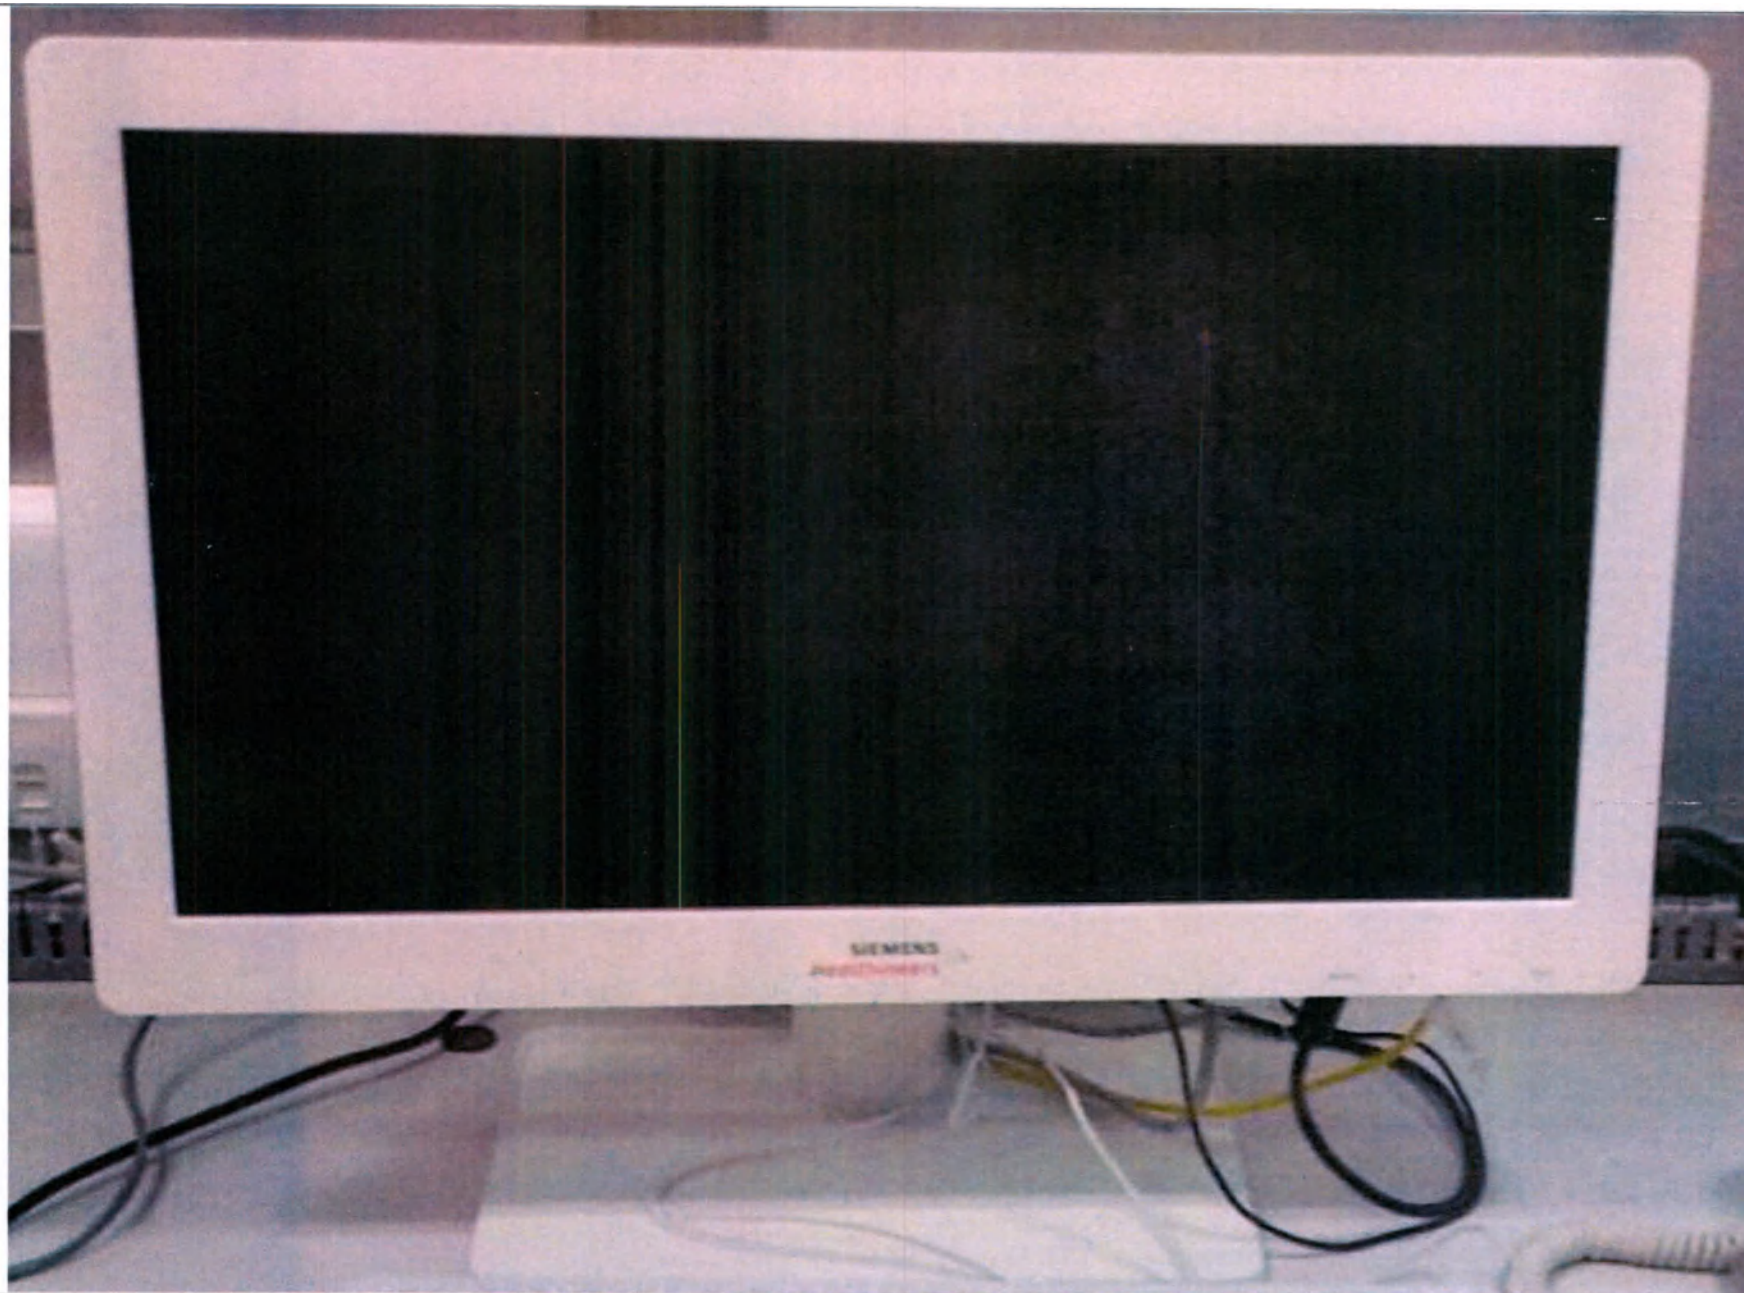

7. Станция формирования изображений с базовым программным обеспечением, варианты исполнения: стандартная; сенсорная.



8.1 Устройство для измерения дозы. 120-131 ZKCANO




8.2 Устройство для измерения дозы. 120-131 OEM CAN



9.1 Генератор рентгеновский, варианты исполнения: встроенный; внешний.
Высоковольтный генератор для фиксированного стола



9.2 Генератор рентгеновский, варианты исполнения: встроенный; внешний.
Высоковольтный генератор для фиксированного стола

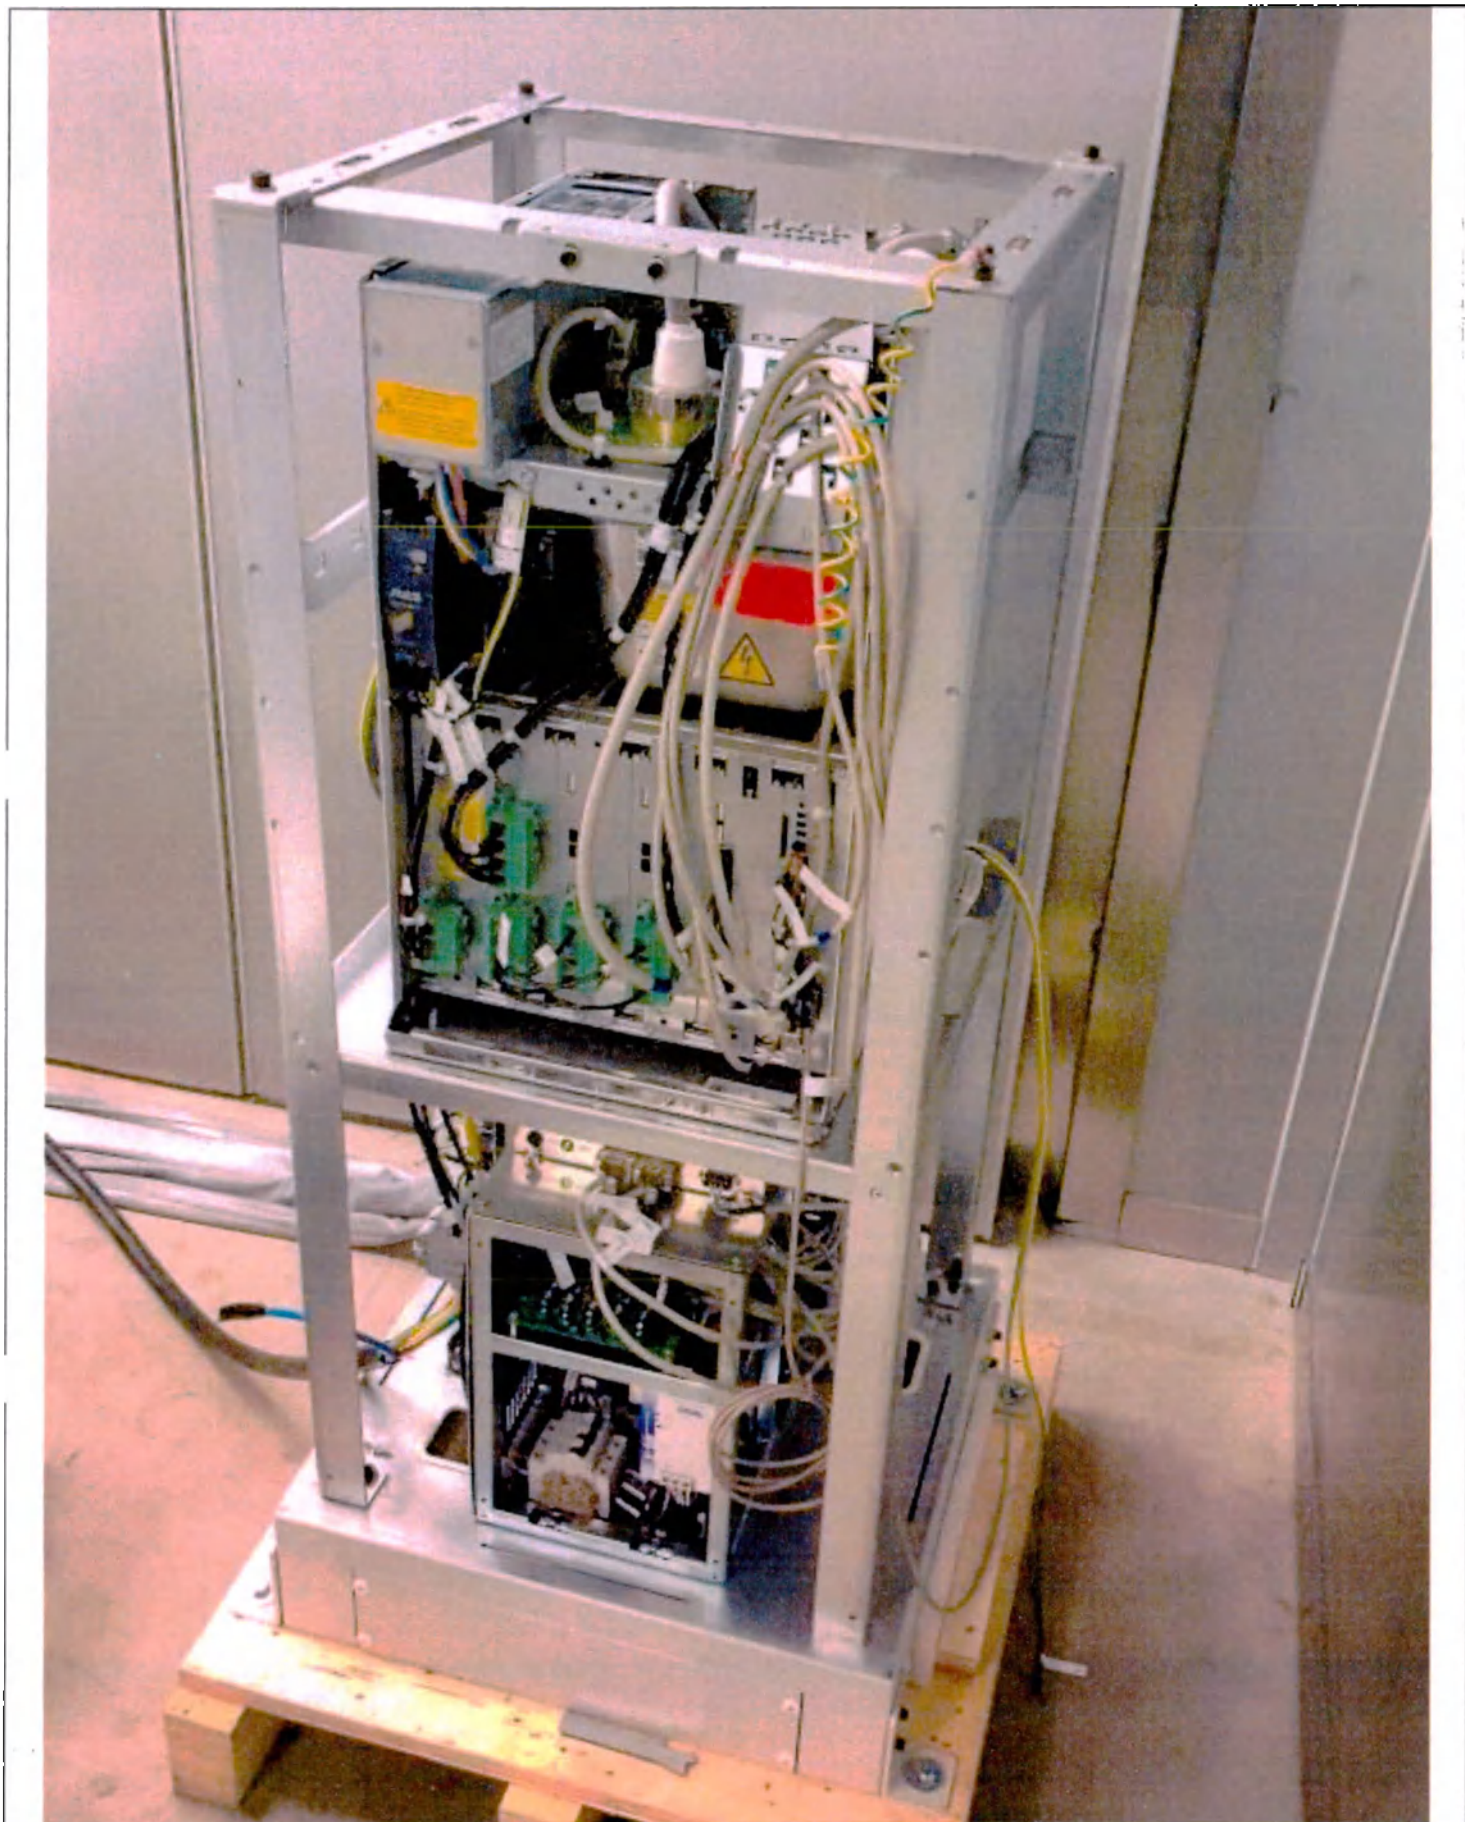

9.3 Генератор рентгеновский, варианты исполнения: встроенный; внешний.
Высоковольтный генератор для стола с вертикальным перемещением



MULTIX Impact

Руководство пользователя
VA20

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers

10. Документация пользователя на русском языке




11. Мобильный стол пациента для Core XL



1.1 Штатив напольный, варианты исполнения:

- полуавтоматический; и/или
- автоматический и/или
- ручной.


Стойка с трубкой, вид спереди

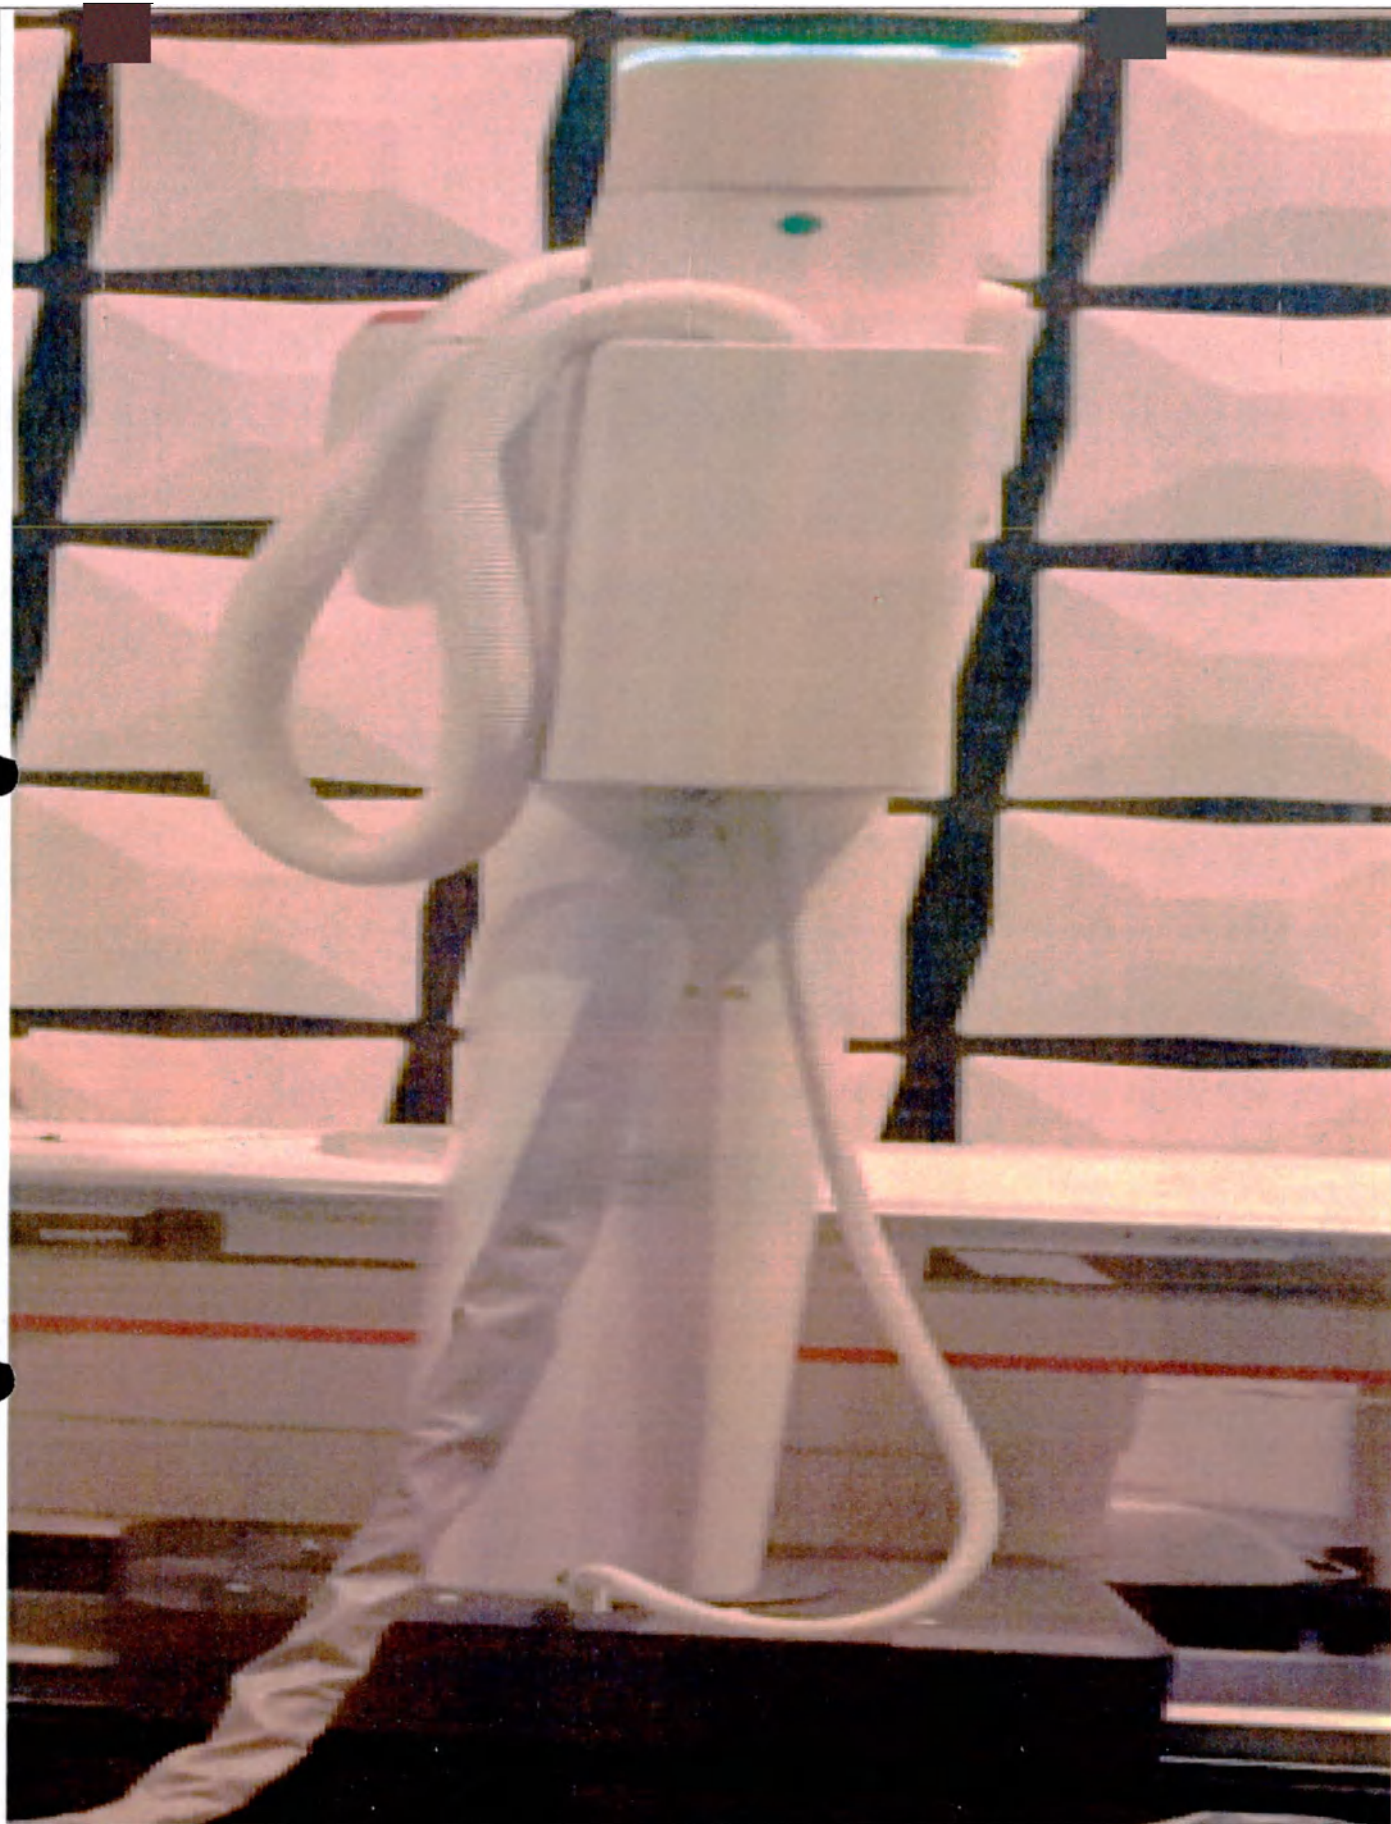


1.2 Штатив напольный, варианты исполнения:

- полуавтоматический; и/или
- автоматический и/или
- ручной.


Стойка с трубкой, вид сзади

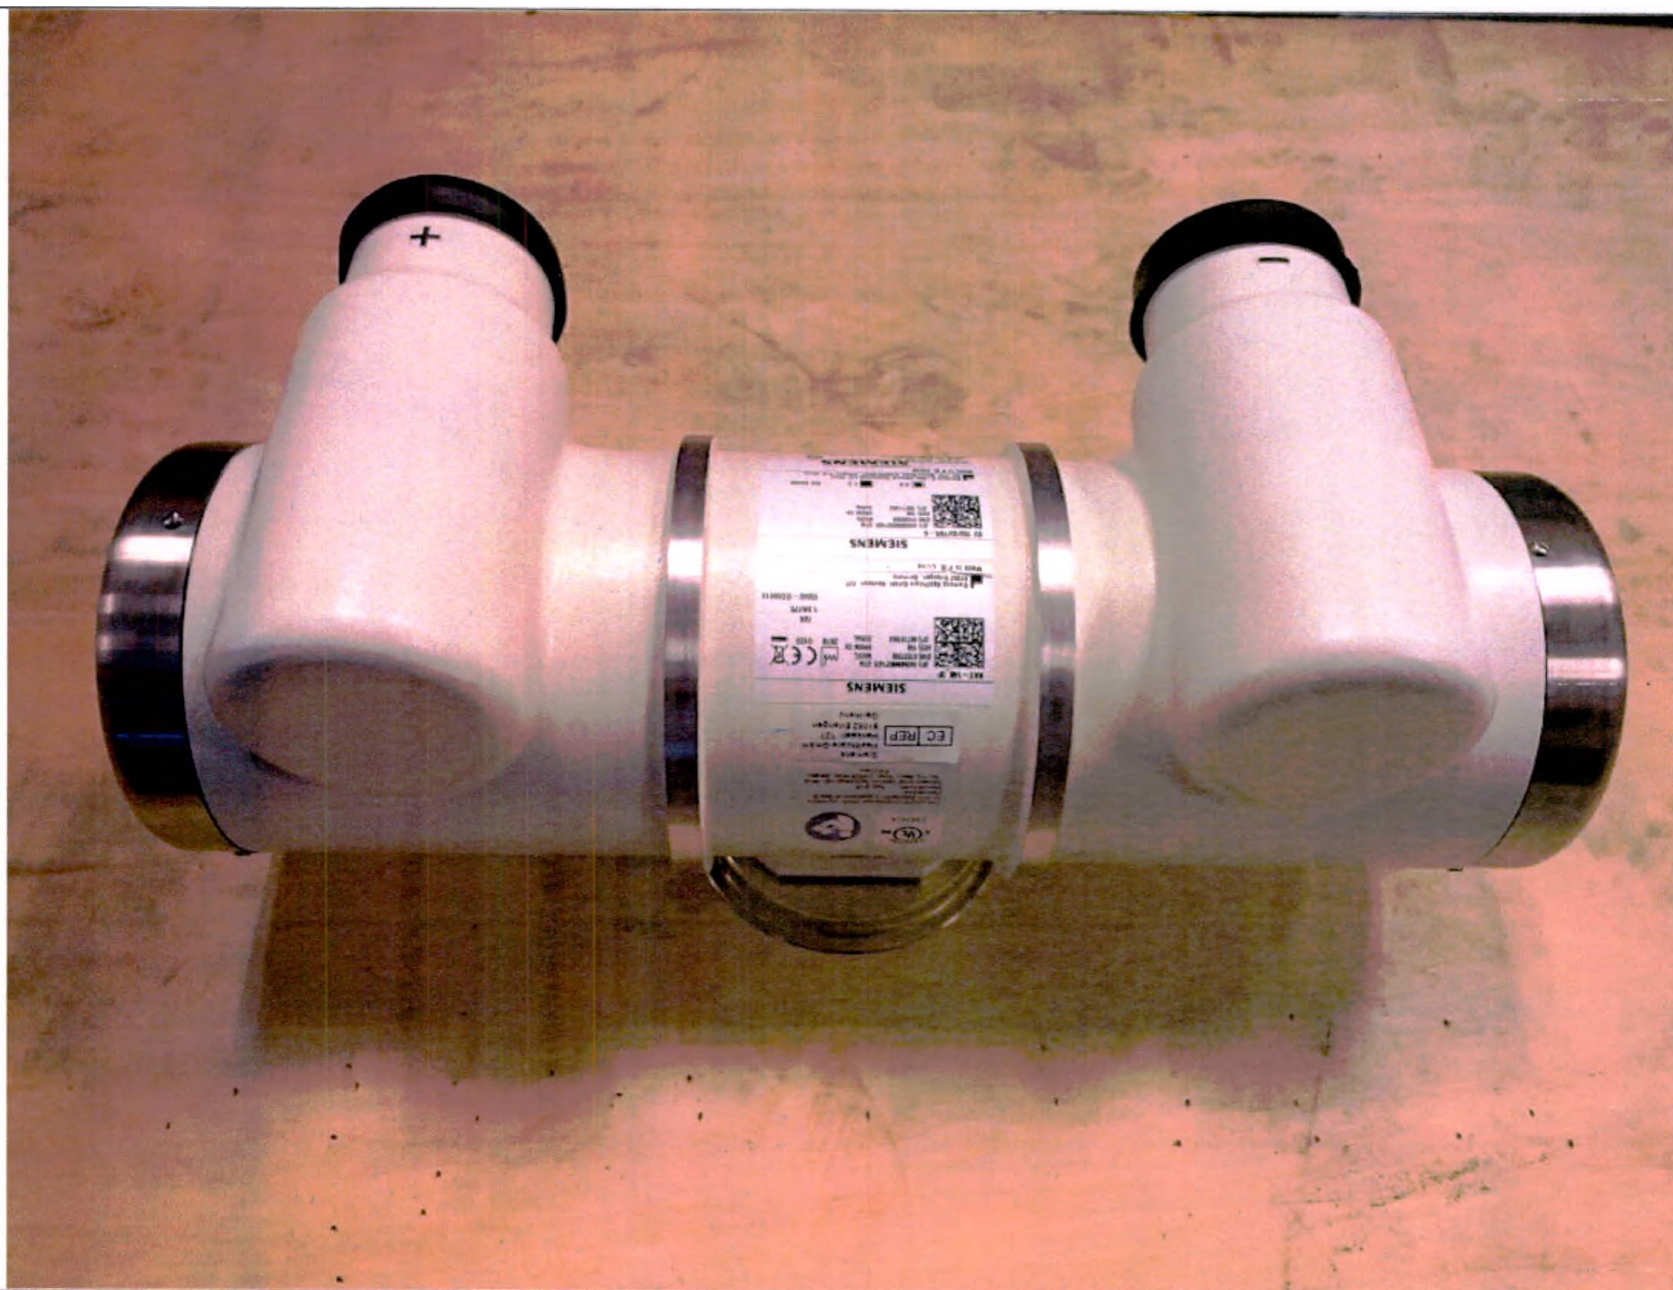


2. Трубка рентгеновская

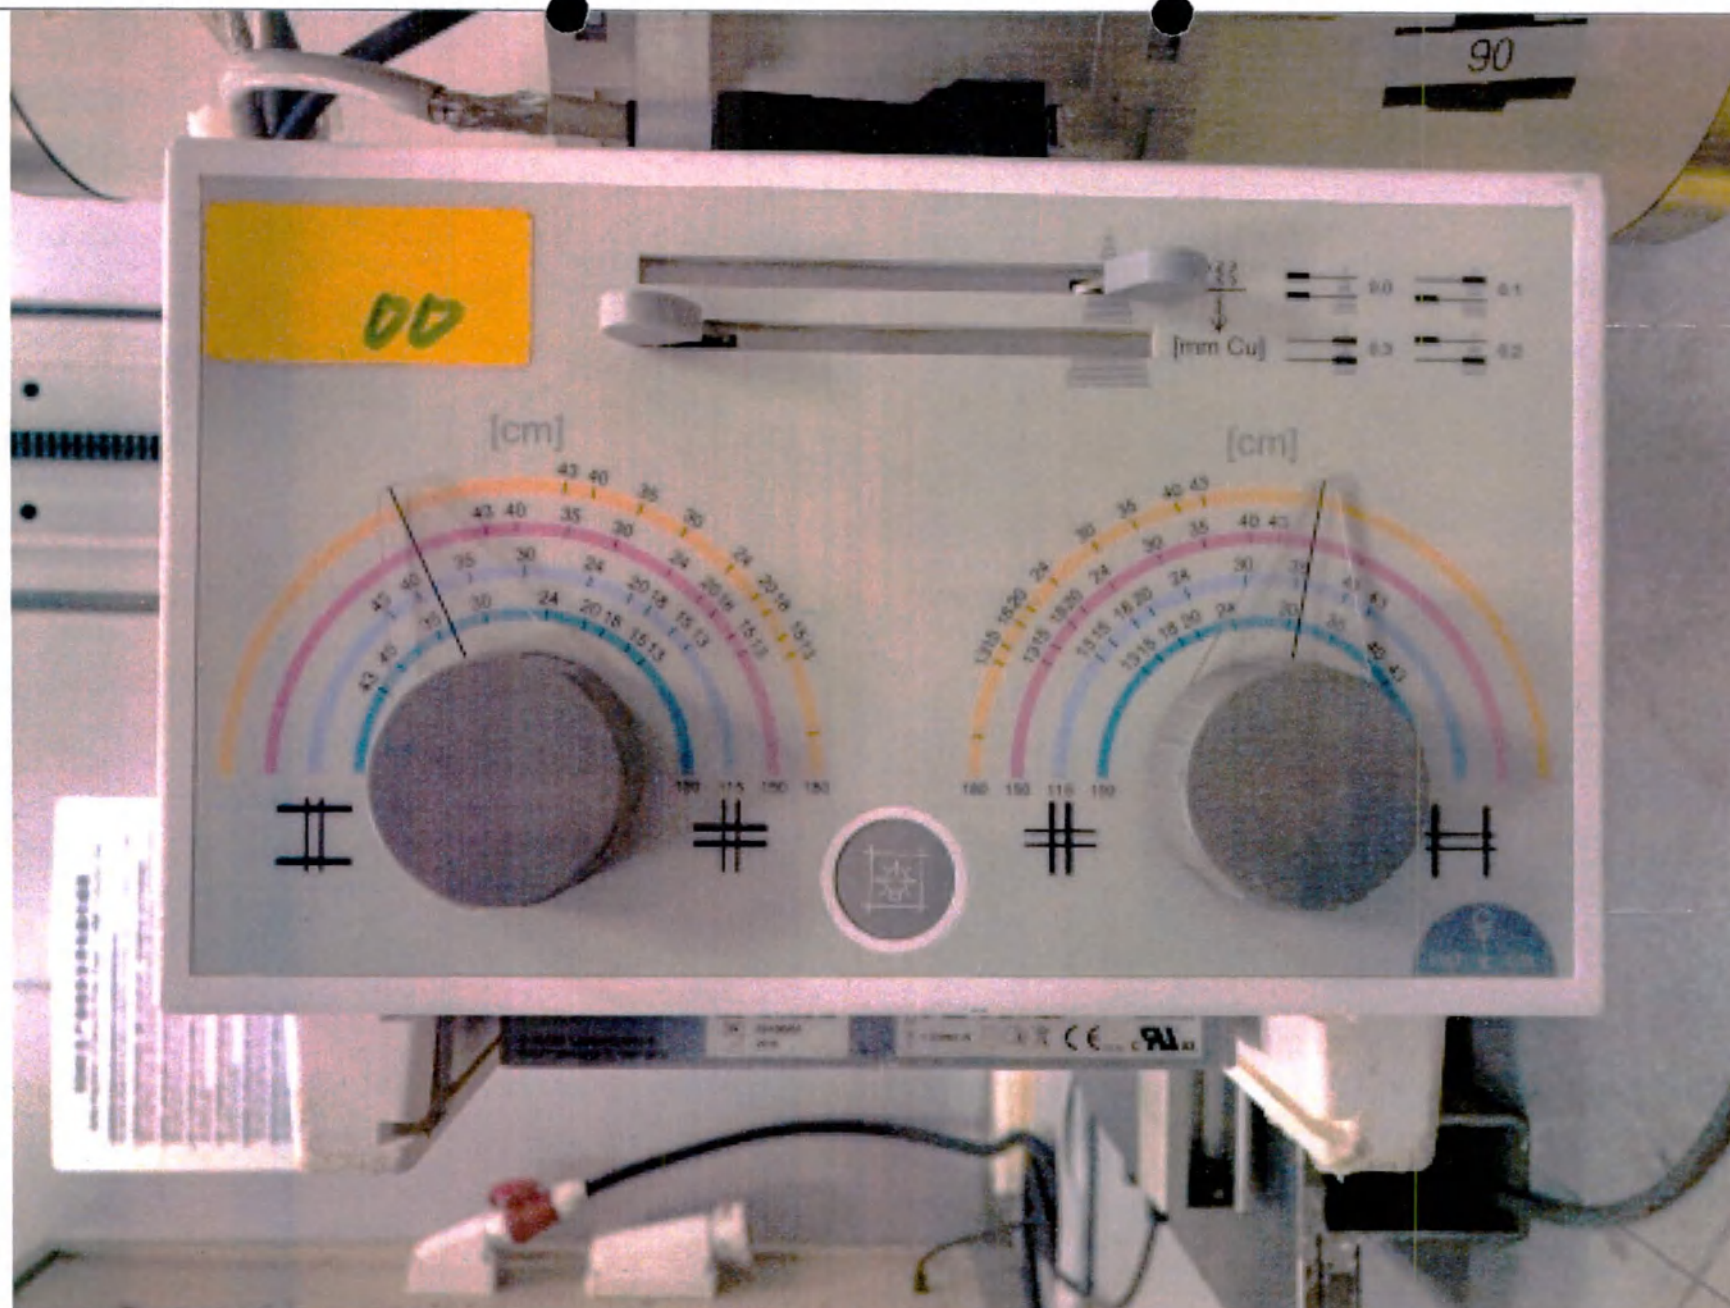


3.1 Коллиматор, варианты исполнения: ручной

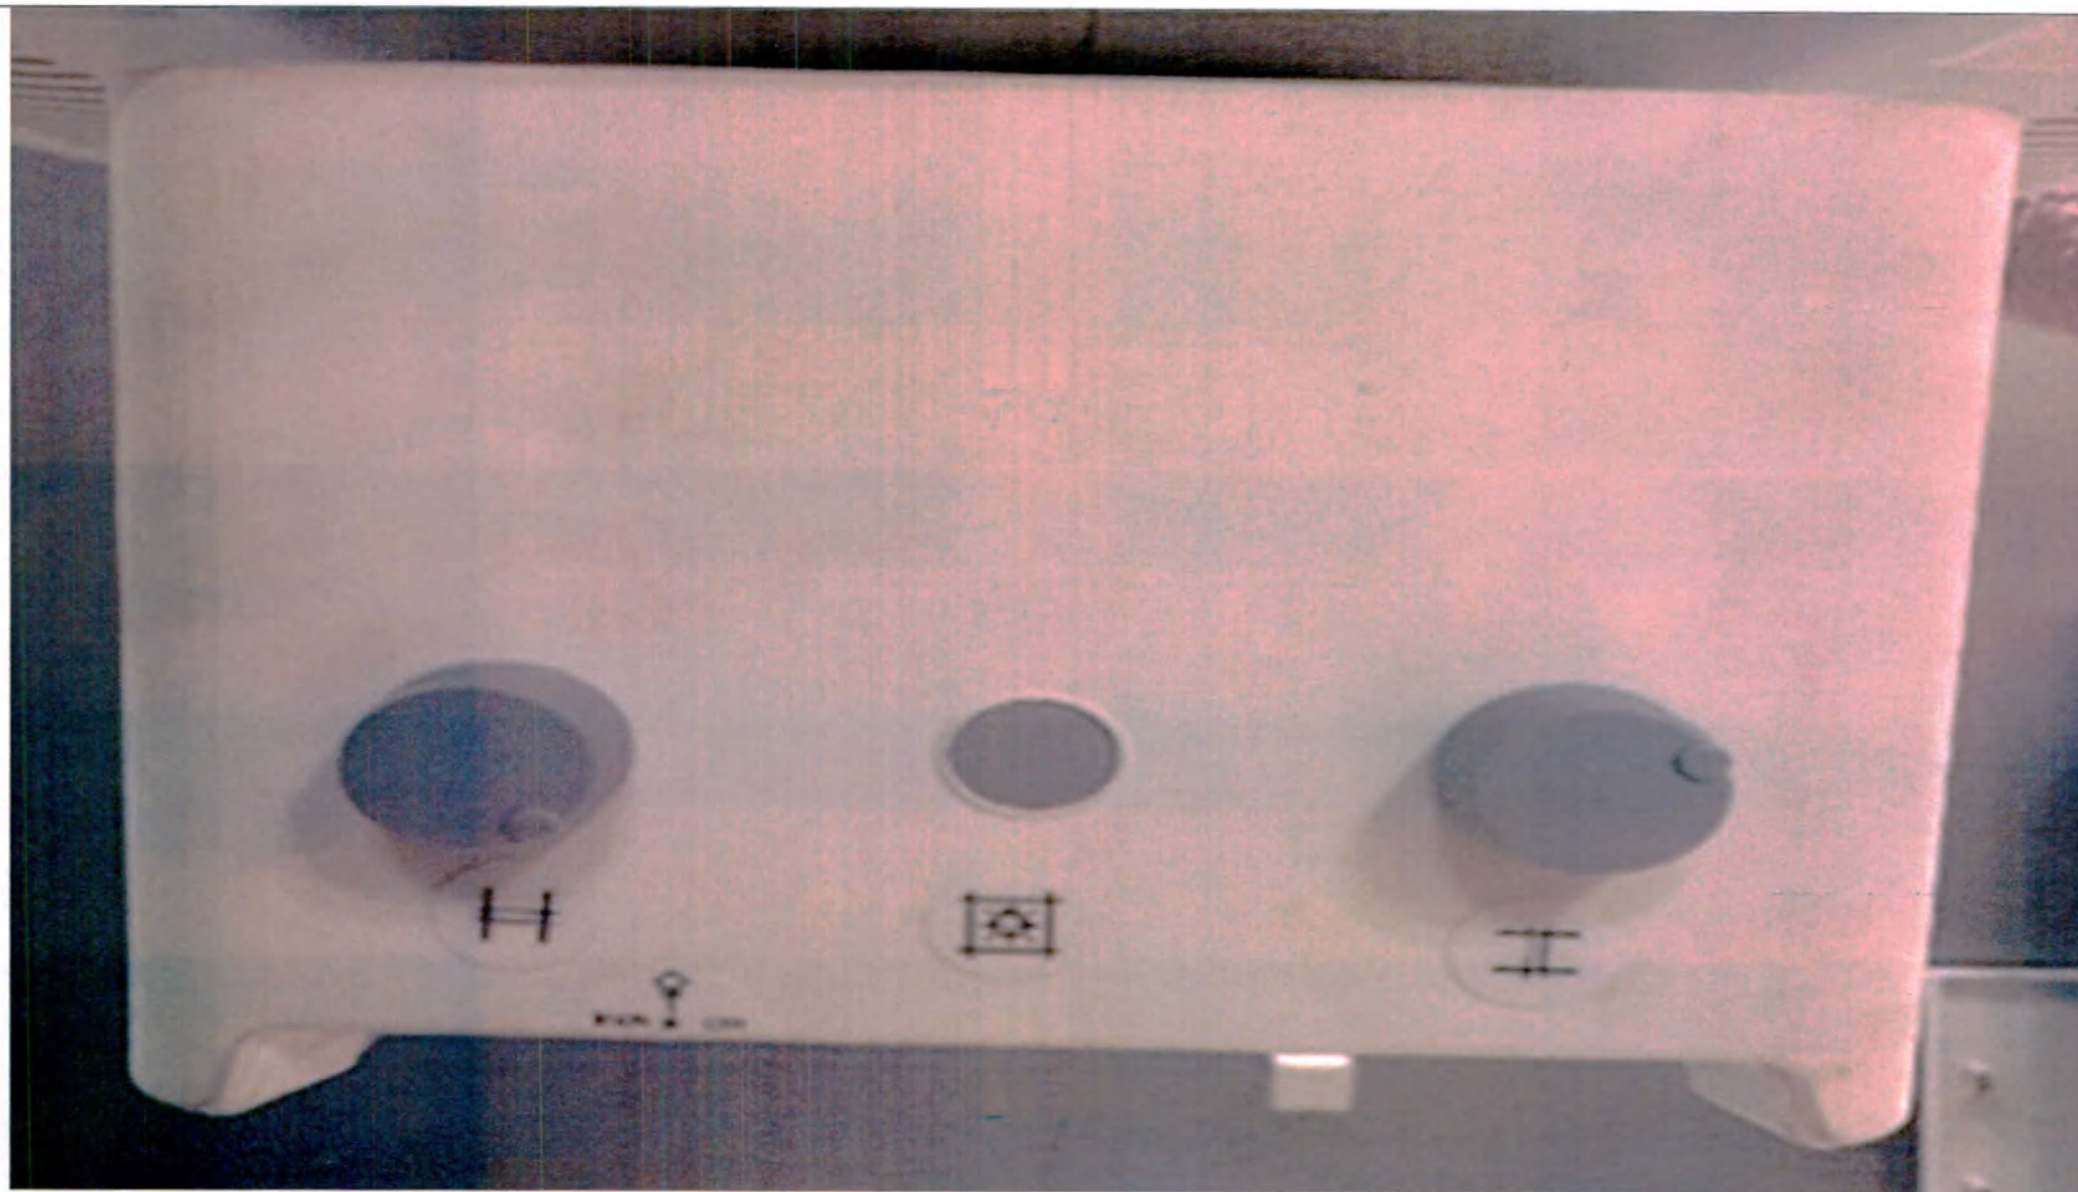


3.2 Коллиматор, варианты исполнения: автоматический

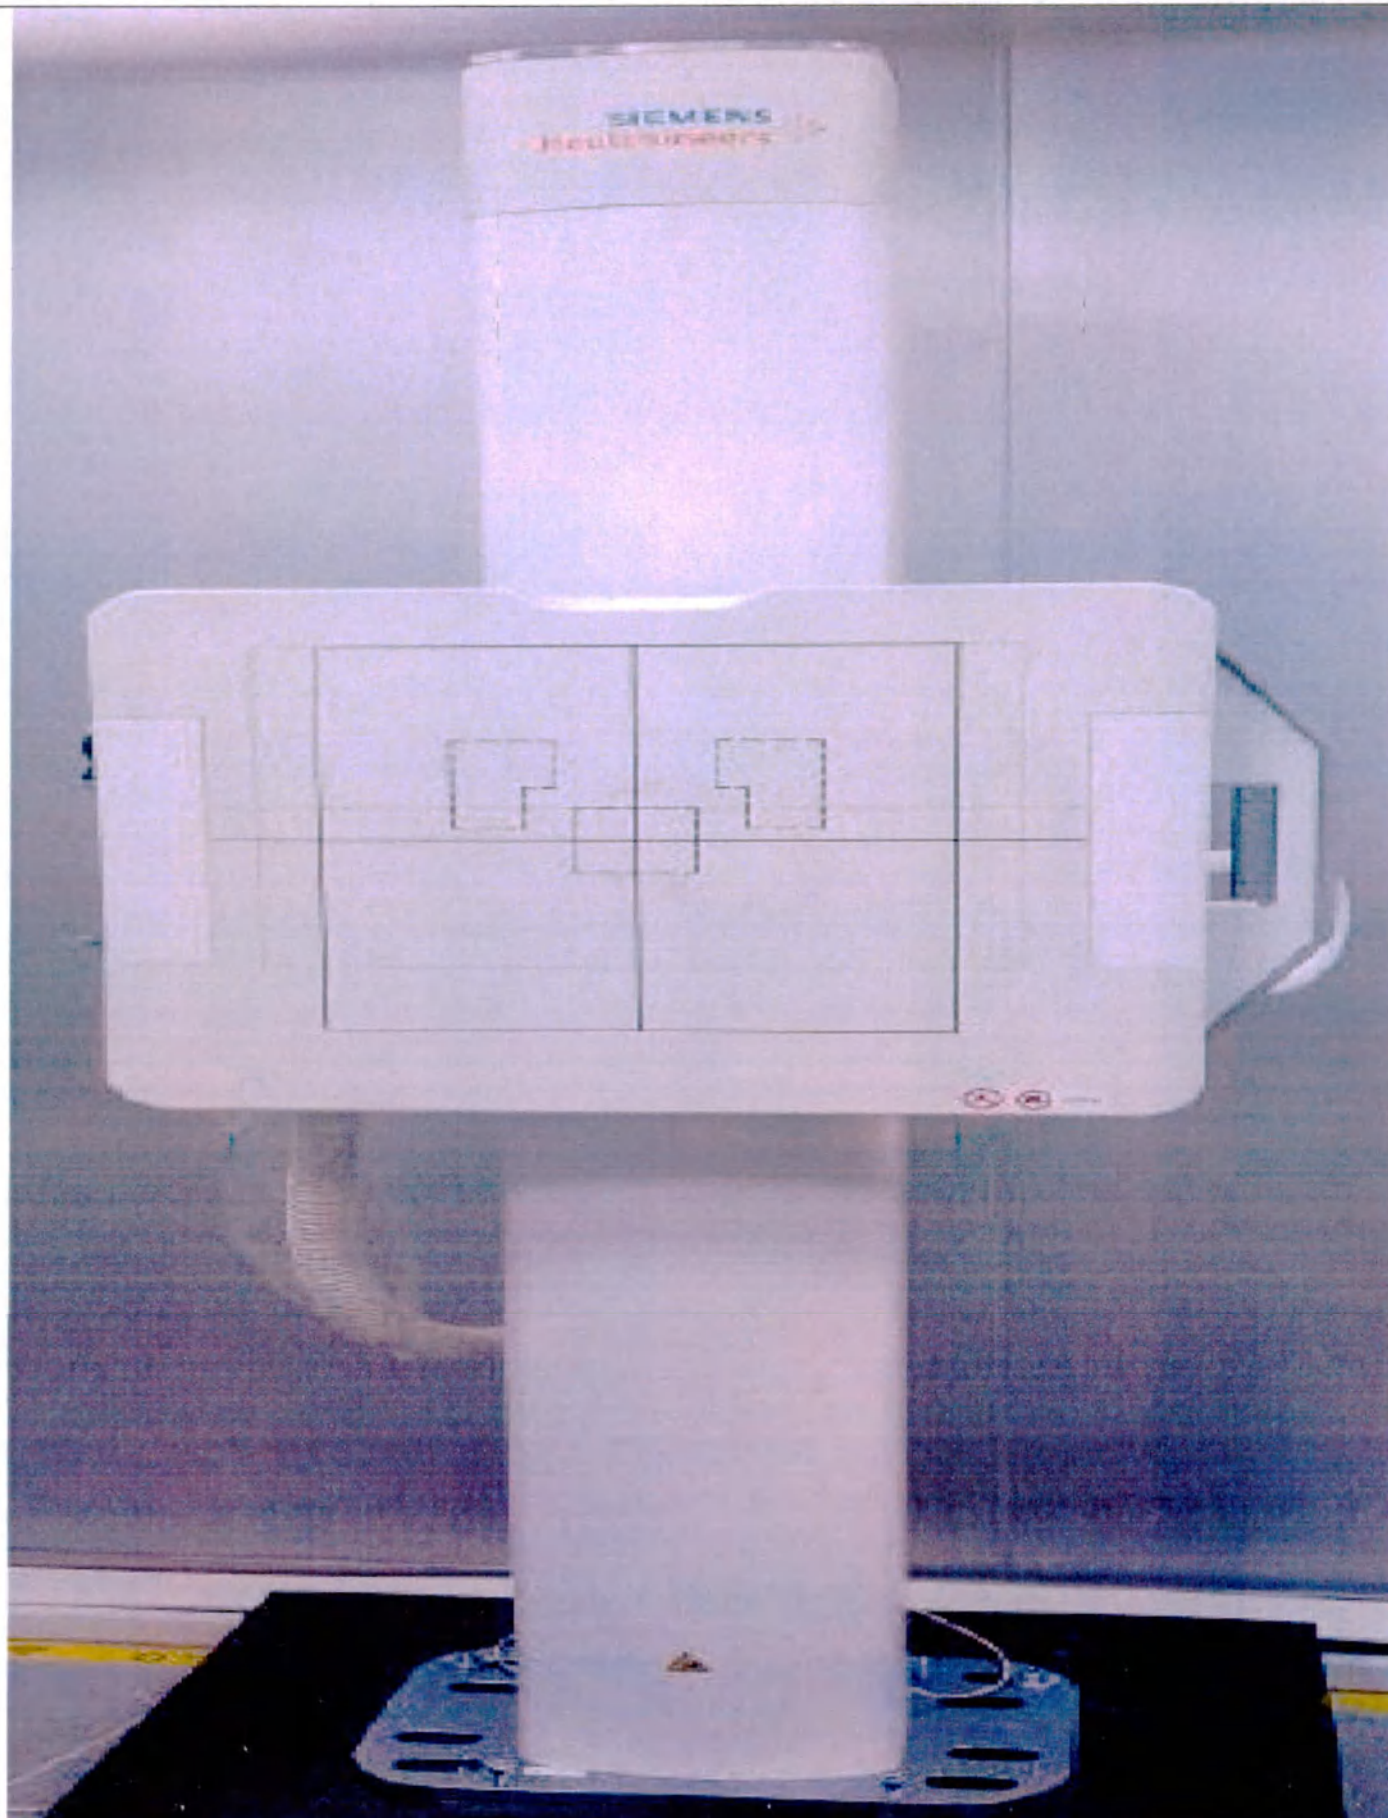

4.1 Стойка вертикальная, варианты исполнения:- для беспроводного детектора MAX wi-D (автоматическая и/или - для беспроводного детектора Core XL (автоматическая) и/или - для беспроводного детектора Core XL (ручная) и/или - для детектора Core static, эксплуатируемая с правой стороны

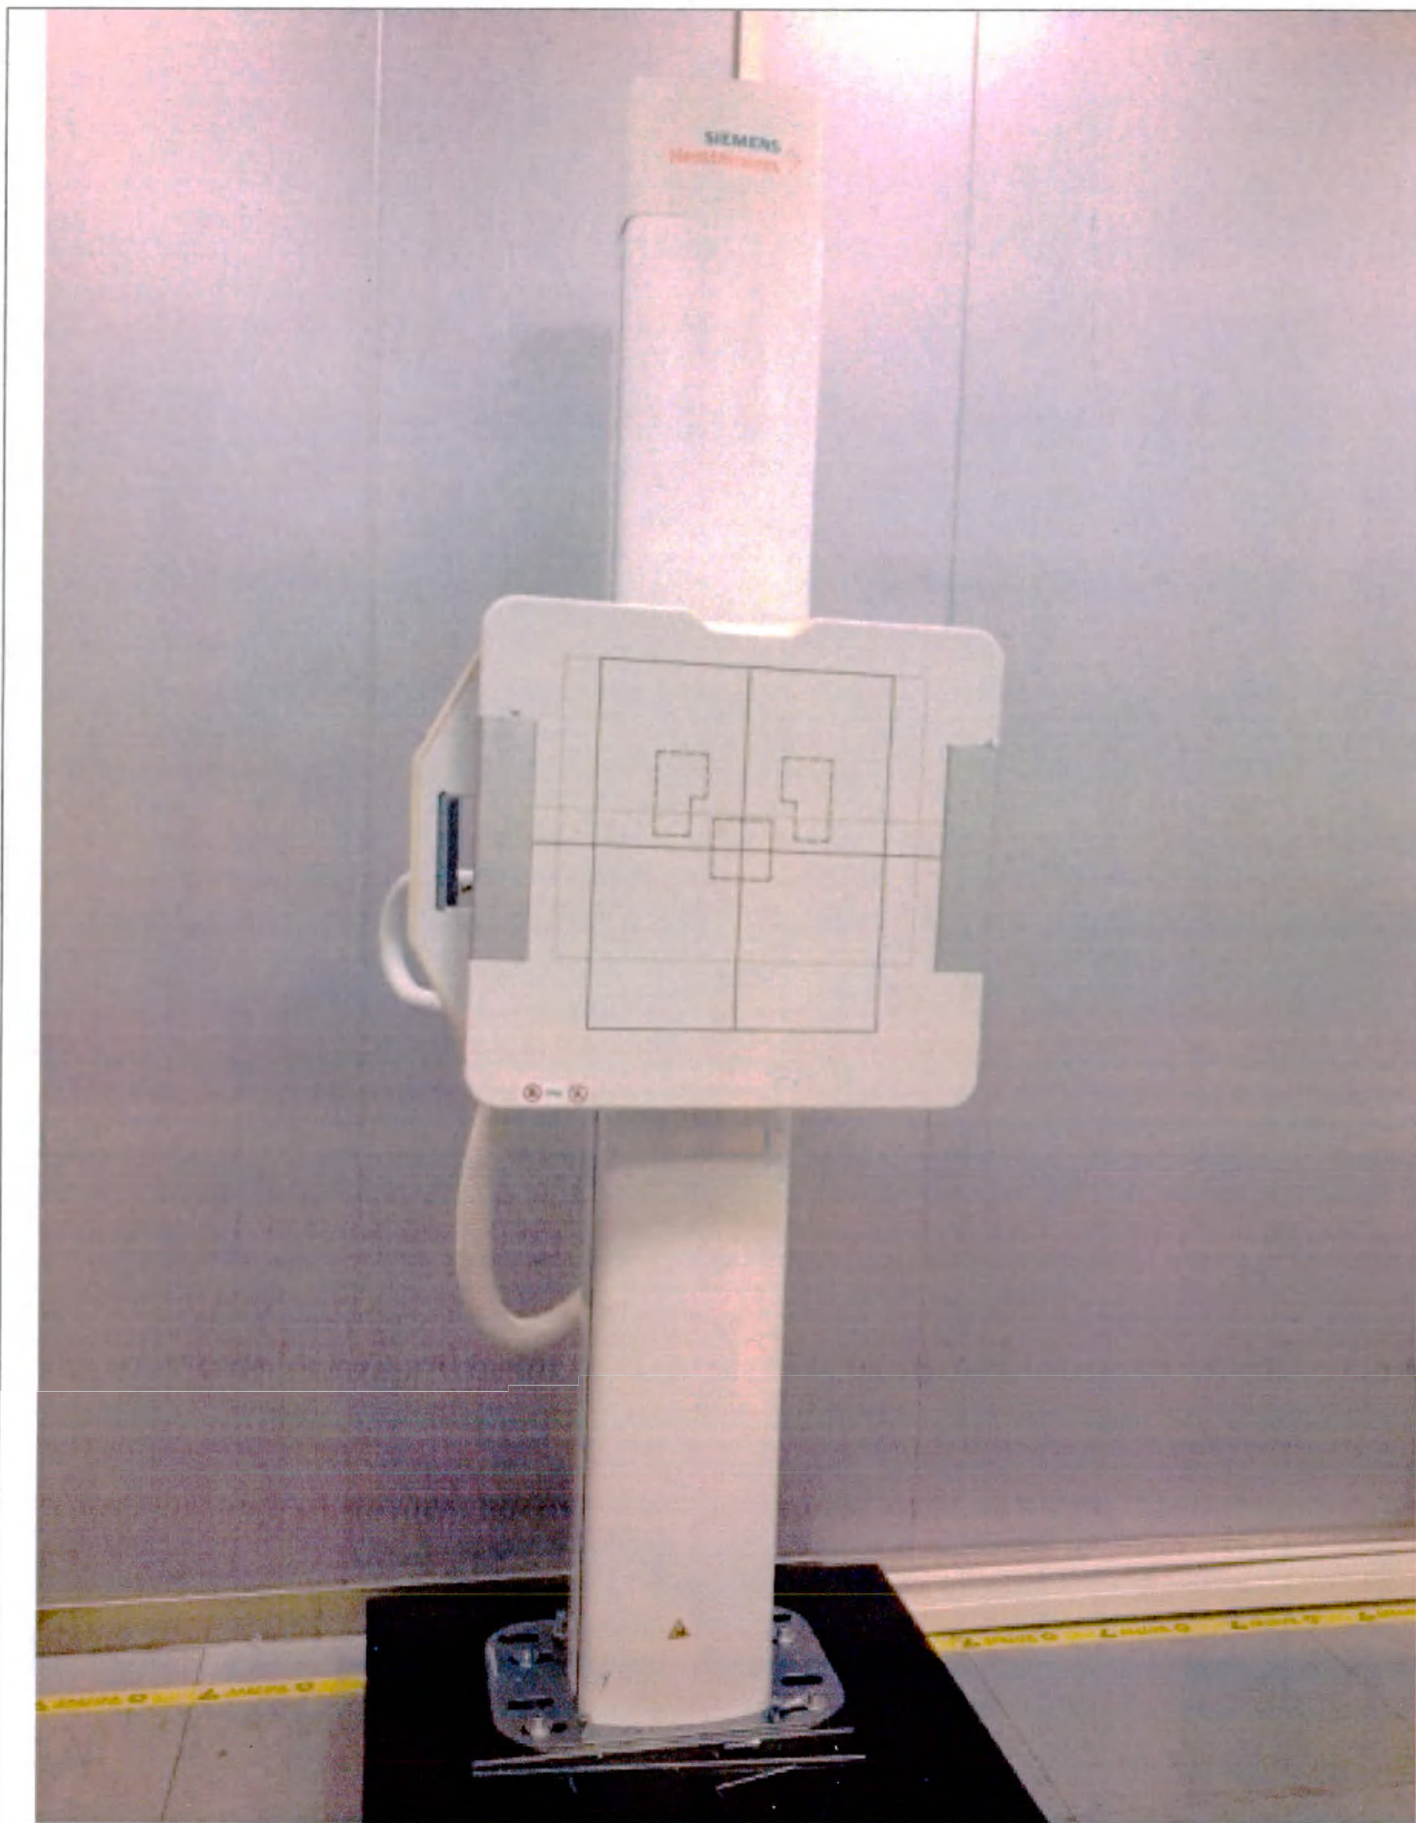


4.2 Стойка вертикальная, варианты исполнения:- для беспроводного детектора MAX wi-D (автоматическая и/или - для беспроводного детектора Core XL (автоматическая) и/или - для беспроводного детектора Core XL (ручная) и/или - для детектора Core static, эксплуатируемая с левой стороны

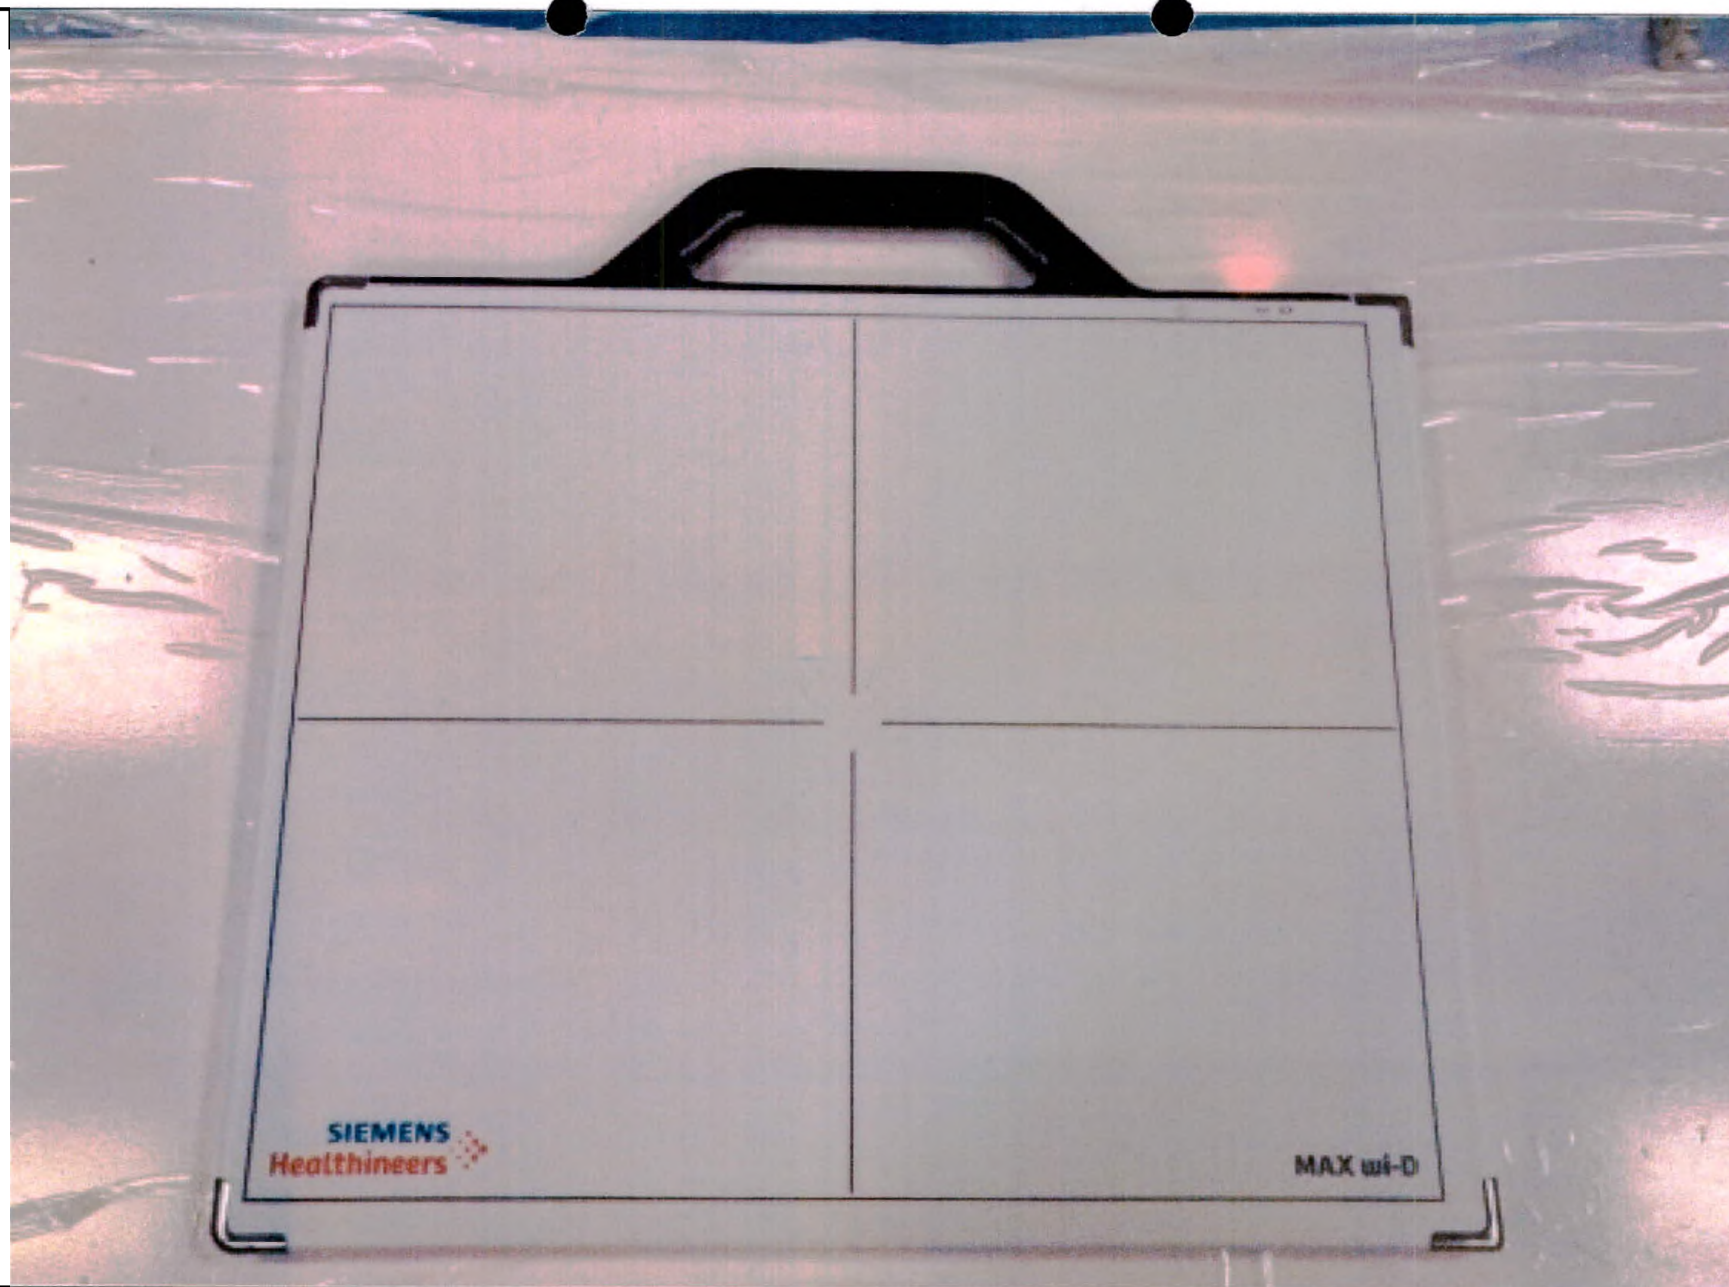

5.1 Детектор беспроводной, варианты исполнения: детектор беспроводной MAX wi-D




5.2 Детектор беспроводной, варианты исполнения: - детектор беспроводной Core XL

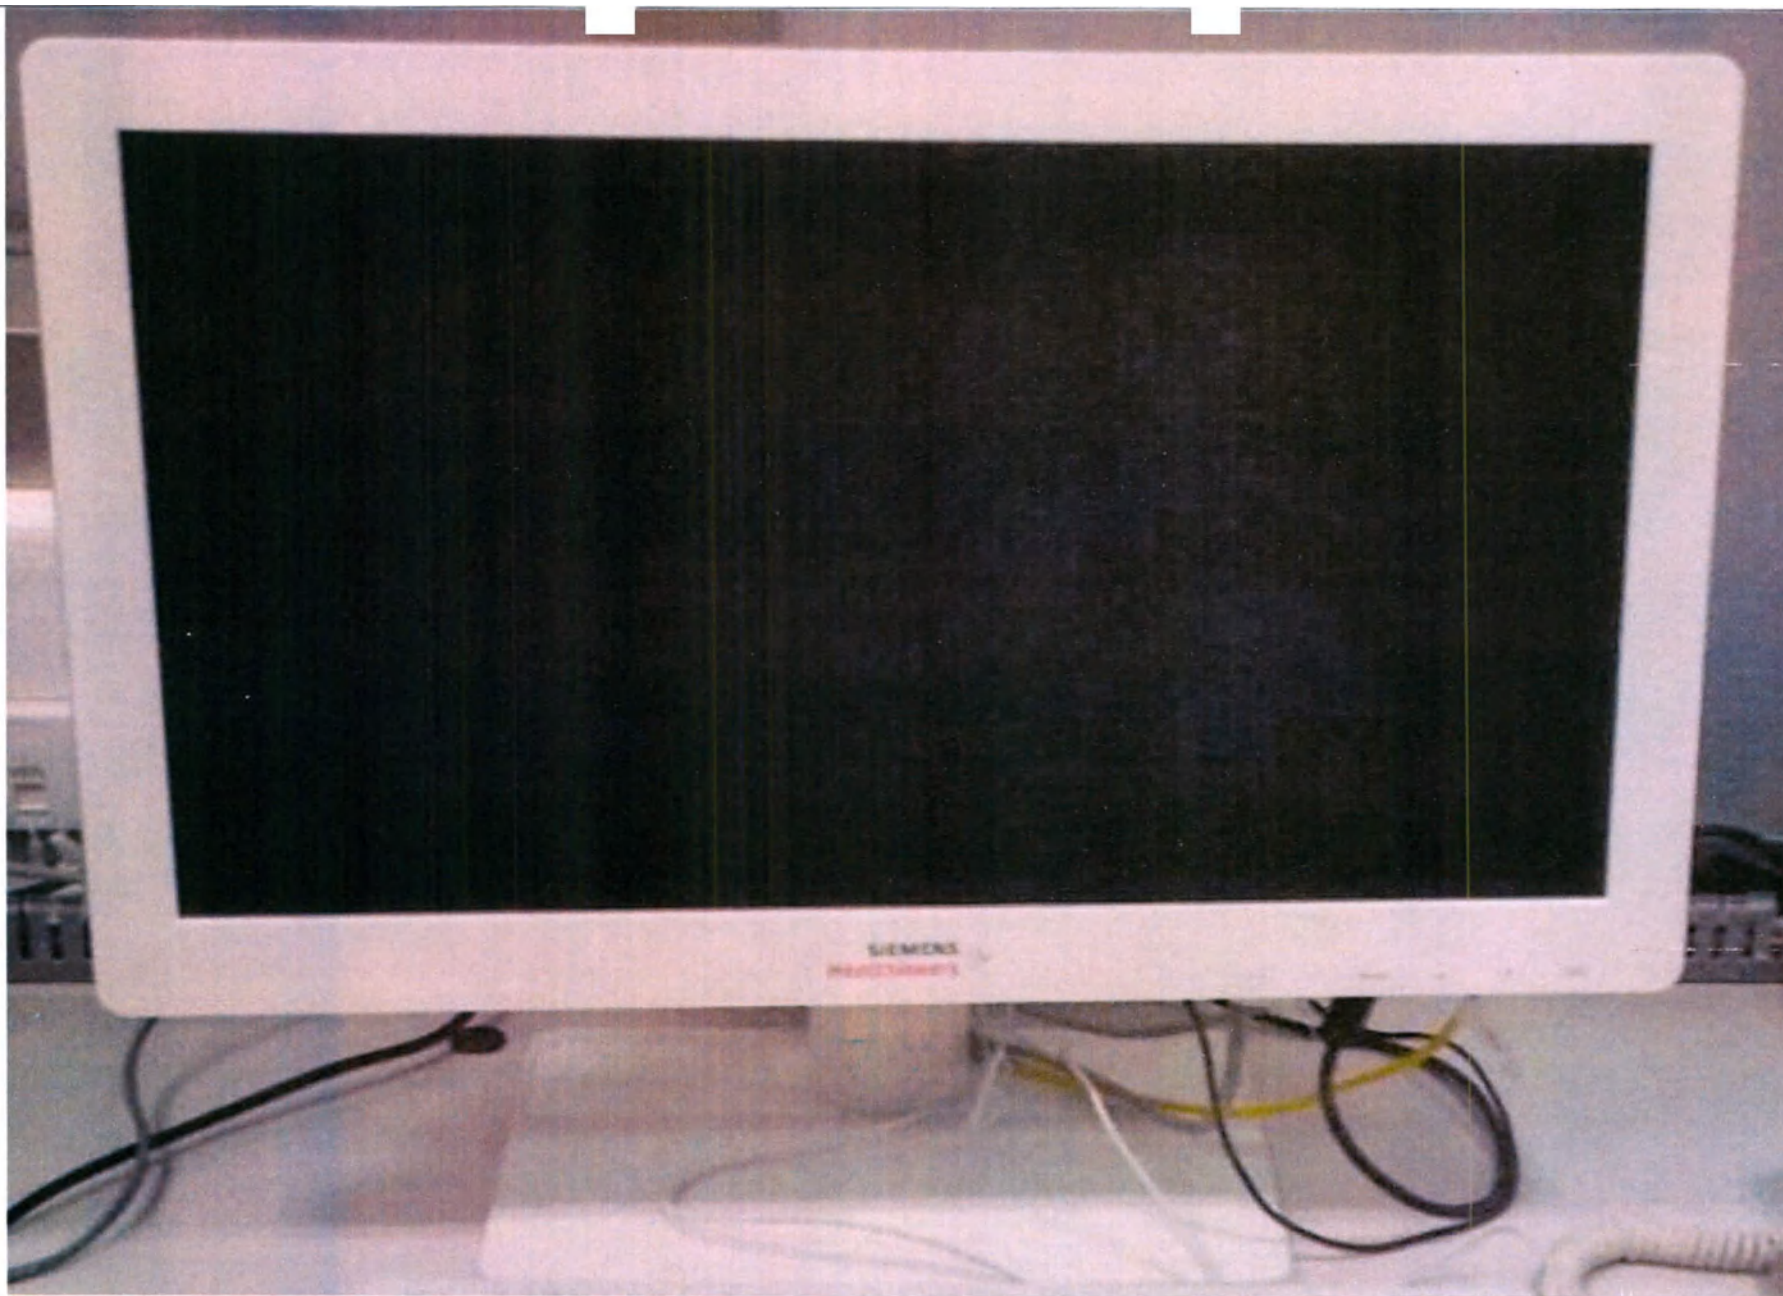

6. Станция формирования изображений с базовым программным обеспечением, варианты исполнения: стандартная; сенсорная.




7.1 Устройство для измерения дозы. 120-131 ZKCANO

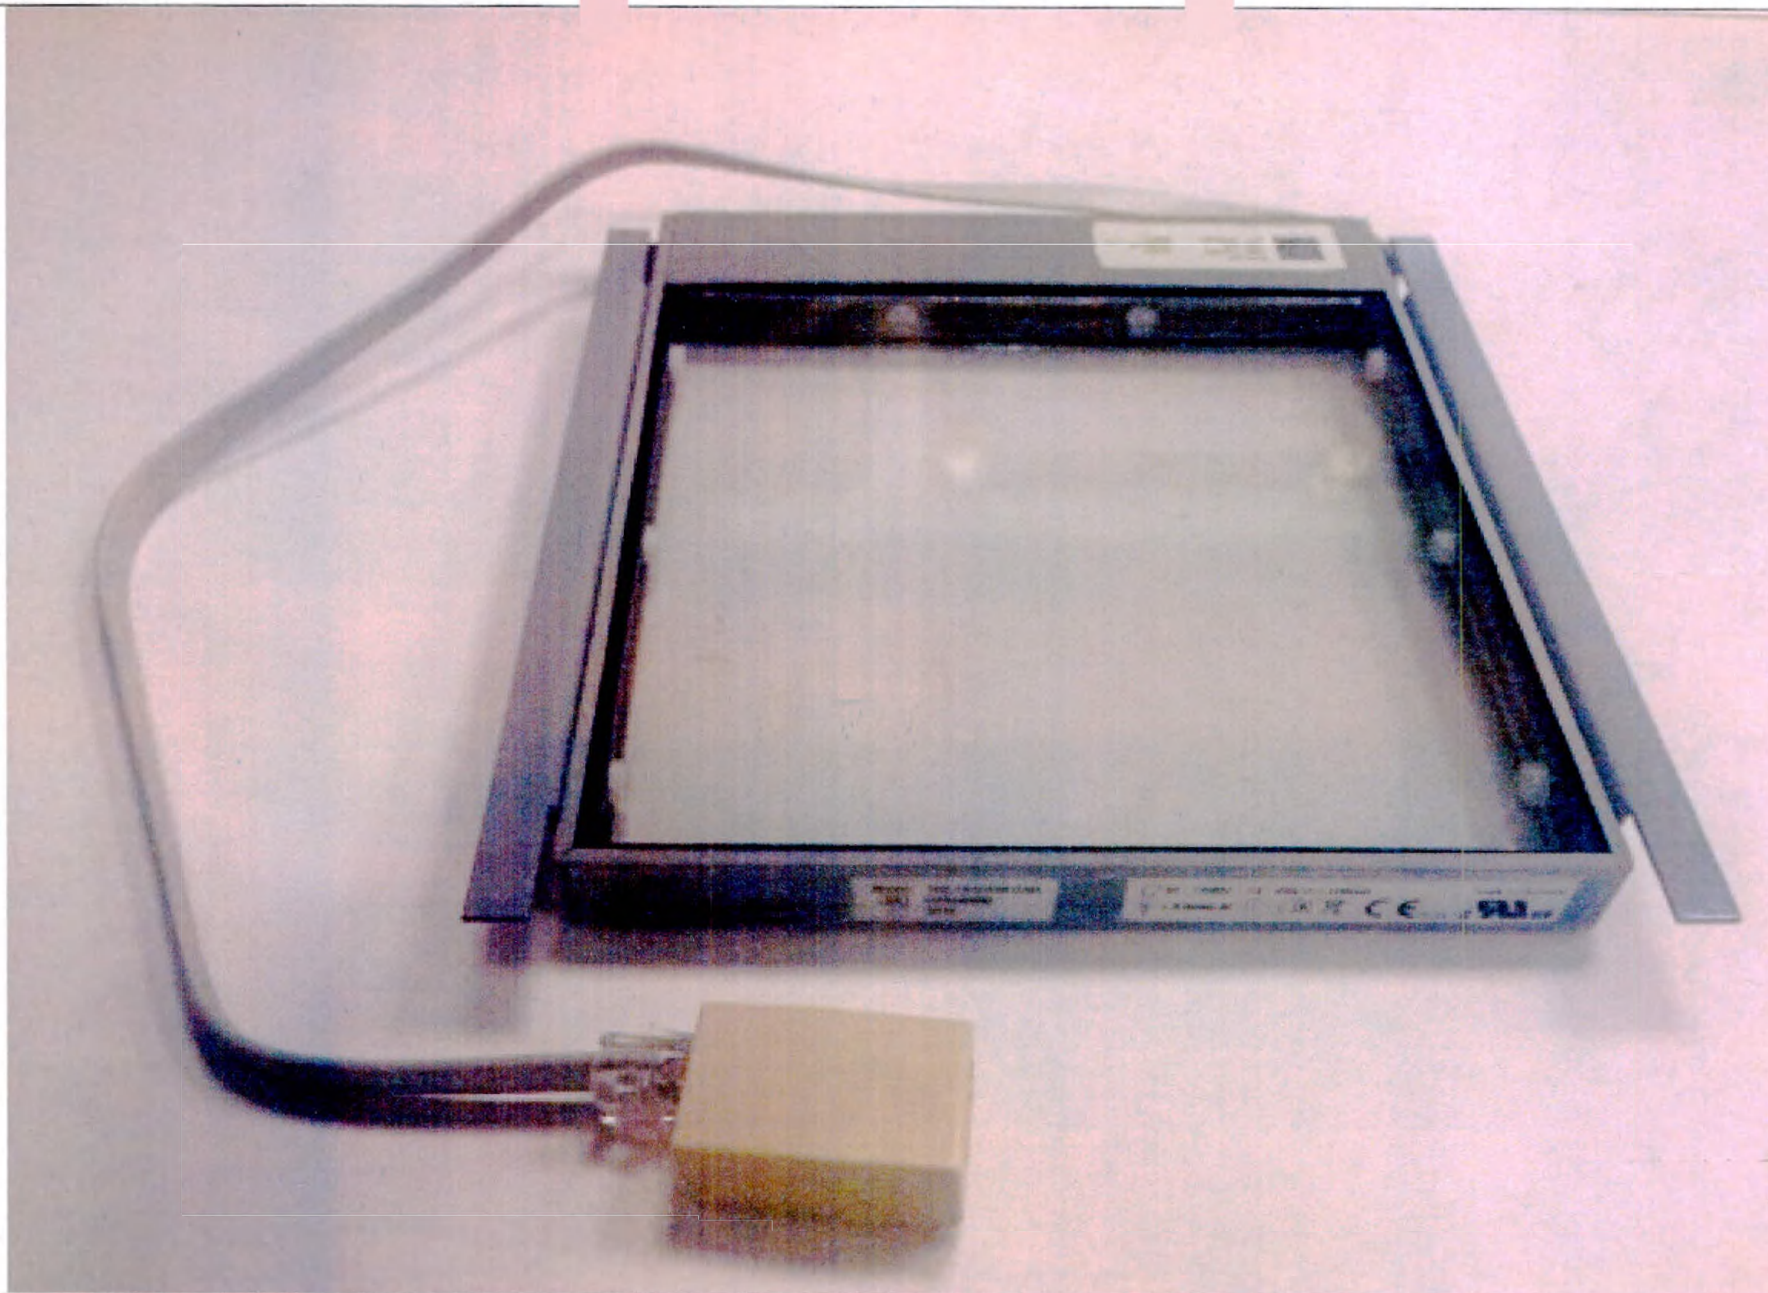


7.2 Устройство для измерения дозы. 120-131 OEM CAN



8.1 Генератор рентгеновский, варианты исполнения: встроенный; внешний
Высоковольтный генератор для фиксированного стола

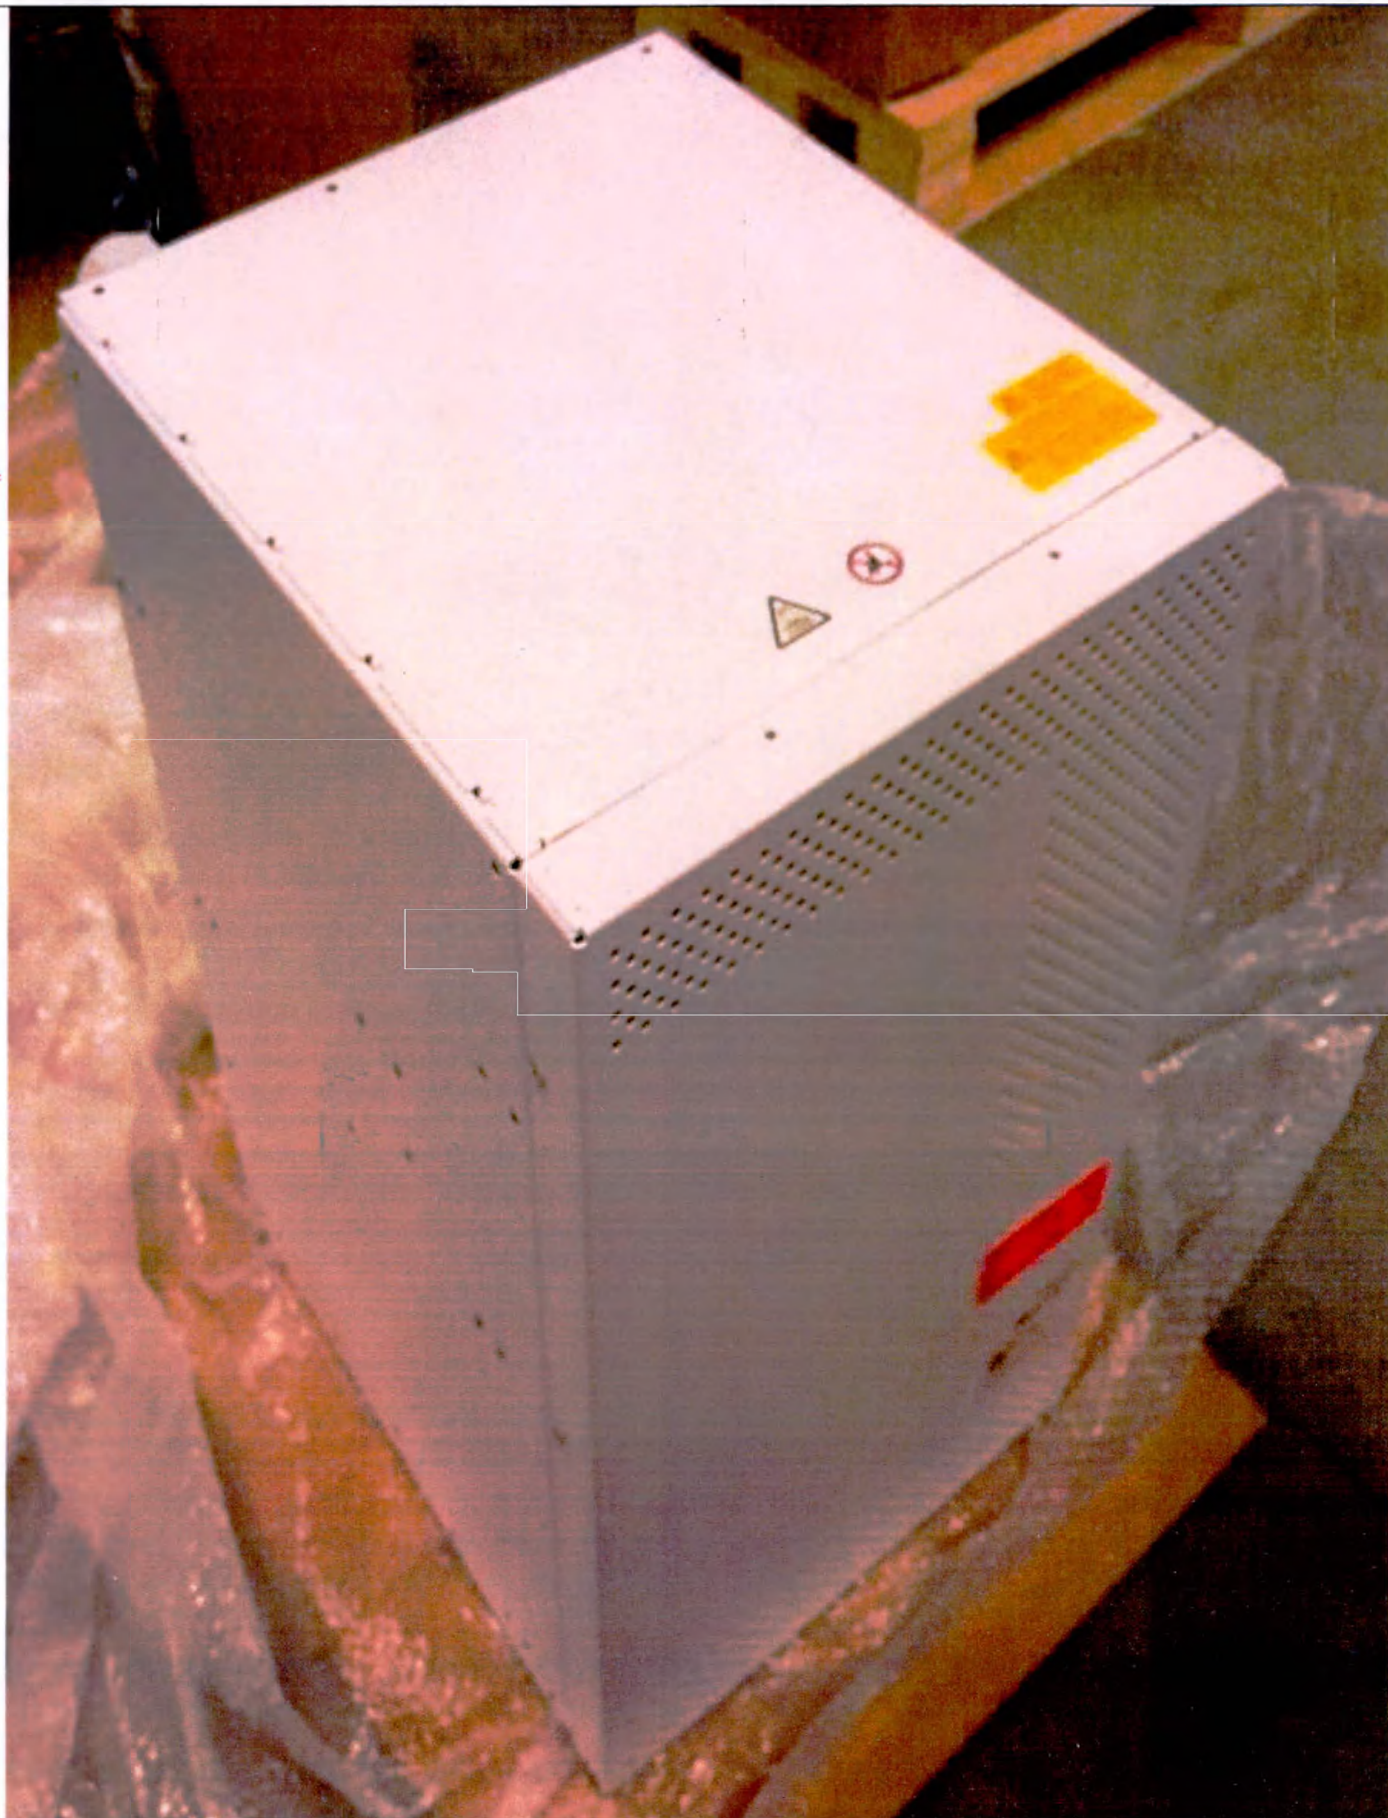

8.2 Генератор рентгеновский, варианты исполнения: встроенный; внешний
Высоковольтный генератор для фиксированного стола

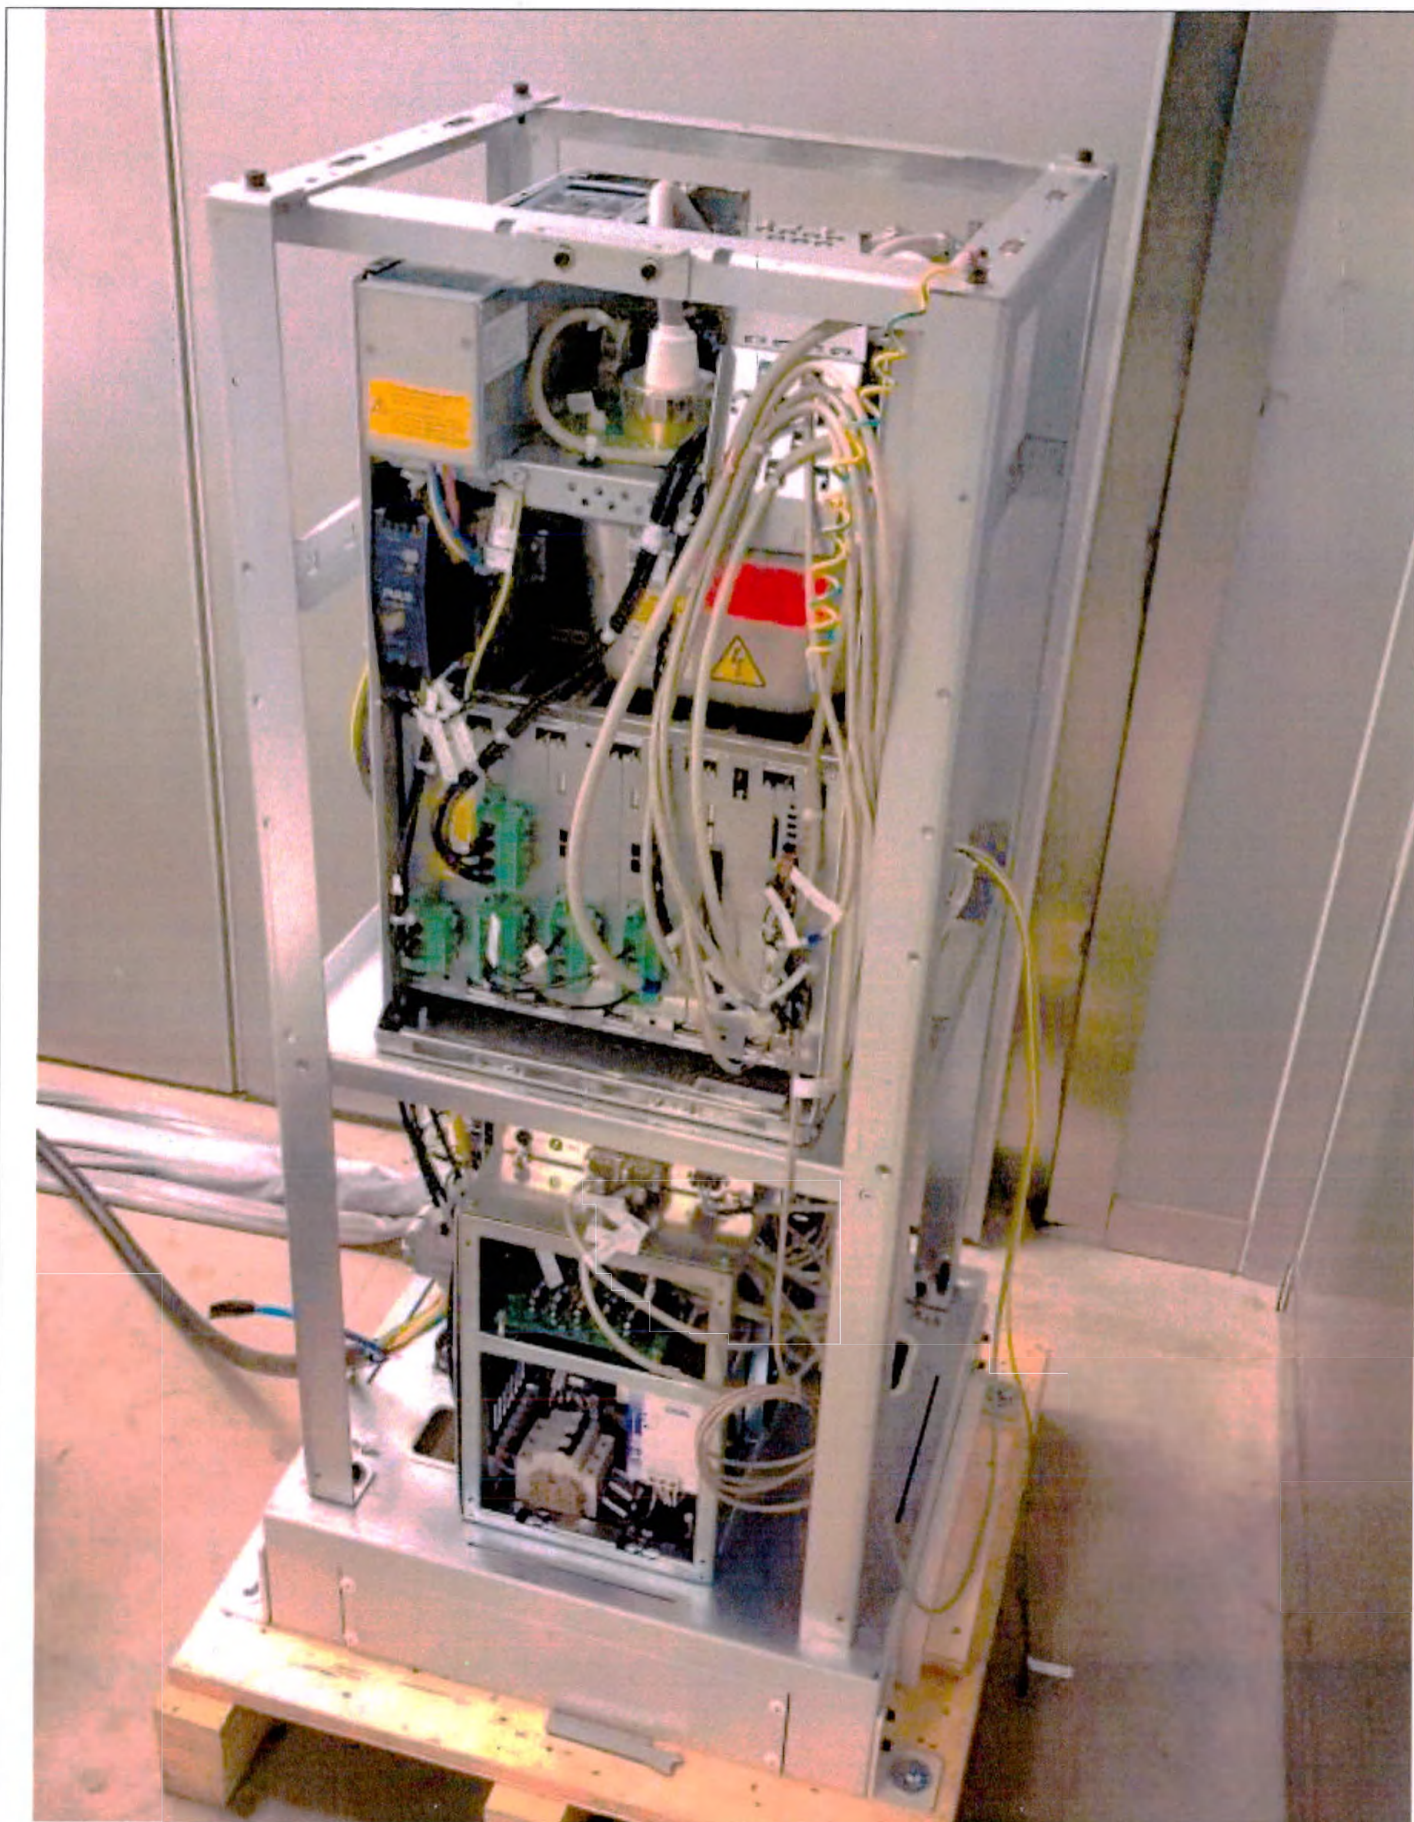

8.3 Генератор рентгеновский, варианты исполнения: встроенный; внешний
Высоковольтный генератор для стола с вертикальным перемещением



9. Мобильный стол пациента для Core XL



MULTIX Impact

Руководство пользователя
VA20

siemens-healthineers.com


SIEMENS
Healthineers

10. Документация пользователя на русском языке

Принадлежности:




1. Камера для позиционирования пациента

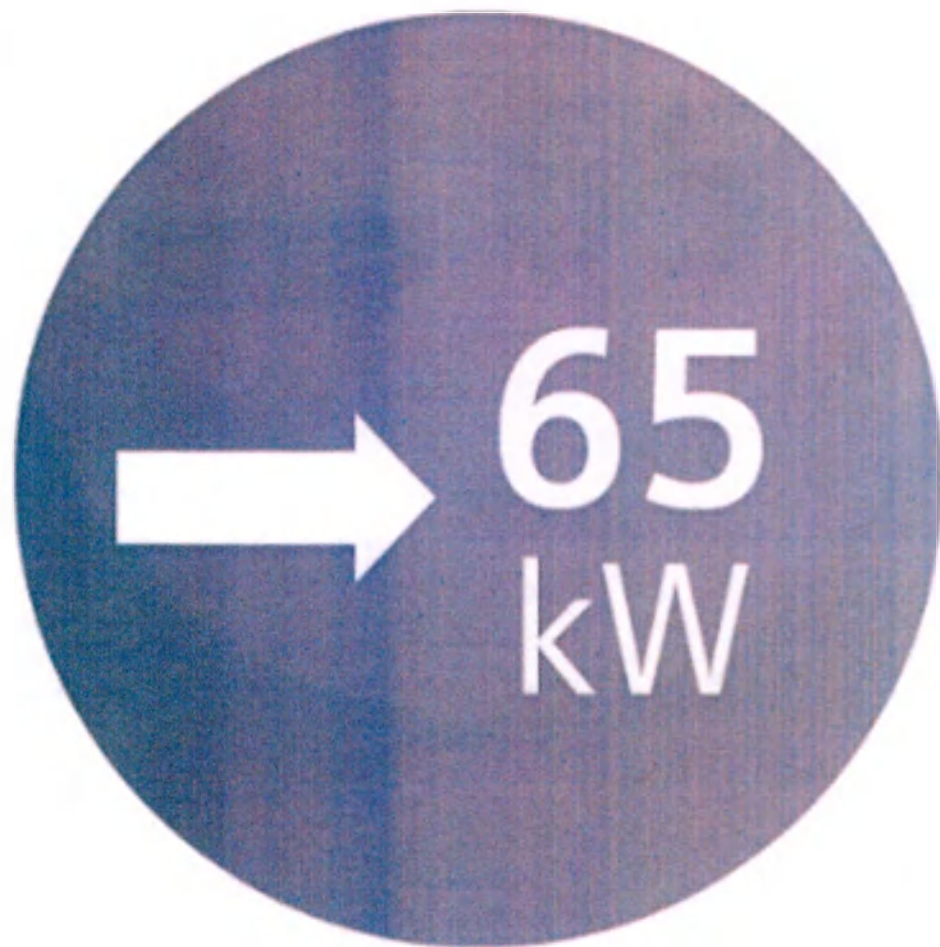


Upgrade

2. Программный режим для увеличения мощности генератора до 65 кВт

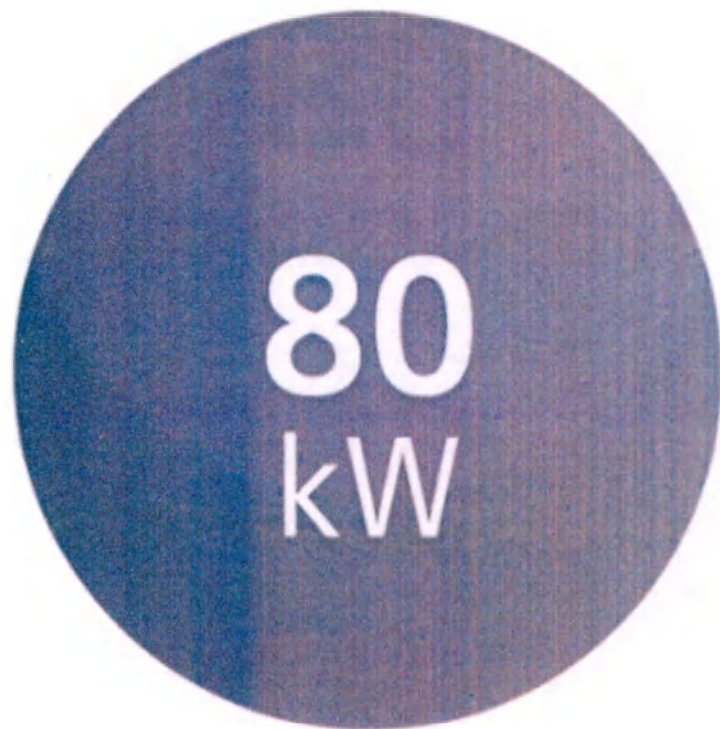


Generator

3. Программный режим для увеличения мощности генератора до 80 кВт

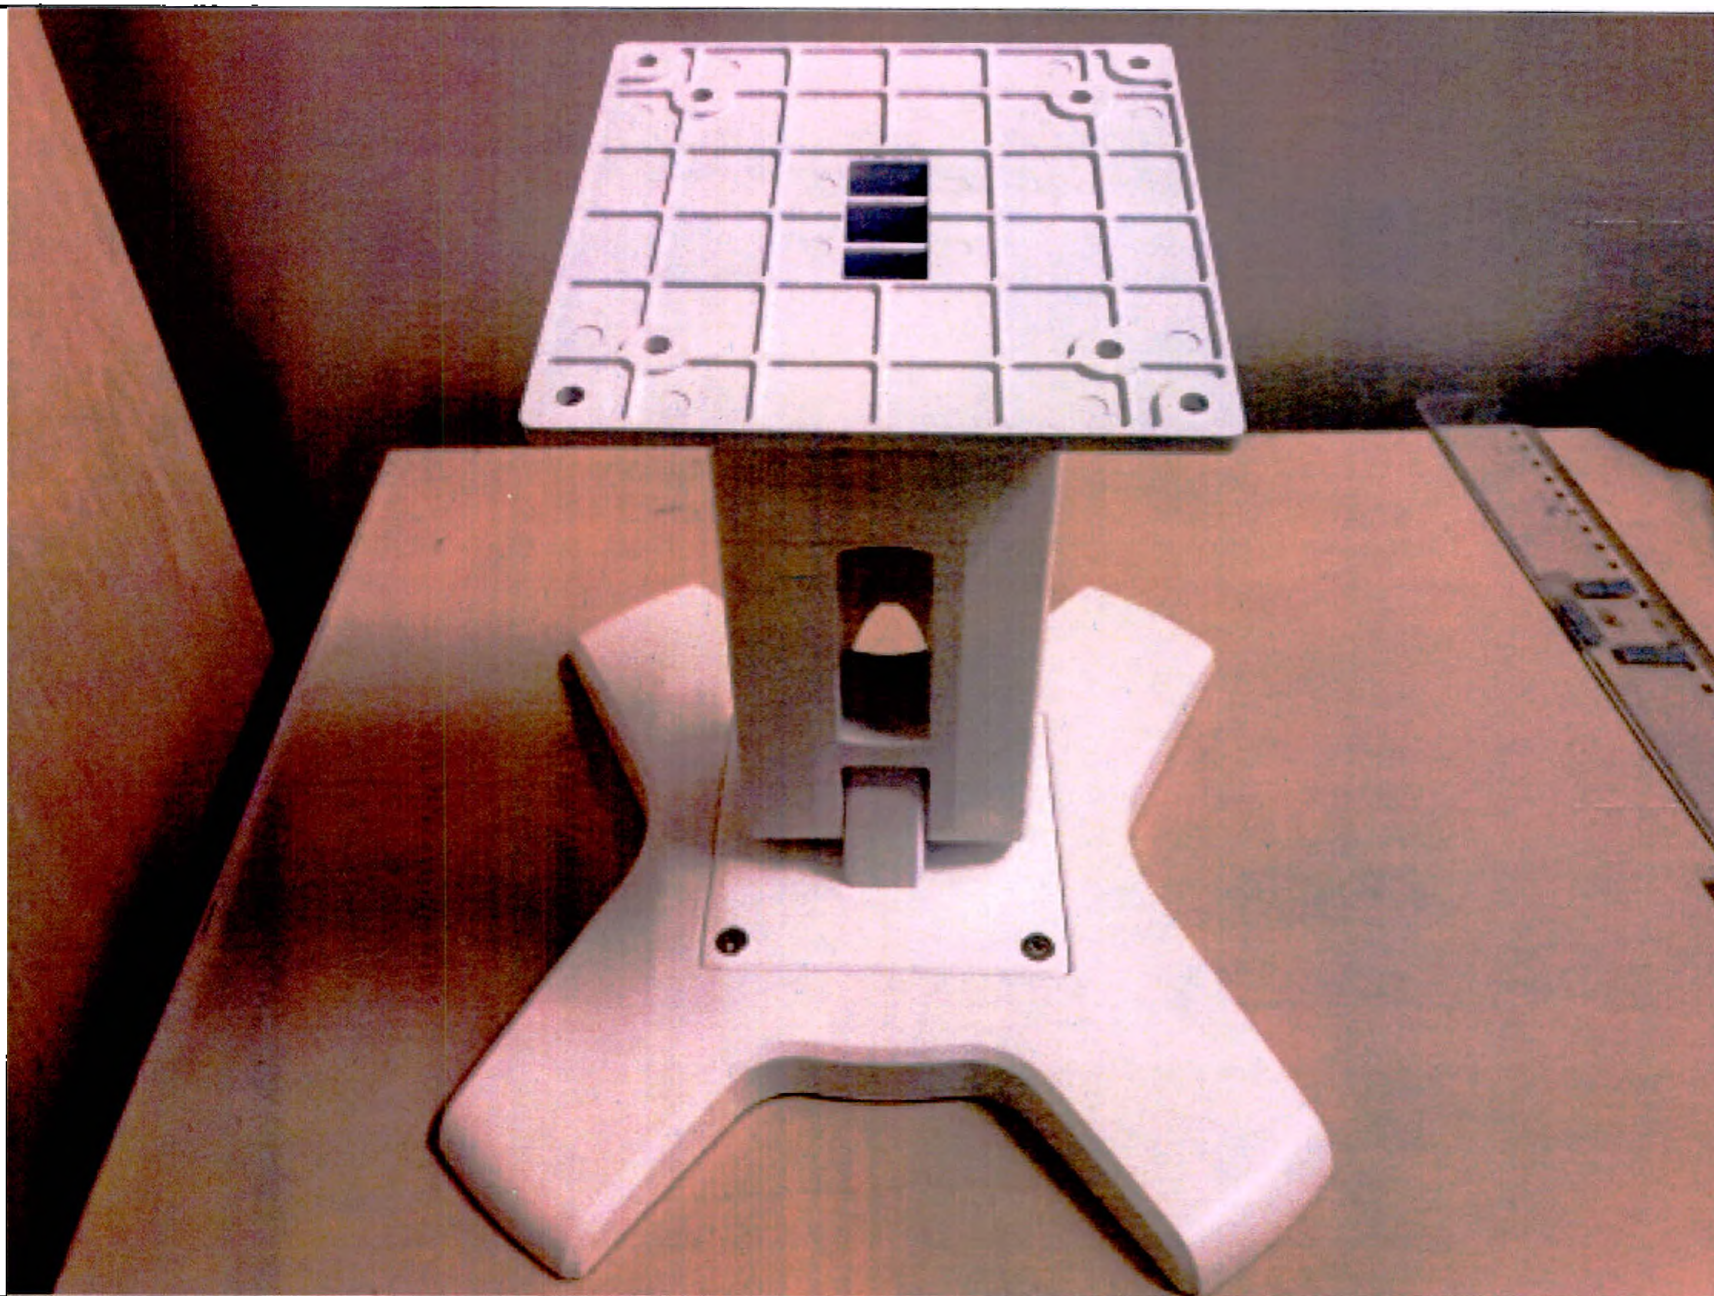


4. Стойка для станции формирования изображений

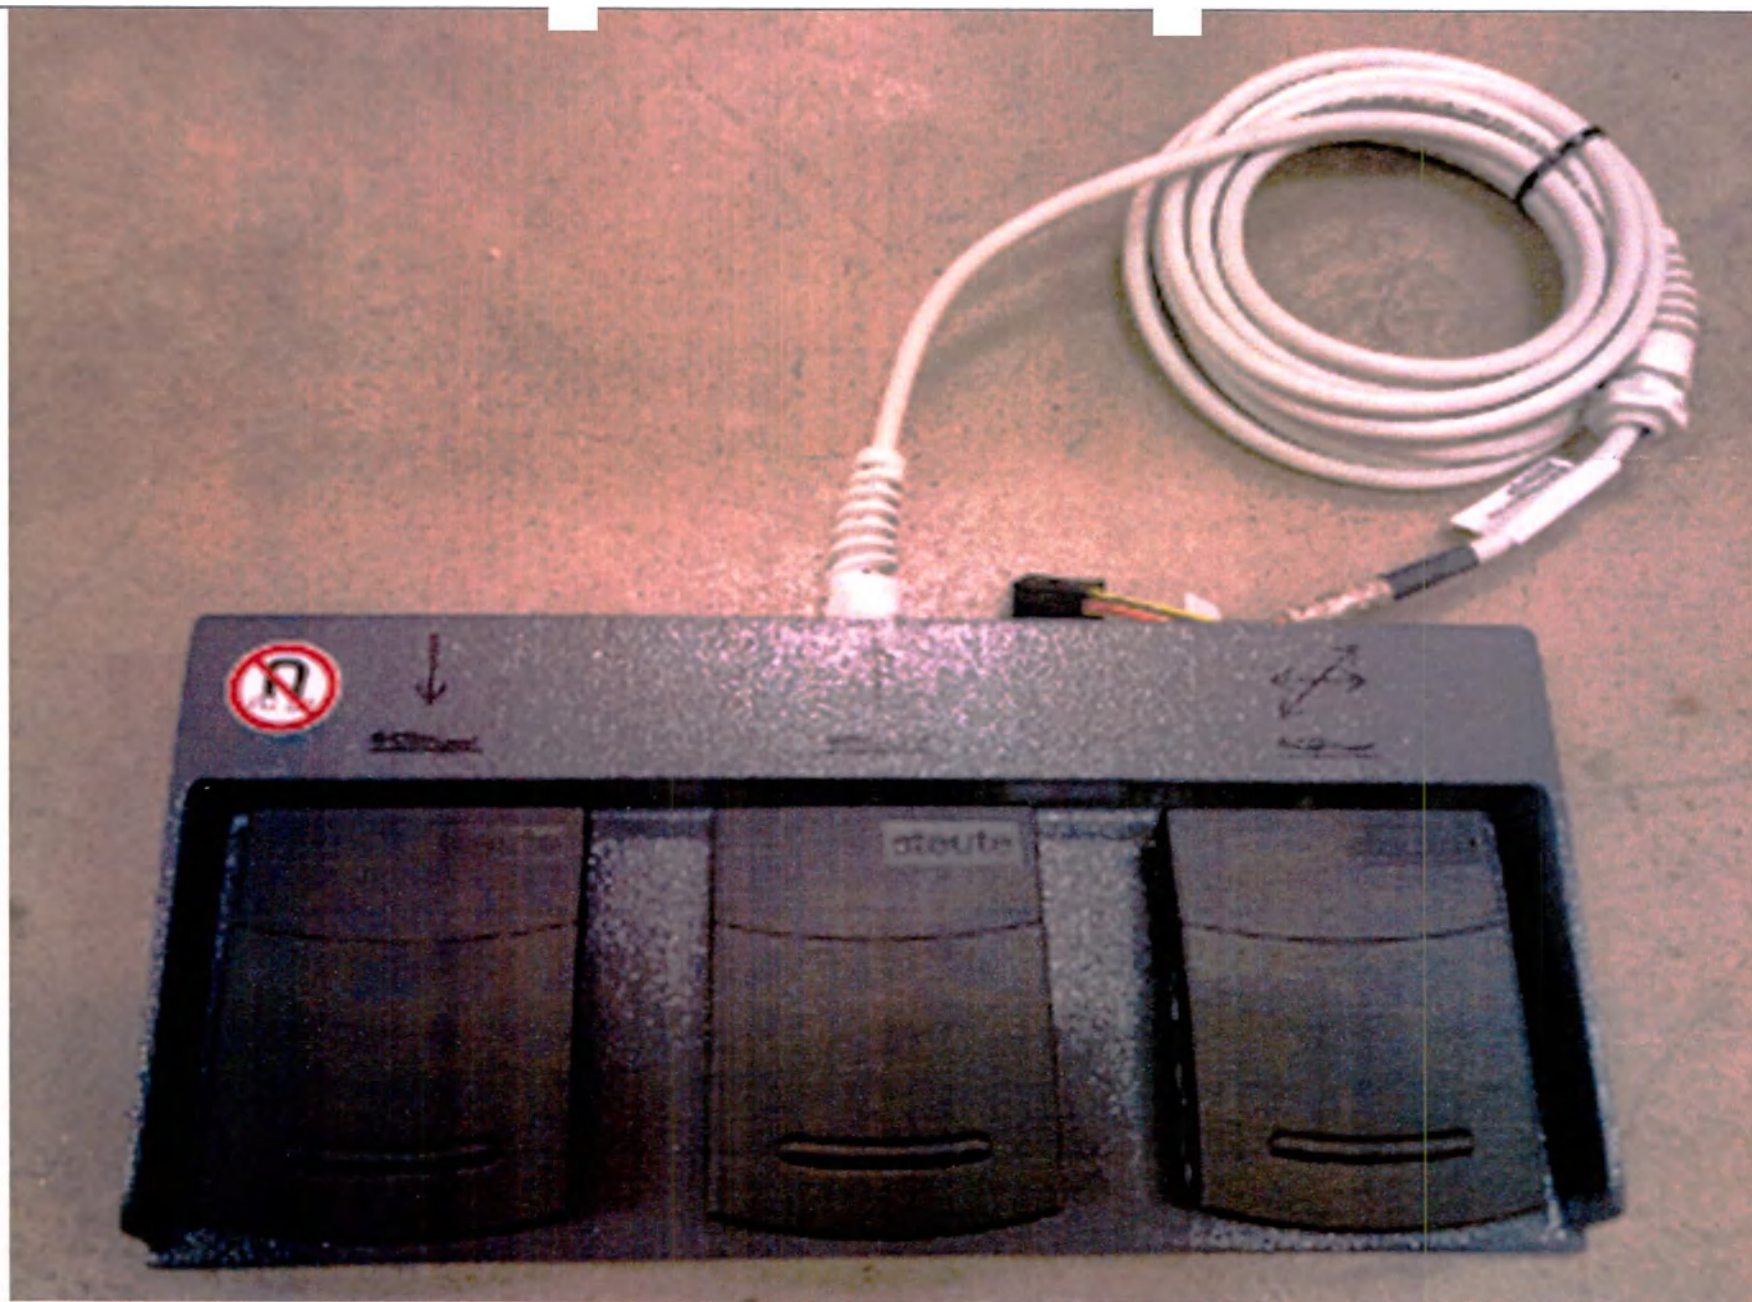

5. Переключатель педальный



6. Беспроводной пульт дистанционного управления

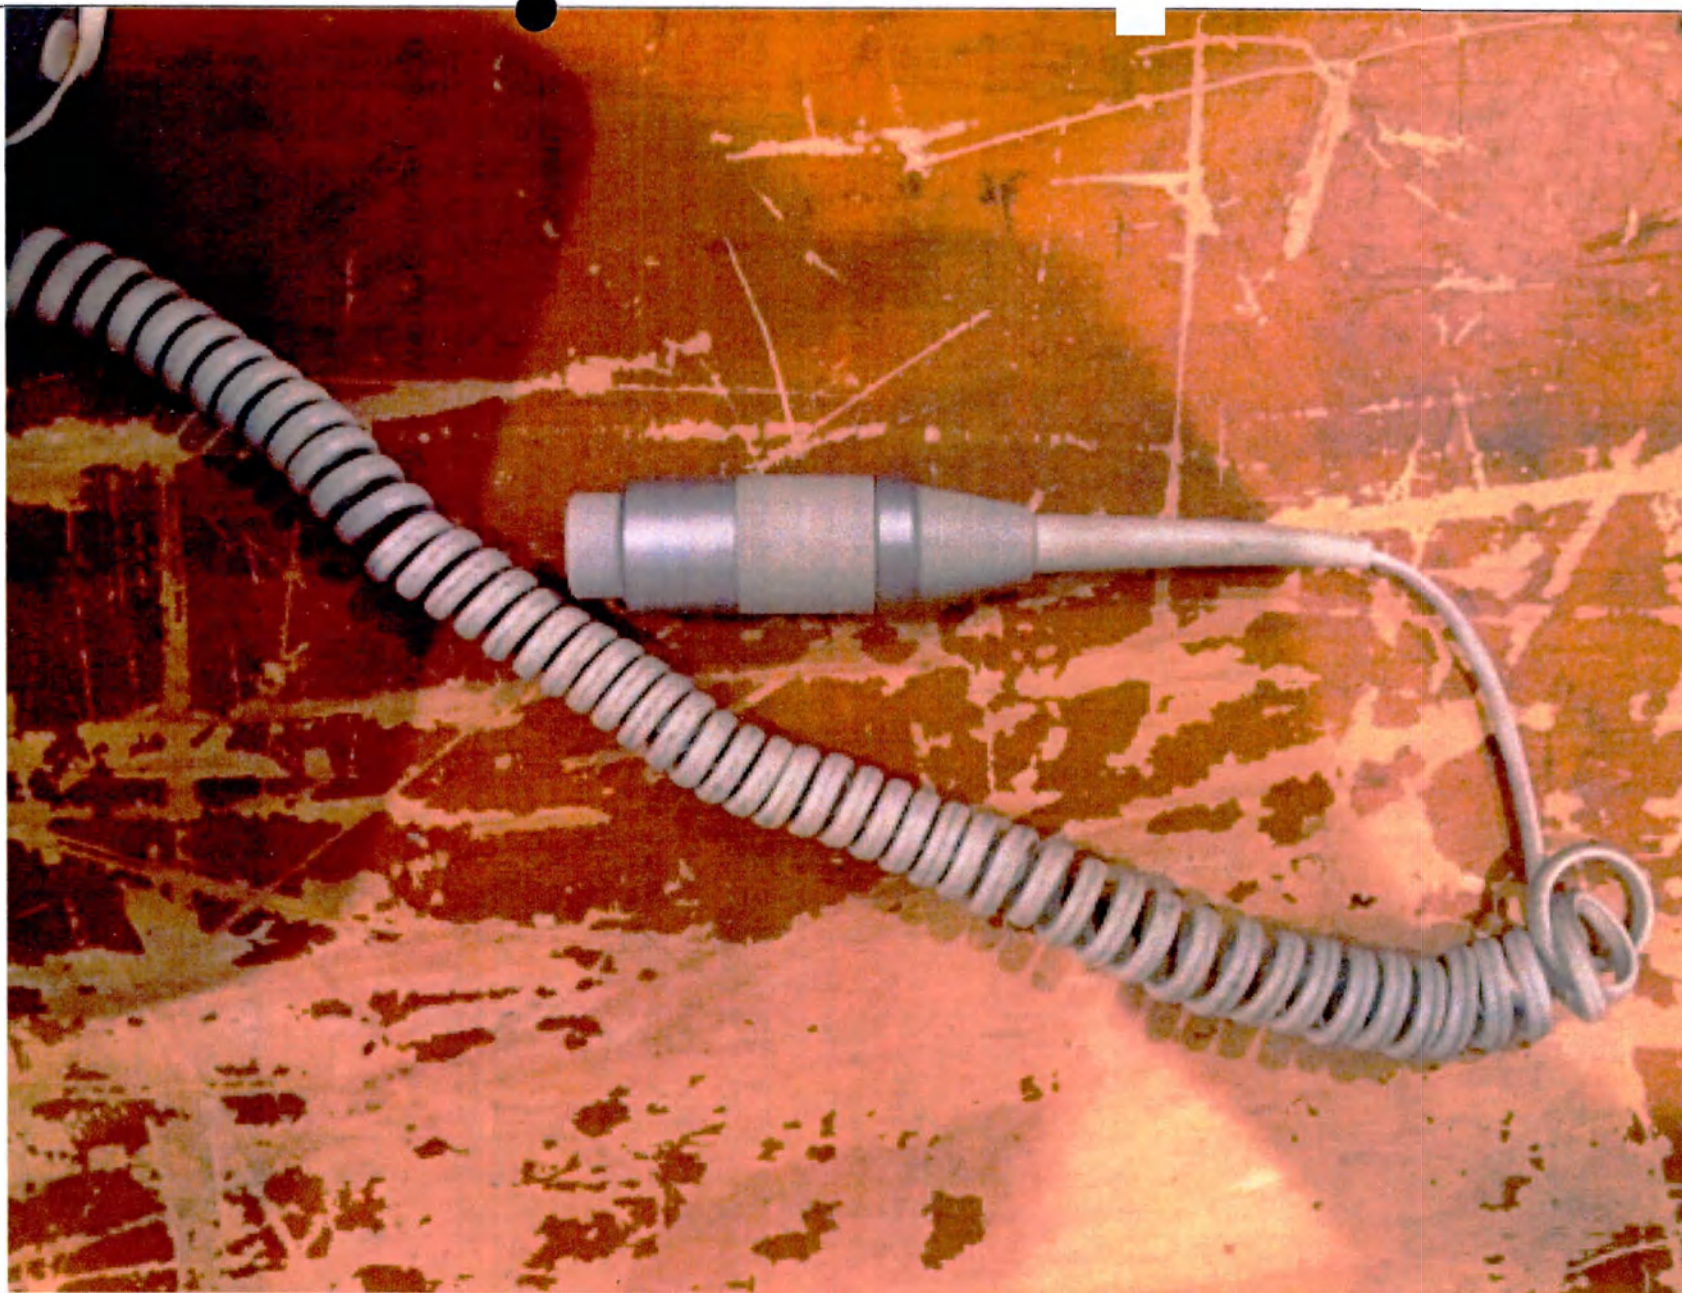


7. Переключатель ручной




8. Дисковод для записи CD/DVD.




9. Источник, бесперебойного питания

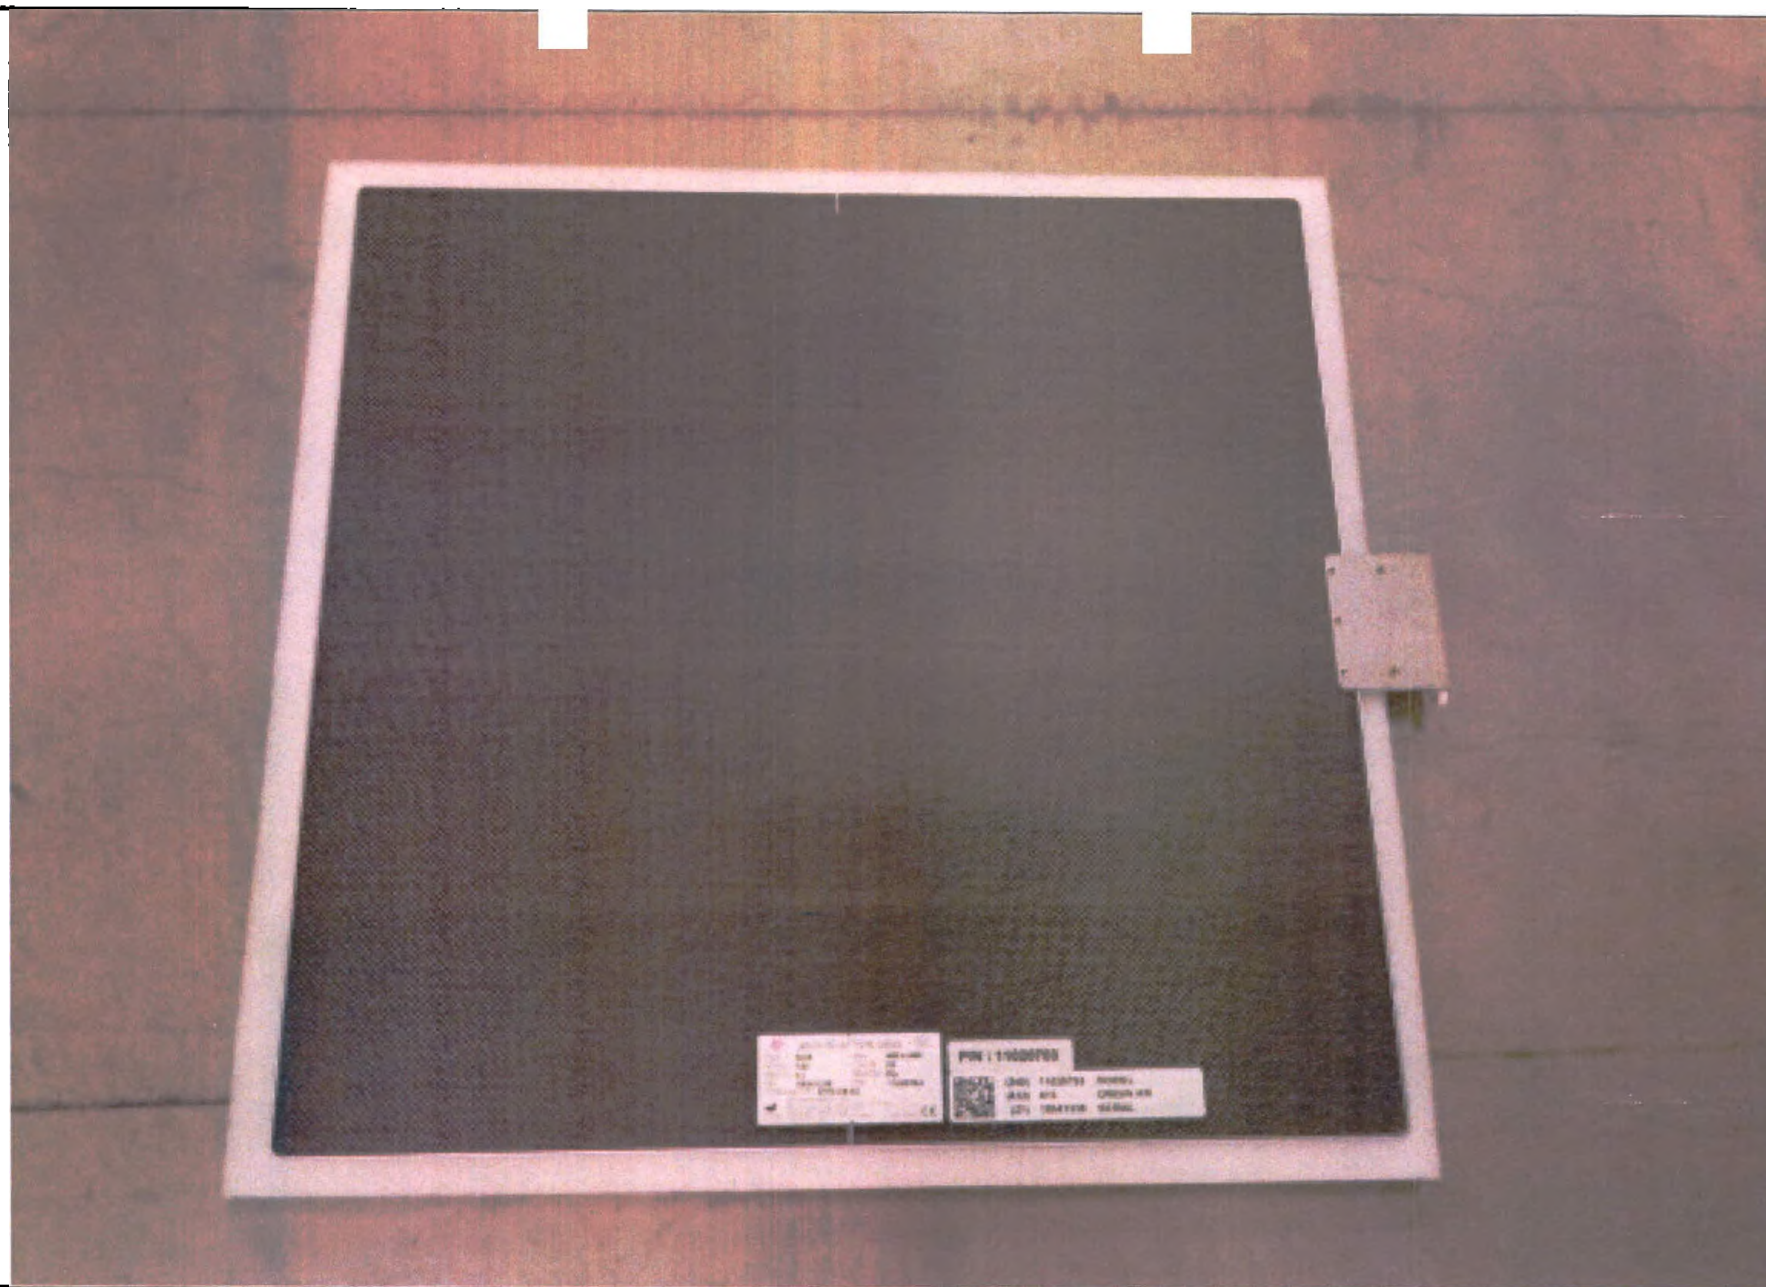

11. Решетка отсеивающая универсальная (13/92)

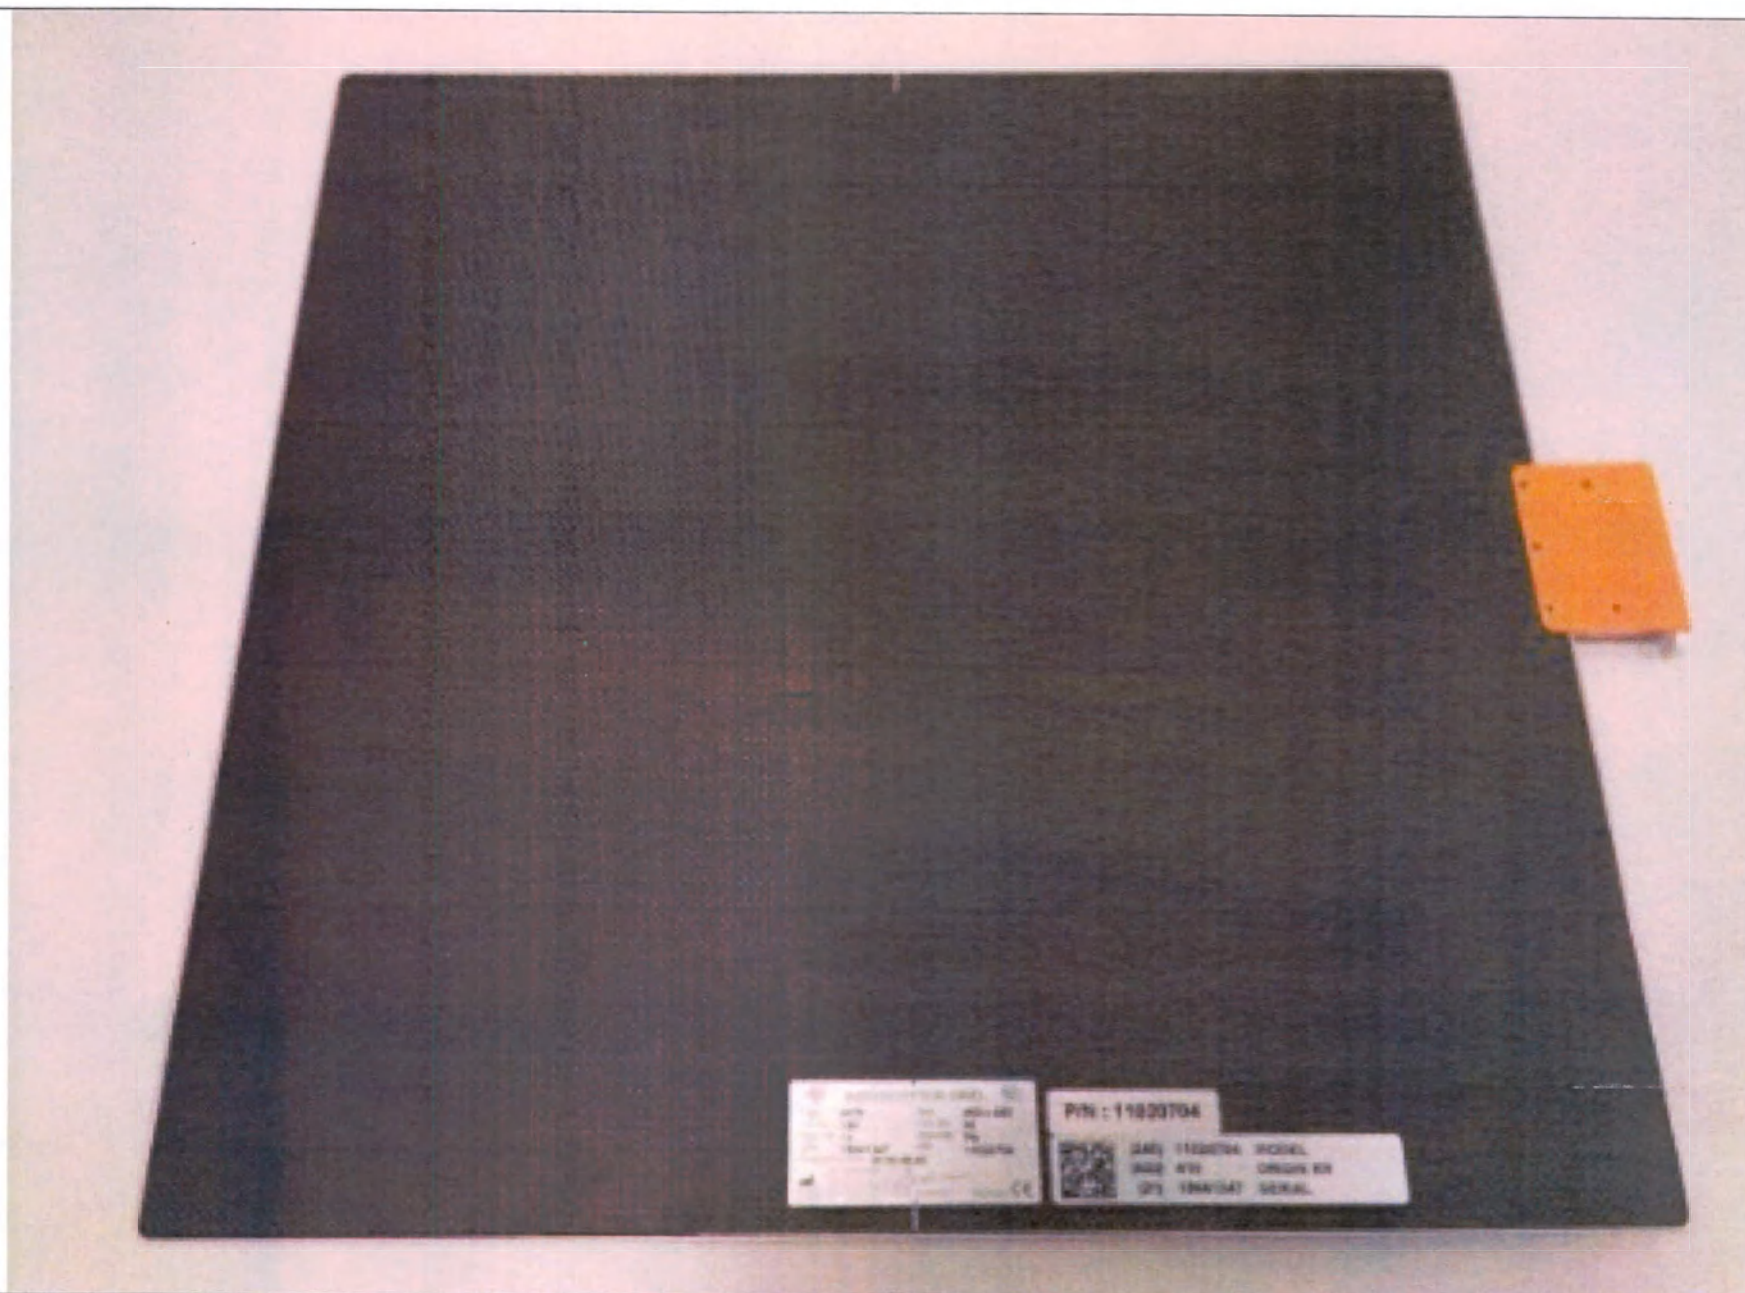


12. Решетка отсеивающая (13/92, F180)

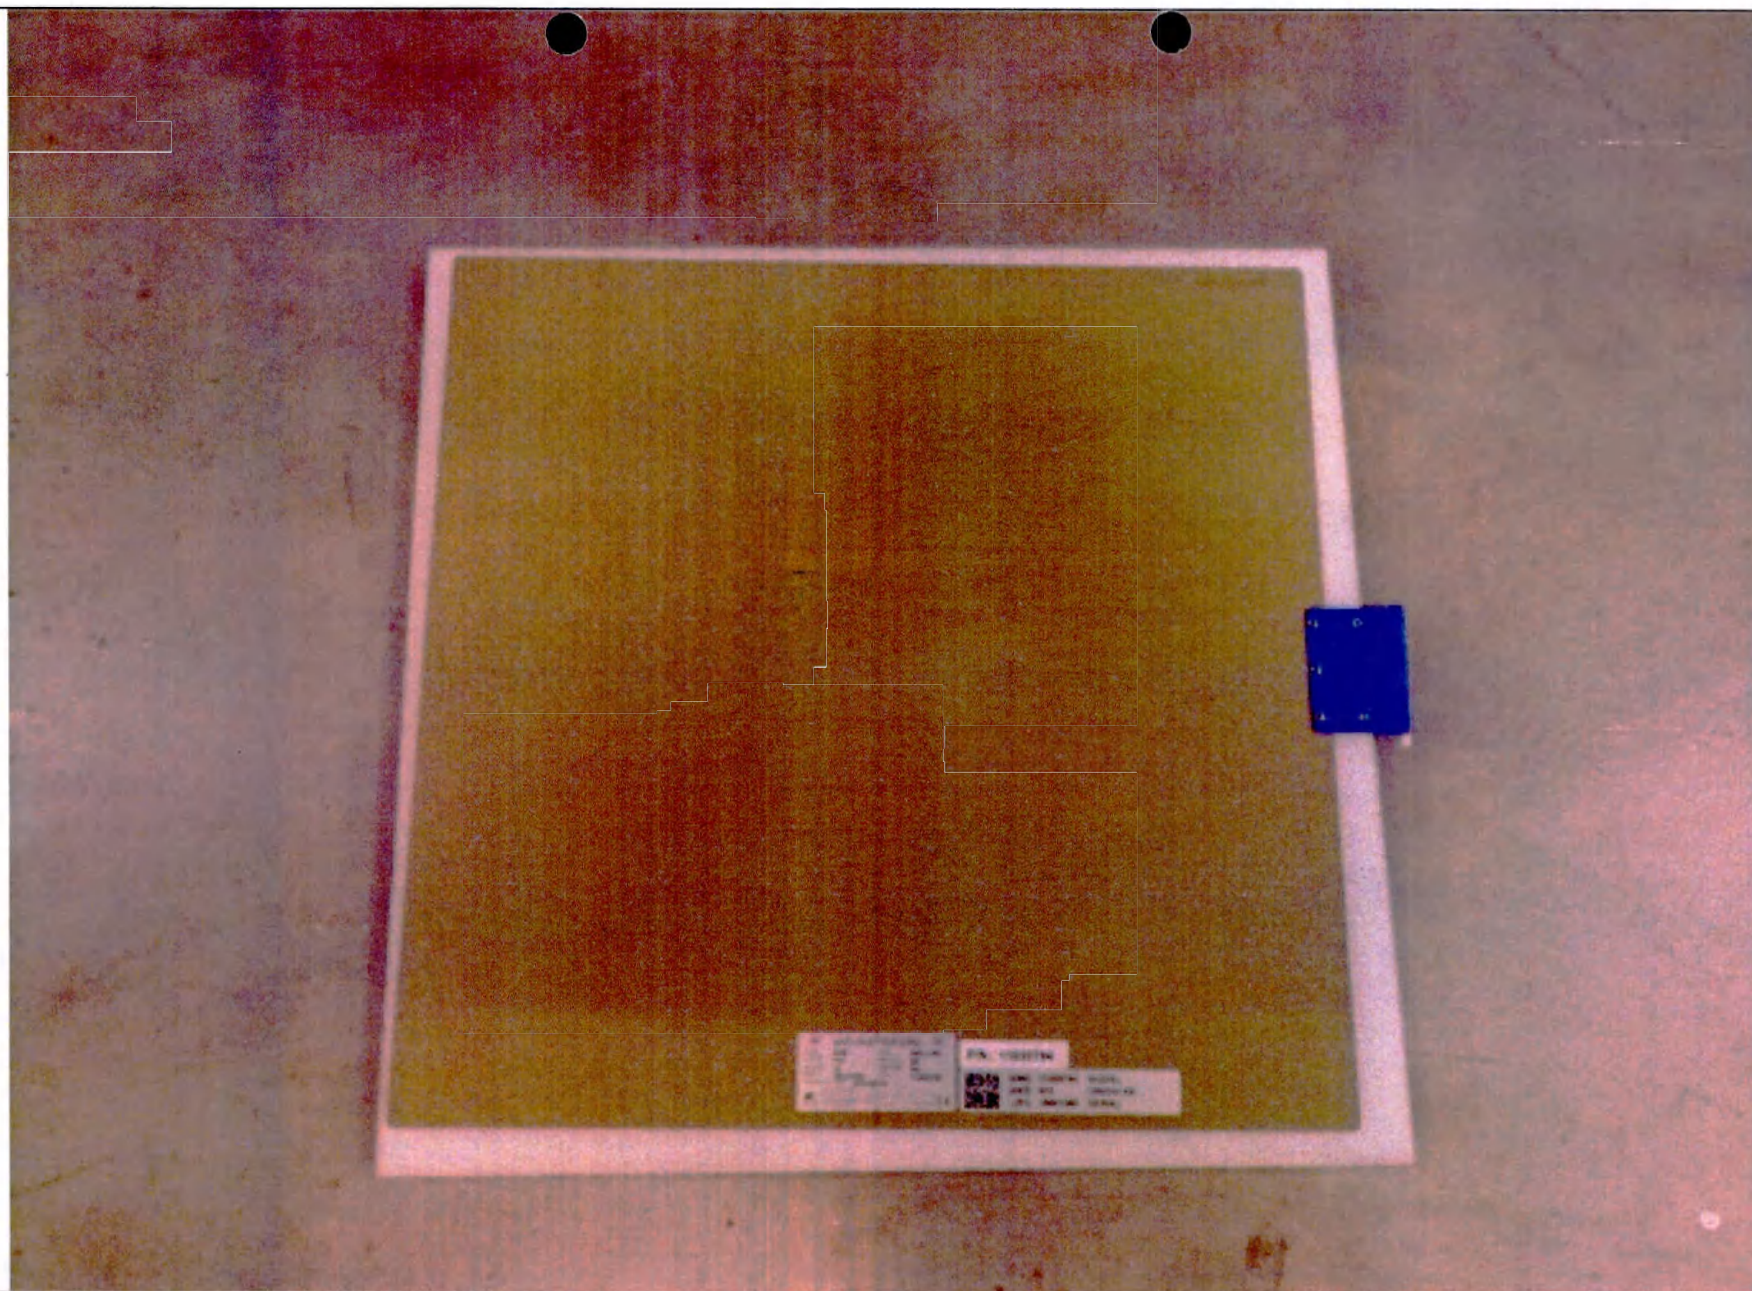


13. Решетка отсеивающая (13/40, F115)




14. Решетка отсеивающая универсальная (13/40)

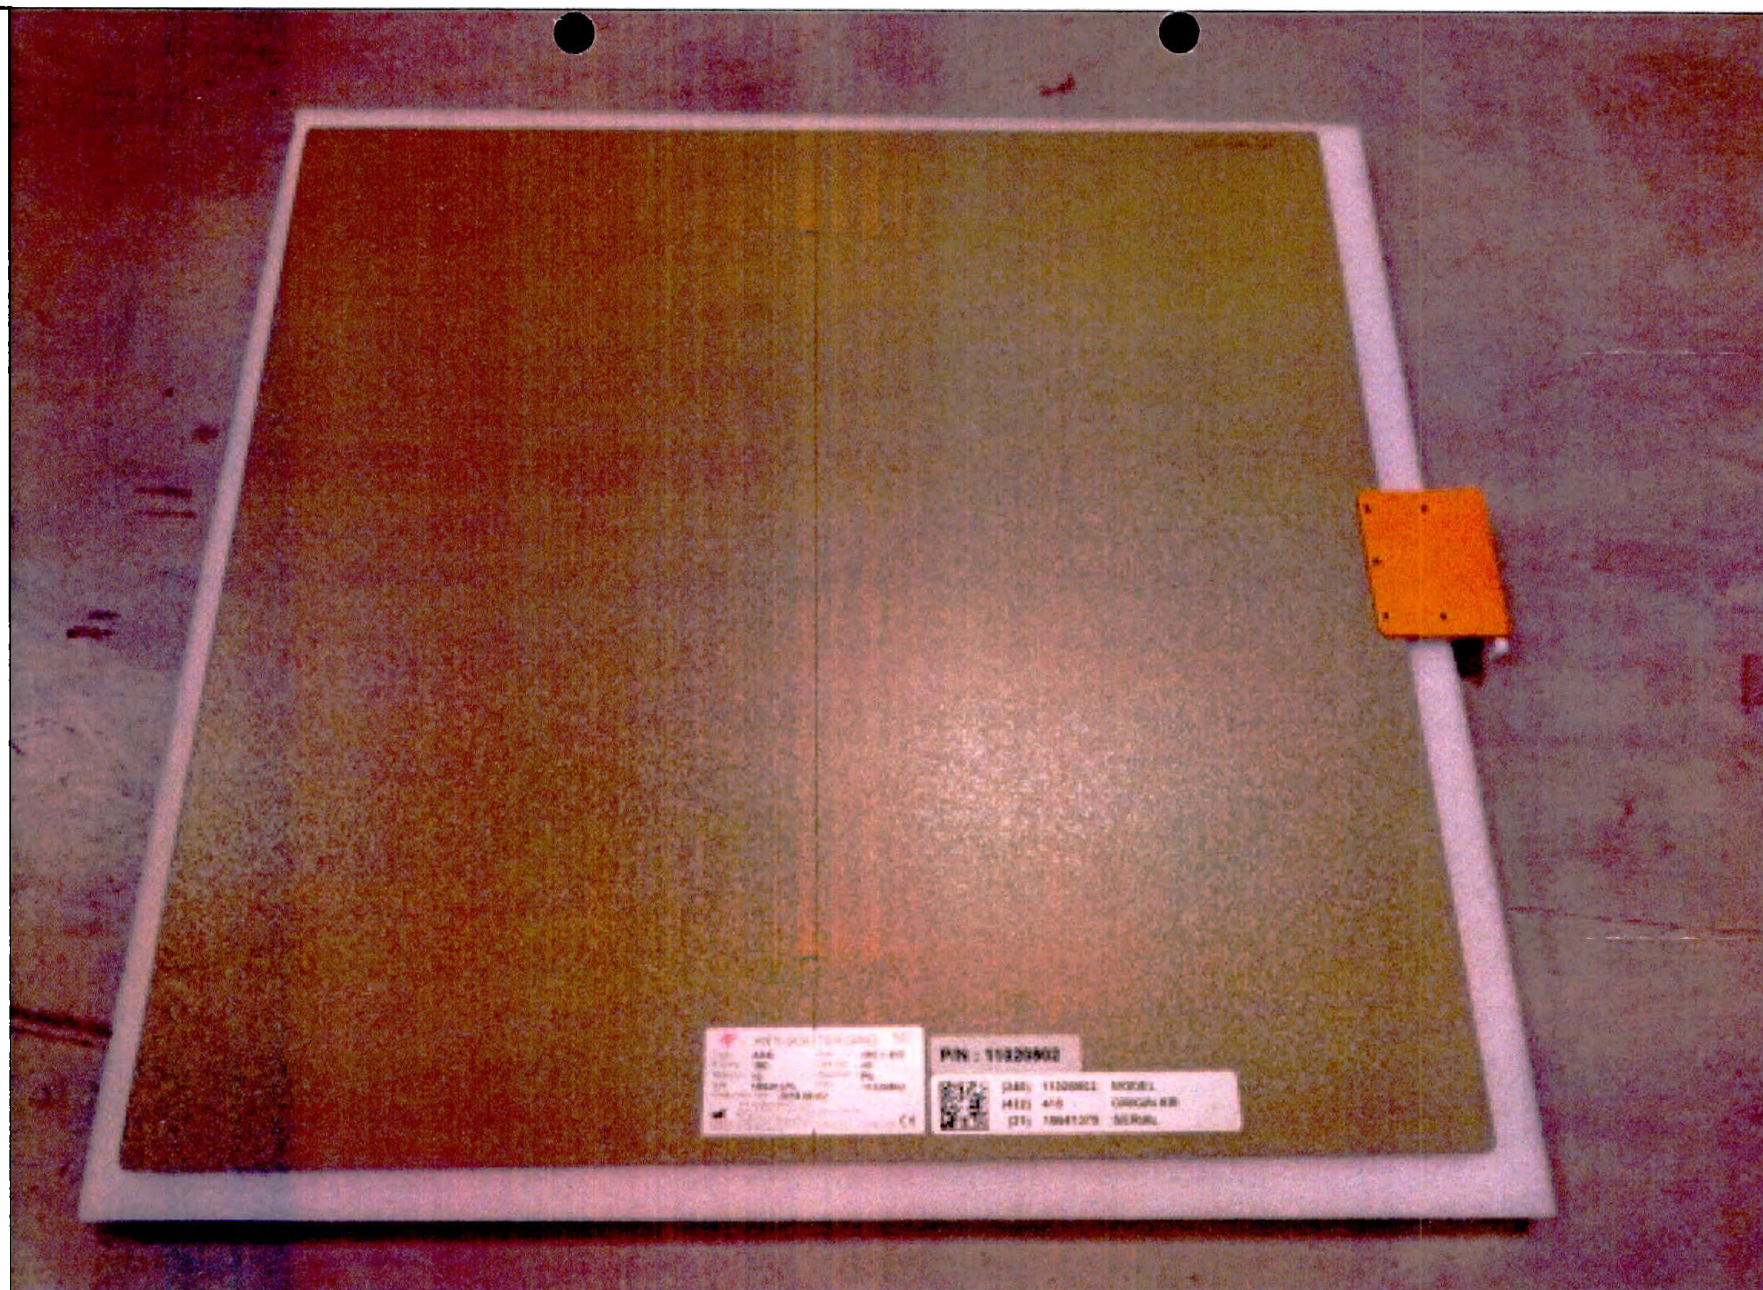

15. Решетка отсеивающая (13/40, F180)

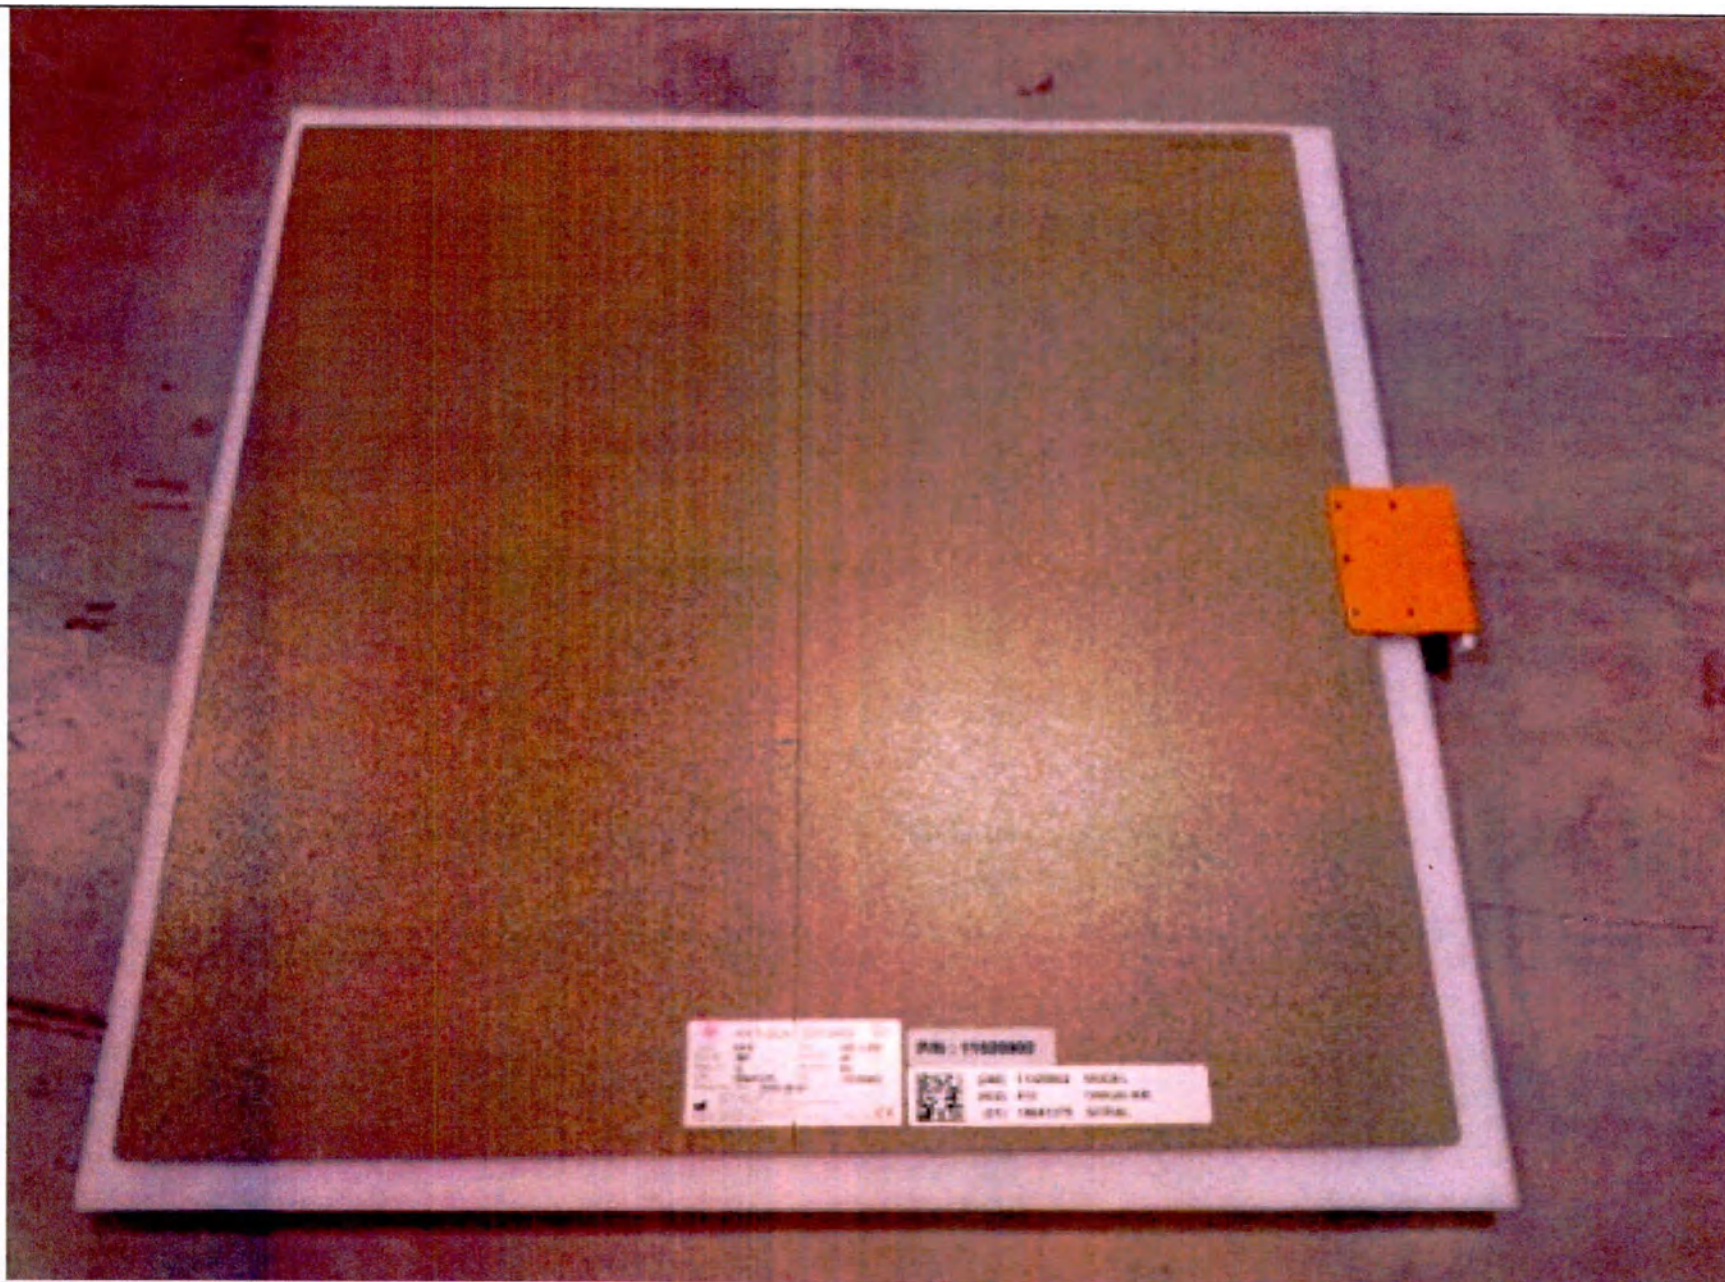

16. Решетка отсеивающая (13/92, F300)

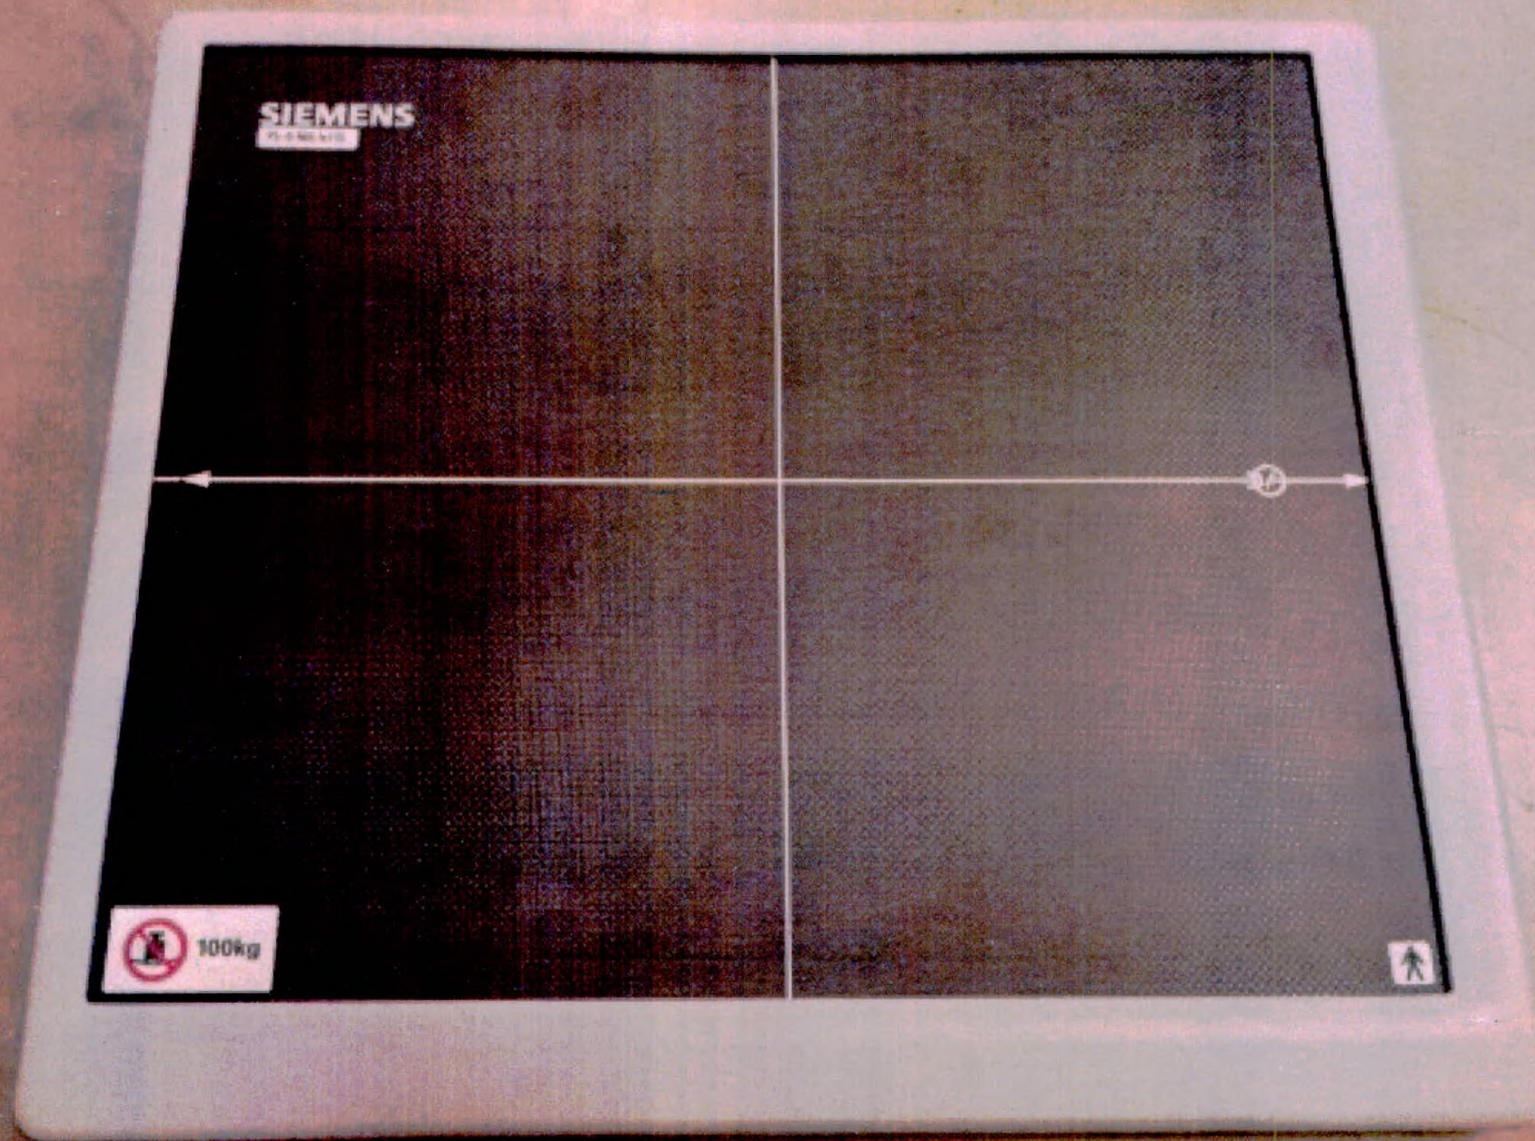


17. Решётка отсеивающая съёмная для детектора MAX wi-D (5/85, F115)




18. Решётка отсеивающая съёмная для детектора MAX wi-D (15/80, F115)




19. Устройство зарядное для батарей детекторов MAX wi-D

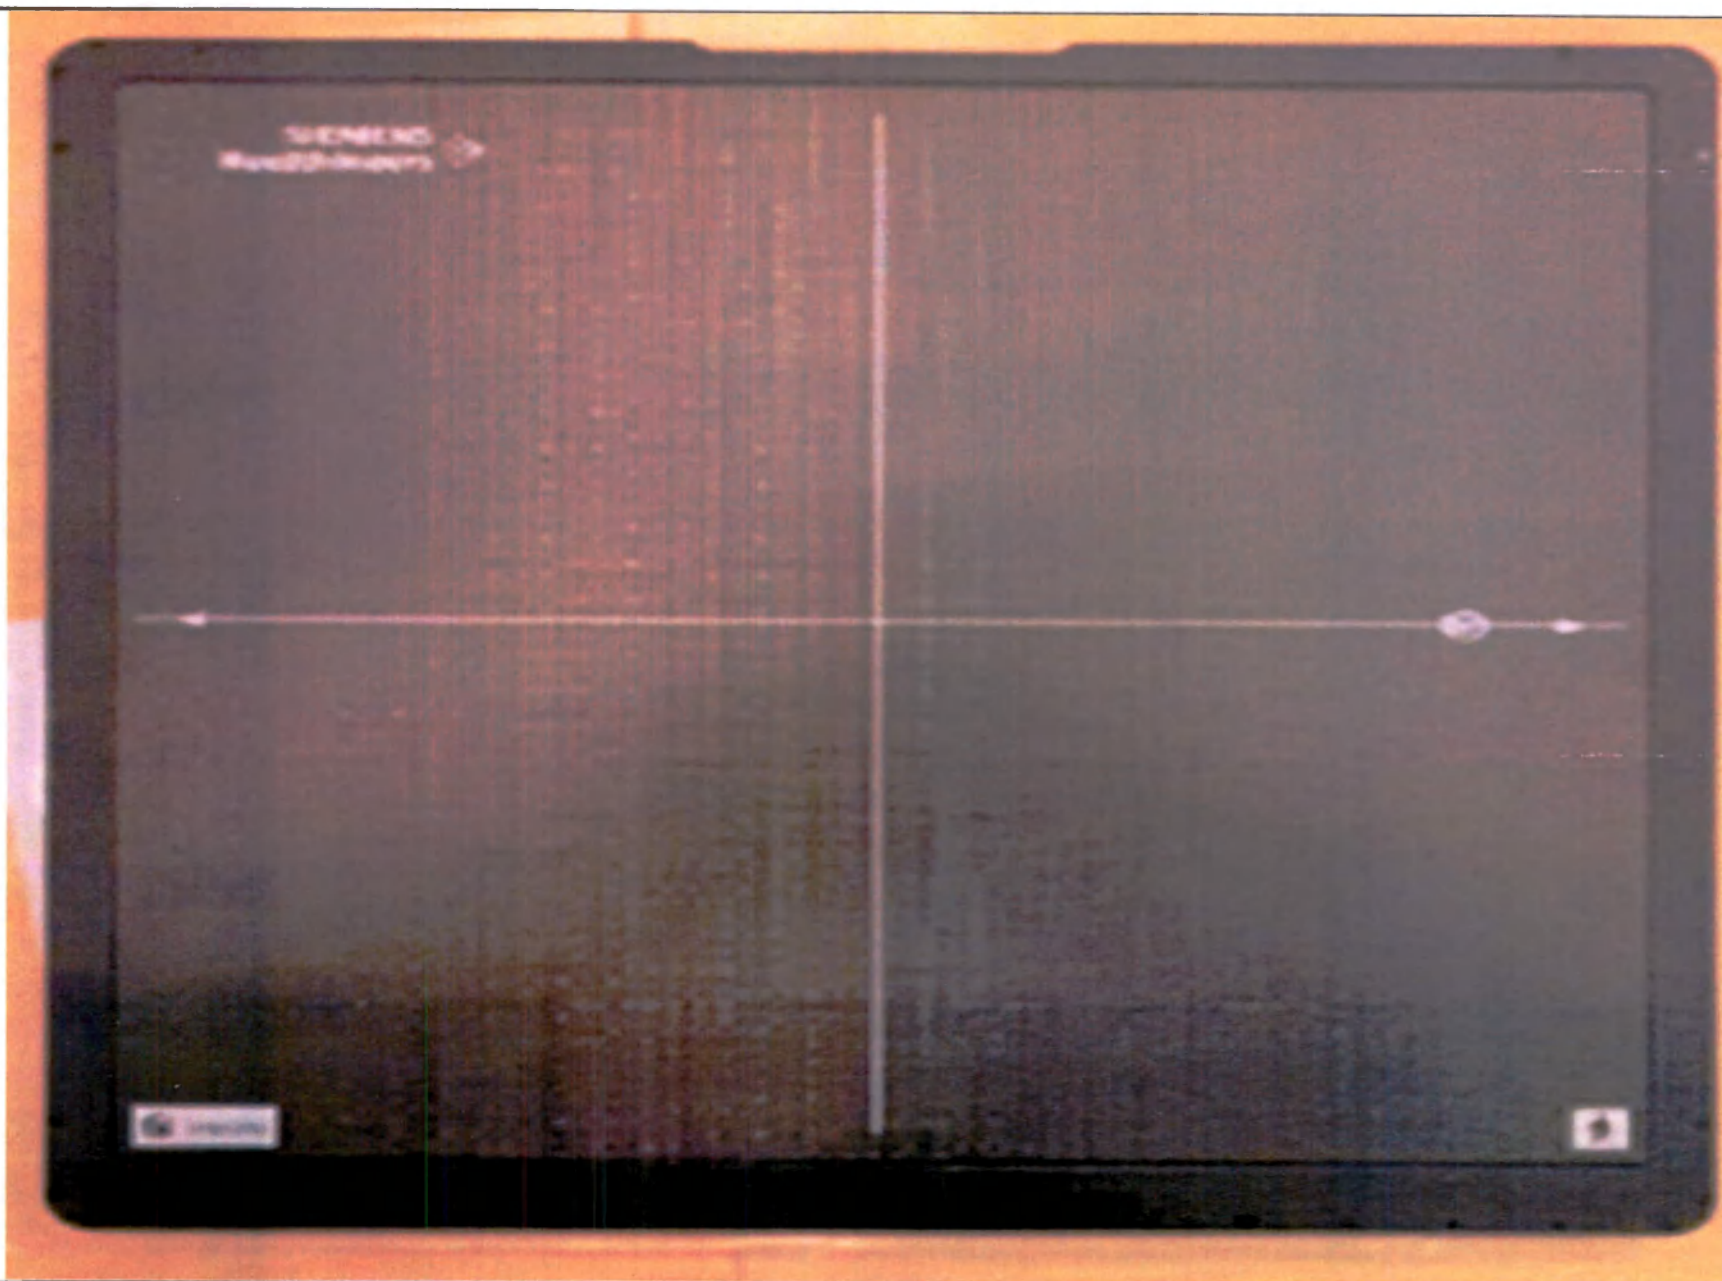


20. Решётка отсеивающая съёмная для детектора Core XL

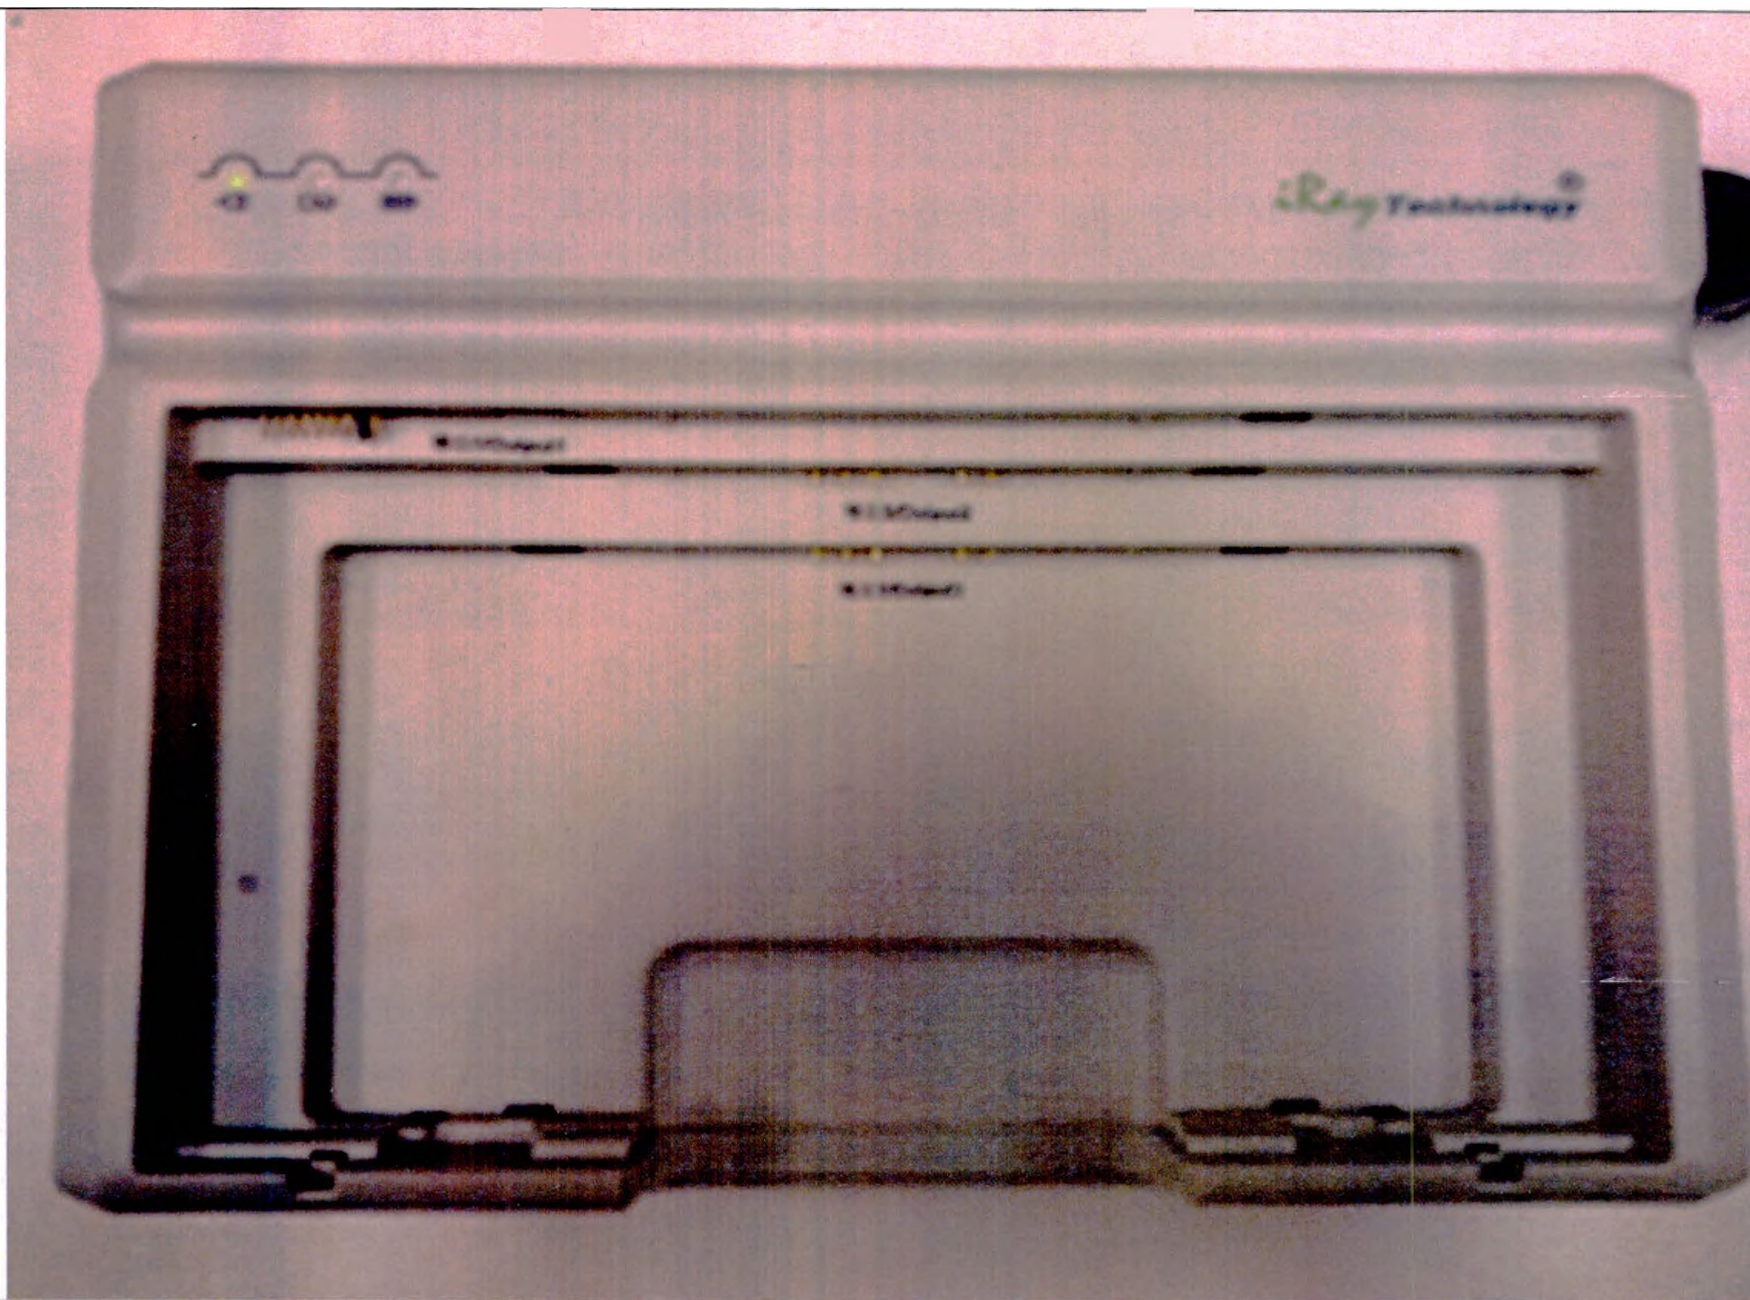


21. Устройство зарядное для батарей детекторов Core XL

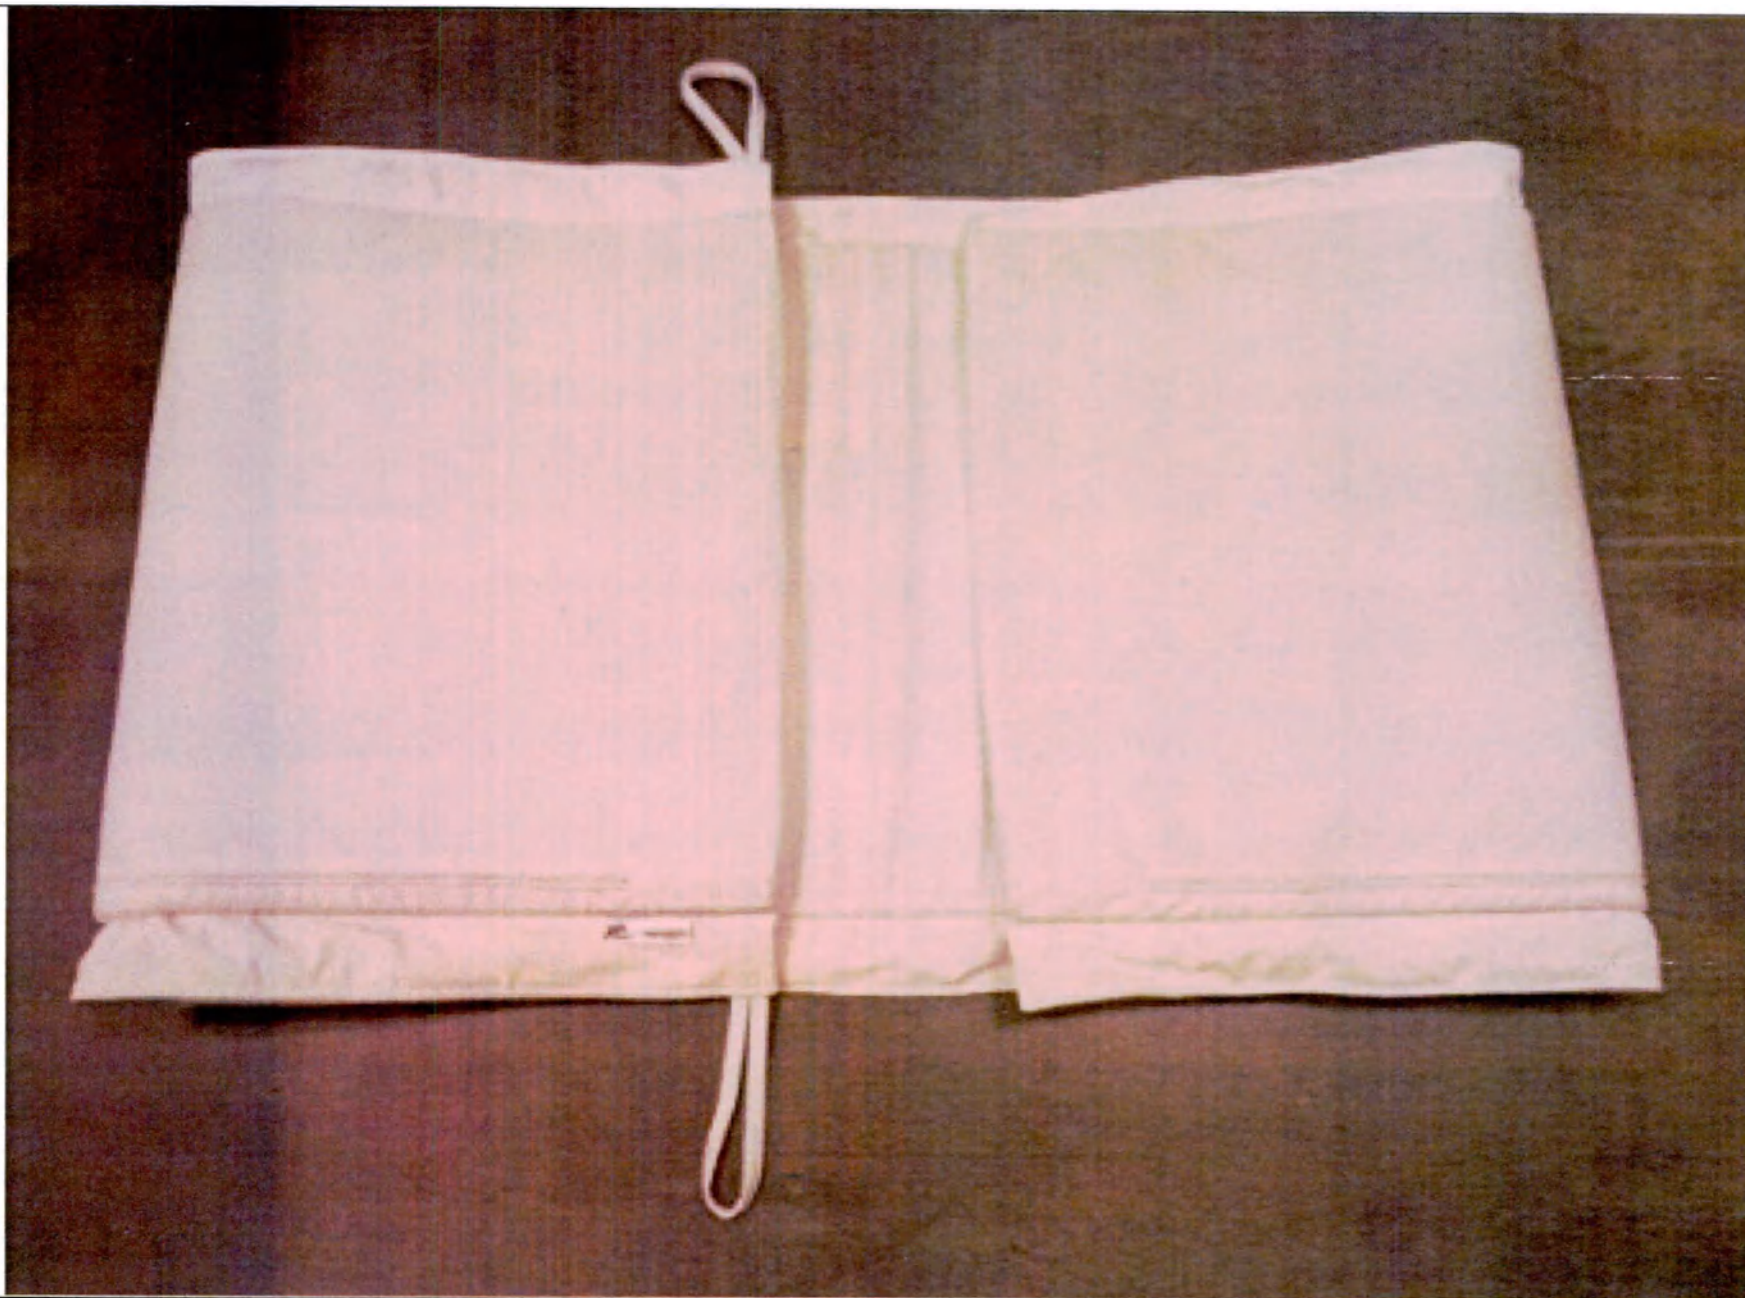

22. Матрас для позиционирования пациента.

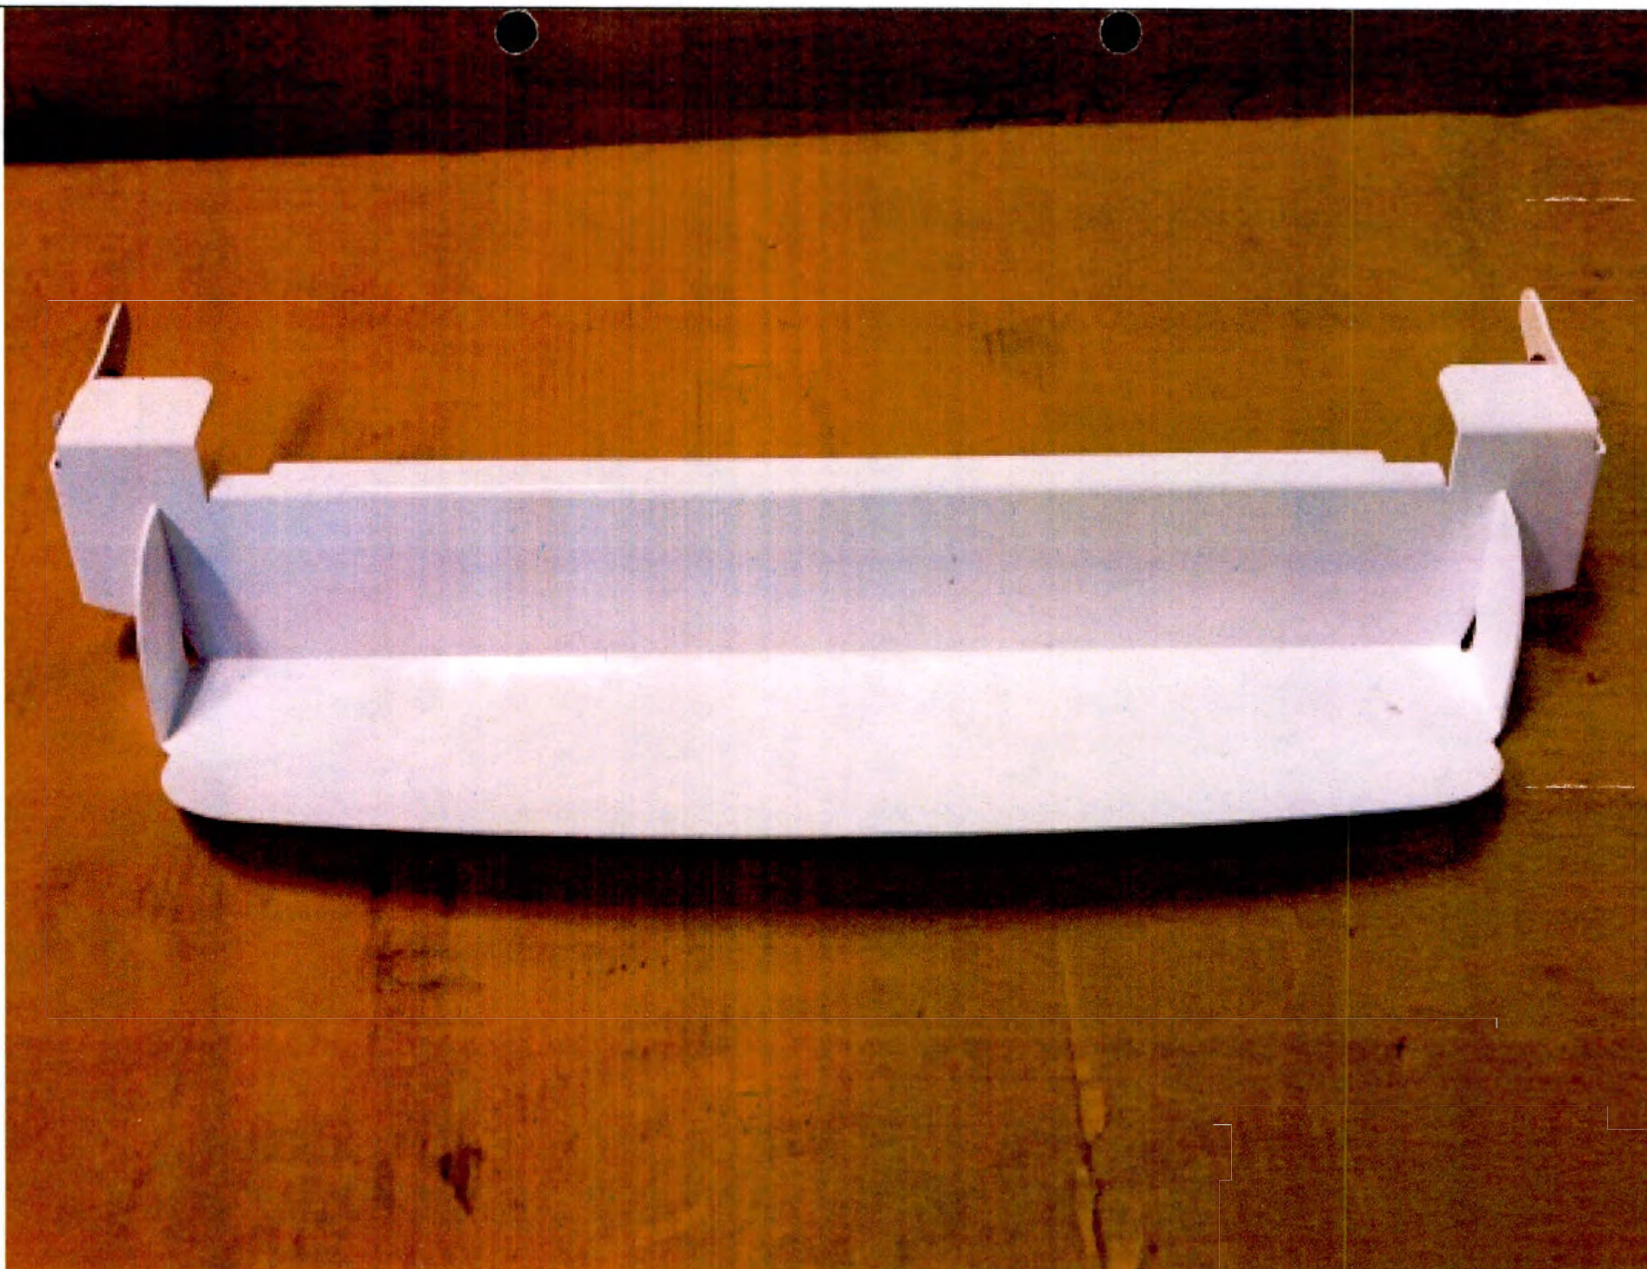

23. Держатель для рулонной бумаги.

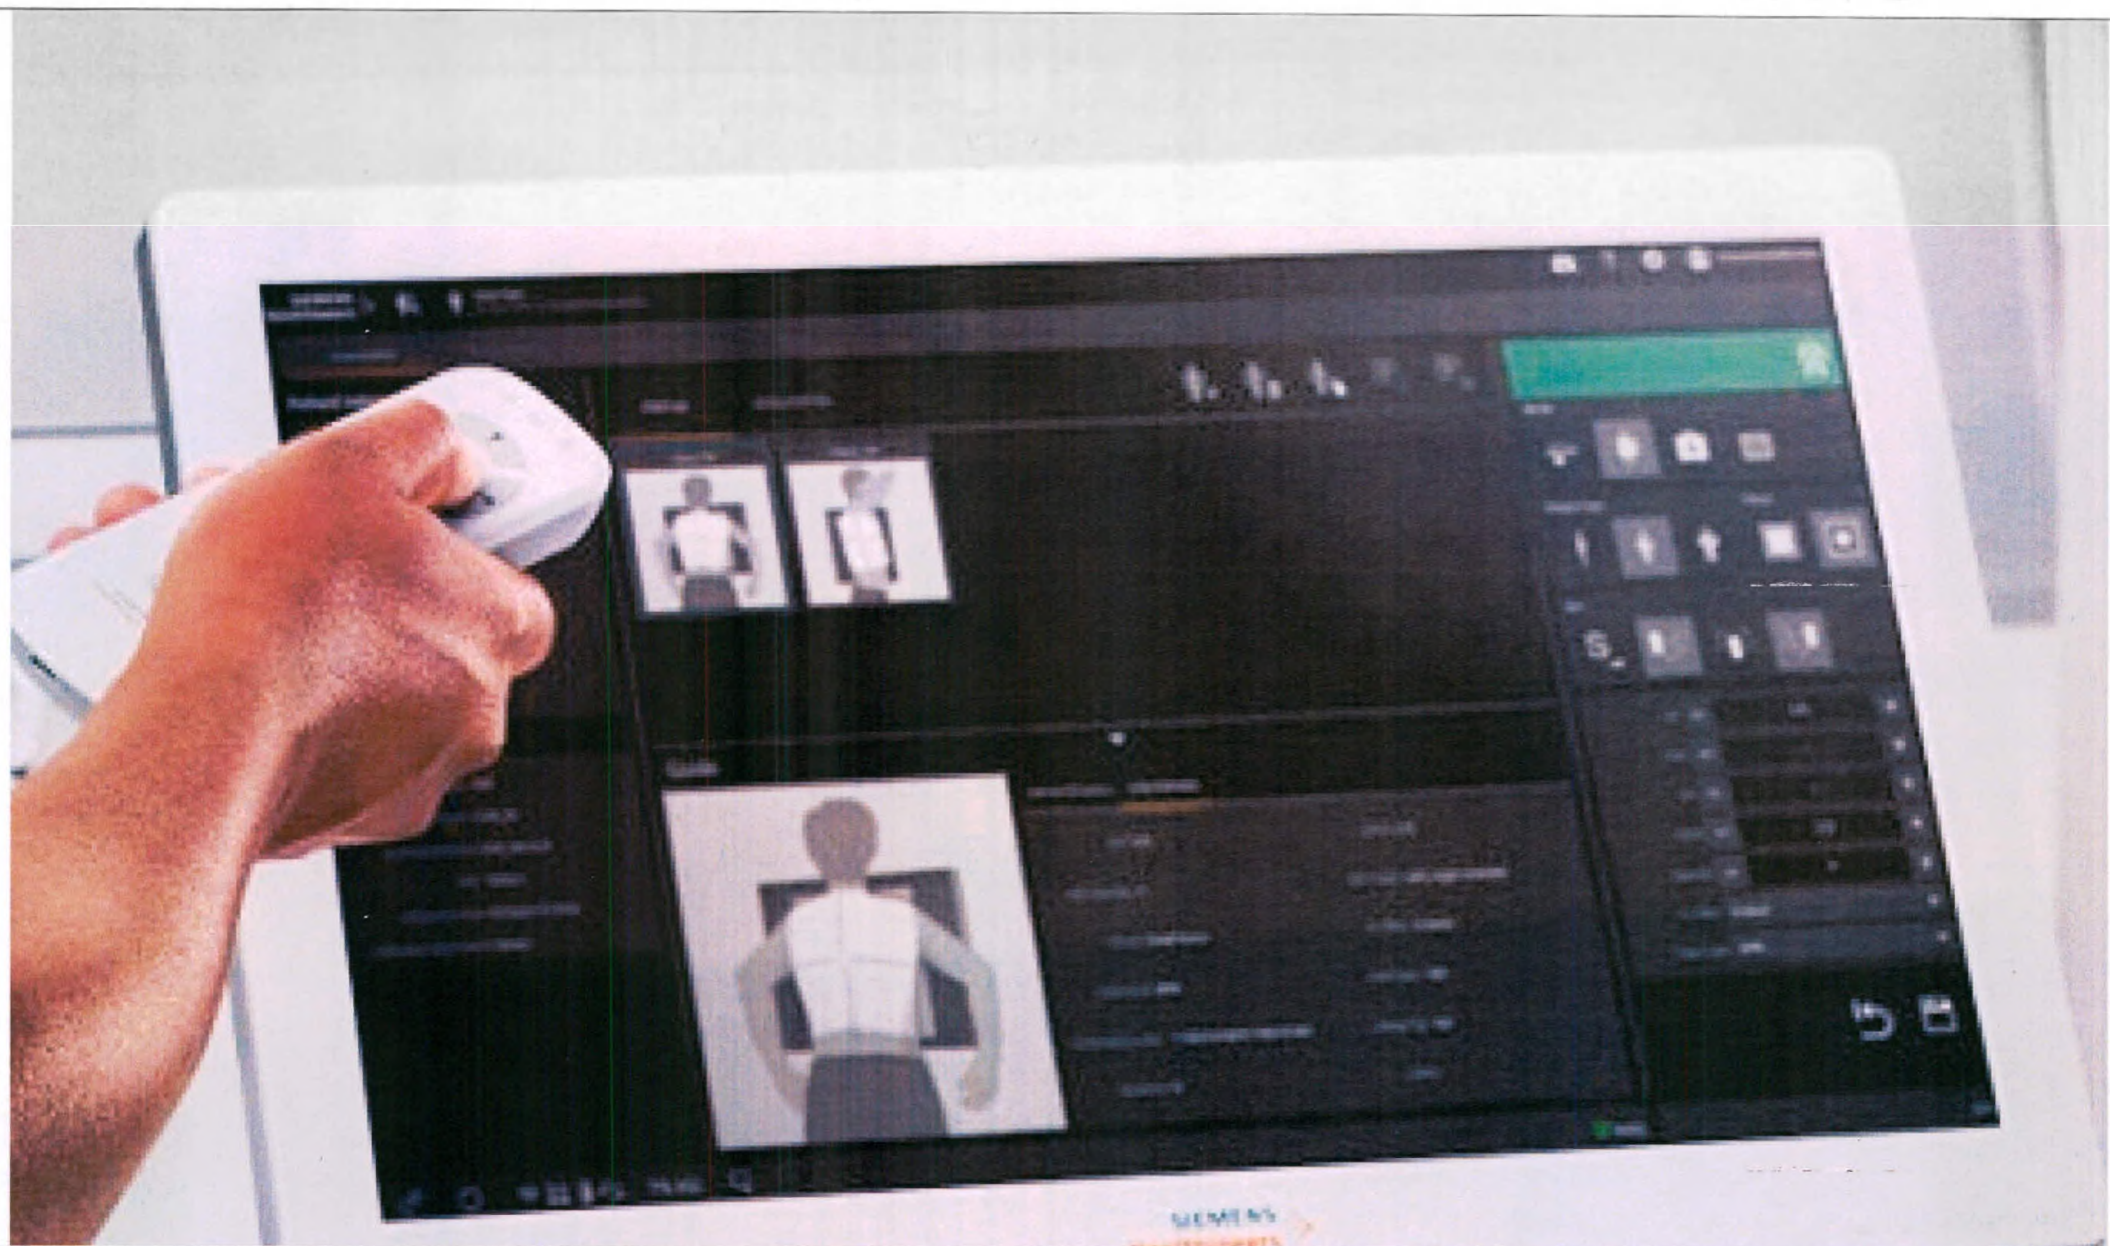

24. Программный режим сохранения положений штатива SmartMove.

Icon	Short description
	Select TOD (Table-Object Distance)
	Acquisition start or end position (based on the acquisition direction)
	Acquisition end or start position (based on the acquisition direction)

26. Программный режим панорамного сканирования SmartOrtho



27.1 Программный режим виртуальной коллимации Smart Virtual Ortho/3D camera




27.2 Программный режим виртуальной коллимации Smart Virtual Ortho/3D camera



28. Программный режим автоматической коллимации.



29. Лицензия временная на программный режим автоматической коллимации.

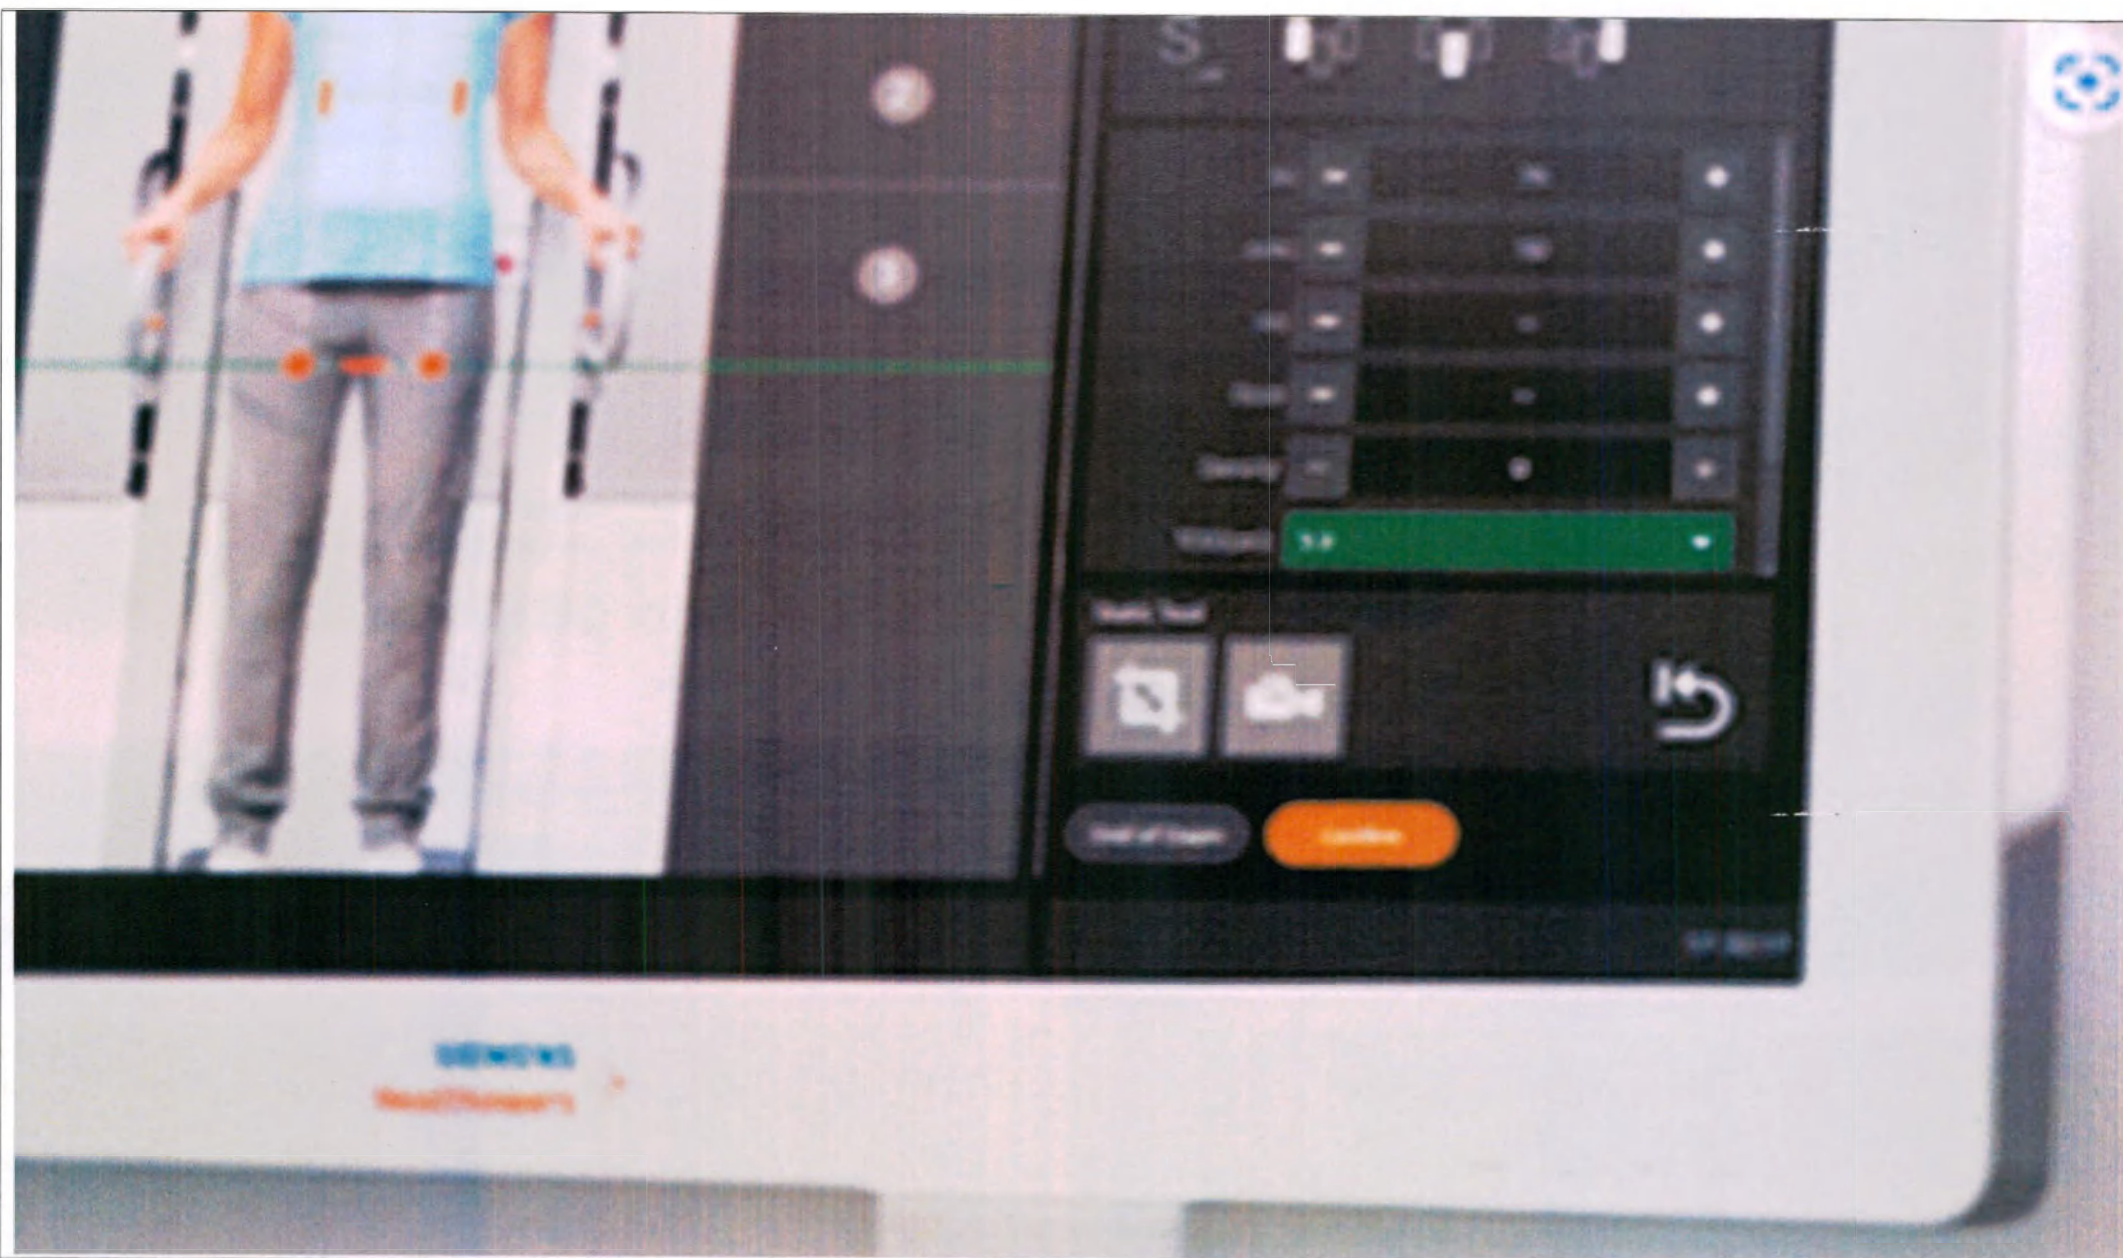

30. Программный режим автоматического определения толщины пациента и TOD




31. Программный режим гибридного документирования




32. Лицензия временная на программный режим гибридного документирования




33. Программный режим виртуальной коллимации

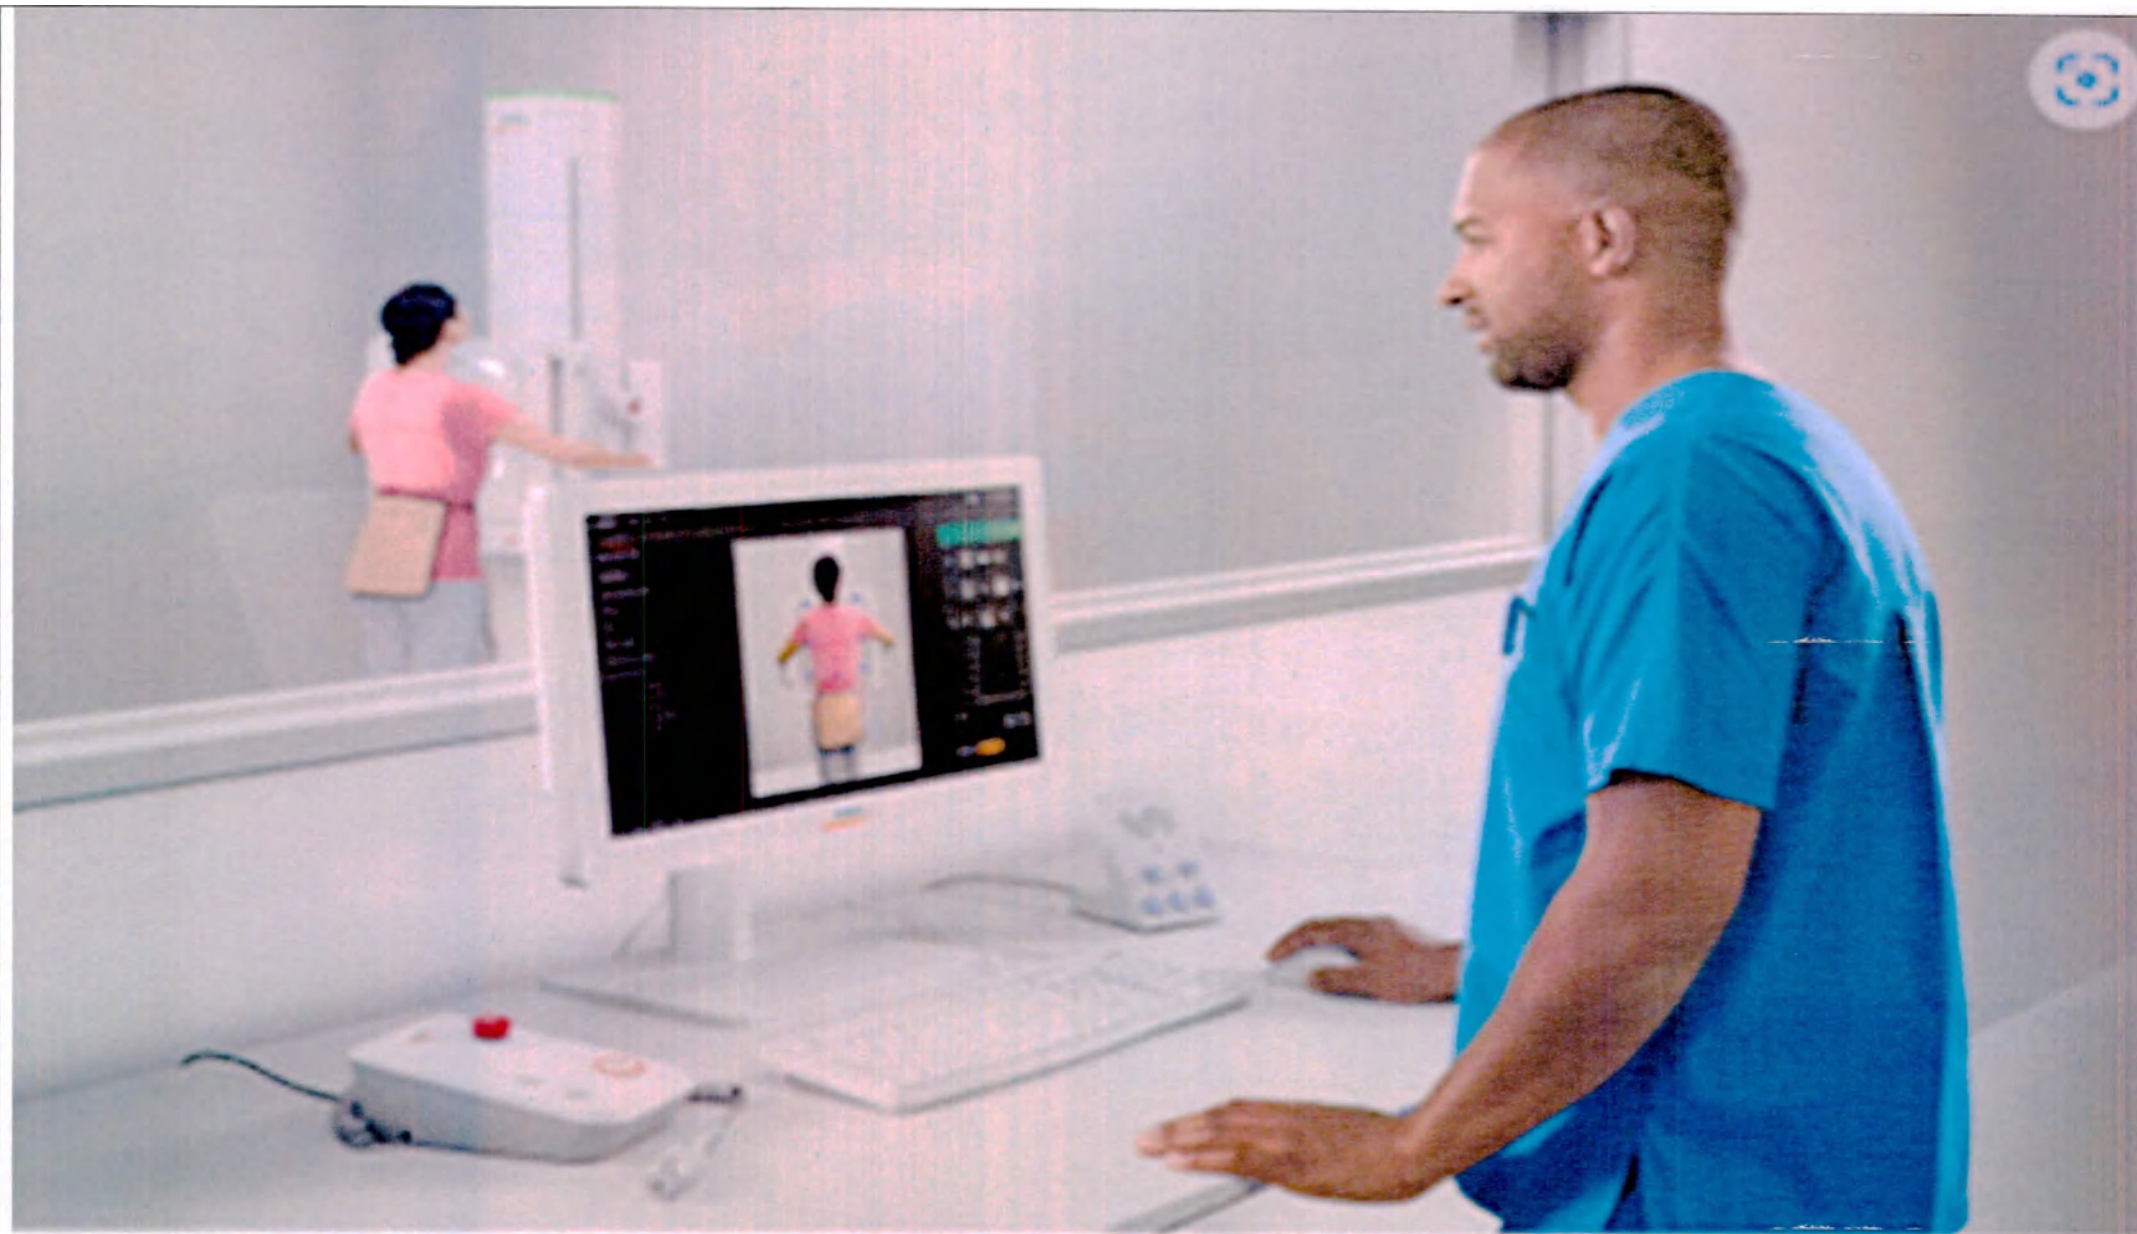


34. Программный режим автоматической коллимации грудной клетки

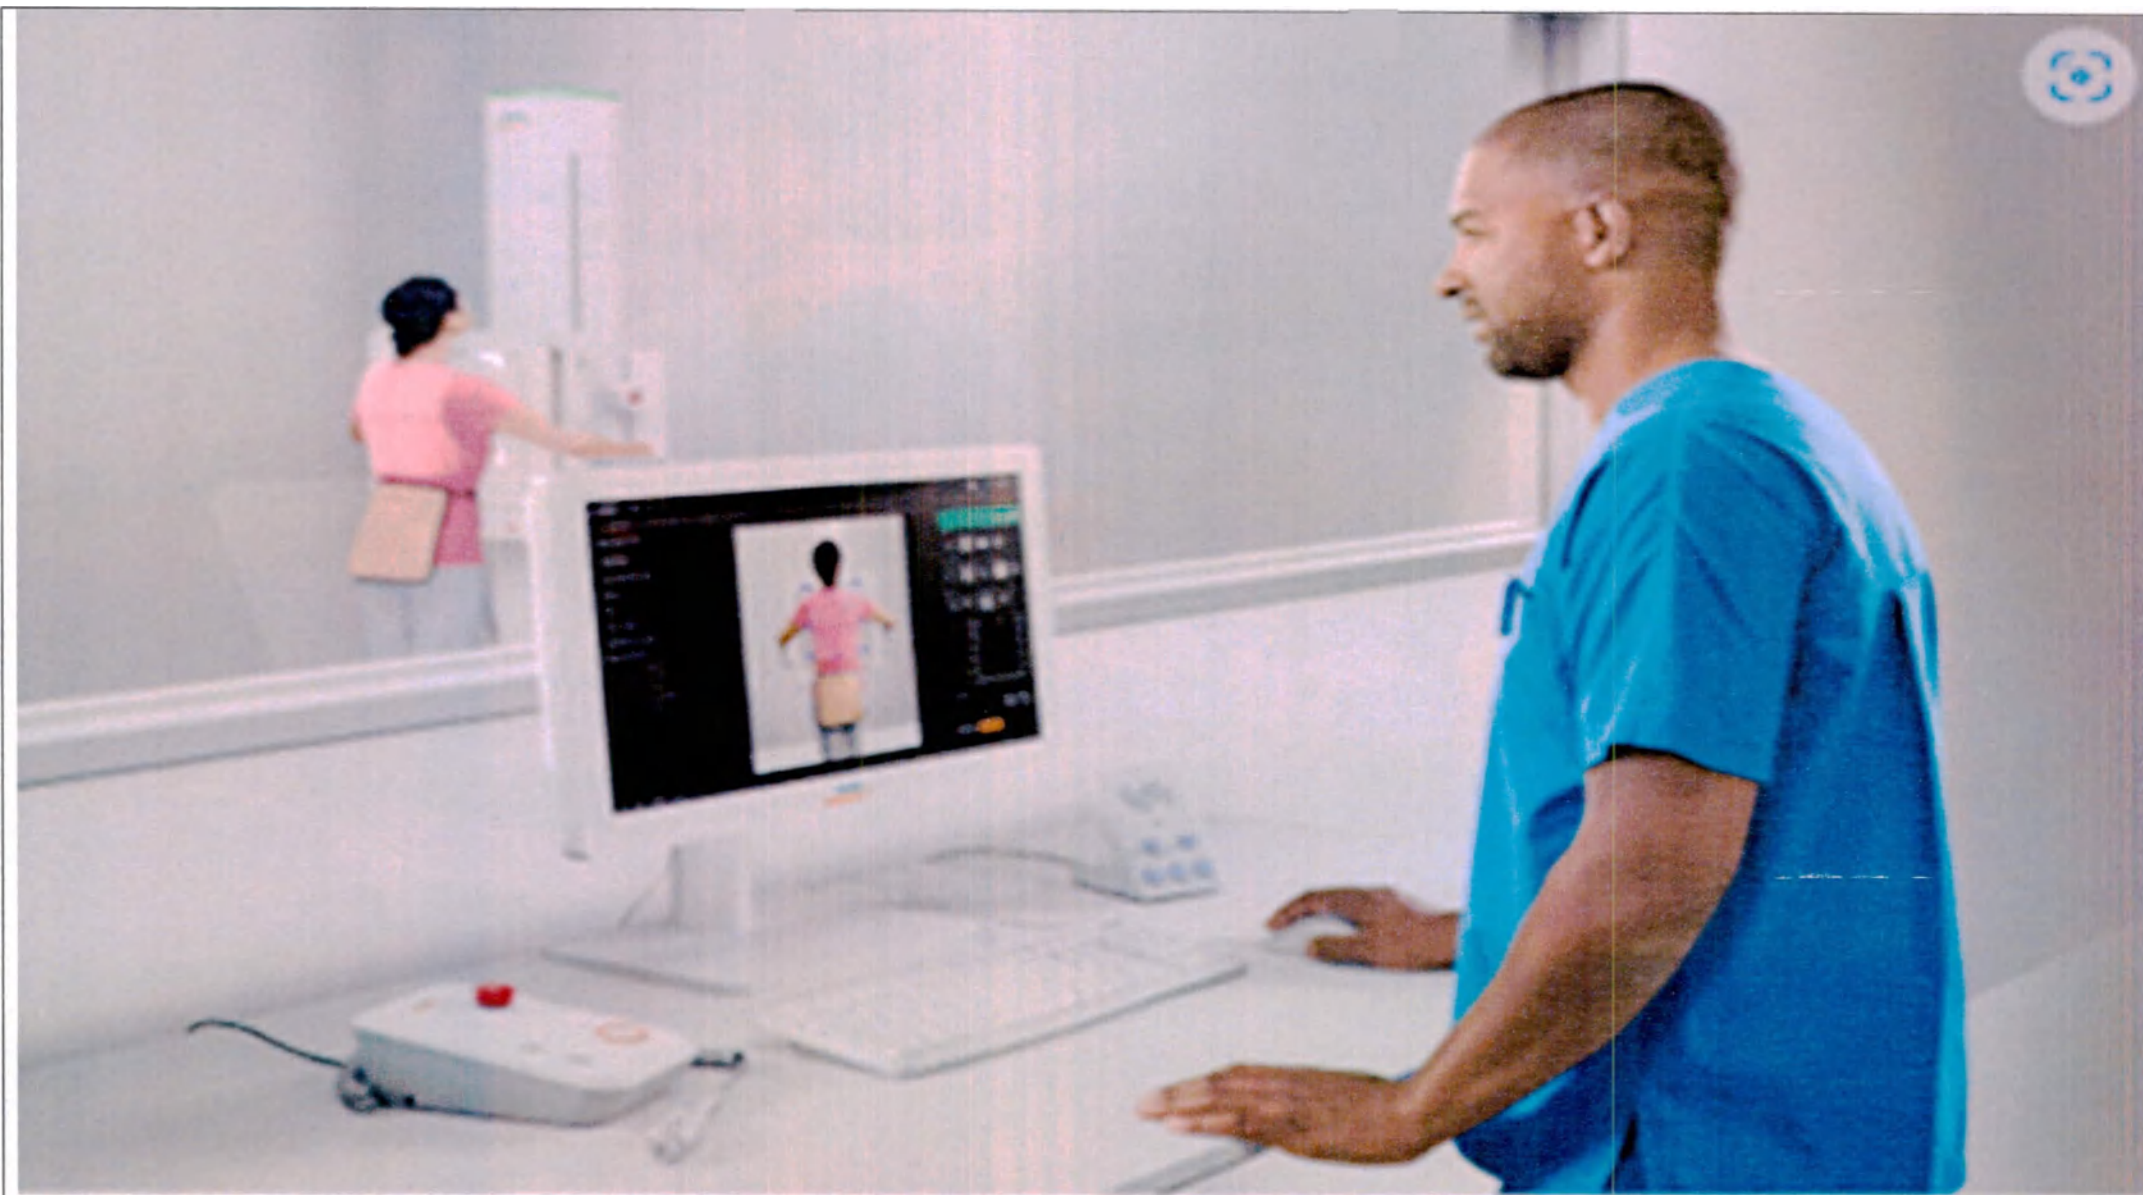

35. Лицензия временная на программный режим автоматической коллимации грудной клетки

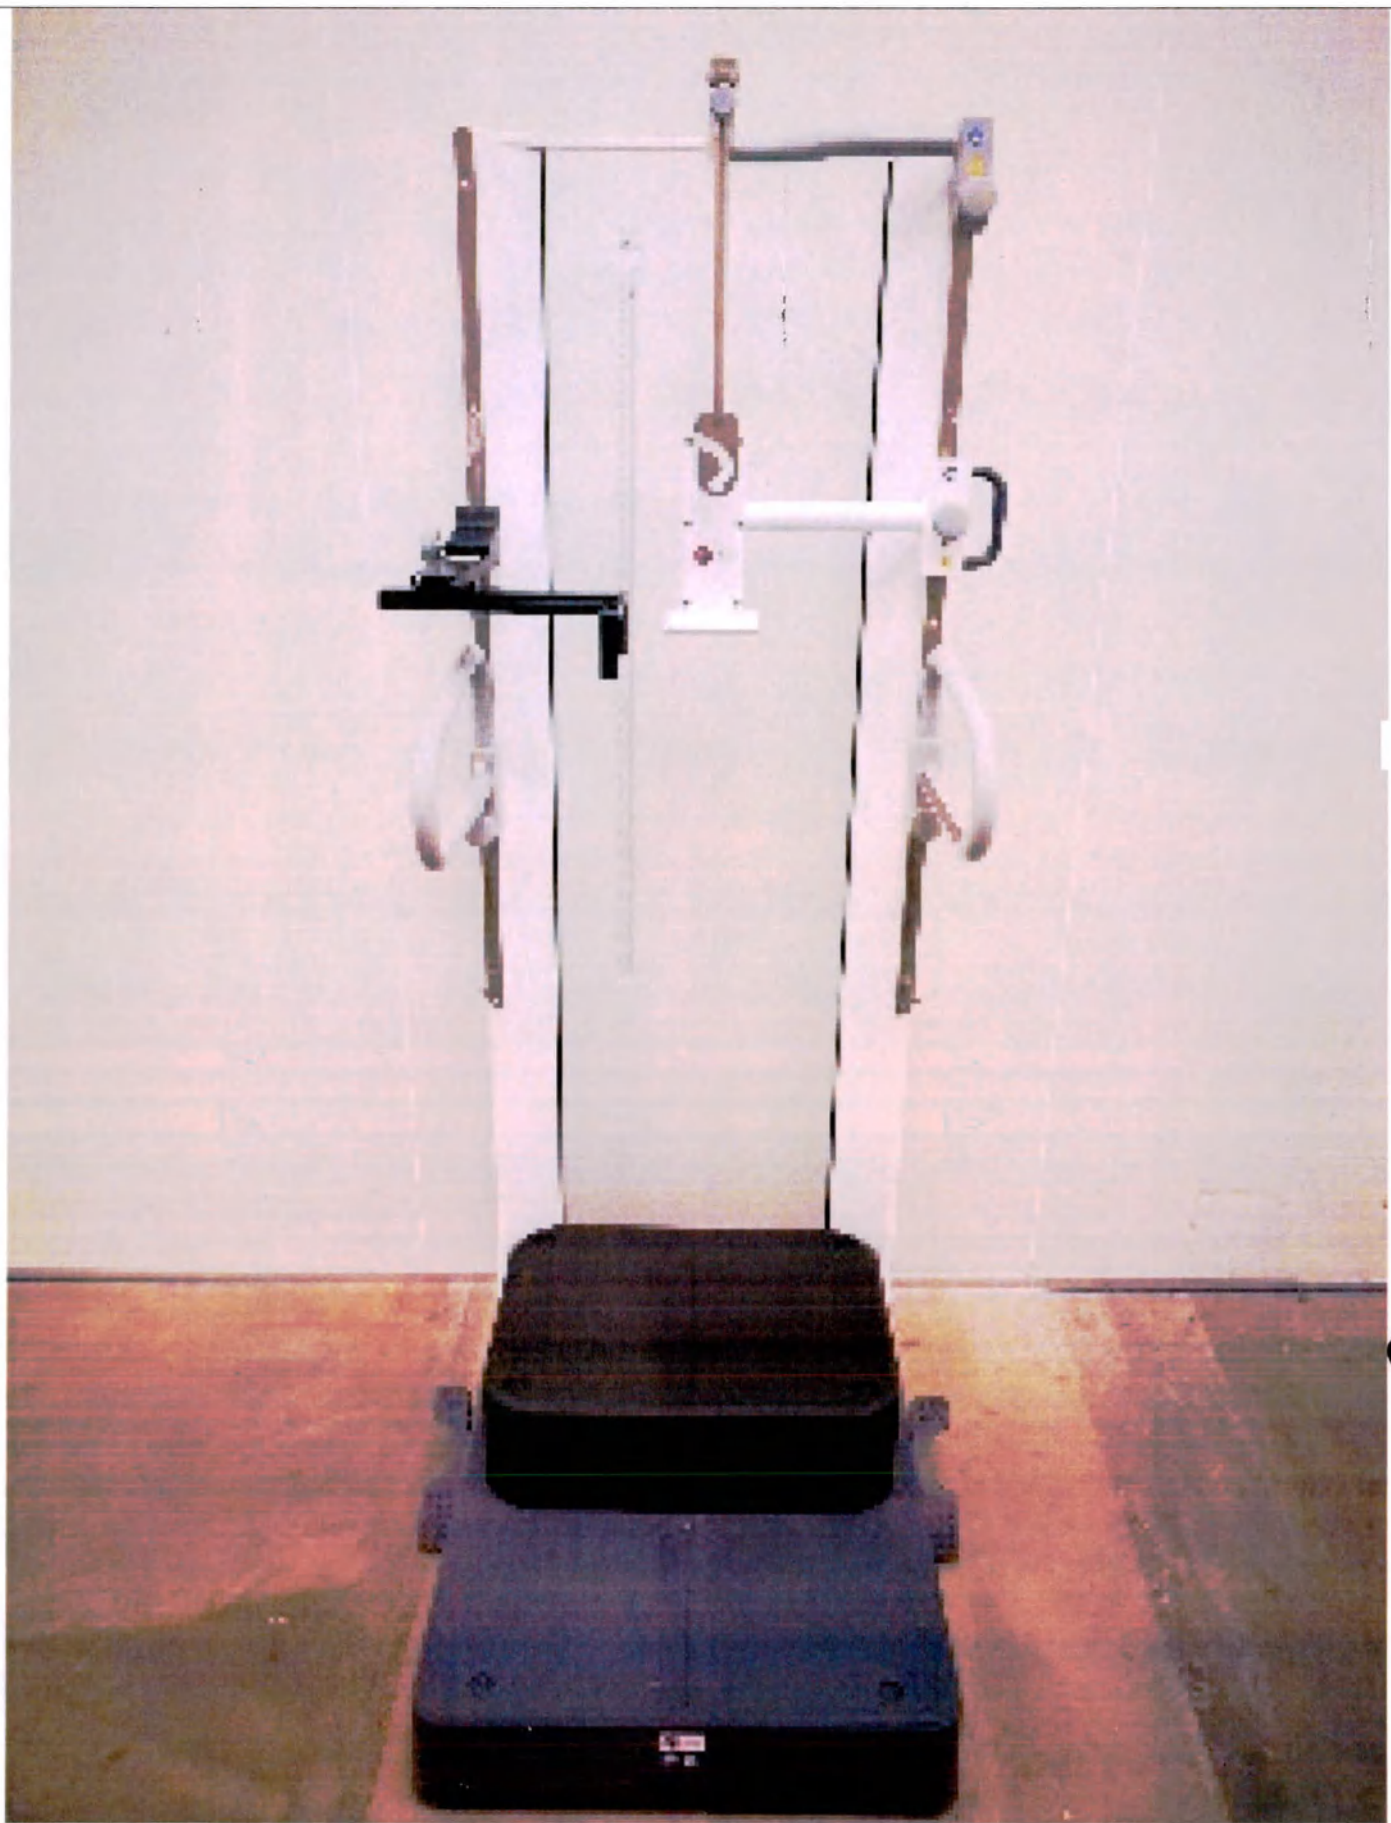


36. Универсальная стойка Ortho

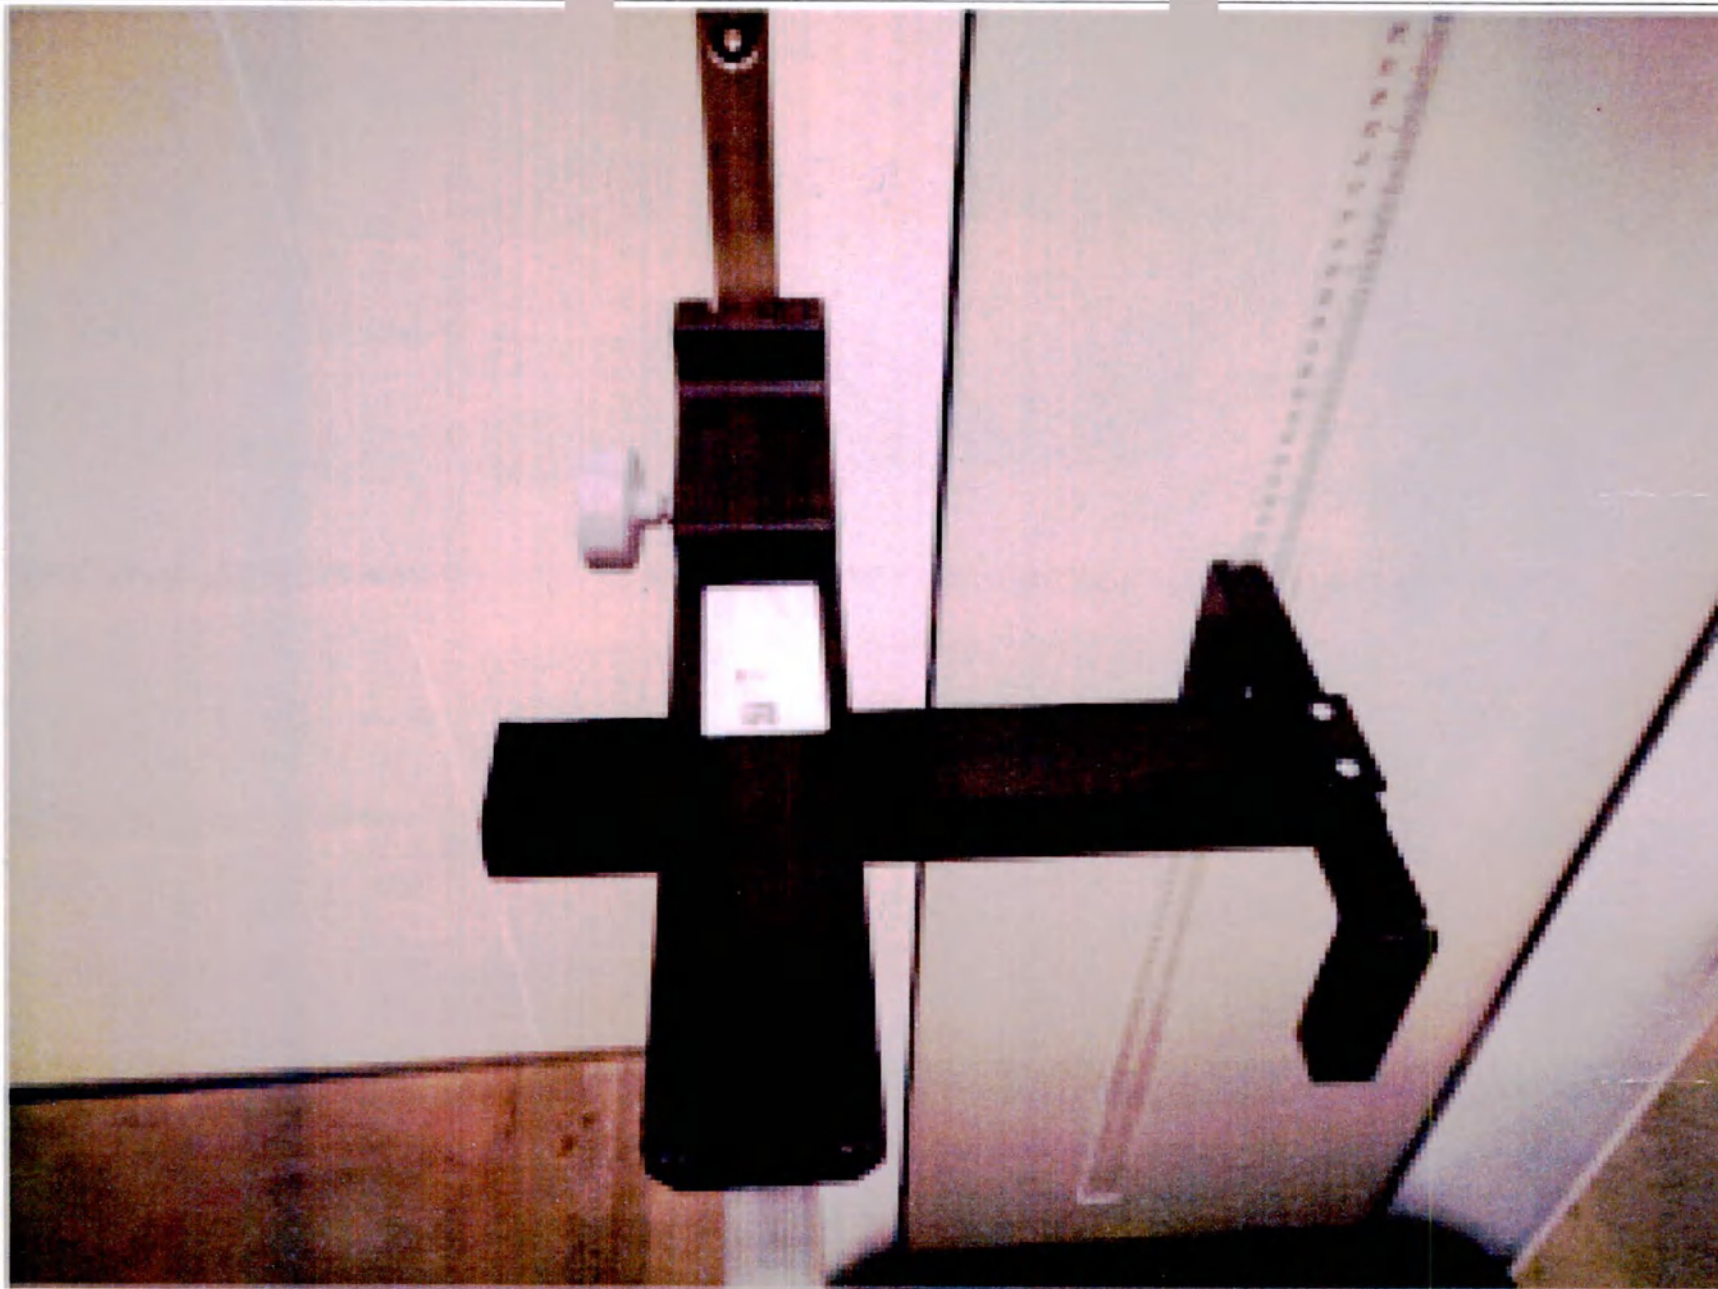


37. Линейка с держателем для универсальной стойки Ortho



38. Индикаторы светодиодные

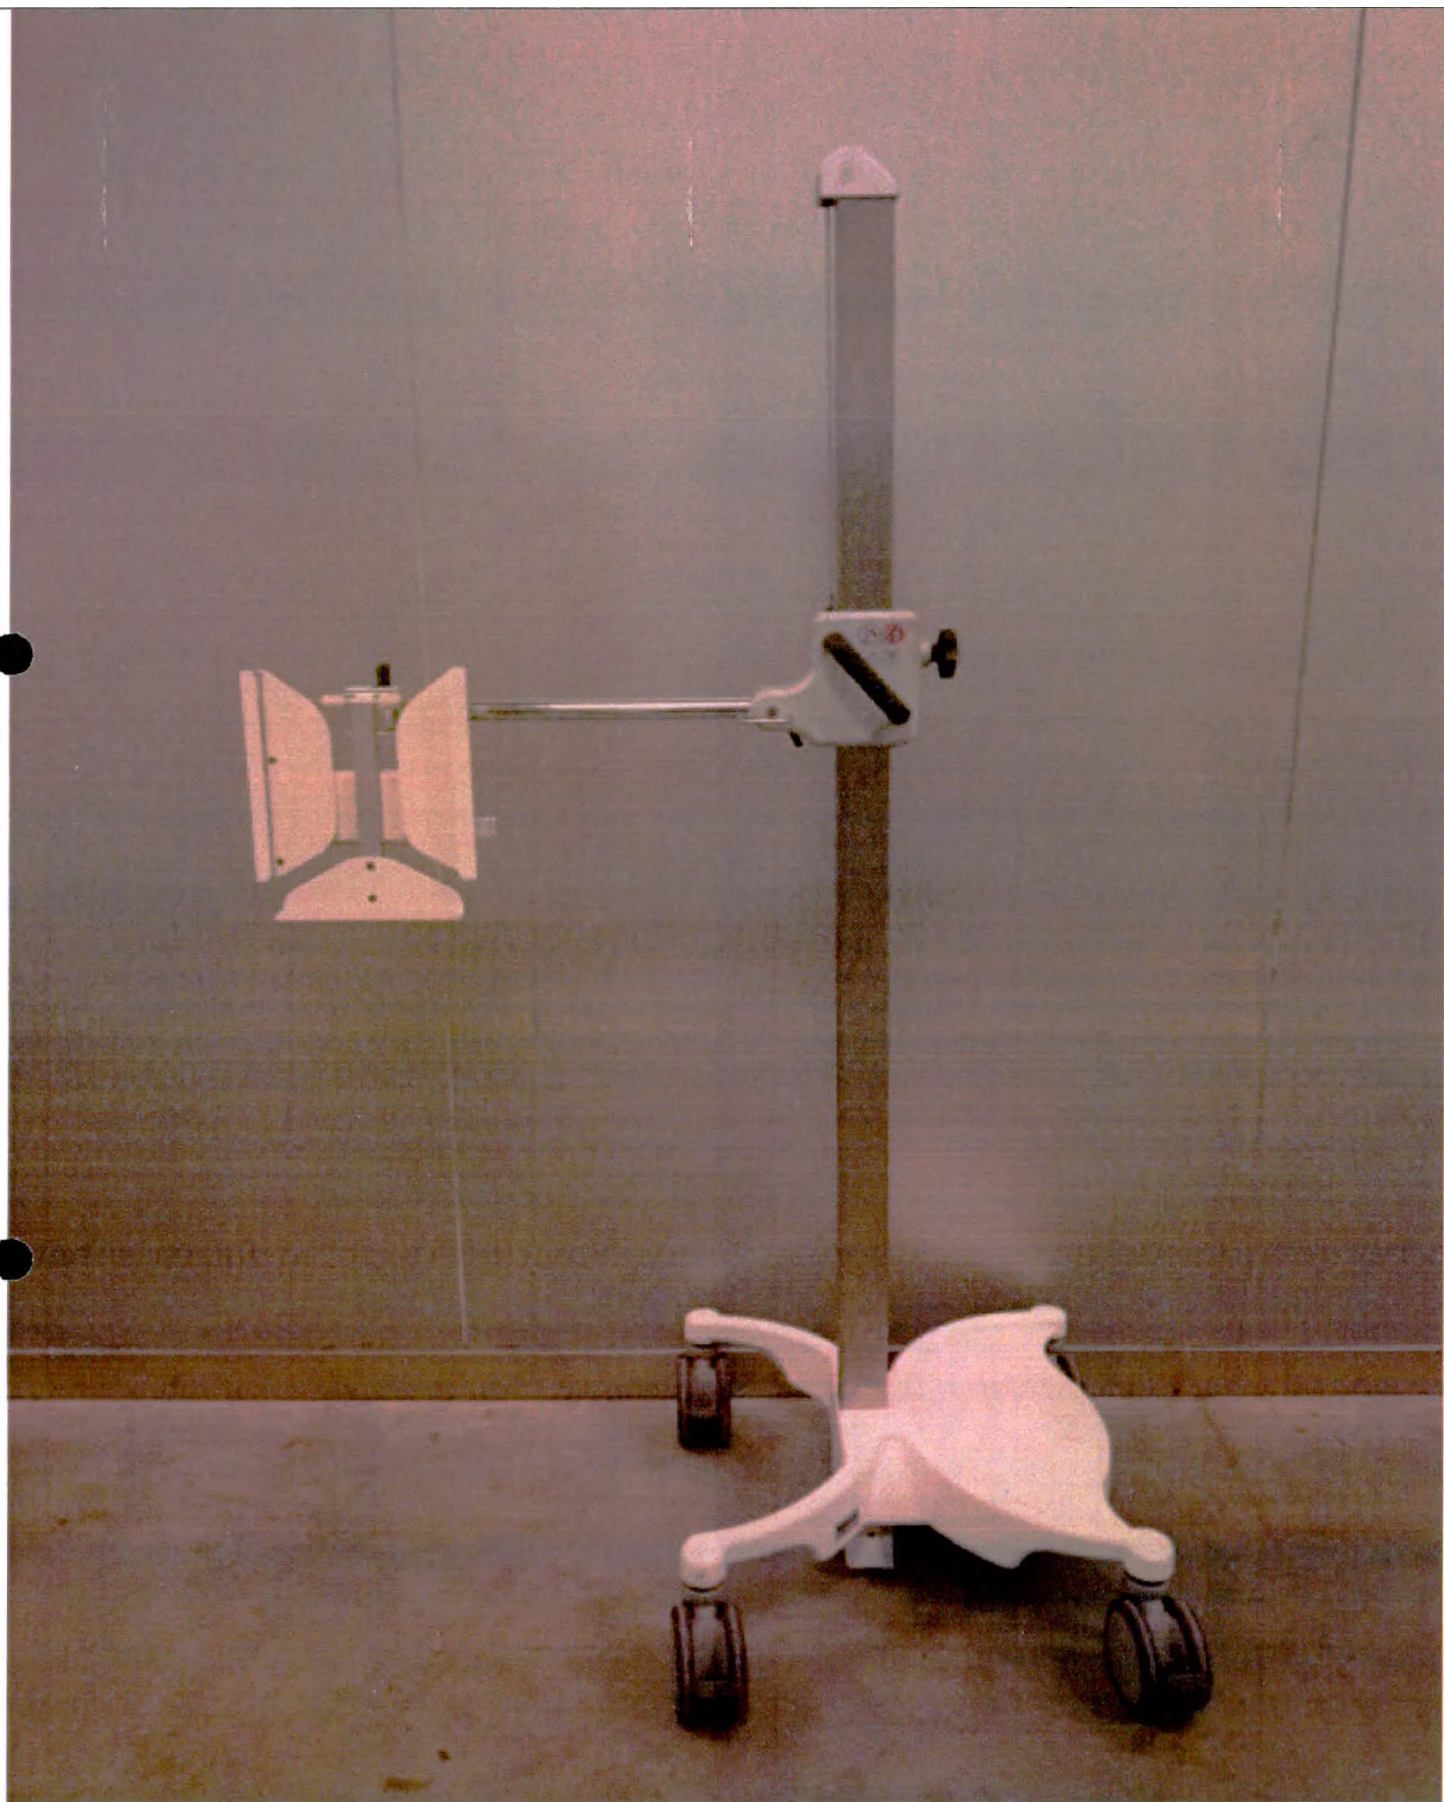


39. Держатель для детектора (мобильный)

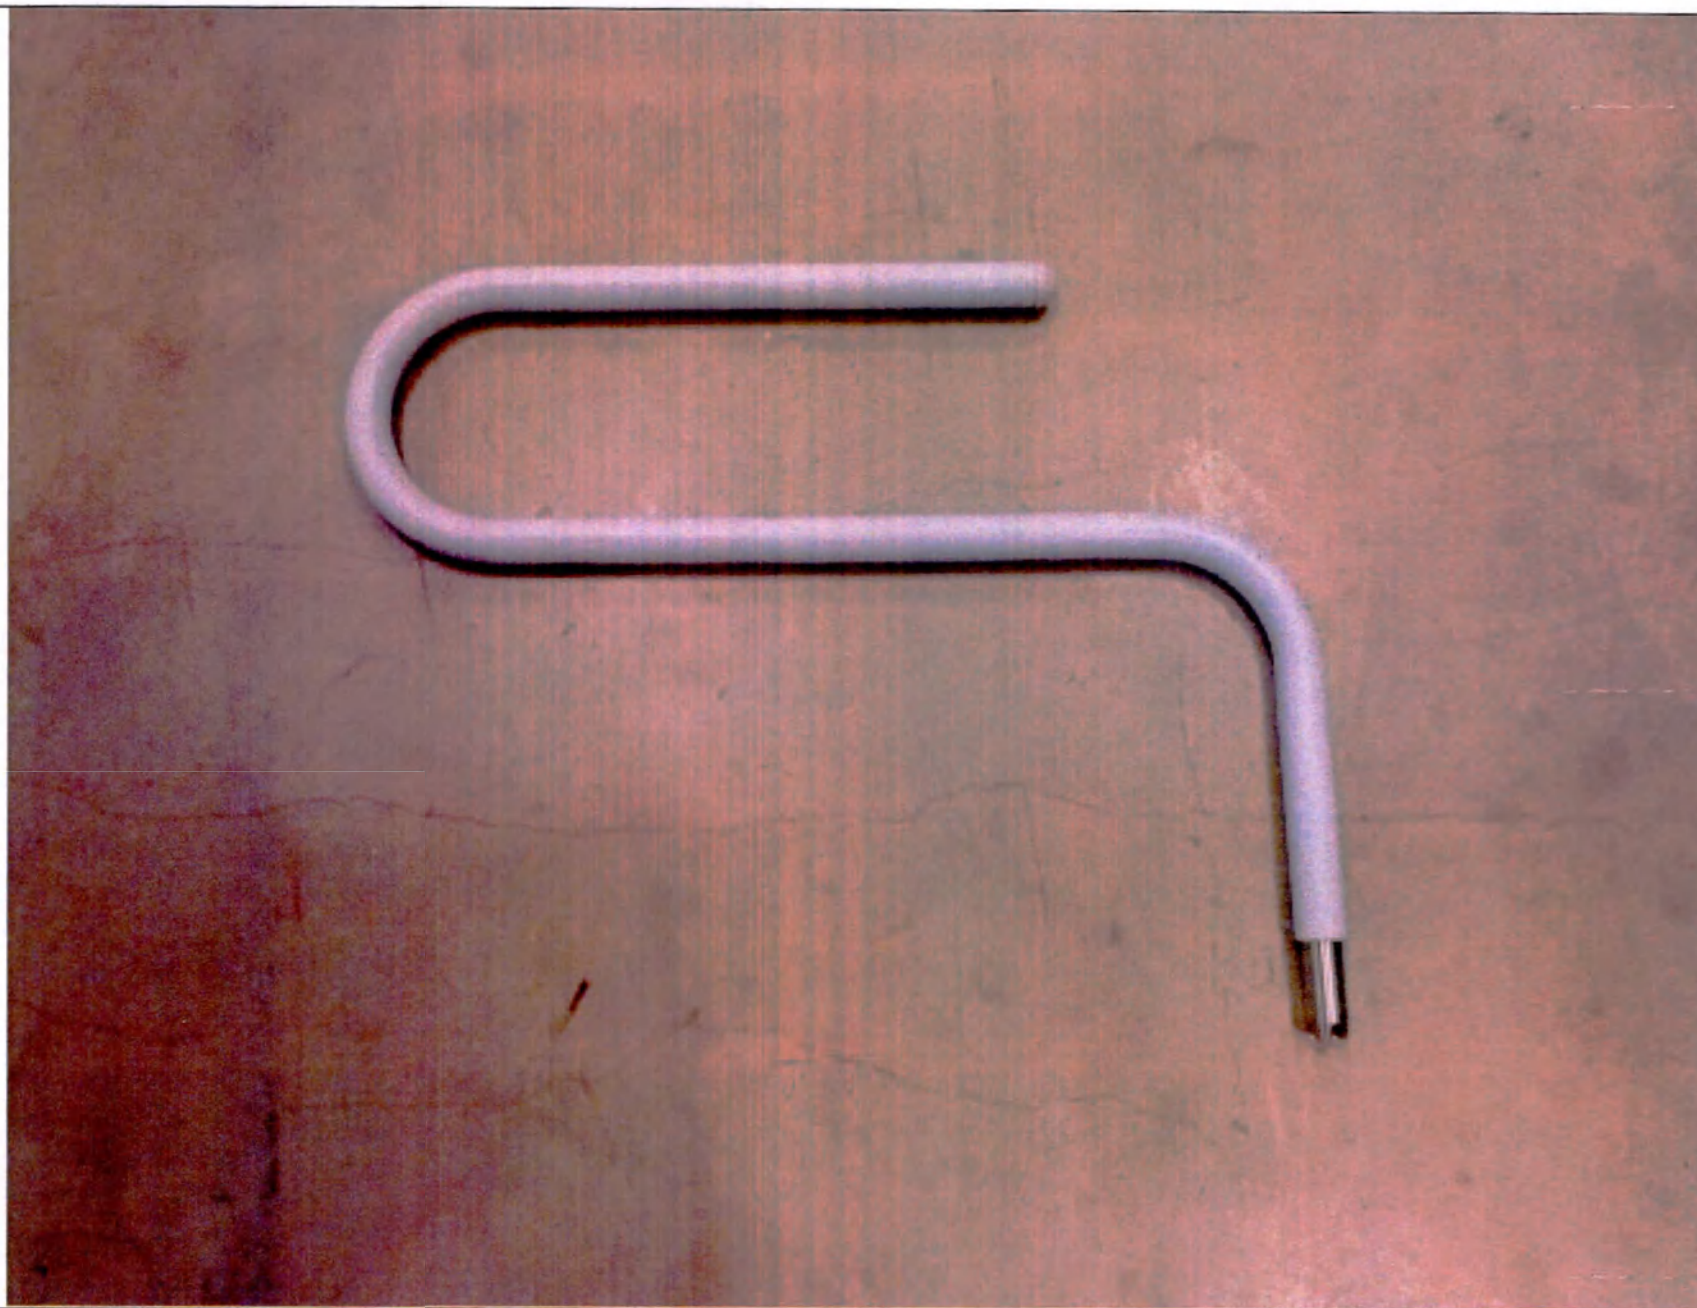

40. Ручки опорные для пациента




41. Держатель для детектора (боковой).

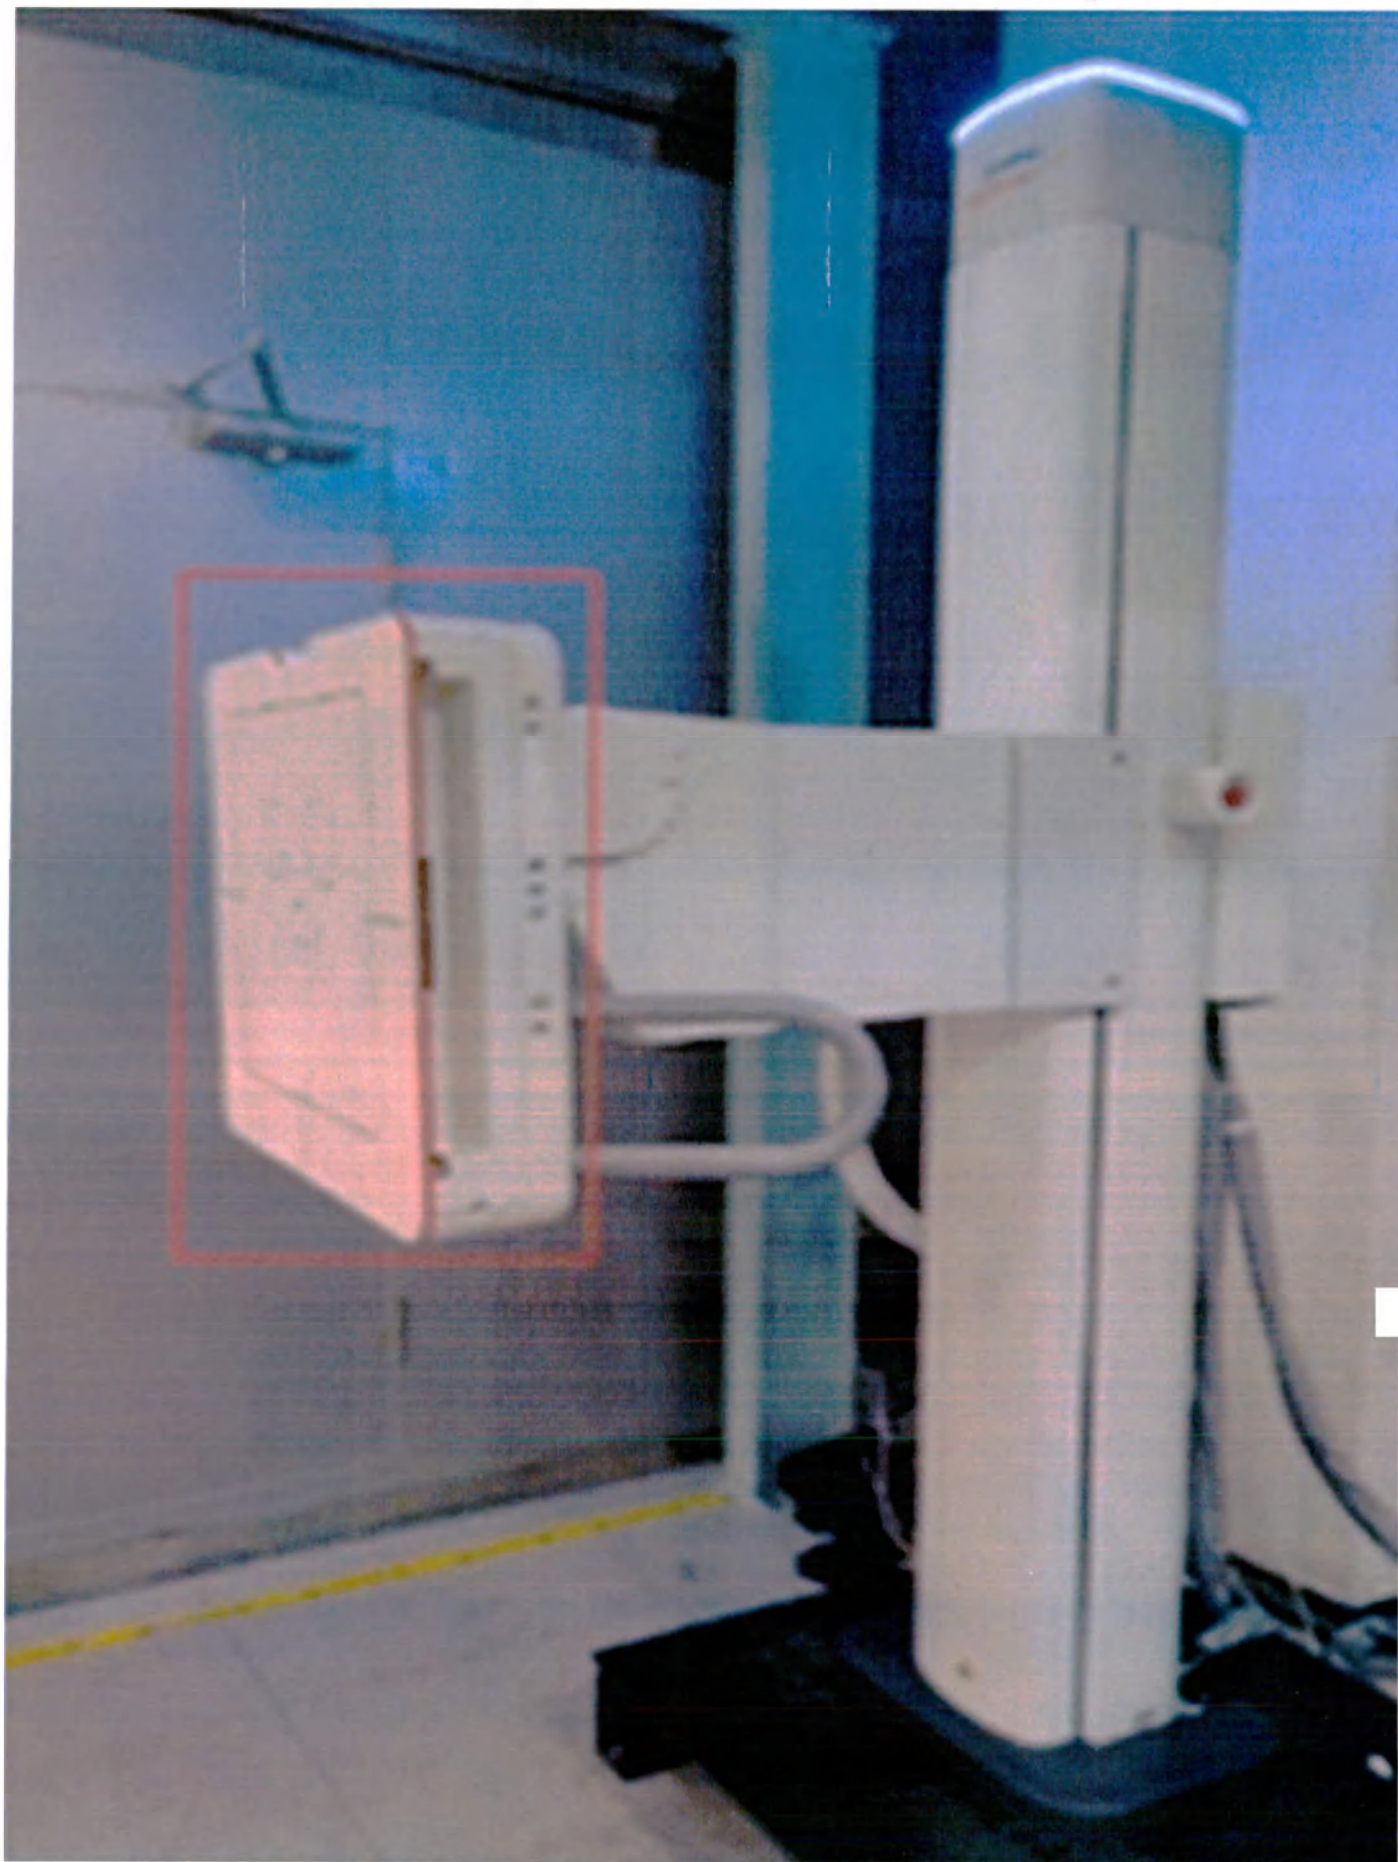

42.1 Комплект модернизации вертикальной стойки для Core XL для использования детектора Core Static, в составе:- Приемник с фиксированной решеткой;- Фронтальная панель приемника детектора; - Детектор Core Static;- Кабель питания;- Кабель Ethernet.



42.2 Комплект модернизации вертикальной стойки для Core XL для использования детектора Core Static, в составе:- Приемник с фиксированной решеткой;- Фронтальная панель приемника детектора; - **Детектор Core Static**;- Кабель питания;- Кабель Ethernet.

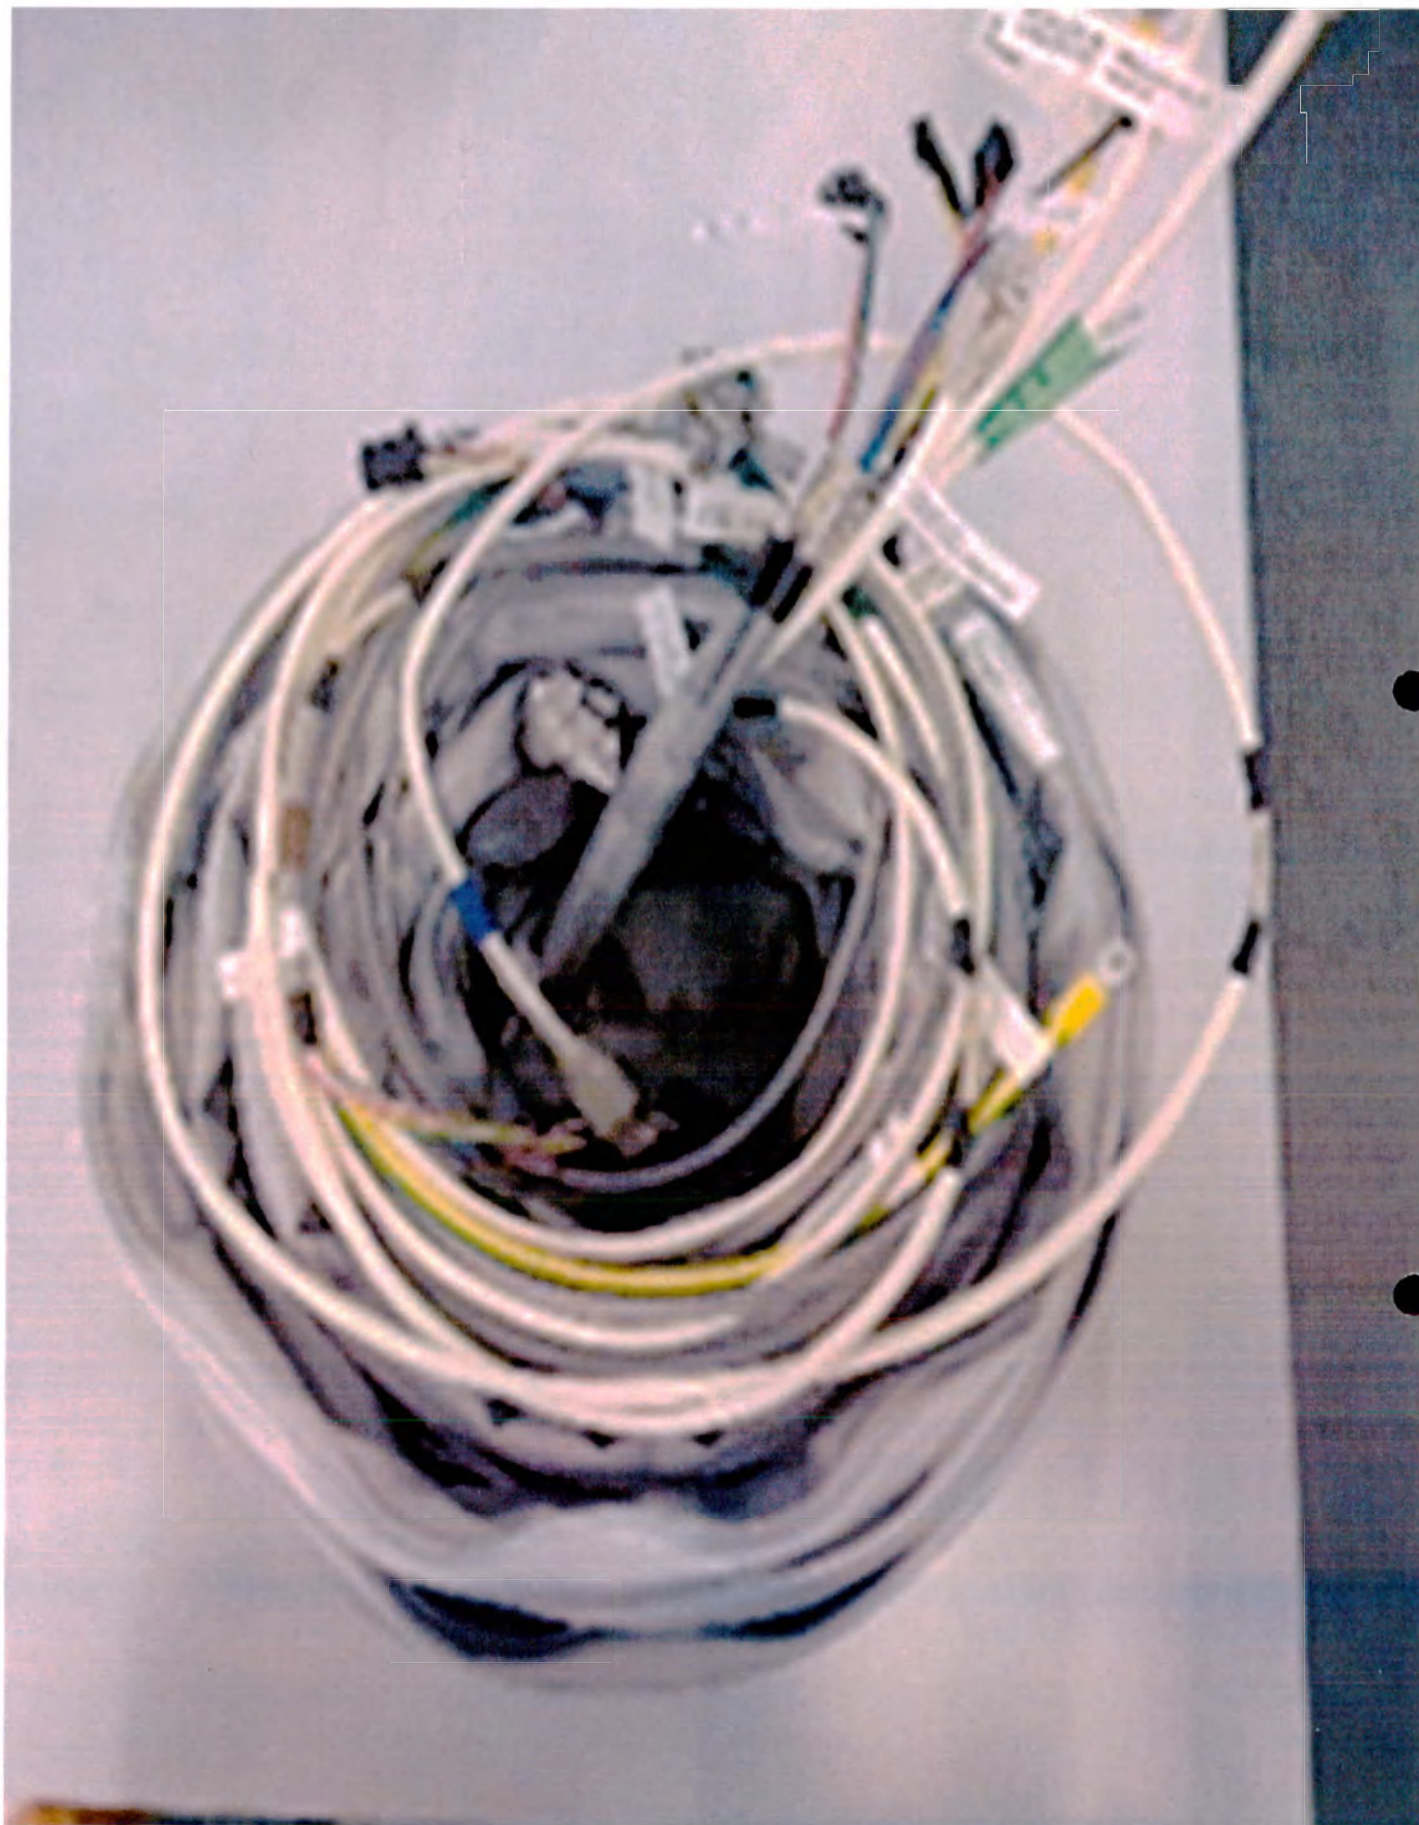


42.3 Комплект модернизации вертикальной стойки для Core XL для использования детектора Core Static, в составе:- Приемник с фиксированной решеткой;- Фронтальная панель приемника детектора;- Детектор Core Static;- **Кабель питания**;- Кабель Ethernet




42.4 Комплект модернизации вертикальной стойки для Core XL для использования детектора Core Static, в составе:- Приемник с фиксированной решеткой;- Фронтальная панель приемника детектора;- Детектор Core Static;- Кабель питания;- Кабель Ethernet



43.1 Комплект модернизации вертикальной стойки для MAX wi-D для использования детектора Core Static, в составе:- Приемник с фиксированной решеткой;- Фронтальная панель приемника детектора; - Детектор Core Static;- Кабель питания;- Кабель Ethernet;- Блок питания для детектора Core Static.

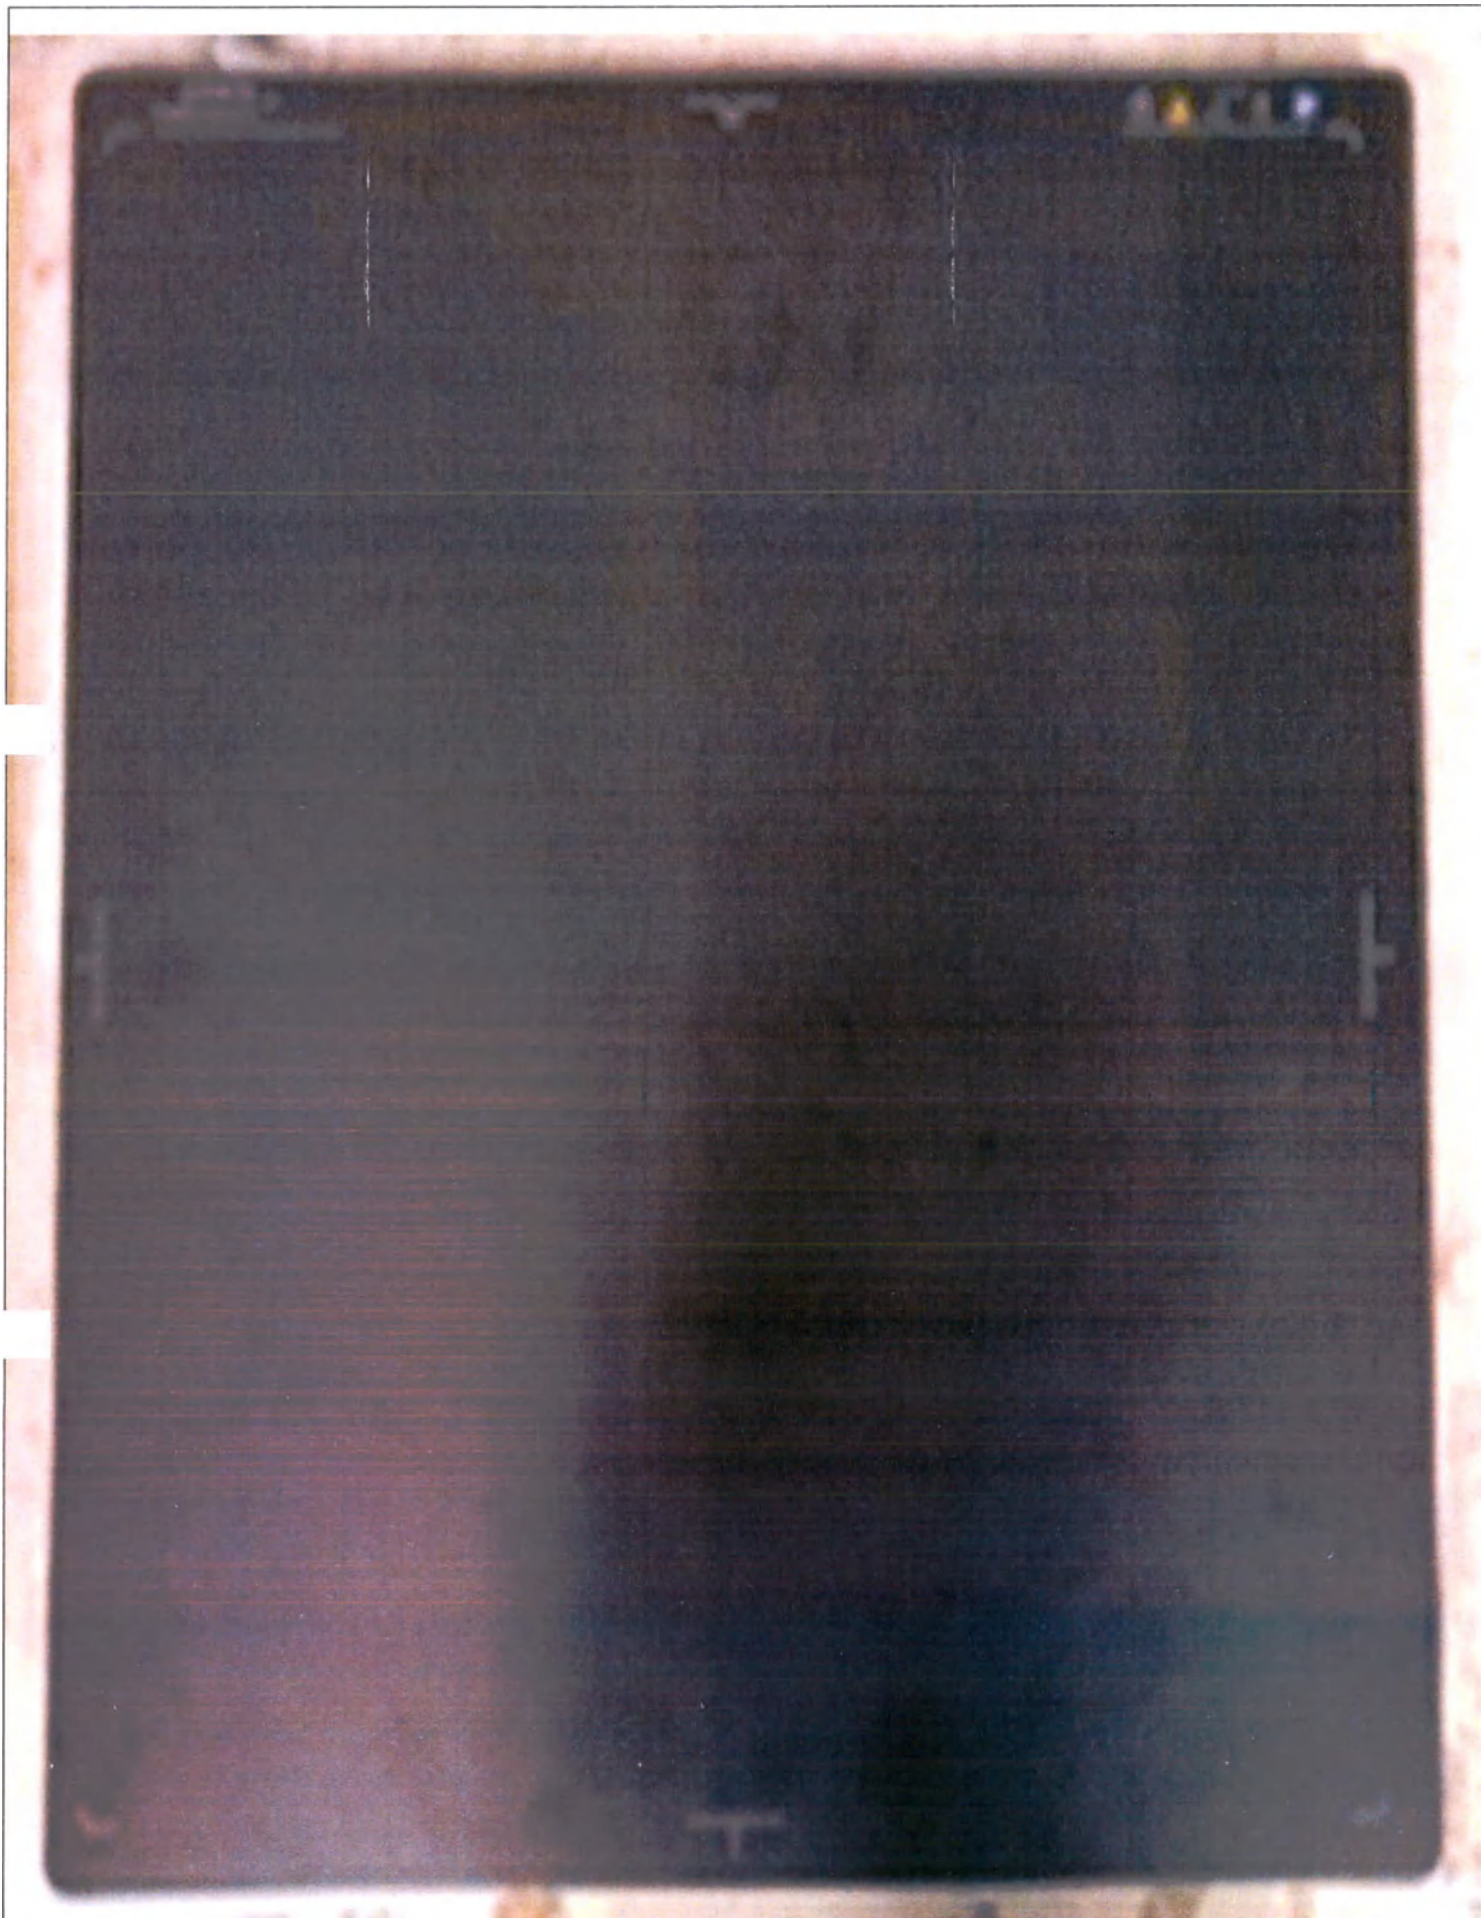


43.2 Комплект модернизации вертикальной стойки для MAX wi-D для использования детектора Core Static, в составе:- Приемник с фиксированной решеткой;- Фронтальная панель приемника детектора; -Детектор Core Static;- Кабель питания;- Кабель Ethernet;- Блок питания для детектора Core Static.

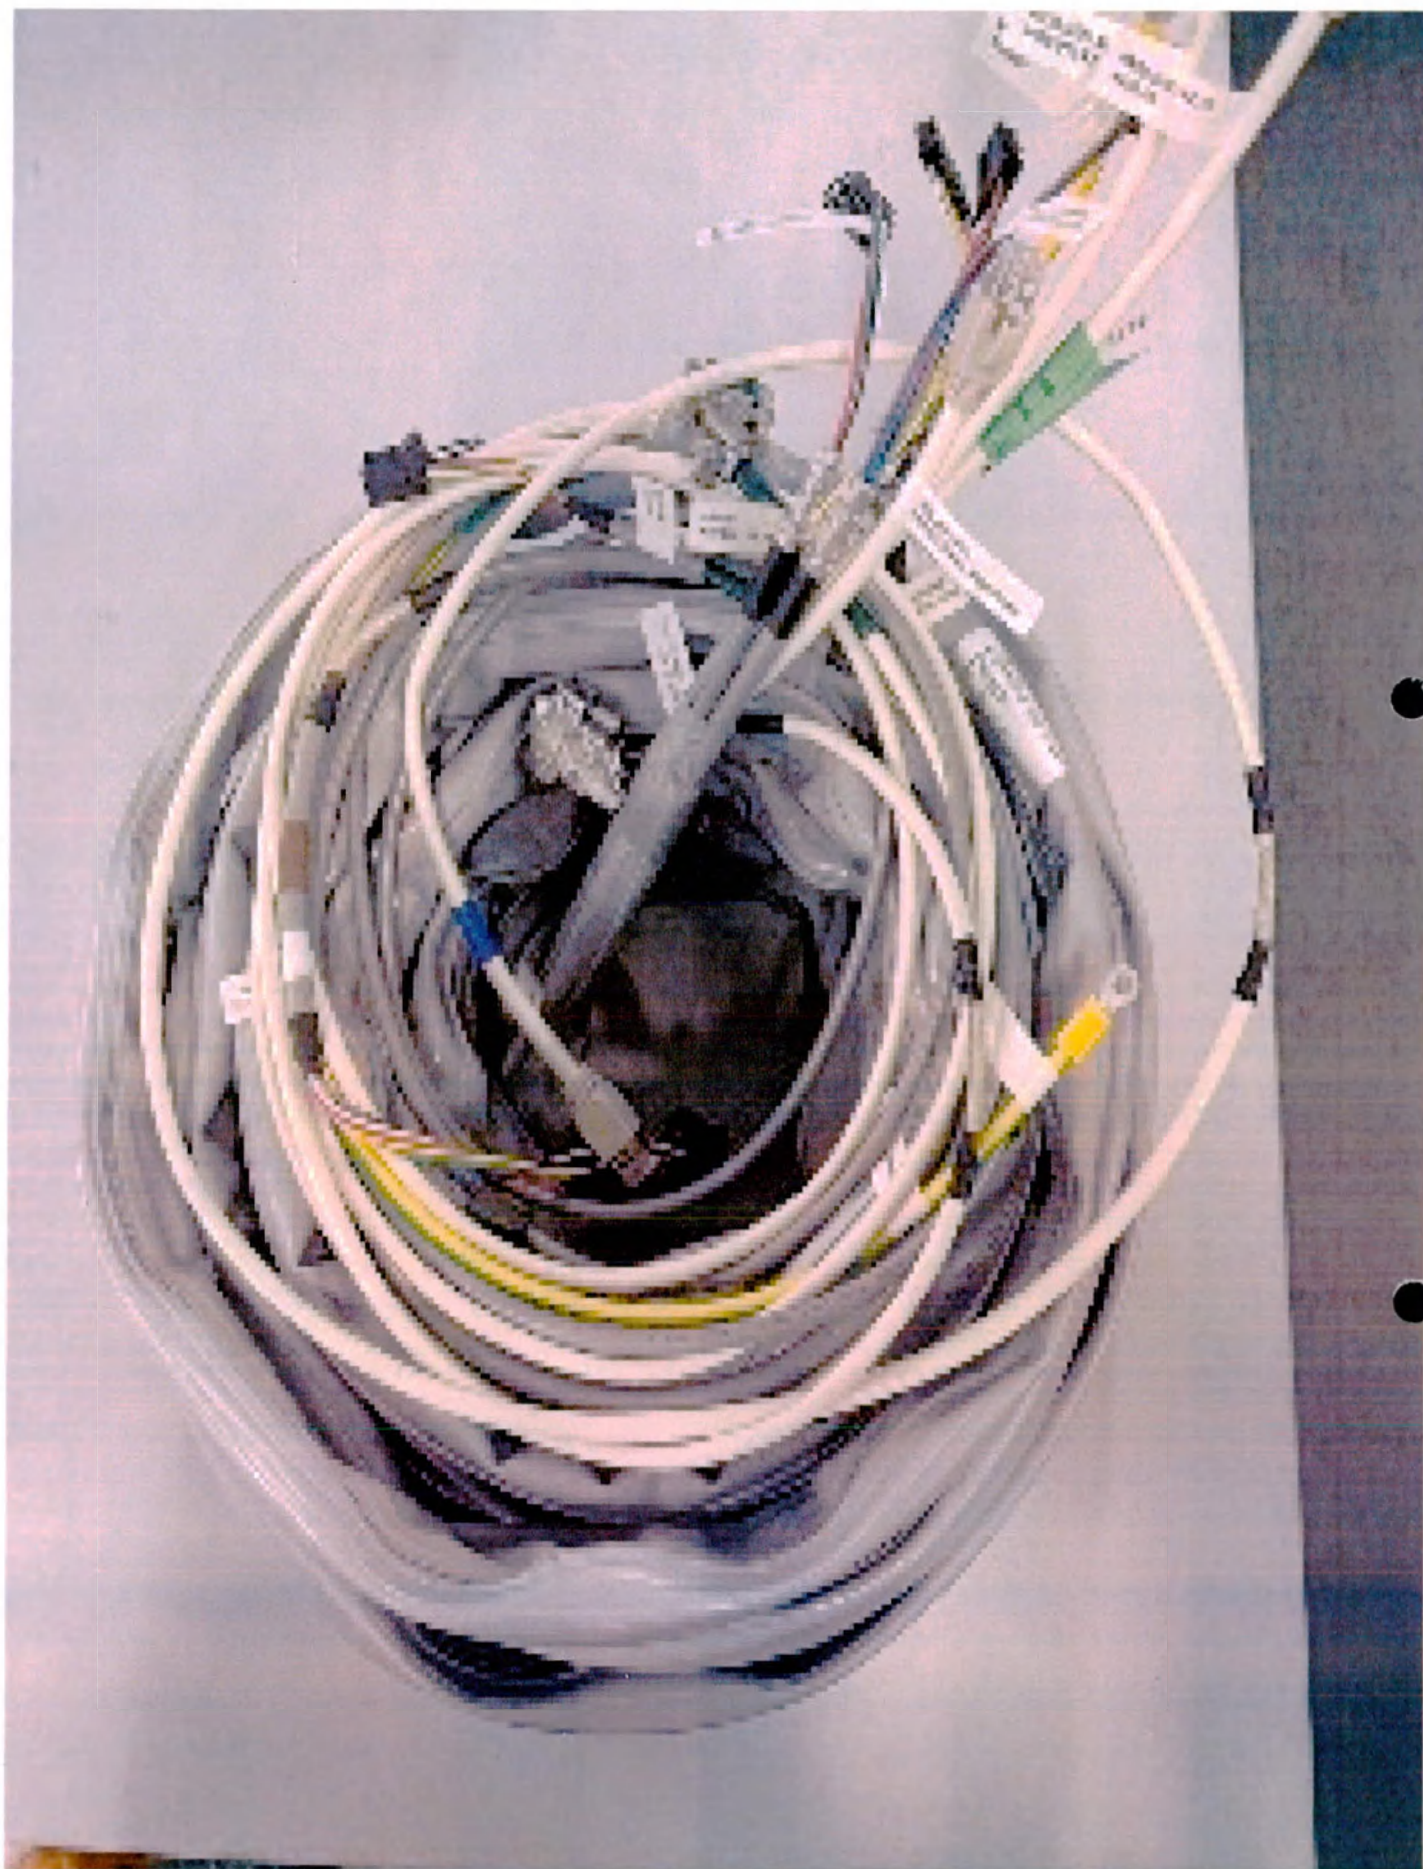


43.3 Комплект модернизации вертикальной стойки для MAX wi-D для использования детектора Core Static, в составе:- Приемник с фиксированной решеткой;- Фронтальная панель приемника детектора; -Детектор Core Static;- **Кабель питания**;- Кабель Ethernet;- Блок питания для детектора Core Static.



43.4 Комплект модернизации вертикальной стойки для MAX wi-D для использования детектора Core Static, в составе:- Приемник с фиксированной решеткой;- Фронтальная панель приемника детектора; -Детектор Core Static;- Кабель питания;- **Кабель Ethernet**;- Блок питания для детектора Core Static.

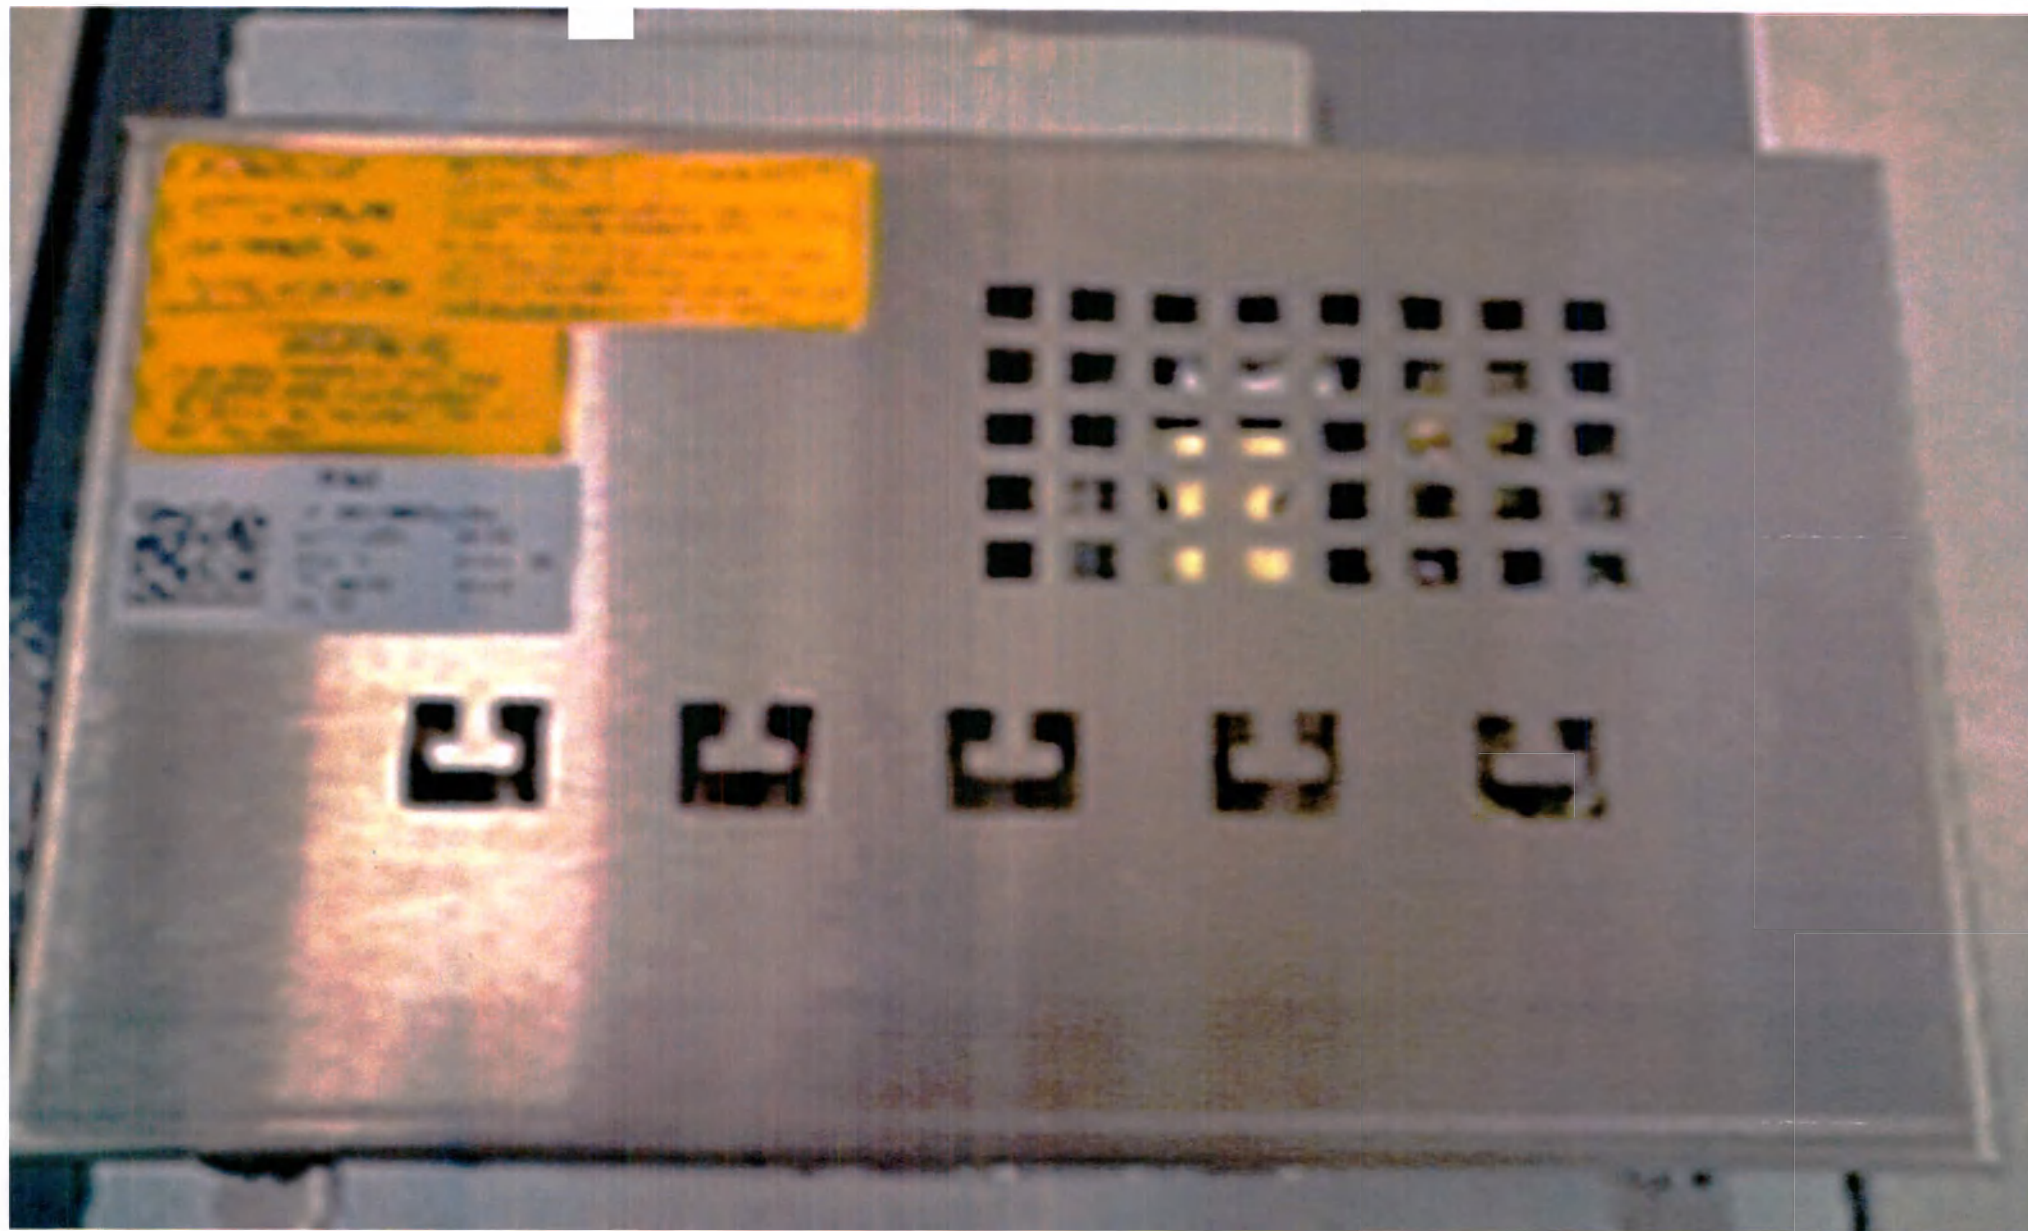


43.5 Комплект модернизации вертикальной стойки для MAX wi-D для использования детектора Core Static, в составе:- Приемник с фиксированной решеткой;- Фронтальная панель приемника детектора; -Детектор Core Static;- Кабель питания;- Кабель Ethernet;- **Блок питания для детектора Core Static.**

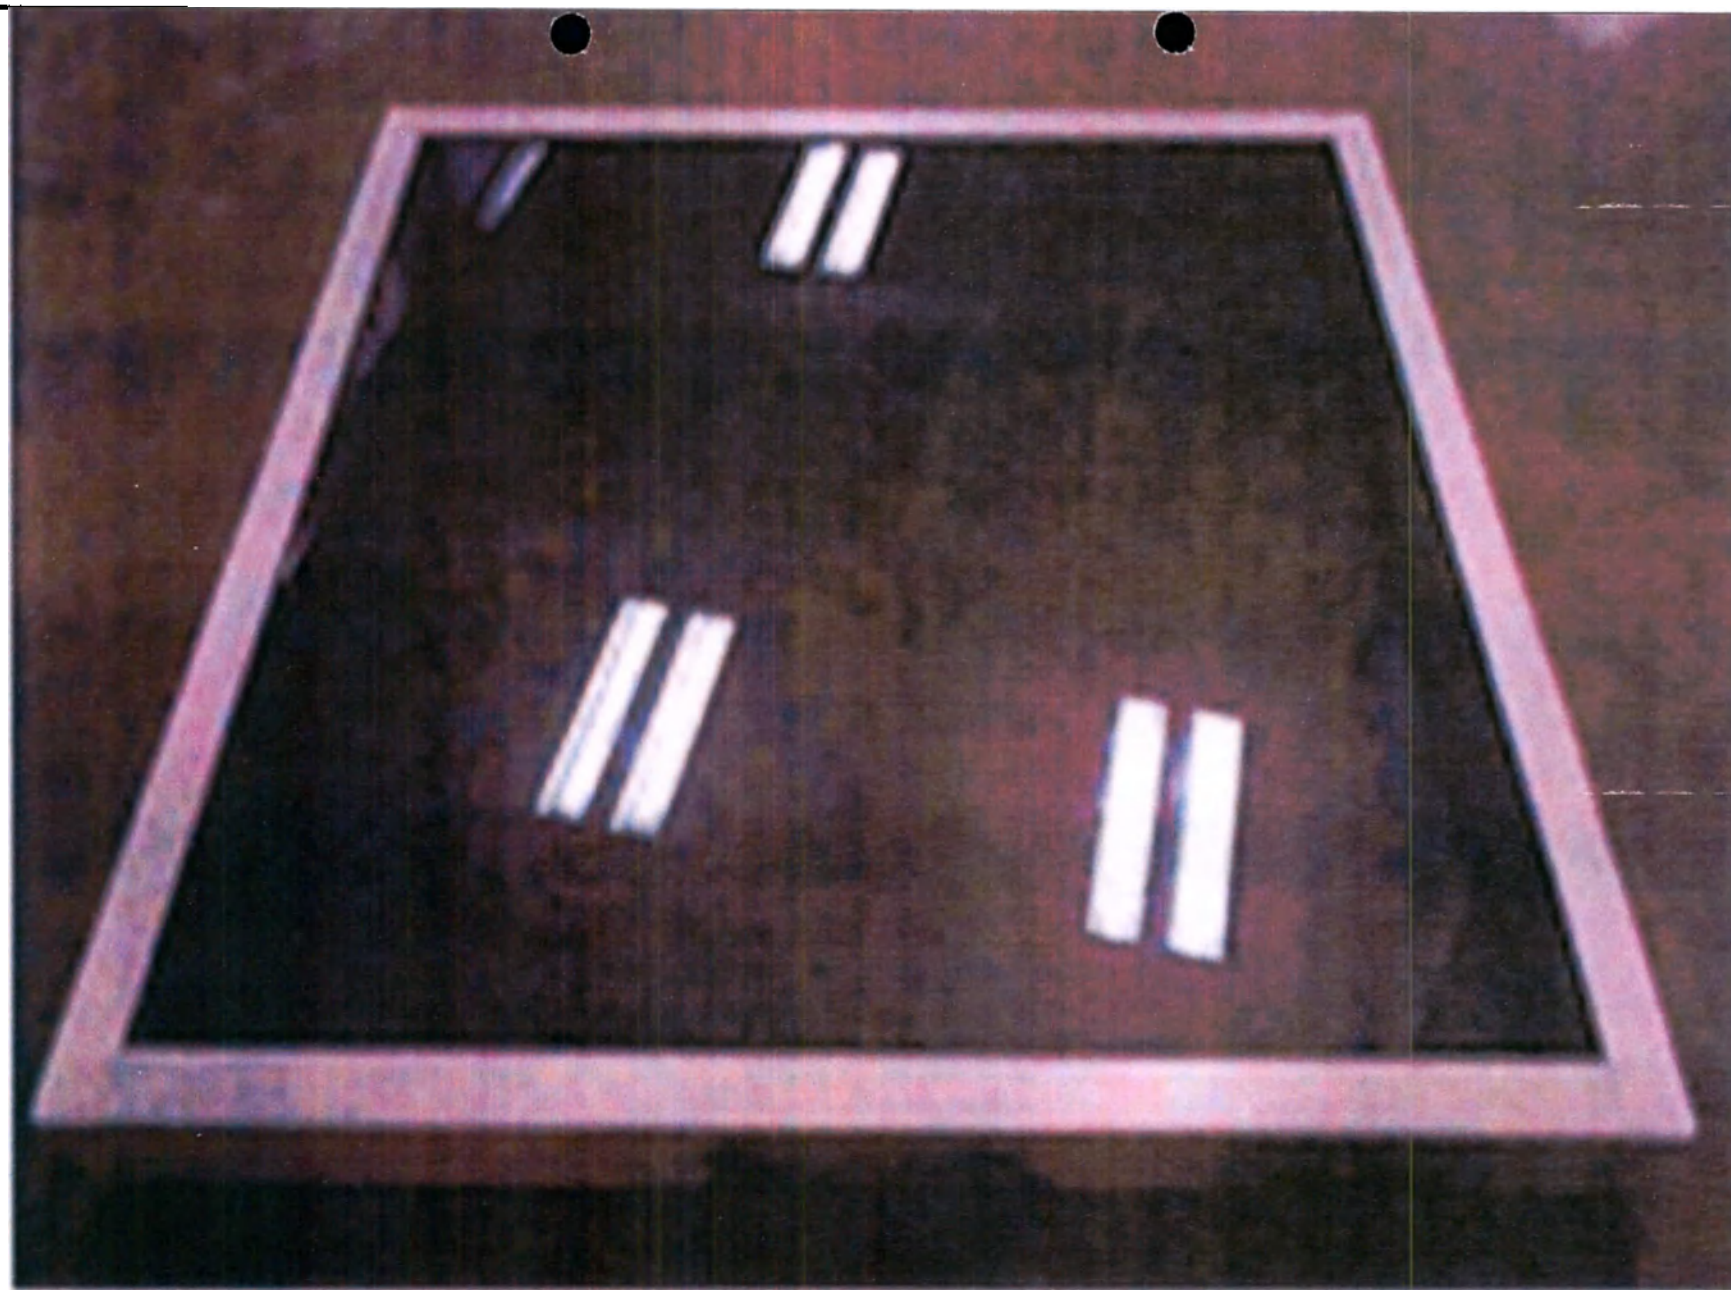


44. Защитная панель для детектора Core XL.




45. Сканер штрих – кода.

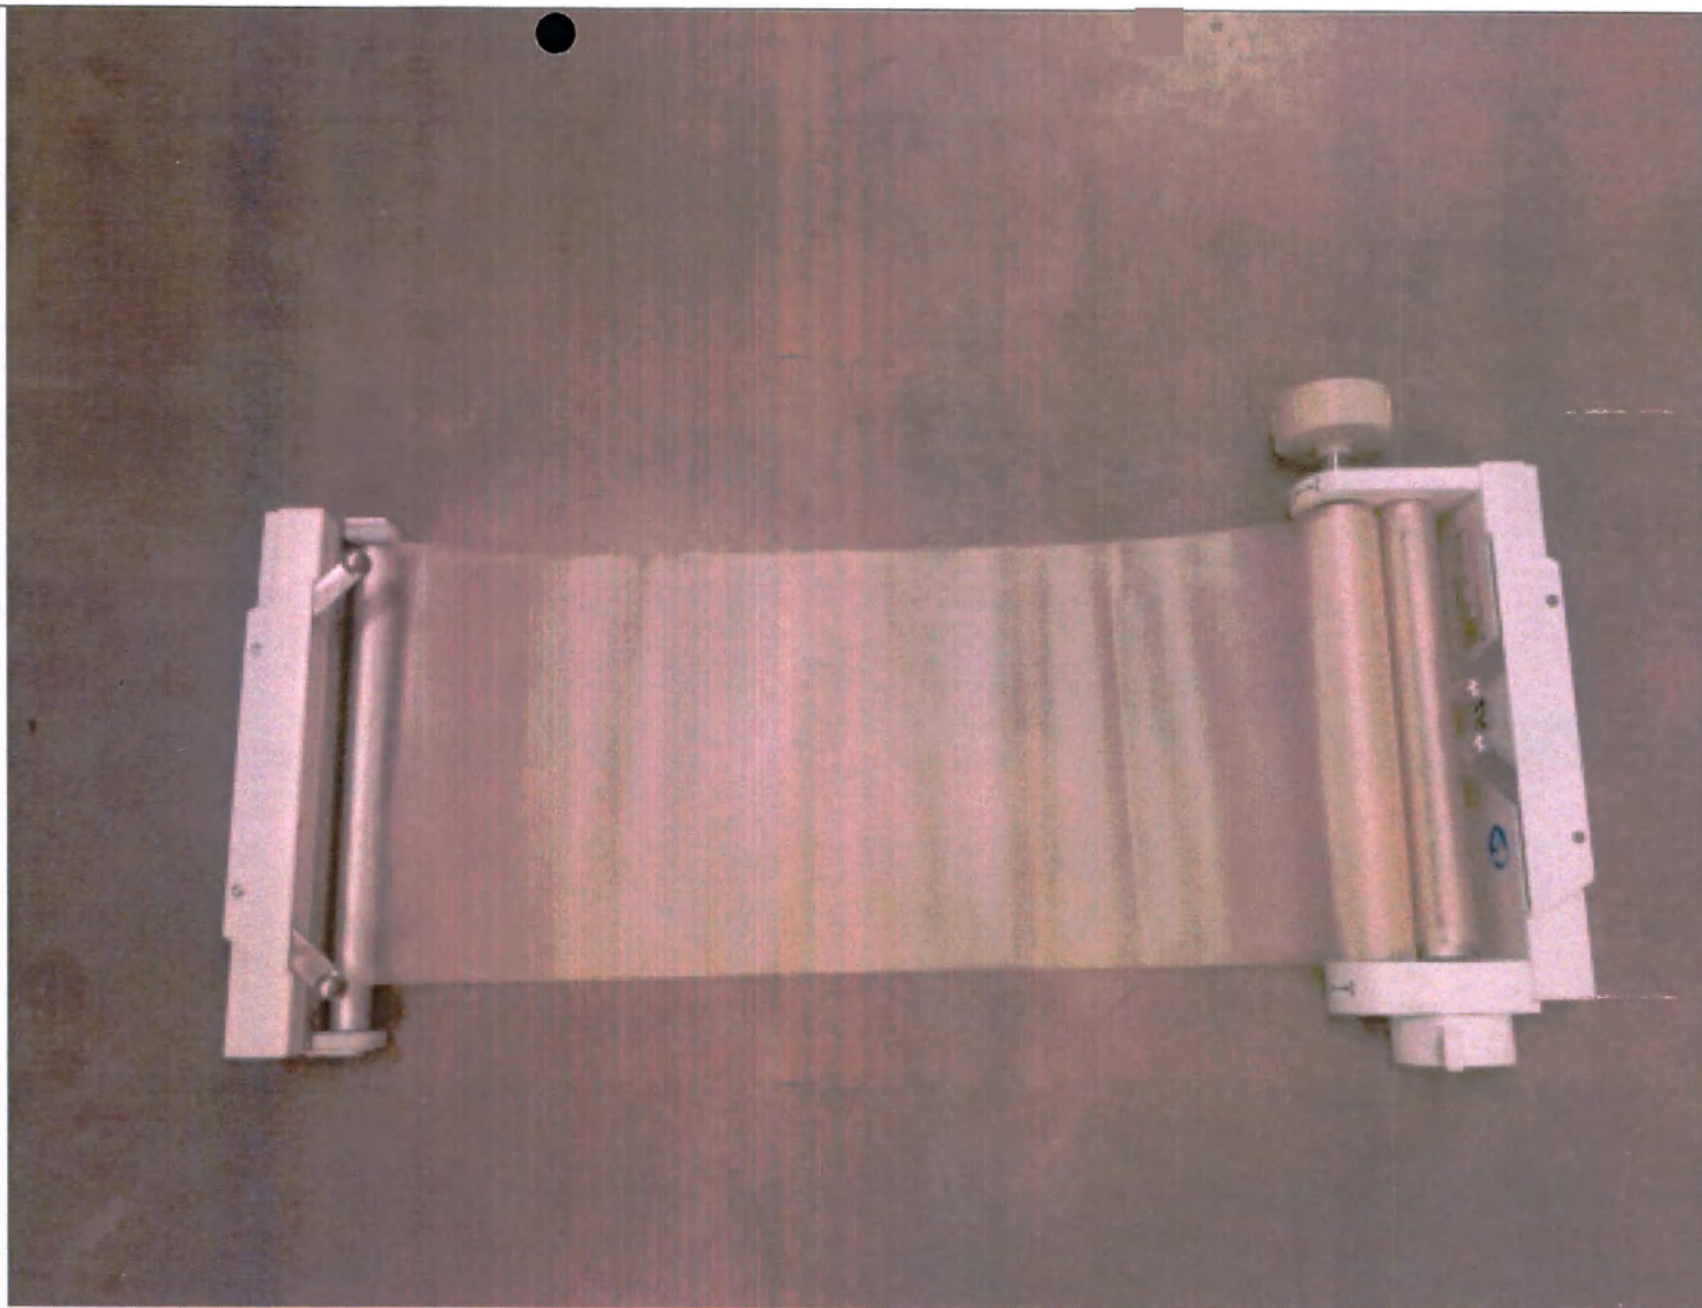


46. Ремень компрессионный.




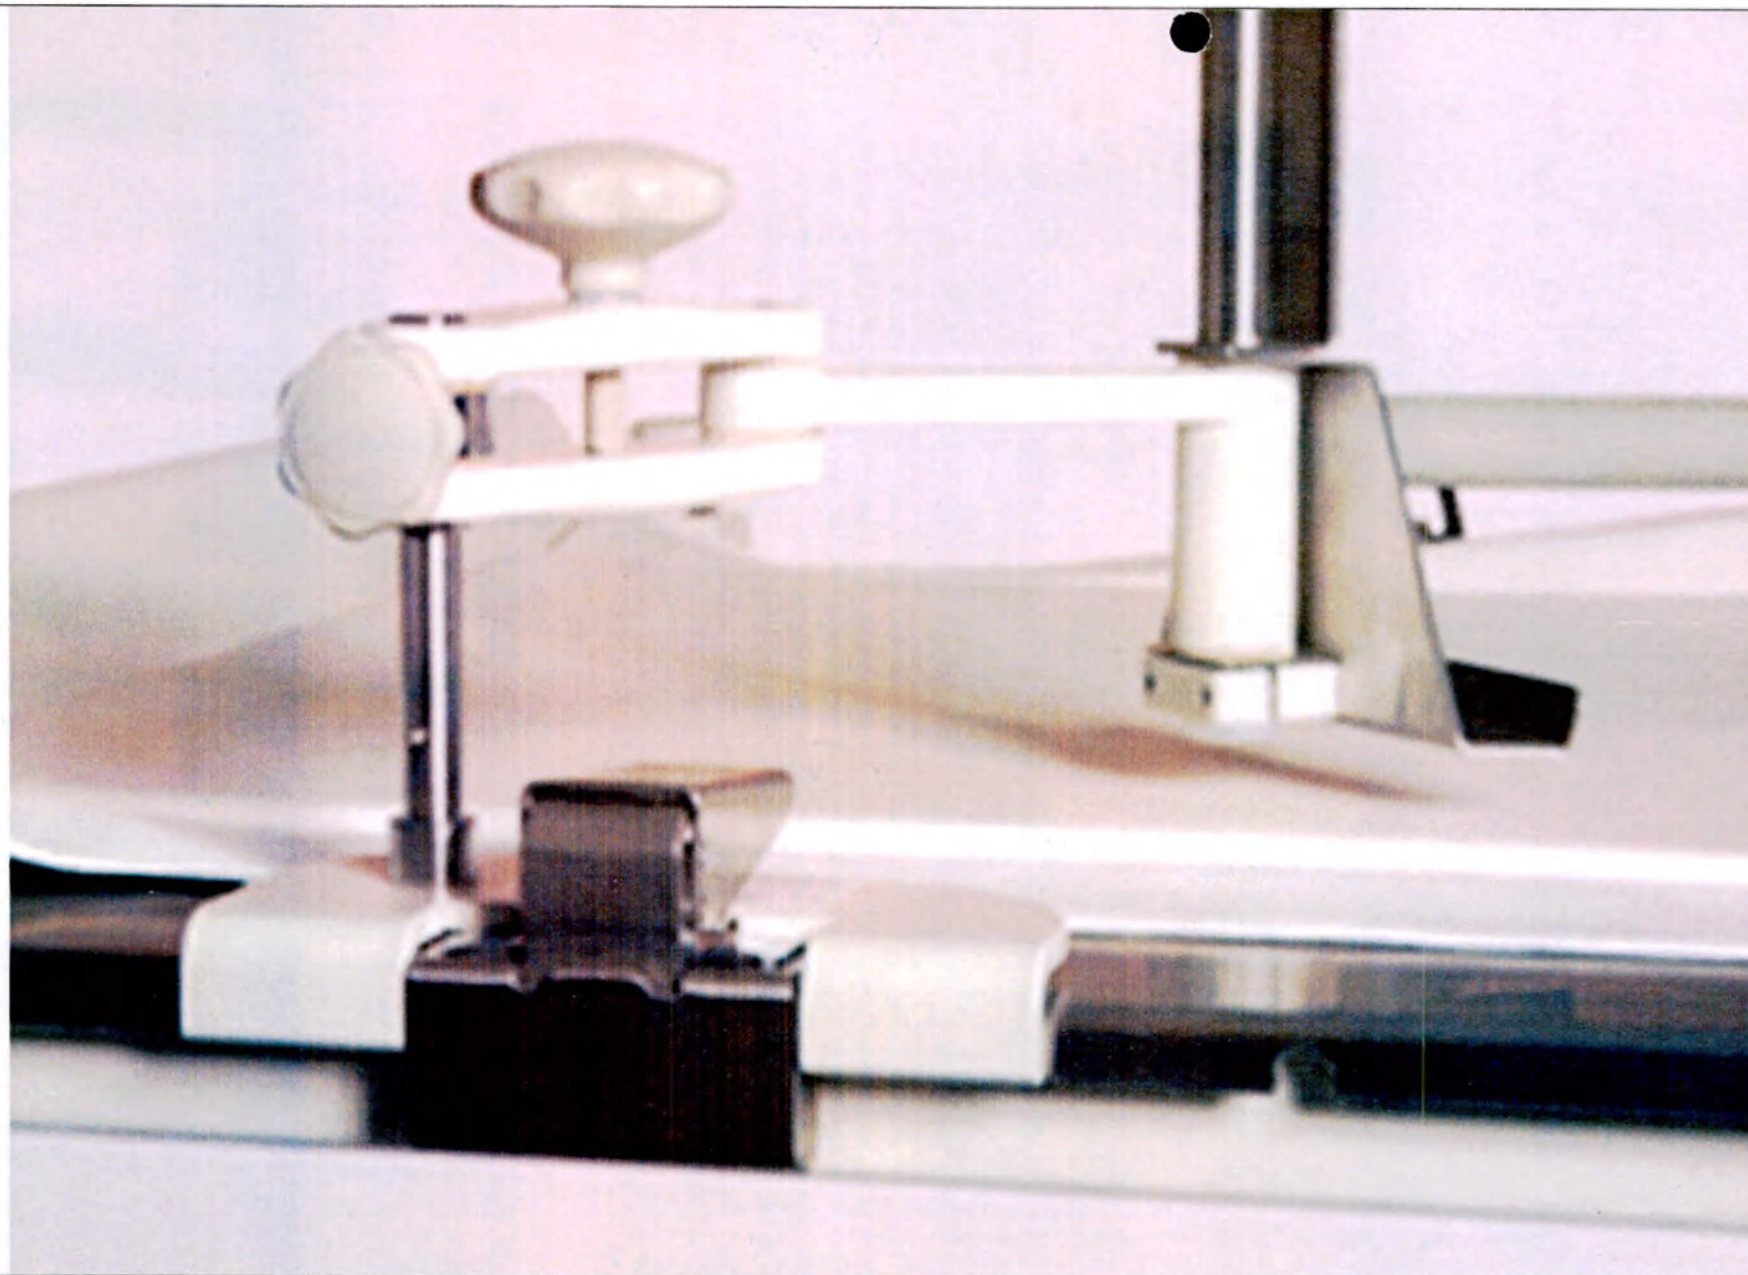

48. Держатель для кассеты (с фиксатором, боковой)

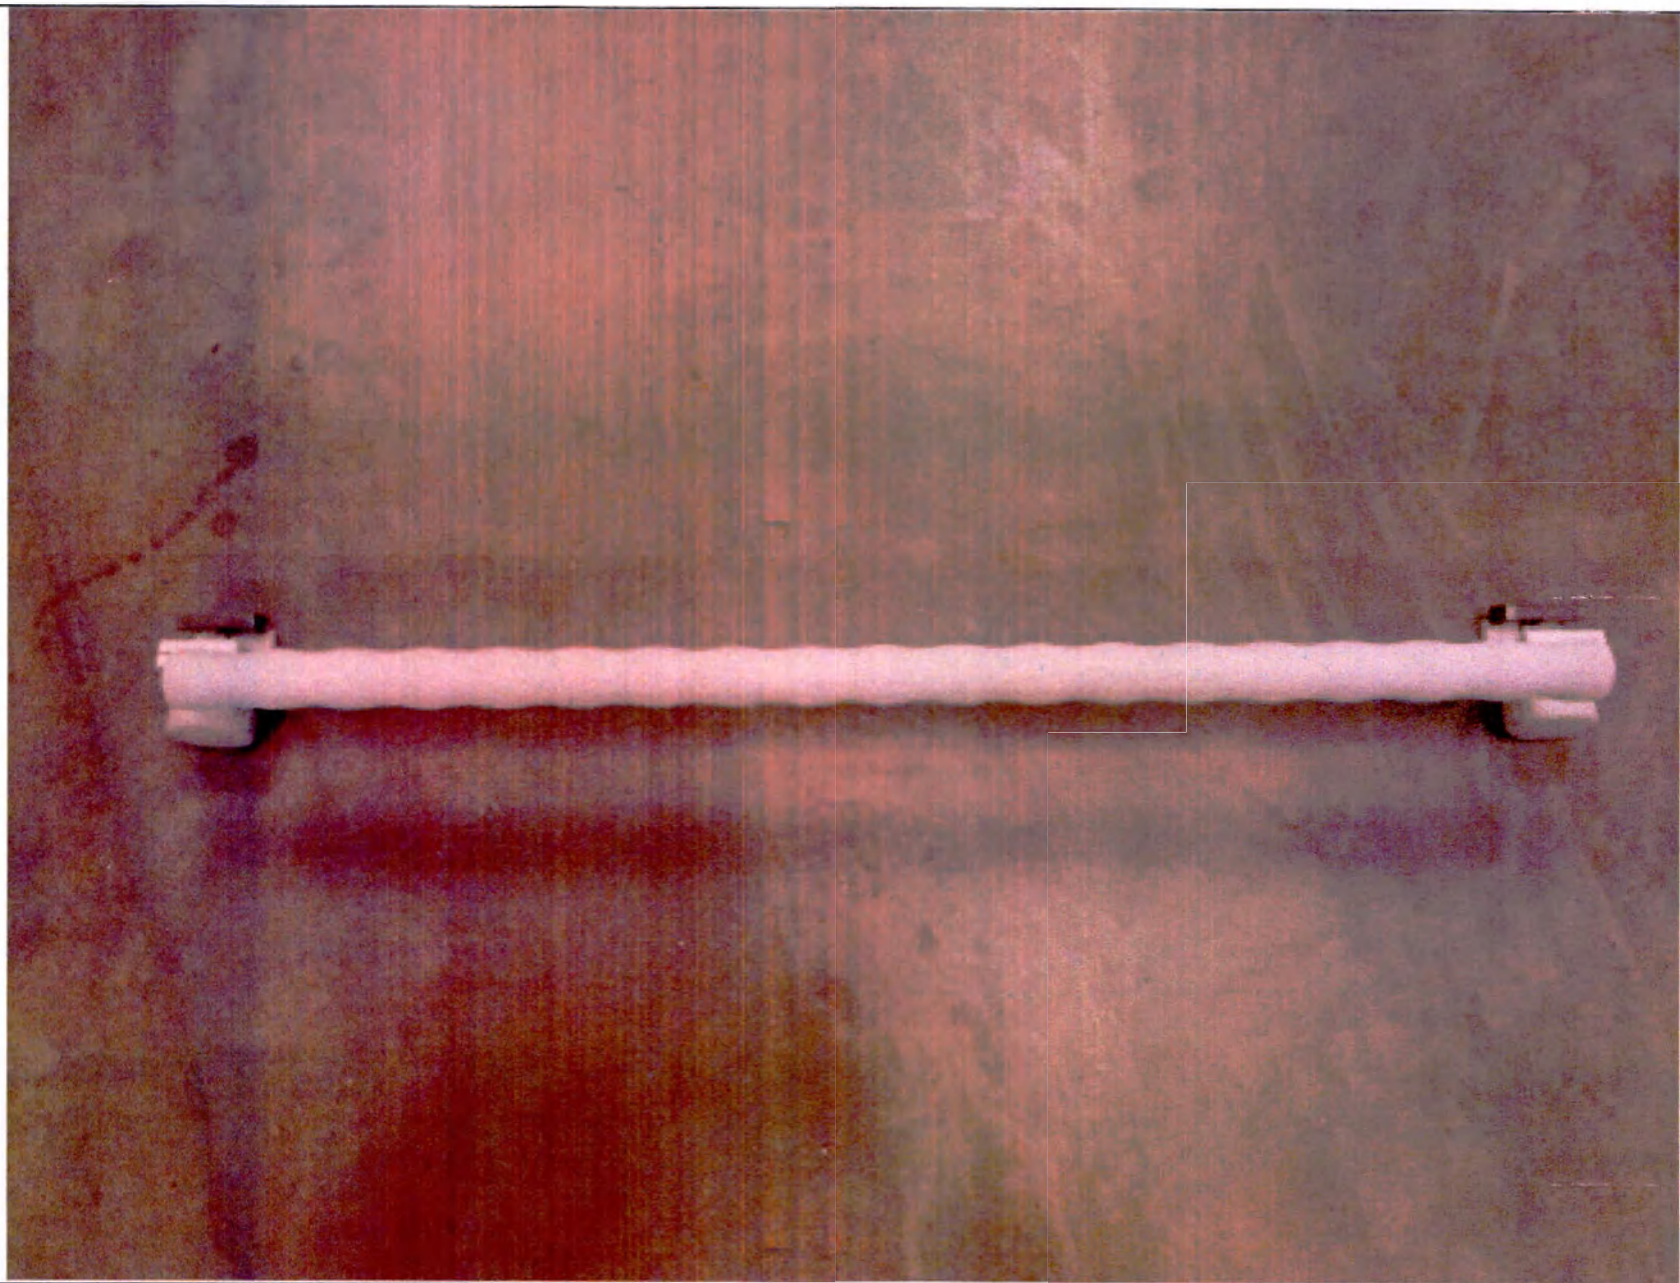


49. Планка – поручень

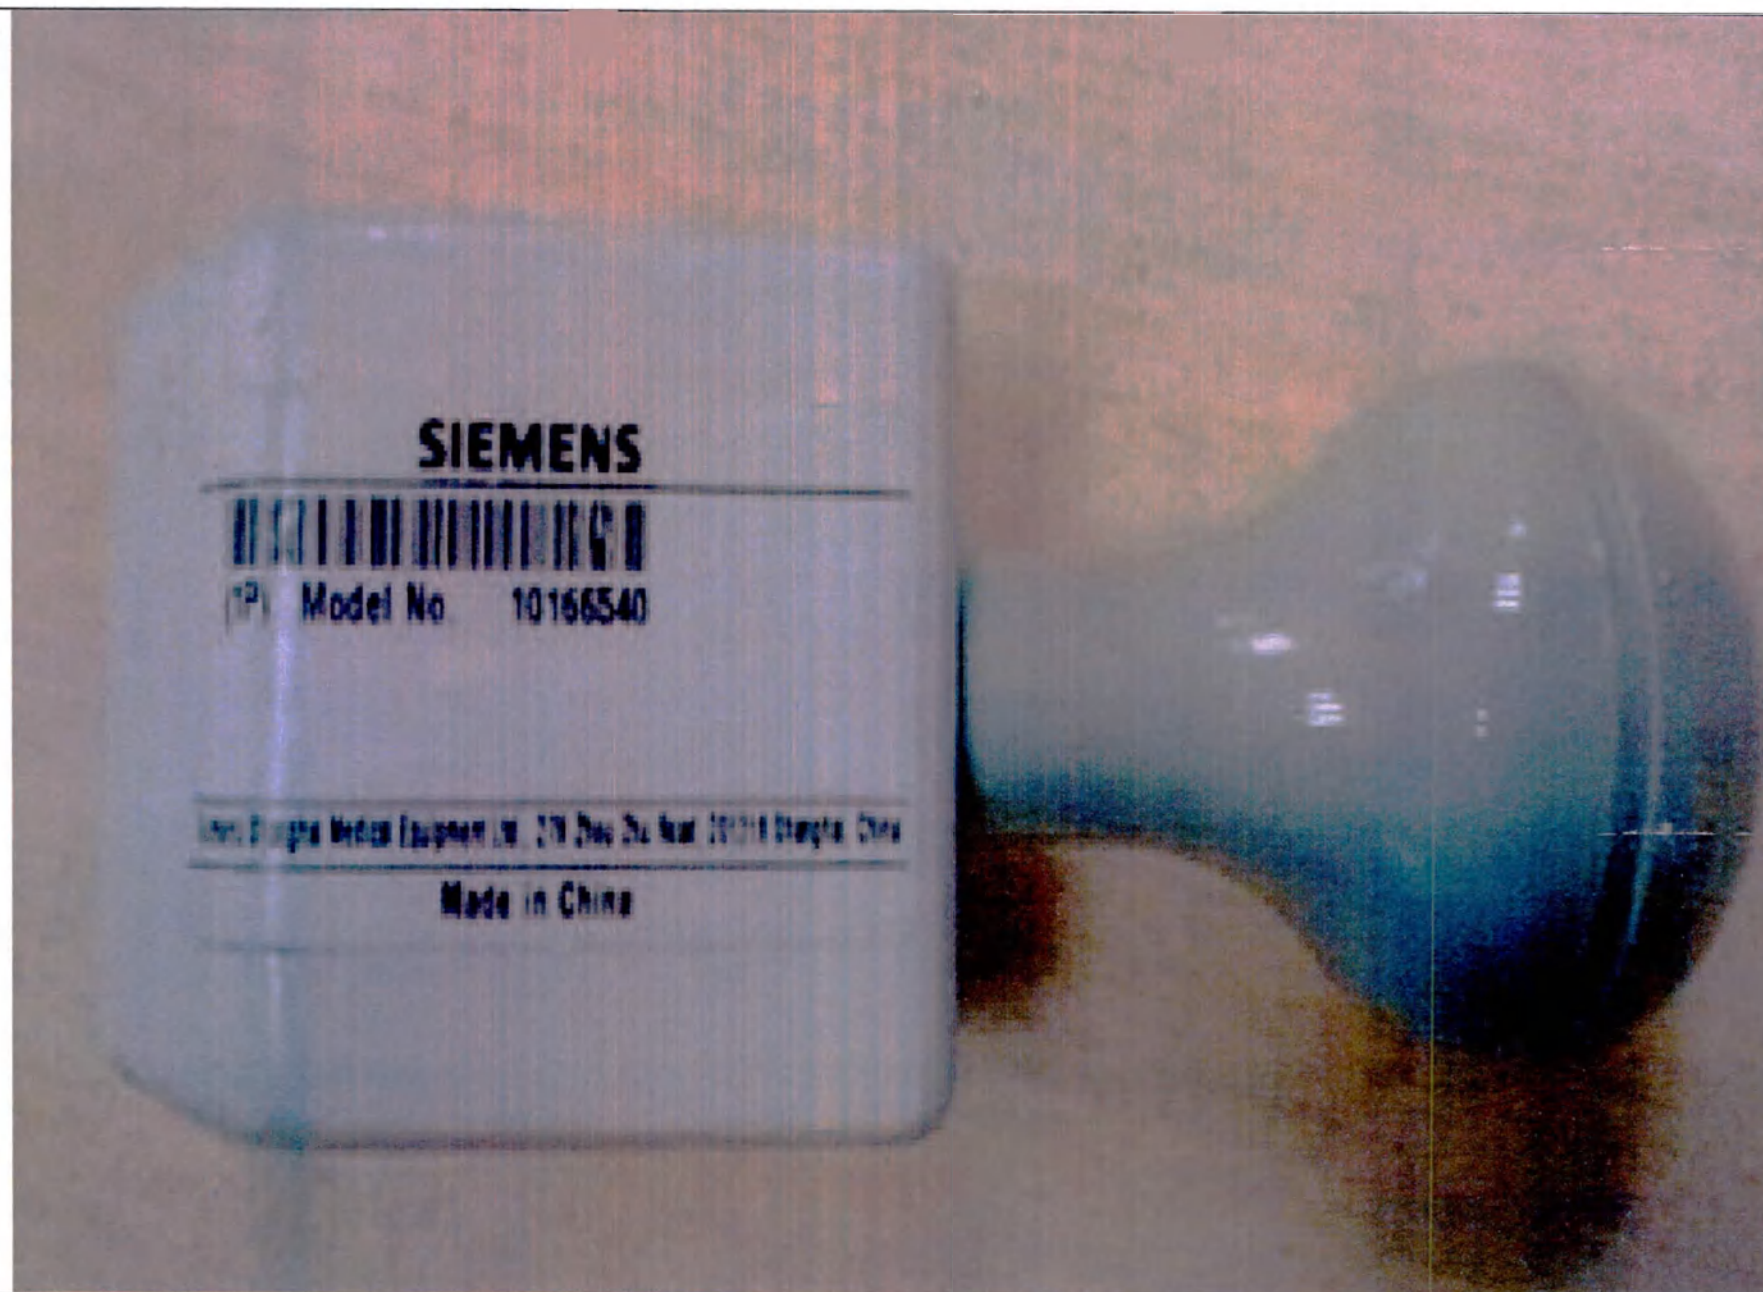


50. Опорная ручка, продольная



51. Стол оператора

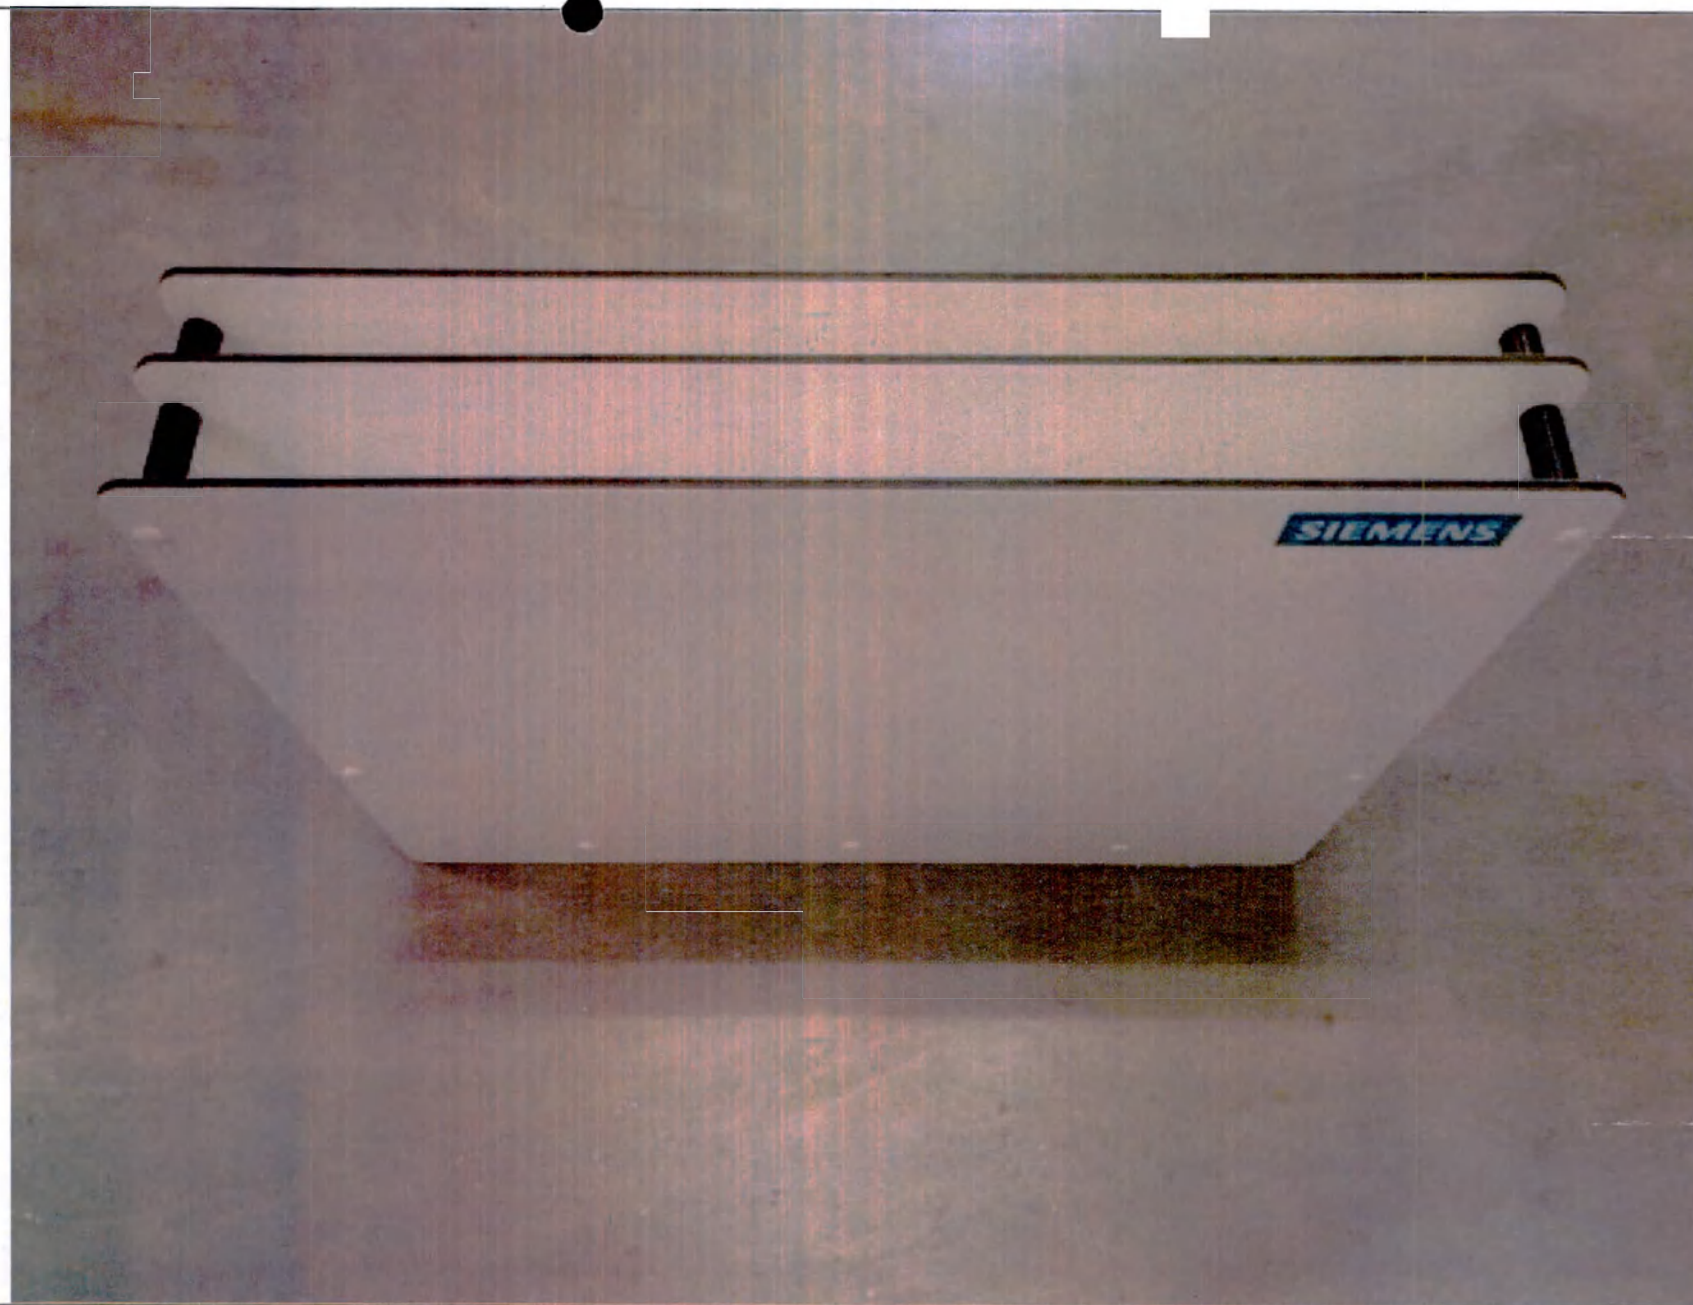

52. Держатель для отсеивающих решеток (настенный).

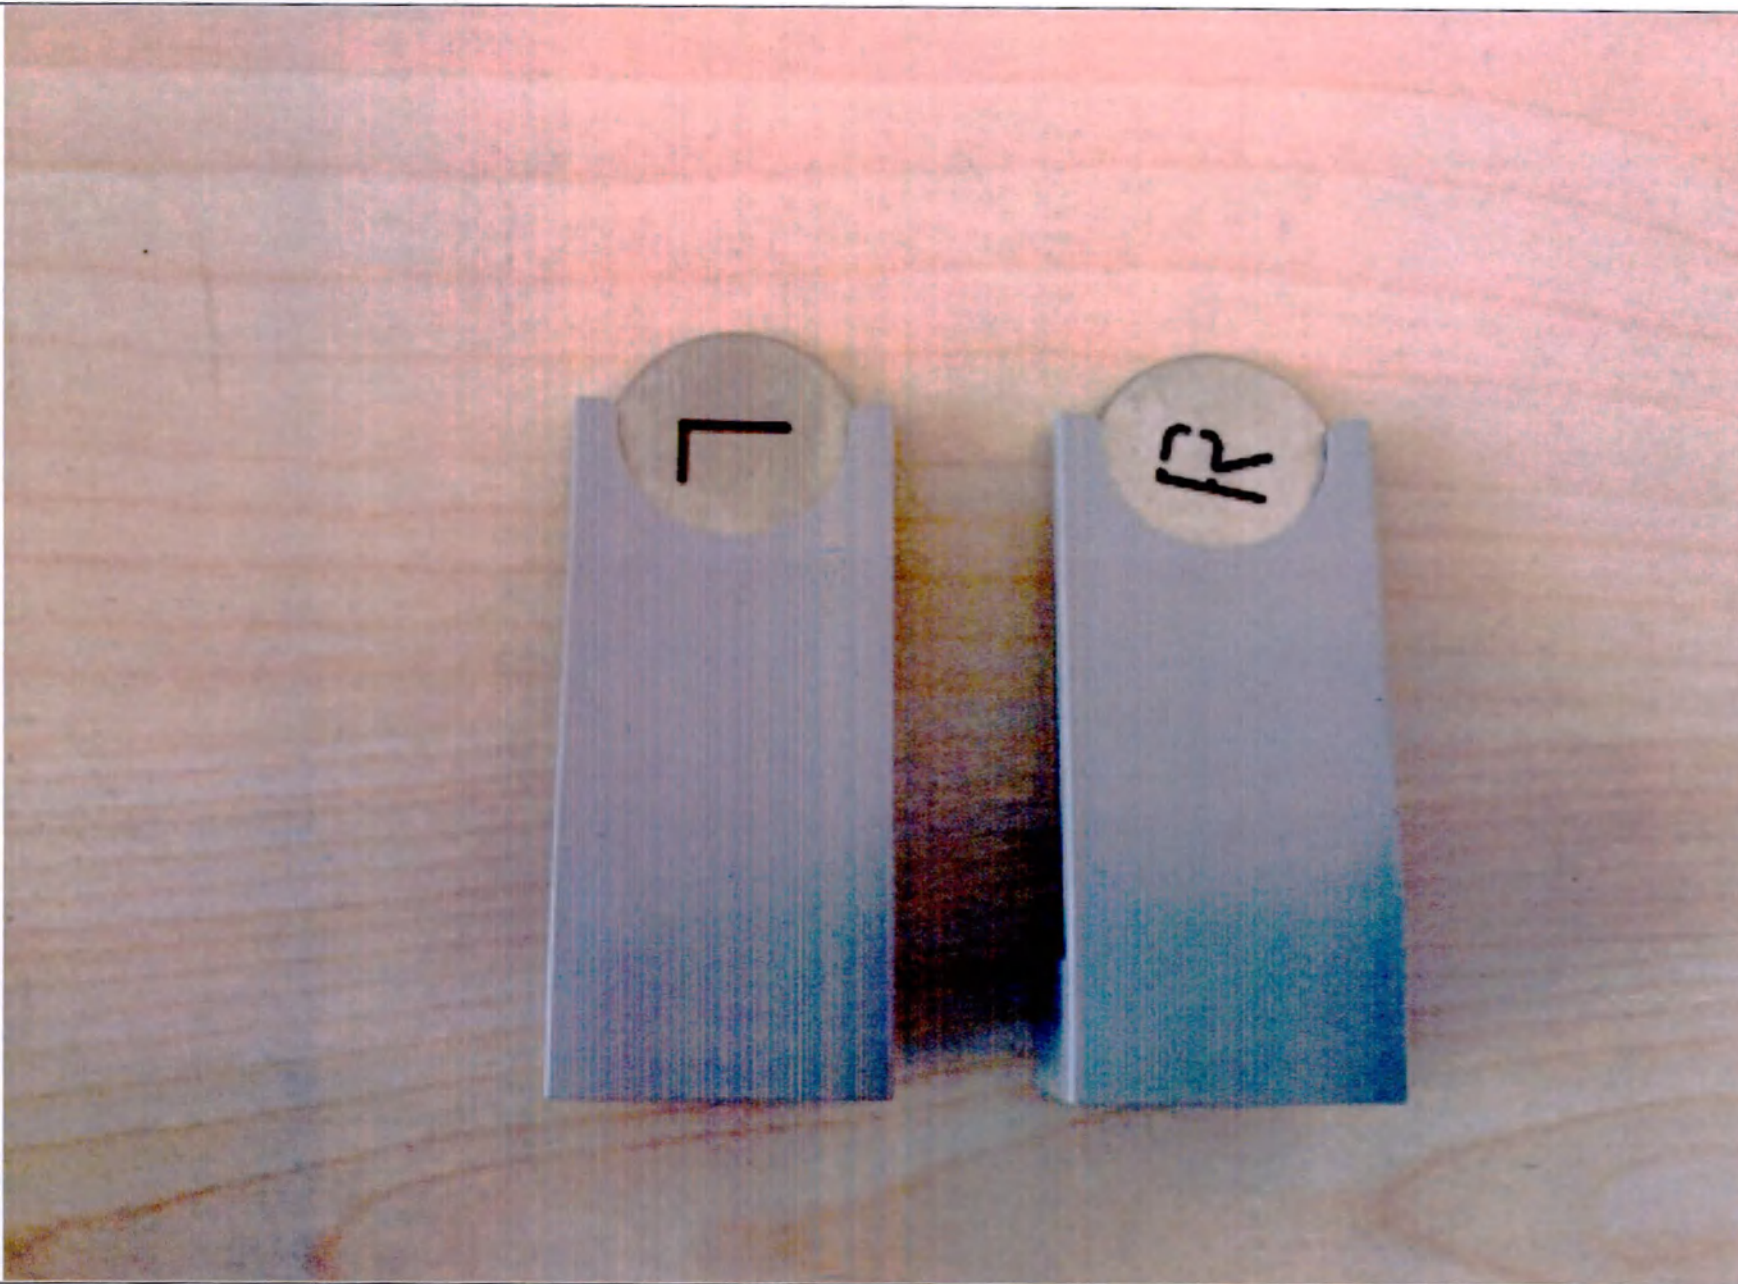

53. Маркер пленки.




54. Система внутренней связи в аппаратной




55. Держатель для детской люльки для вертикальной стойки.




56. Держатель для детской люльки для Ortho стойки

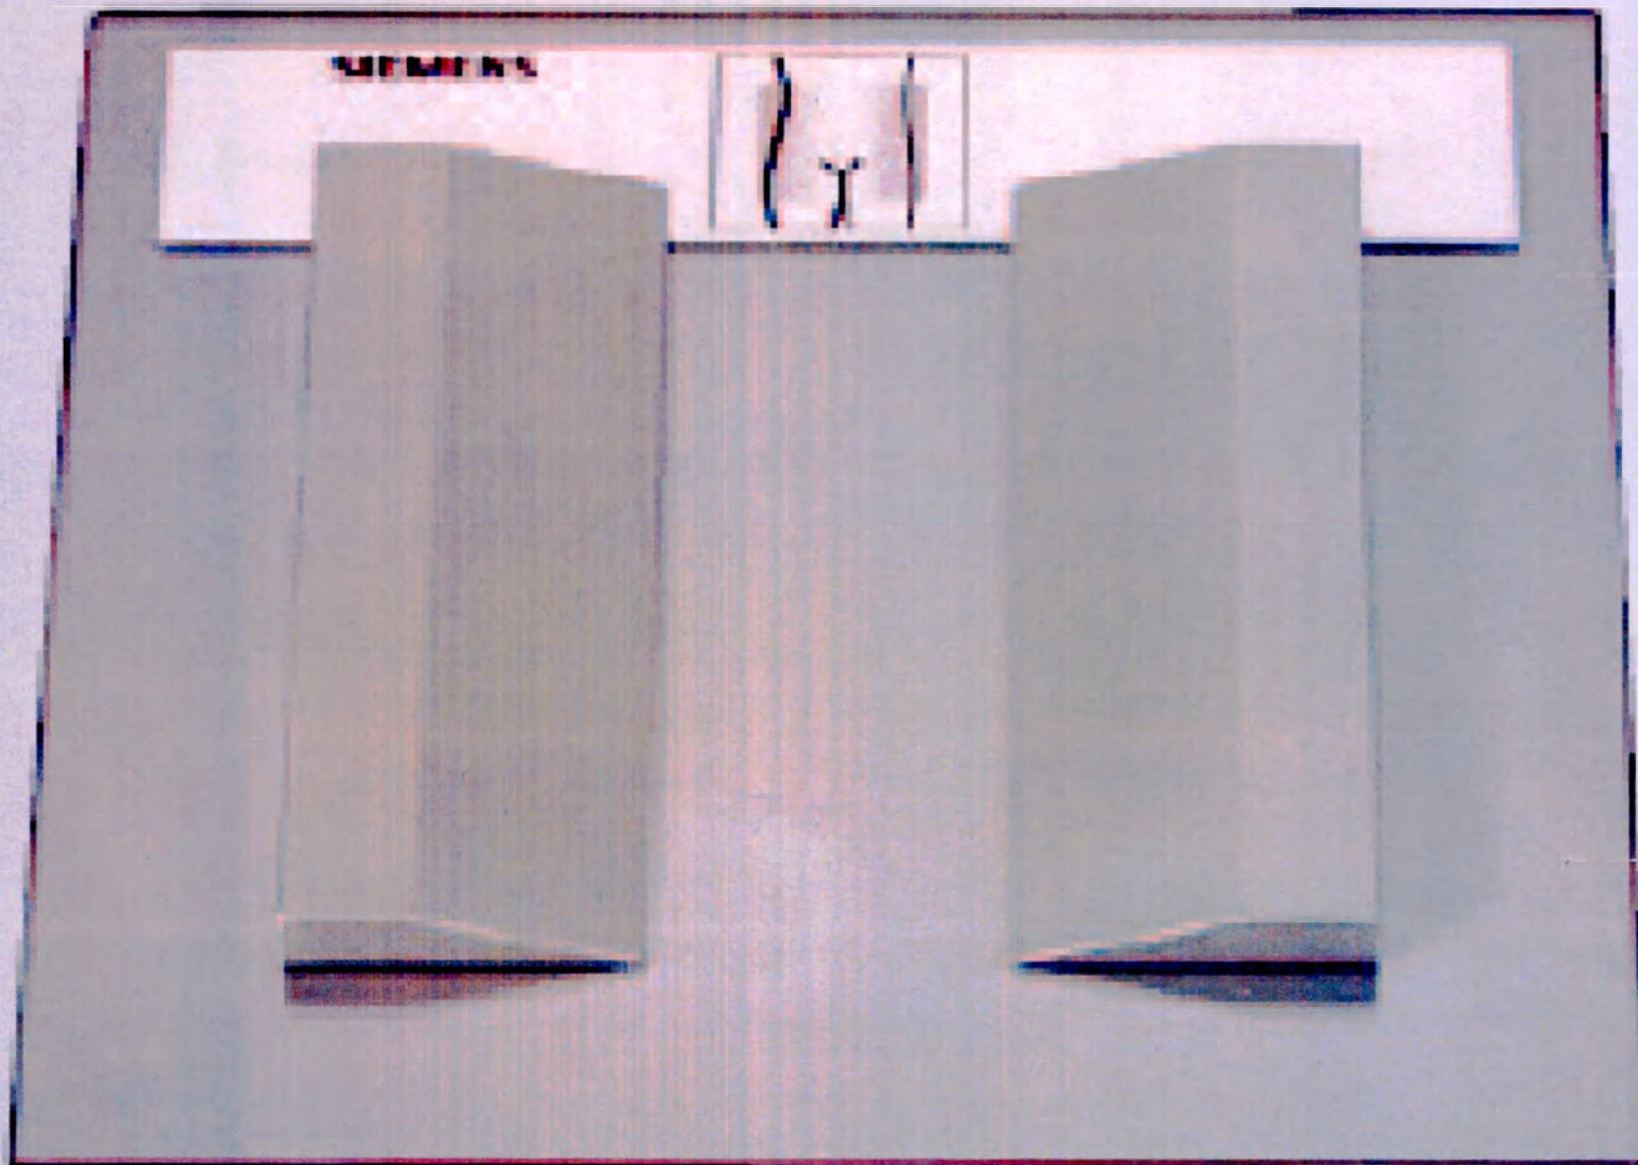


57. Компенсационный фильтр, таз

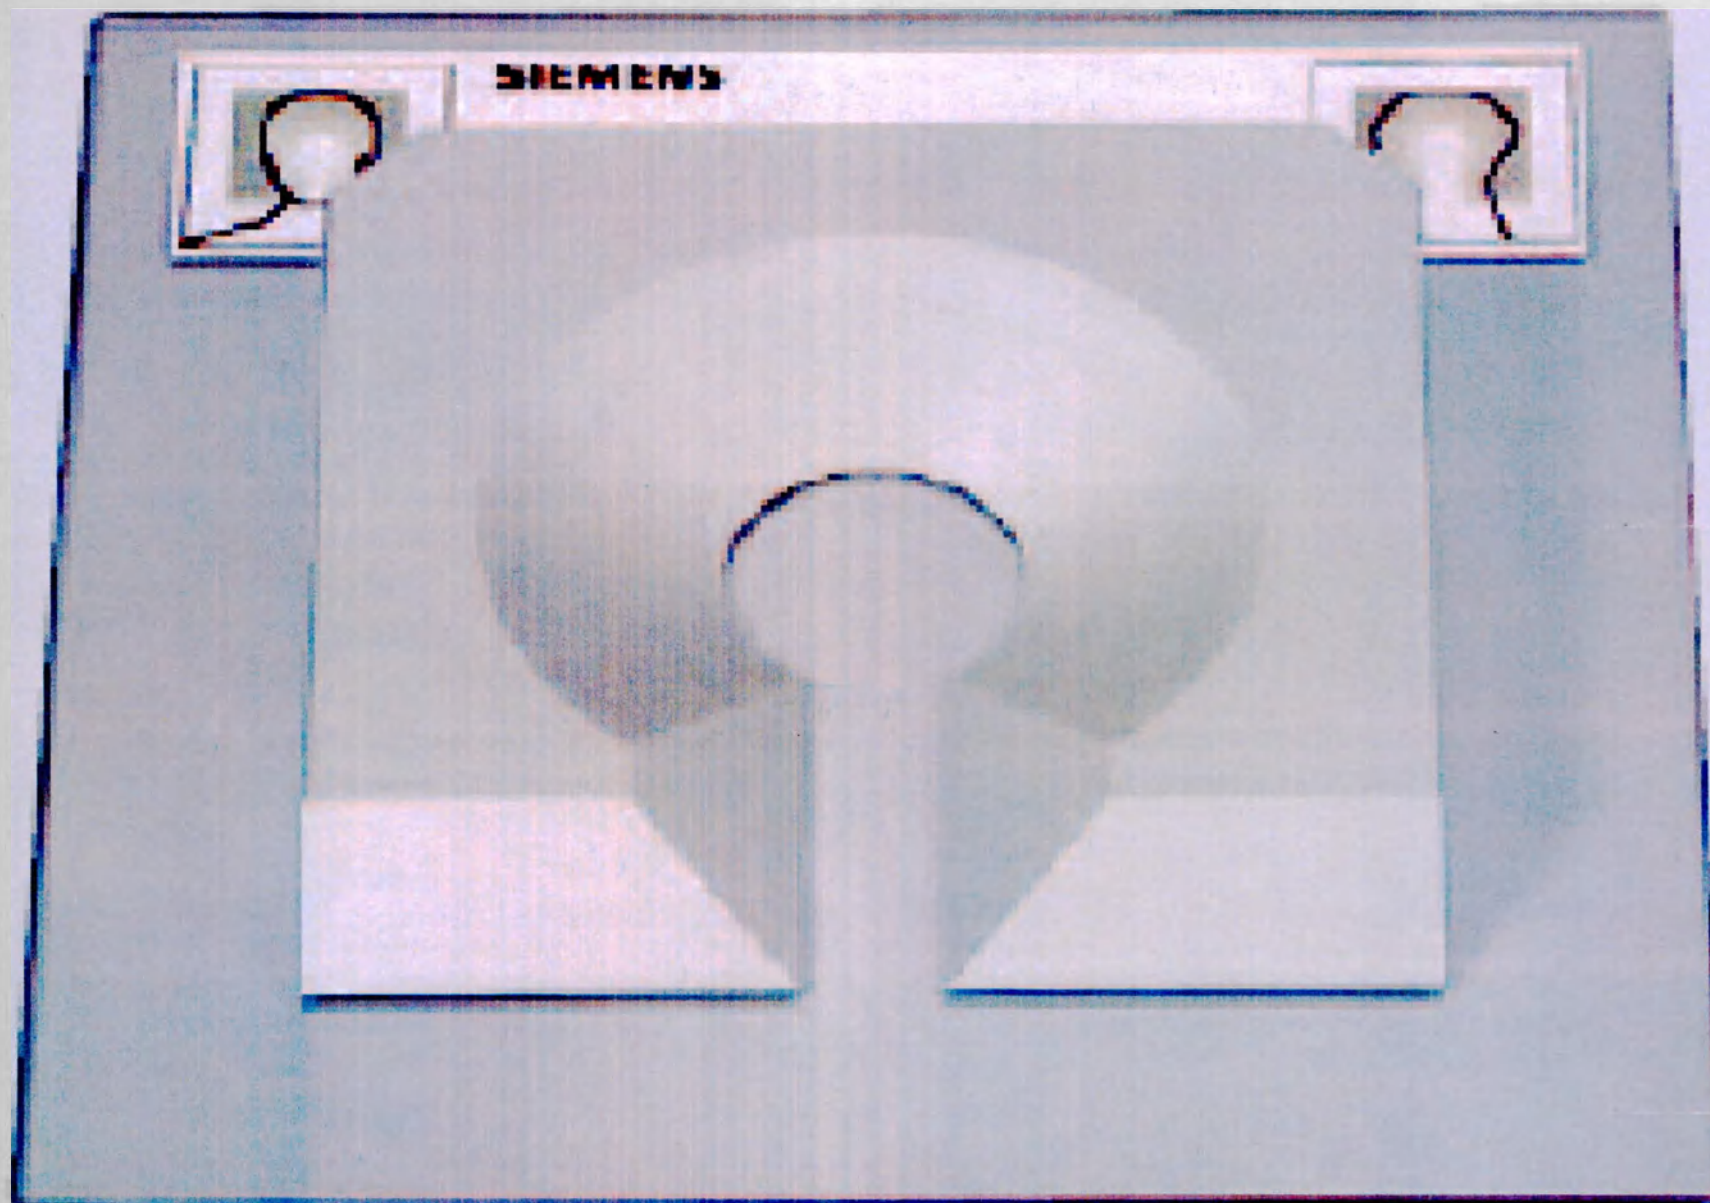


58. Компенсационный фильтр, череп взрослого

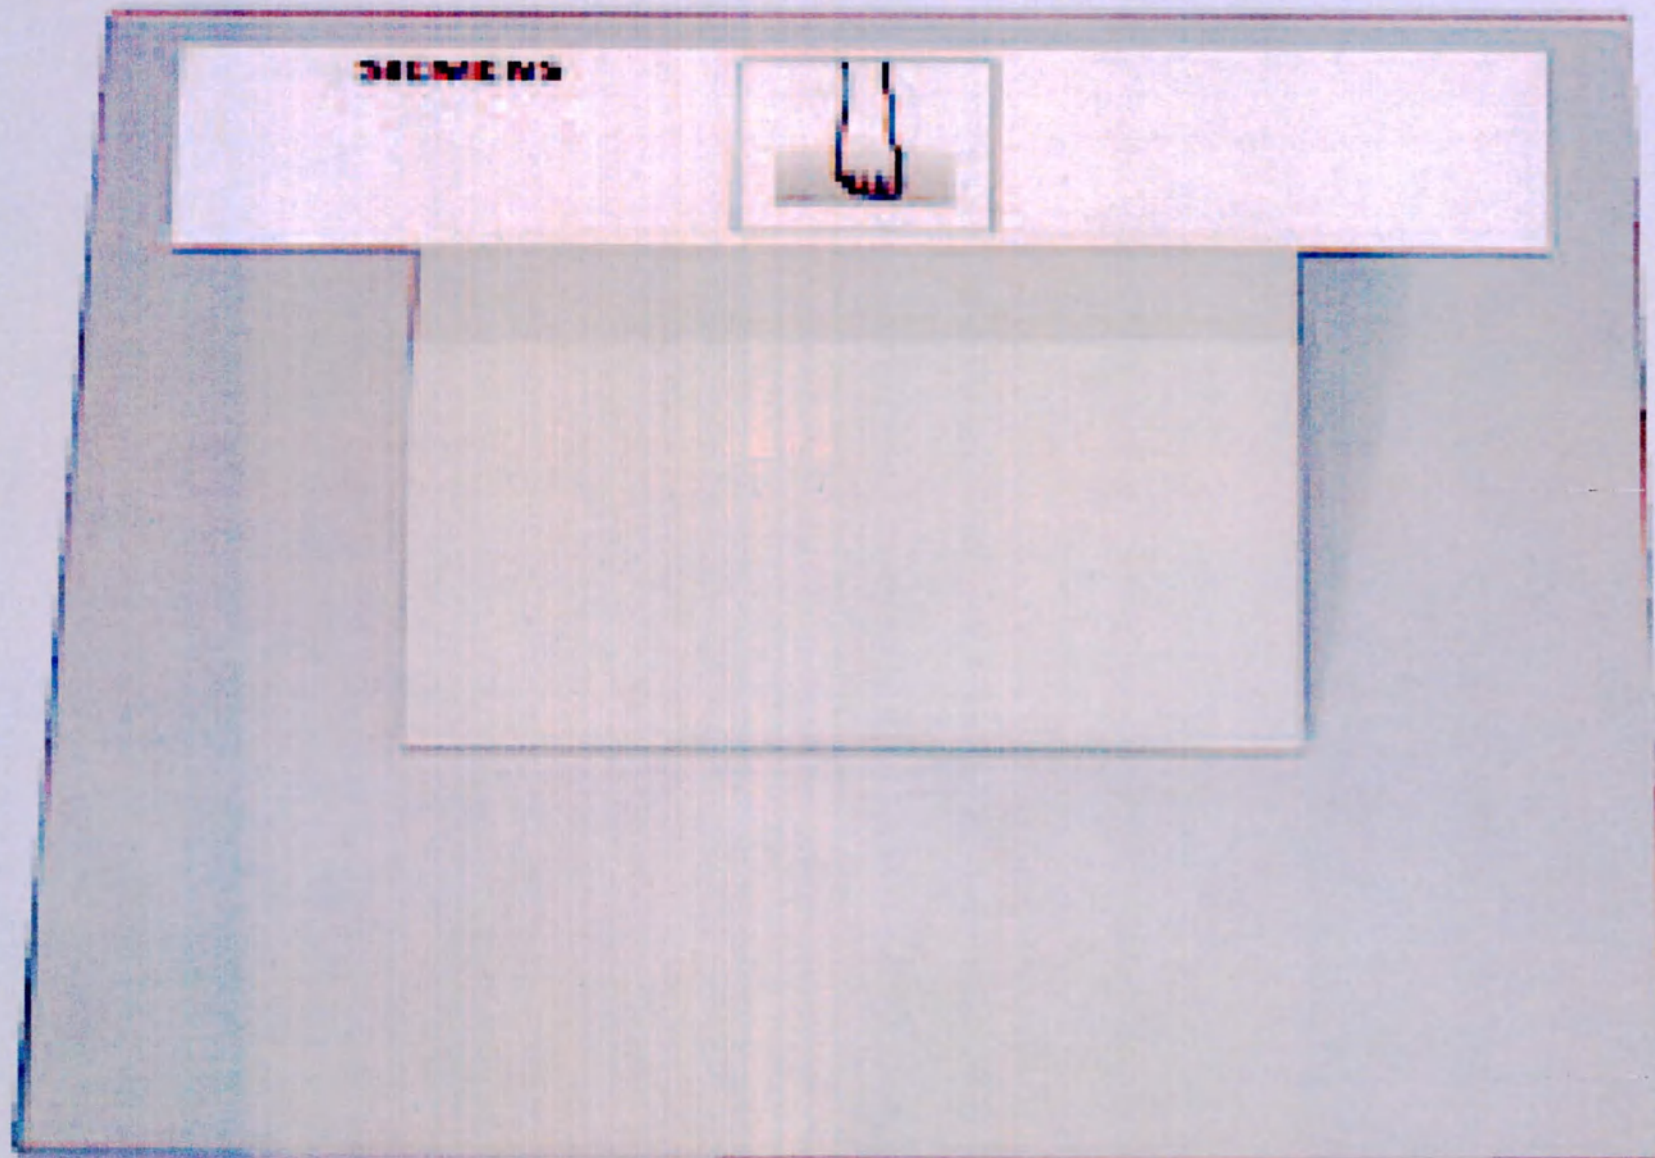

59. Компенсационный фильтр, нога

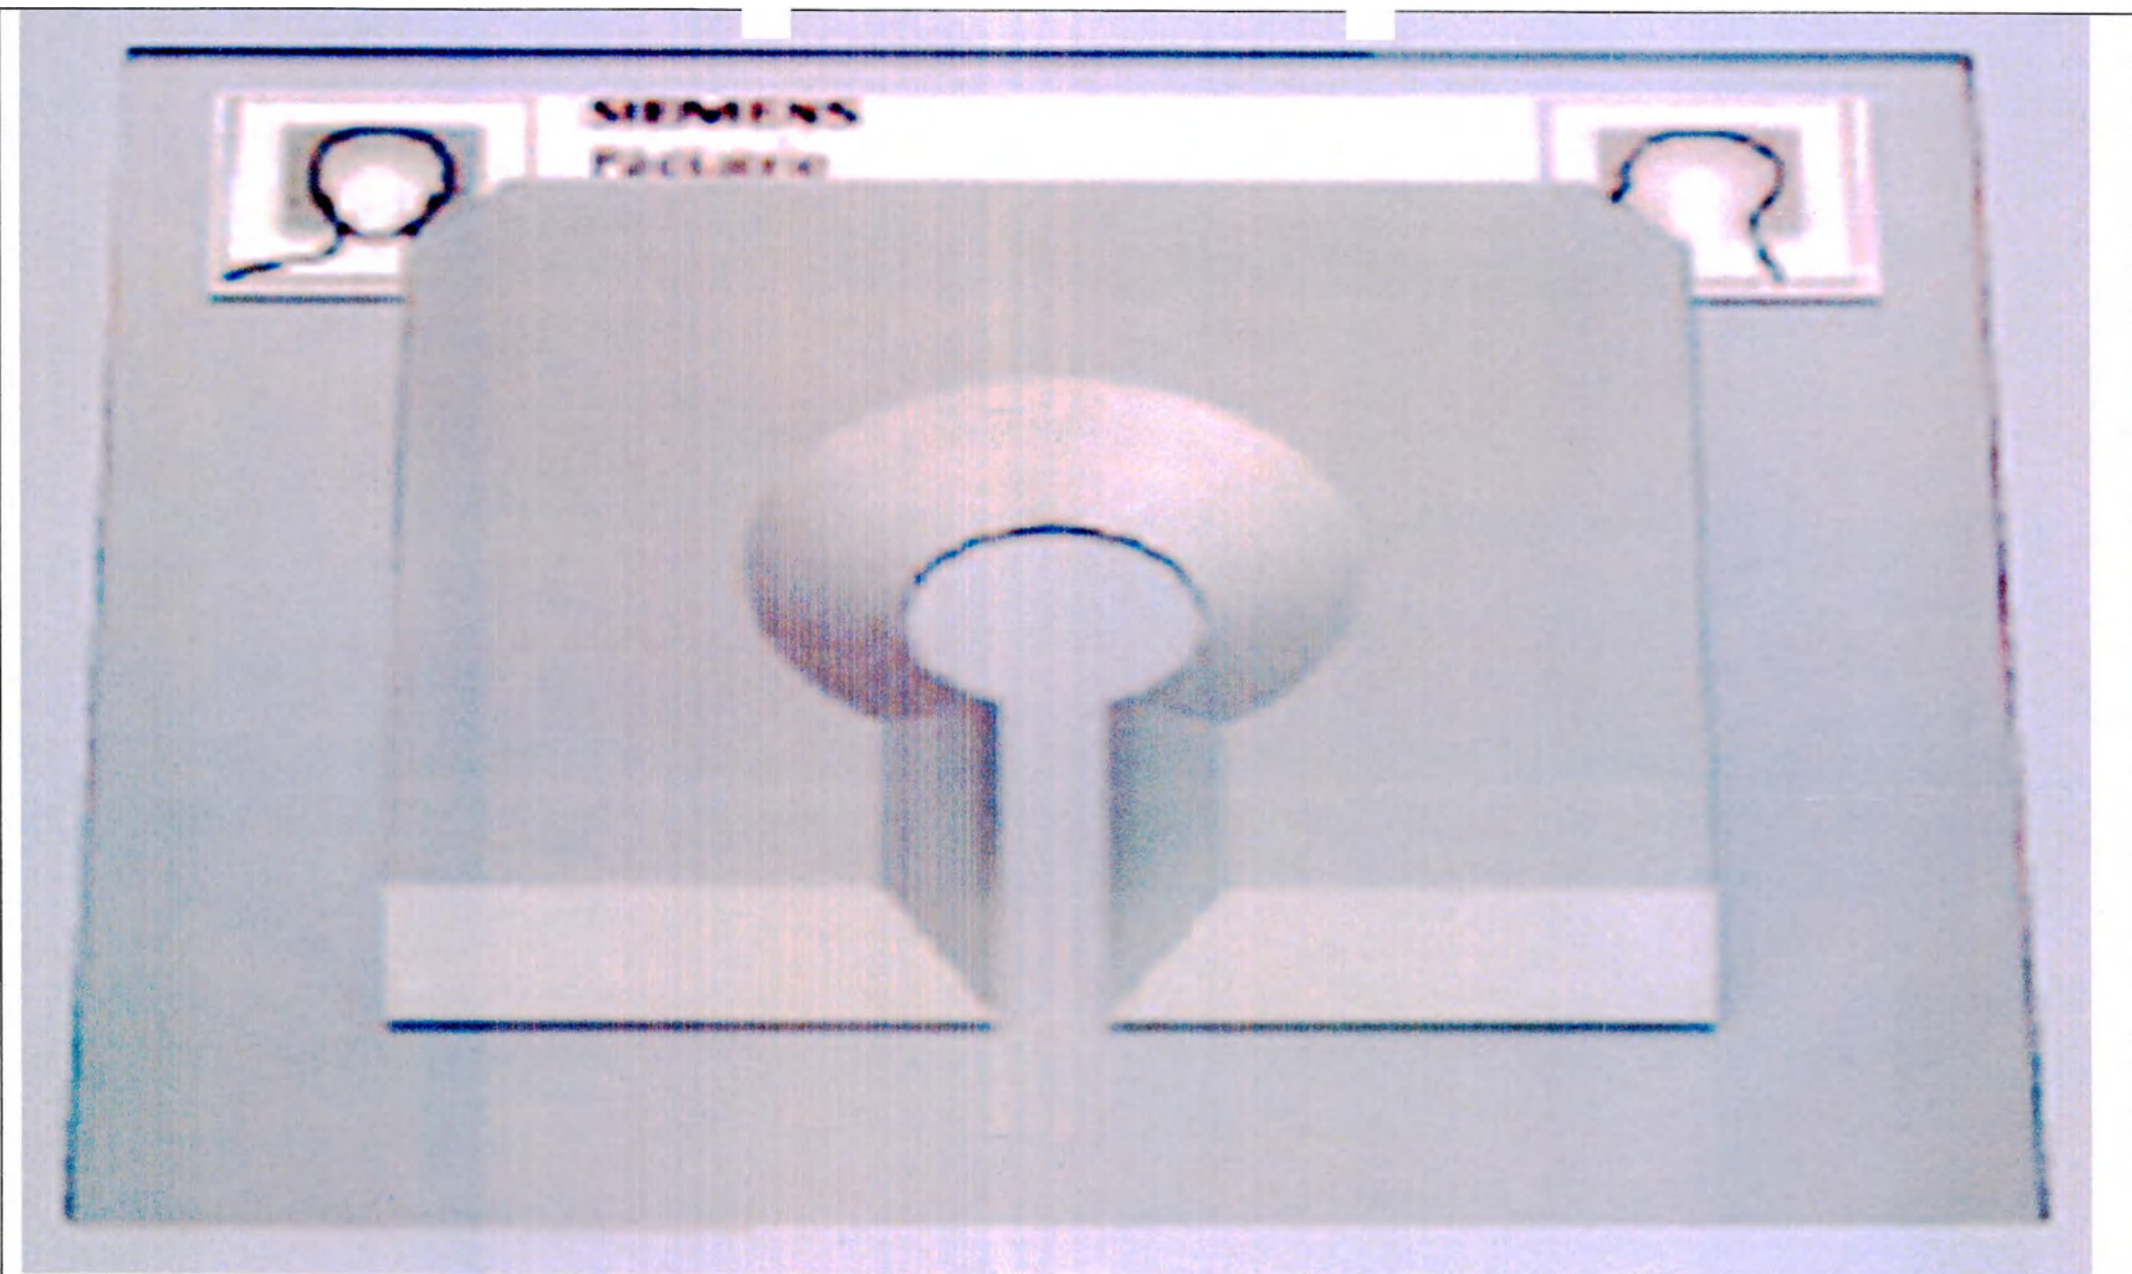


60. Компенсационный фильтр, череп ребенка

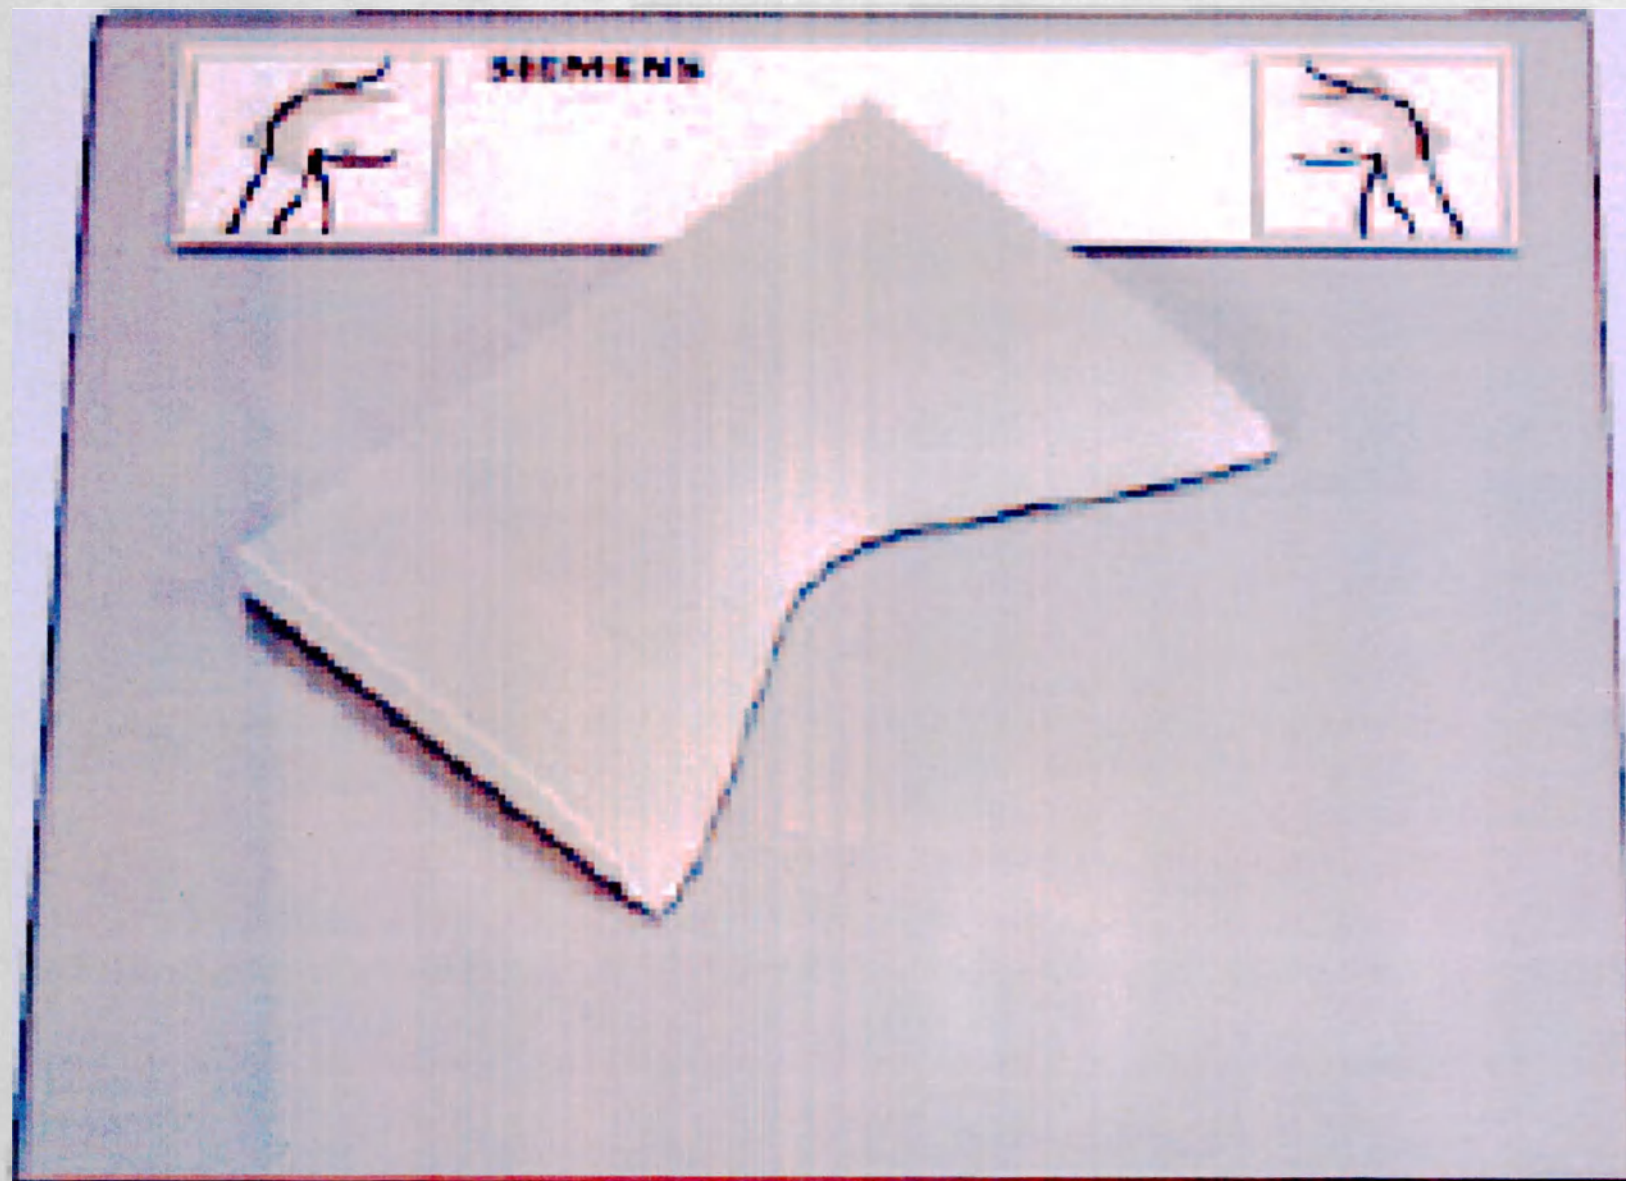


61. Компенсационный фильтр, плечо




62. Компенсационный фильтр, Т-позвоночник, L - позвонок

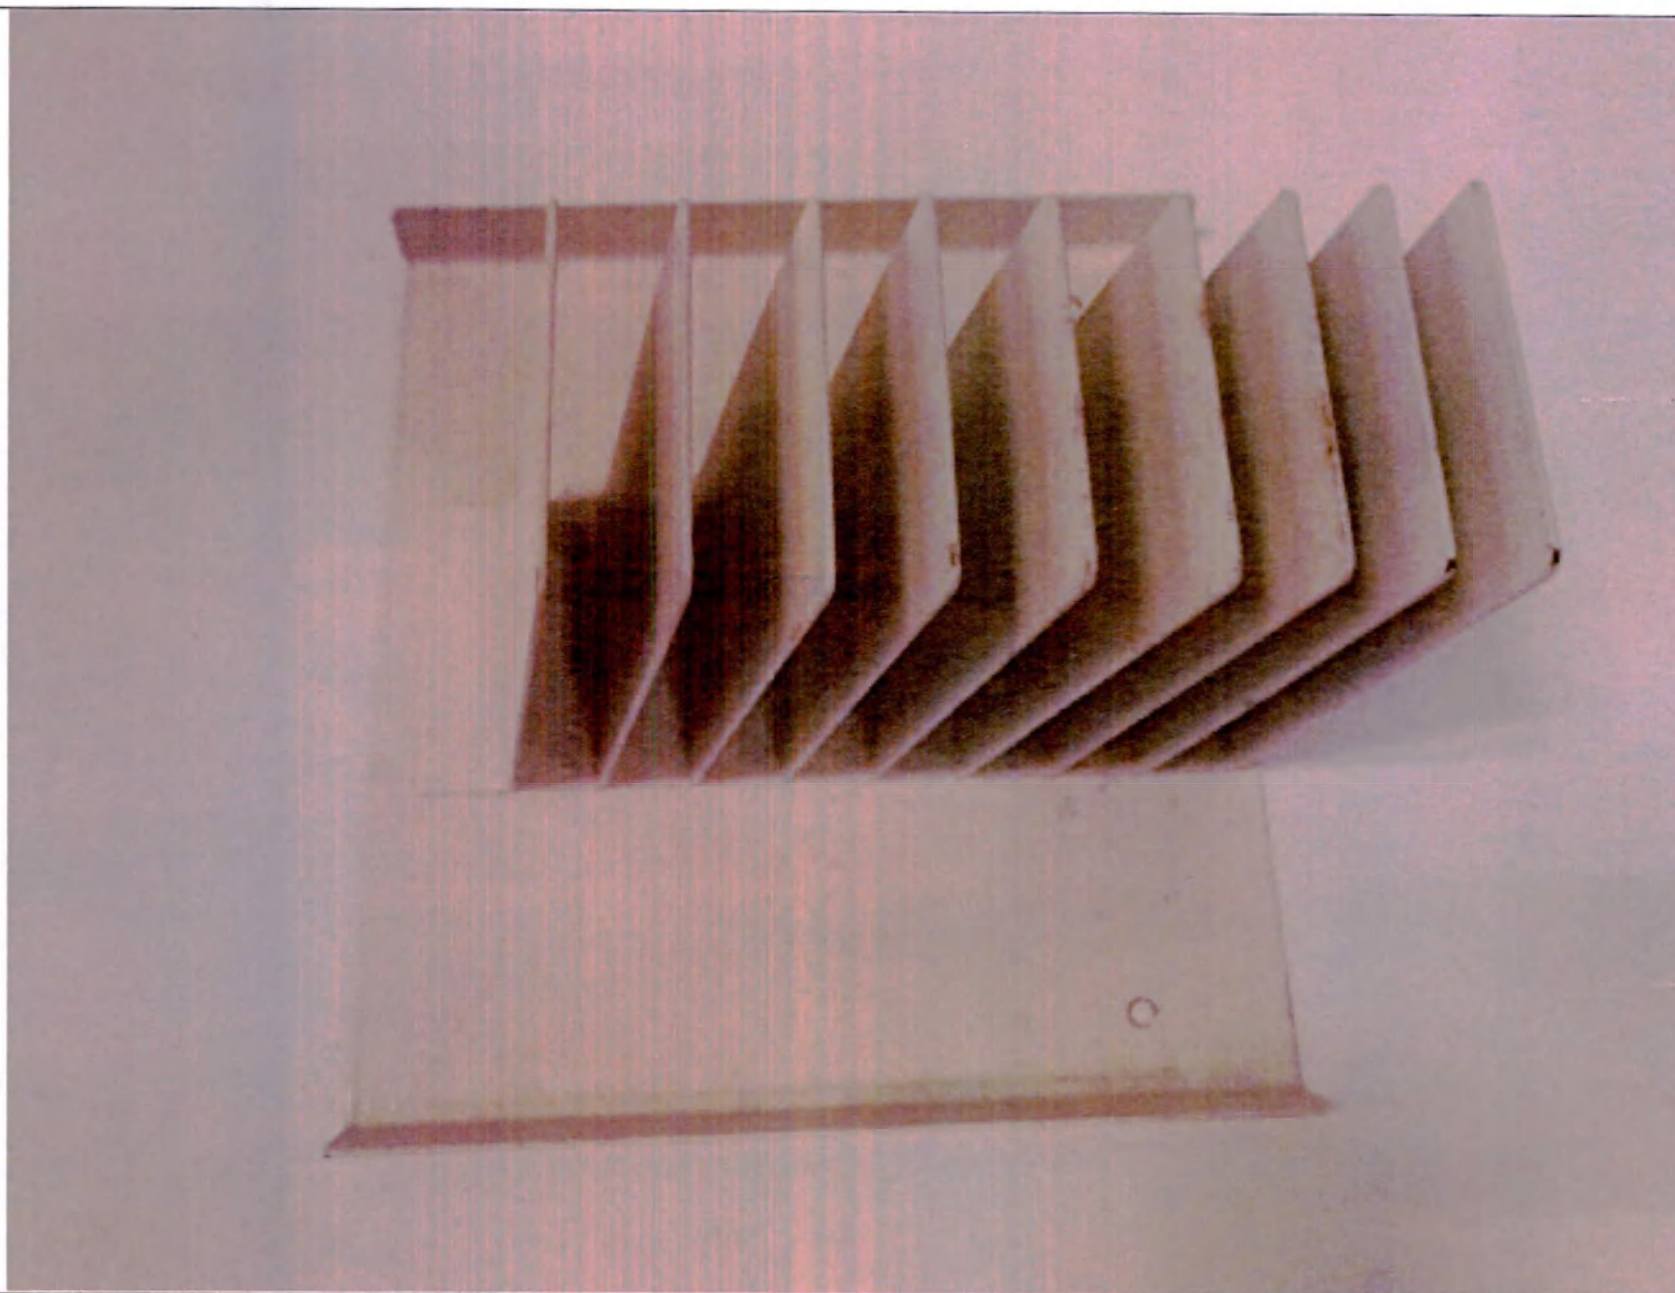

63. Держатель для фильтров.

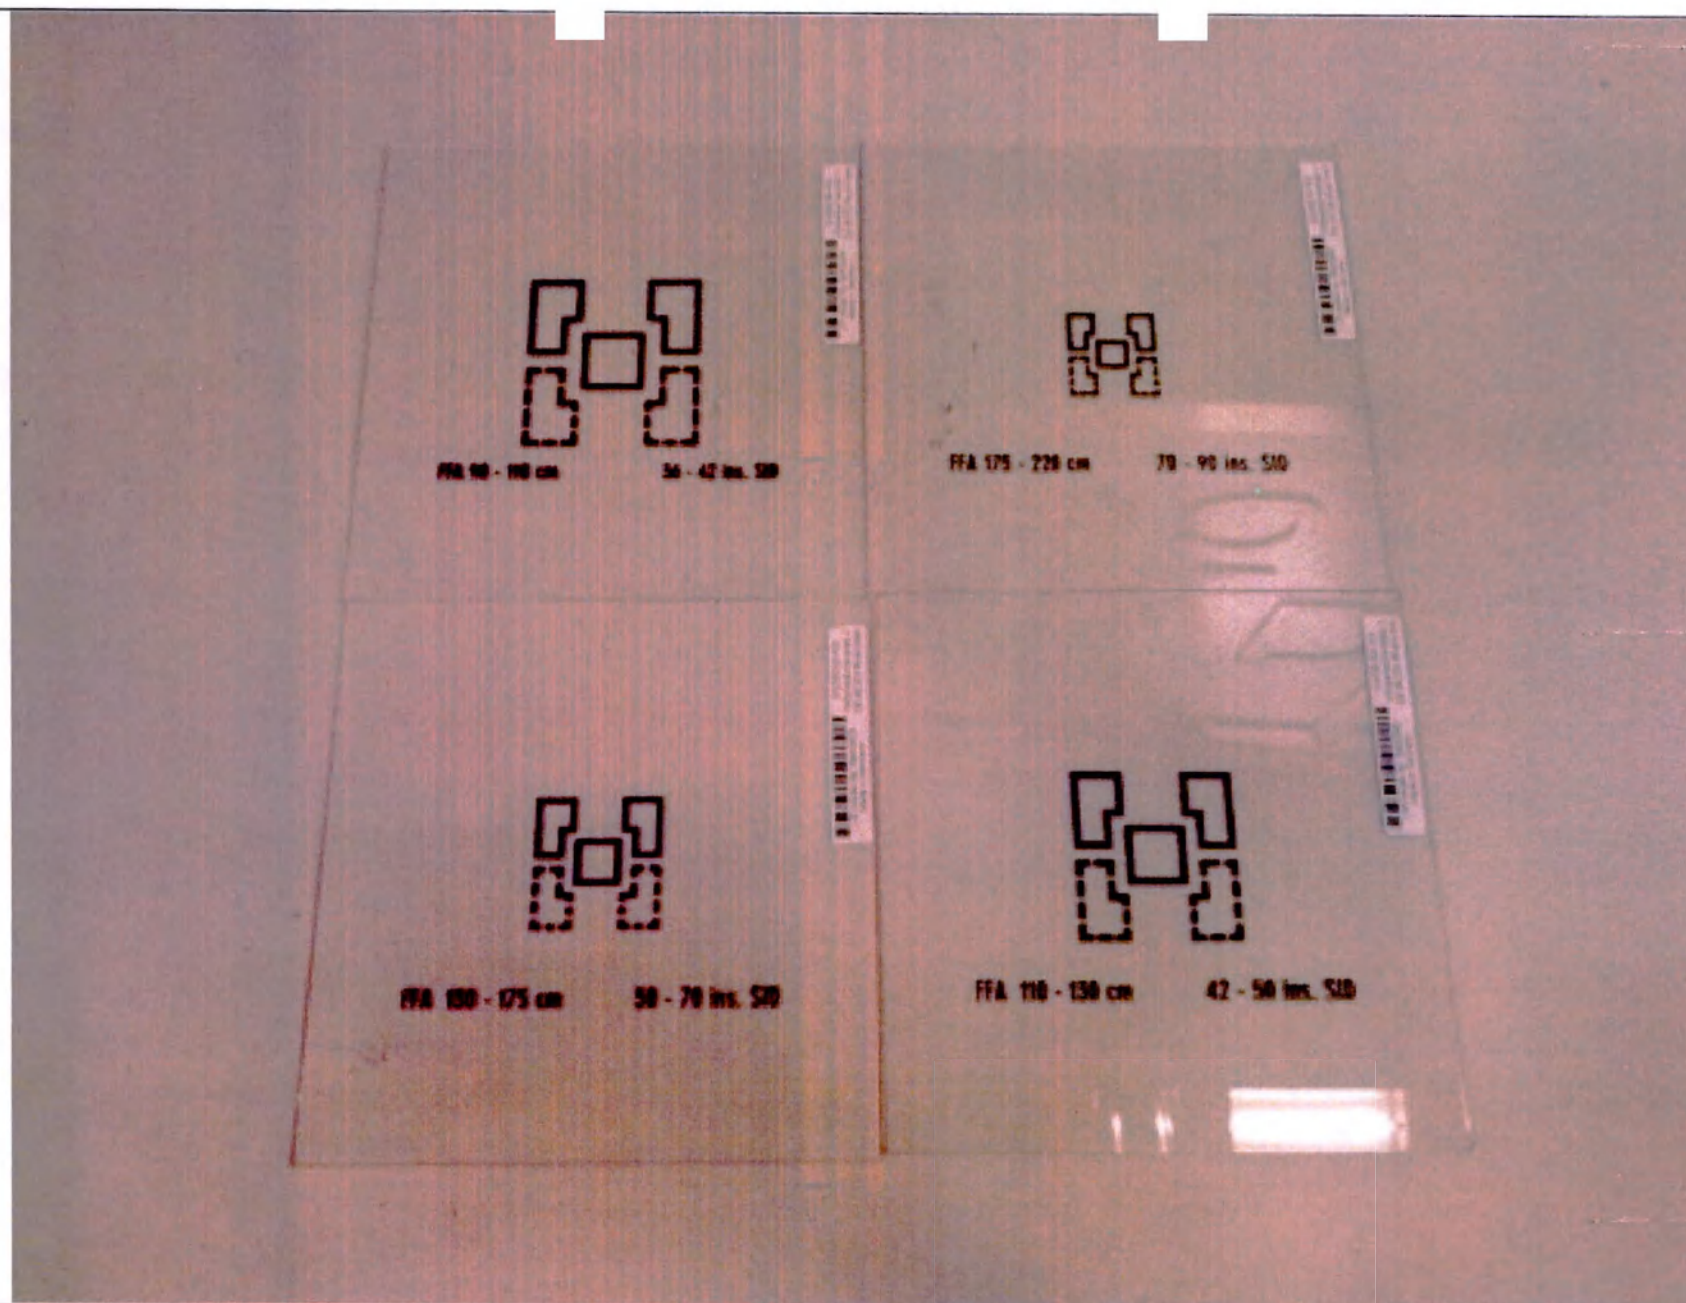

64. Шаблоны трехпольные

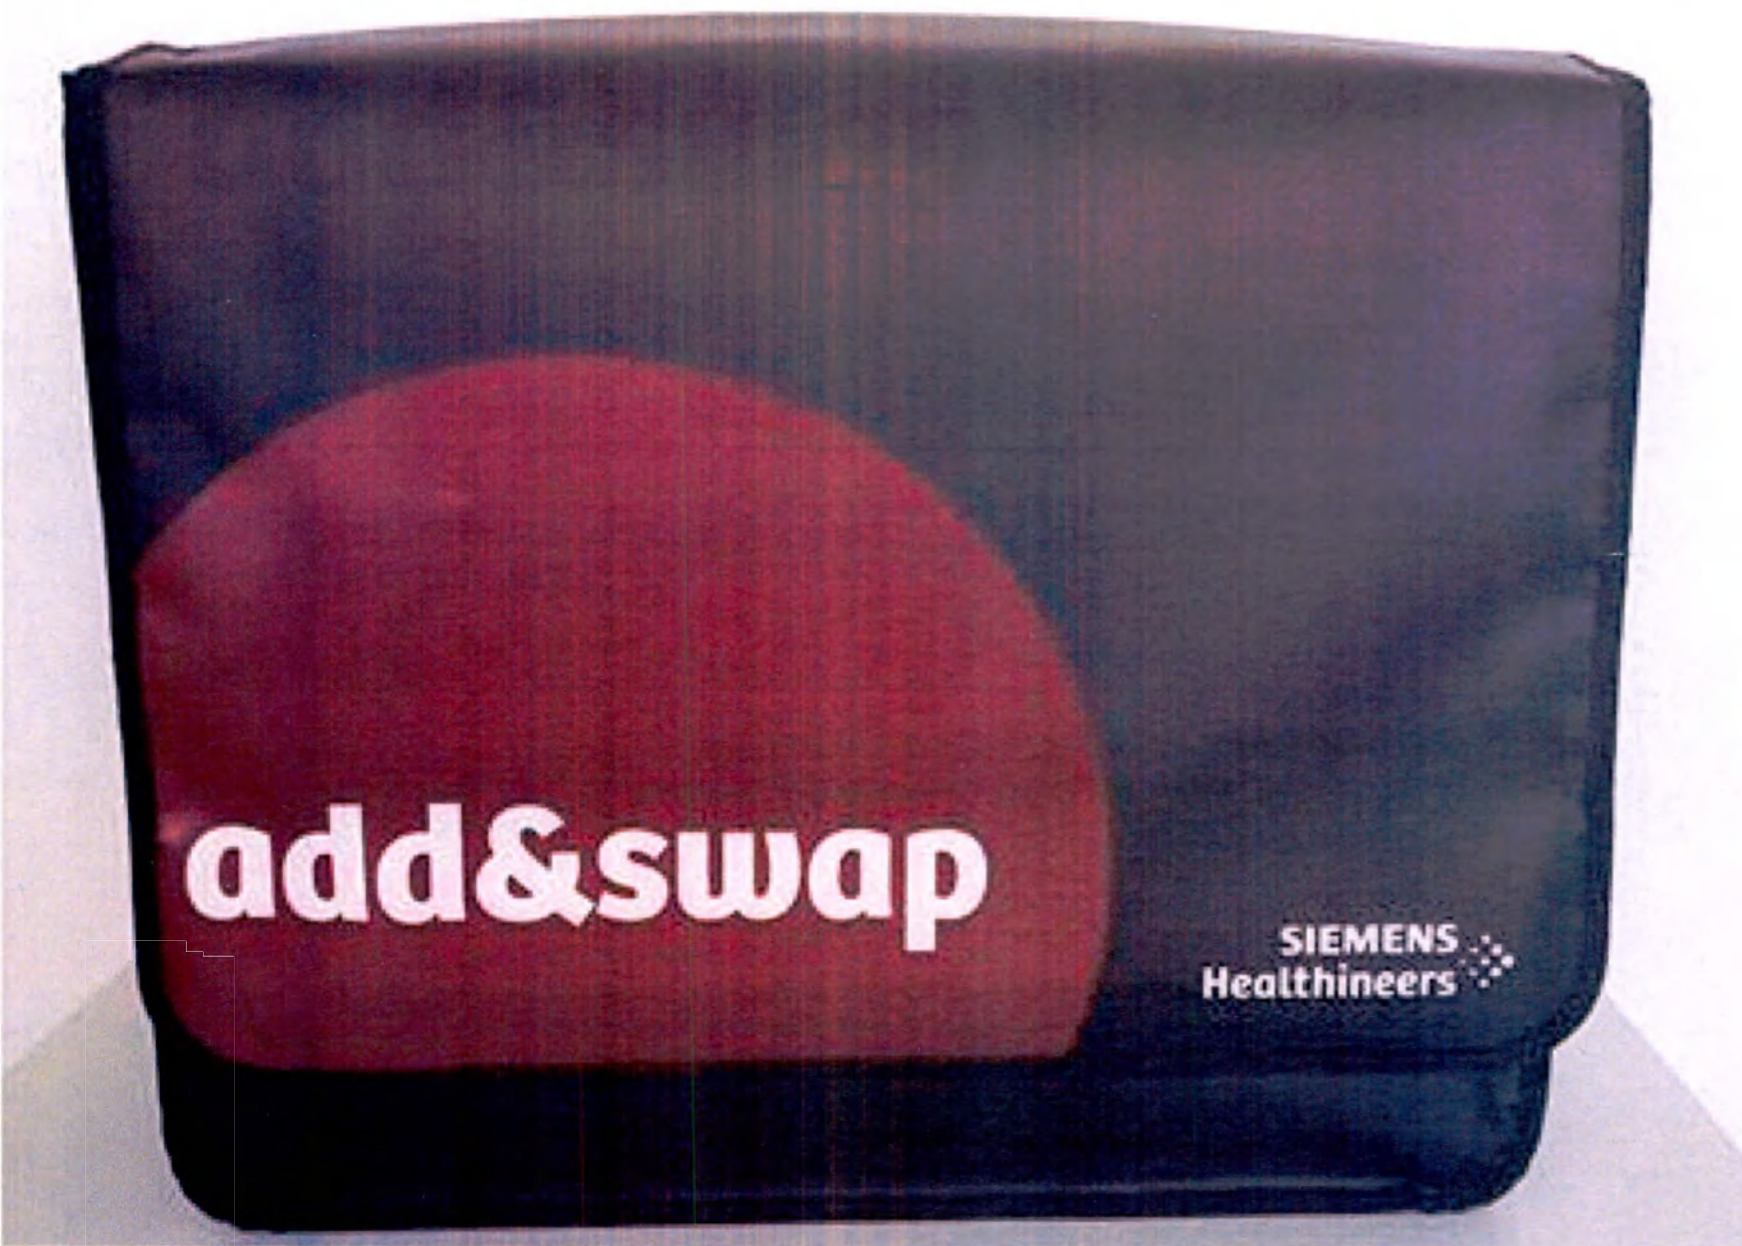


65. Сумка для принадлежностей.




66. Тест – комплект для контроля качества. Включает в себя крепежную пластину, приспособления для установки стойки Букки, Al абсорбента (фиксируемого непосредственно на коллиматоре), направляющие и футляр.




67. Набор принадлежностей для позиционирования: подушка прямоугольная ; клин большой; клин маленький; клин плоский; подушка круглая без отверстия; подушка круглая с отверстием; валик.

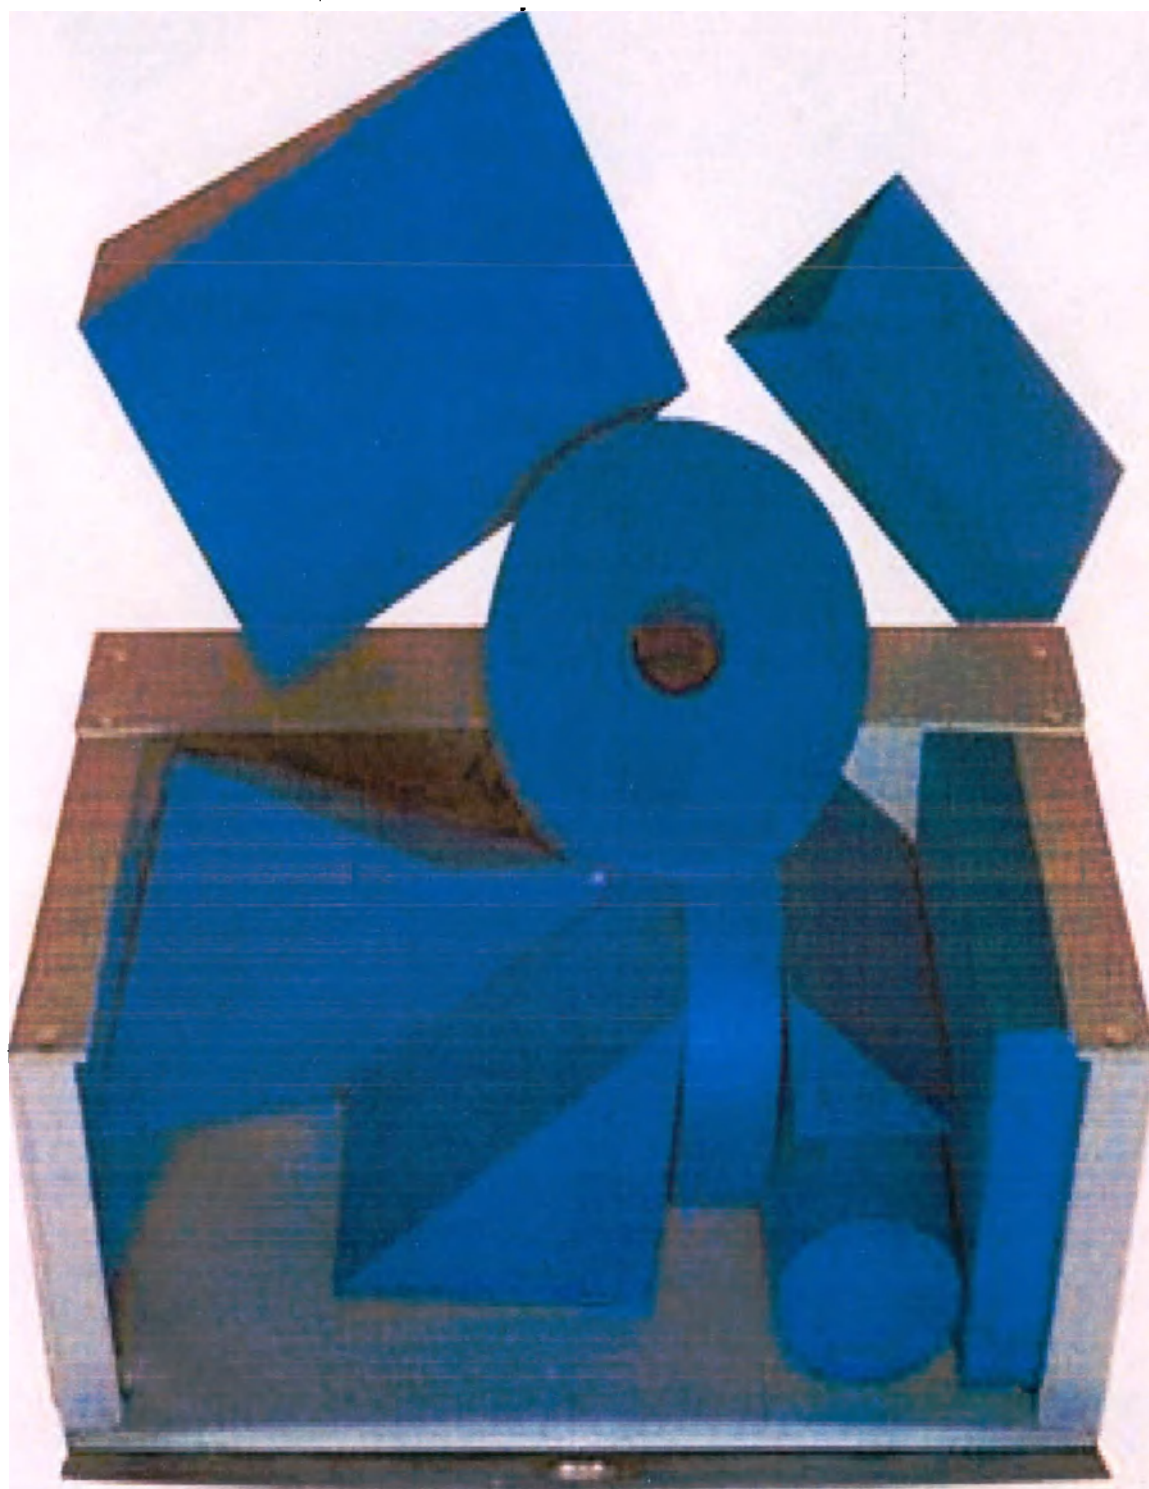


68. Набор принадлежностей для позиционирования с местом для хранения: подушка прямоугольная; клин большой; клин маленький; клин плоский; подушка круглая без отверстия; подушка круглая с отверстием; валик.

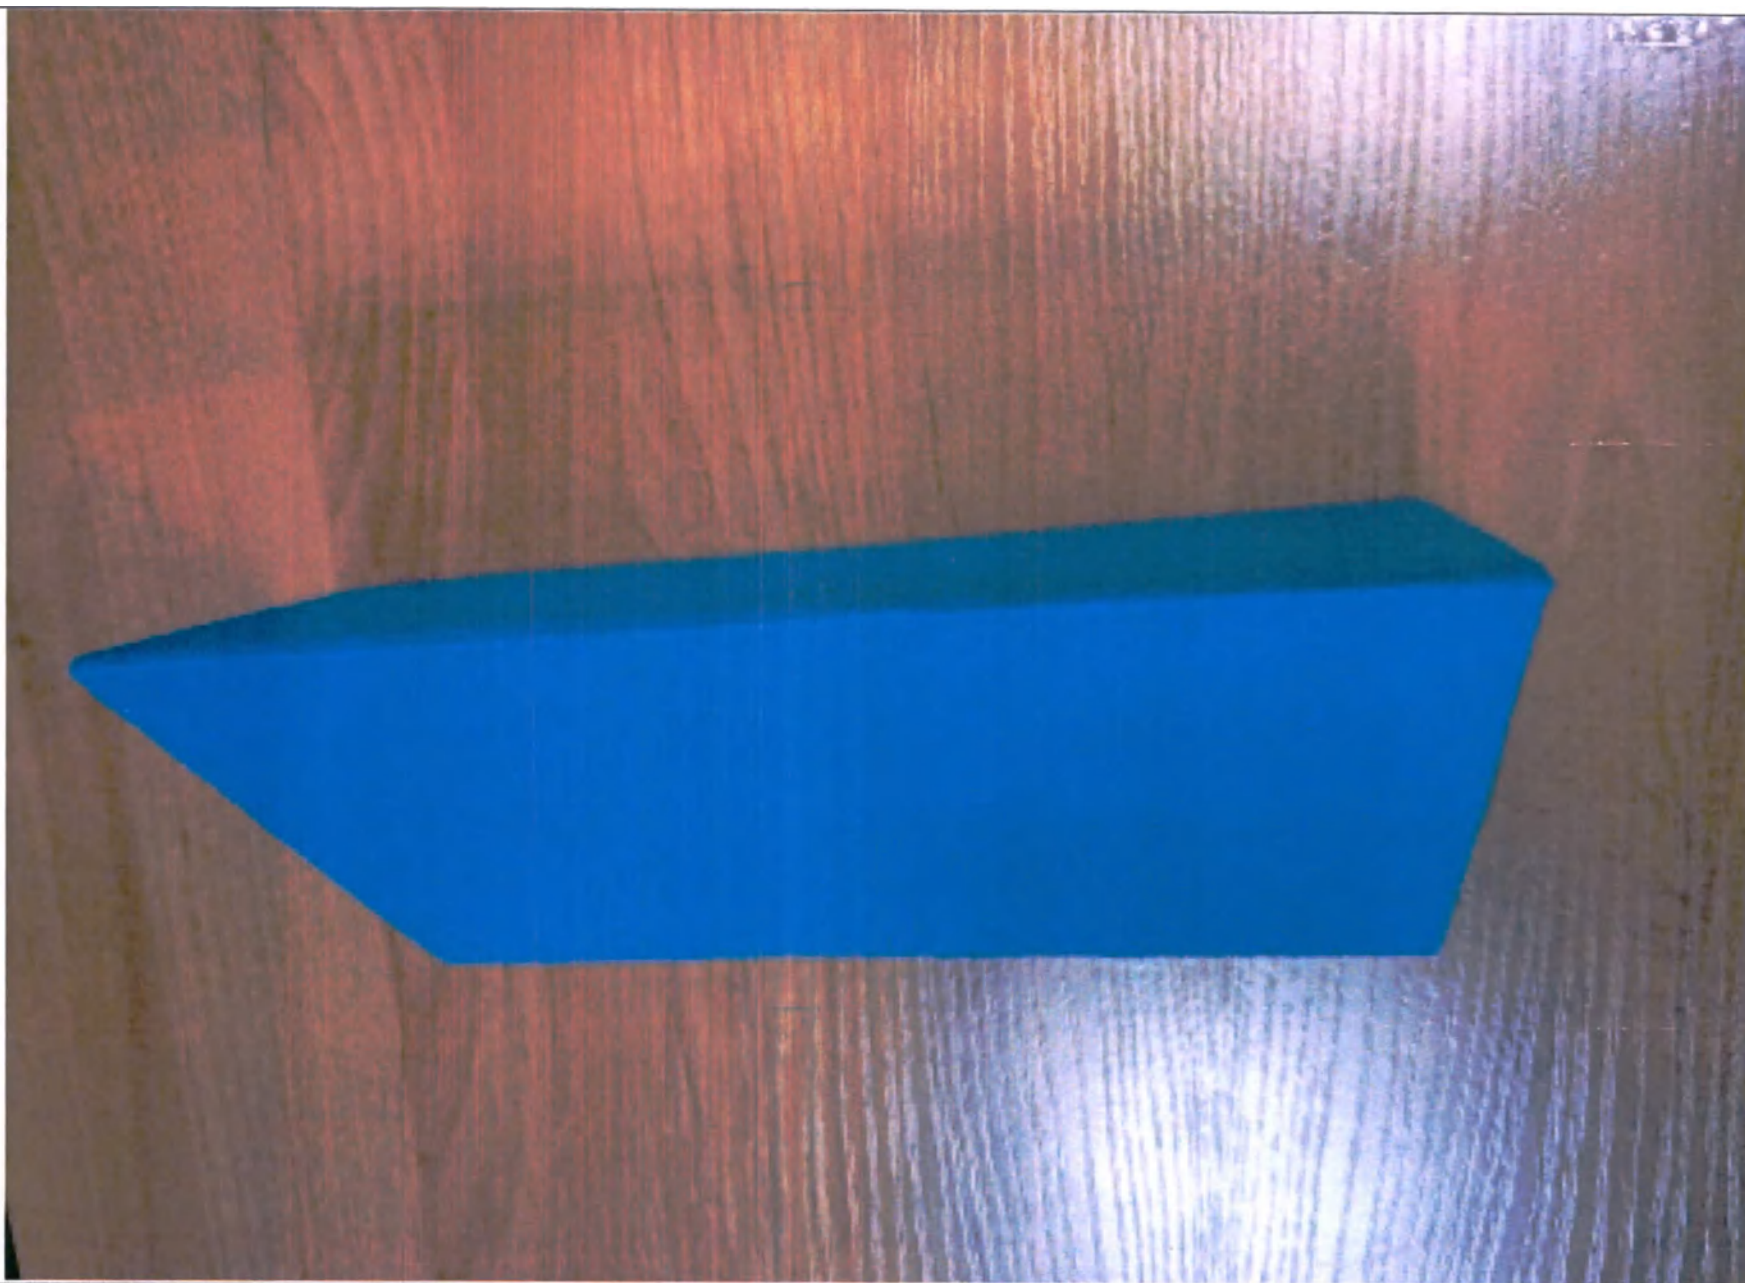

69. Клин маленький

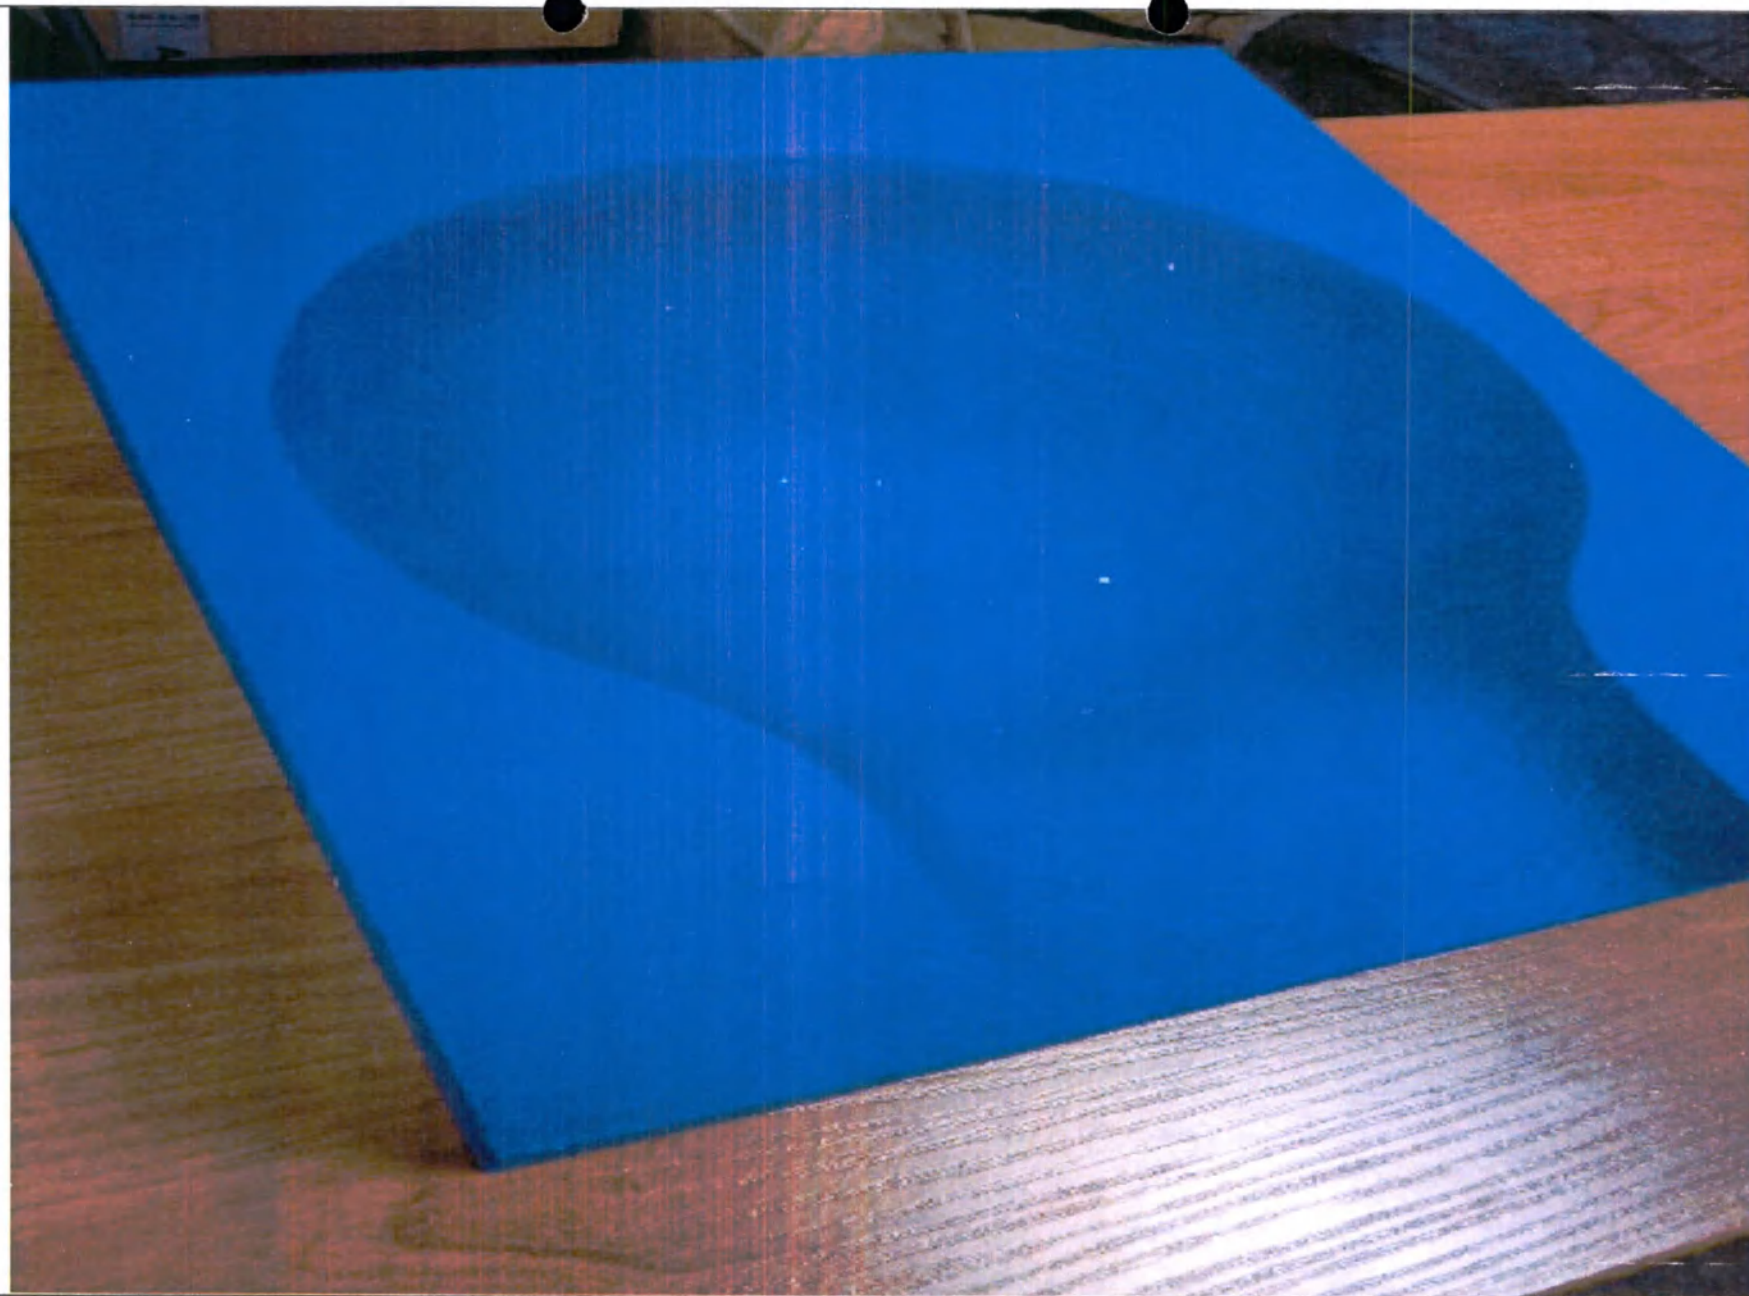


70. Опора для головы (правосторонняя)

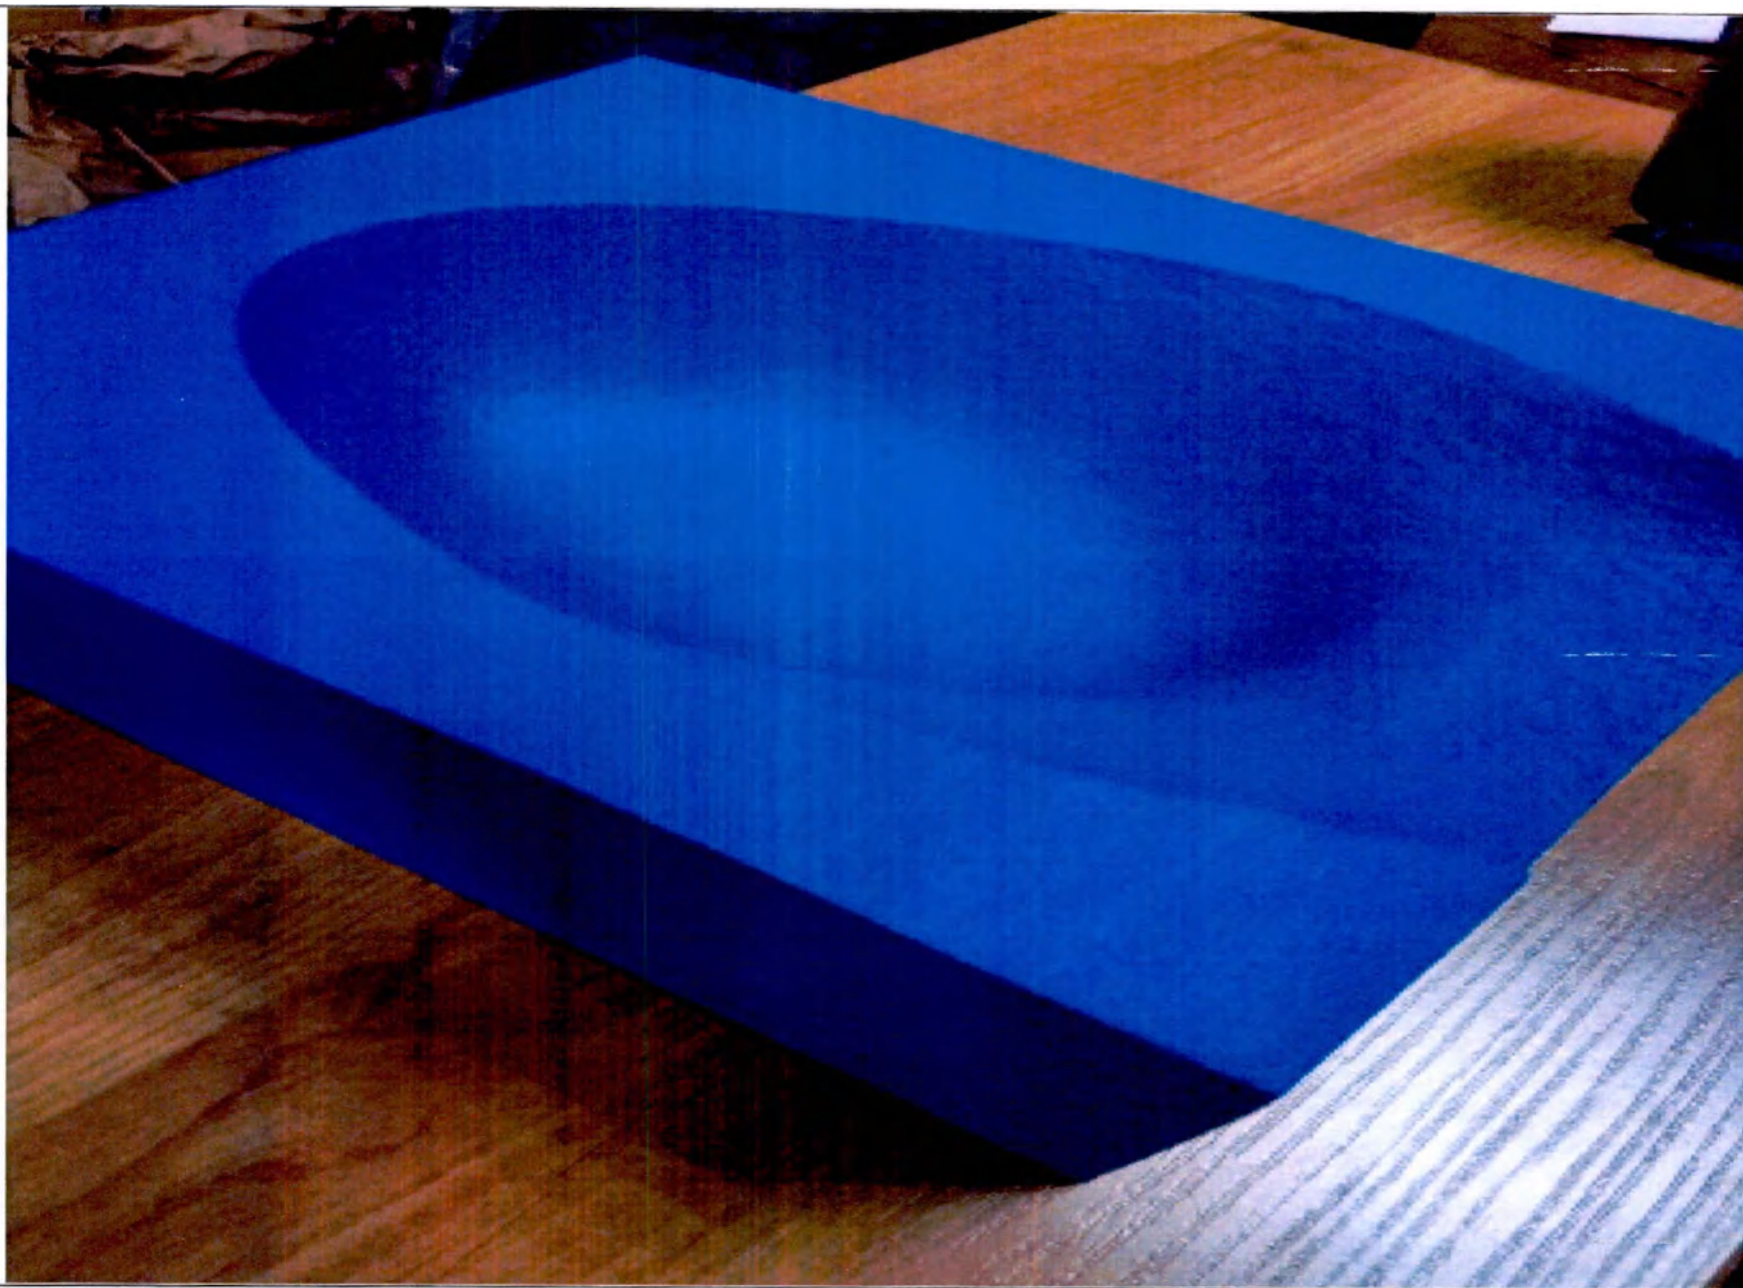

71. Опора для головы (левосторонняя)



72. Покрытие для стола 20 мм

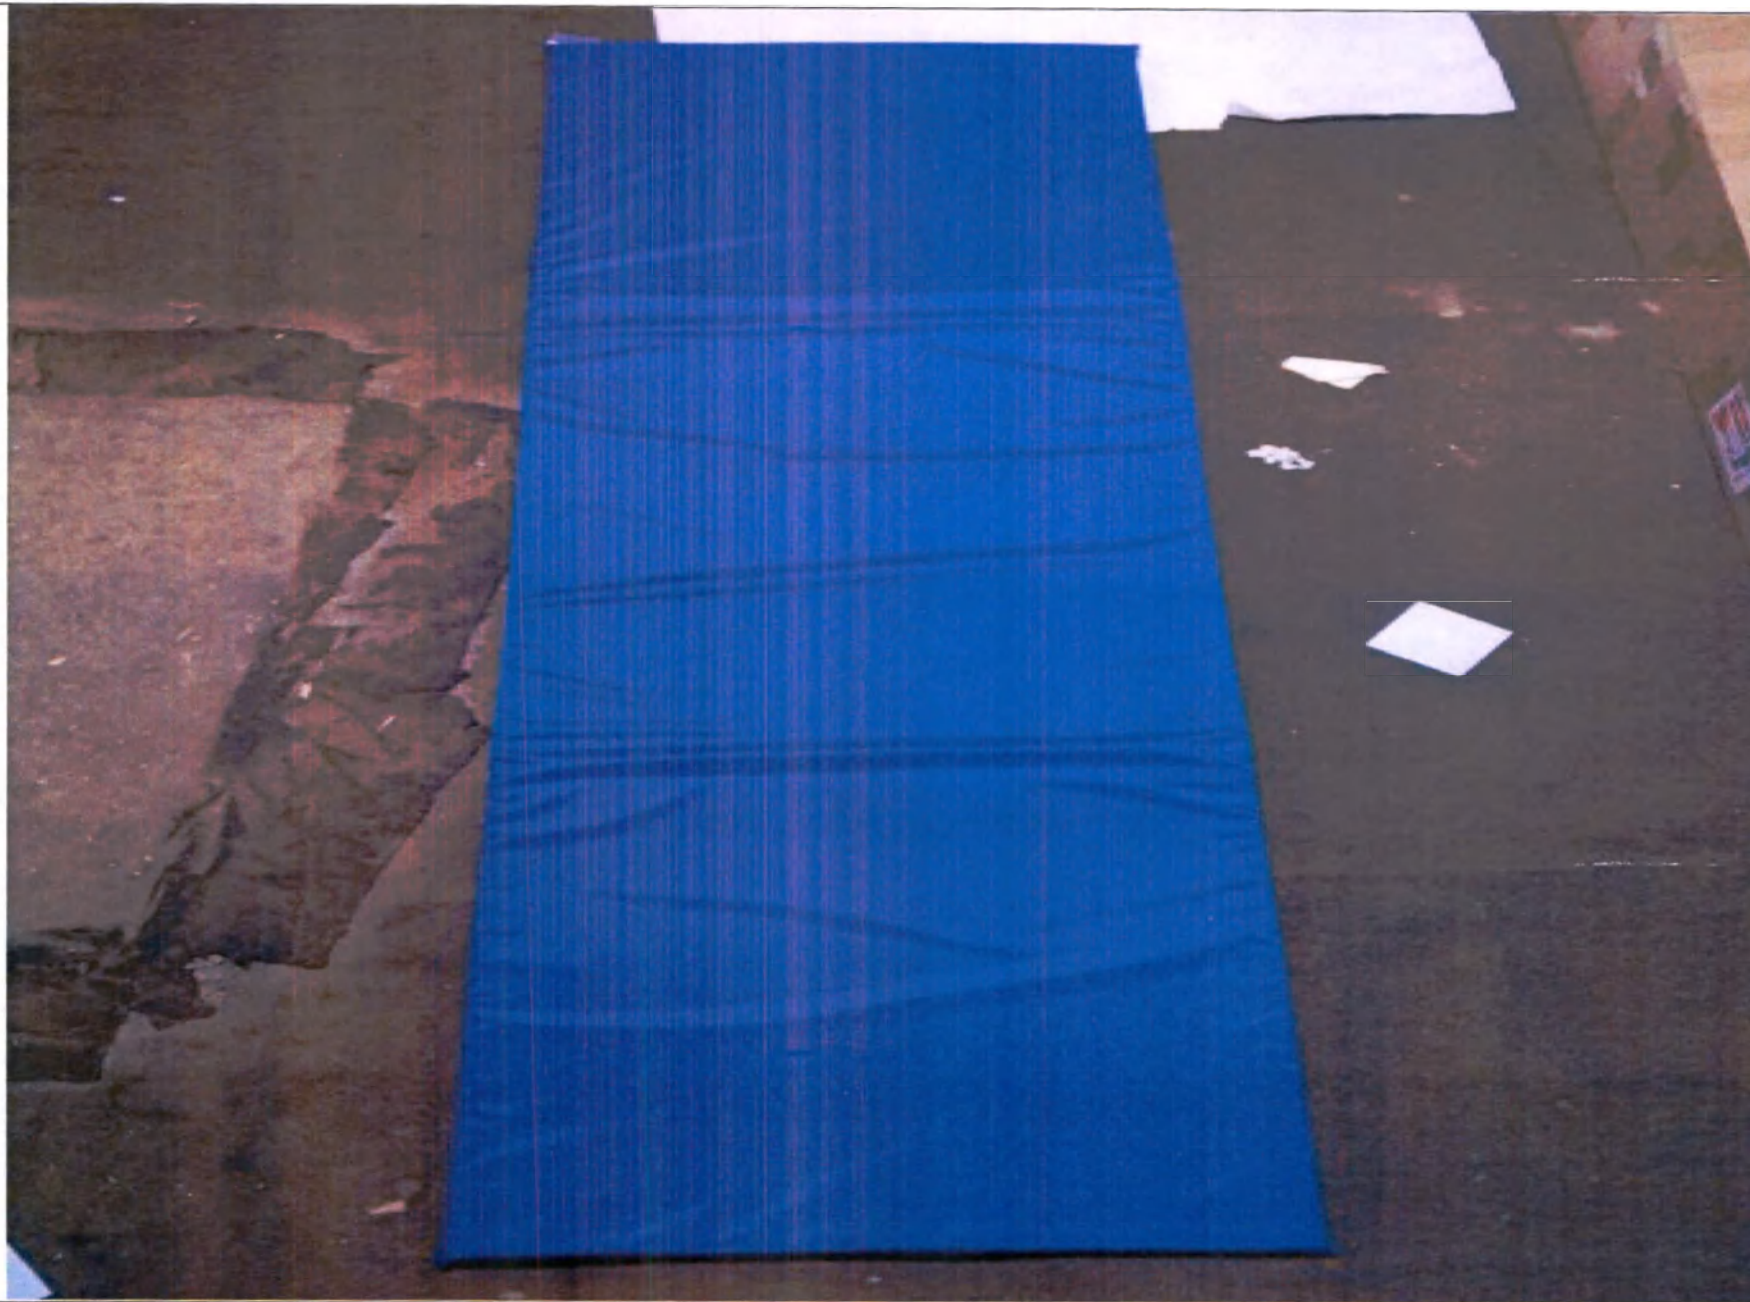

73. Покрытие для стола 30 мм

Система рентгенографическая MUliX Impact с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от dd.мм.гггг

Официальный производитель: 278 Zhou Zhu Road, Bldg. 2, 3, 4, 5, 7, Pudong New Area, Shanghai, P.R.China

Страна производства: Китай

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия.

Назначение: нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие:

массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская., д. 96

~3/PE 380/400/440 В	50/60 Гц	127 кВА / 1,0 кВА
---------------------	----------	-------------------

~3/PE 480 В	60 Гц	127 кВА / 1,0 кВА
-------------	-------	-------------------

Макет маркировки на русском языке



Всего прошито и пронумеровано
60 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

