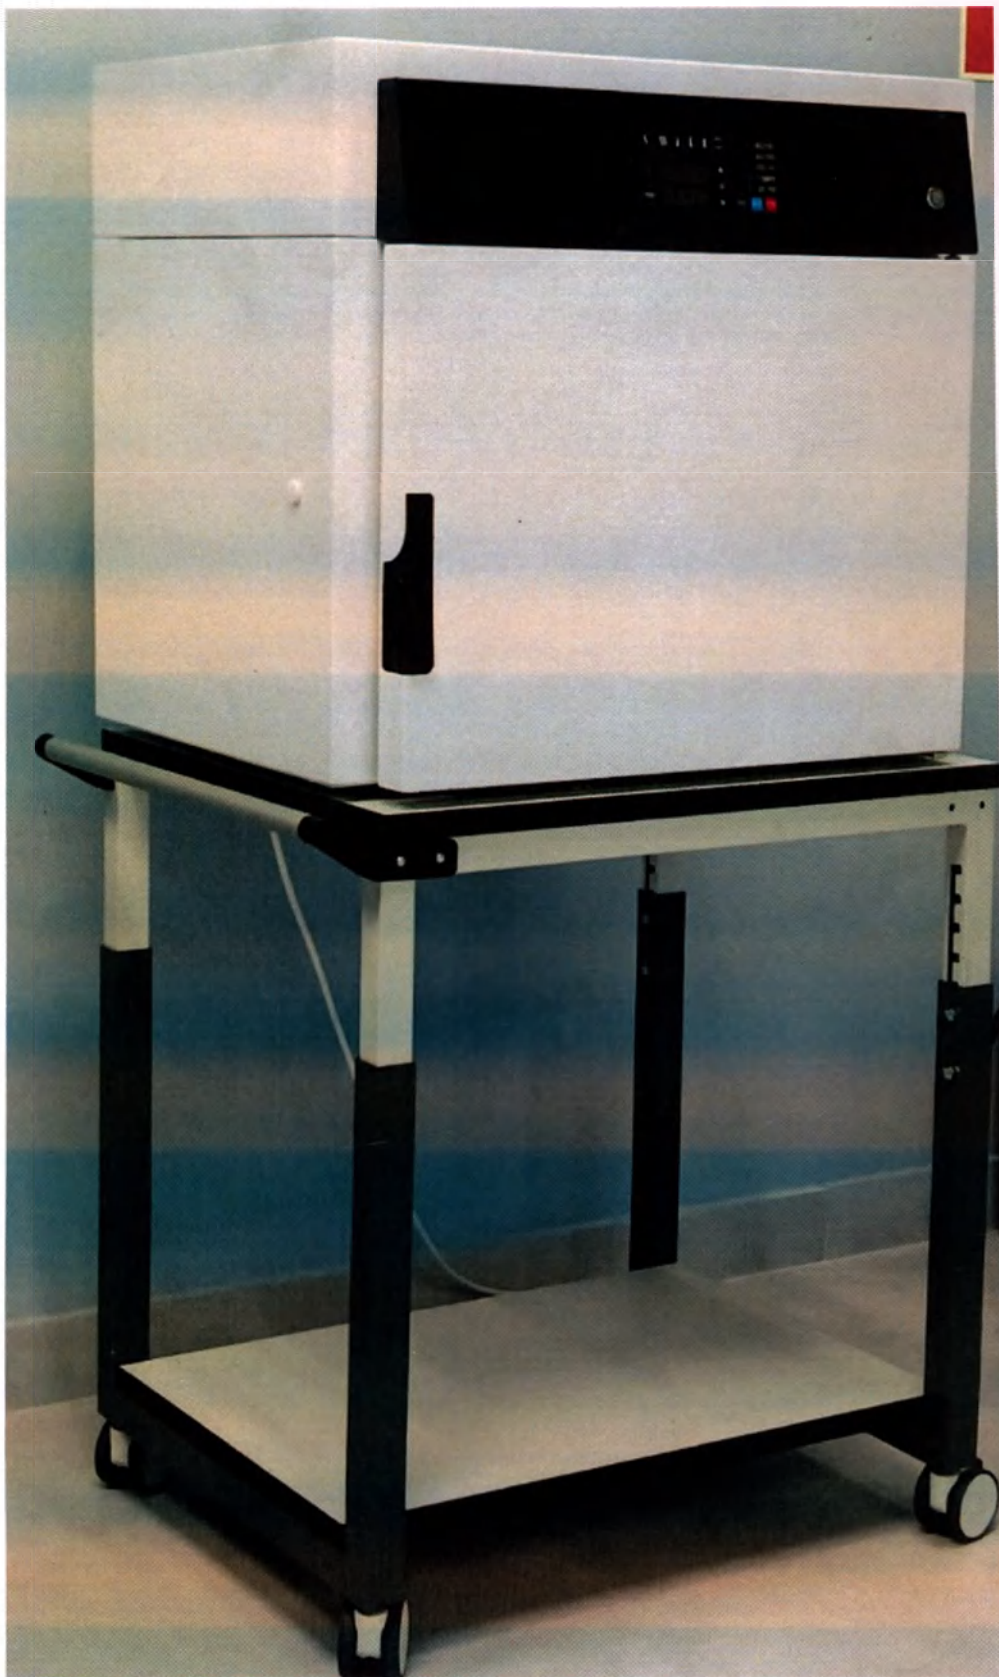
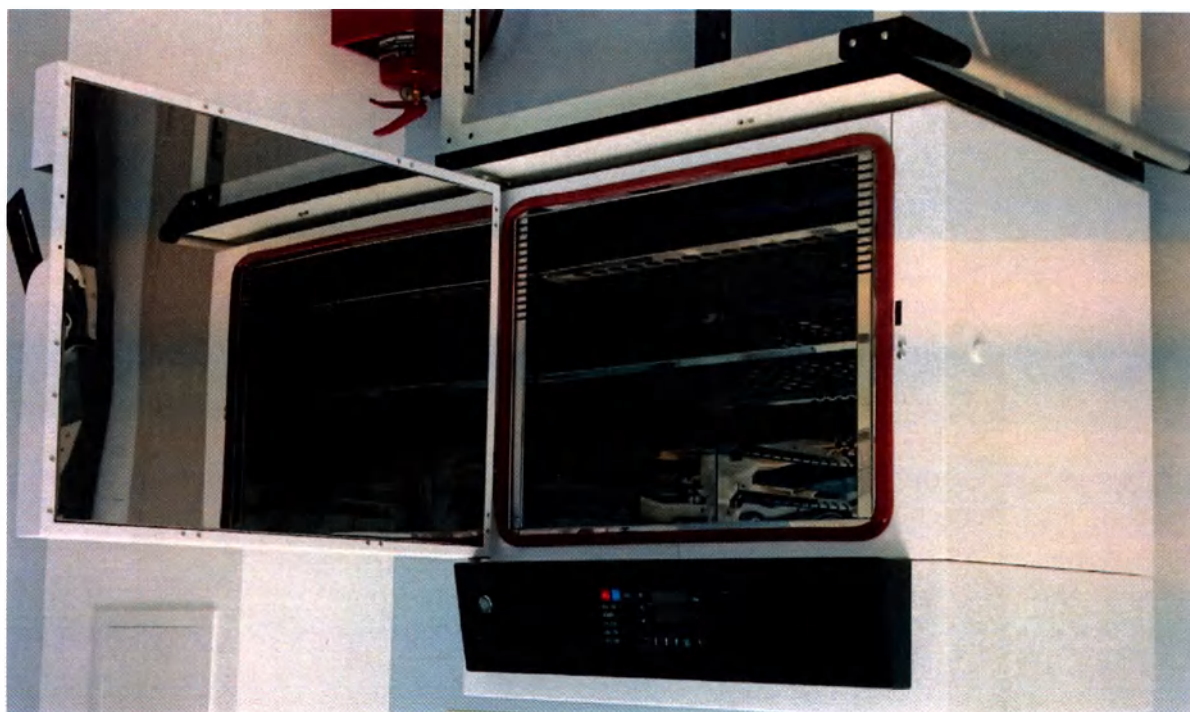


**Фото внешнего вида стерилизатора воздушного
ГП-80 САГА по ТУ 9451-006-36738690-2023»**





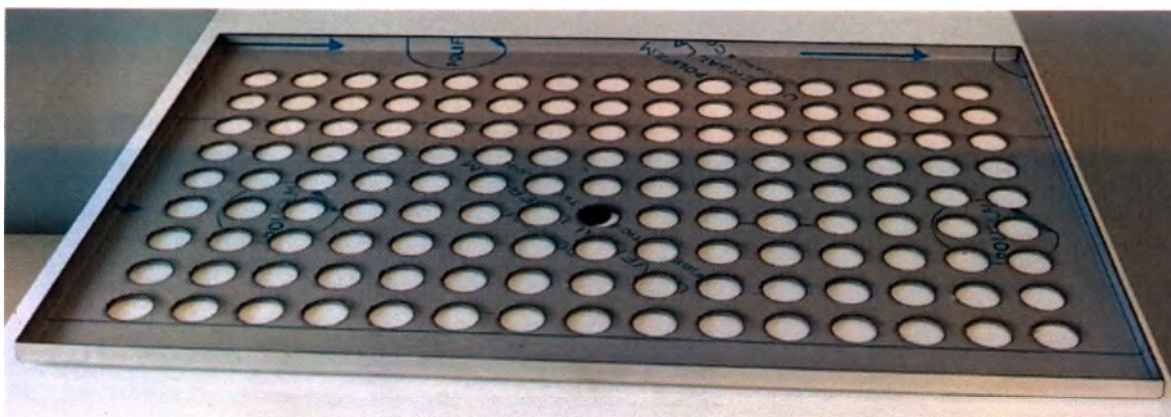


Рисунок А.2 – Маркировка стерилизатора воздушного ГП-80 Сага по ТУ 9451-006-36738690-2023.



Рисунок А.3 – Транспортная упаковка.



АО "ТРАНС-СИГНАЛ"

Стерилизатор воздушный ГП-80 Сага

ТУ 9451-006-36738690-2023

Выполнен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

82,2×62,8×82,3 см

Кол-во 1 шт.

Дата выпуска 03.2023

Зав. № 0001

Брутто 74 кг

Срок службы 10 лет

Упаковщик Берд

Нетто 52 кг

Срок хранения 1 год

Штамп ОТК

03.2023

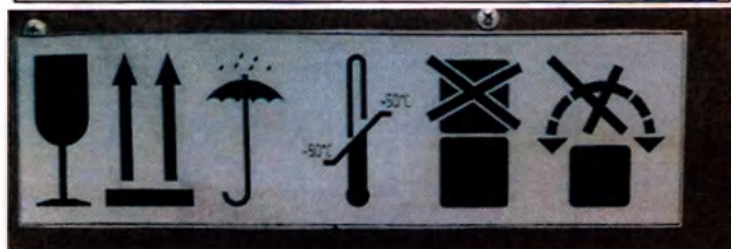


Рисунок А.4 – Маркировка транспортной упаковки.

прошито, пронумеровано,

скреплено печатью

всего

4

/лист

Директор АО «Транс-Сигнал»

Д.М.Евдокимов

