

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие для in vitro диагностики:

«Тест-полоски BioHermes® для количественного определения уровня глюкозы в цельной крови электрохимическим методом на анализаторе BioHermes® GluCoA1c (BioHermes® GluCoA1c blood Glucose Test Strips)»

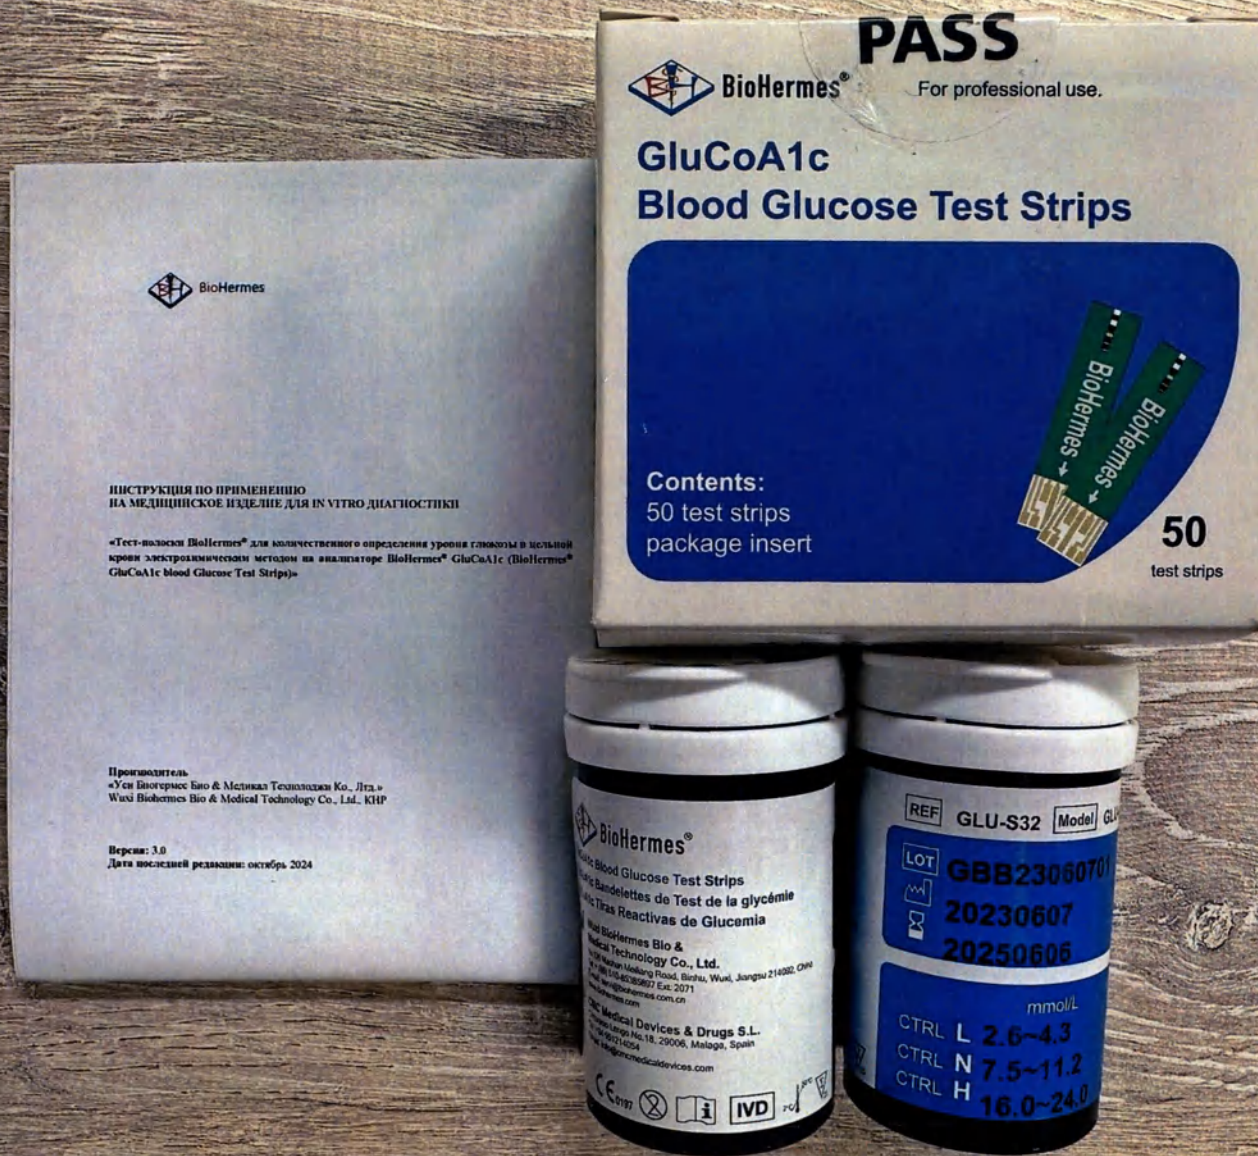


Рисунок 1. Общий вид МИ



Рисунок 2. Внешний вид потребительской упаковки медицинского изделия

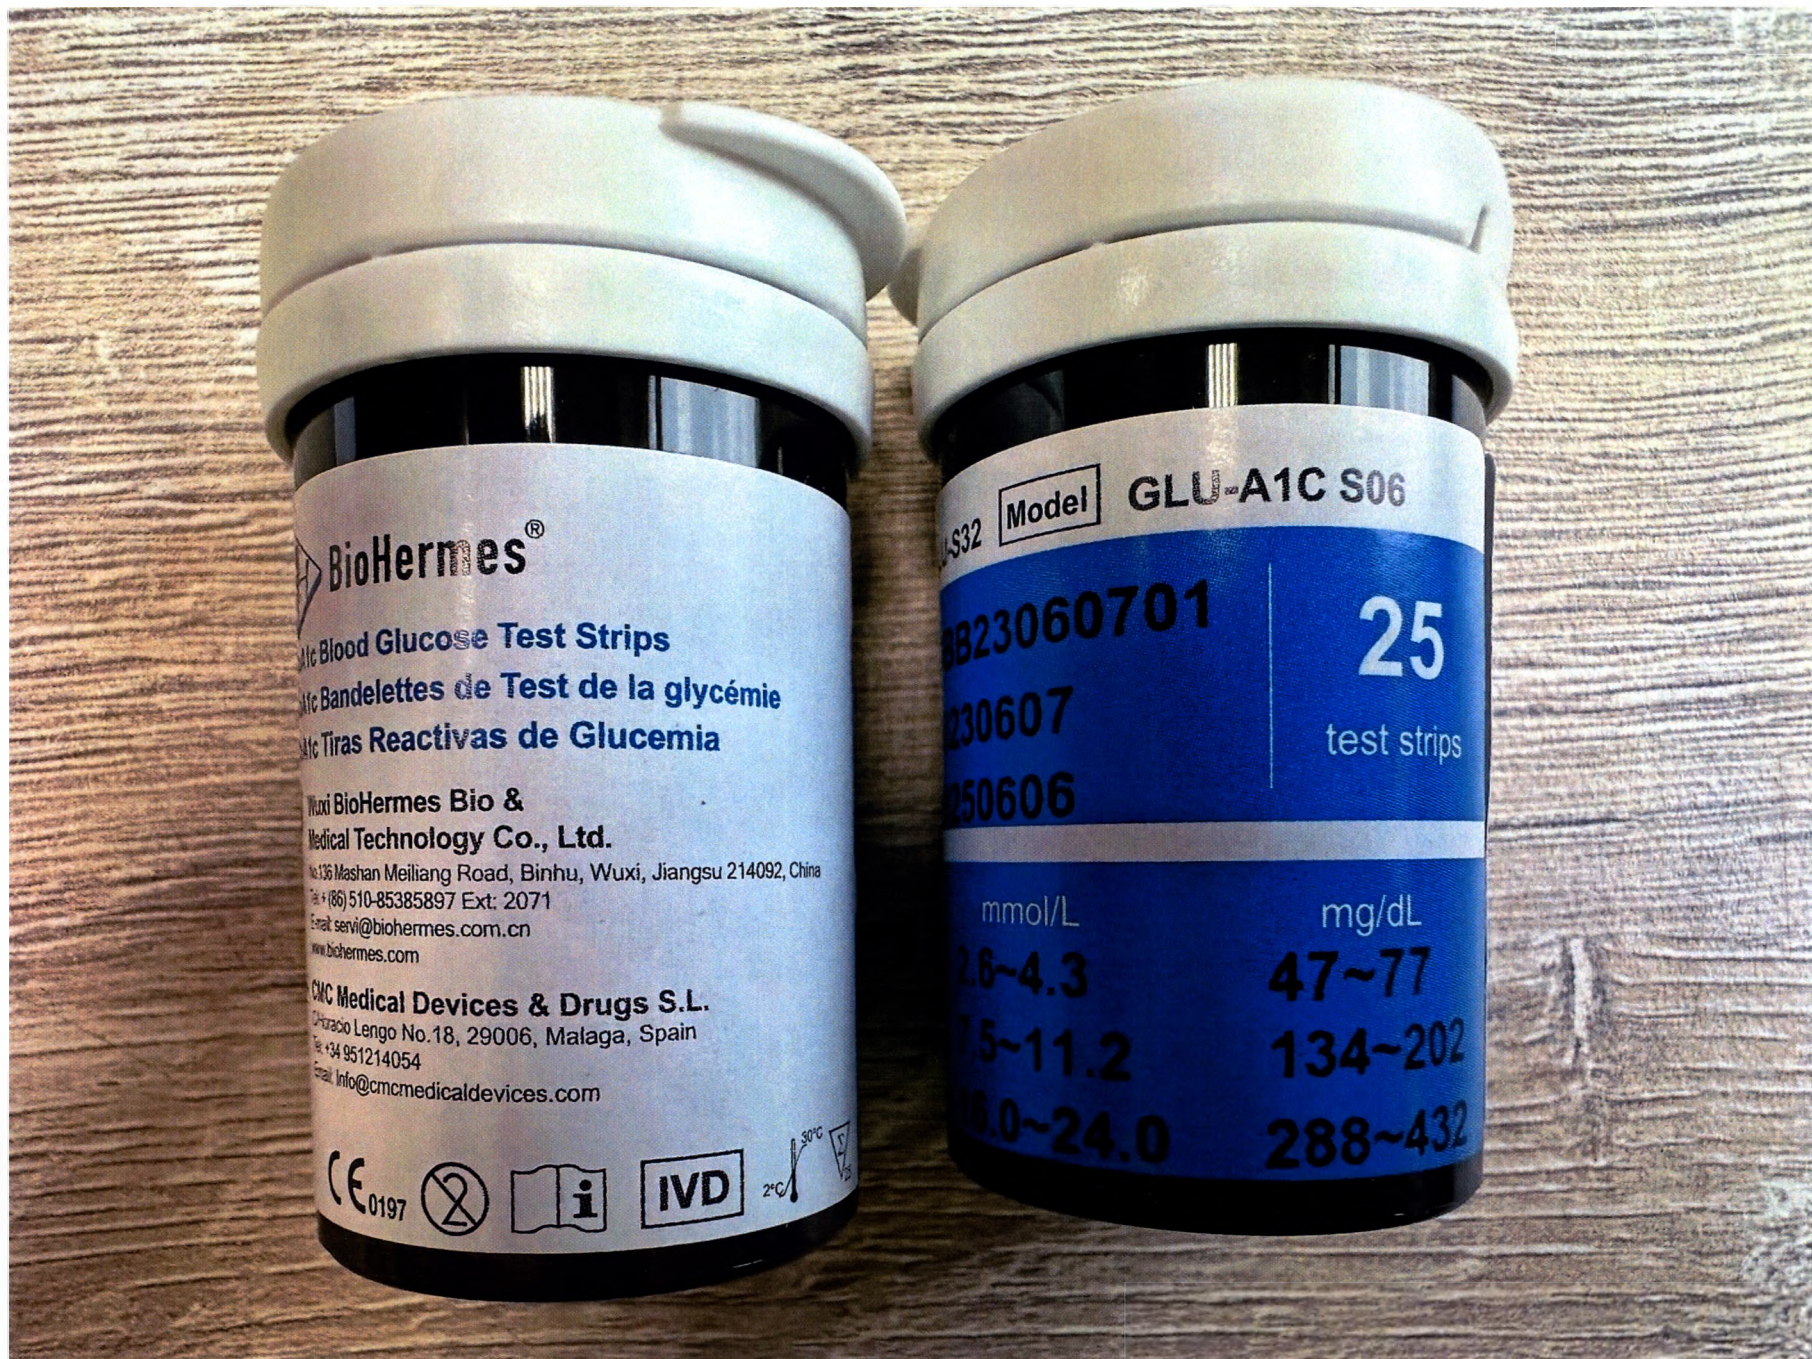


Рисунок 3. Внешний вид первичной упаковки Тест-полосок BioHermes® GluCoA1c blood Glucose Test Strips

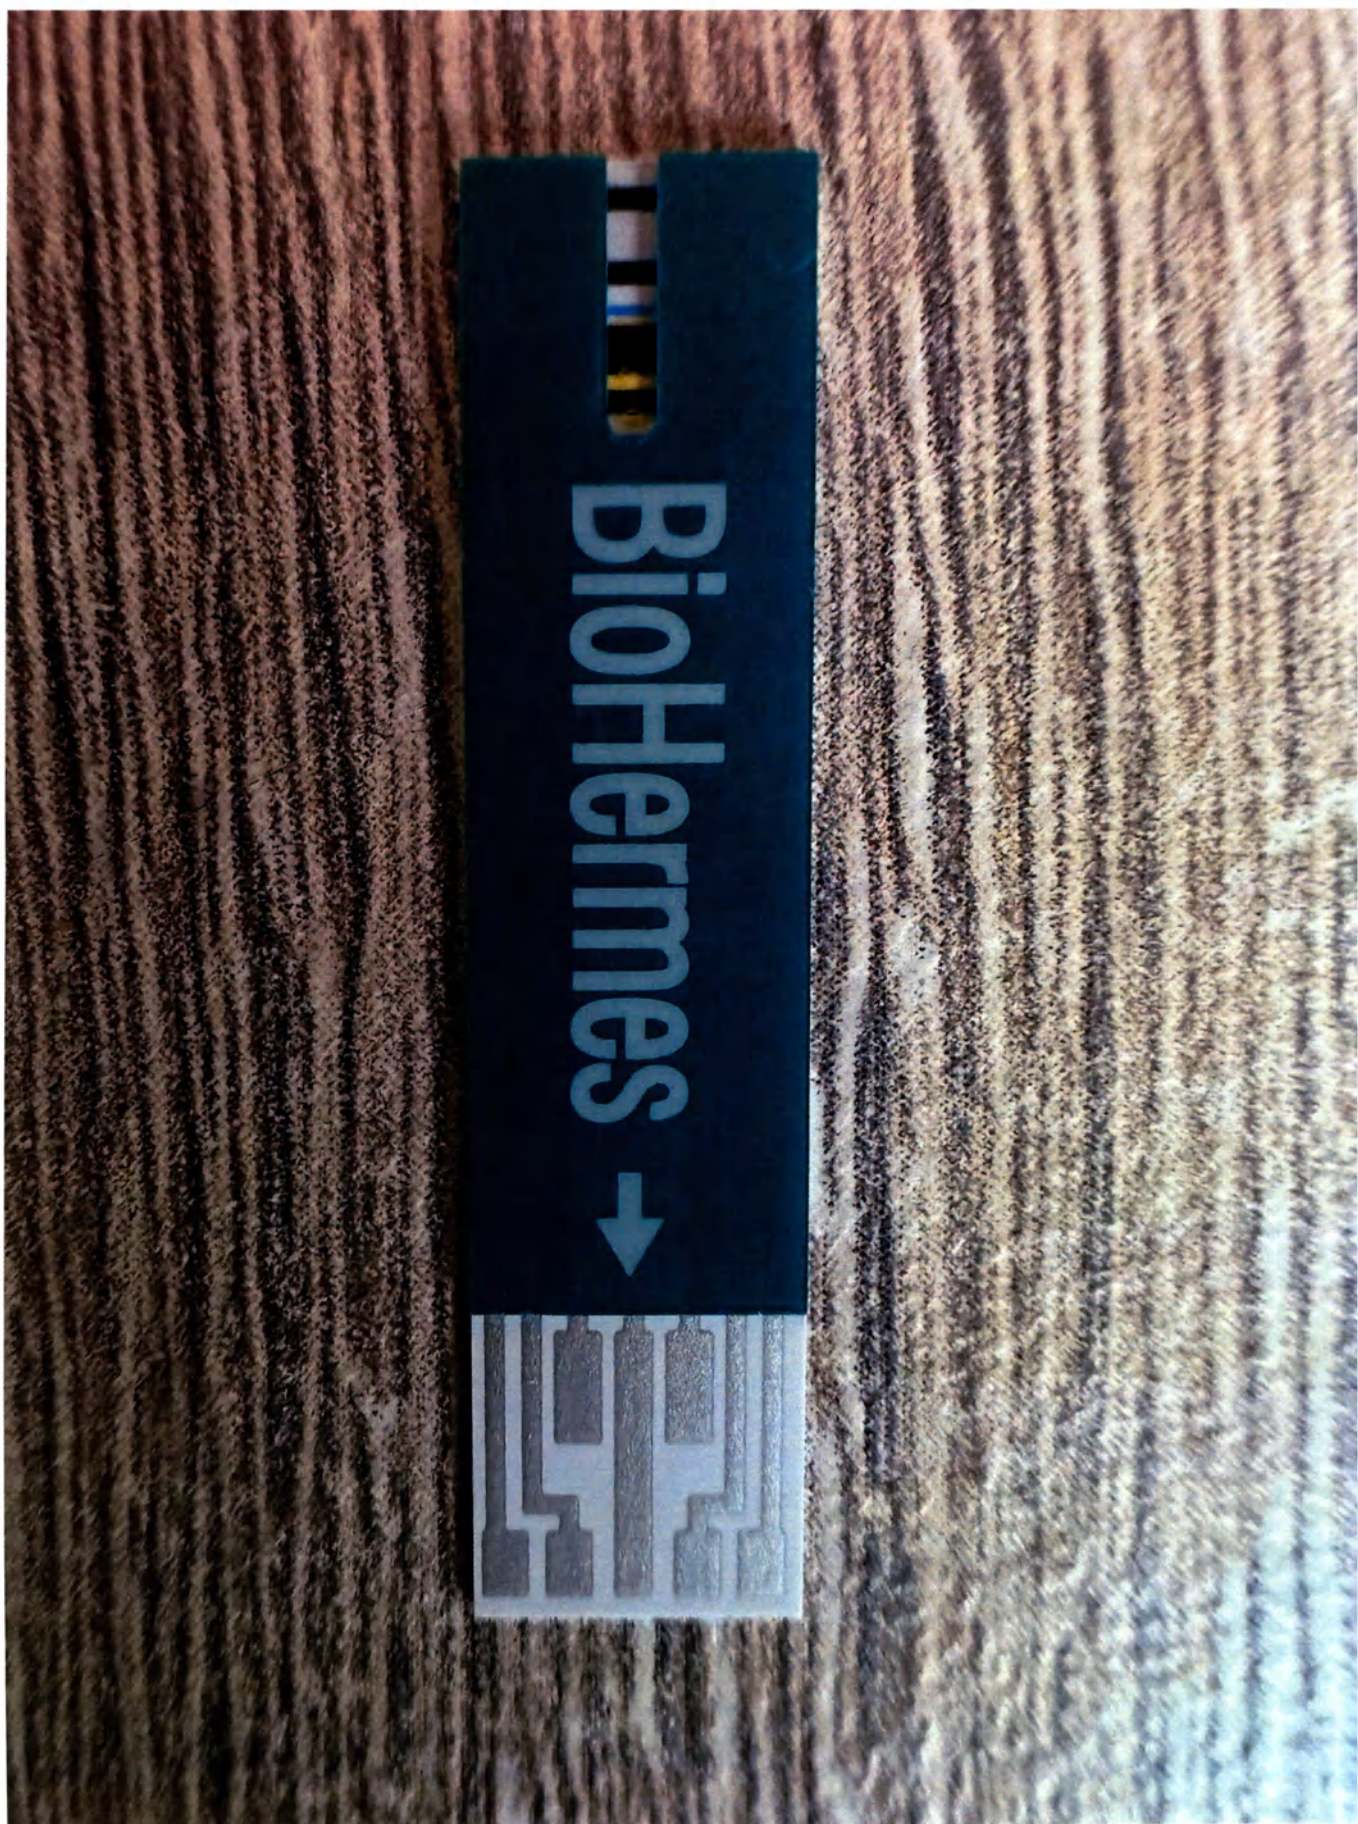


Рисунок 4. Внешний вид Тест-полоски BioHermes® (GluCoA1c blood Glucose Test Strips)

Тест-полоски BioHermes® для количественного определения уровня глюкозы в цельной крови электрохимическим методом на анализаторе BioHermes® GluCoA1c (BioHermes® GluCoA1c blood Glucose Test Strips)

Состав:

1. Тест-полоска BioHermes® (GluCoA1c blood Glucose Test Strips) – 2 x 25 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

РУ № РЗН 2024/22807 от

Производитель: "Уси Биогермес Био & Медикал Технолоджи Ко., Лтд.", КНР

Место производства:

1. No.88 Mashan Meiliang Road, Binhu, Wuxi 214092 Jiangsu P.R. China
2. No.136 Mashan Meiliang Road, Binhu, Wuxi 214092 Jiangsu P.R. China
3. 11th Floor, 530 Mansion, #18 Qingyan Road, Xinwu District Wuxi 214135 Jiangsu P.R. China

УПП / Организация, принимающая претензии: ООО "КардиоМед"

Адрес: 119285, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, километр МЖД Киевское 5-й. дом 1, строение 1, помещение 32/1

Тел.: +7 (495)-955-52-58.

Адрес электронной почты: info@cardiomed.ru

Рисунок 5. Дополнительная маркировка потребительской упаковки на русском языке

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
6 ЛИСТОВ

