

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»




Н.Н. Перцева

«28» августа 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов для количественного определения антимюллерова гормона в сыворотке крови человека (AMH CLIA Microparticles (AMH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 50*2 тестов

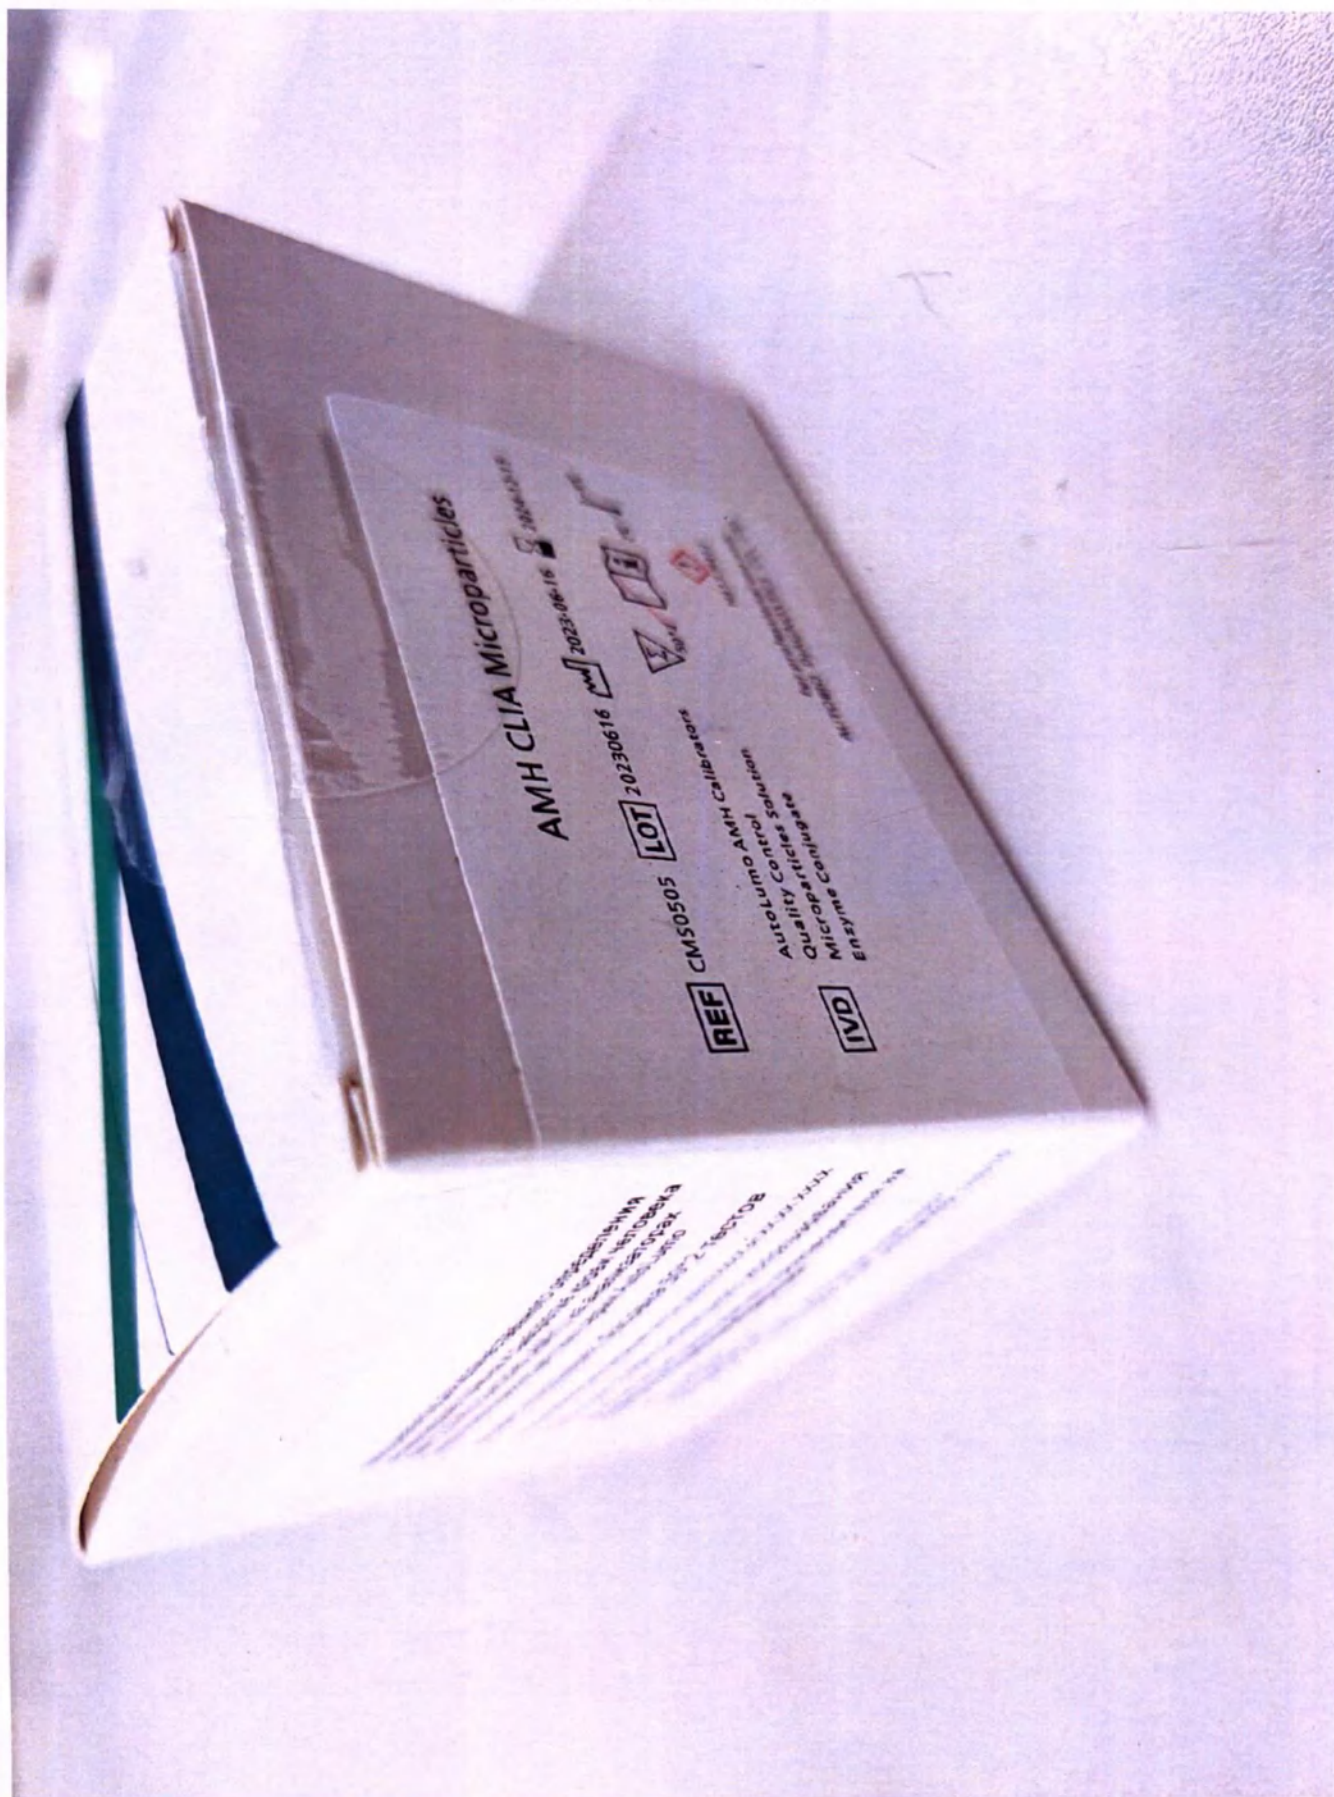

Фотография набора реагентов ДО вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 100 тестов


Набор реагентов для количественного определения
антимюллера гормона в сыворотке крови человека
(AMH CLIA Microparticles (AMH)) на анализаторах
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов


Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования
Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/18/10

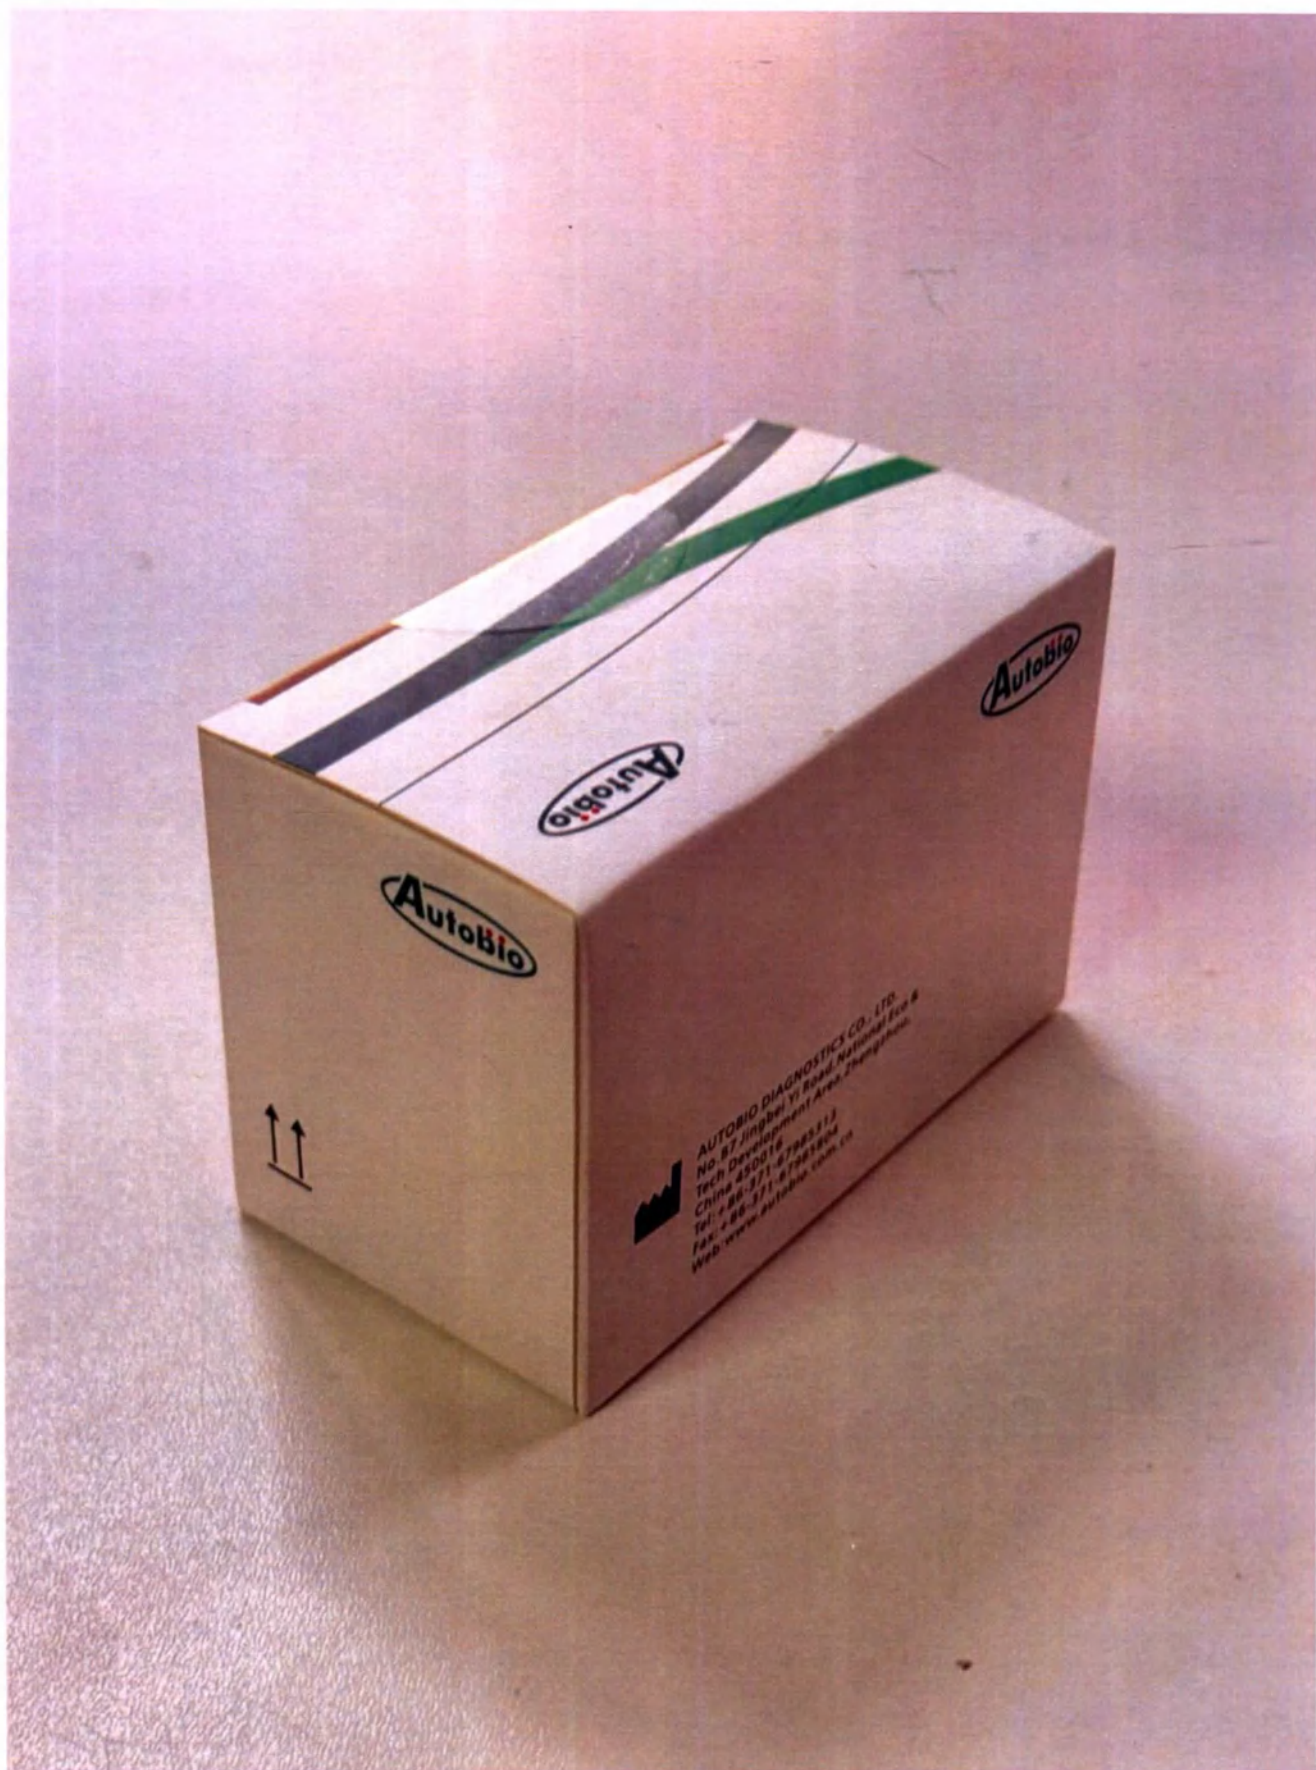


Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 50*2 тестов

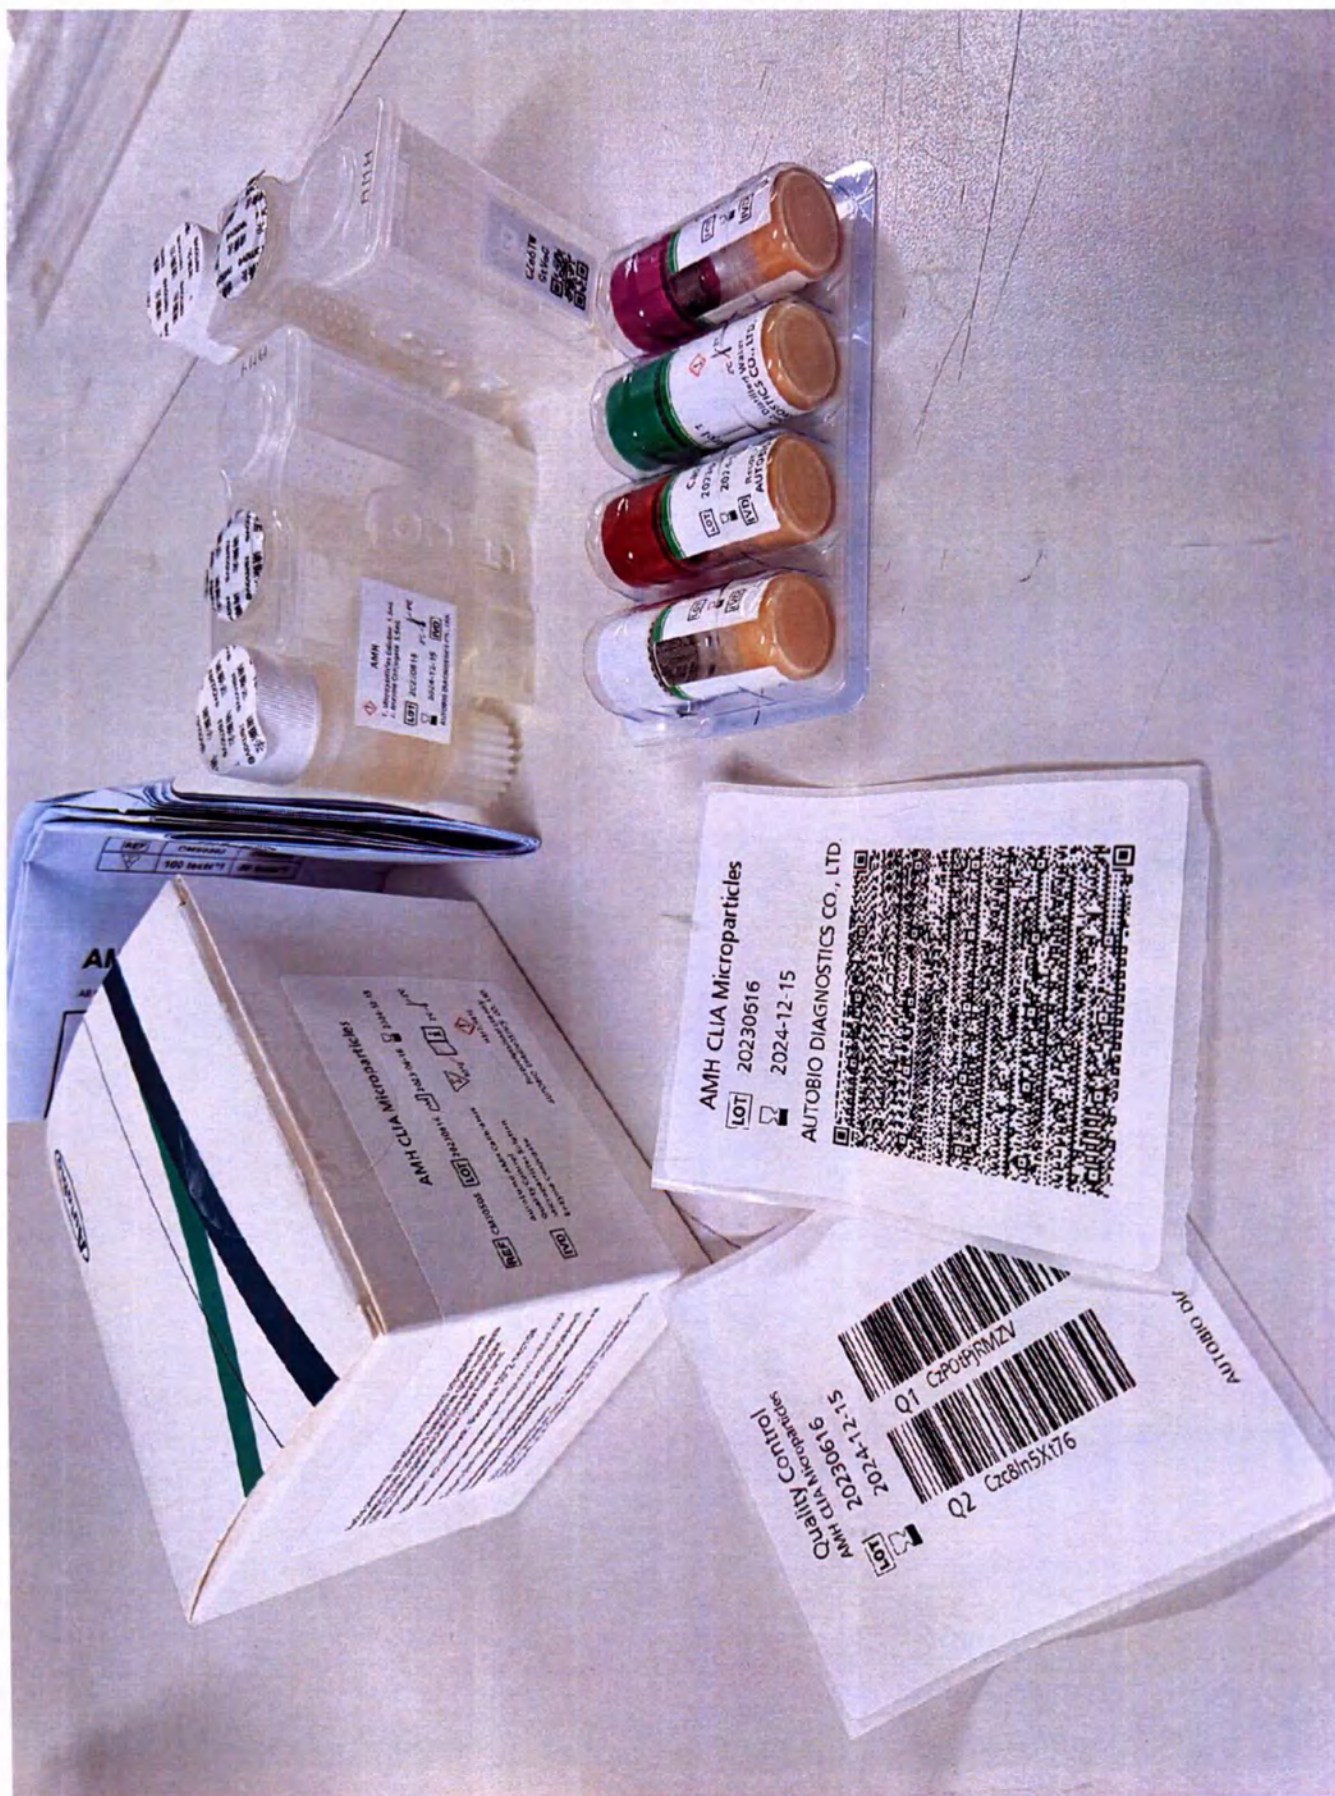


Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 100 тестов



Фото калибраторов низкого и высокого уровней

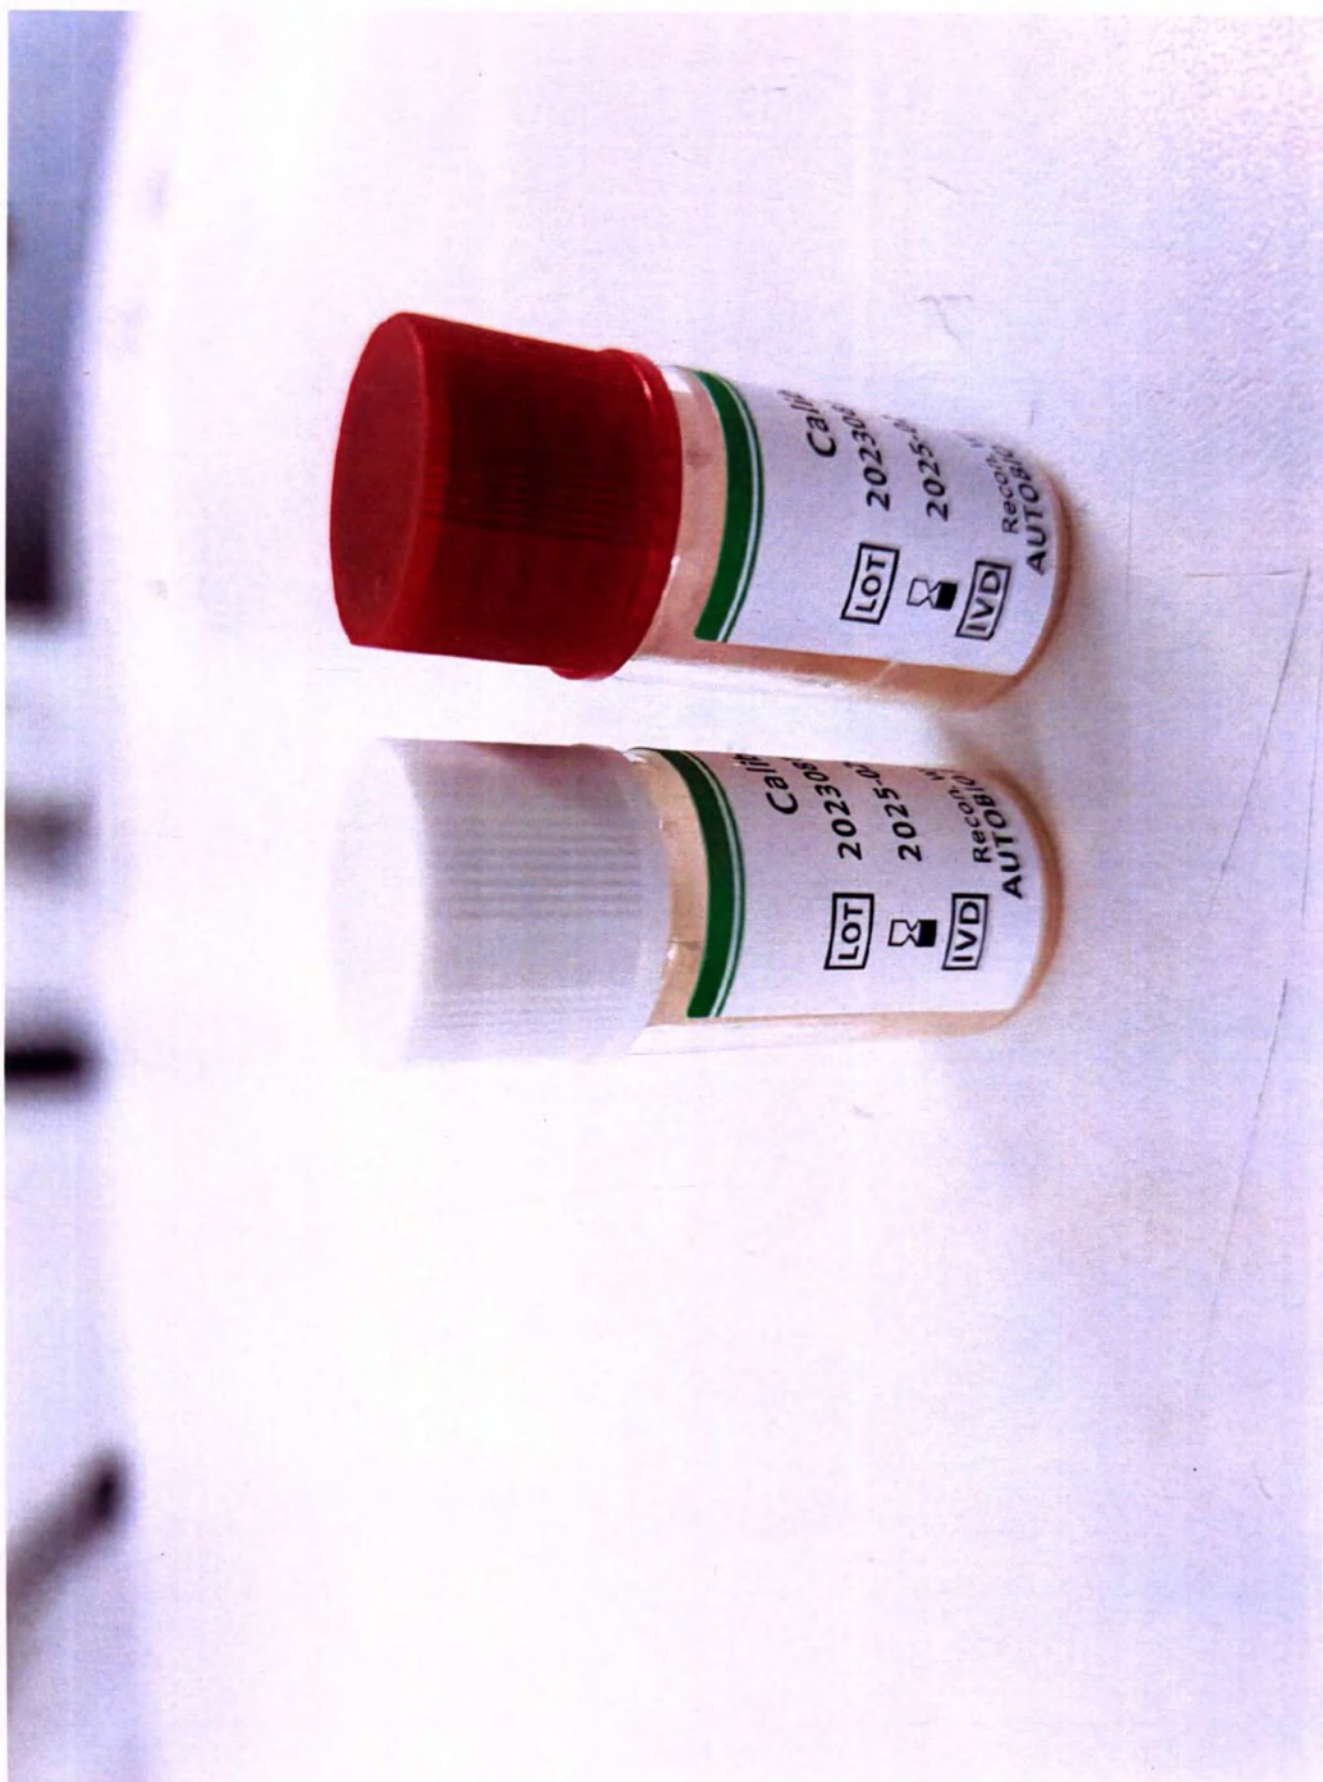

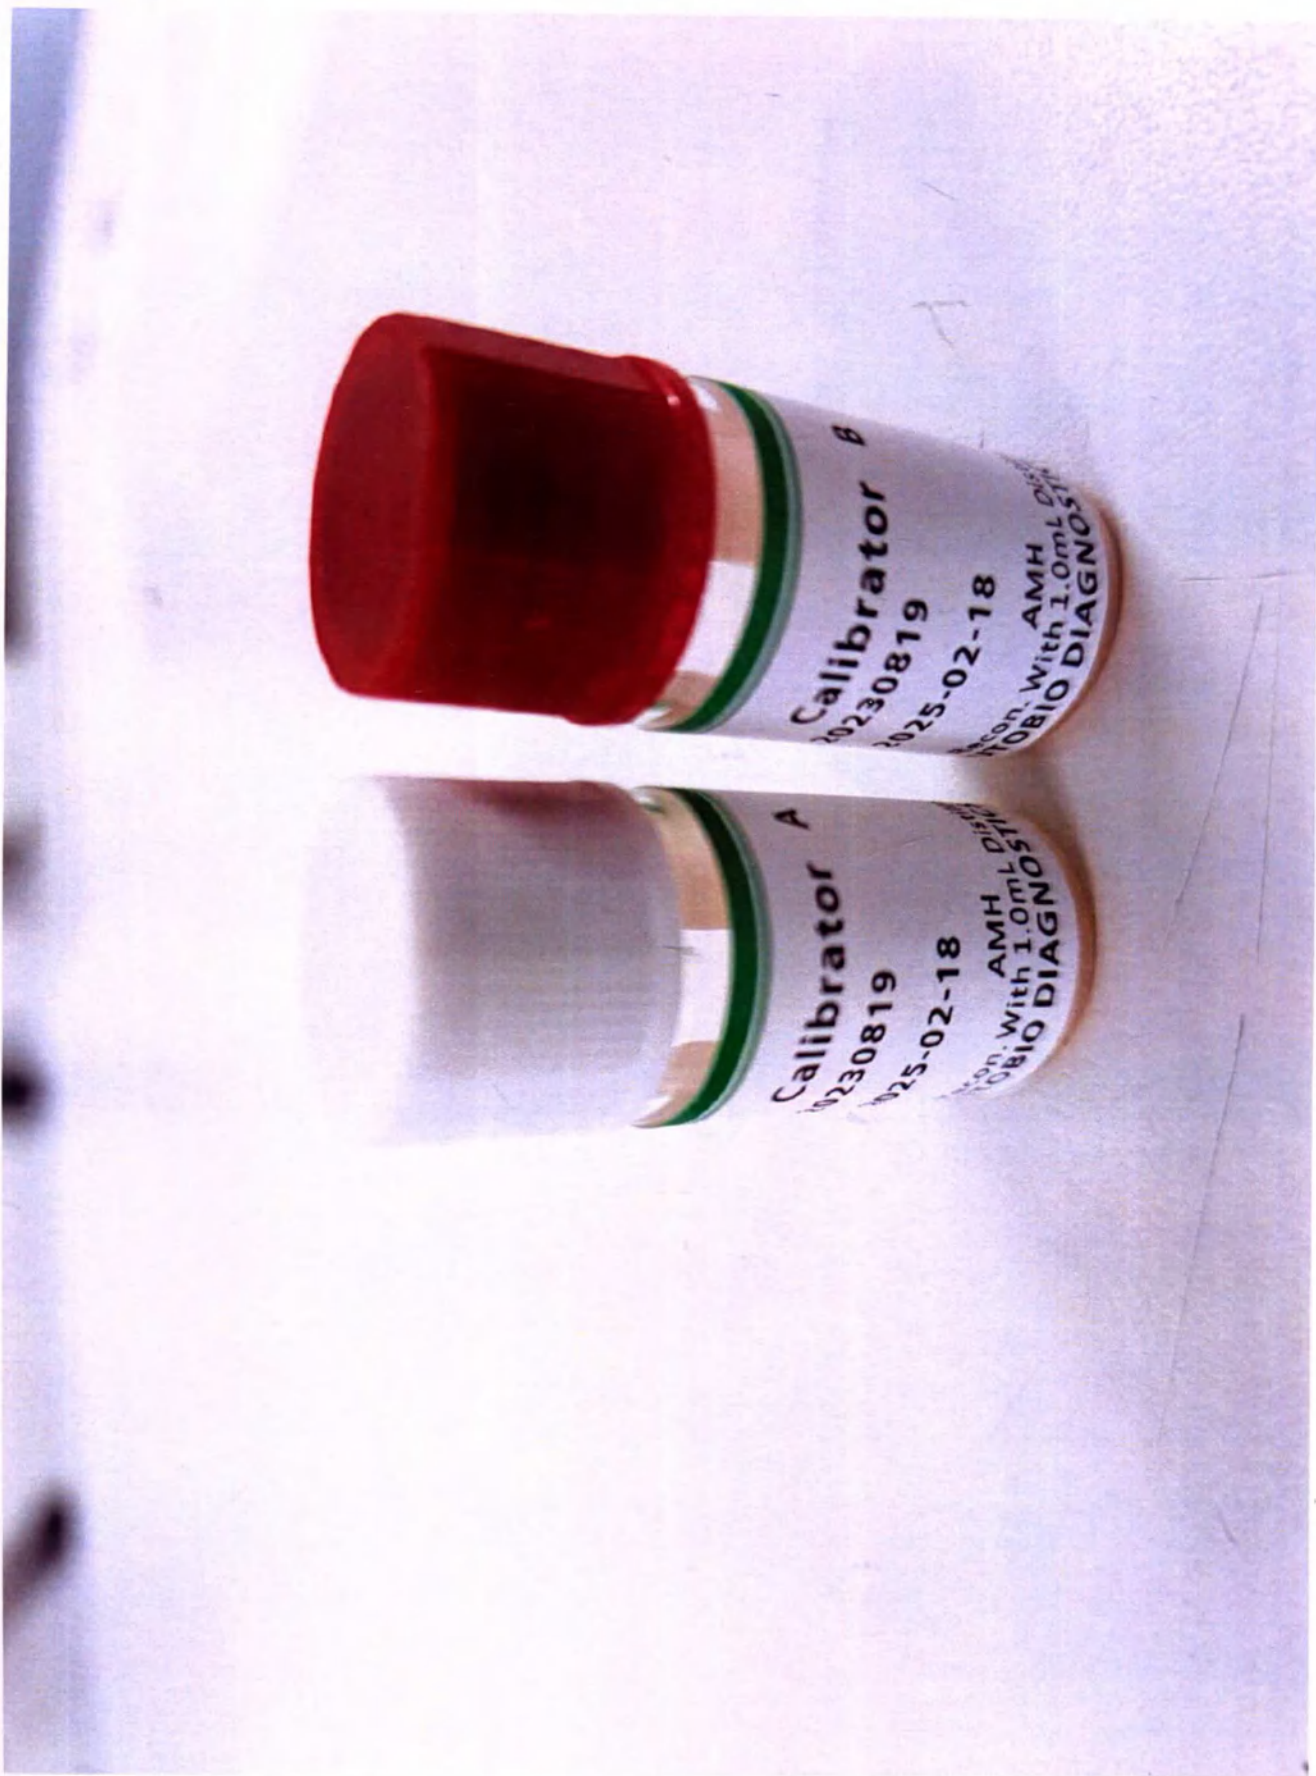













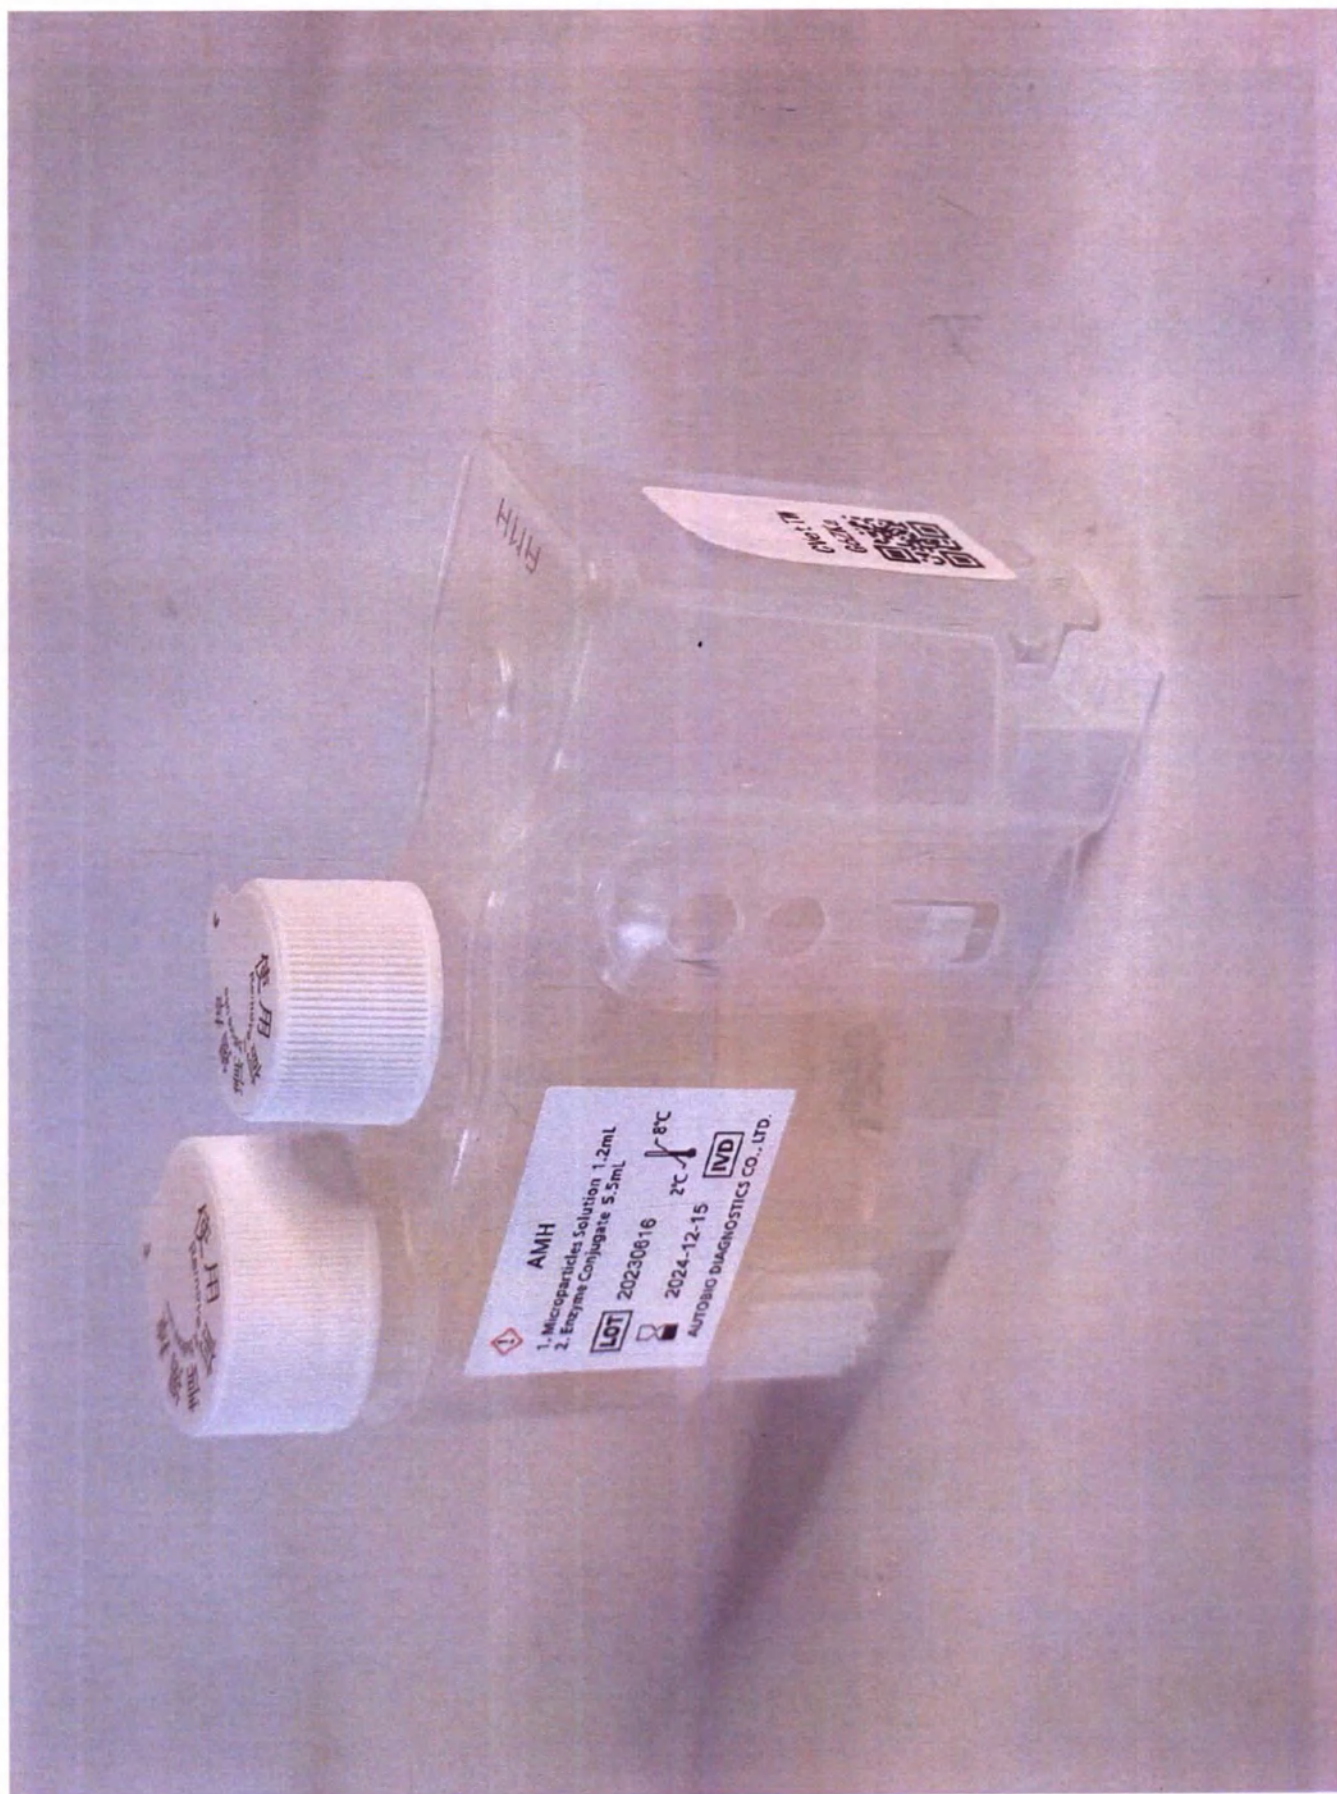

Фотографическое изображение примера транспортной упаковки
медицинского изделия

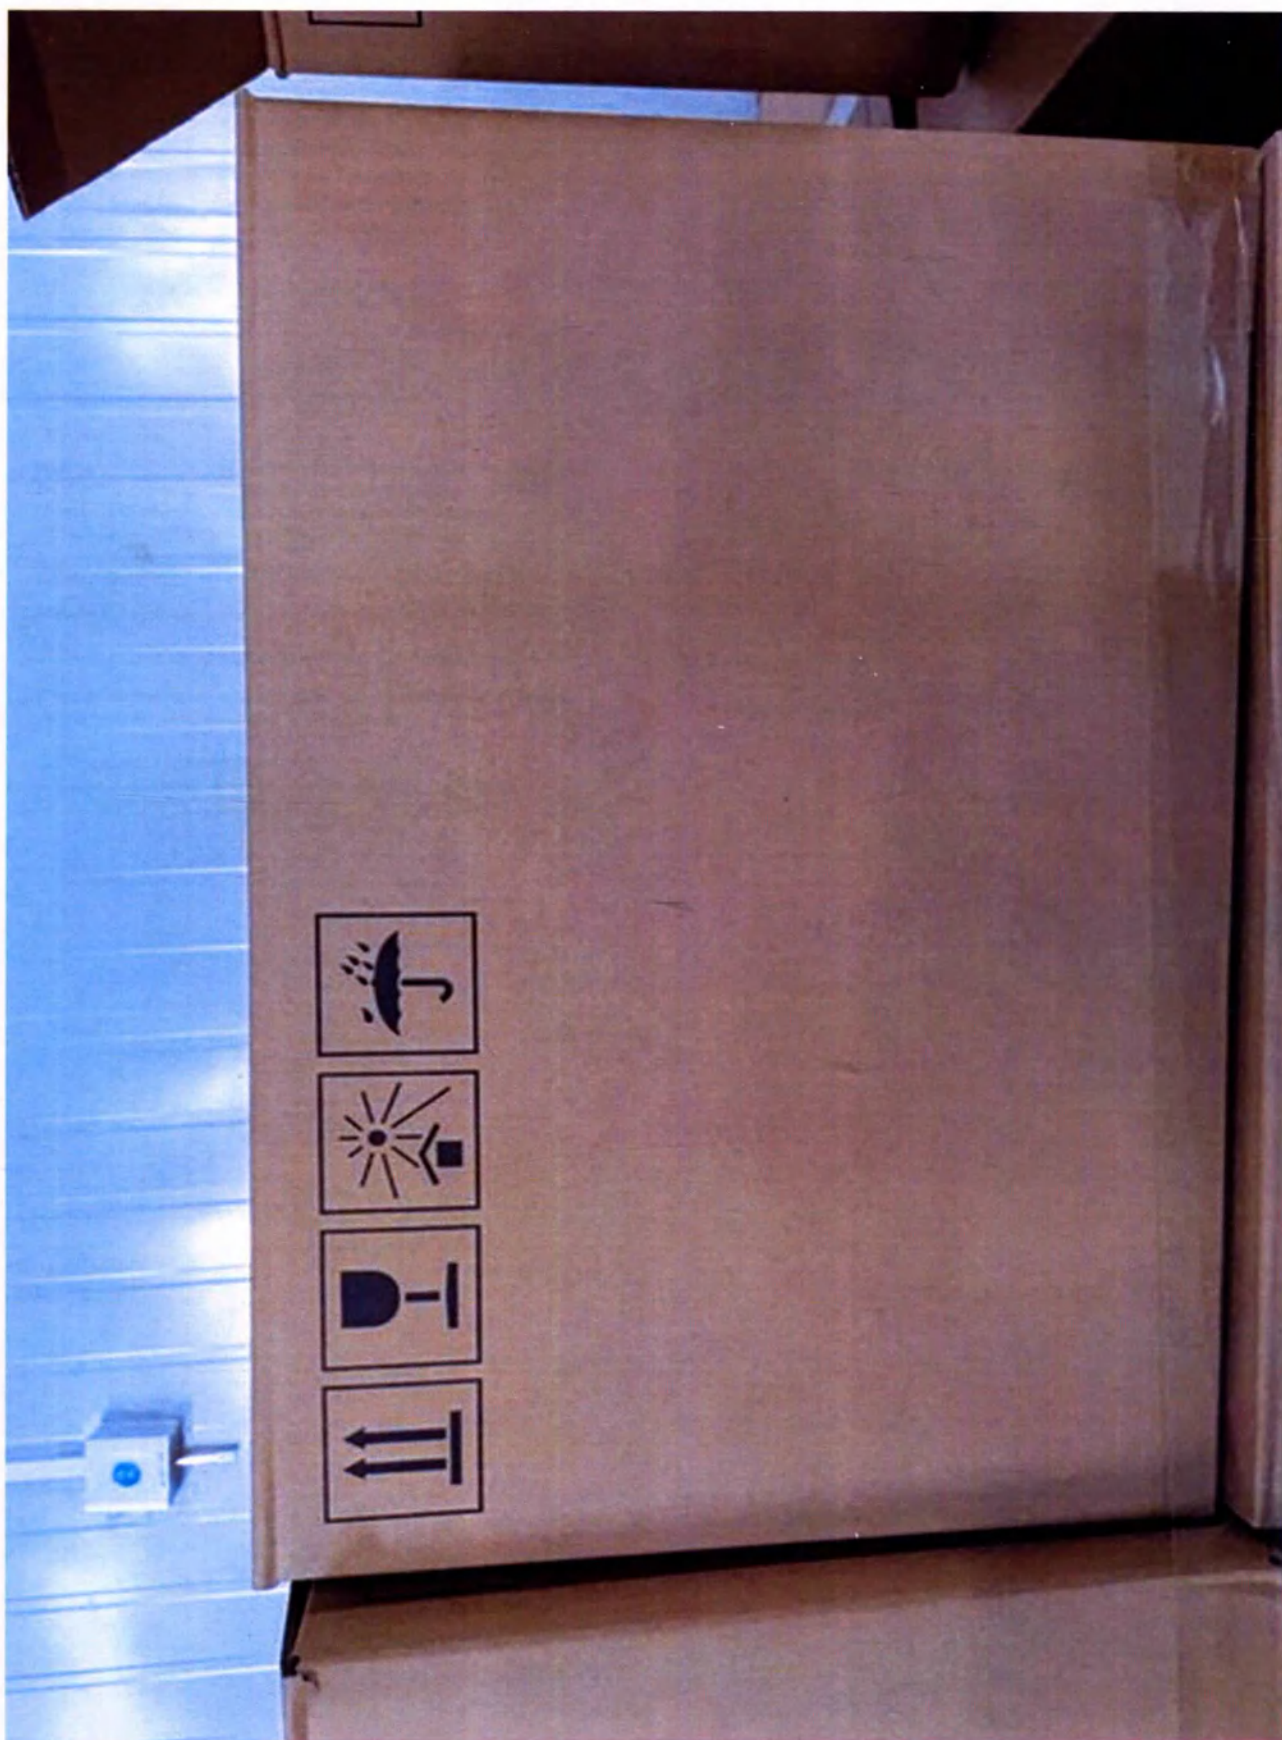

Макеты русскоязычной маркировки

Набор реагентов для количественного определения антимюллерова гормона в сыворотке крови человека (AMH CLIA Microparticles (AMH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

AMH CLIA Microparticles

REF

CMS0502

LOT



IVD

AutoLumo AMH Calibrators
Quality Control
Microparticles Solution
Enzyme Conjugate



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения антимюллерова гормона в сыворотке крови человека (AMH CLIA Microparticles (AMH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

AMH CLIA Microparticles

REF

CMS0505

LOT



IVD

AutoLumo AMH Calibrators
Quality Control
Microparticles Solution
Enzyme Conjugate





H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.


Макеты маркировки калибраторов:

Калибратор низкого уровня (Calibrator A) и Калибратор высокого уровня (Calibrator B)

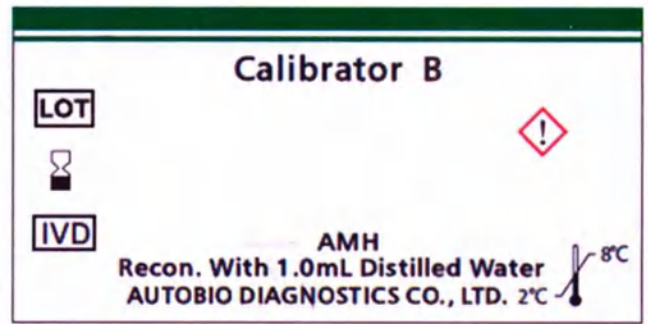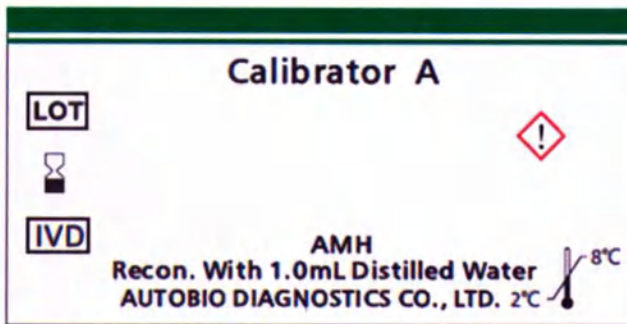


Макеты маркировки контролей:


Контроль низкого уровня (Quality Control 1) и Контроль высокого уровня (Quality Control 2)

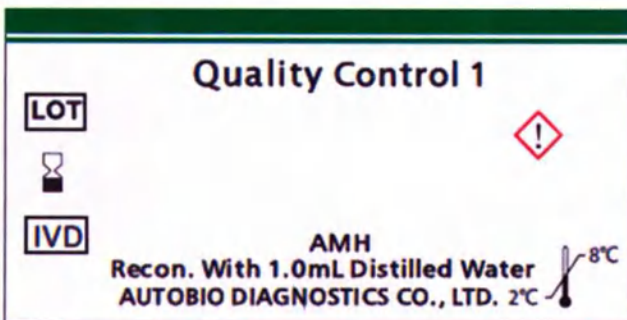

Маркет маркировки основного реагента для варианта исполнения Фасовка 50*2 тестов

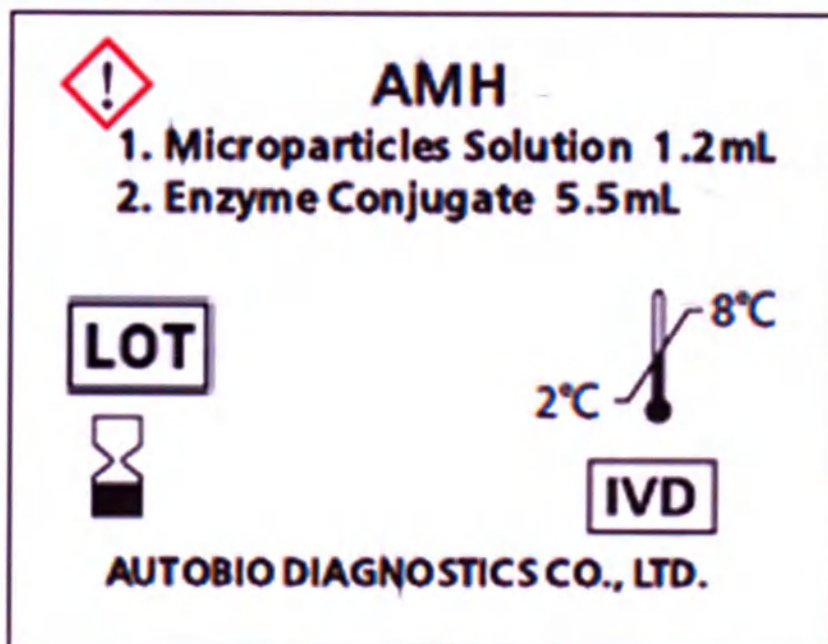

Маркет маркировки основного реагента для варианта исполнения Фасовка 100 тестов

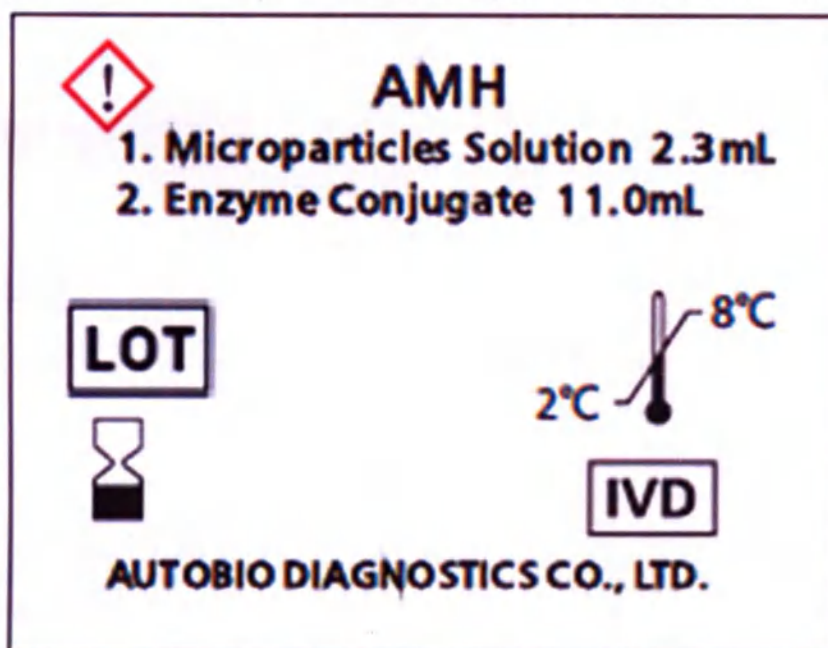



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 18

(всего 18) листах

