

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»




Перцева Н. Н.

«16» июля 2024 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови человека (CEA CLIA Microparticles (CEA)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo.



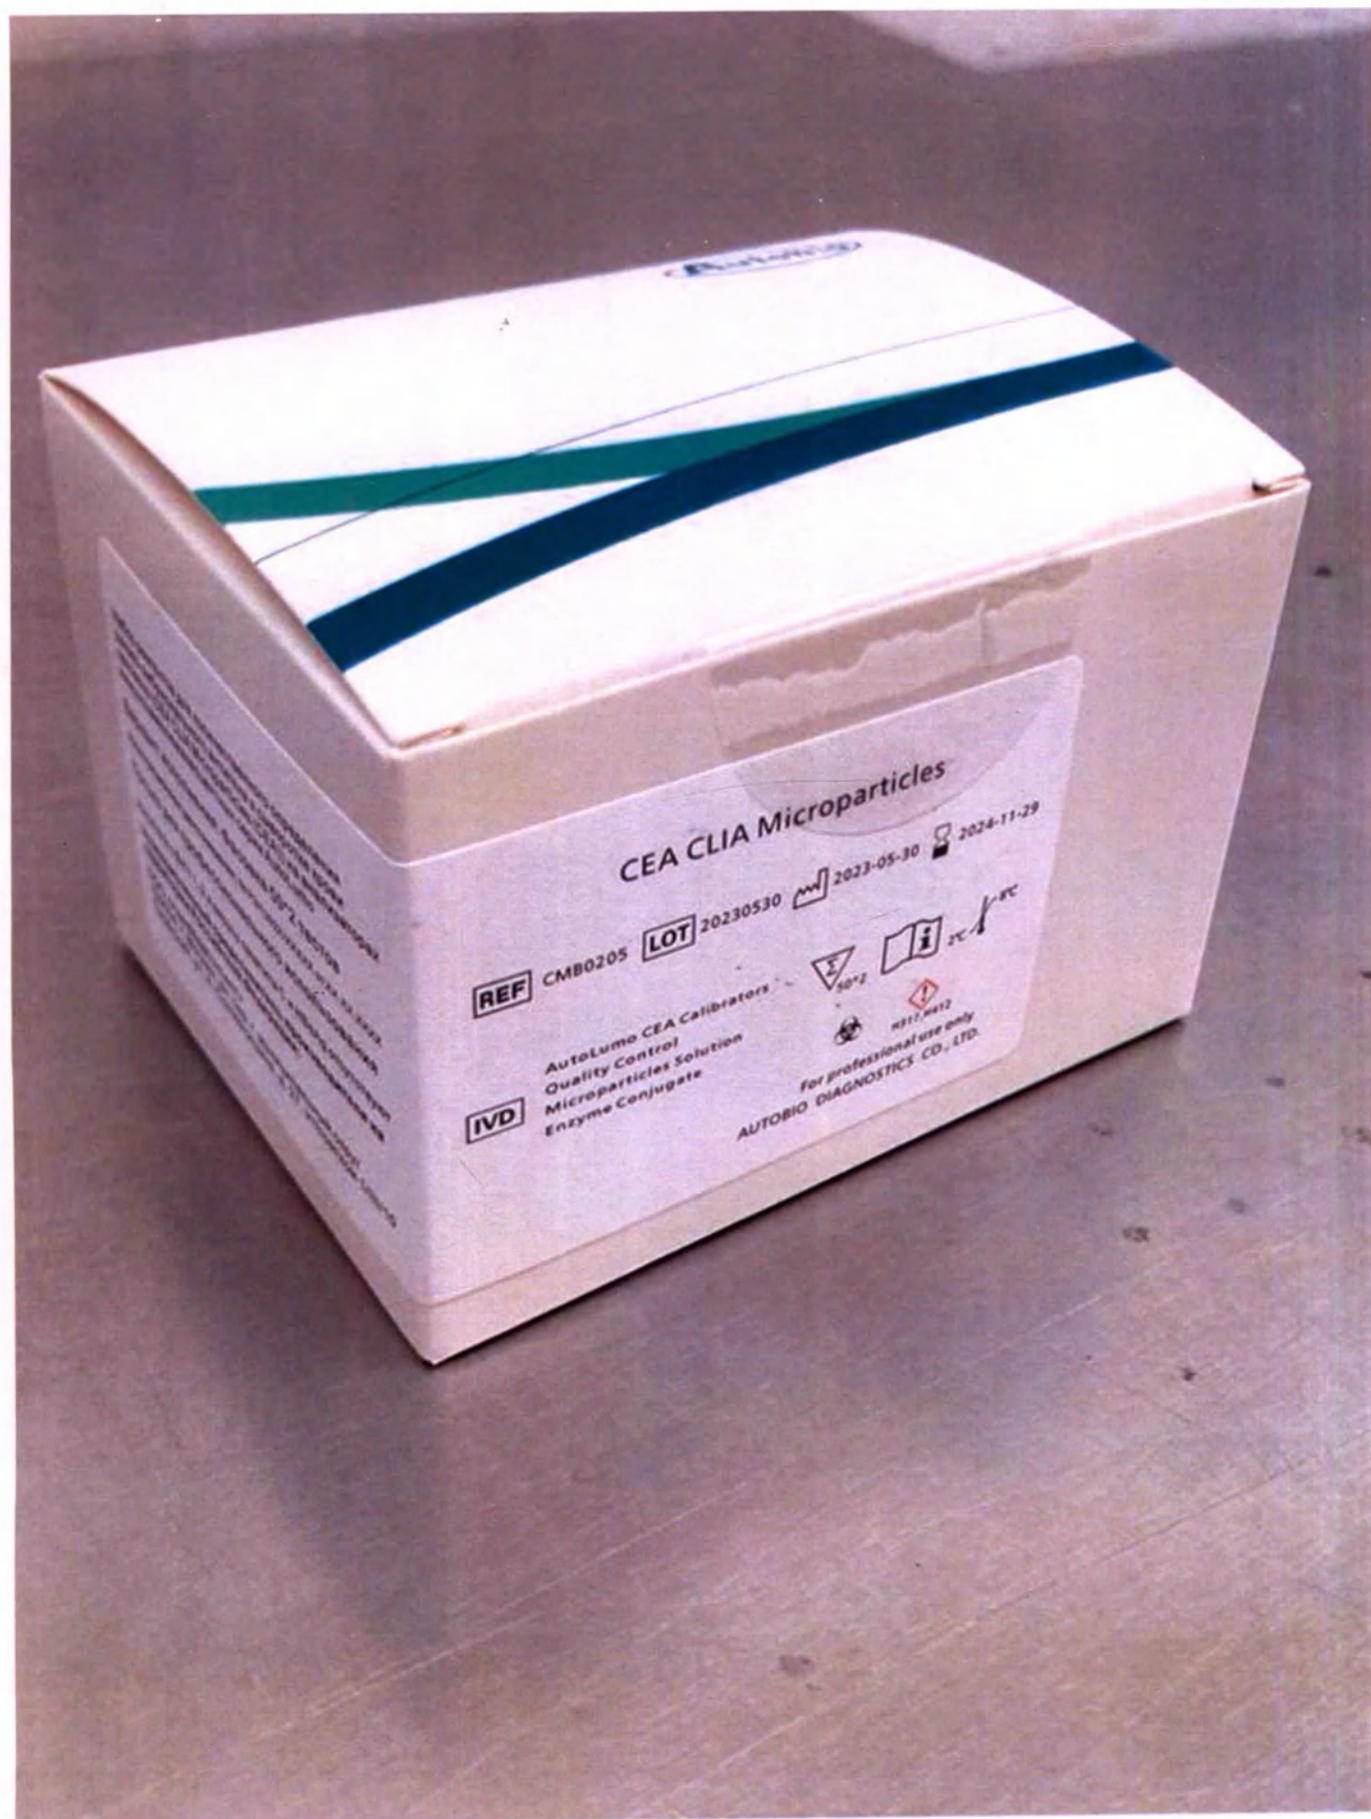

Фотографическое изображение набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка),
фасовка 50*2 тестов

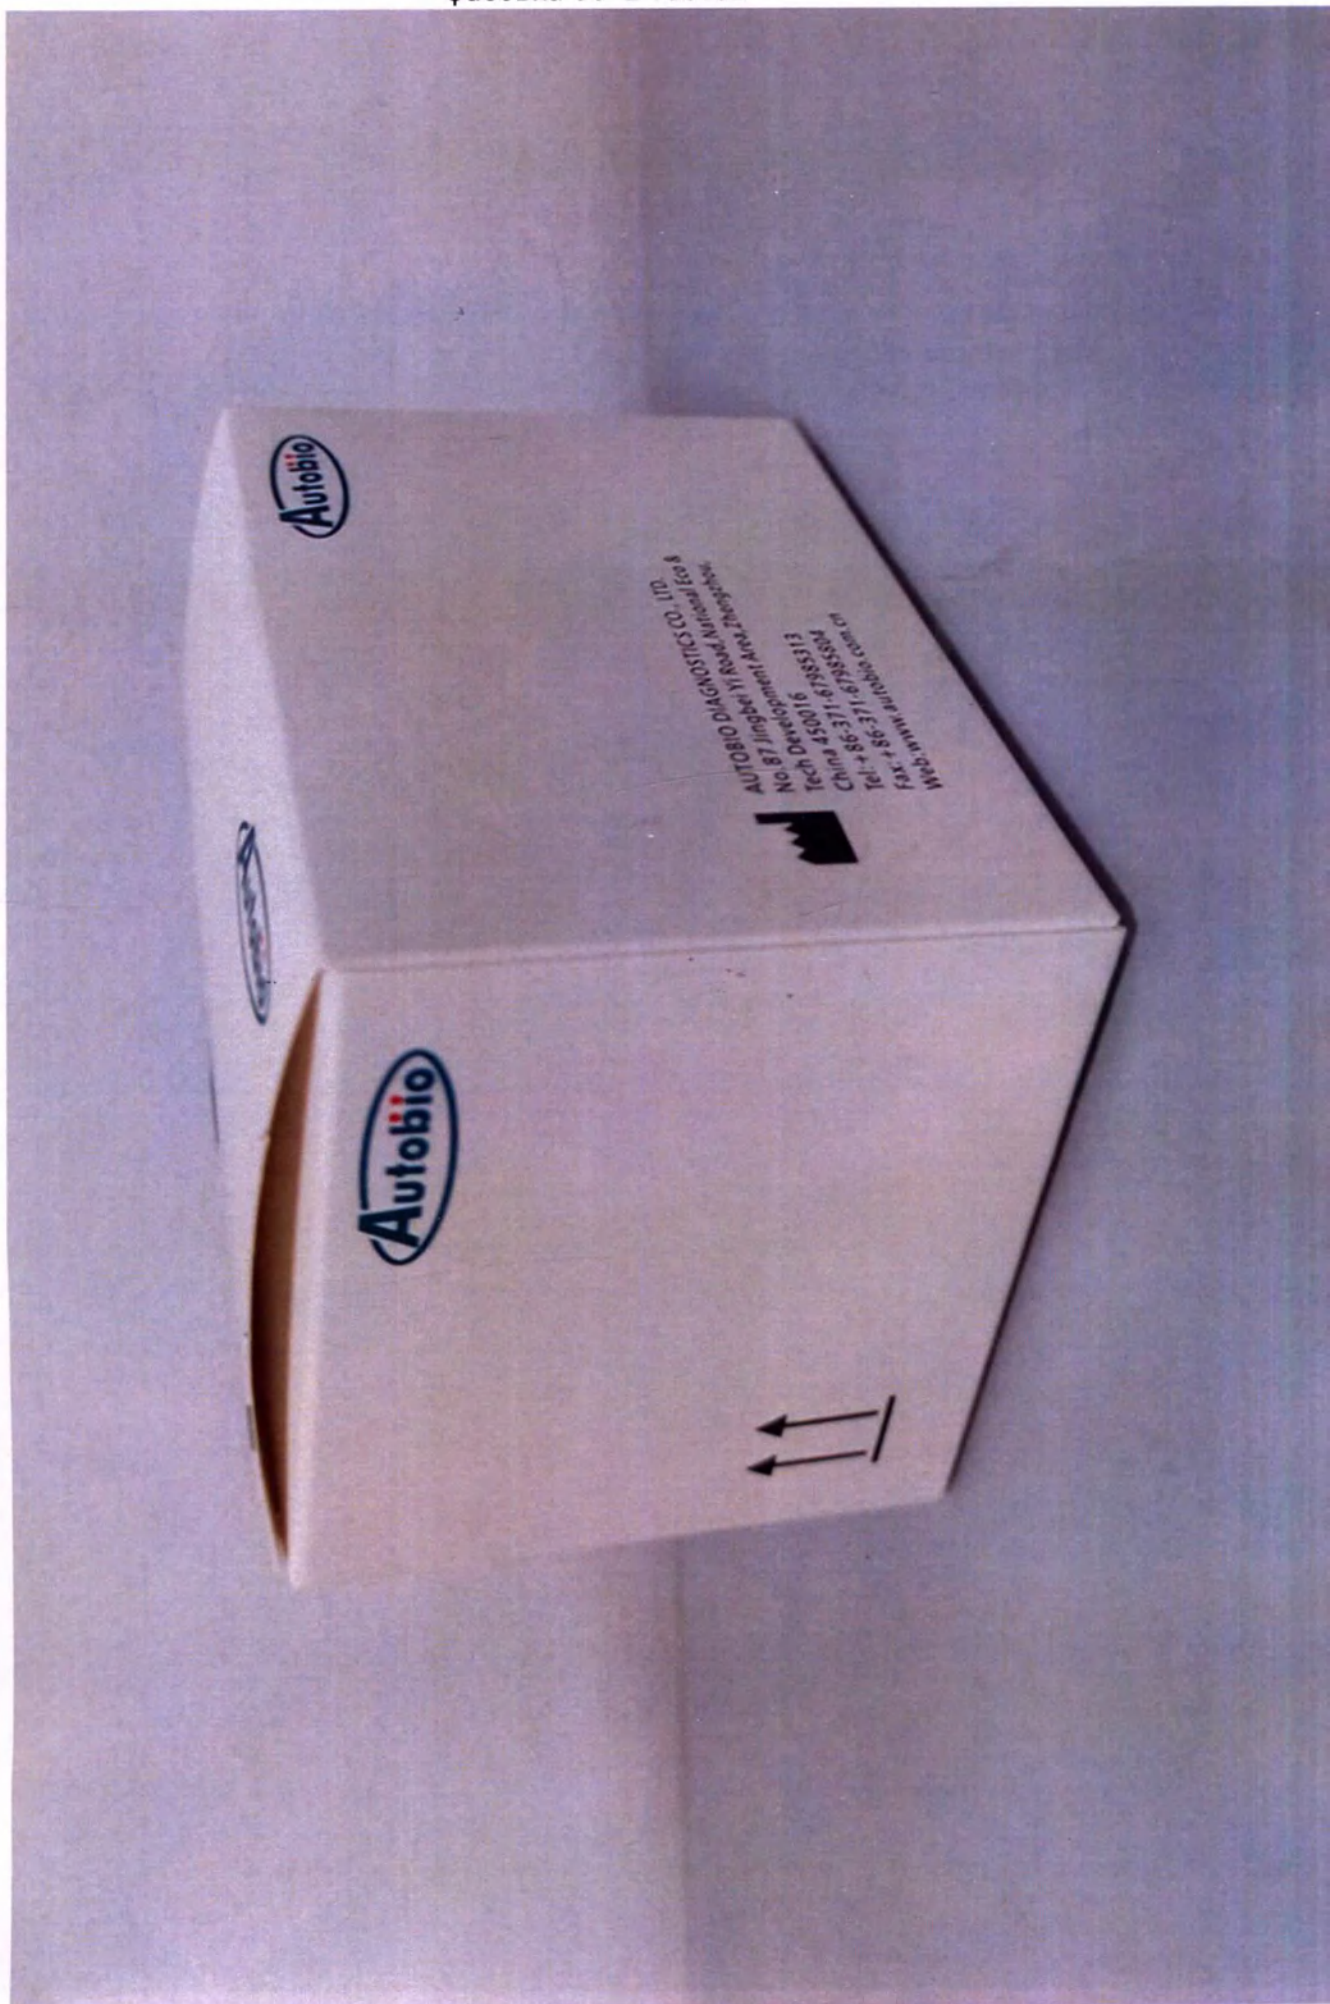


Фотографическое изображение набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов



Фотографическое изображение набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 100 тестов





Фотографическое изображение набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 100 тестов

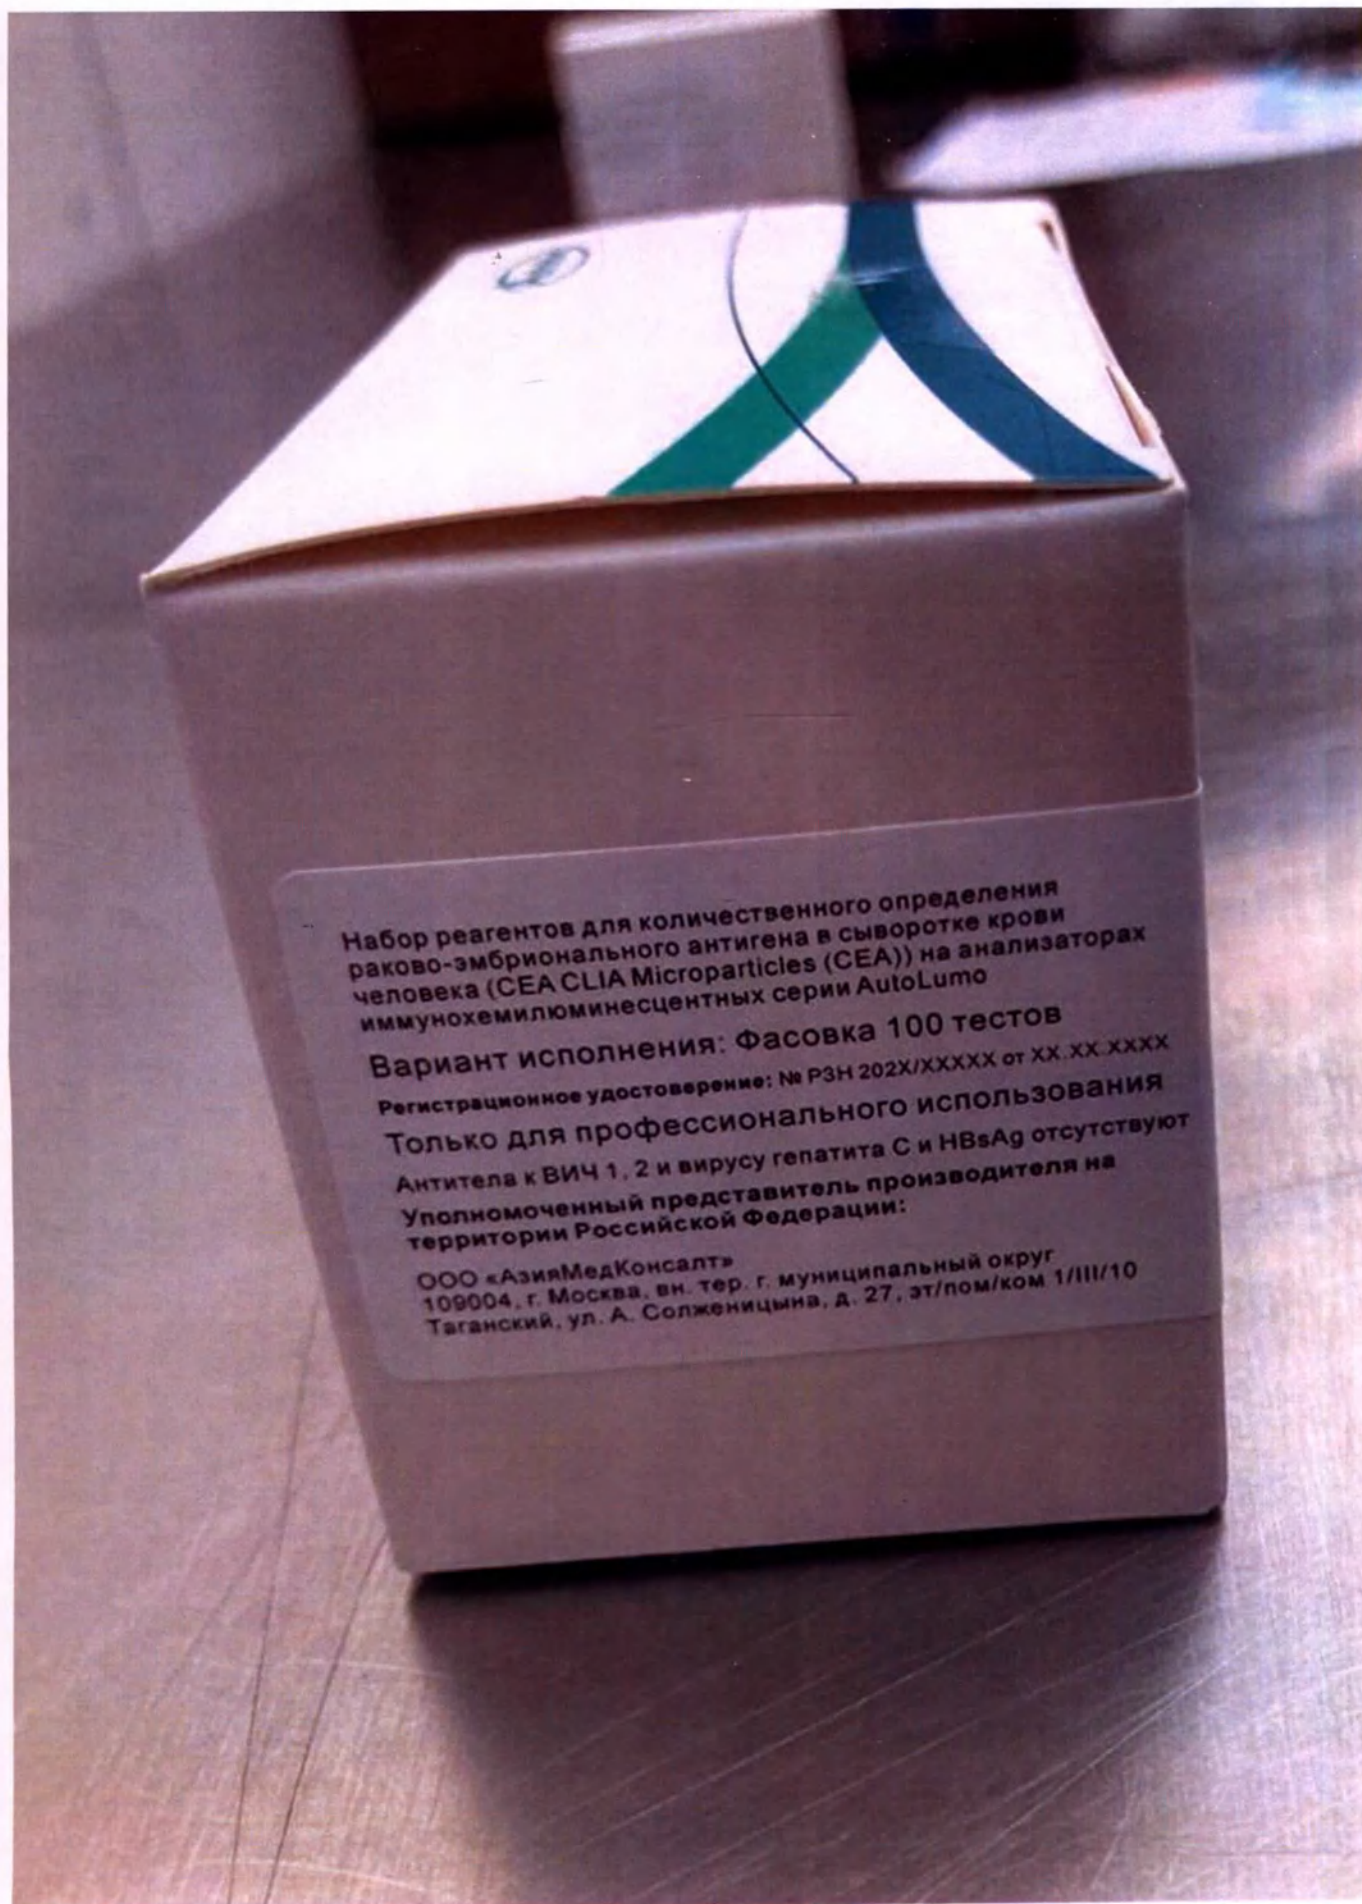


Фотографическое изображение набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов




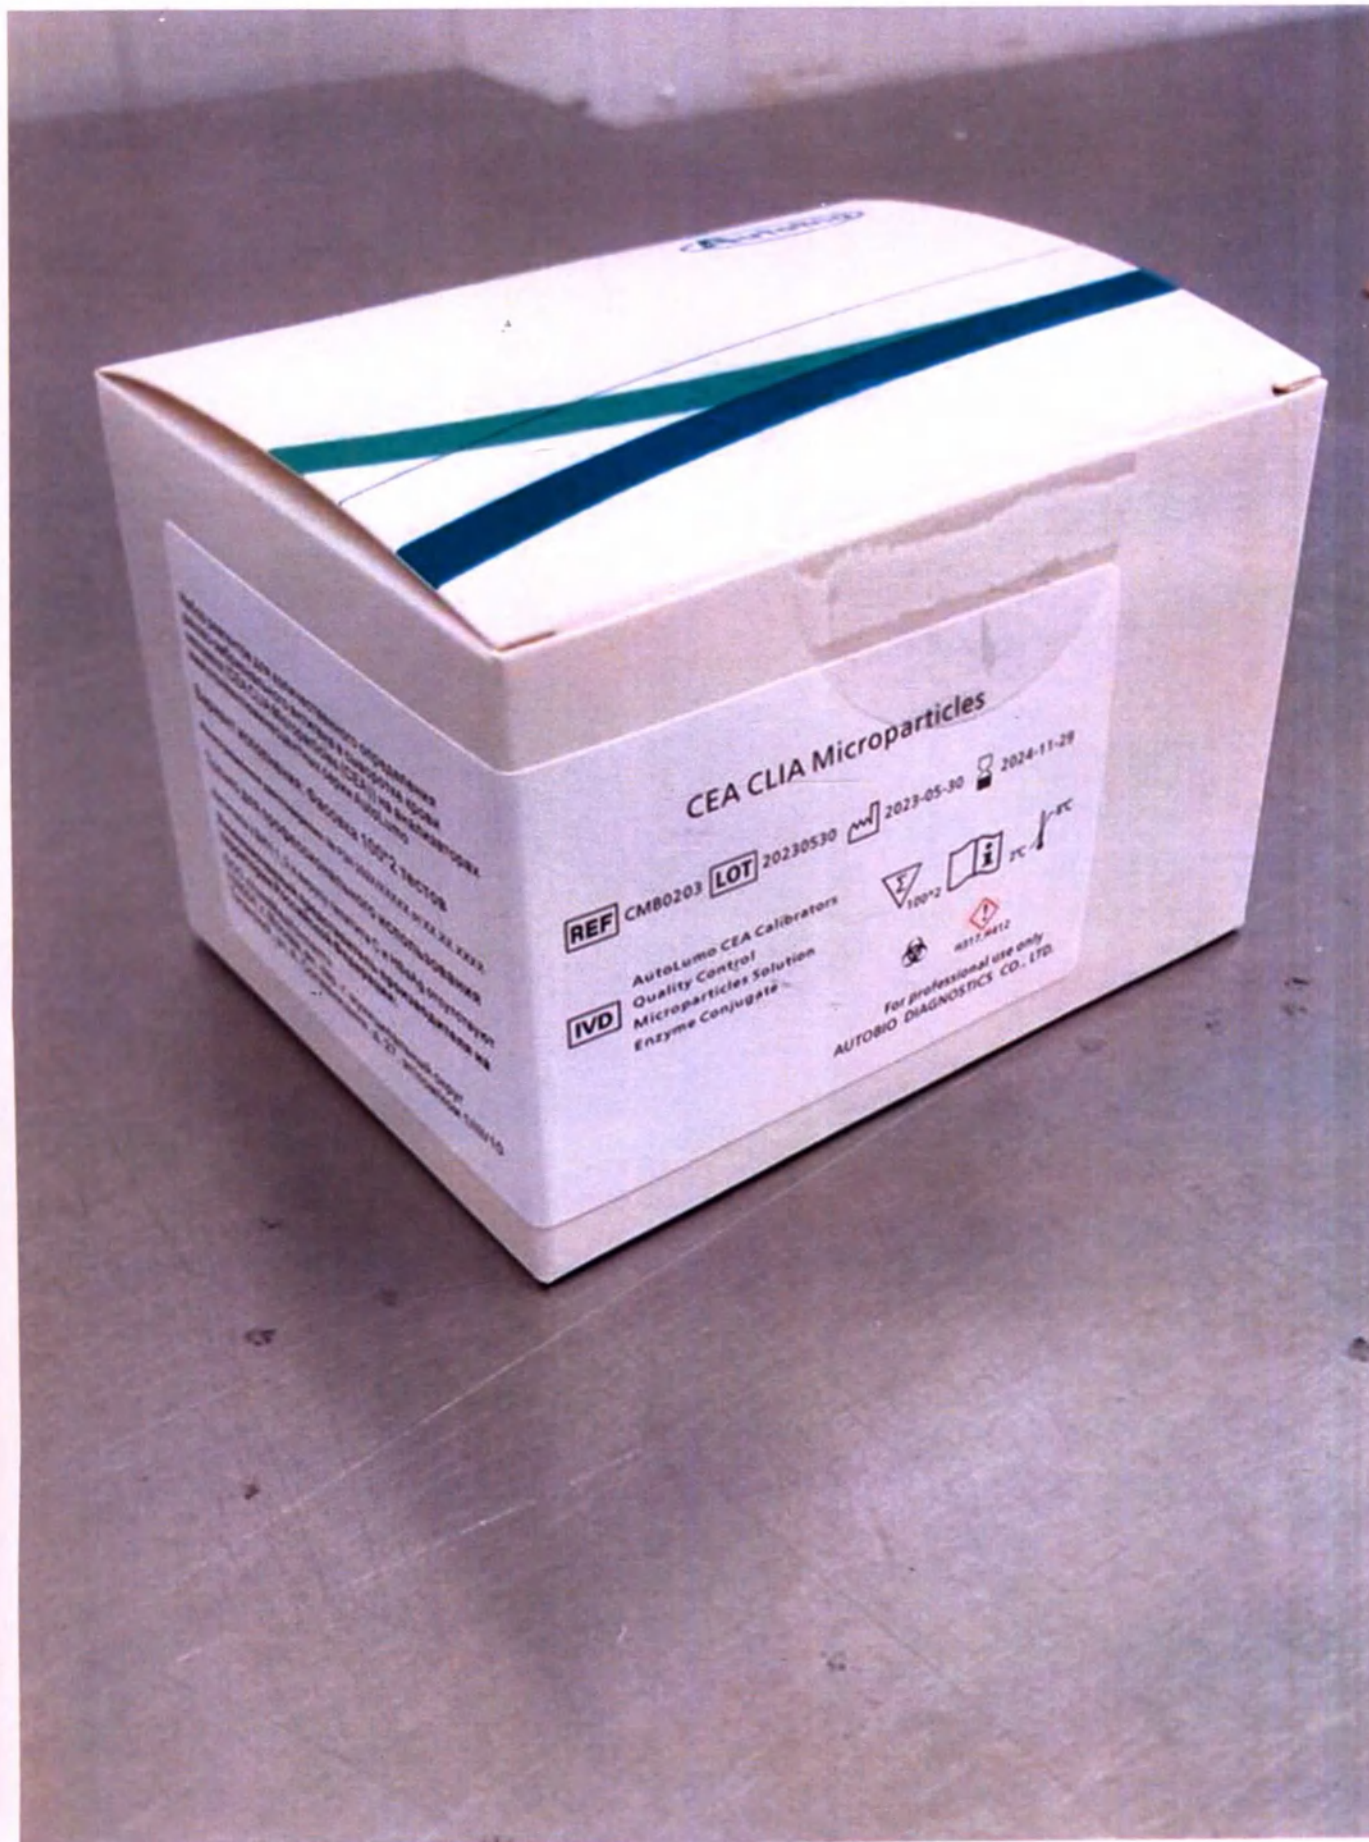

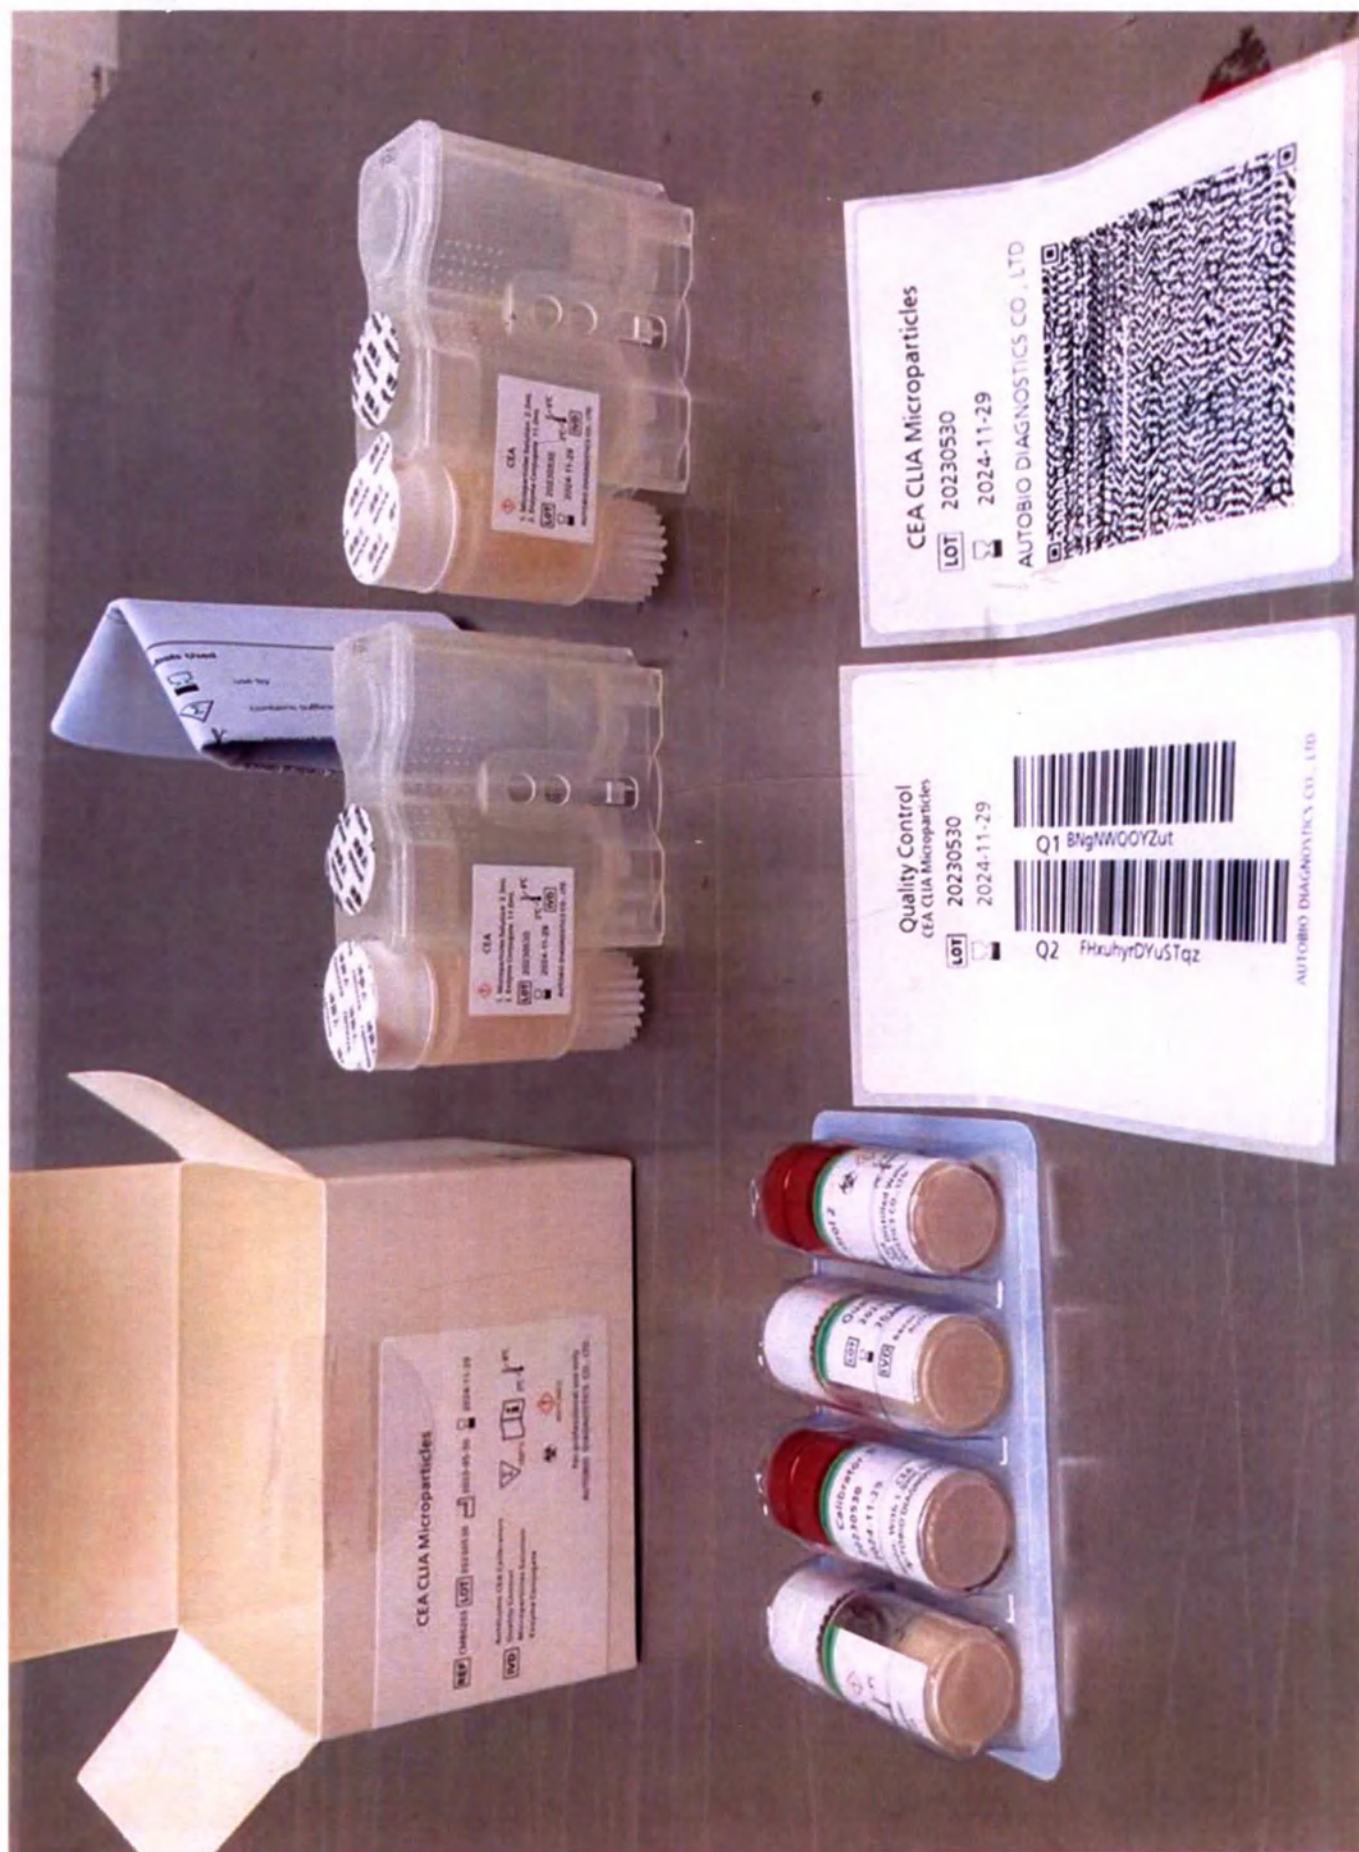


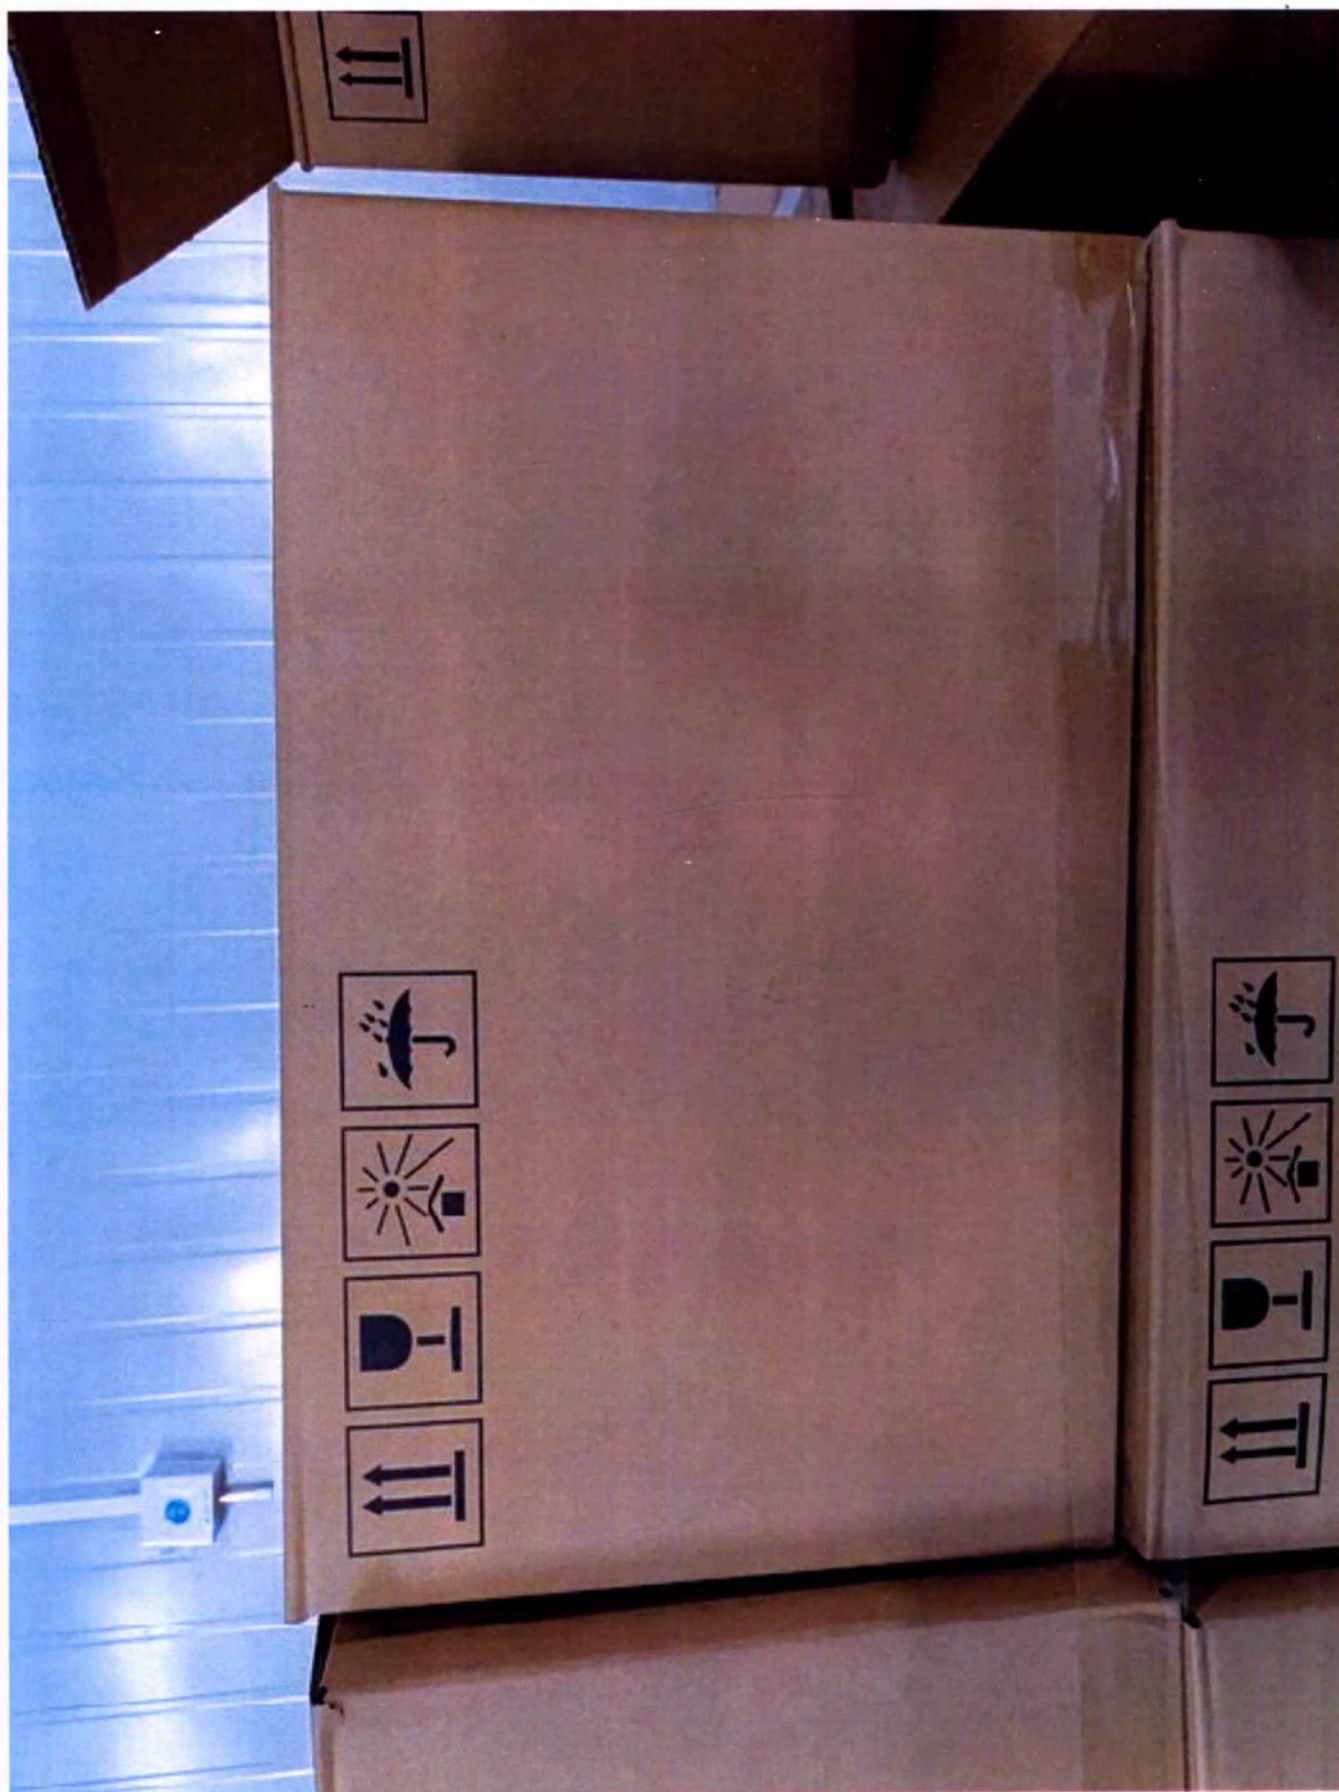



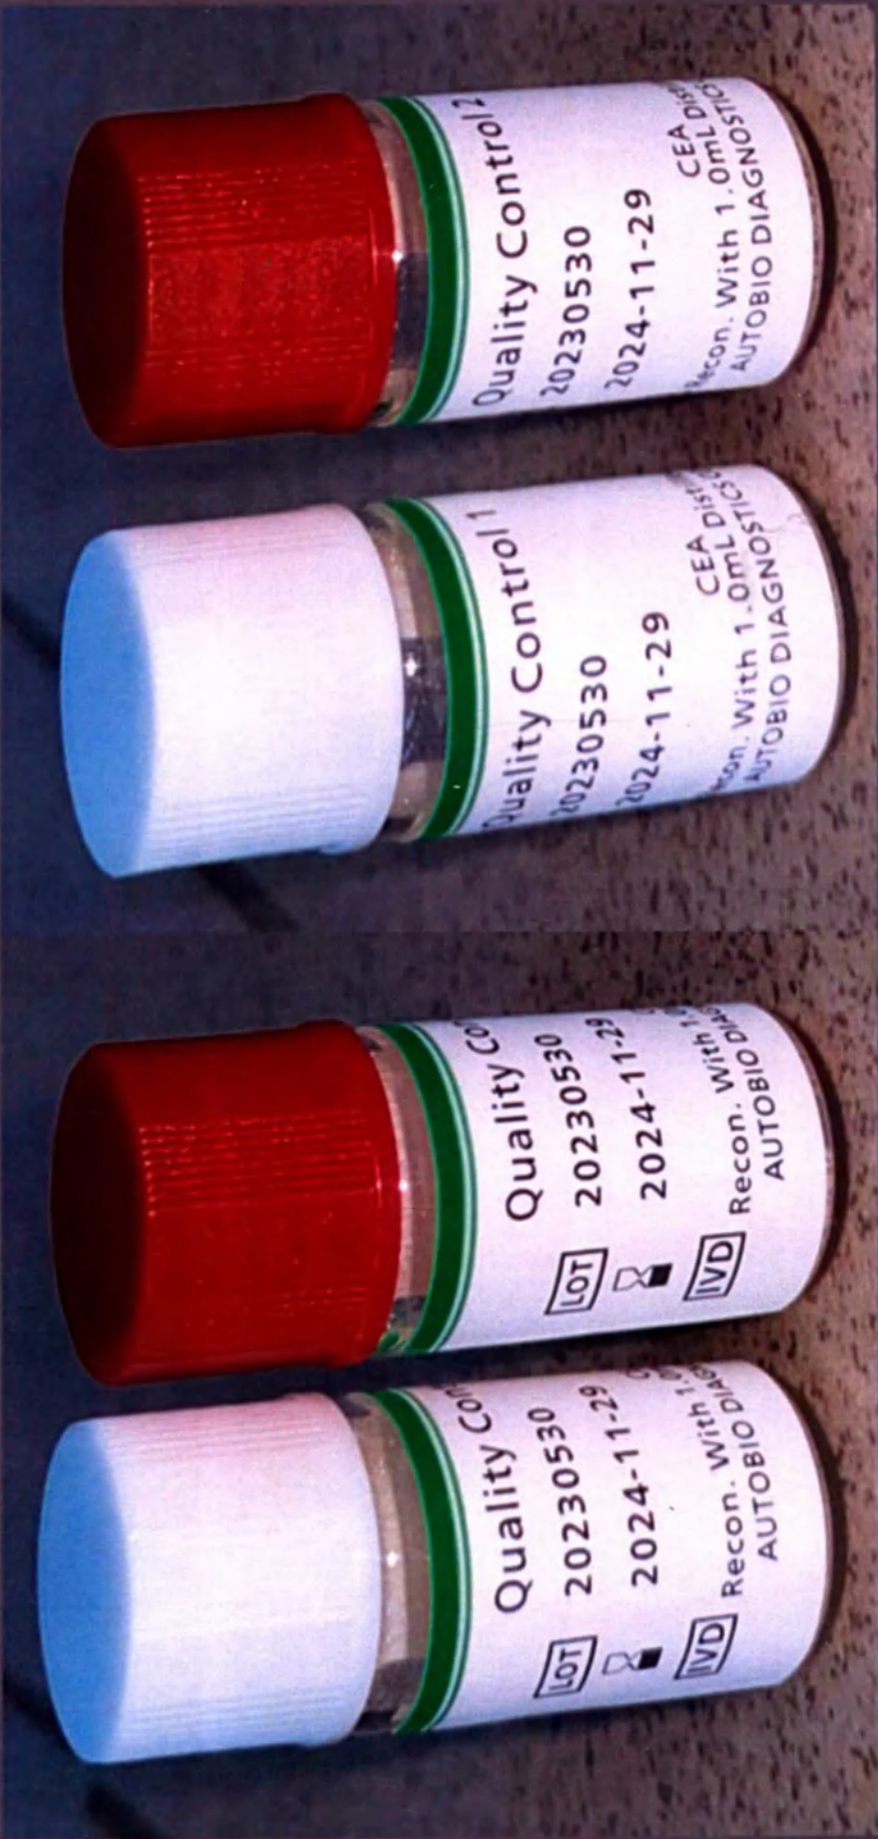

Фотографическое изображение картриджей
Вариант картриджа № 2

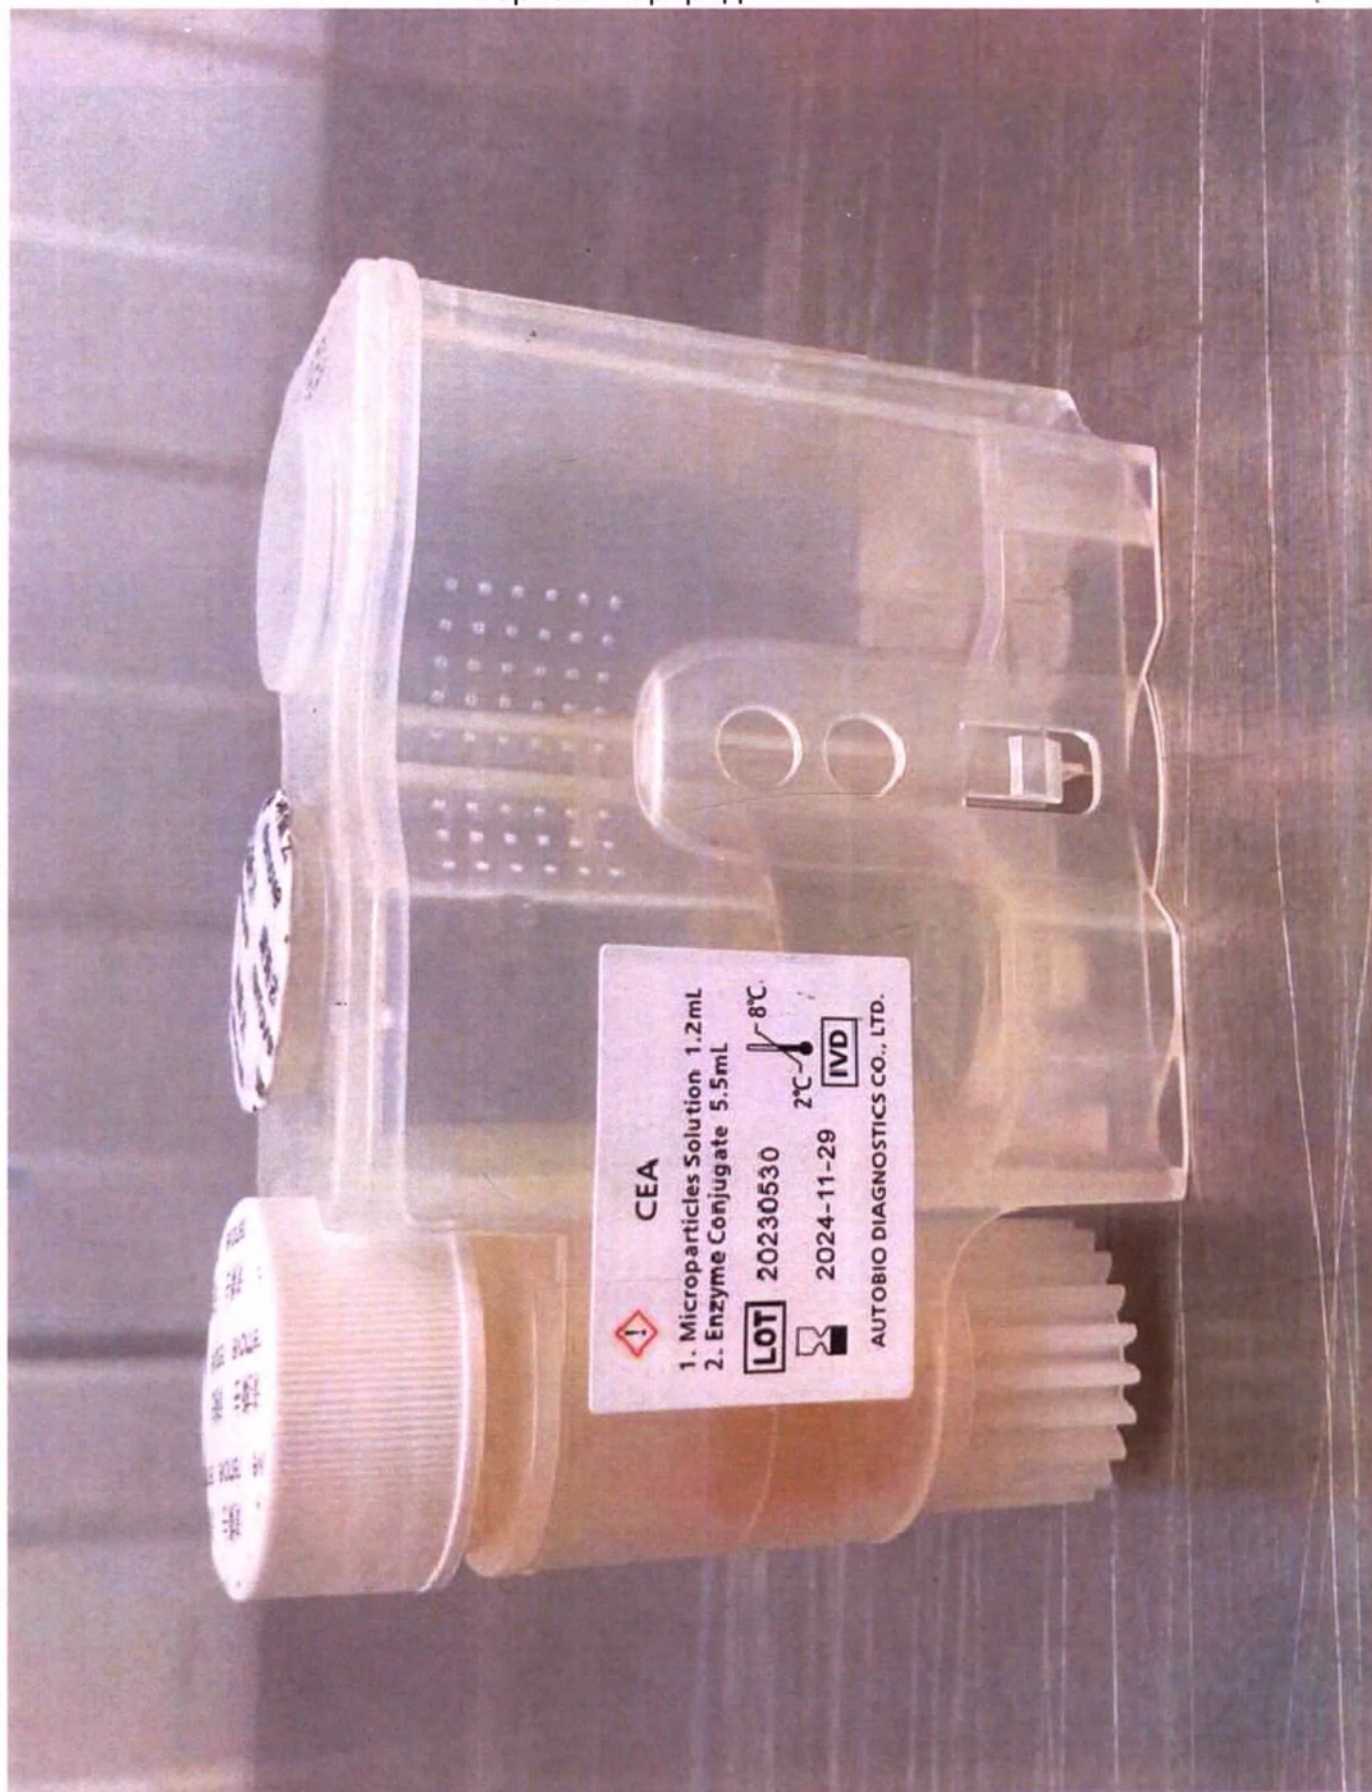

Фотографическое изображение картриджей
Вариант картриджа № 1



CEA CLIA Microparticles

Набор реагентов для количественного определения
раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови
человека (CEA CLIA Microparticles (CEA)) на анализаторах
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации:**

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10


REF CMB0205

LOT



IVD

AutoLumo CEA Calibrators
Quality Control
Microparticles Solution
Enzyme Conjugate



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения
раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови
человека (CEA CLIA Microparticles (CEA)) на анализаторах
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации:**

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Сопженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

CEA CLIA Microparticles

REF CMB0202 **LOT**

AutoLumo CEA Calibrators
Quality Control
Microparticles Solution
Enzyme Conjugate

IVD

НЗ17,Н412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

100

2°C 8°C

!

Набор реагентов для количественного определения
раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови
человека (CEA CLIA Microparticles (CEA)) на анализаторах
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации:**

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

CEA CLIA Microparticles

REF CMB0203

LOT



IVD

AutoLumo CEA Calibrators
Quality Control
Microparticles Solution
Enzyme Conjugate



100*2




2°C



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Фотографическое изображение макета маркировки калибратора низкого уровня (Calibrator A) и калибратора высокого уровня (Calibrator B)

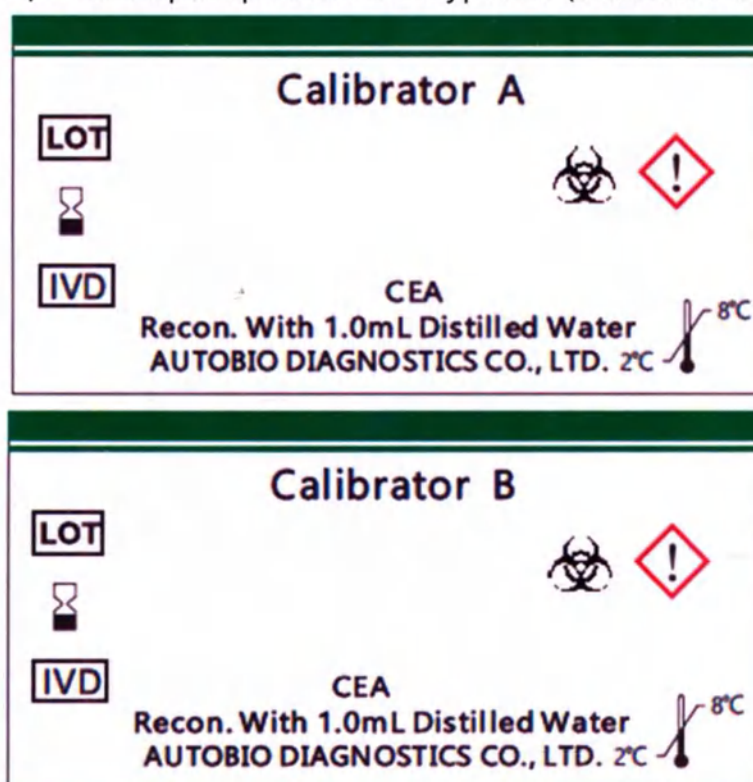

Фотографическое изображение макета маркировки контроля низкого уровня (Quality Control 1) и контроля высокого уровня (Quality Control 2)



Маркет маркировки Основного реагента CEA для варианта исполнения: Фасовка 50*2 тестов



CEA

1. Microparticles Solution 1.2mL

2. Enzyme Conjugate 5.5mL









AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Маркет маркировки Основного реагента CEA для варианта исполнения: Фасовка 100 тестов, Фасовка 100*2 тестов



CEA

1. Microparticles Solution 2.3mL

2. Enzyme Conjugate 11.0mL









AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

девятнадцать листах

