

Руководитель группы регистрации

ООО «Сименс Здравоохранение»

Н.А. Горшкова

«30» ноября 2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Система рентгенографическая MULTIX Impact C в исполнениях с
принадлежностями


Система рентгенографическая MULTIX Impact C в исполнениях с принадлежностями, базовый блок 1:




1. Потолочный штатив MULTIX Impact C с панелью управления, рентгеновским излучателем, сенсорным интерфейсом пользователя и коллиматором, вариант исполнения: - стандартный, -с моторизованным наклоном. (Изображение распространяется на все варианты исполнения)




2. Стойка вертикальная со стационарным детектором Core static.

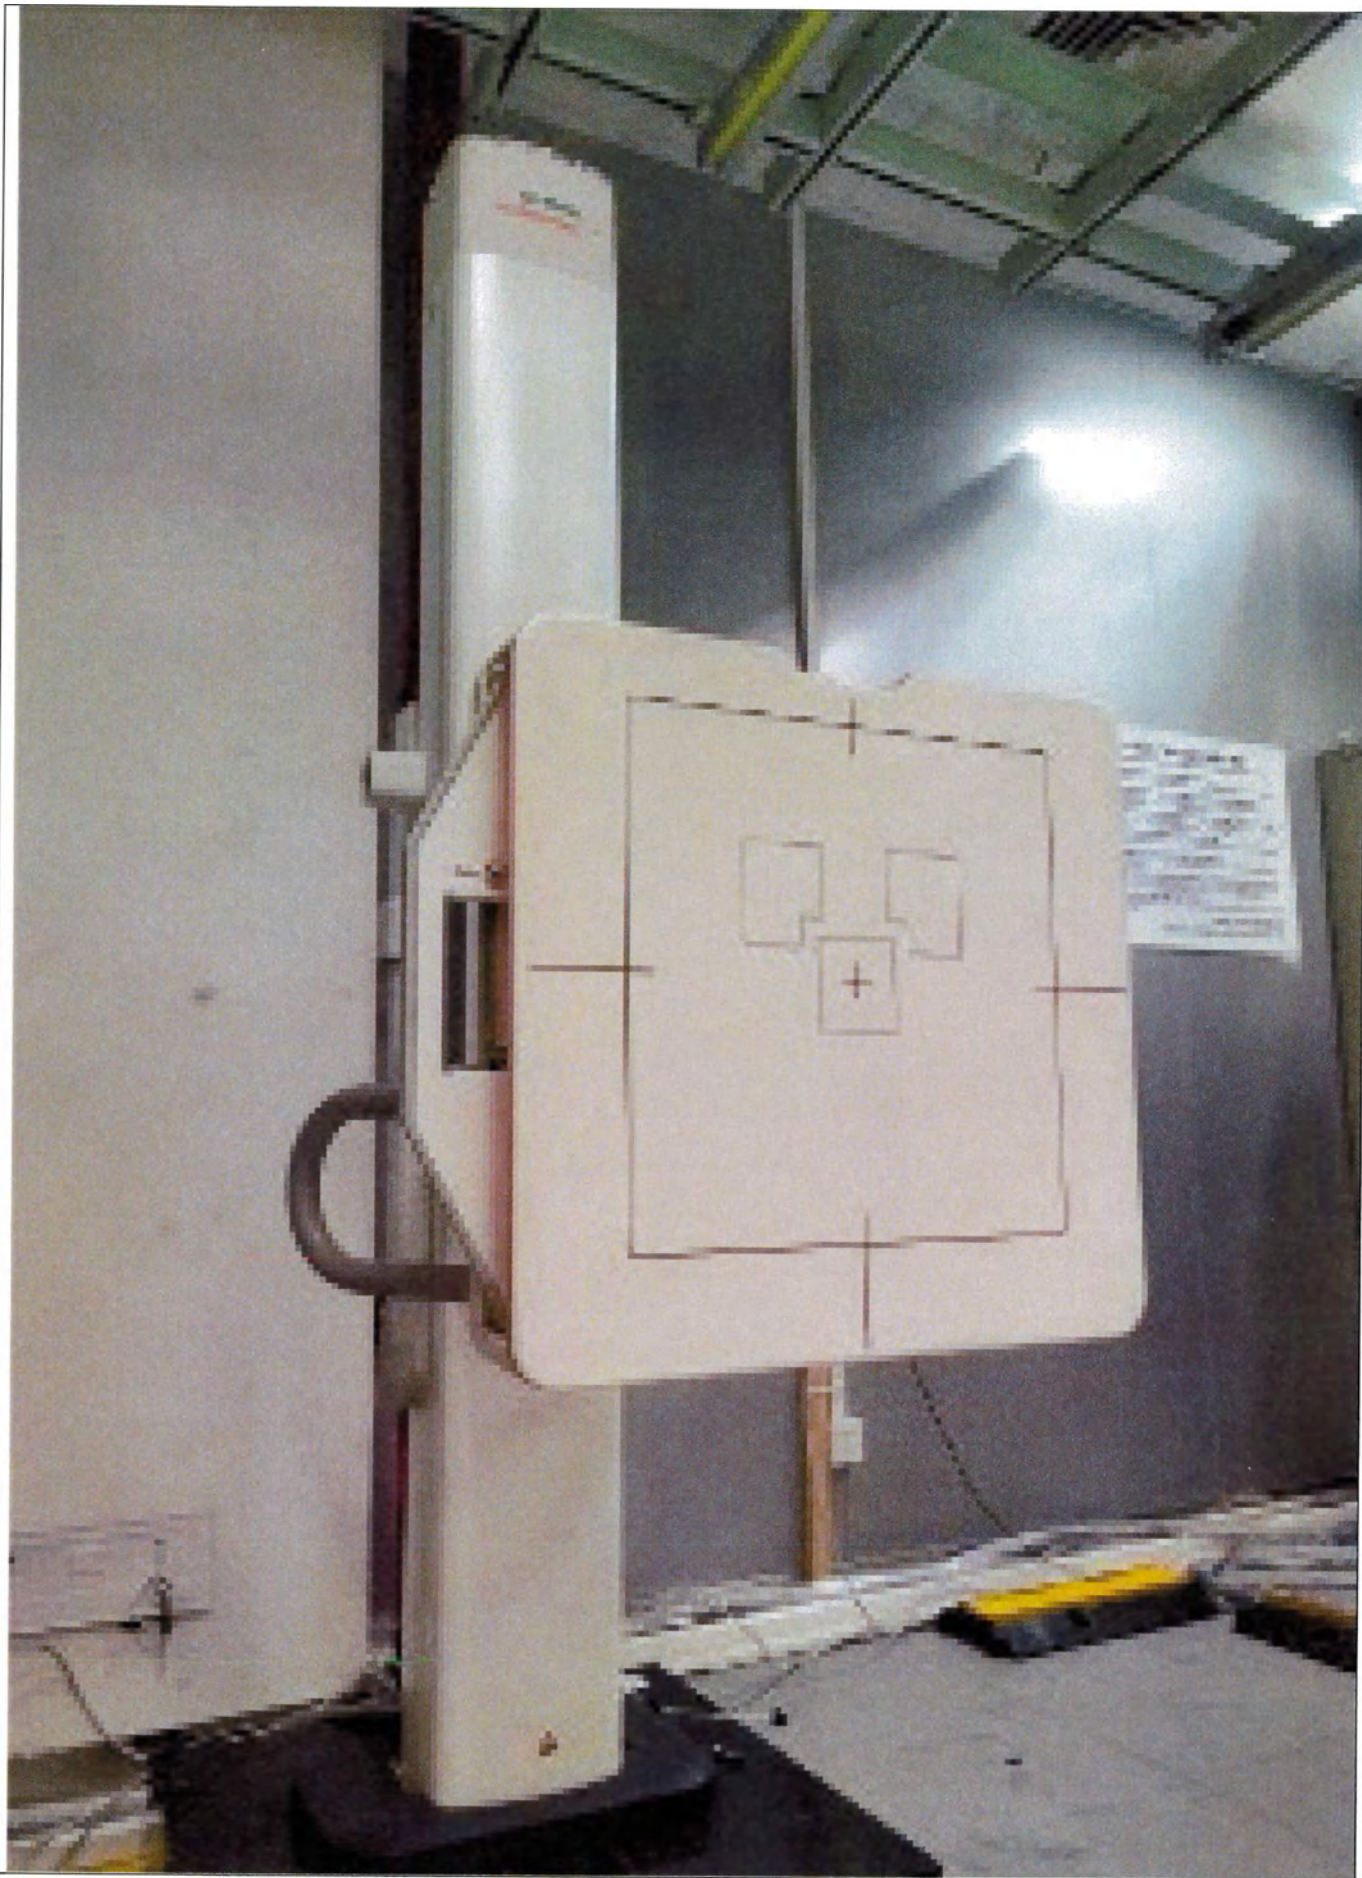

3. Стойка вертикальная для беспроводного детектора MAX wi-D.

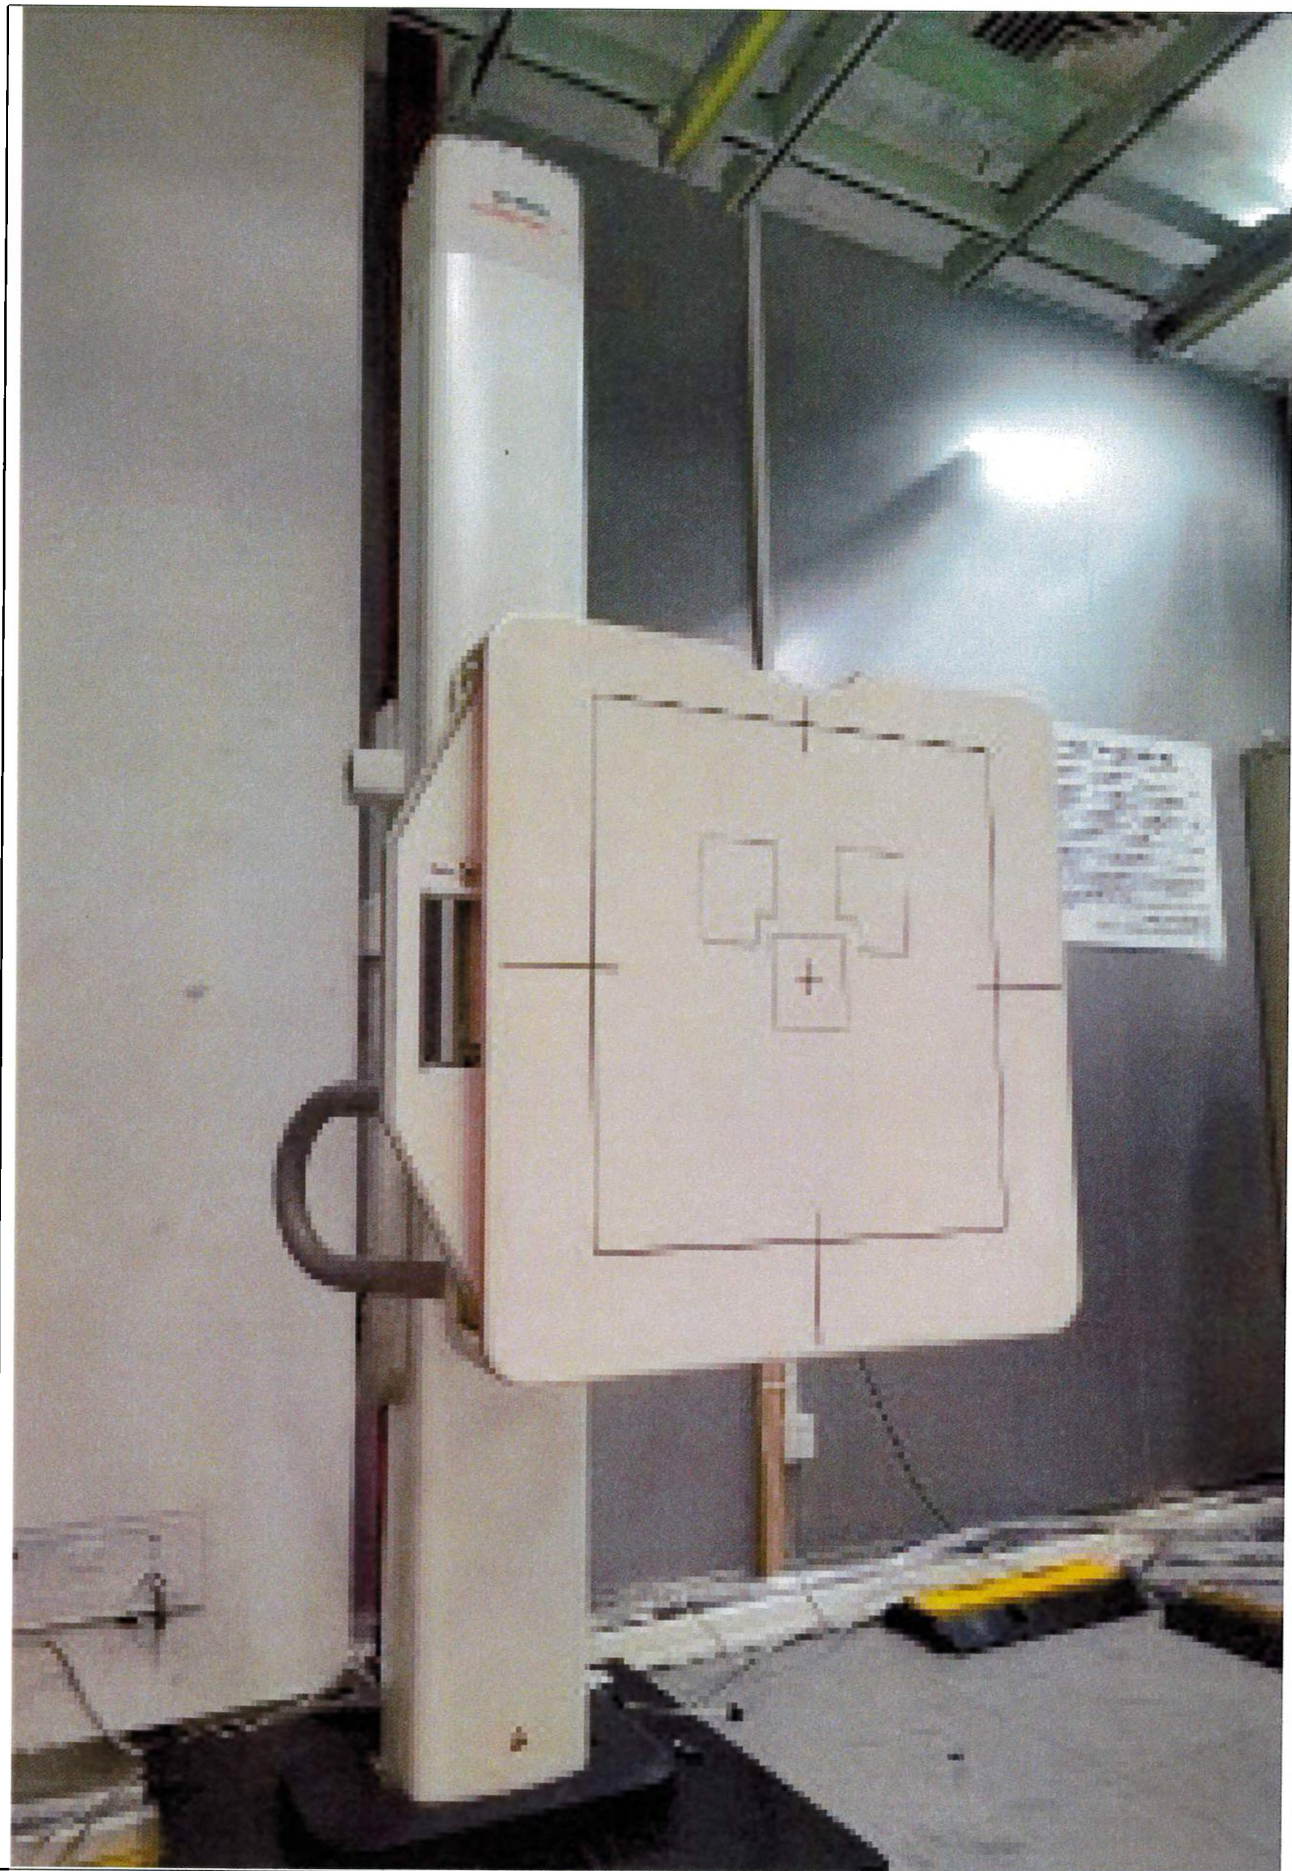

4. Стойка вертикальная для беспроводного детектора Core XL.

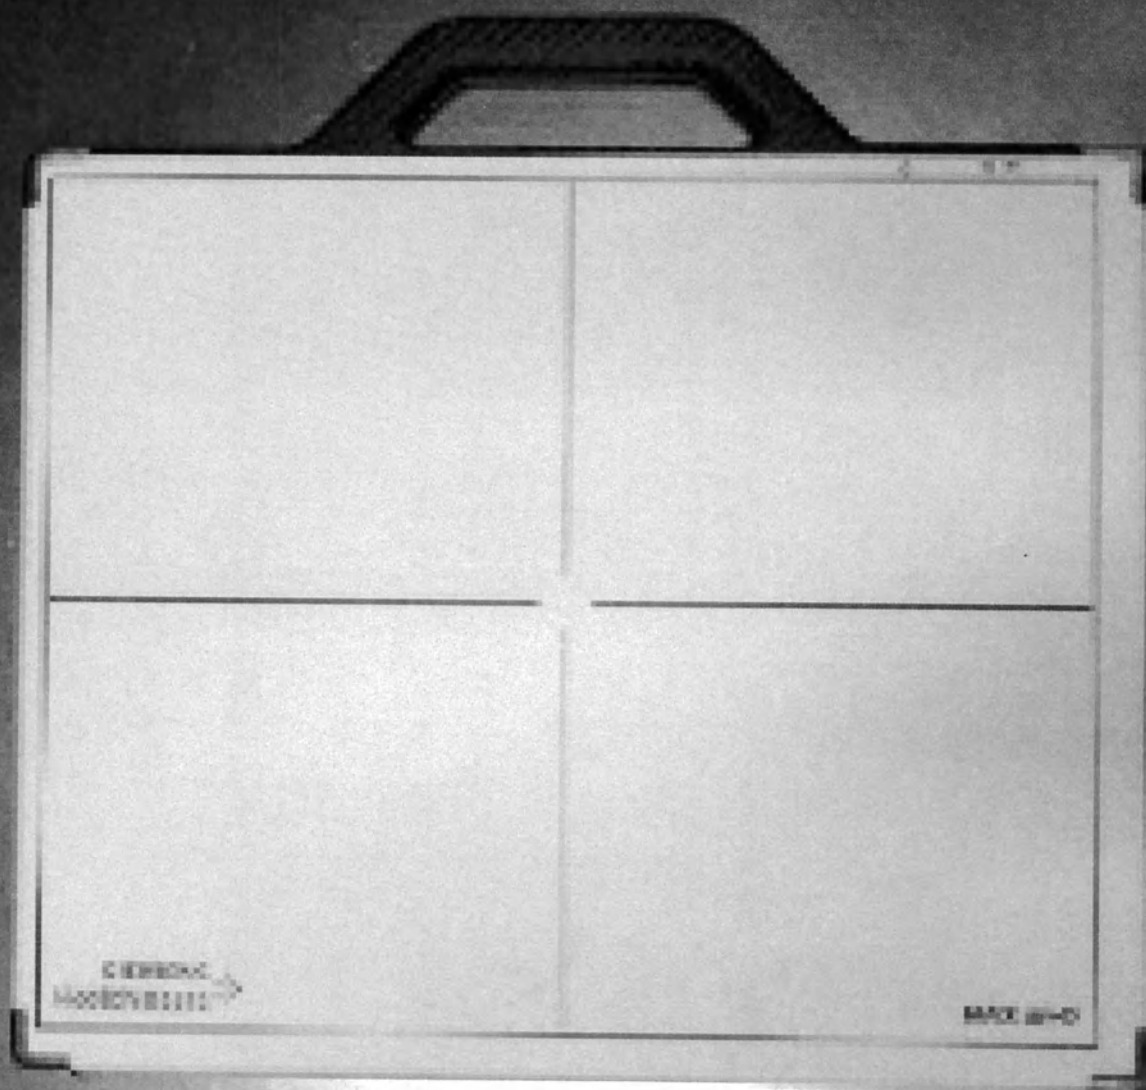





7. Генератор рентгеновский, вариант исполнения: - 55 кВт., 65 кВт, 80 кВт.
(Изображение распространяется на все варианты исполнения)



8. Станция формирования изображений сенсорная с базовым программным обеспечением.



9. Станция формирования изображений с базовым программным обеспечением, мышью и клавиатурой.



MULTIX Impact C

Руководство пользователя
VA20


11. Документация пользователя на русском языке.




1.1. Потолочный штатив MULTIX Impact C с панелью управления, рентгеновским излучателем, сенсорным интерфейсом пользователя и коллиматором, вариант исполнения: - стандартный, - с моторизованным наклоном. (Изображение распространяется на все варианты исполнения)



2. Стойка вертикальная со стационарным детектором Core static.

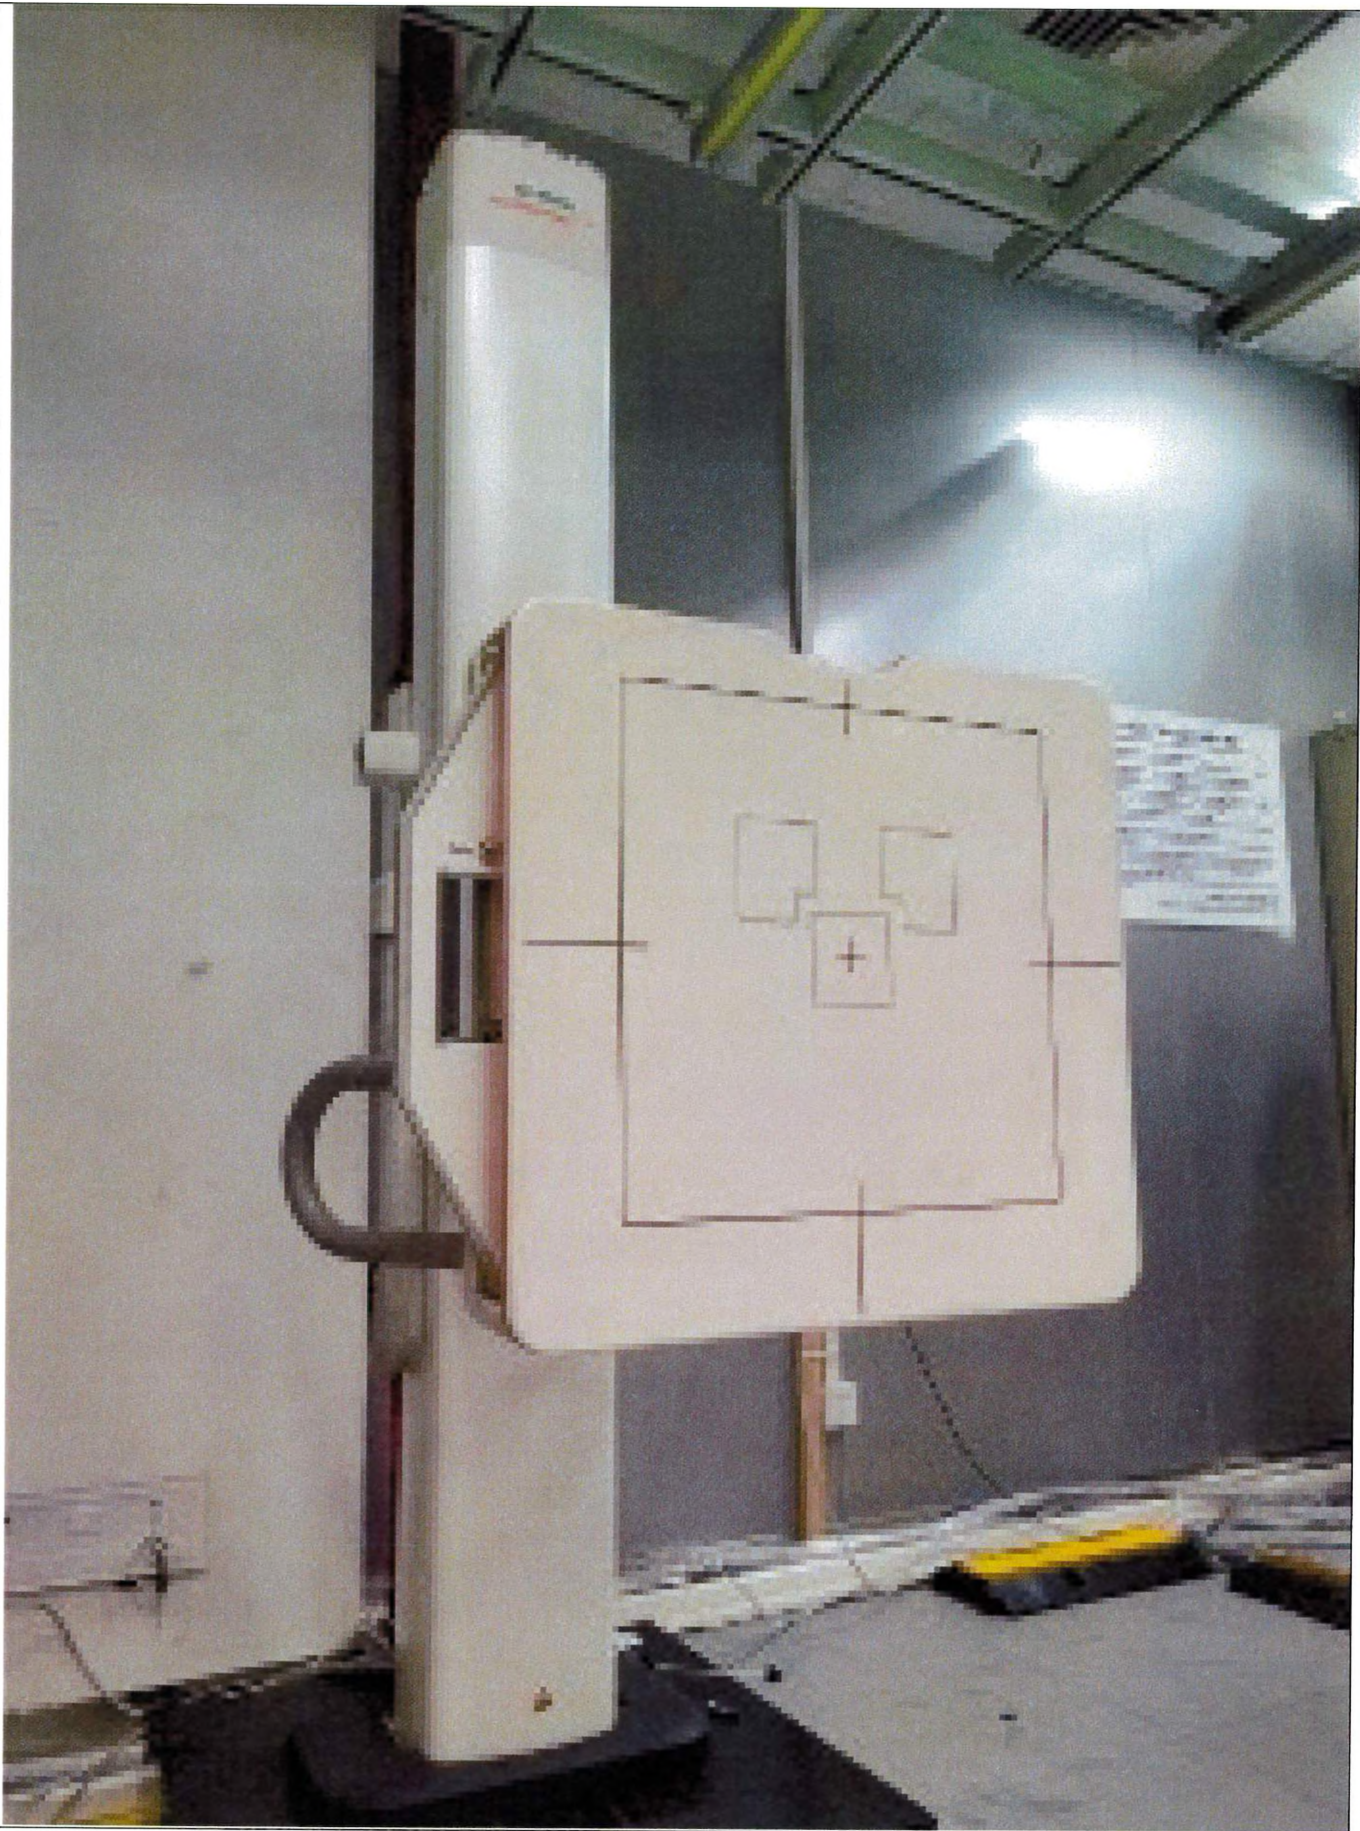


3. Стойка вертикальная для беспроводного детектора MAX wi-D.

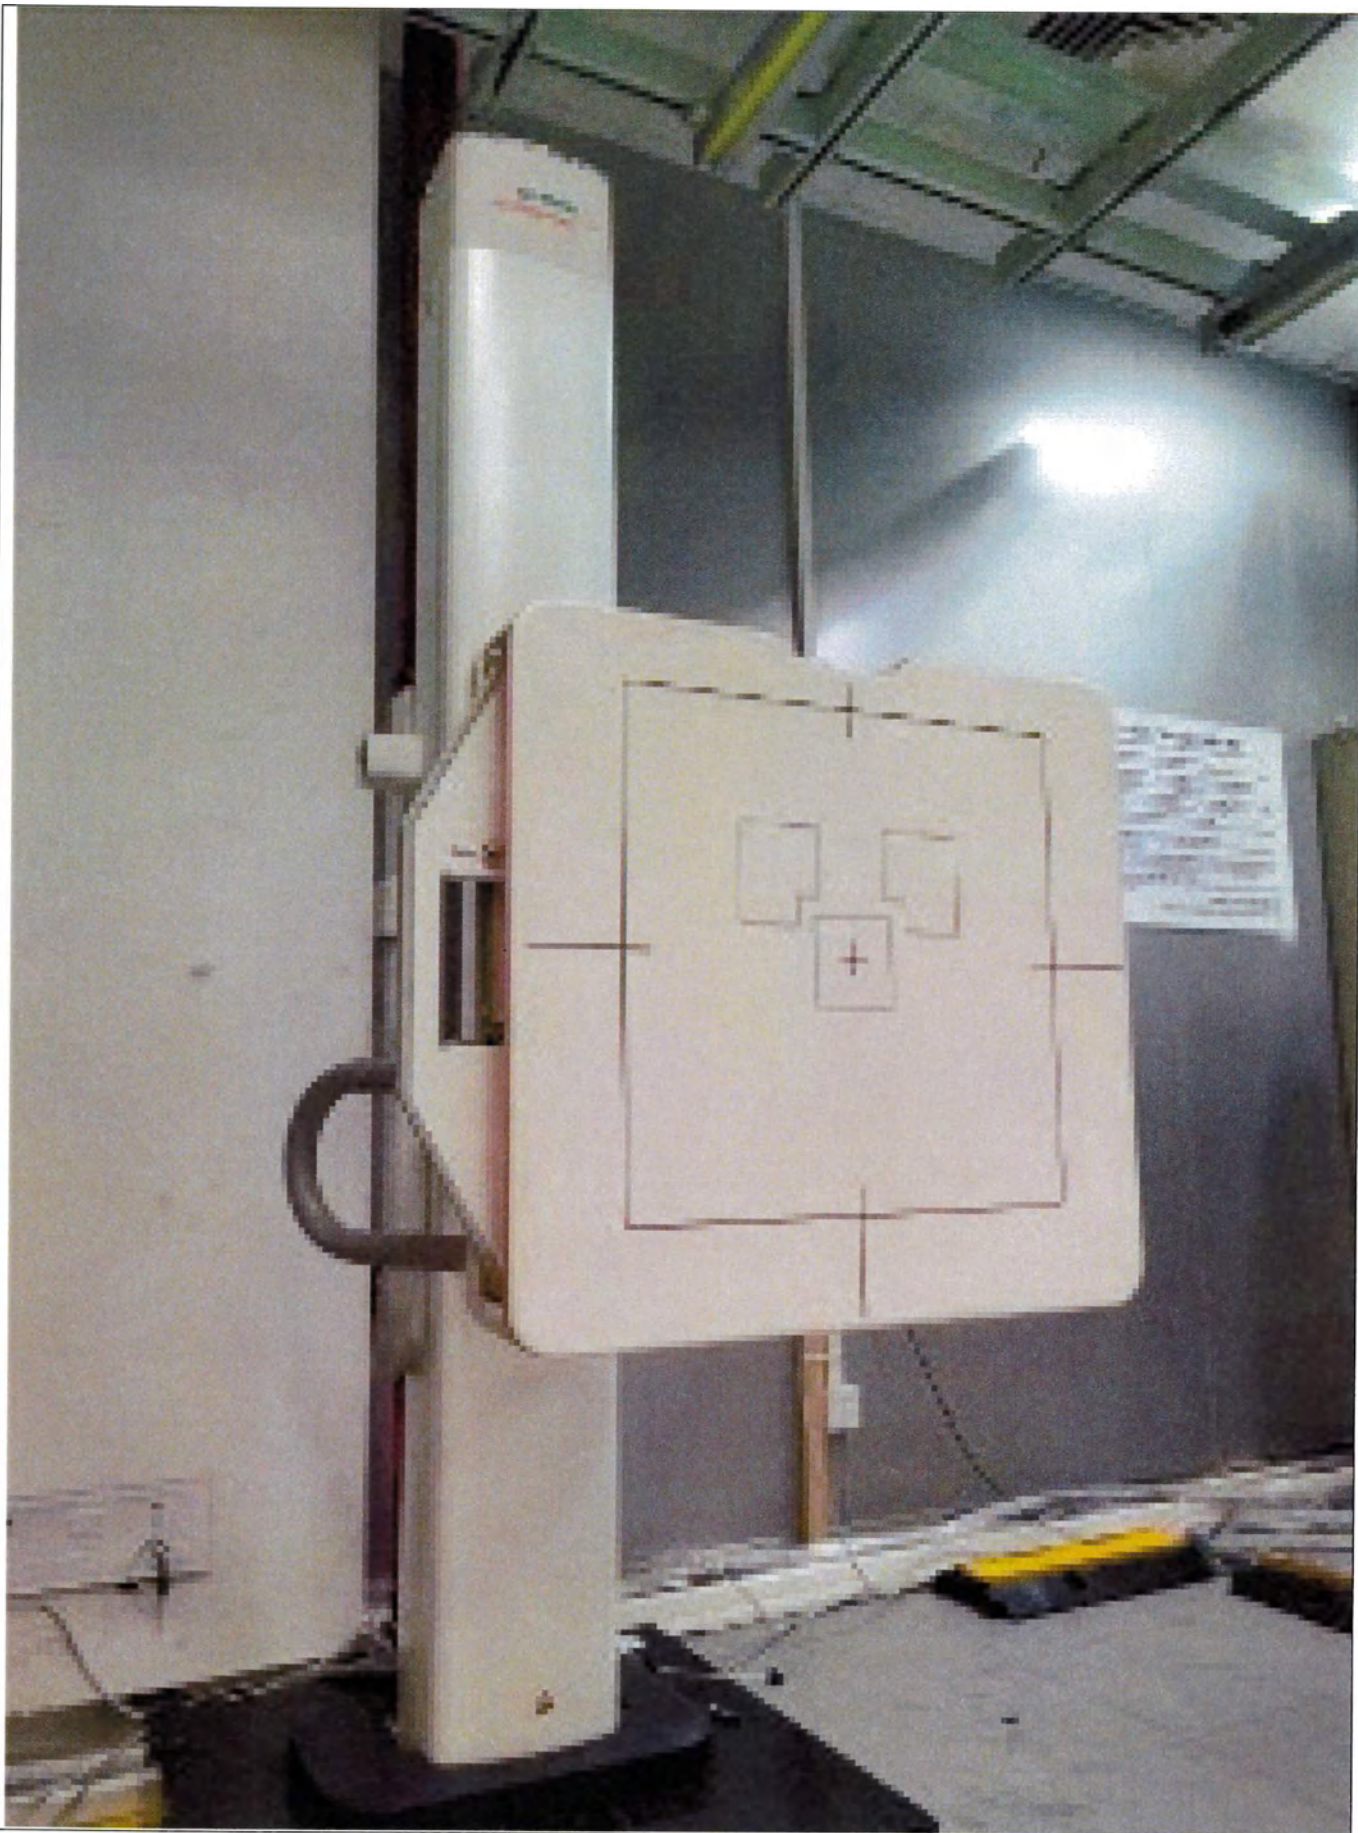


4. Стойка вертикальная для беспроводного детектора Core XL.





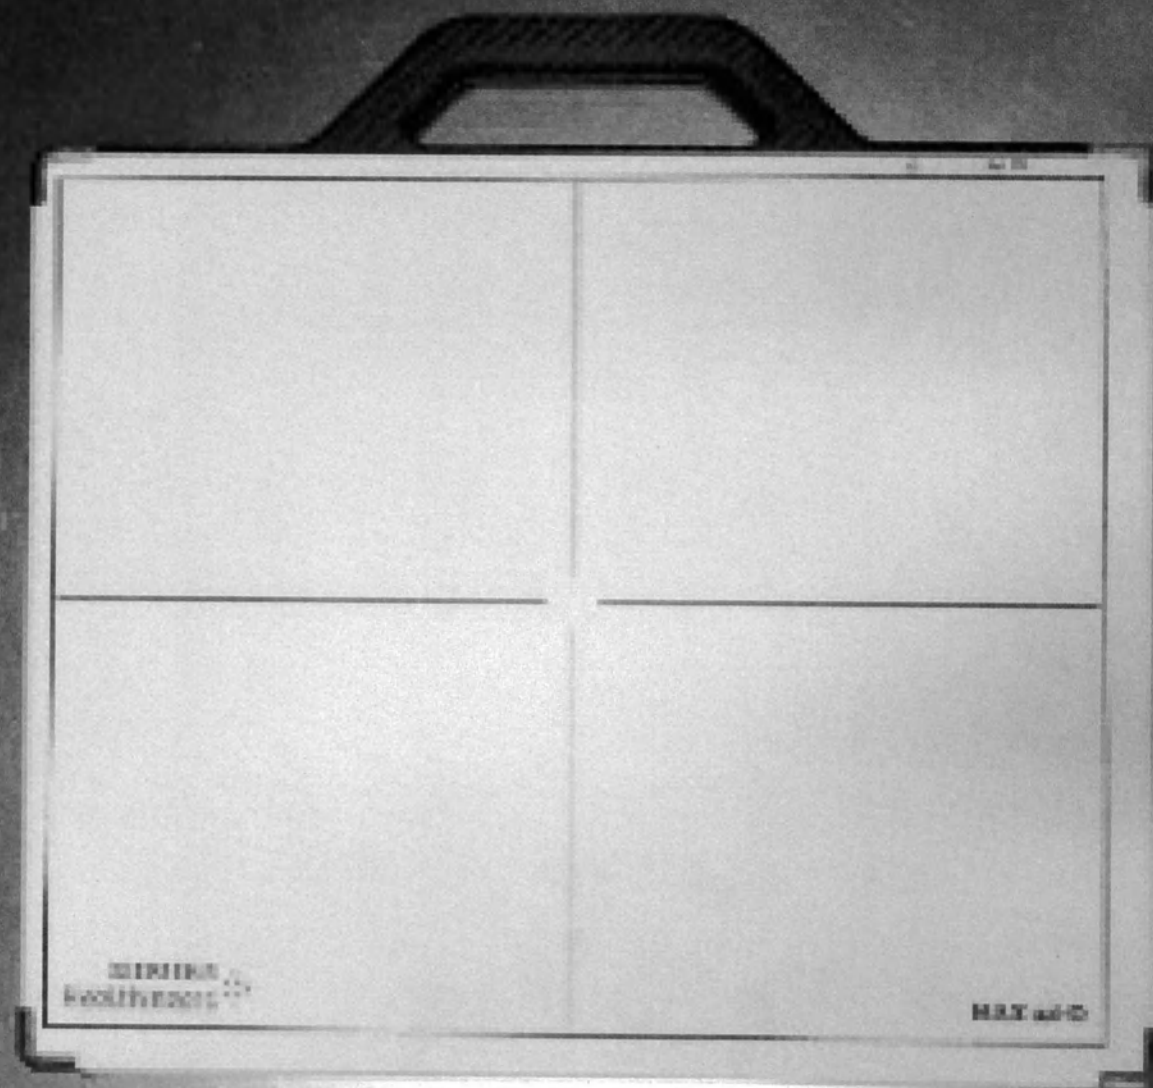

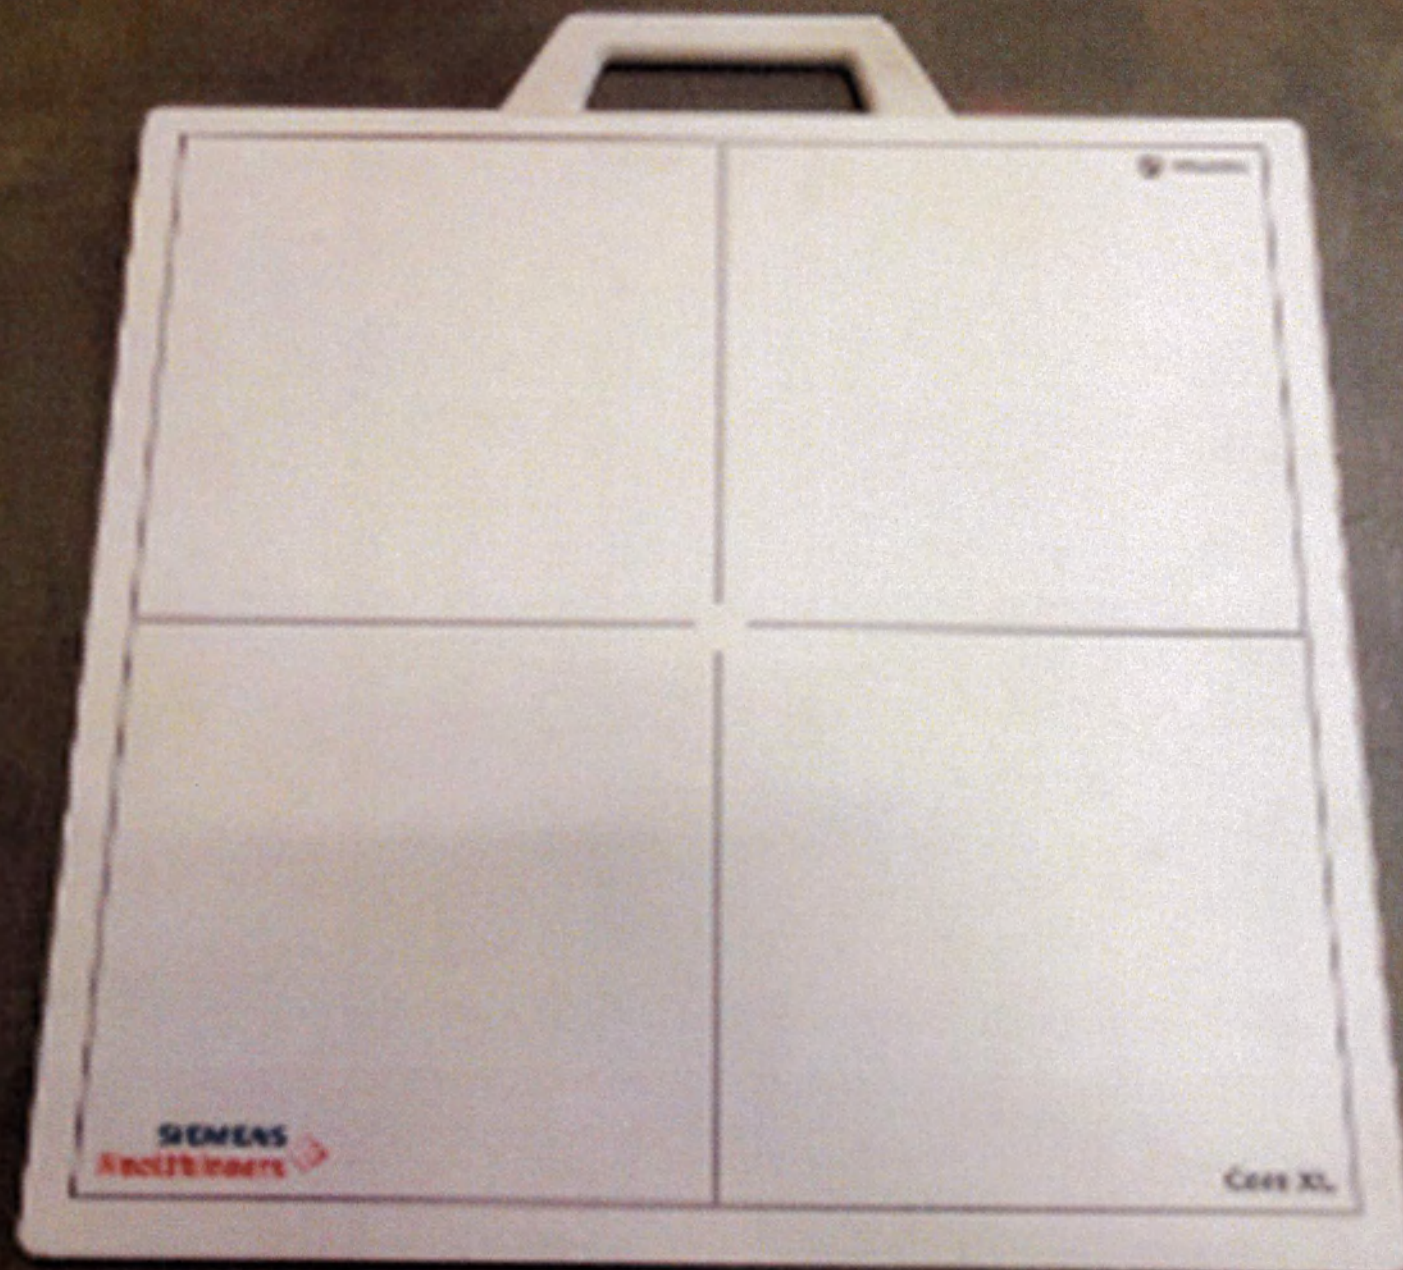




9. Генератор рентгеновский, вариант исполнения: - 55 кВт, - 65 кВт, - 80 кВт.
(Изображение распространяется на все варианты исполнения)





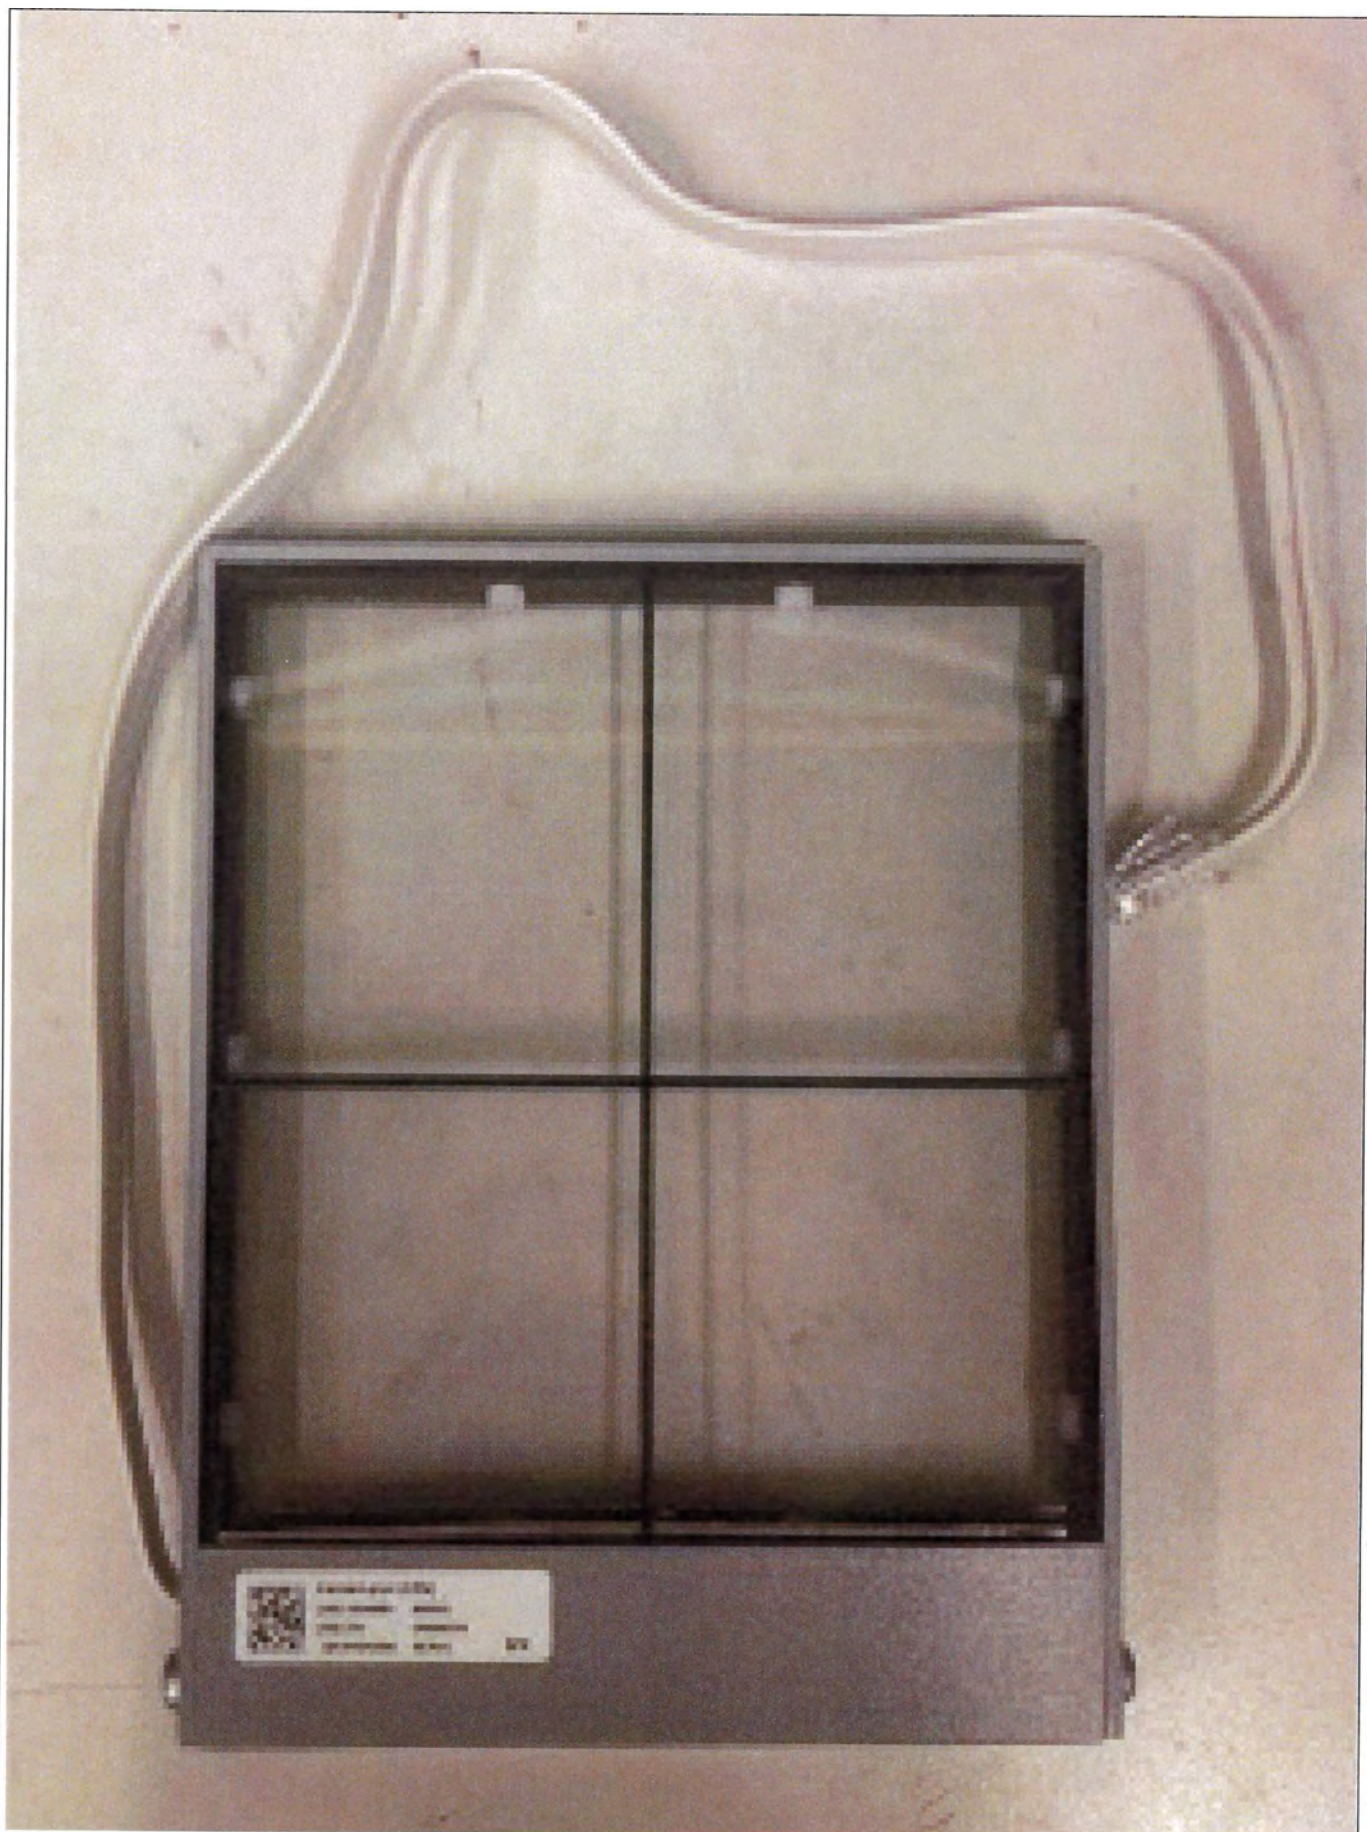

12. Устройство для измерения дозы.




MULTIX Impact C


Руководство пользователя
VA20

13. Документация пользователя на русском языке.

Принадлежности:

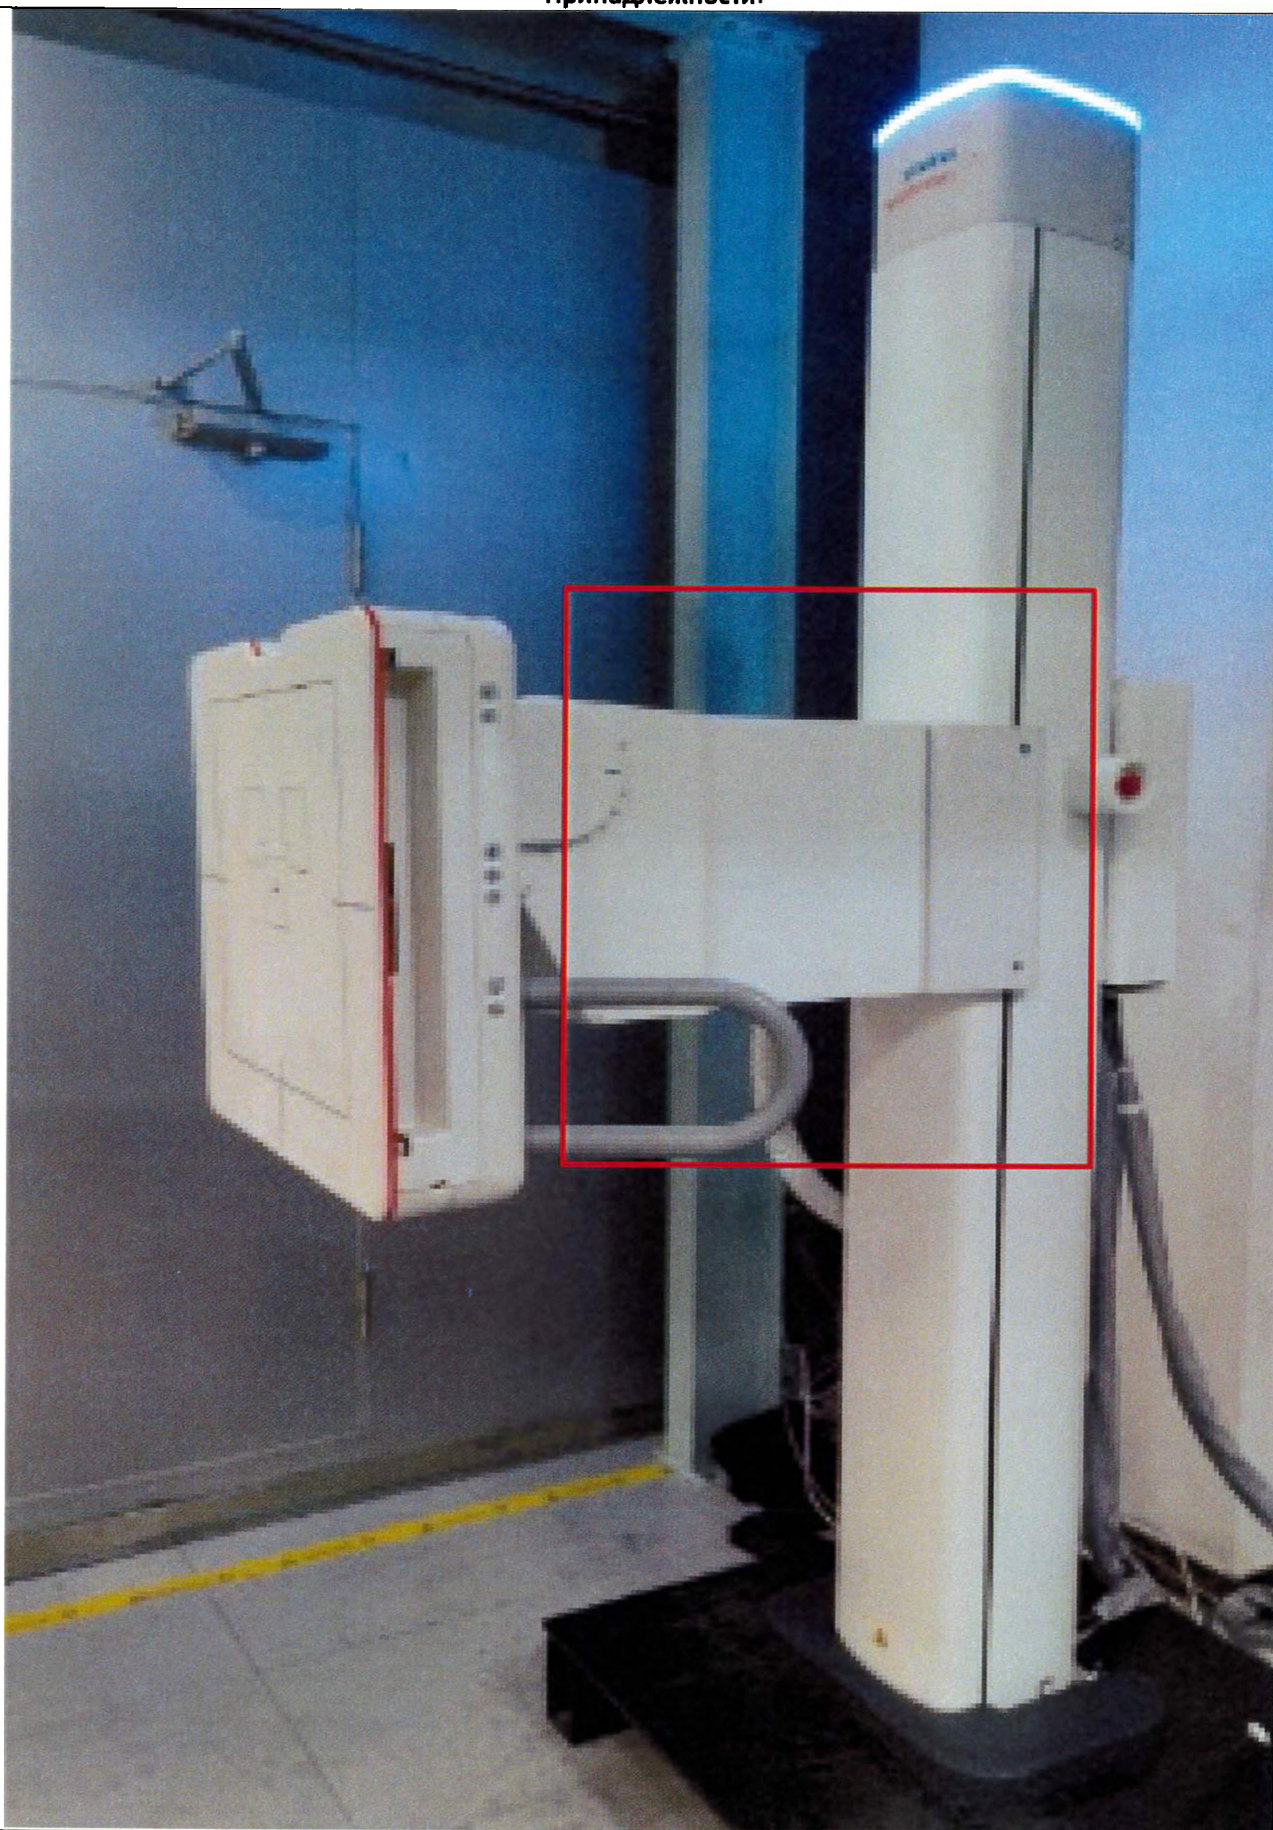



1. Удлинение для вертикальной стойки.

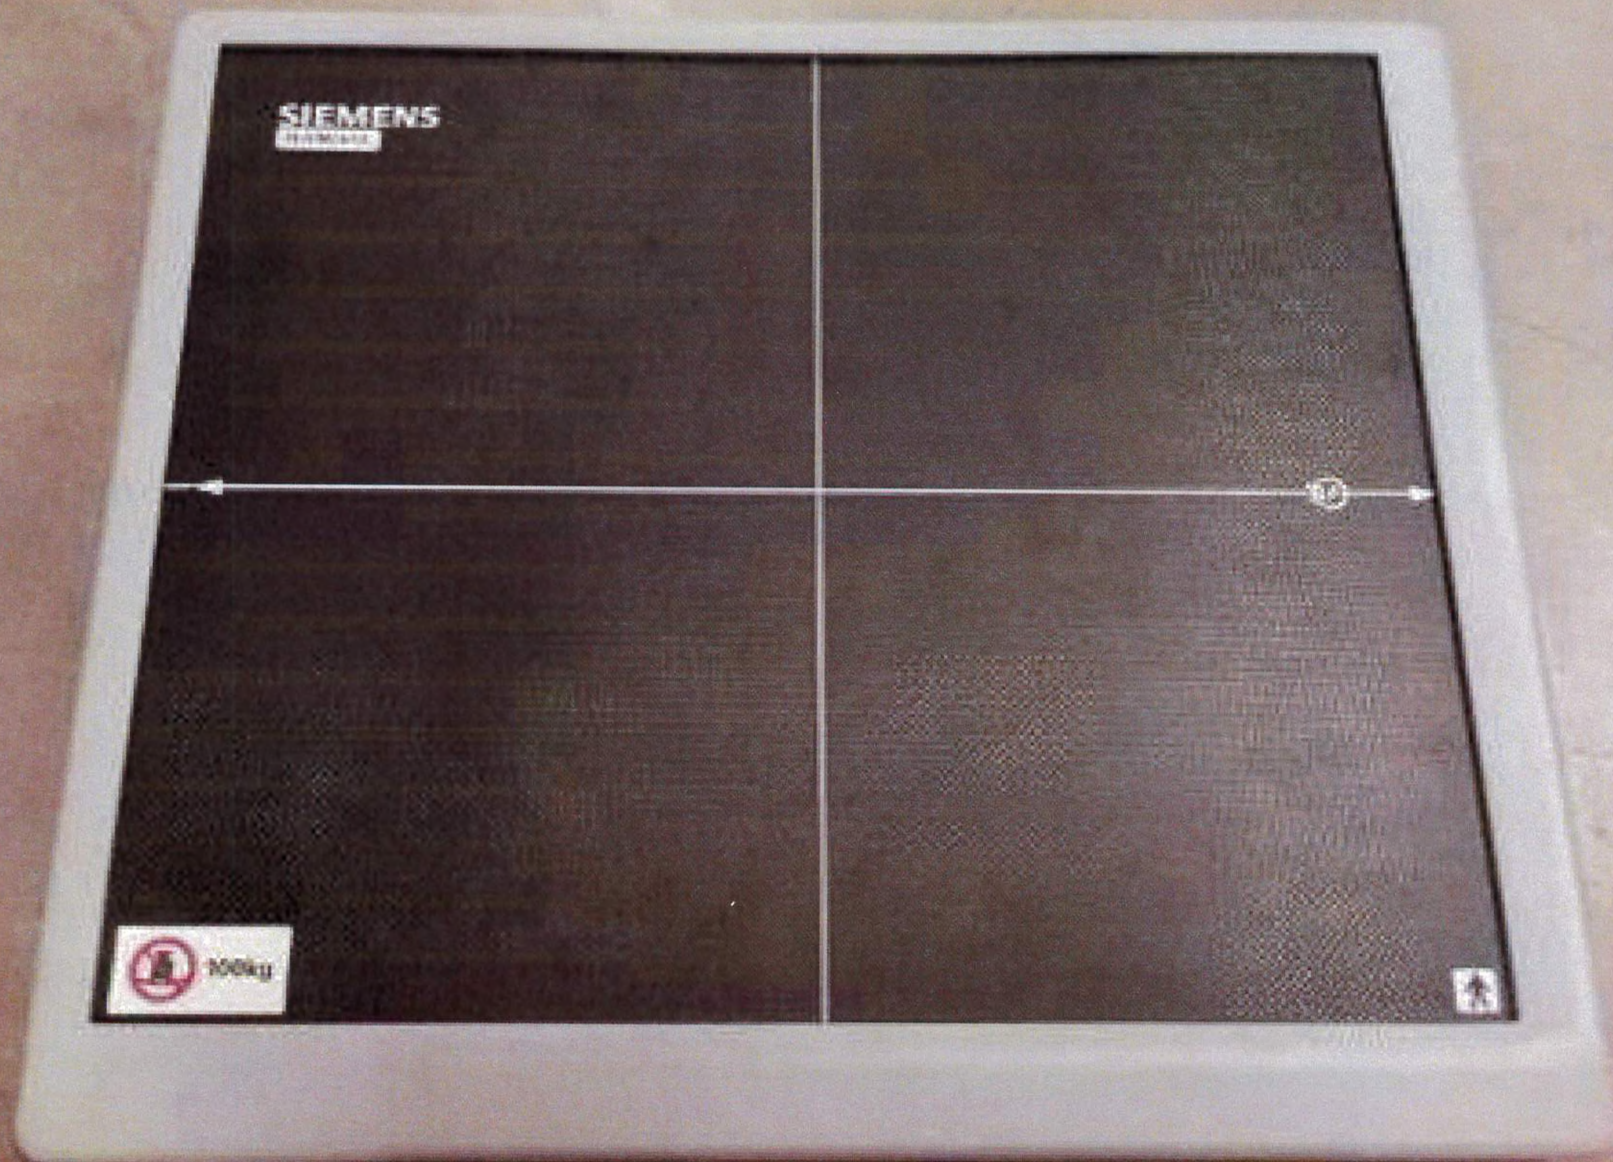


2. Решетка отсеивающая для детектора MAX wi-D (5/85, F115).



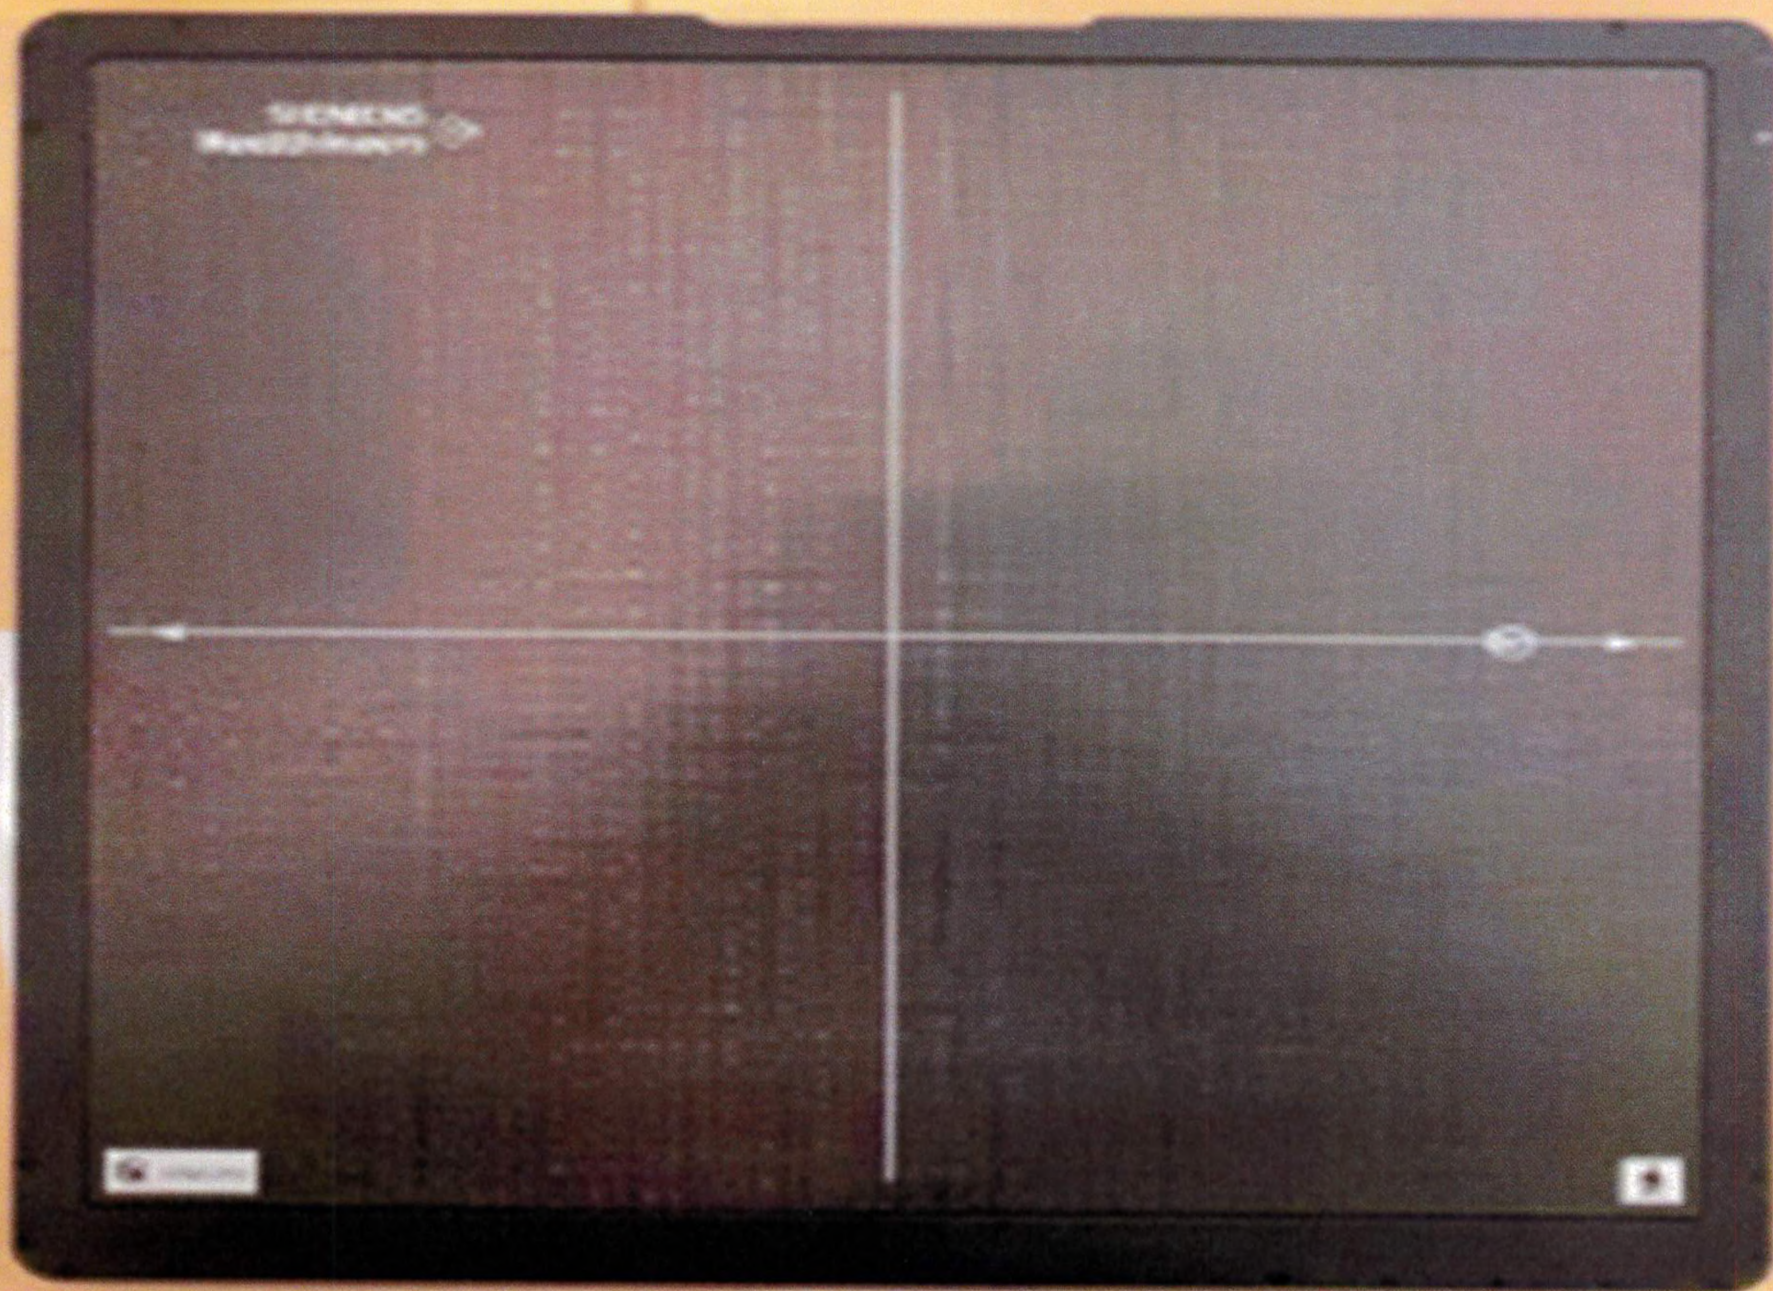


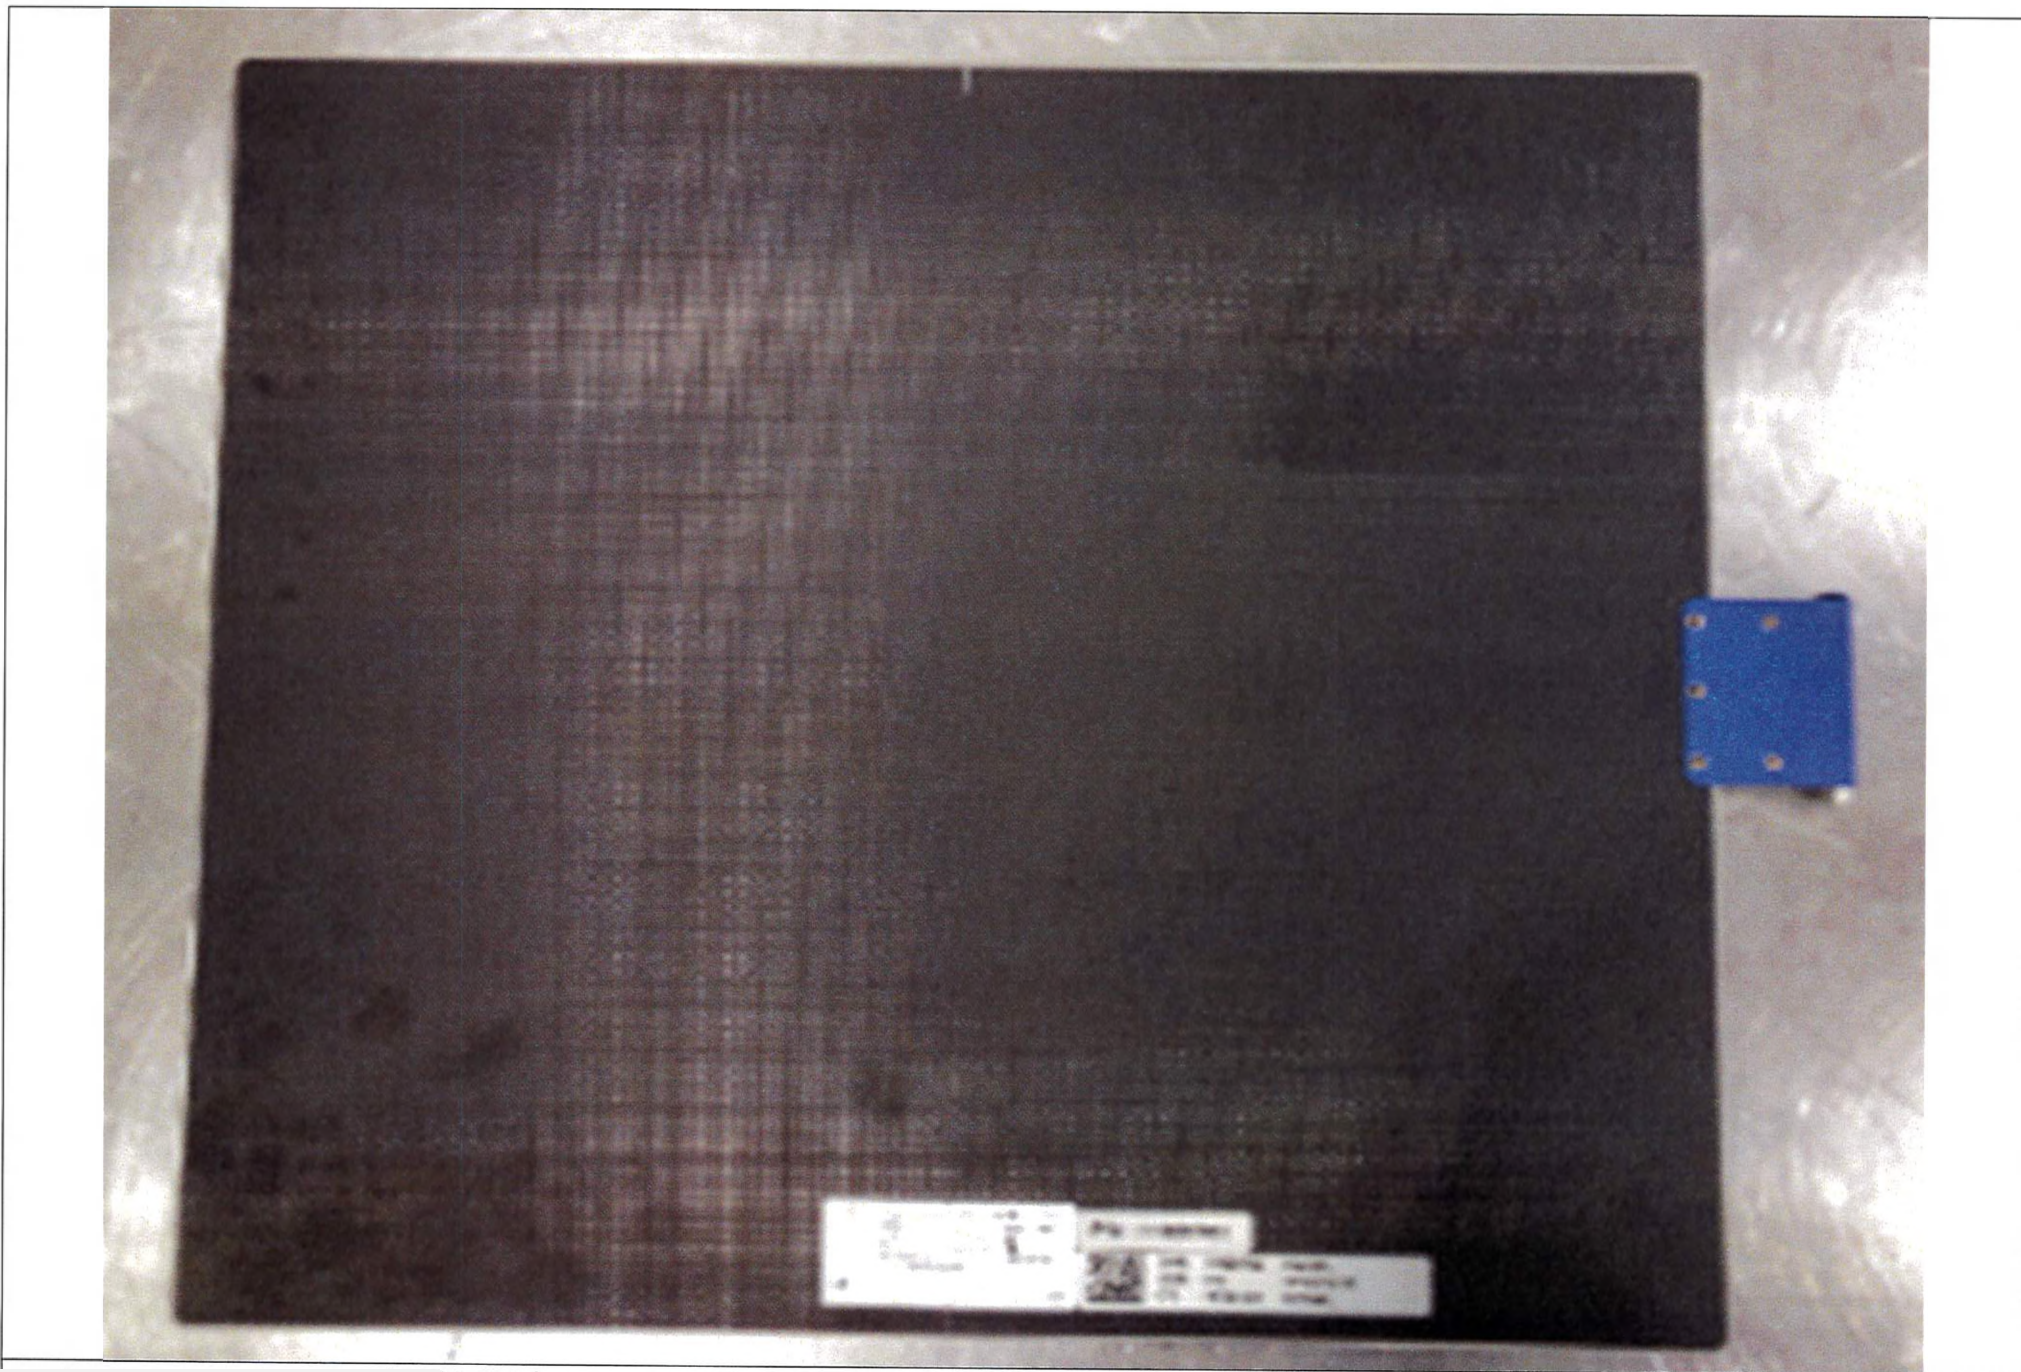


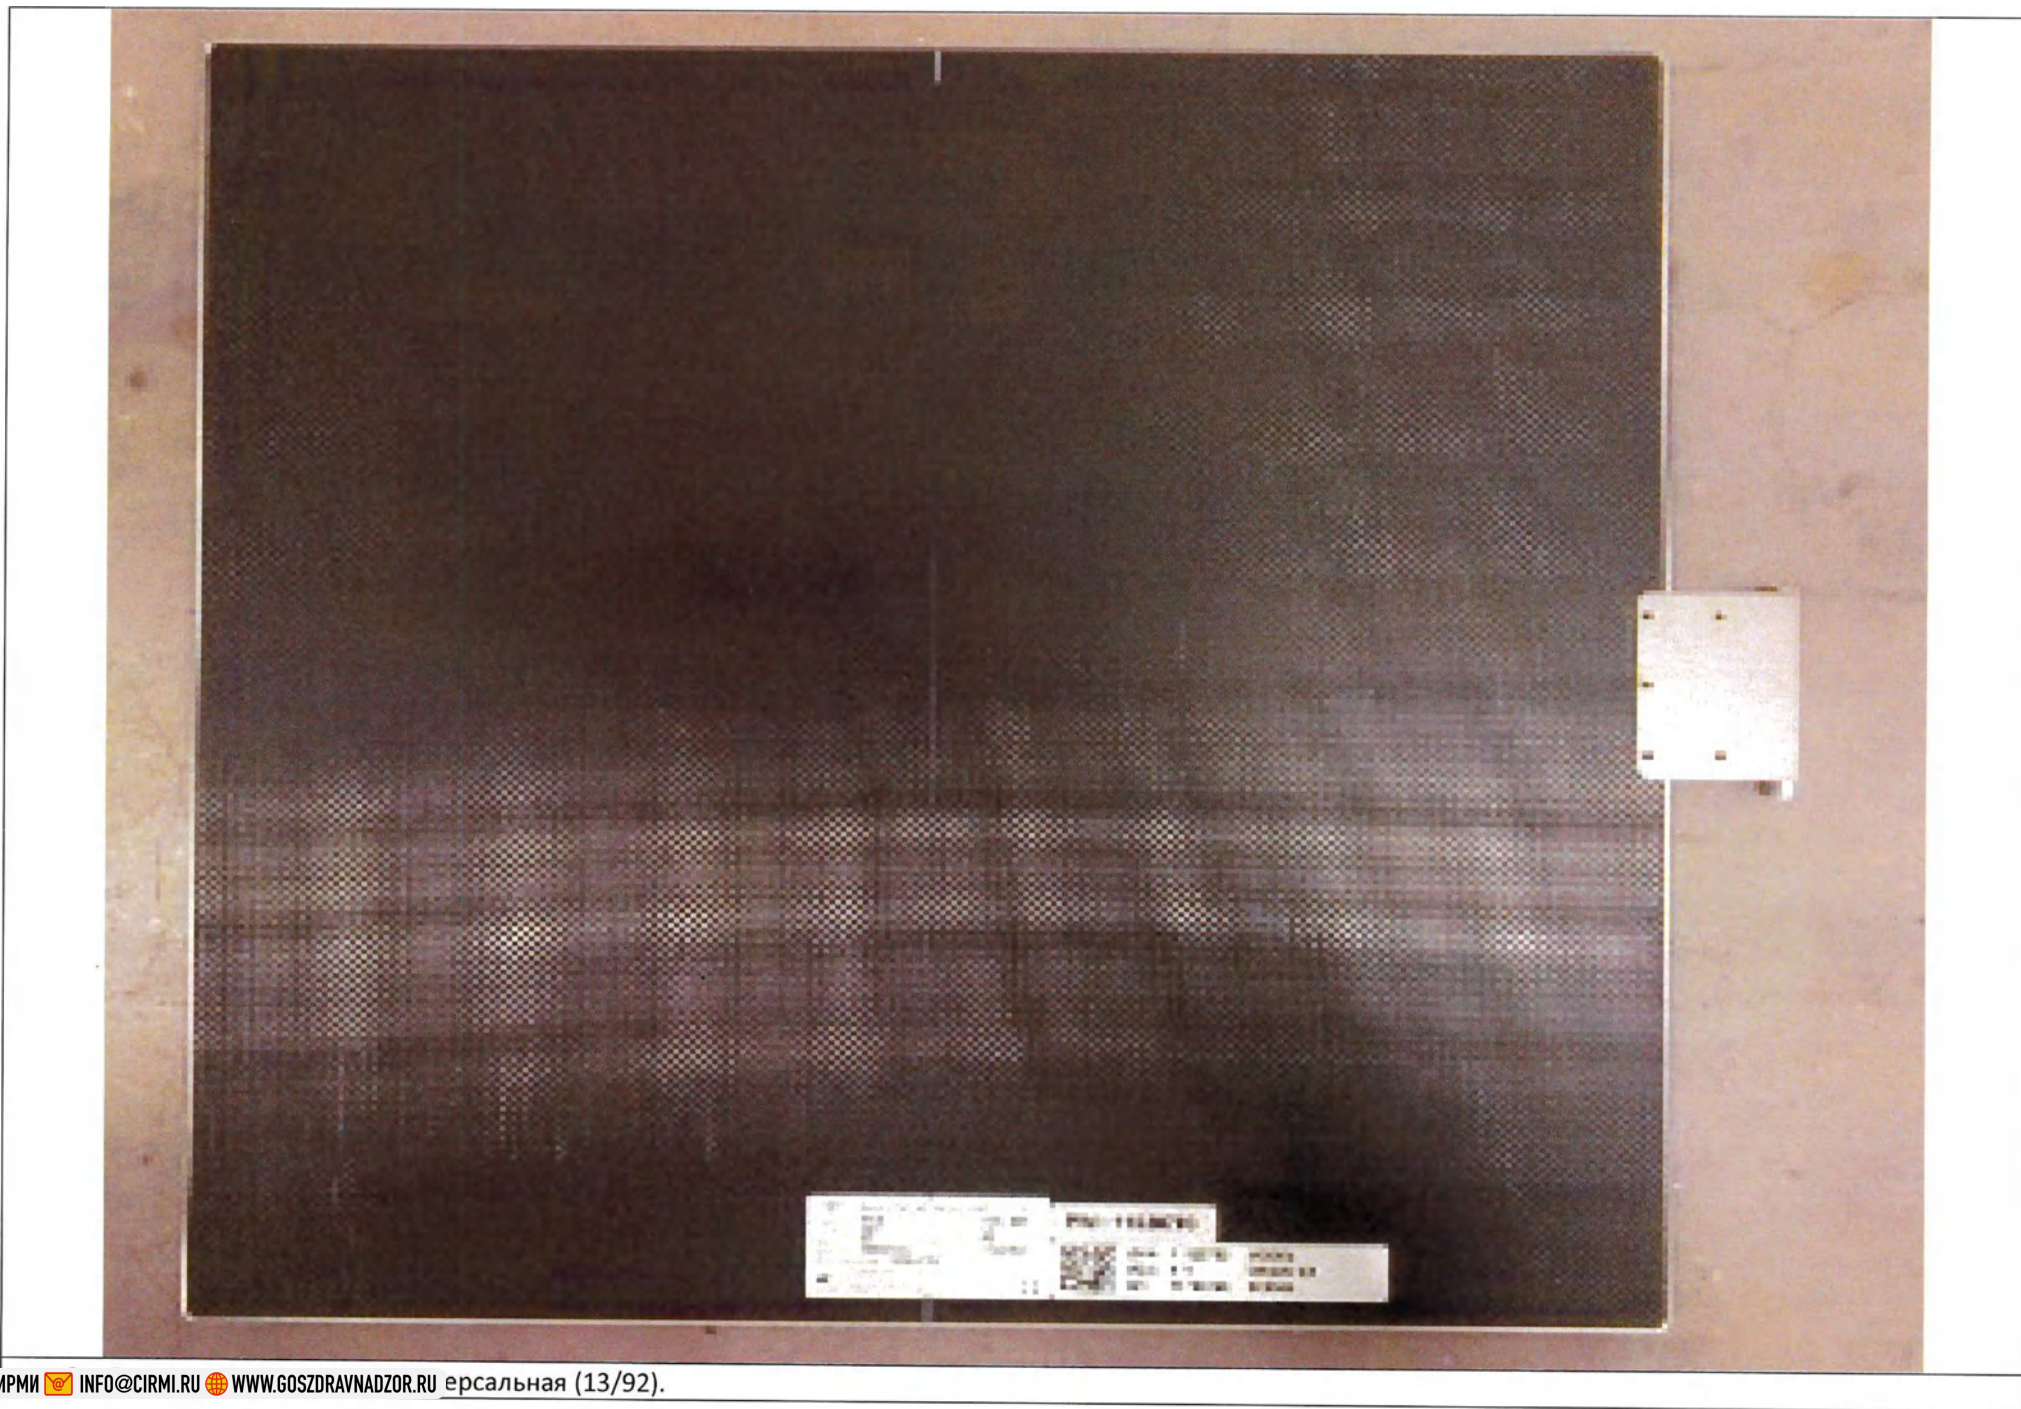







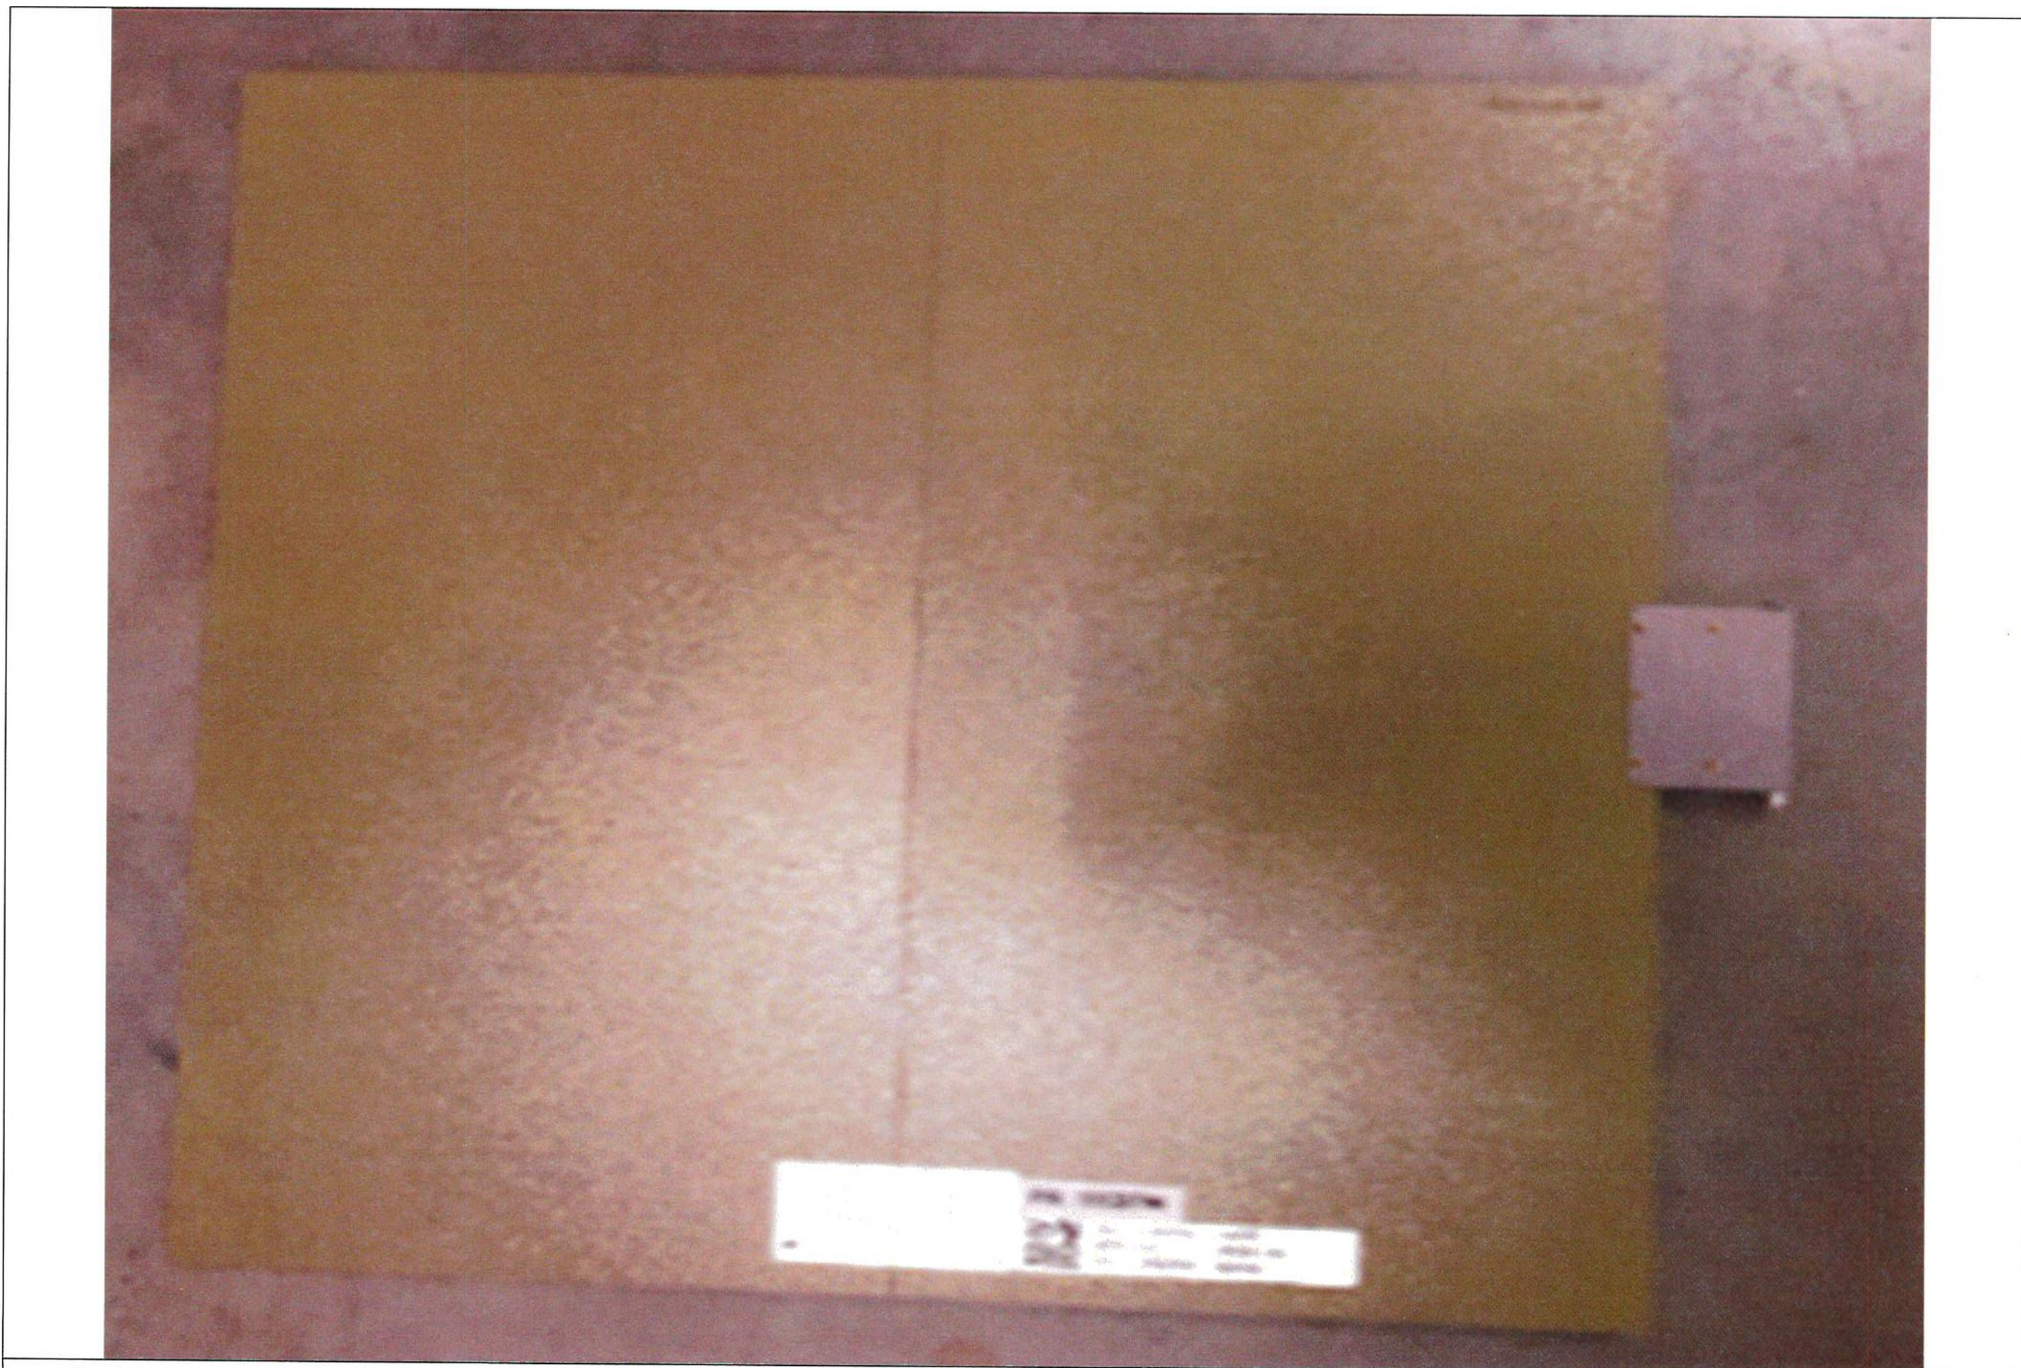

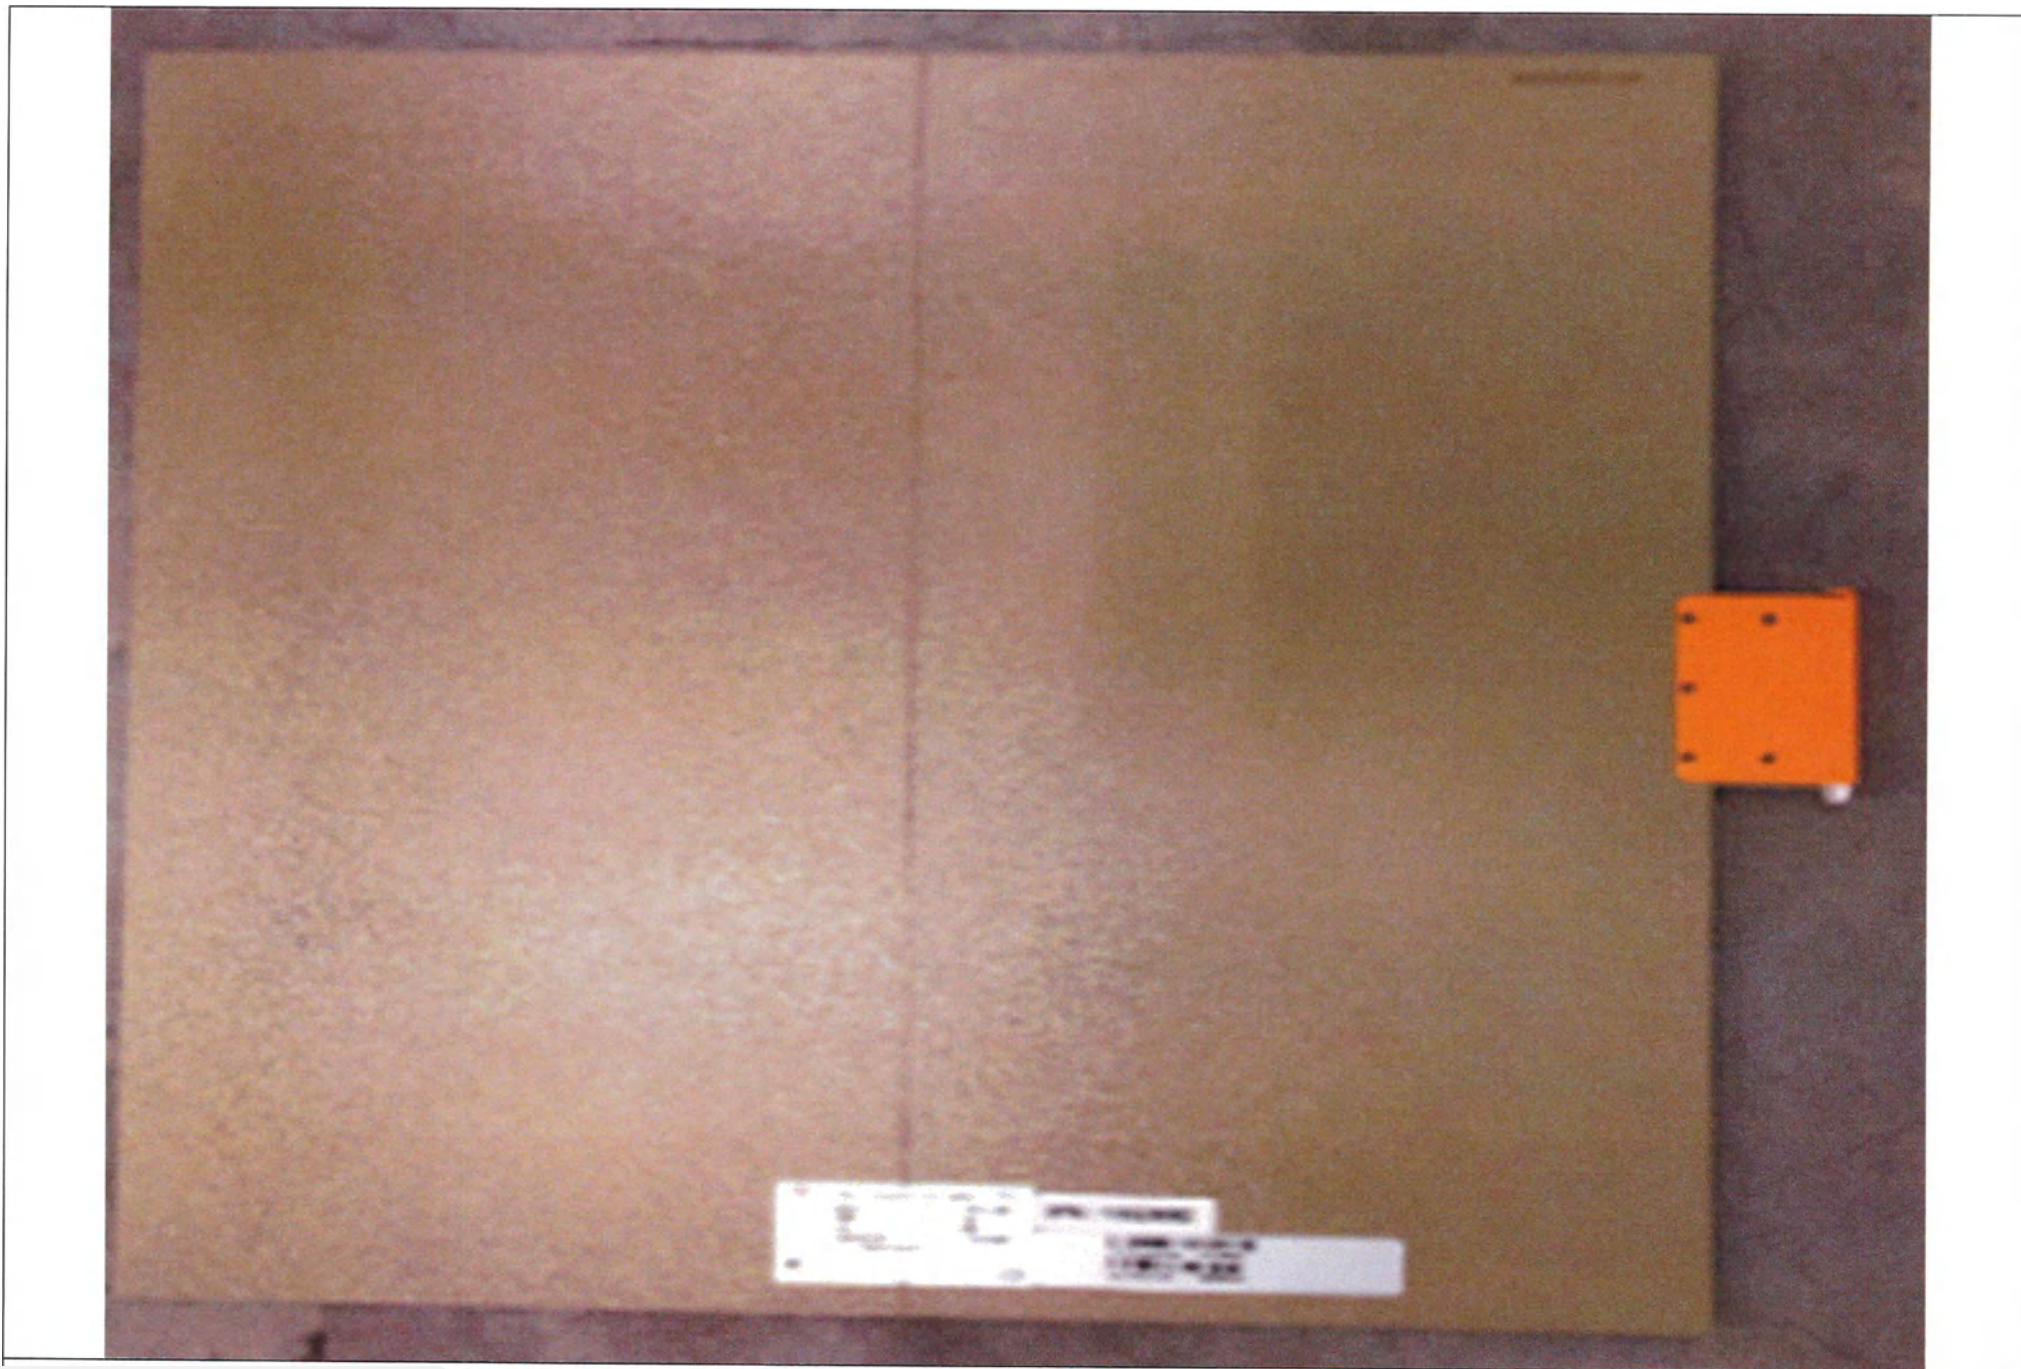

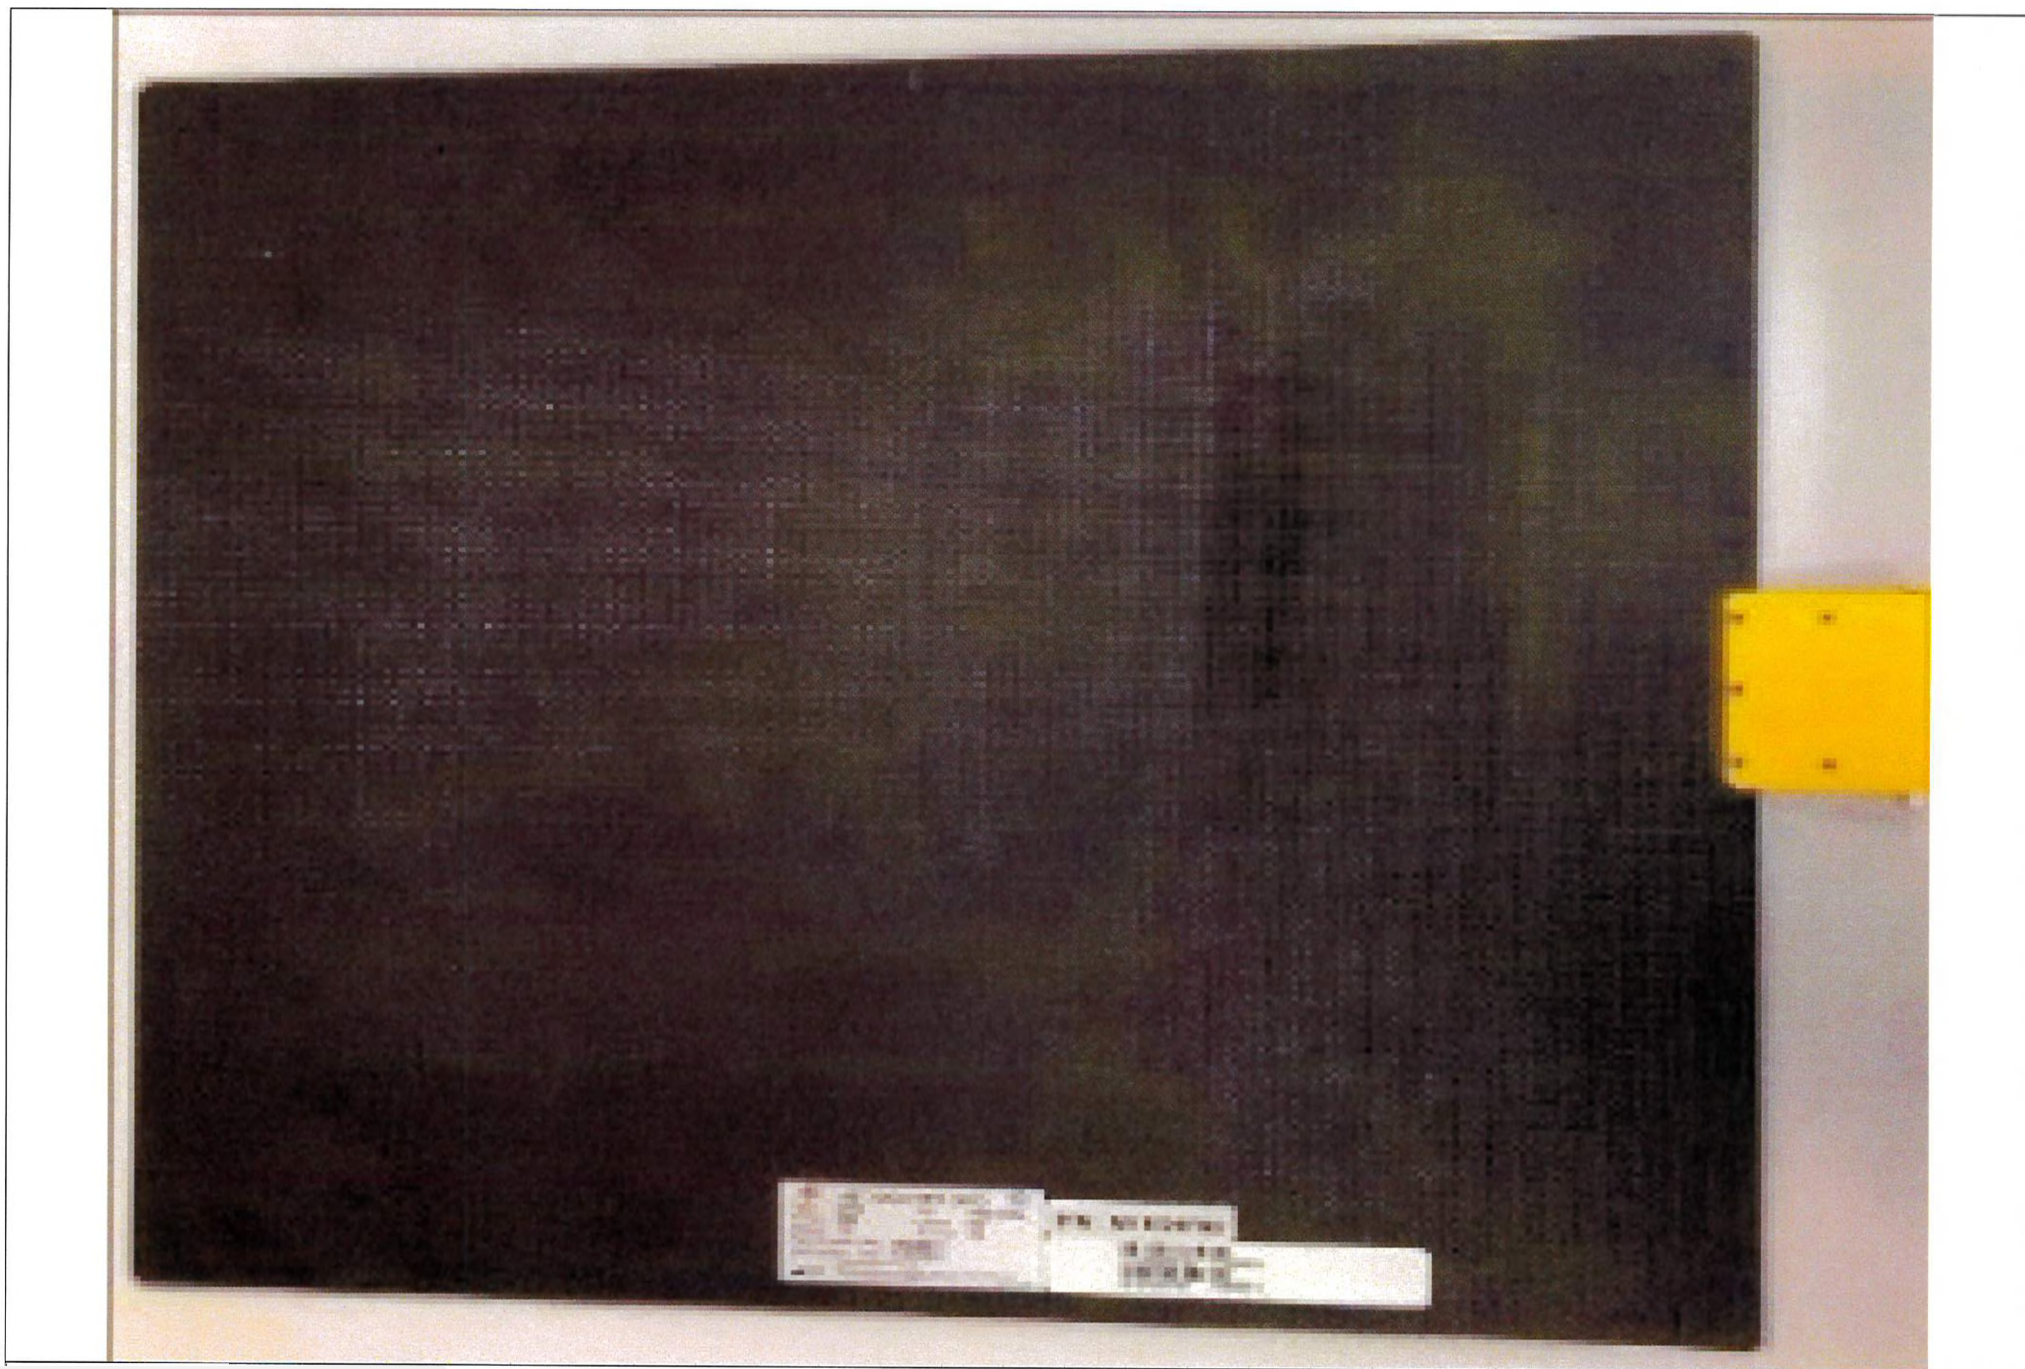

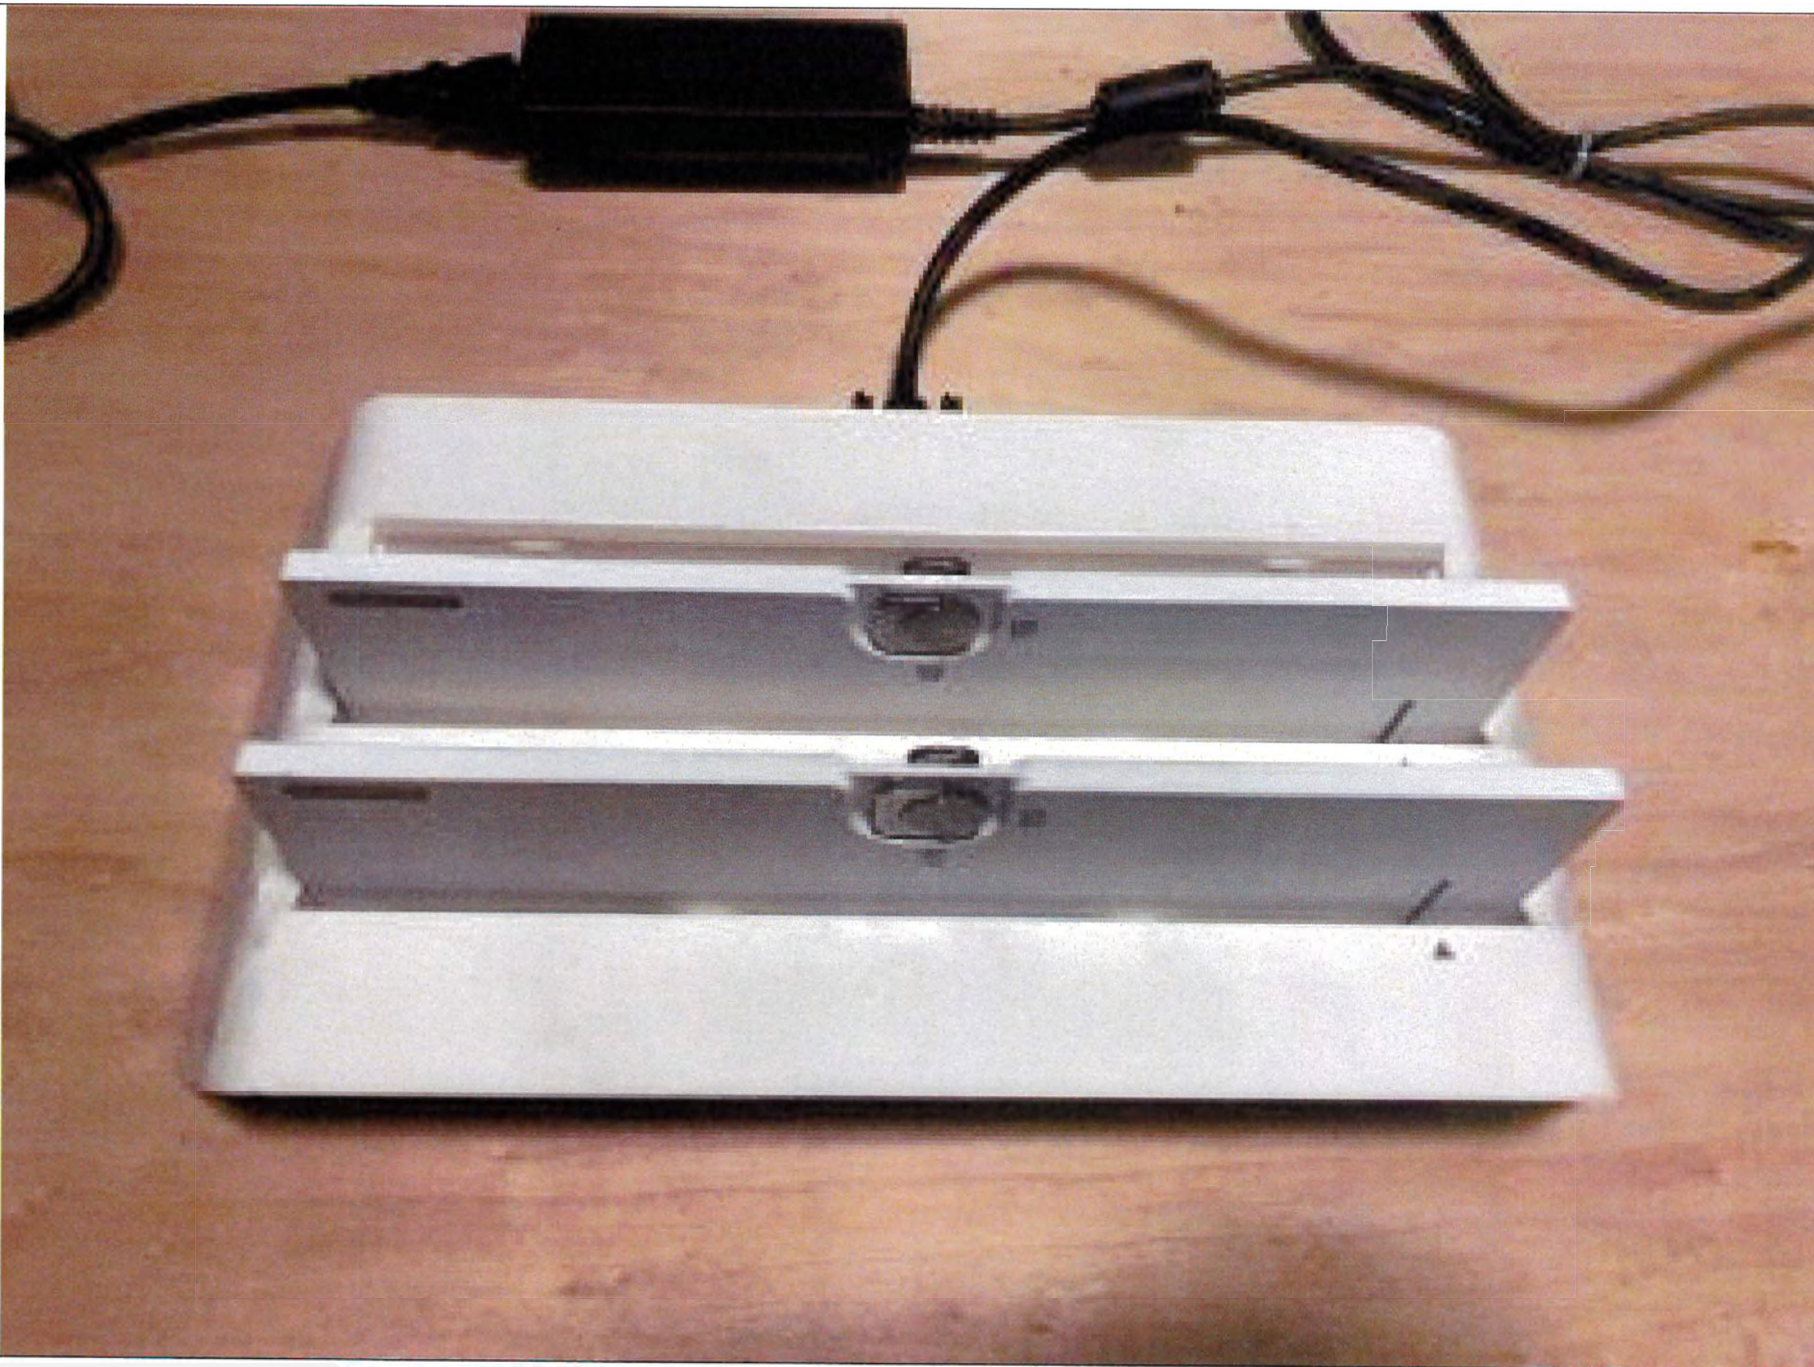

S/N: CNJMK9T6S0
MAC: E8268C2C176
BLE MAC: F830023D3DA1

REMOVE THIS
ENTIRE LABEL
USE AS NEEDED




Aruba303 RoW
(01)04050809274401 GTIN
(240)11333838 Model
(422)156 Origin CN
(21)CNJMK9T6S0 Serial
(01)01 Revision

aruba




14. 2 Точка доступа беспроводного соединения WLAN для детекторов.

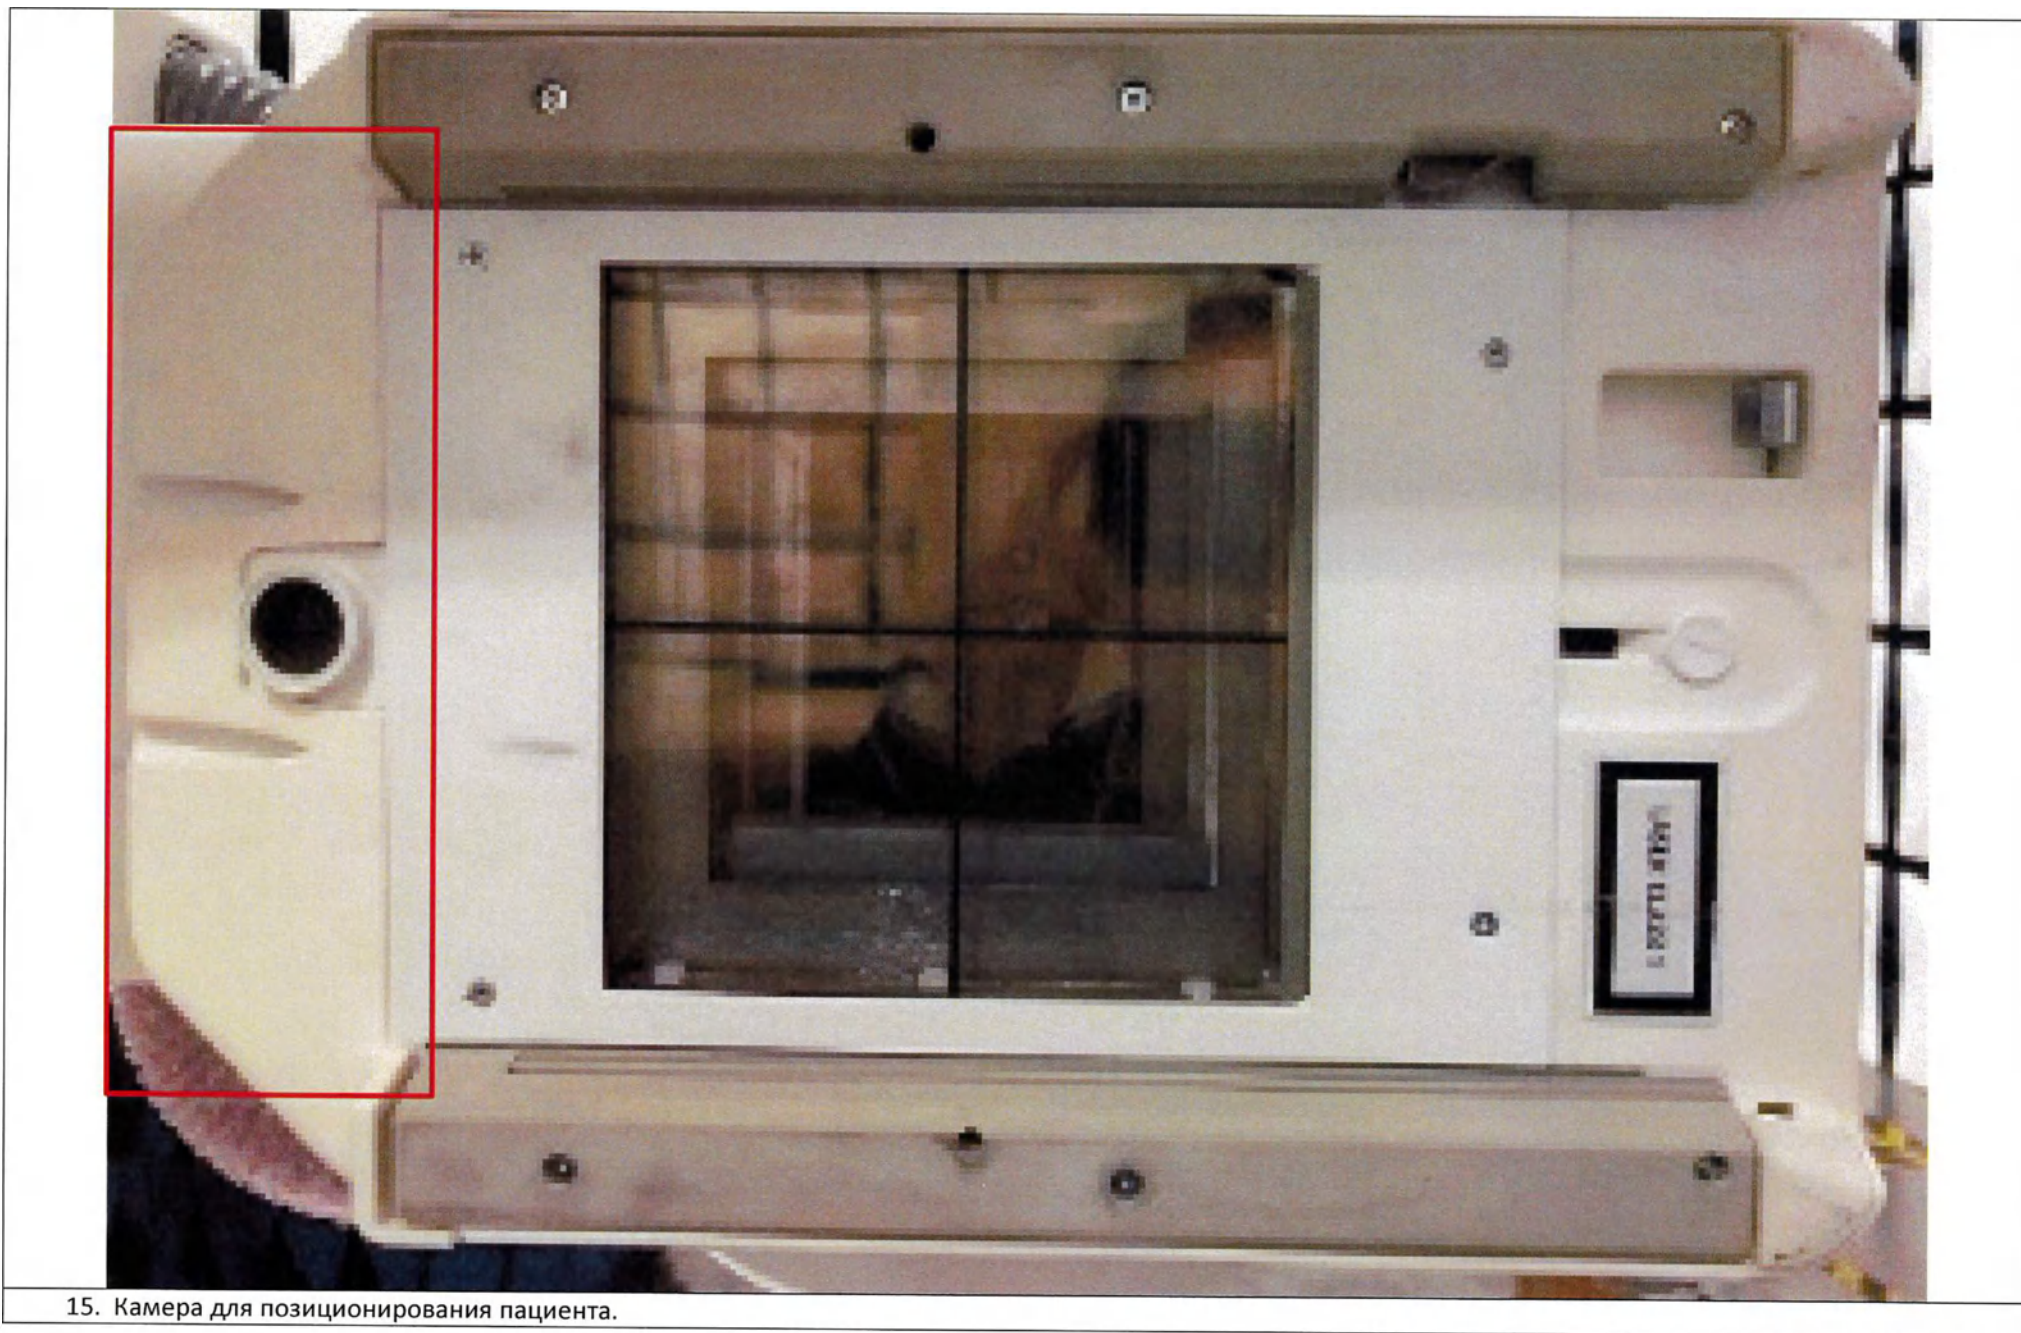


15. Камера для позиционирования пациента.




16. Программный режим изменения мощности генератора.

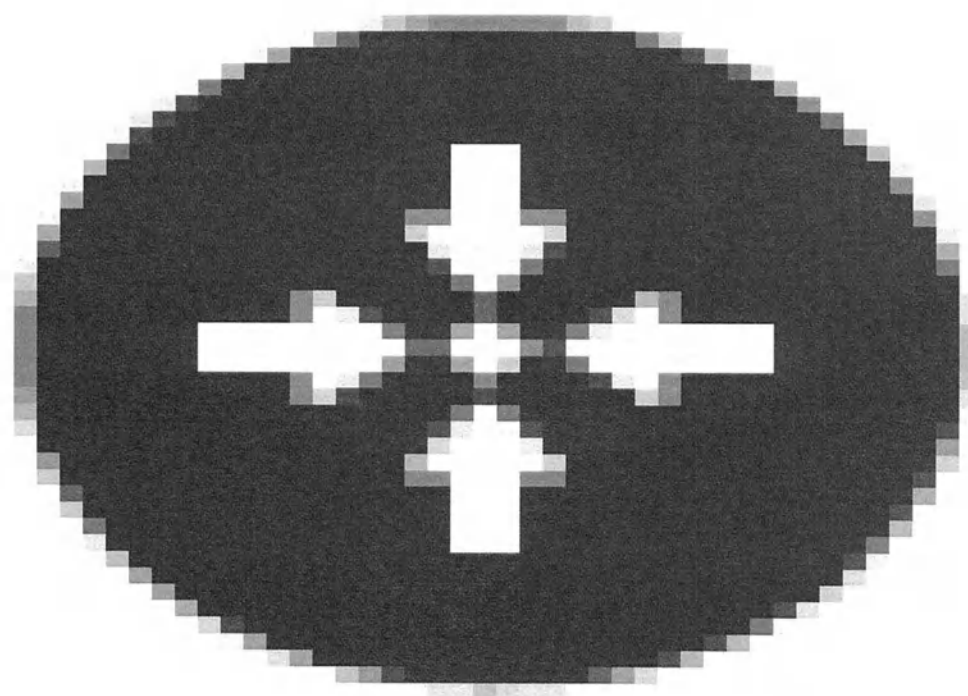


17. Программный режим автоматического позиционирования системы SmartPositioning.

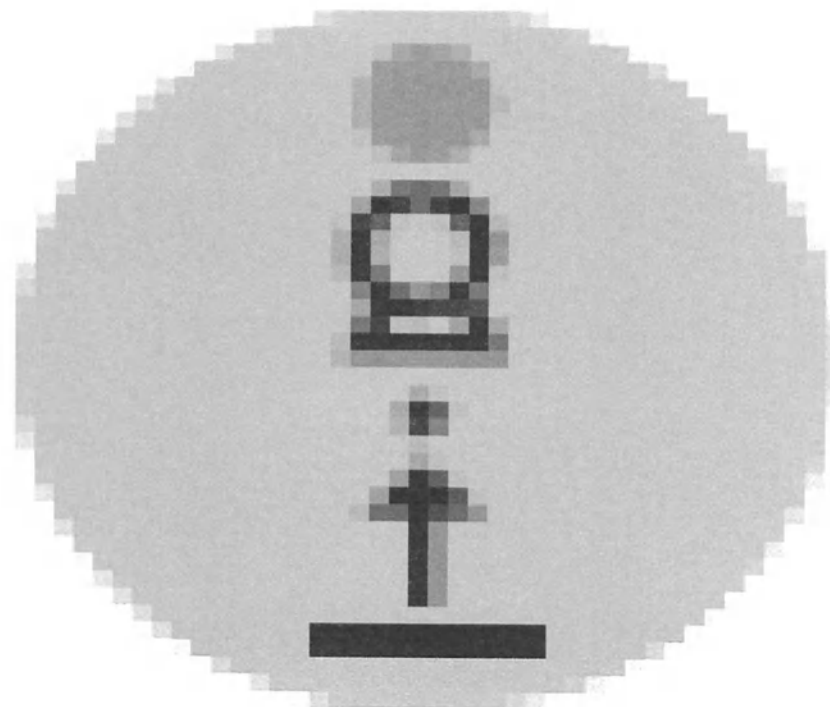

18. Программный режим автоматического отслеживания детектора для стола и стойки.

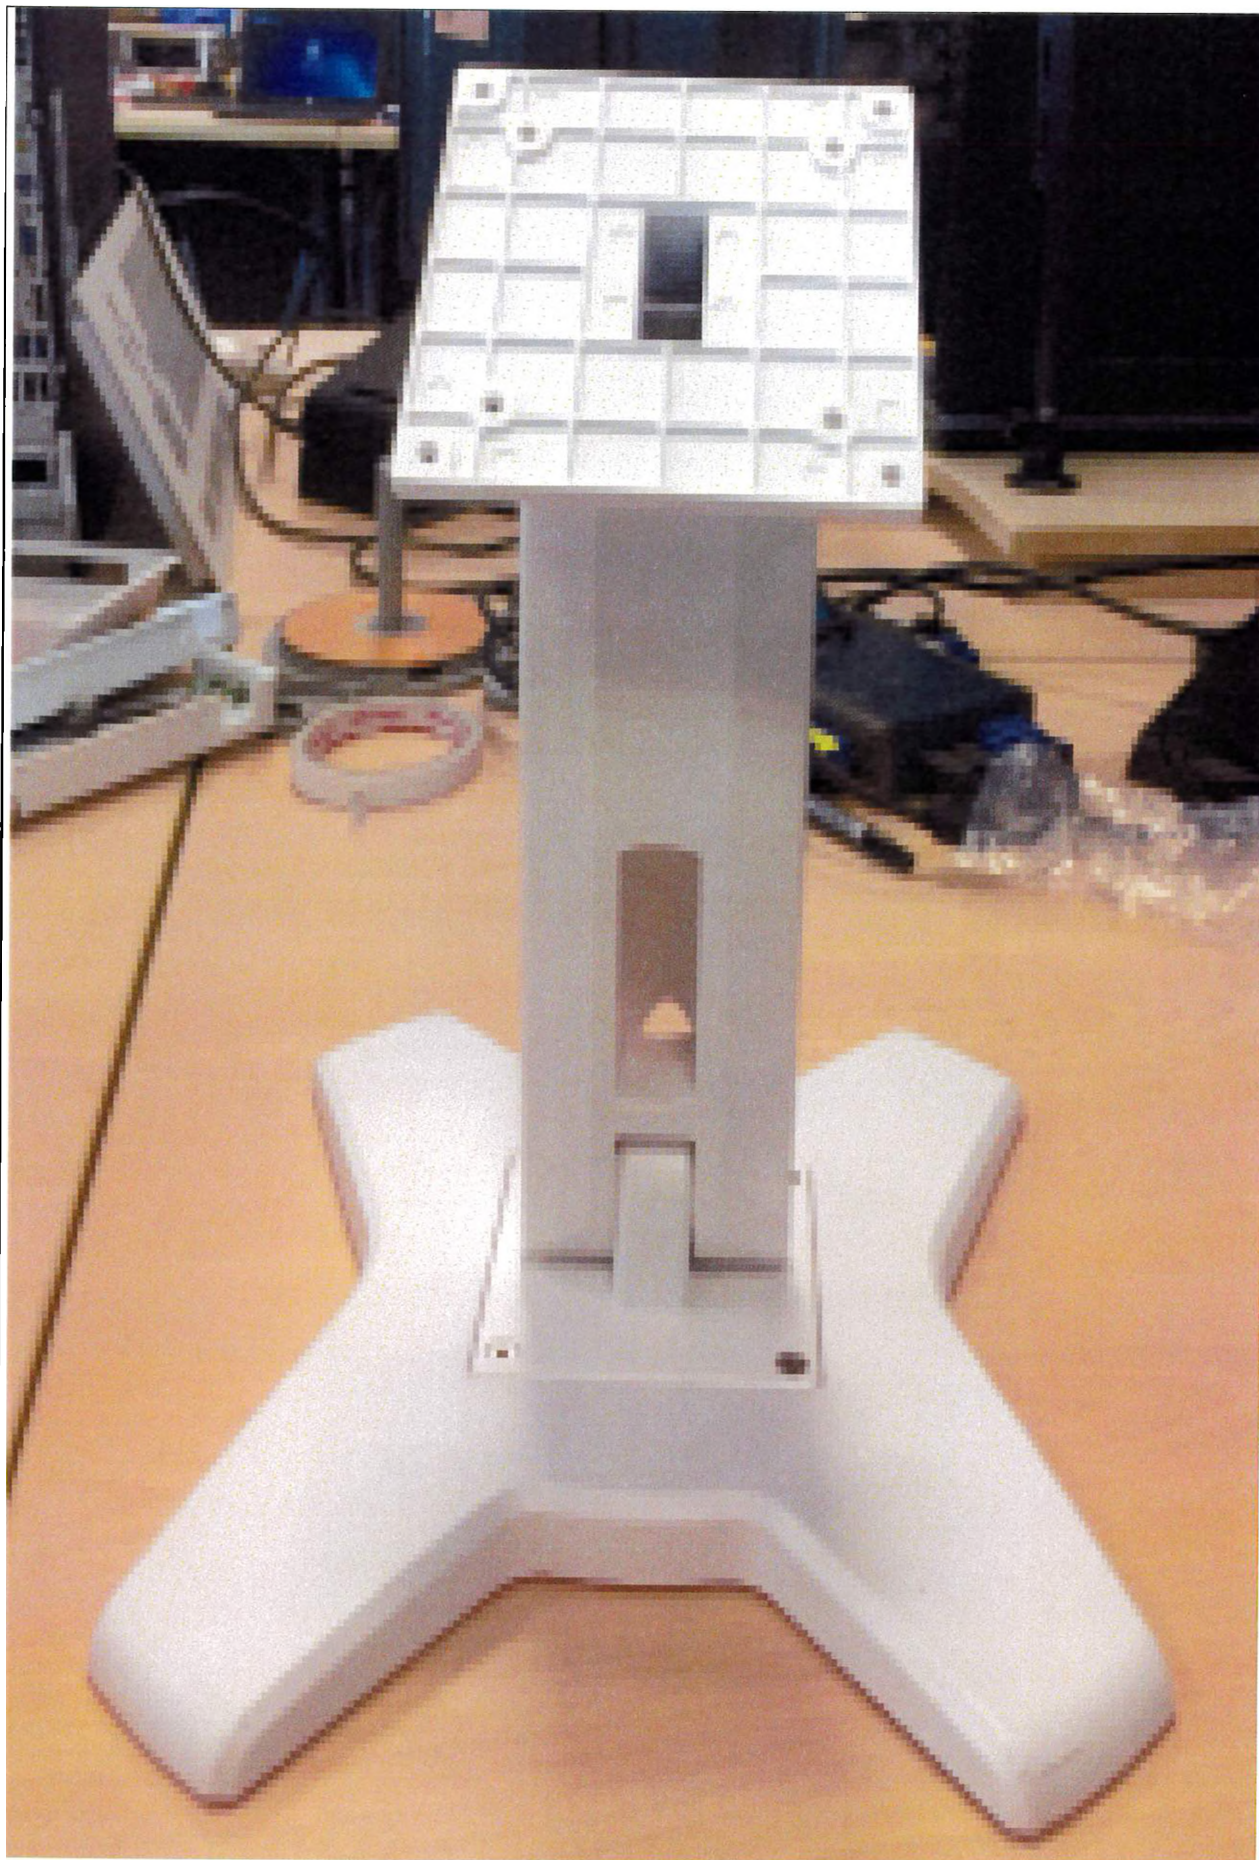

19. Подставка для станции формирования изображений.

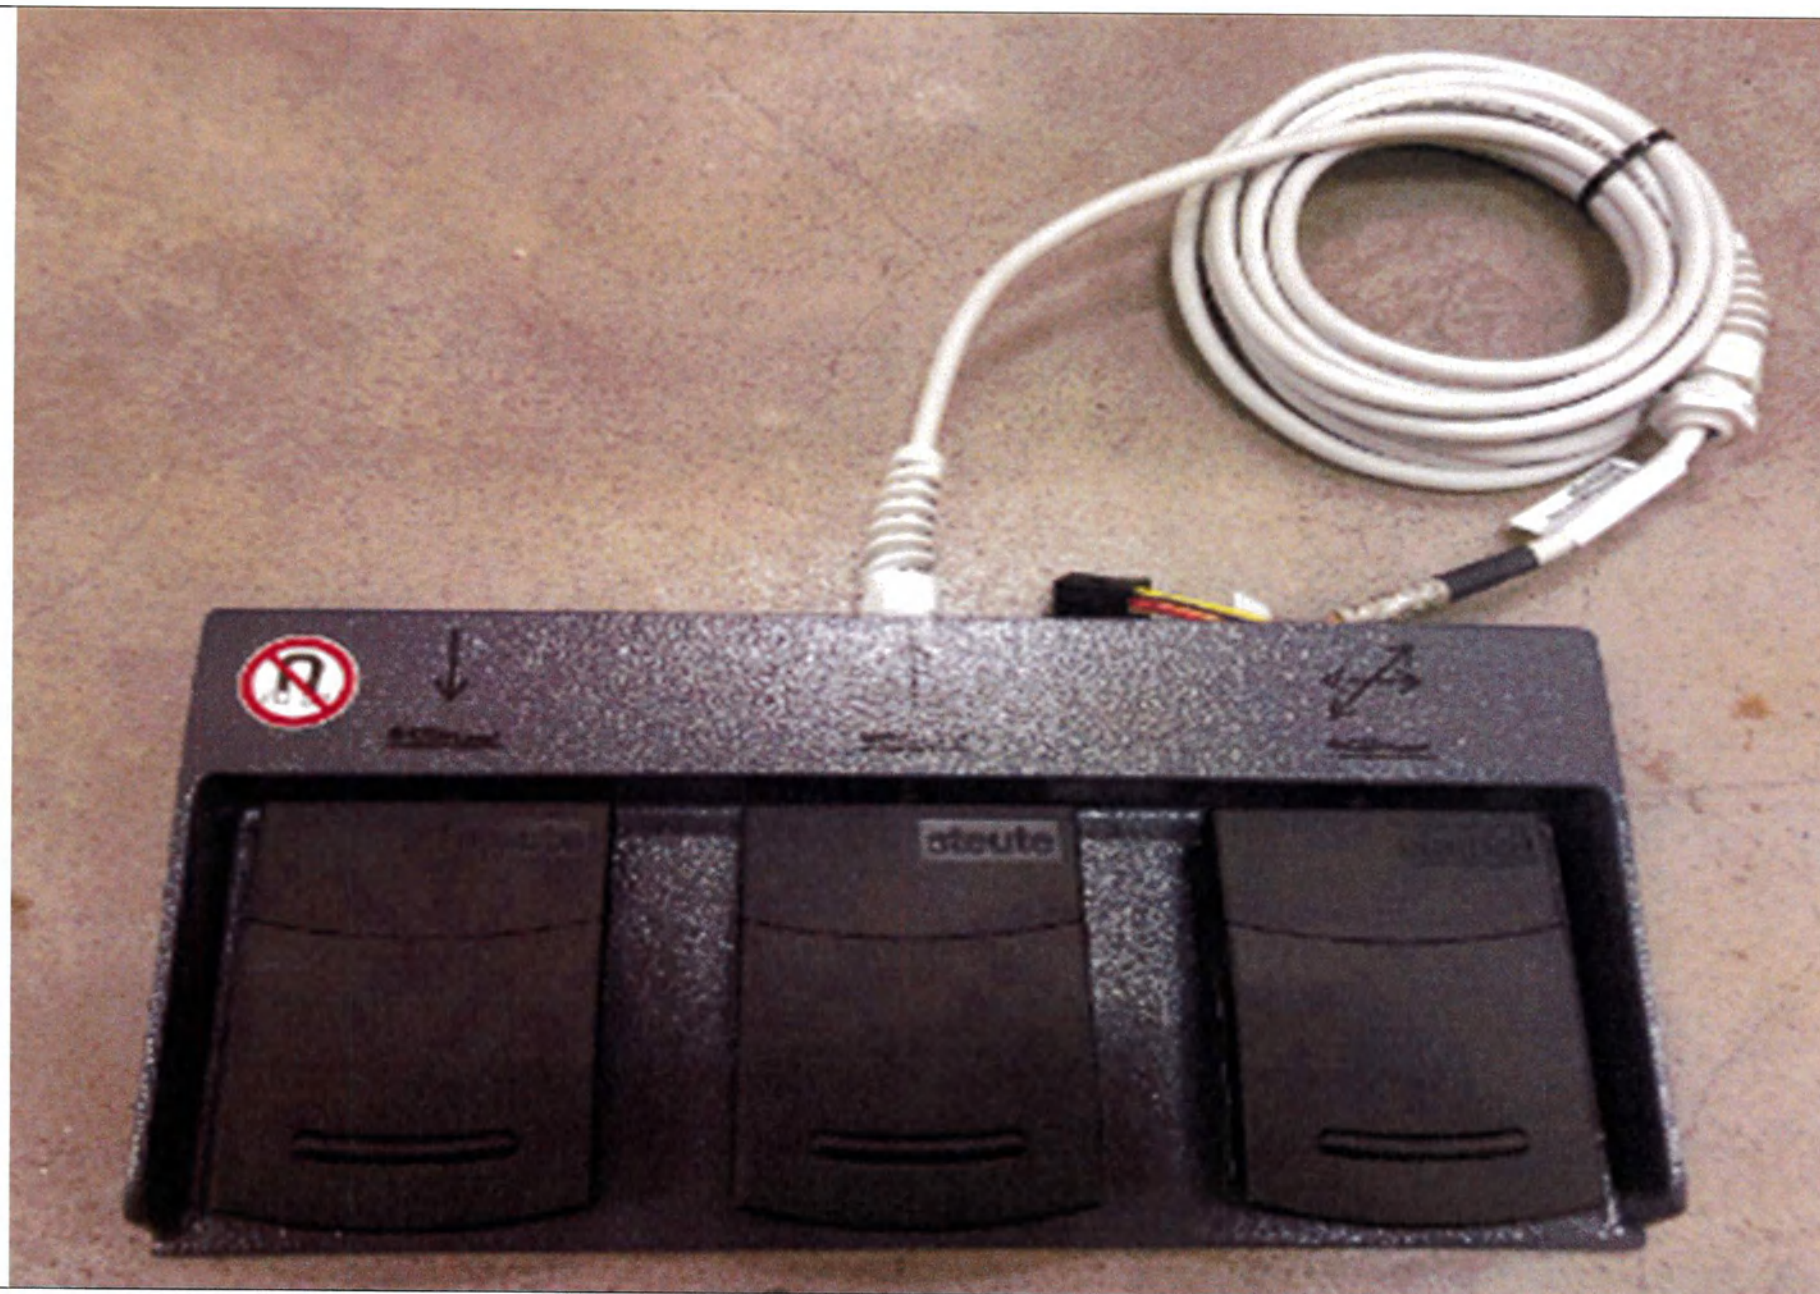

20. Педальный переключатель




21. Ножной переключатель двухсторонний.



22. Беспроводной пульт дистанционного управления.



23. Ручной переключатель экспозиции.

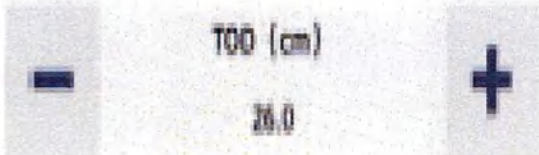Icon	Short description
	Select TOD (Table-Object Distance)
	Acquisition start or end position (based on the acquisition direction)
	Acquisition end or start position (based on the acquisition direction)


24. Программный режим SmartOrtho.







26. Программный режим автоматической коллимации.




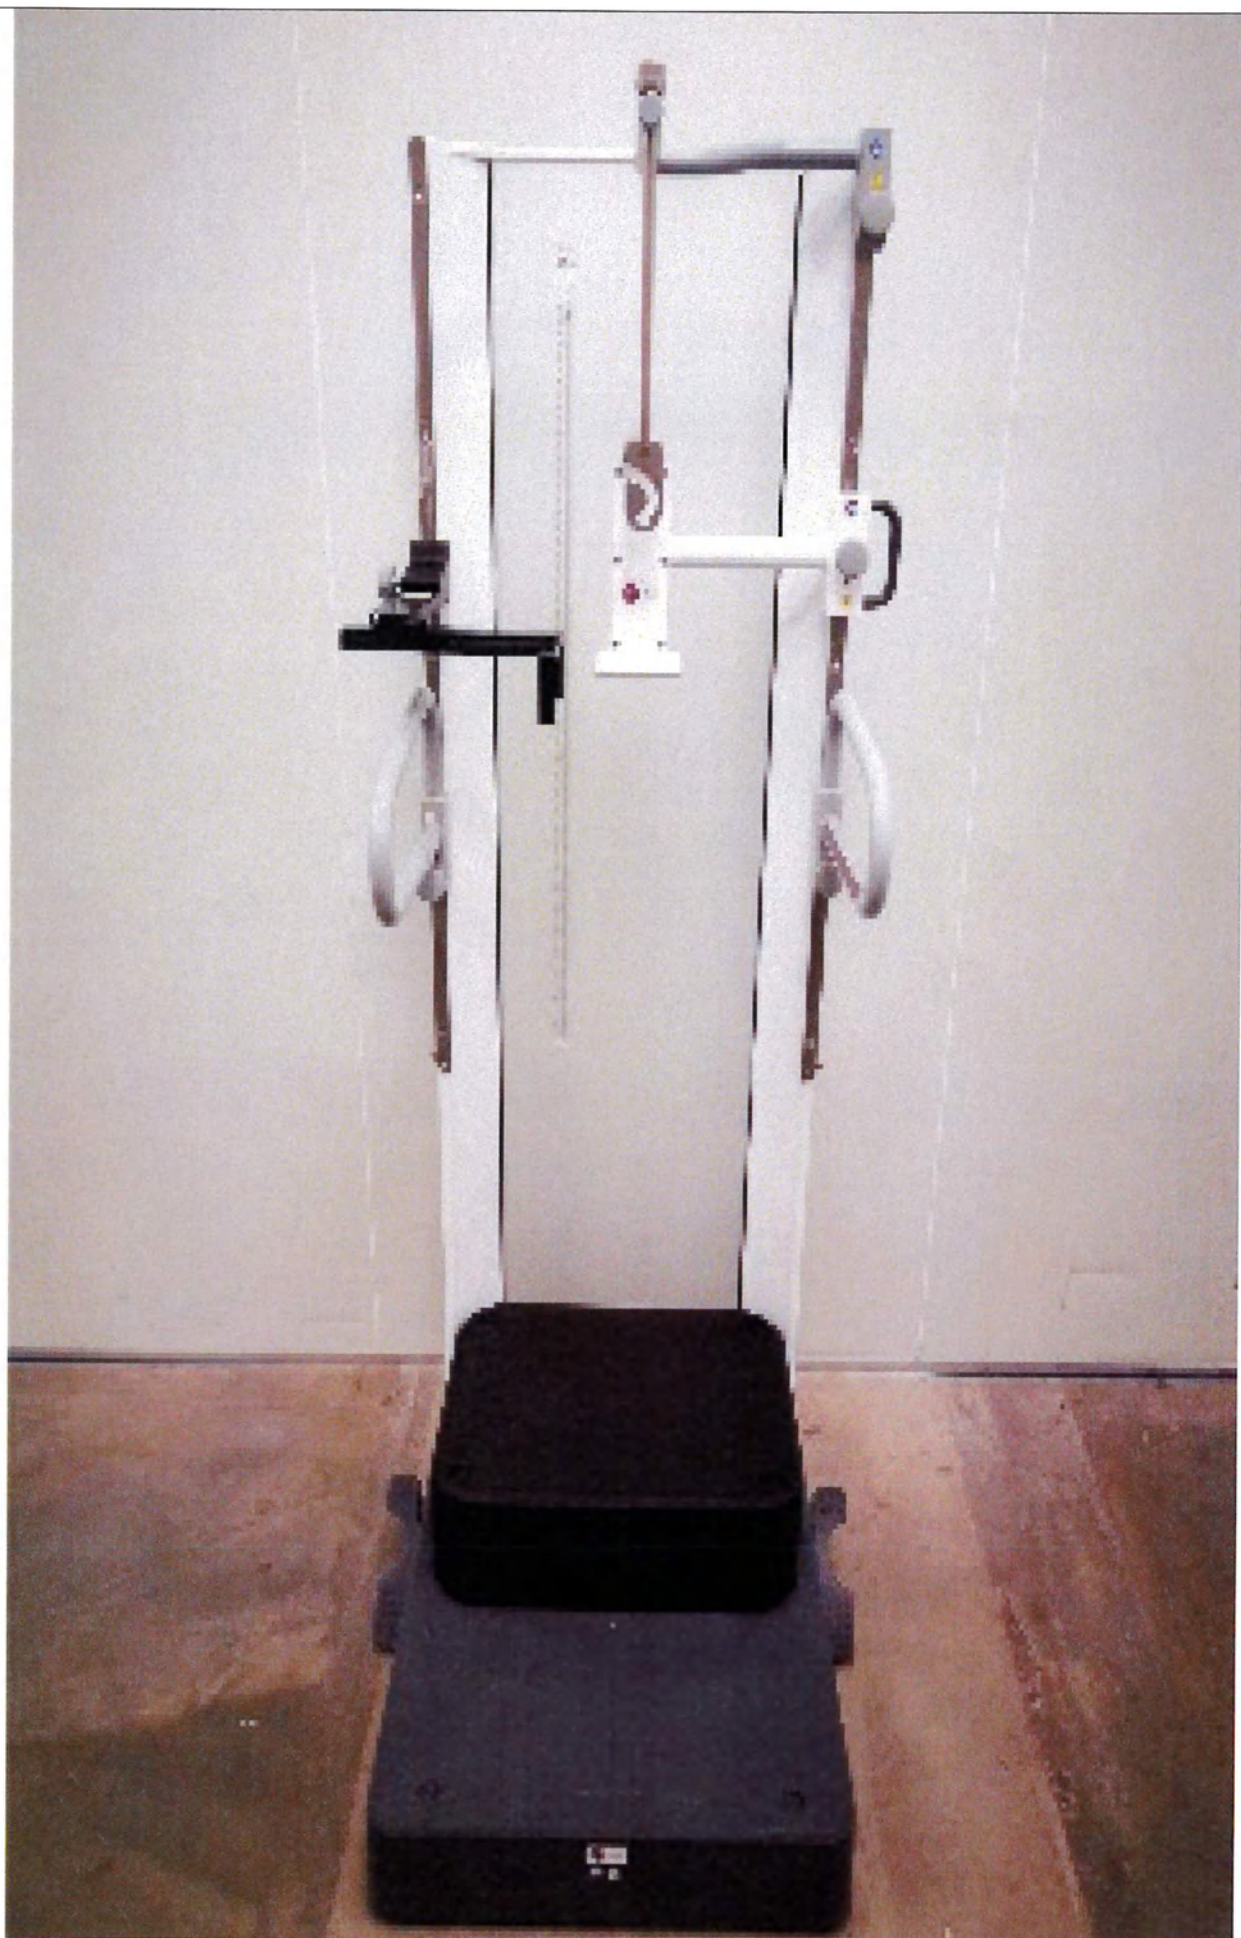

28. Универсальная стойка Ortho.

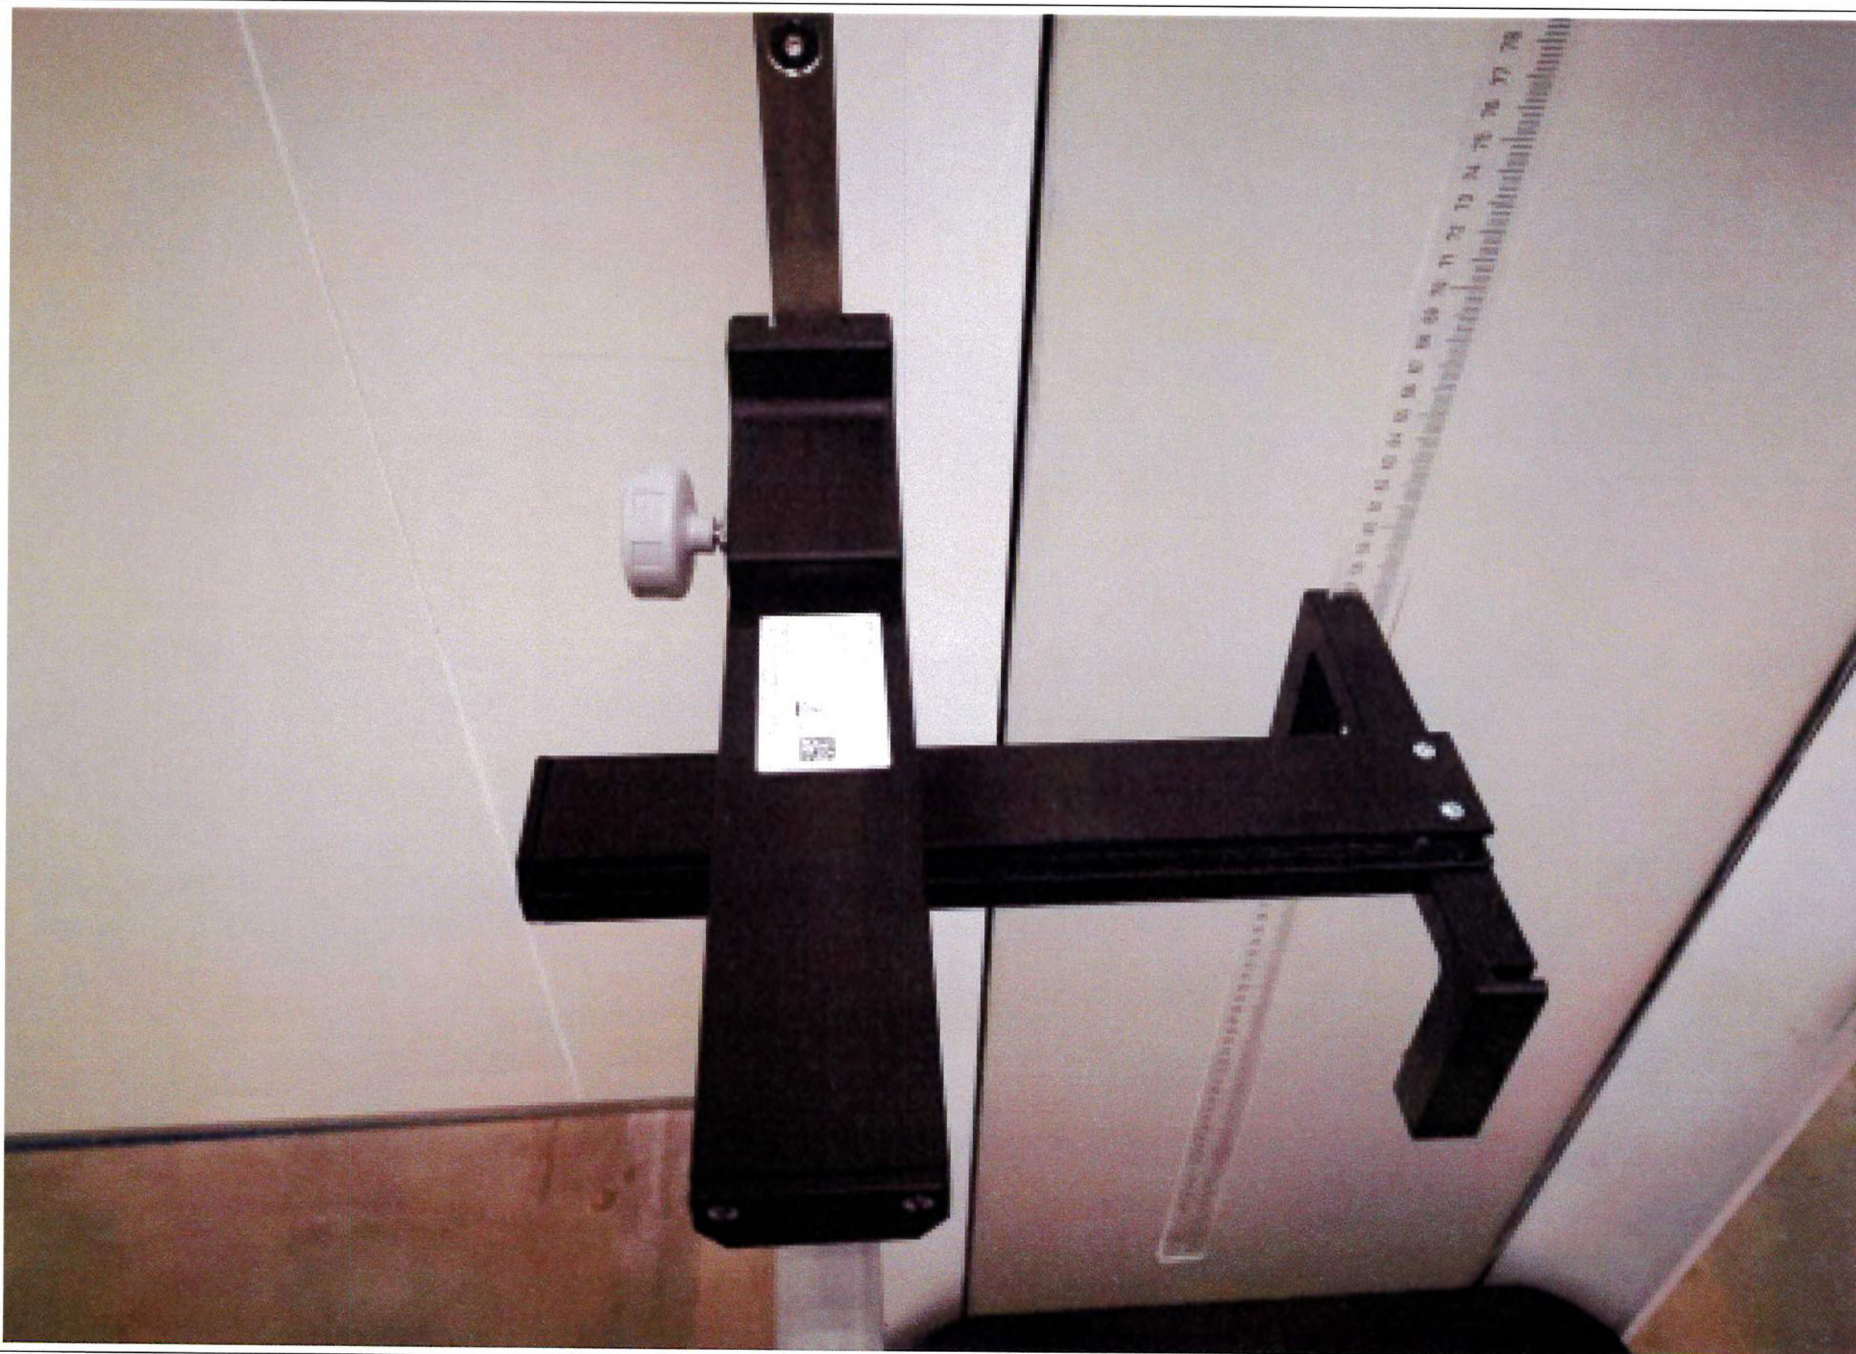

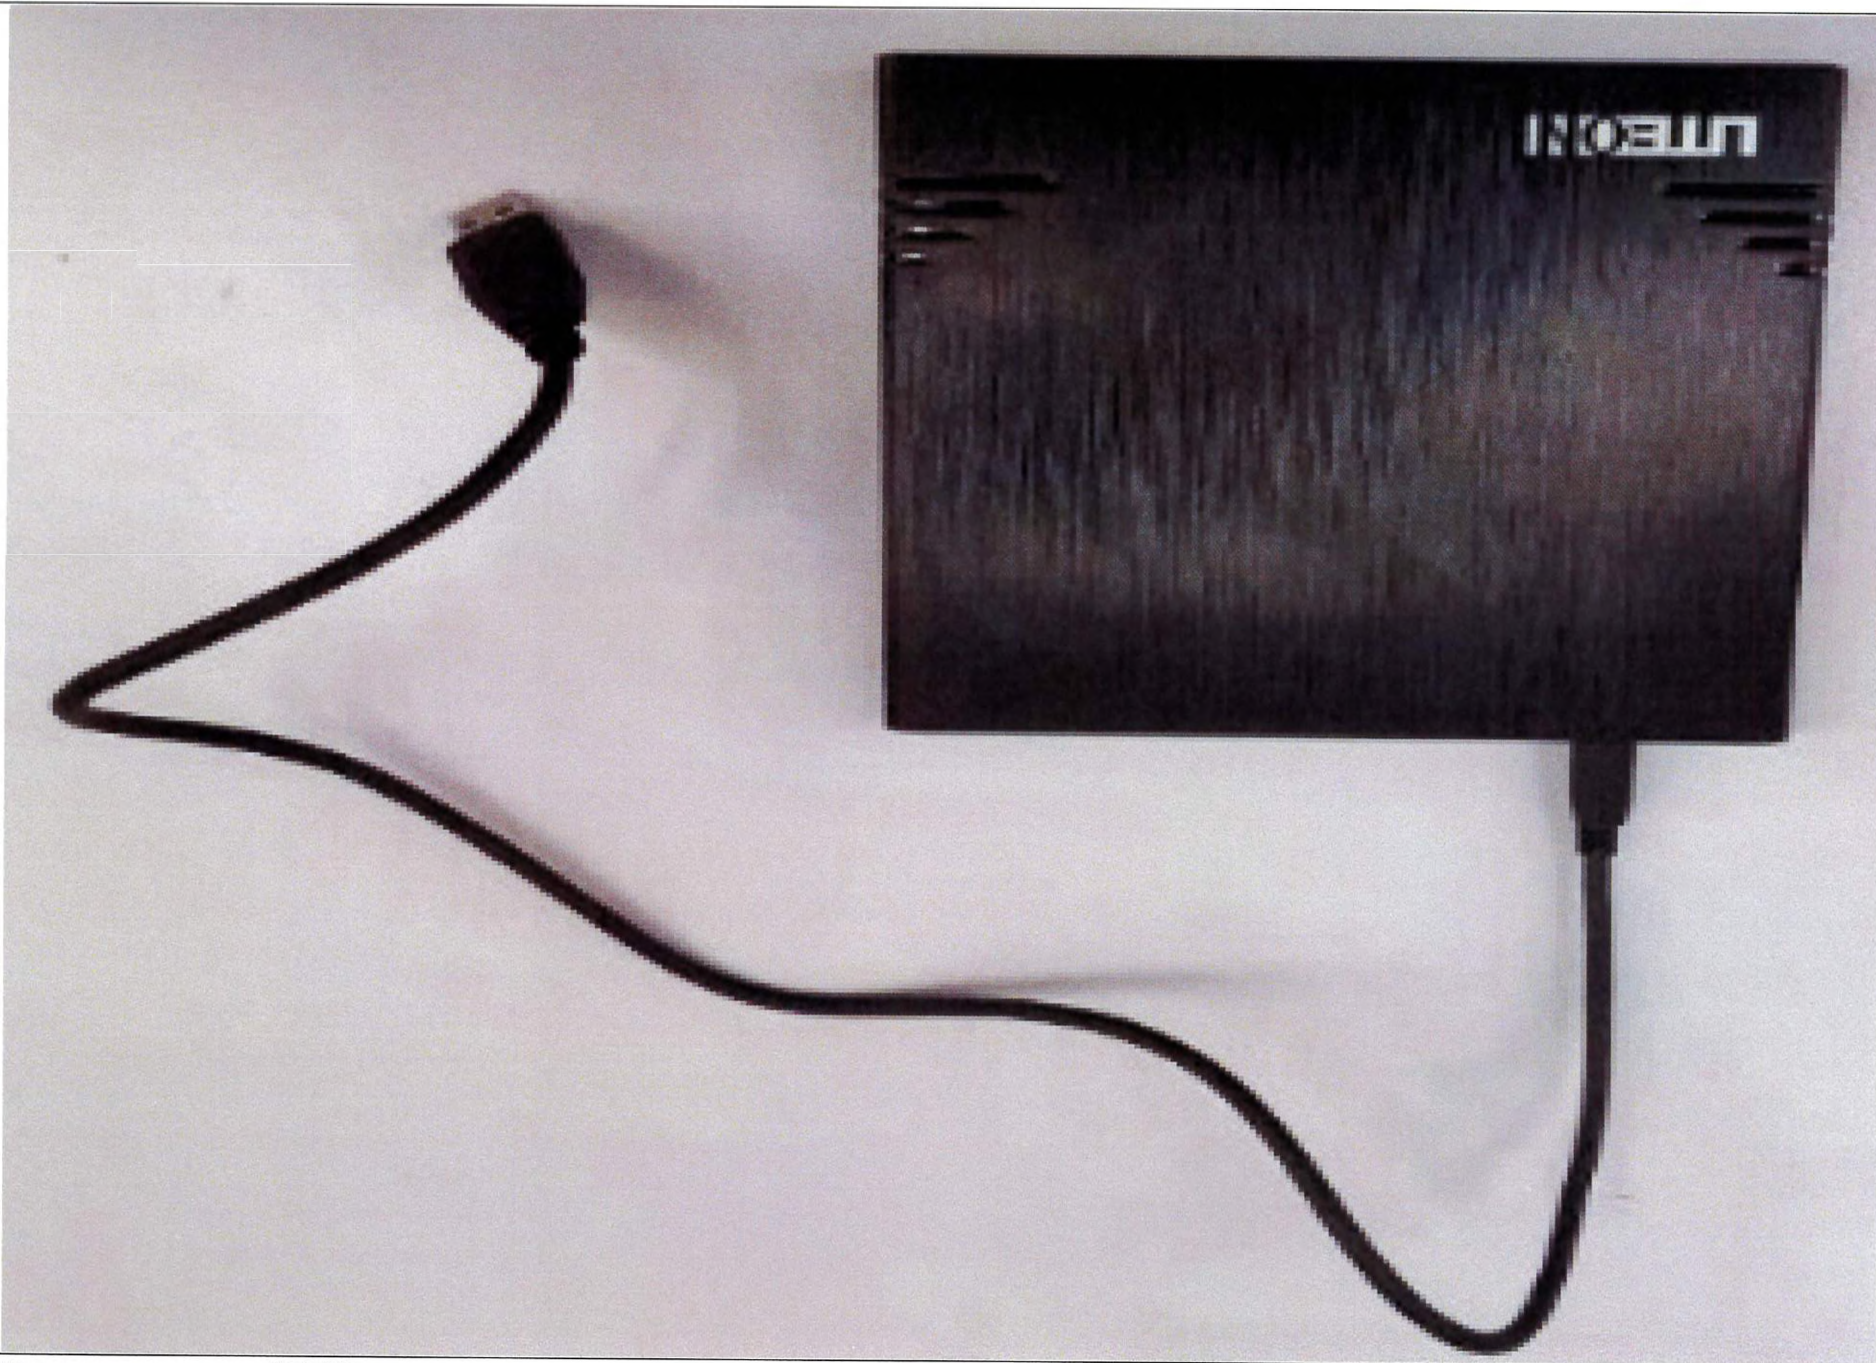

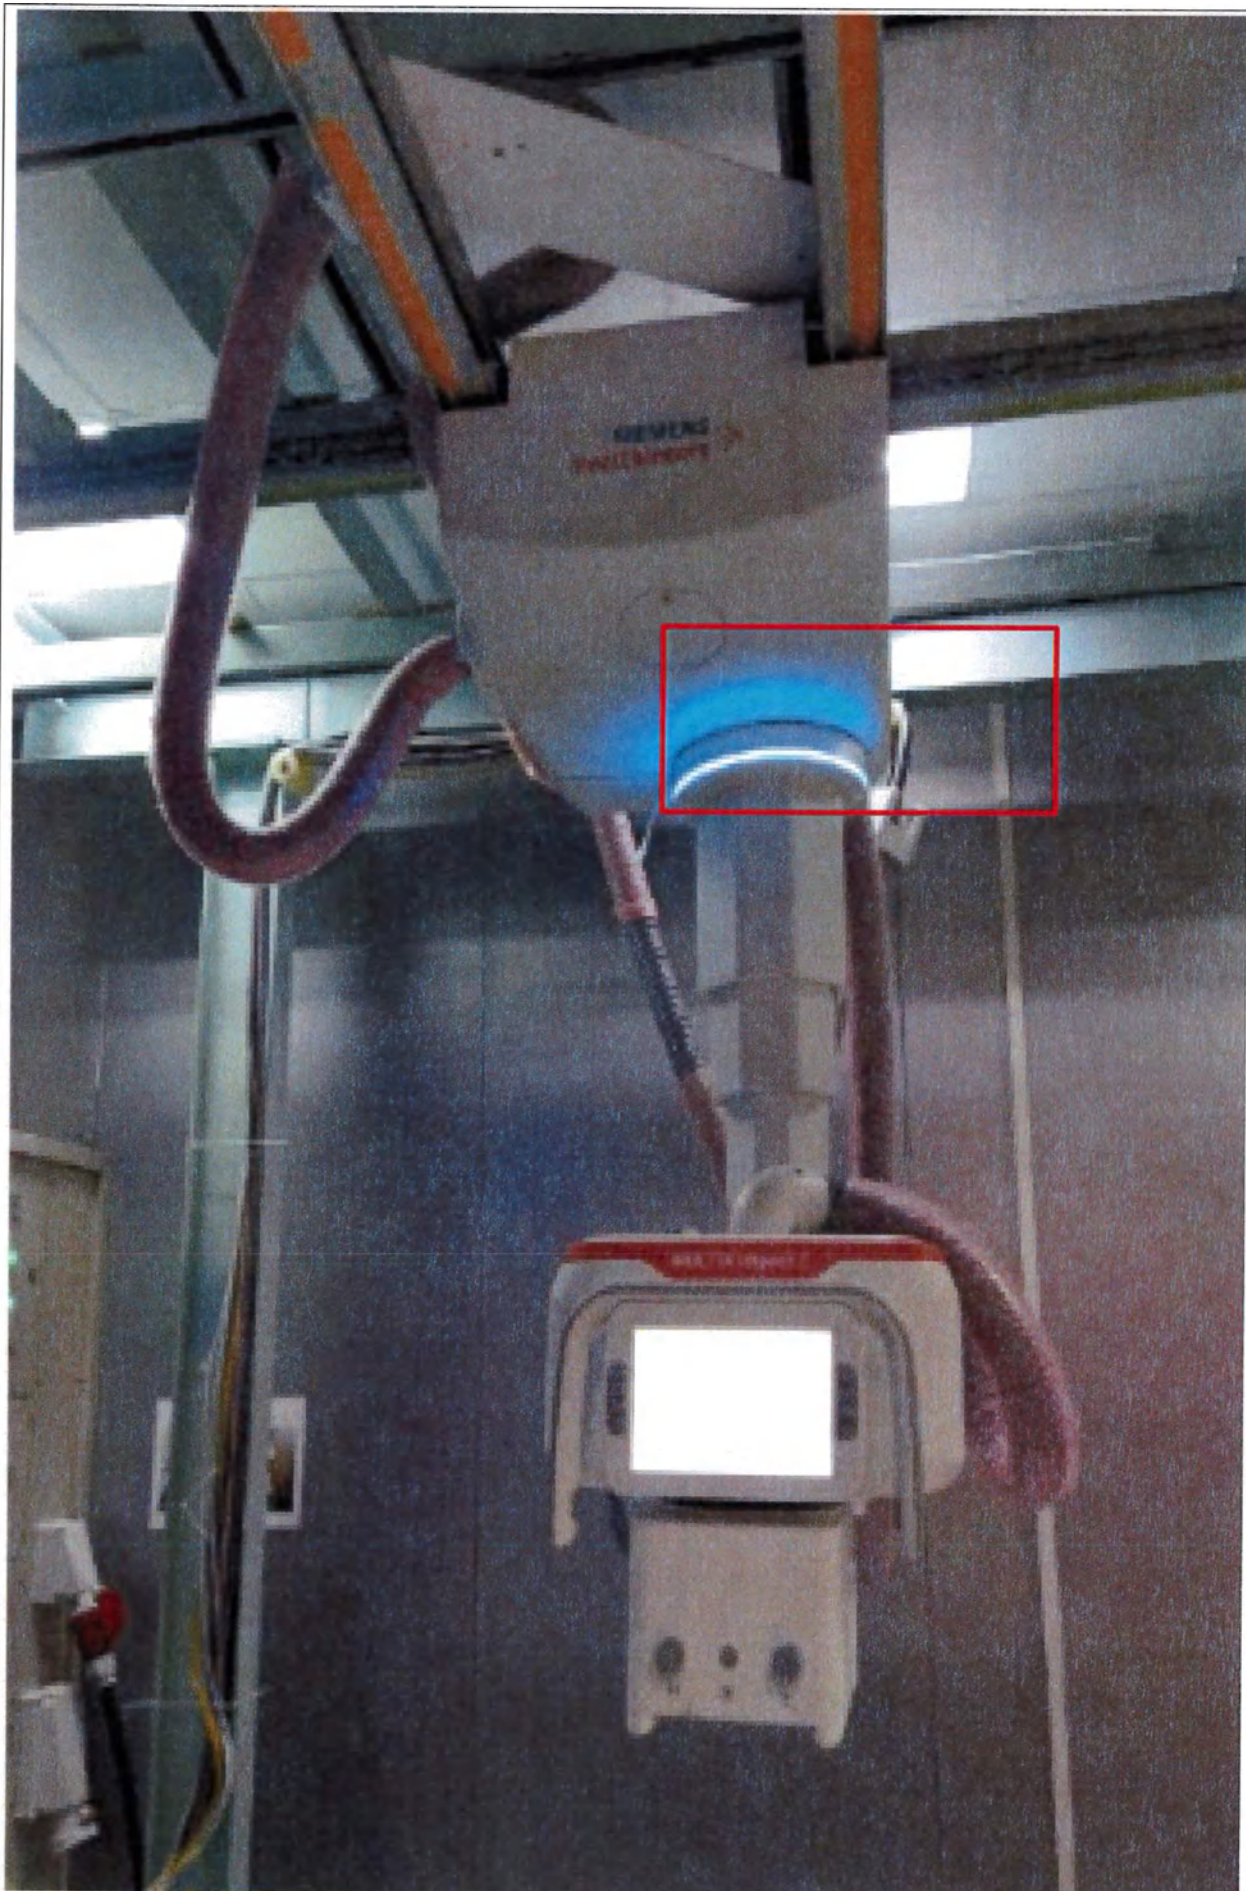


32. 1 Подсветка светодиодная.



32. 2 Подсветка светодиодная.



33. Устройство для дистанционного управления на основе планшета.

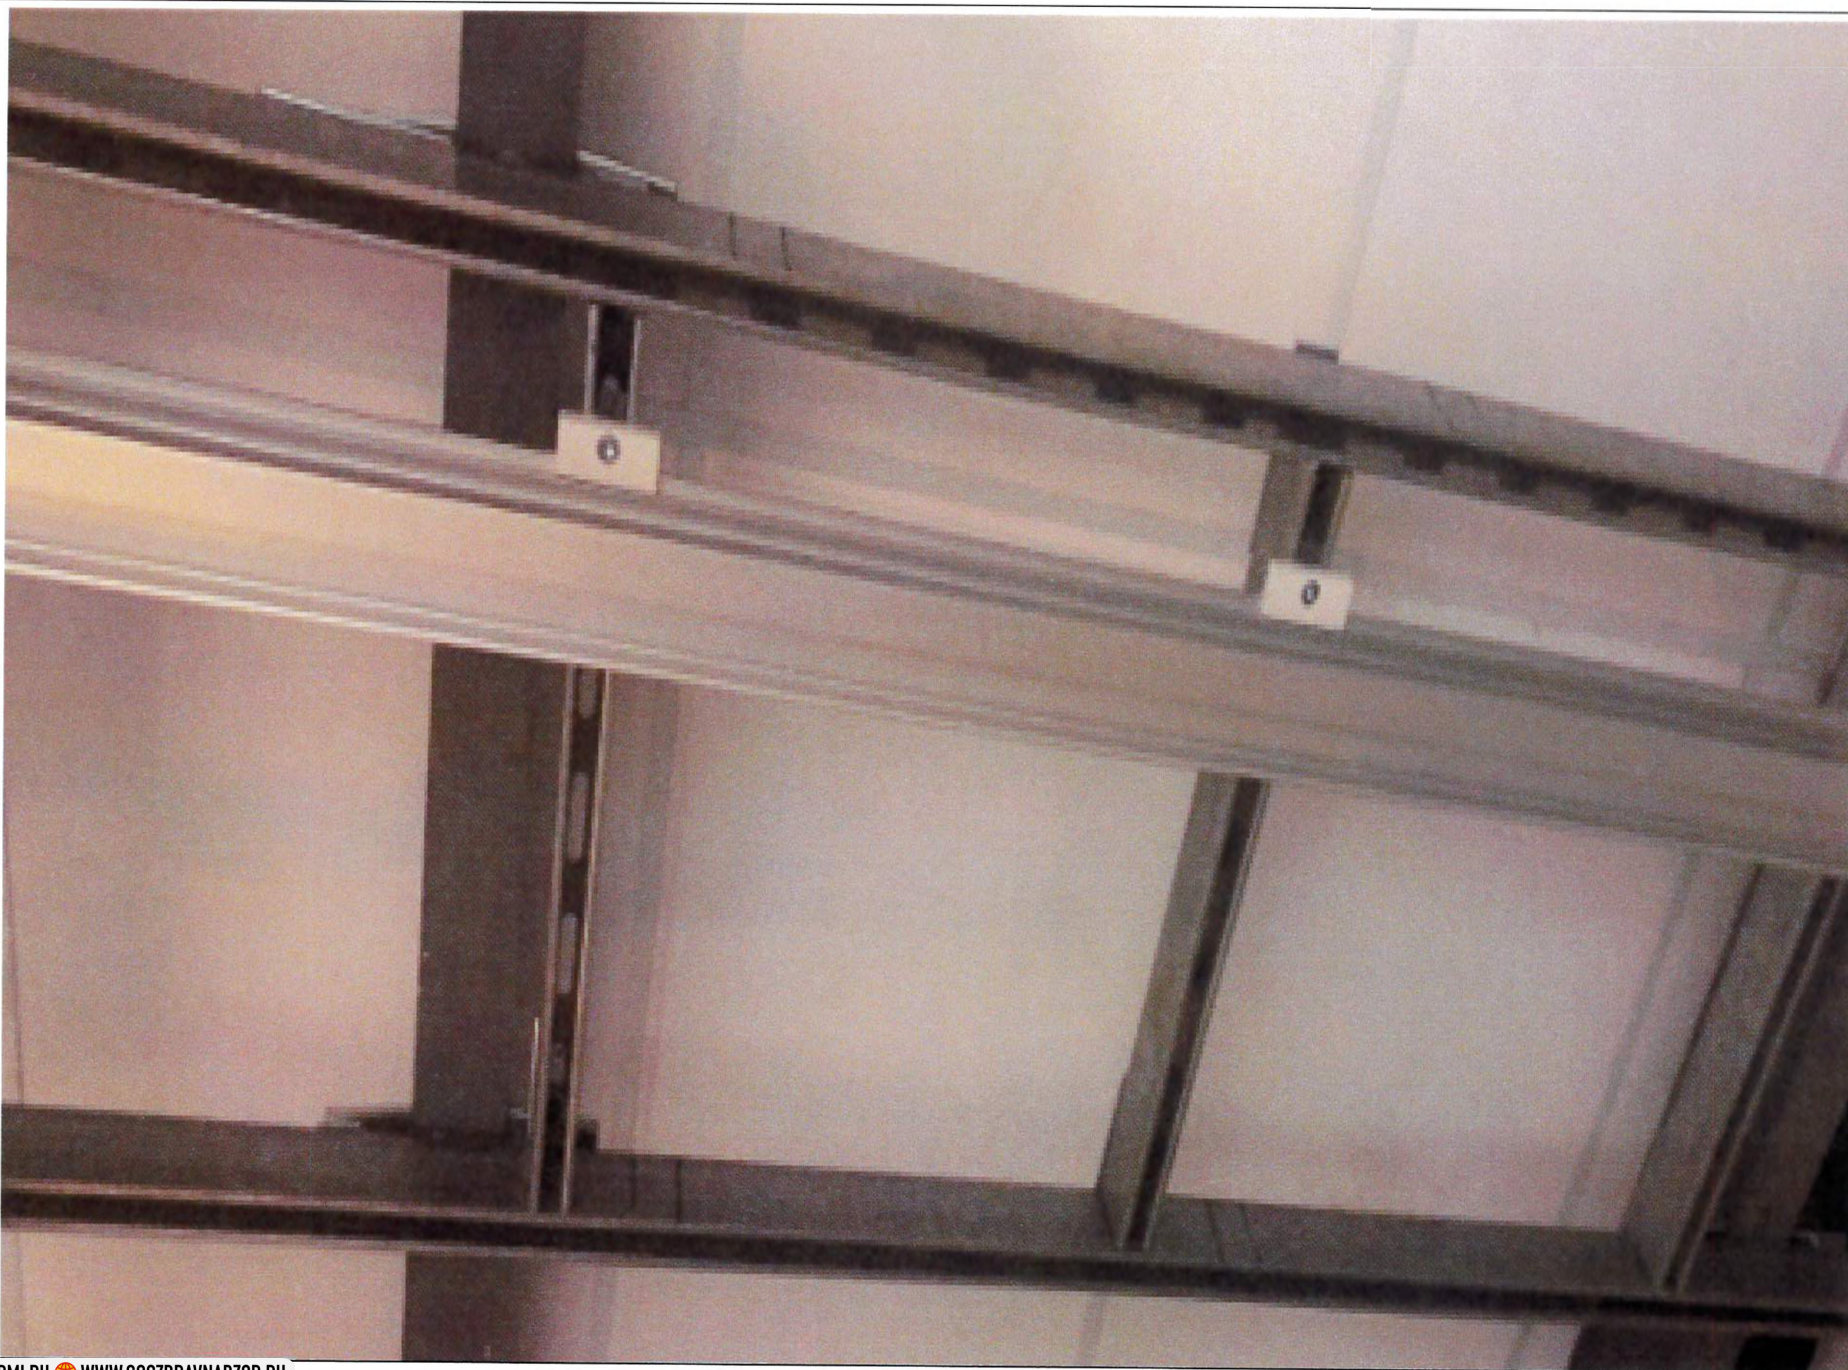




35. Удлинение штатива телескопическое.




36. Источник бесперебойного питания.





37. Держатель мобильный.

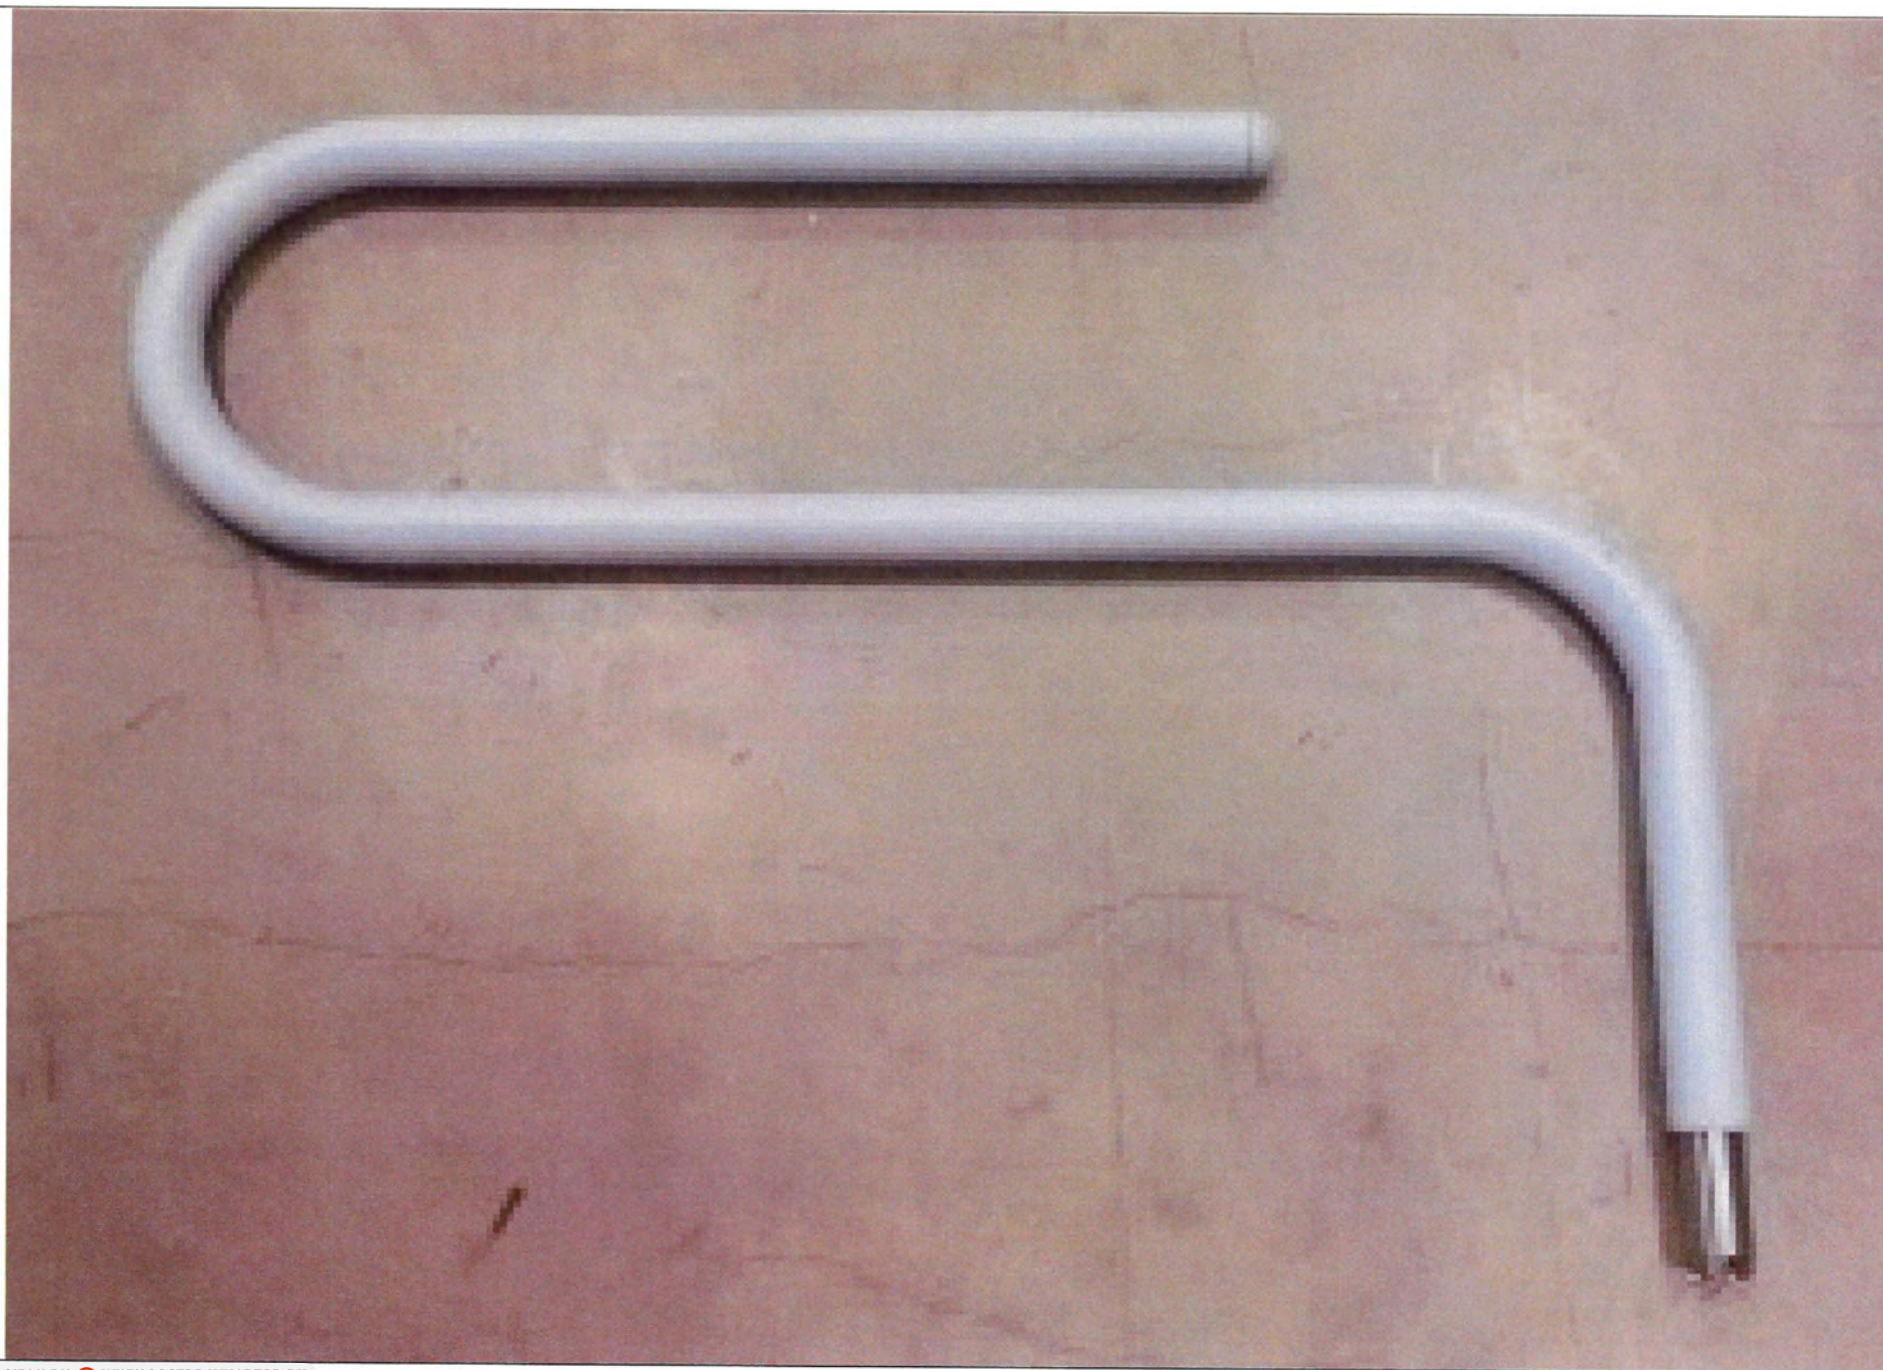




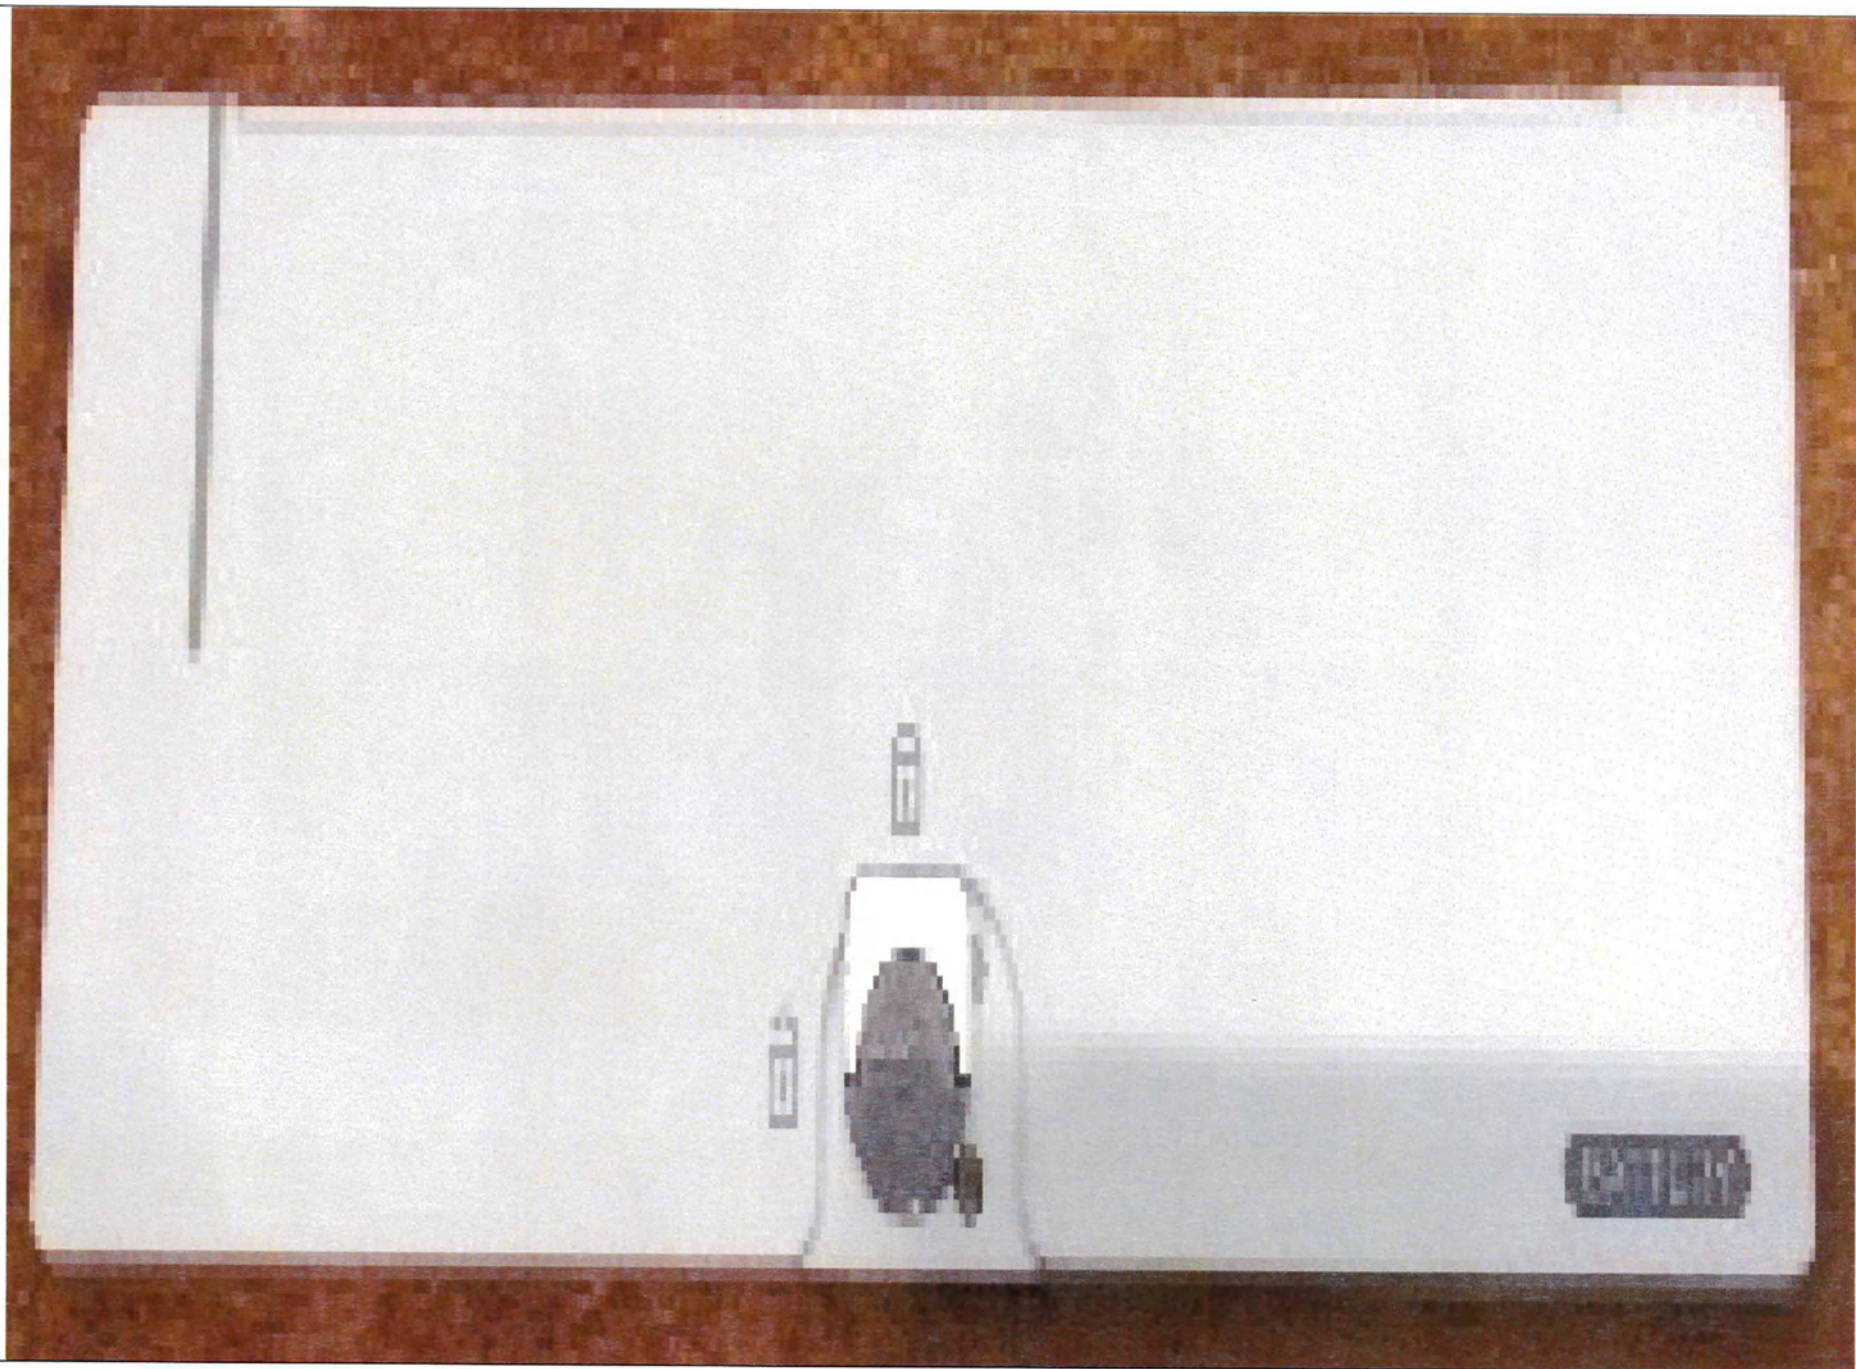


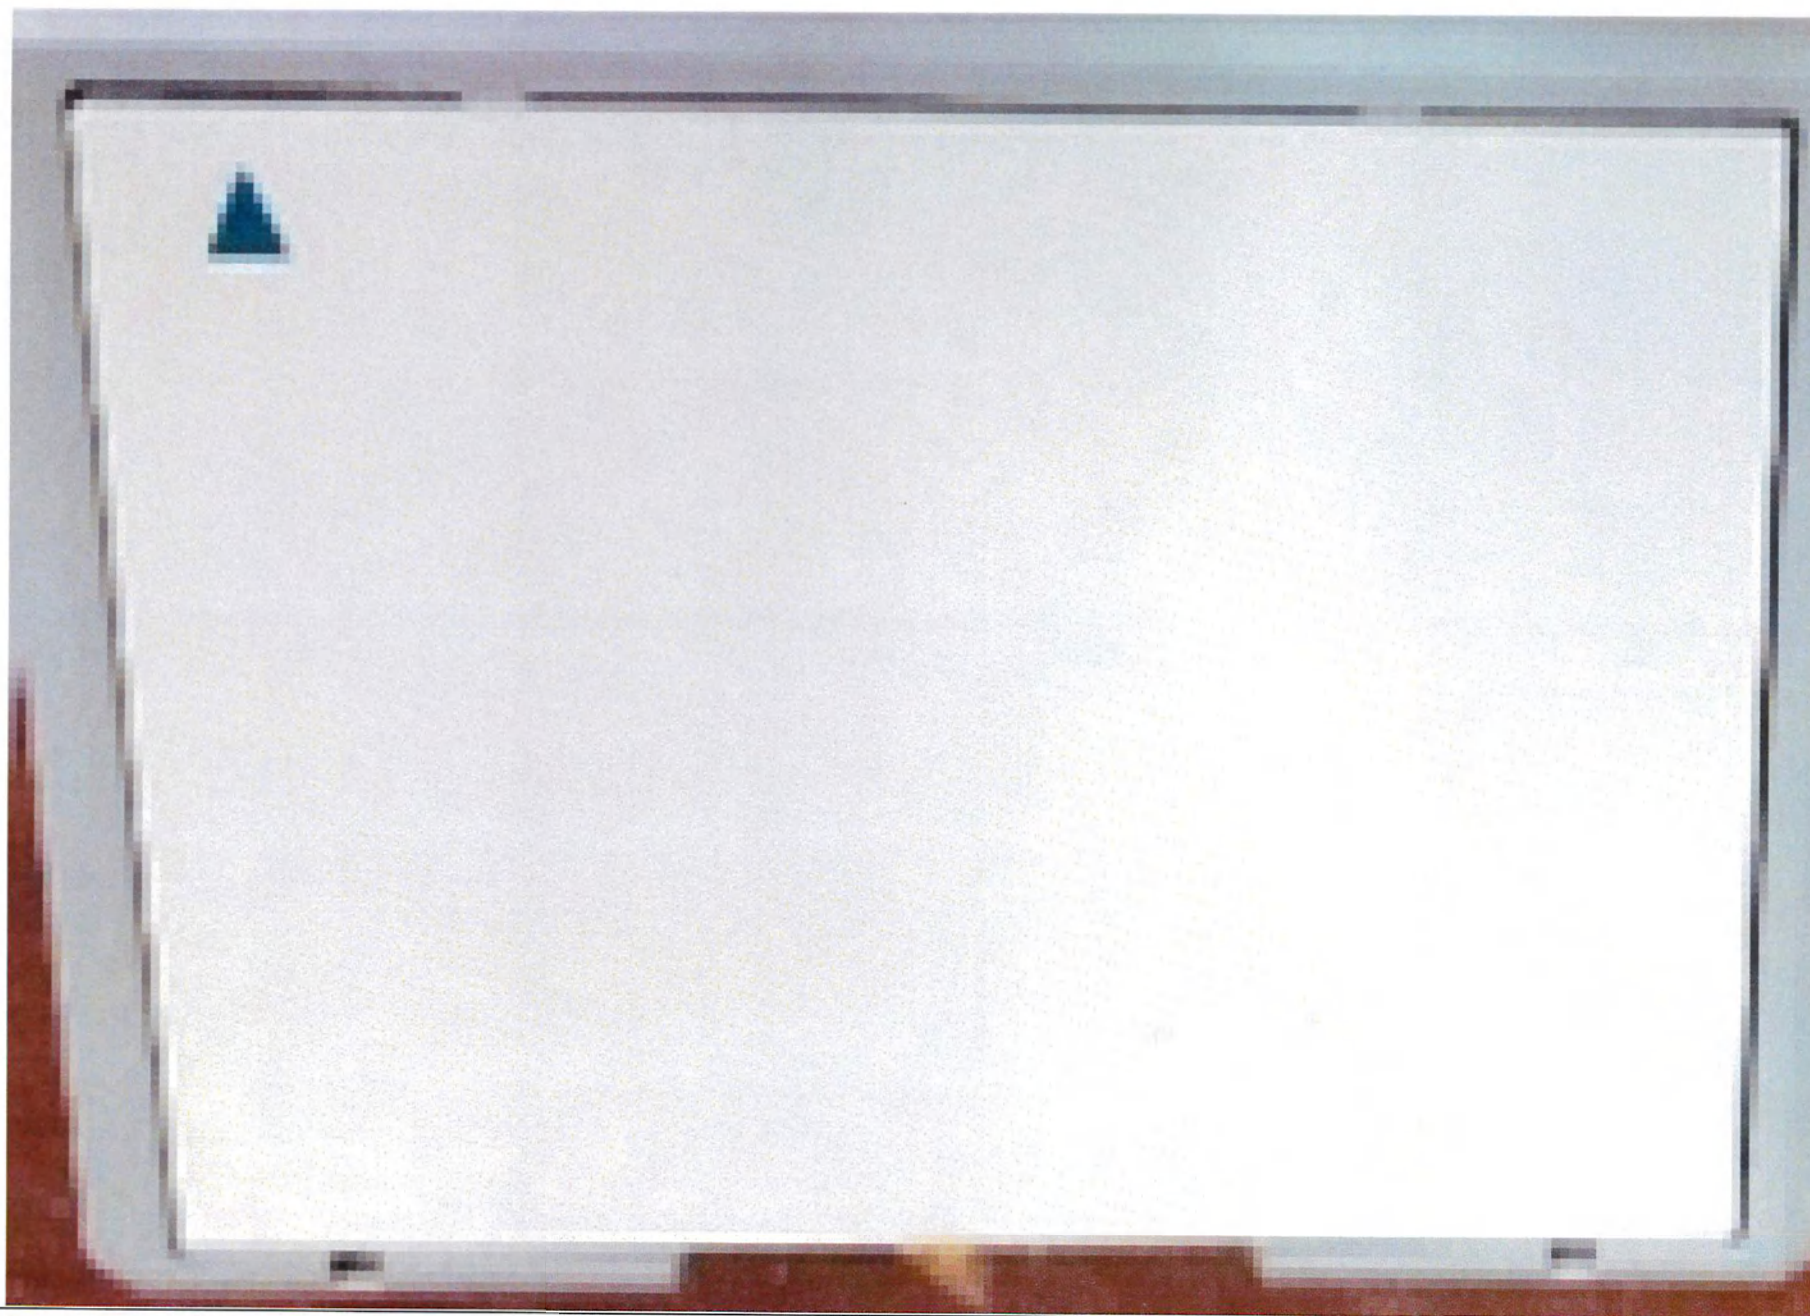


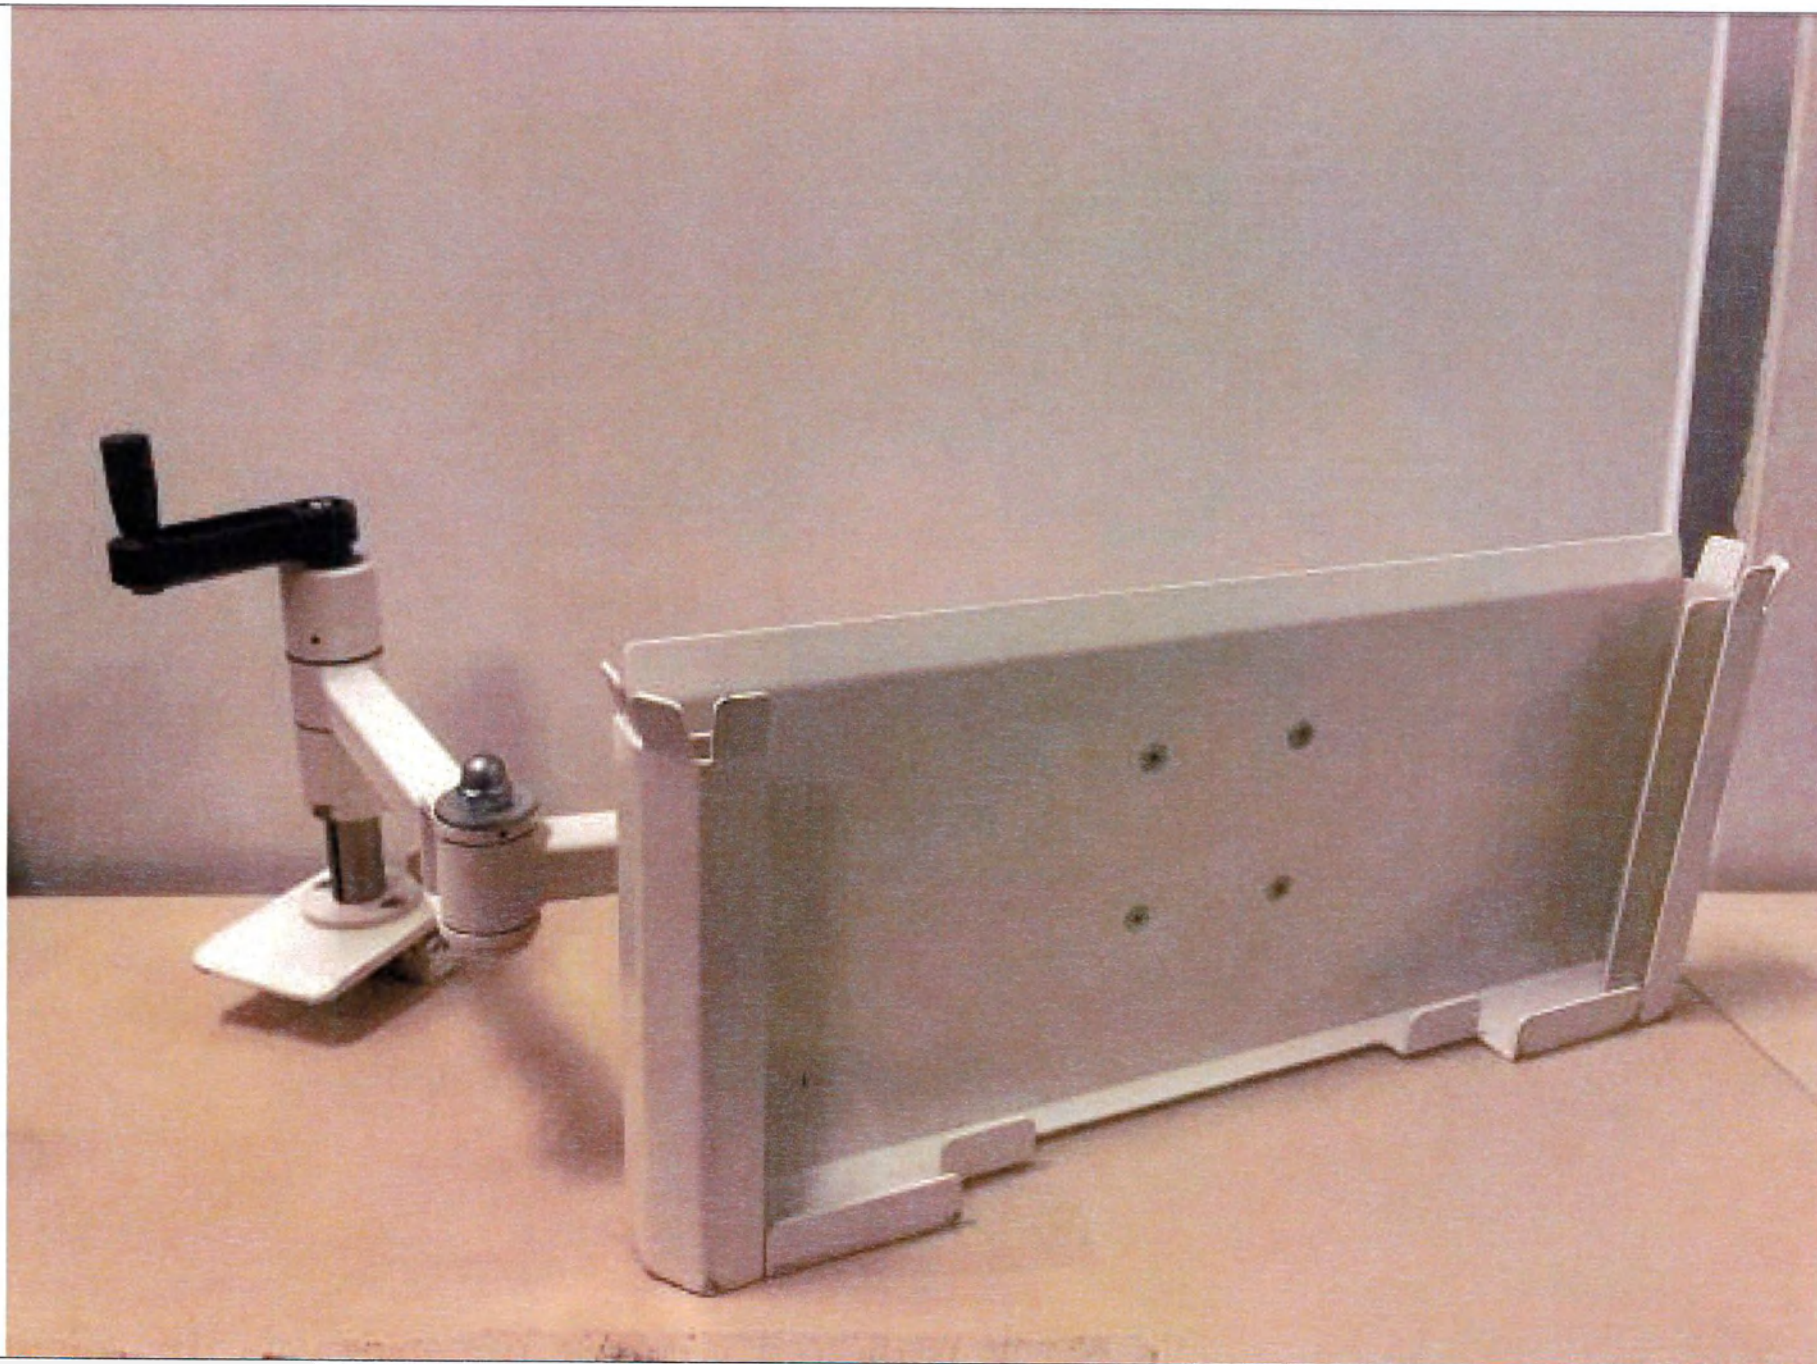





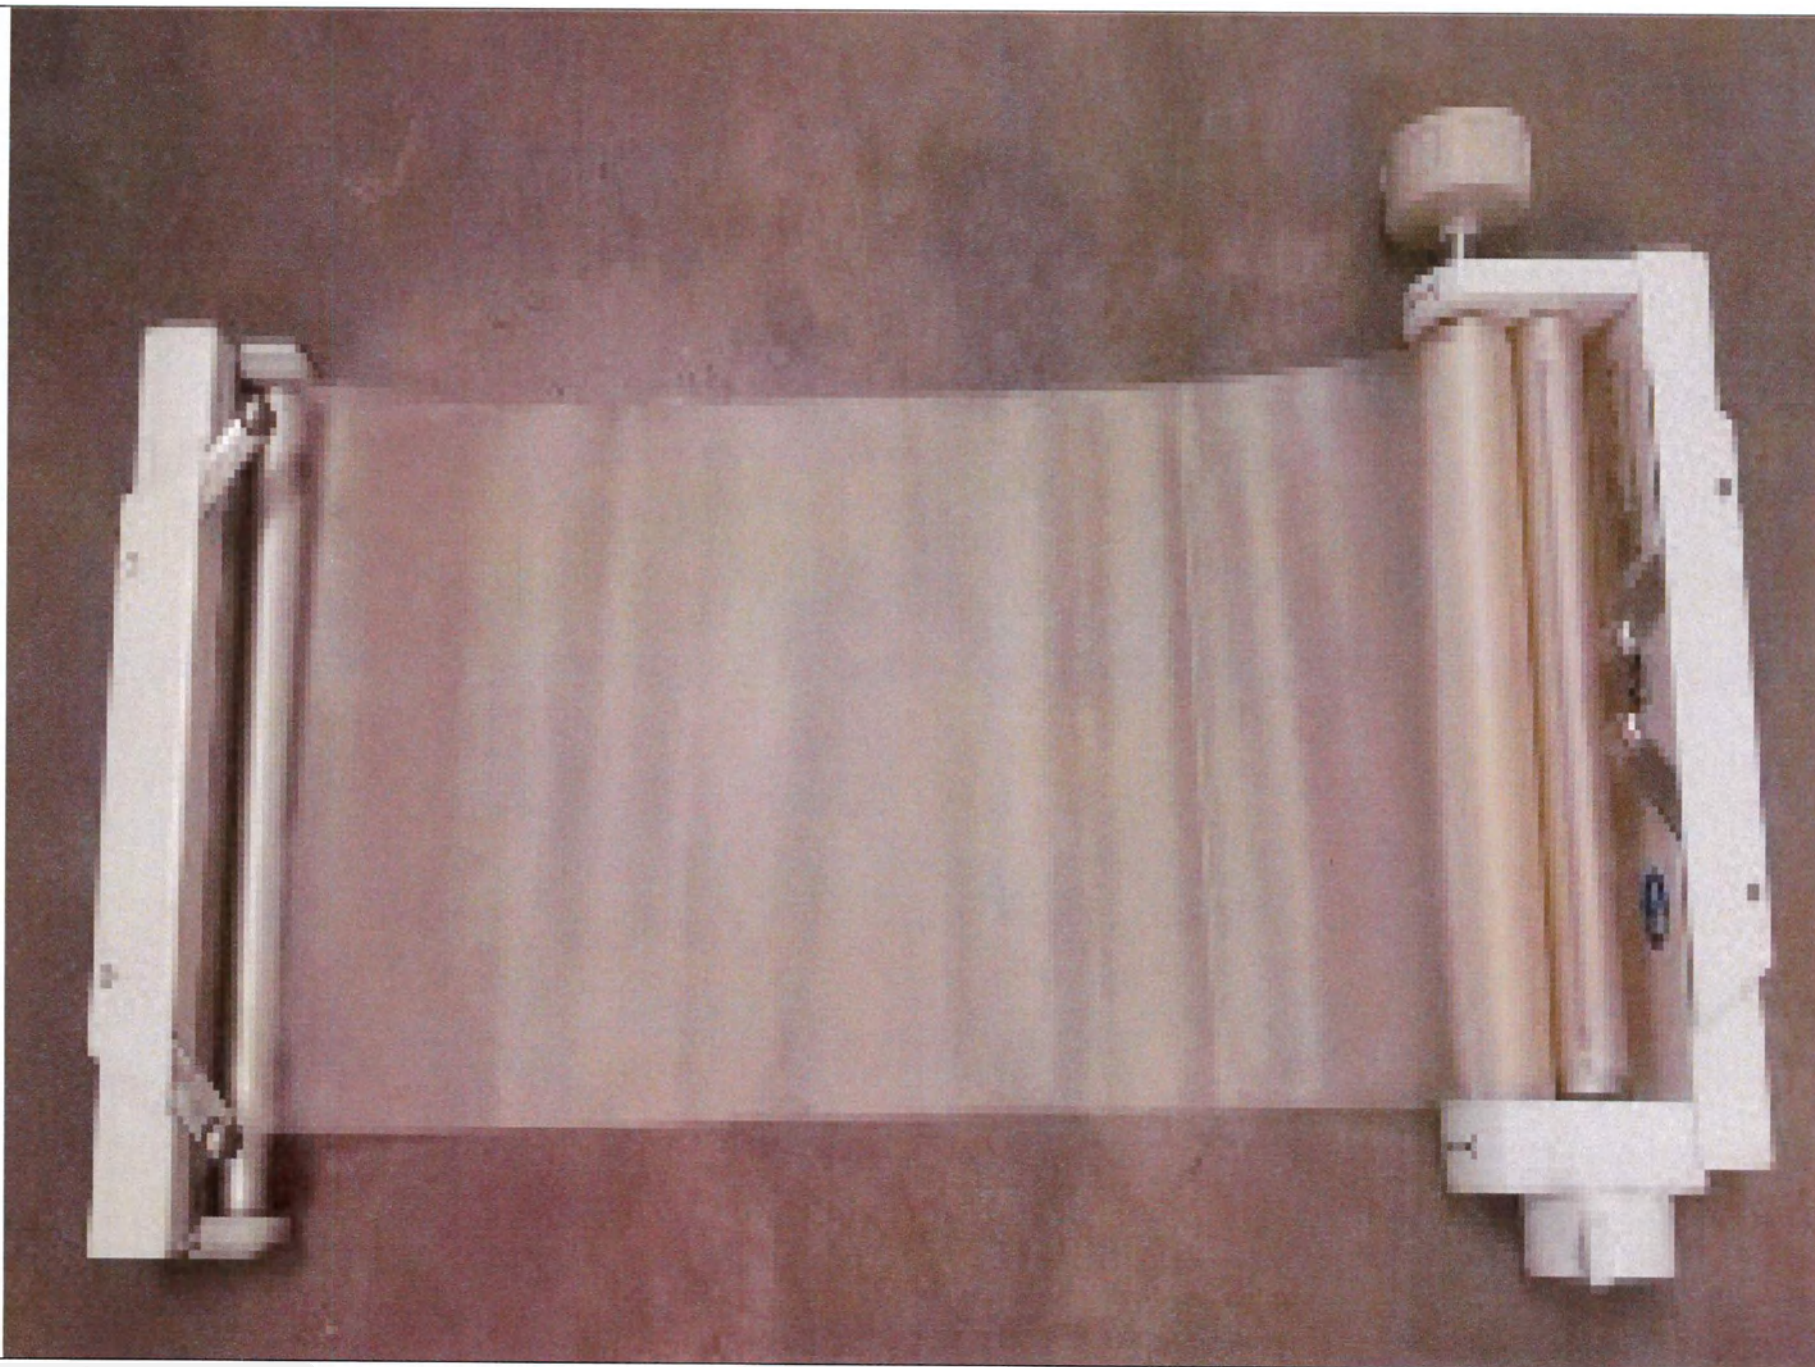


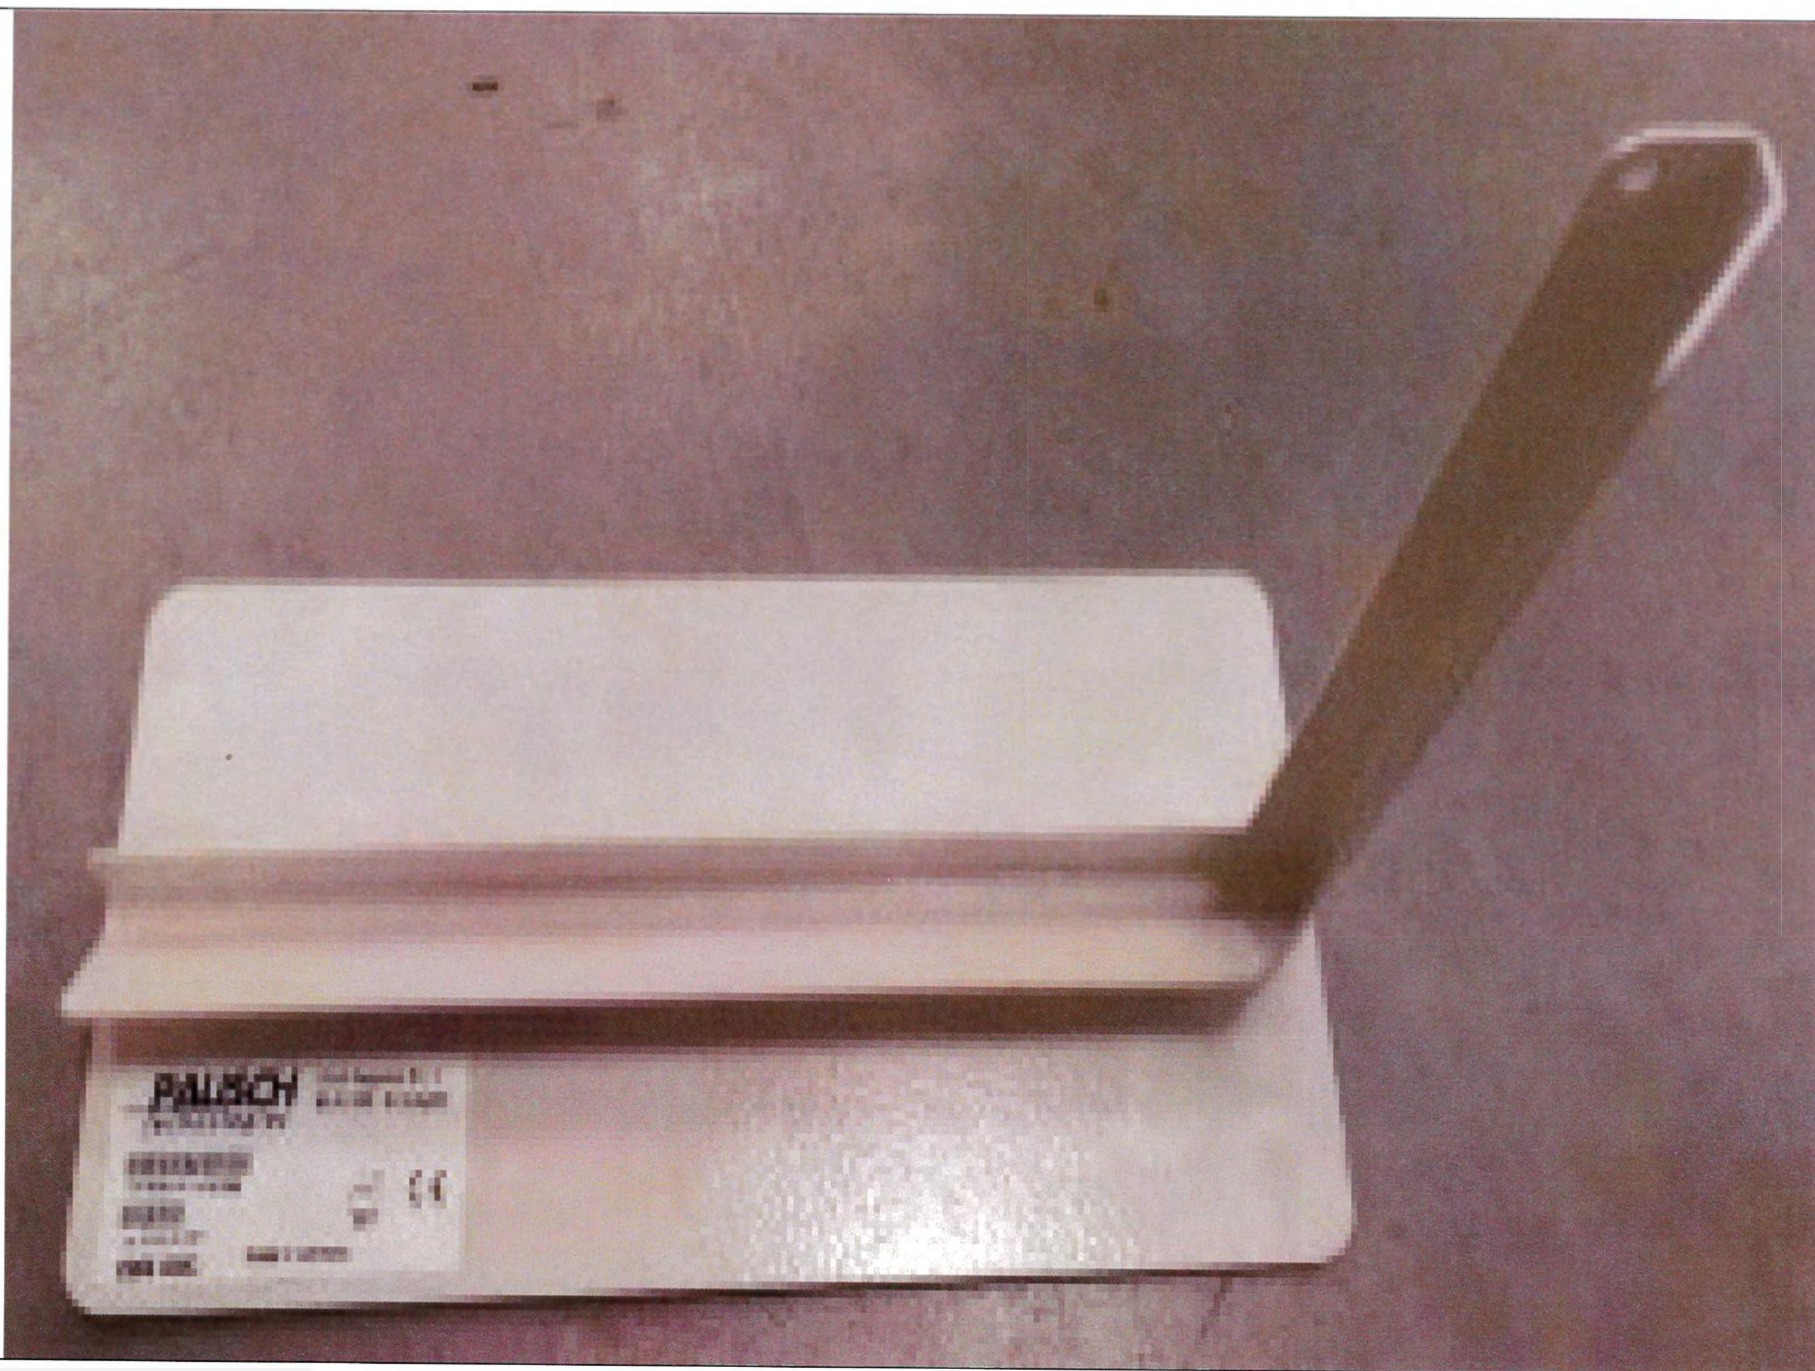


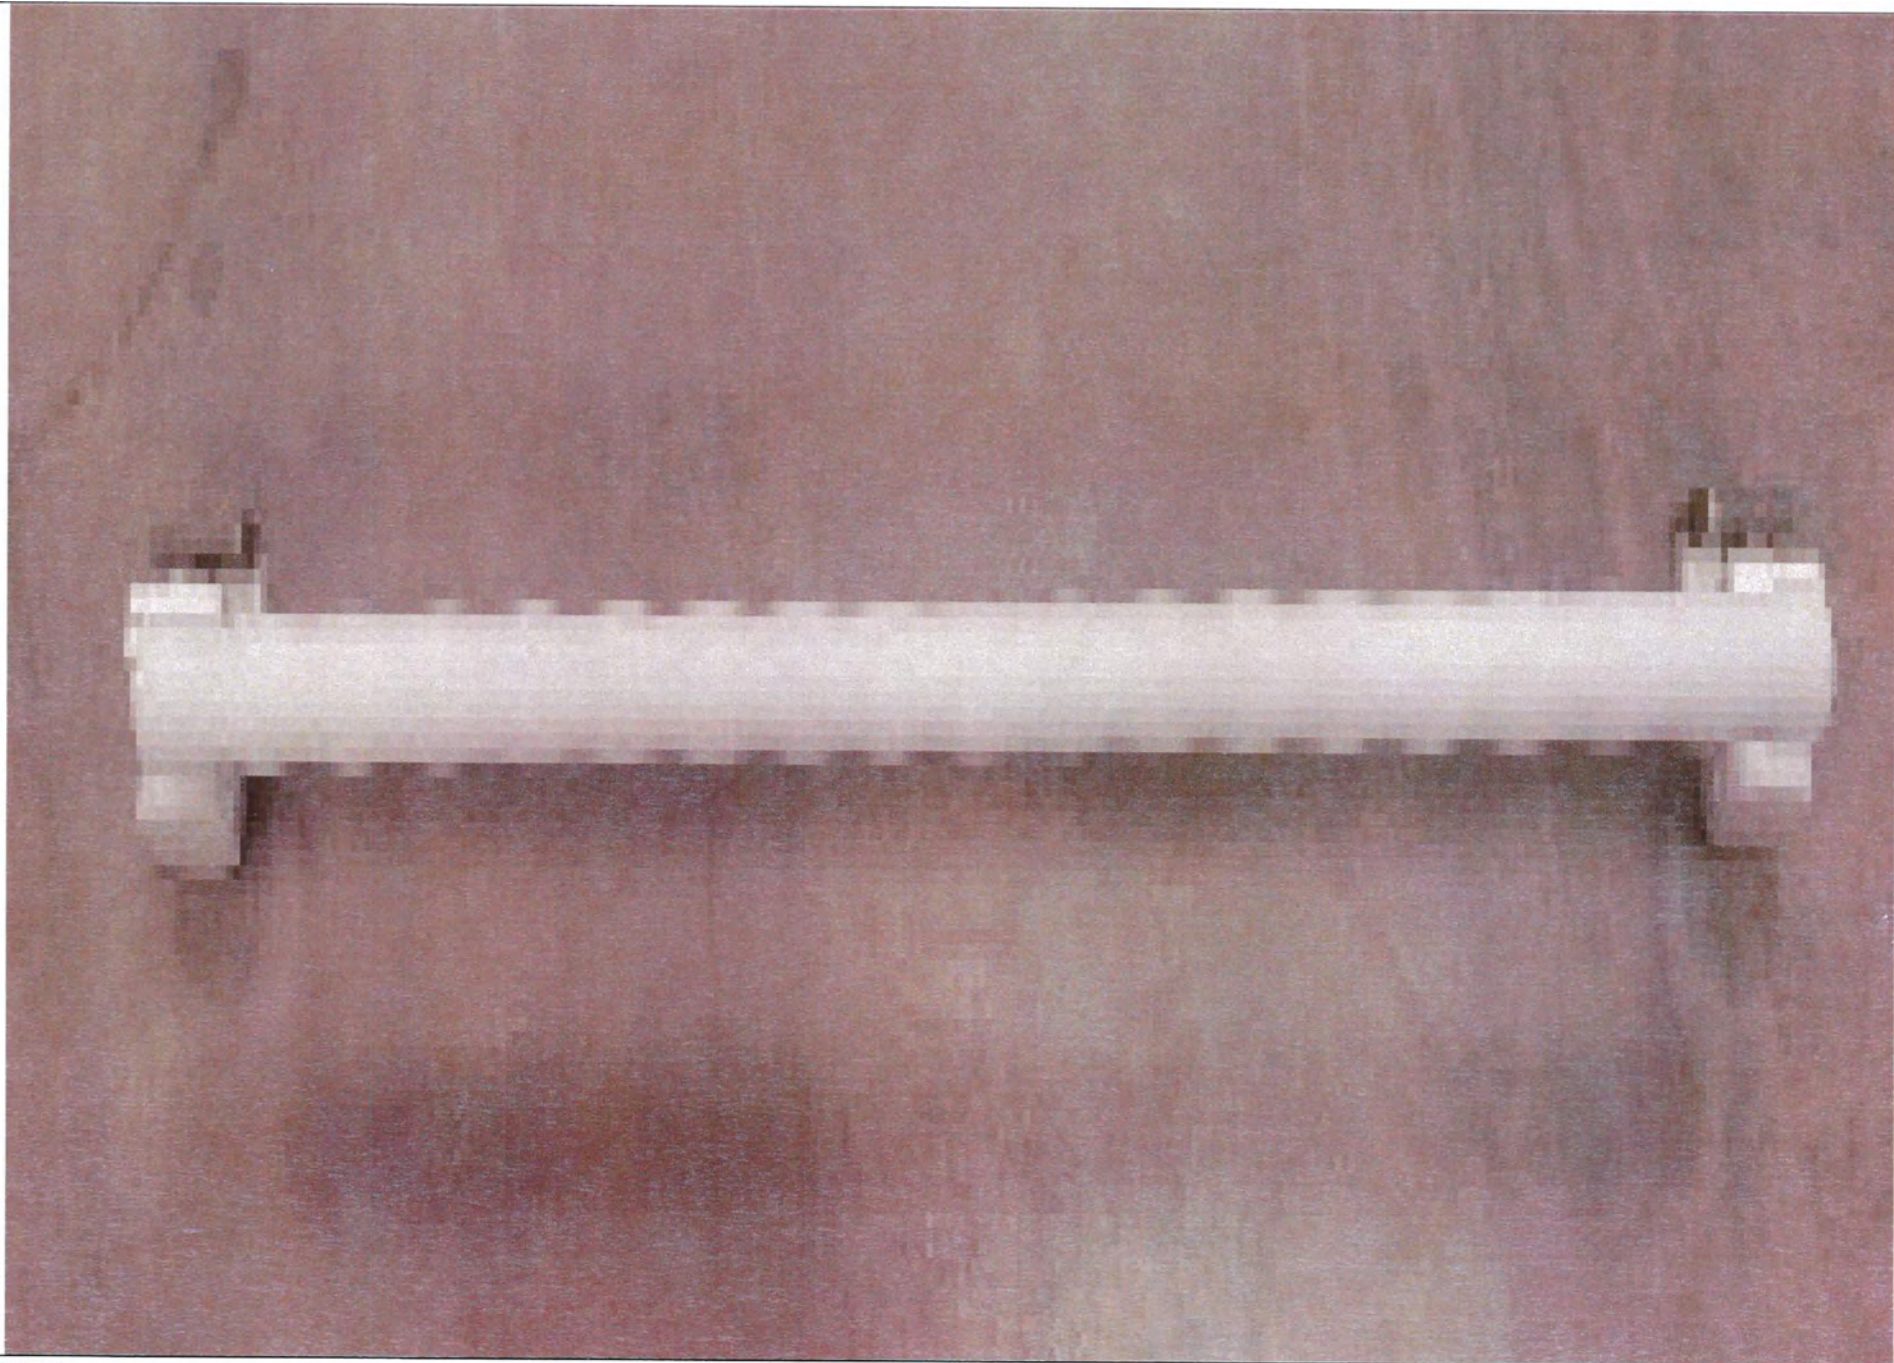


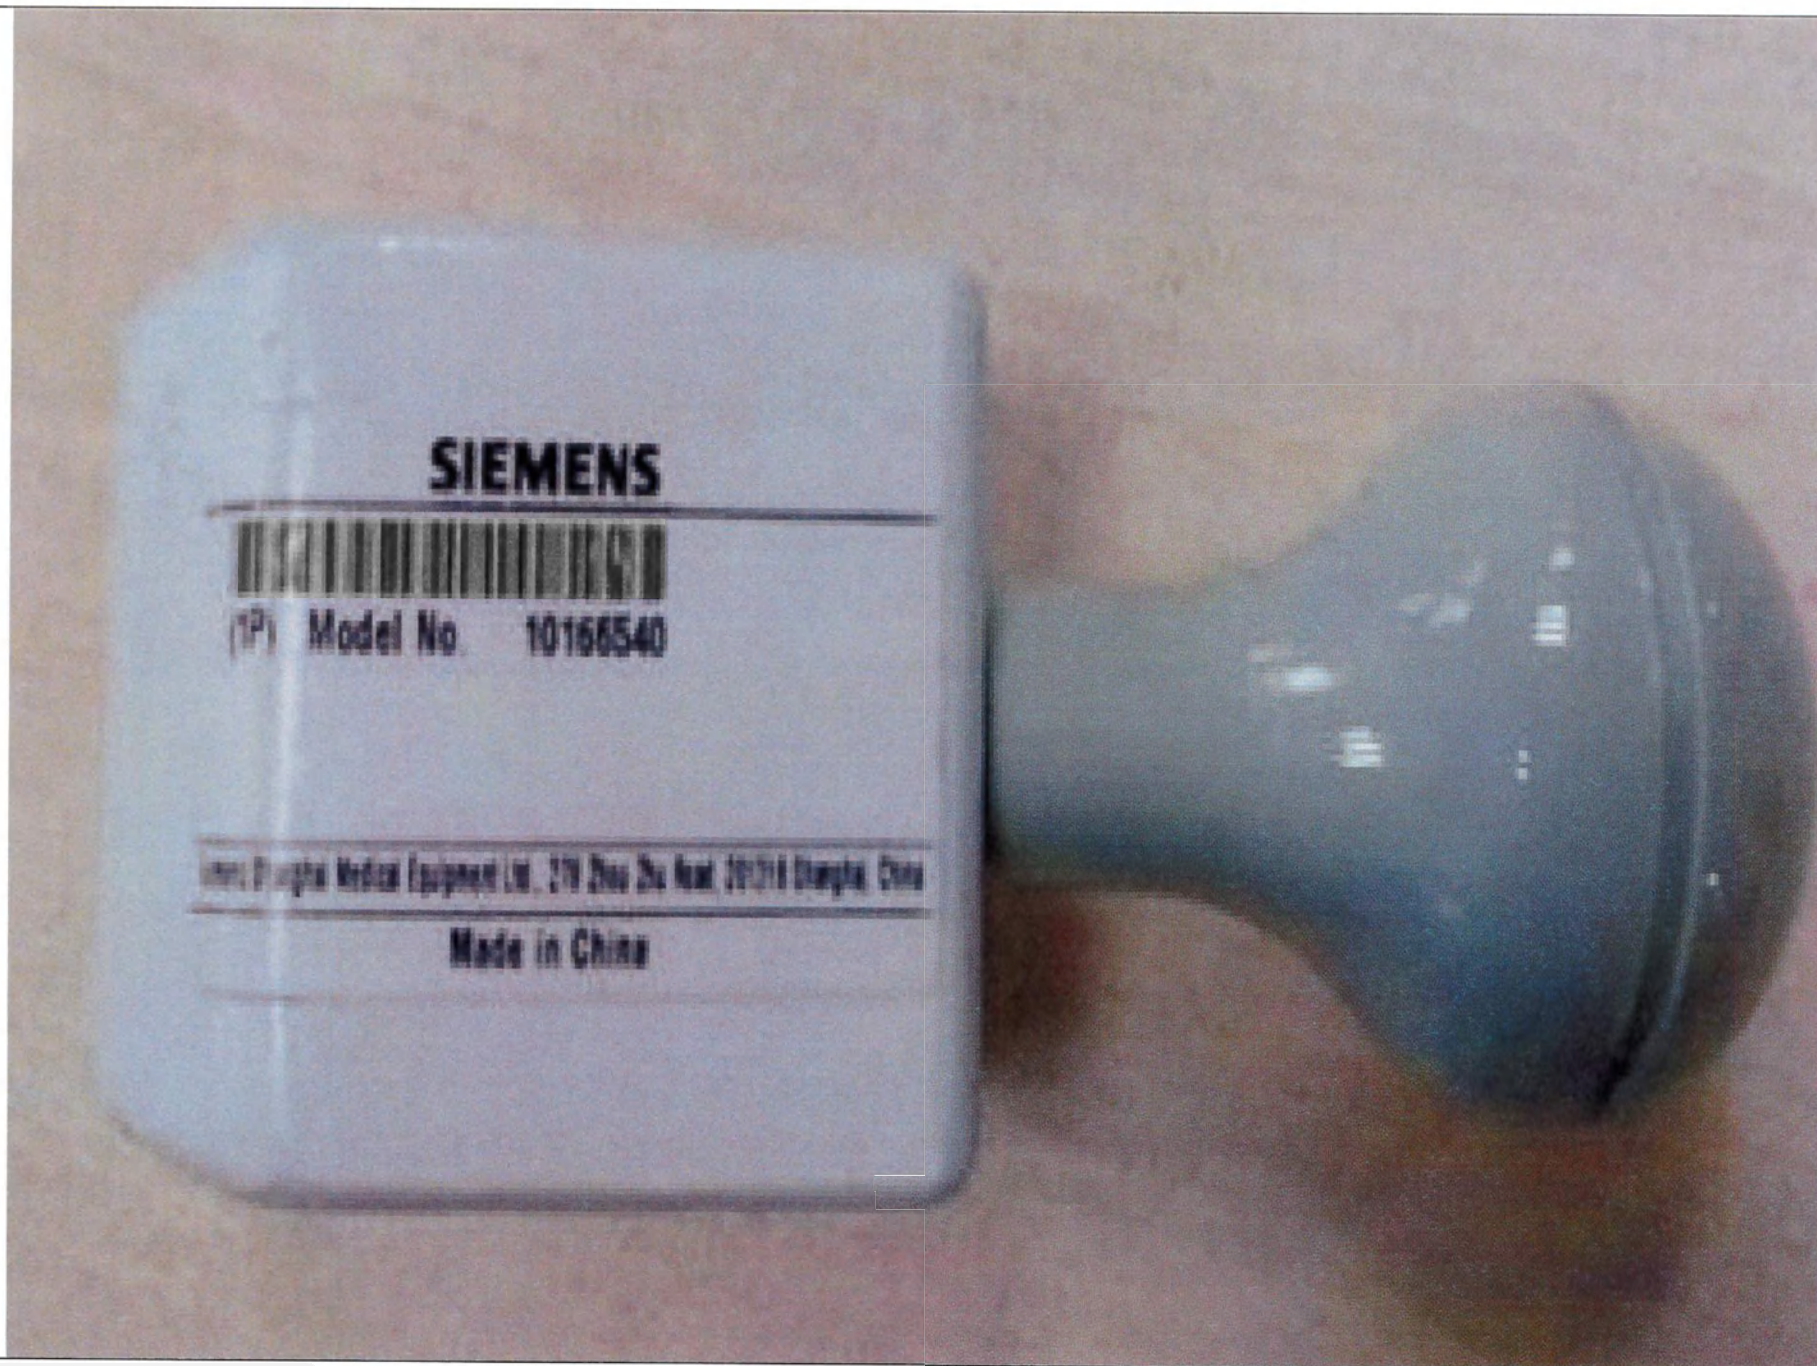


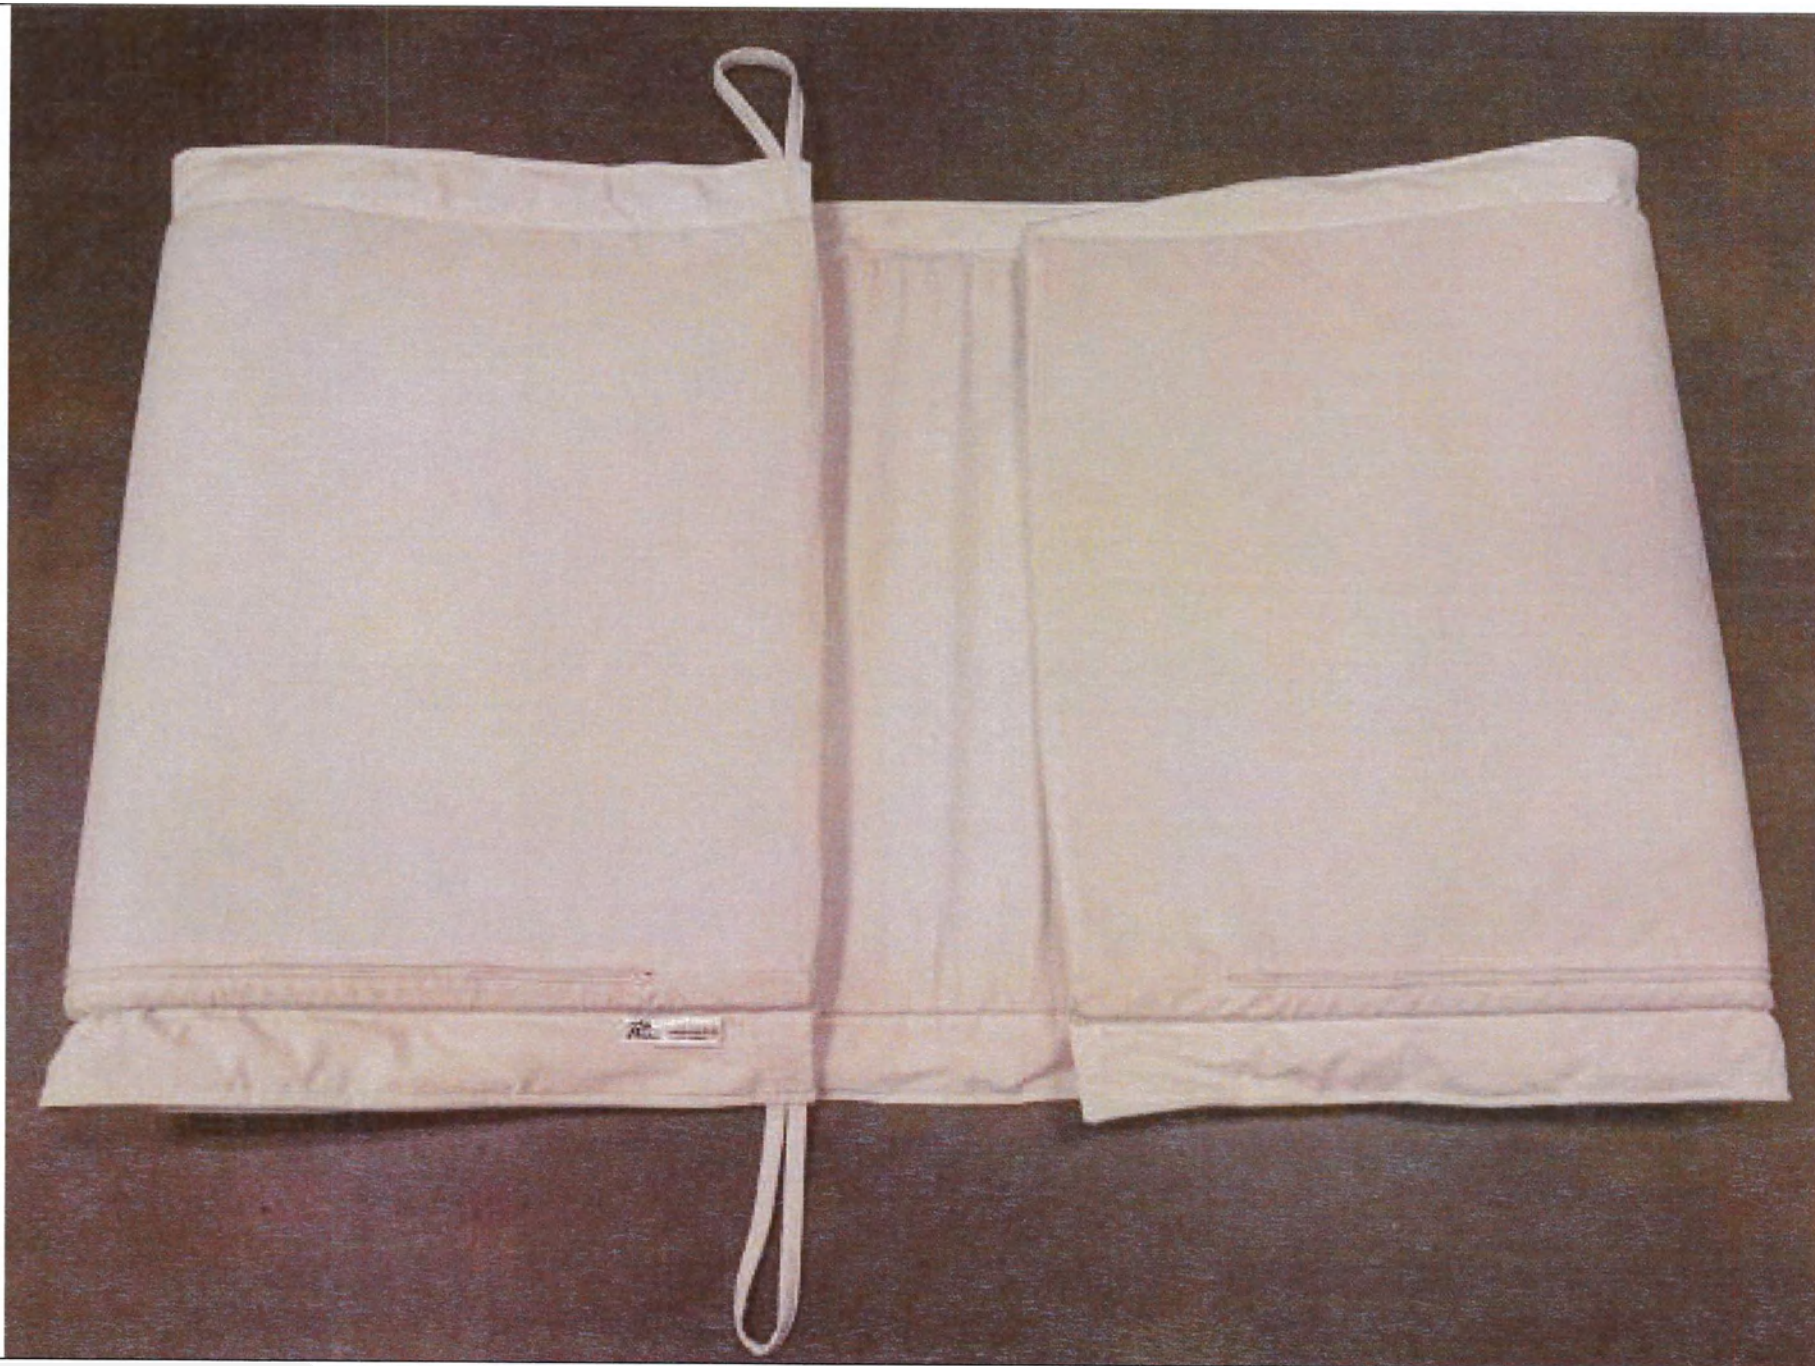

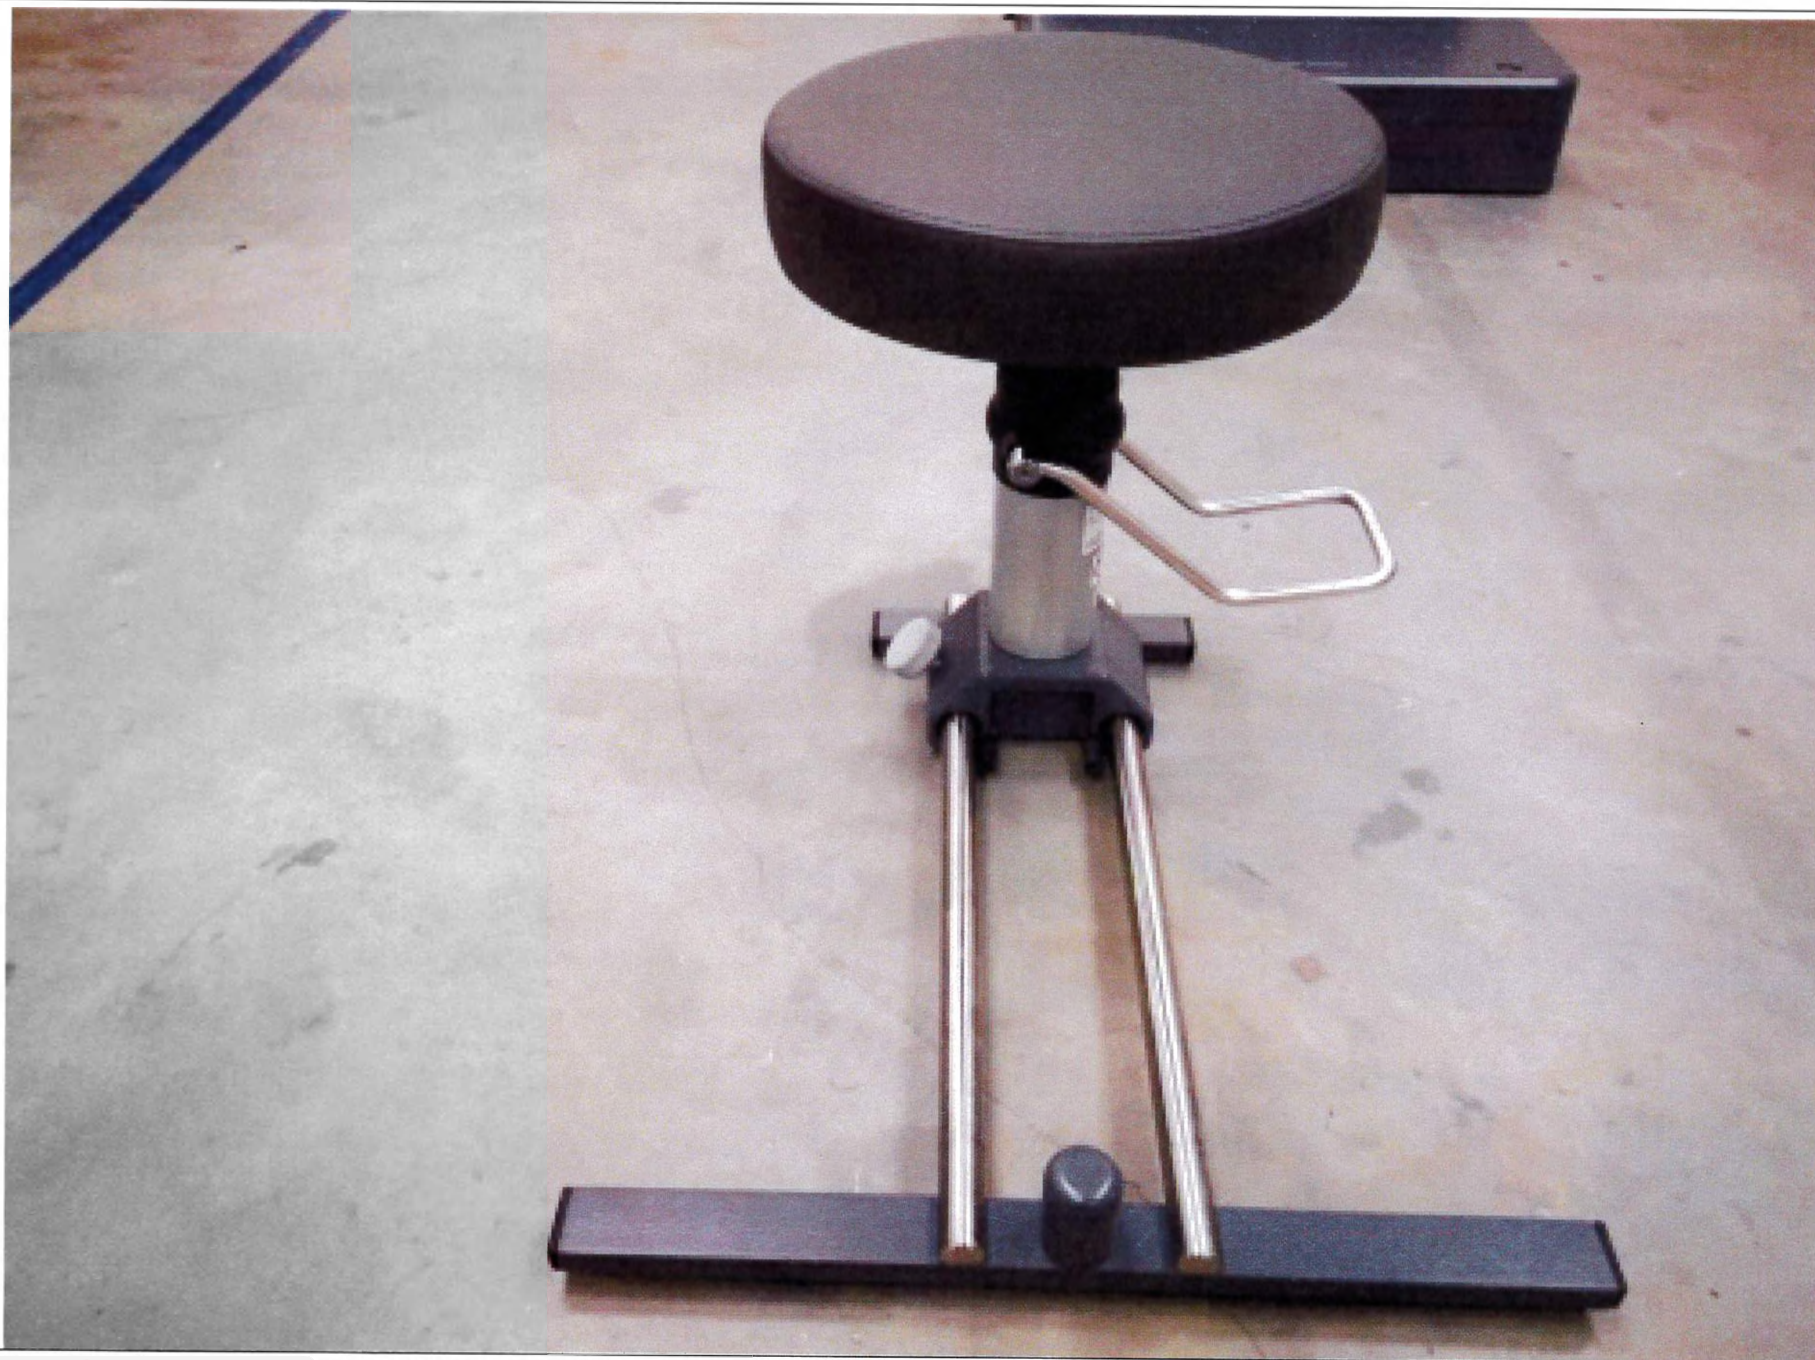

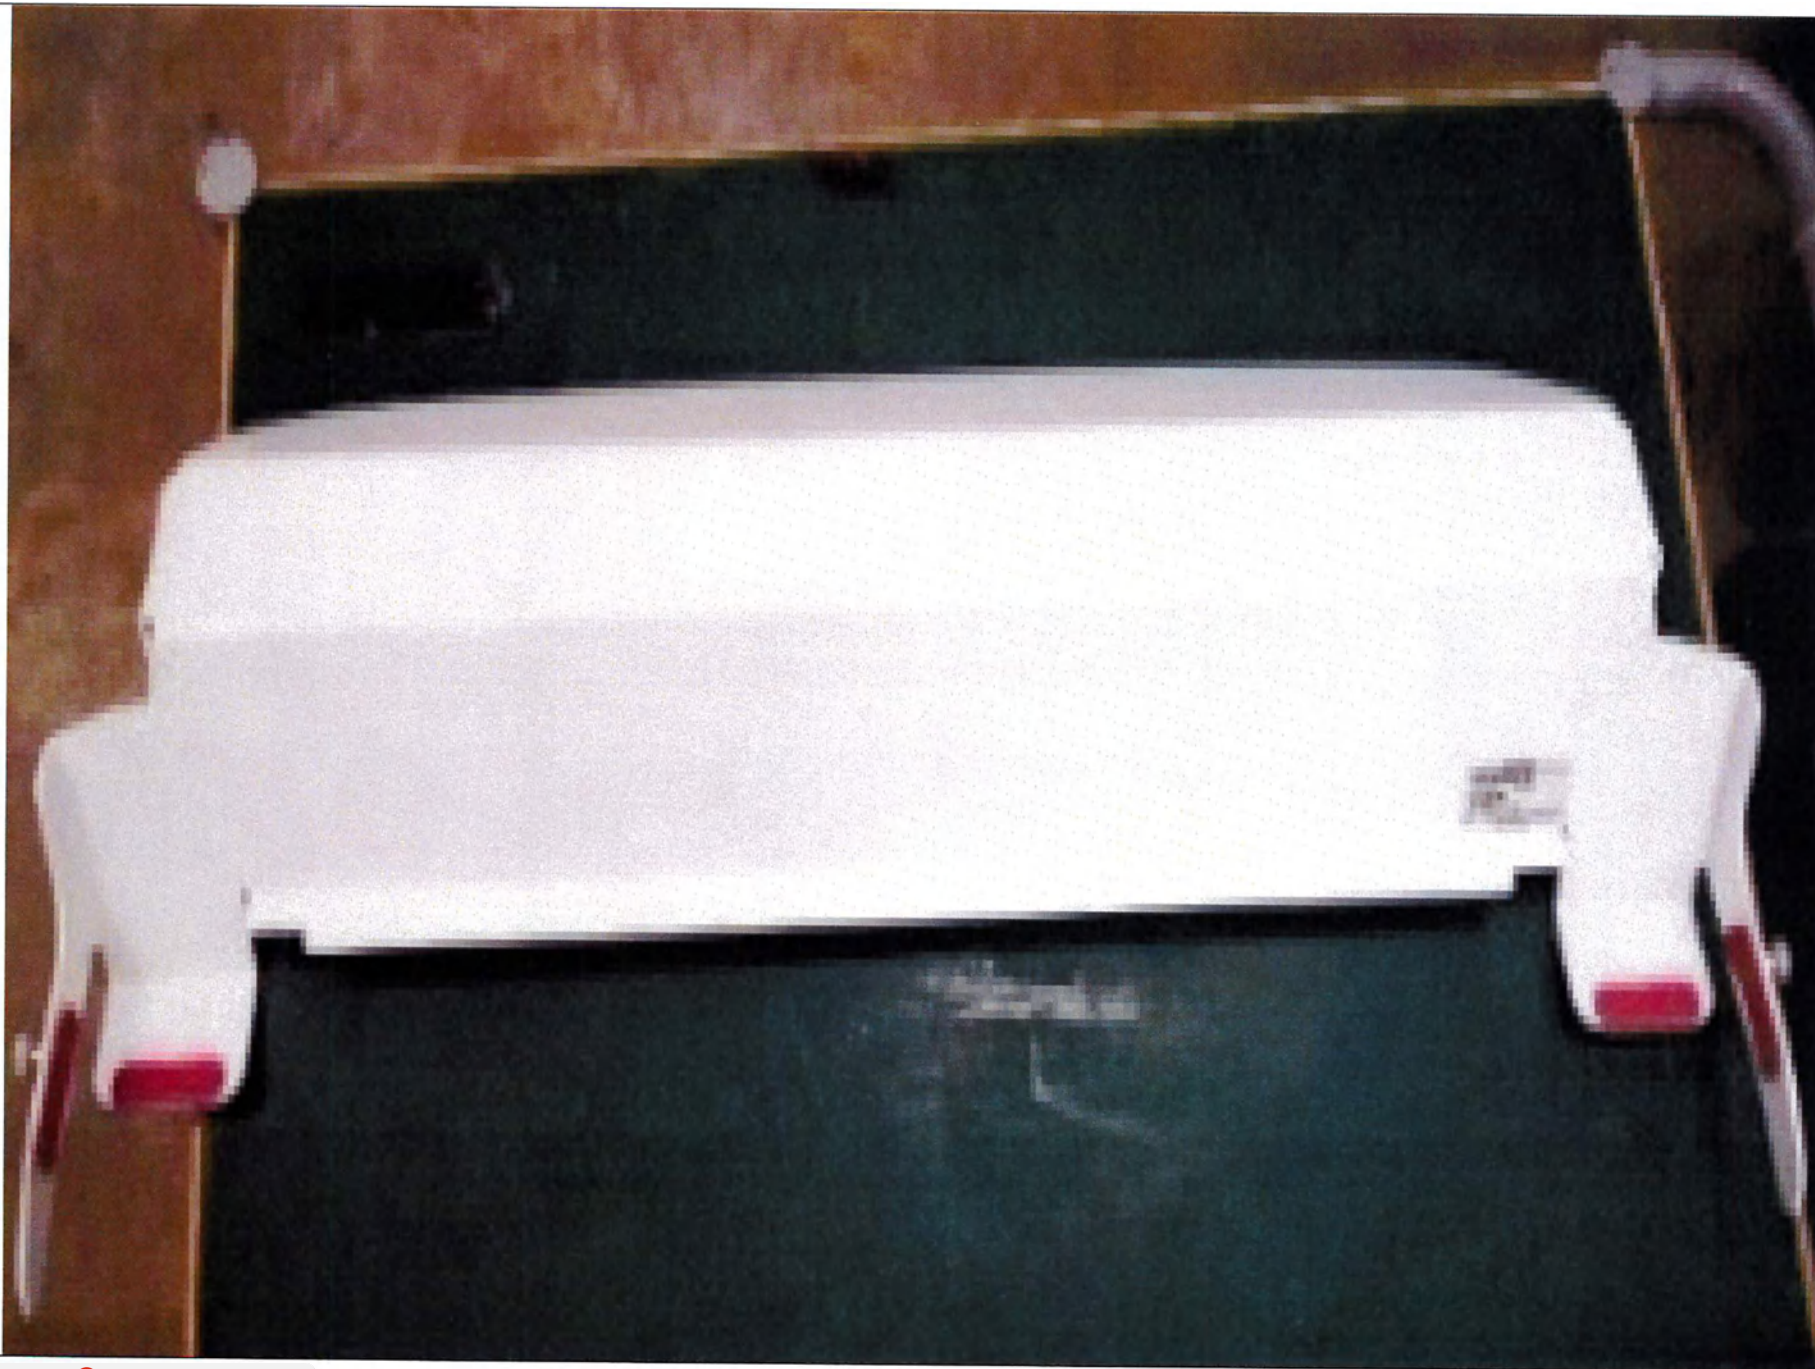


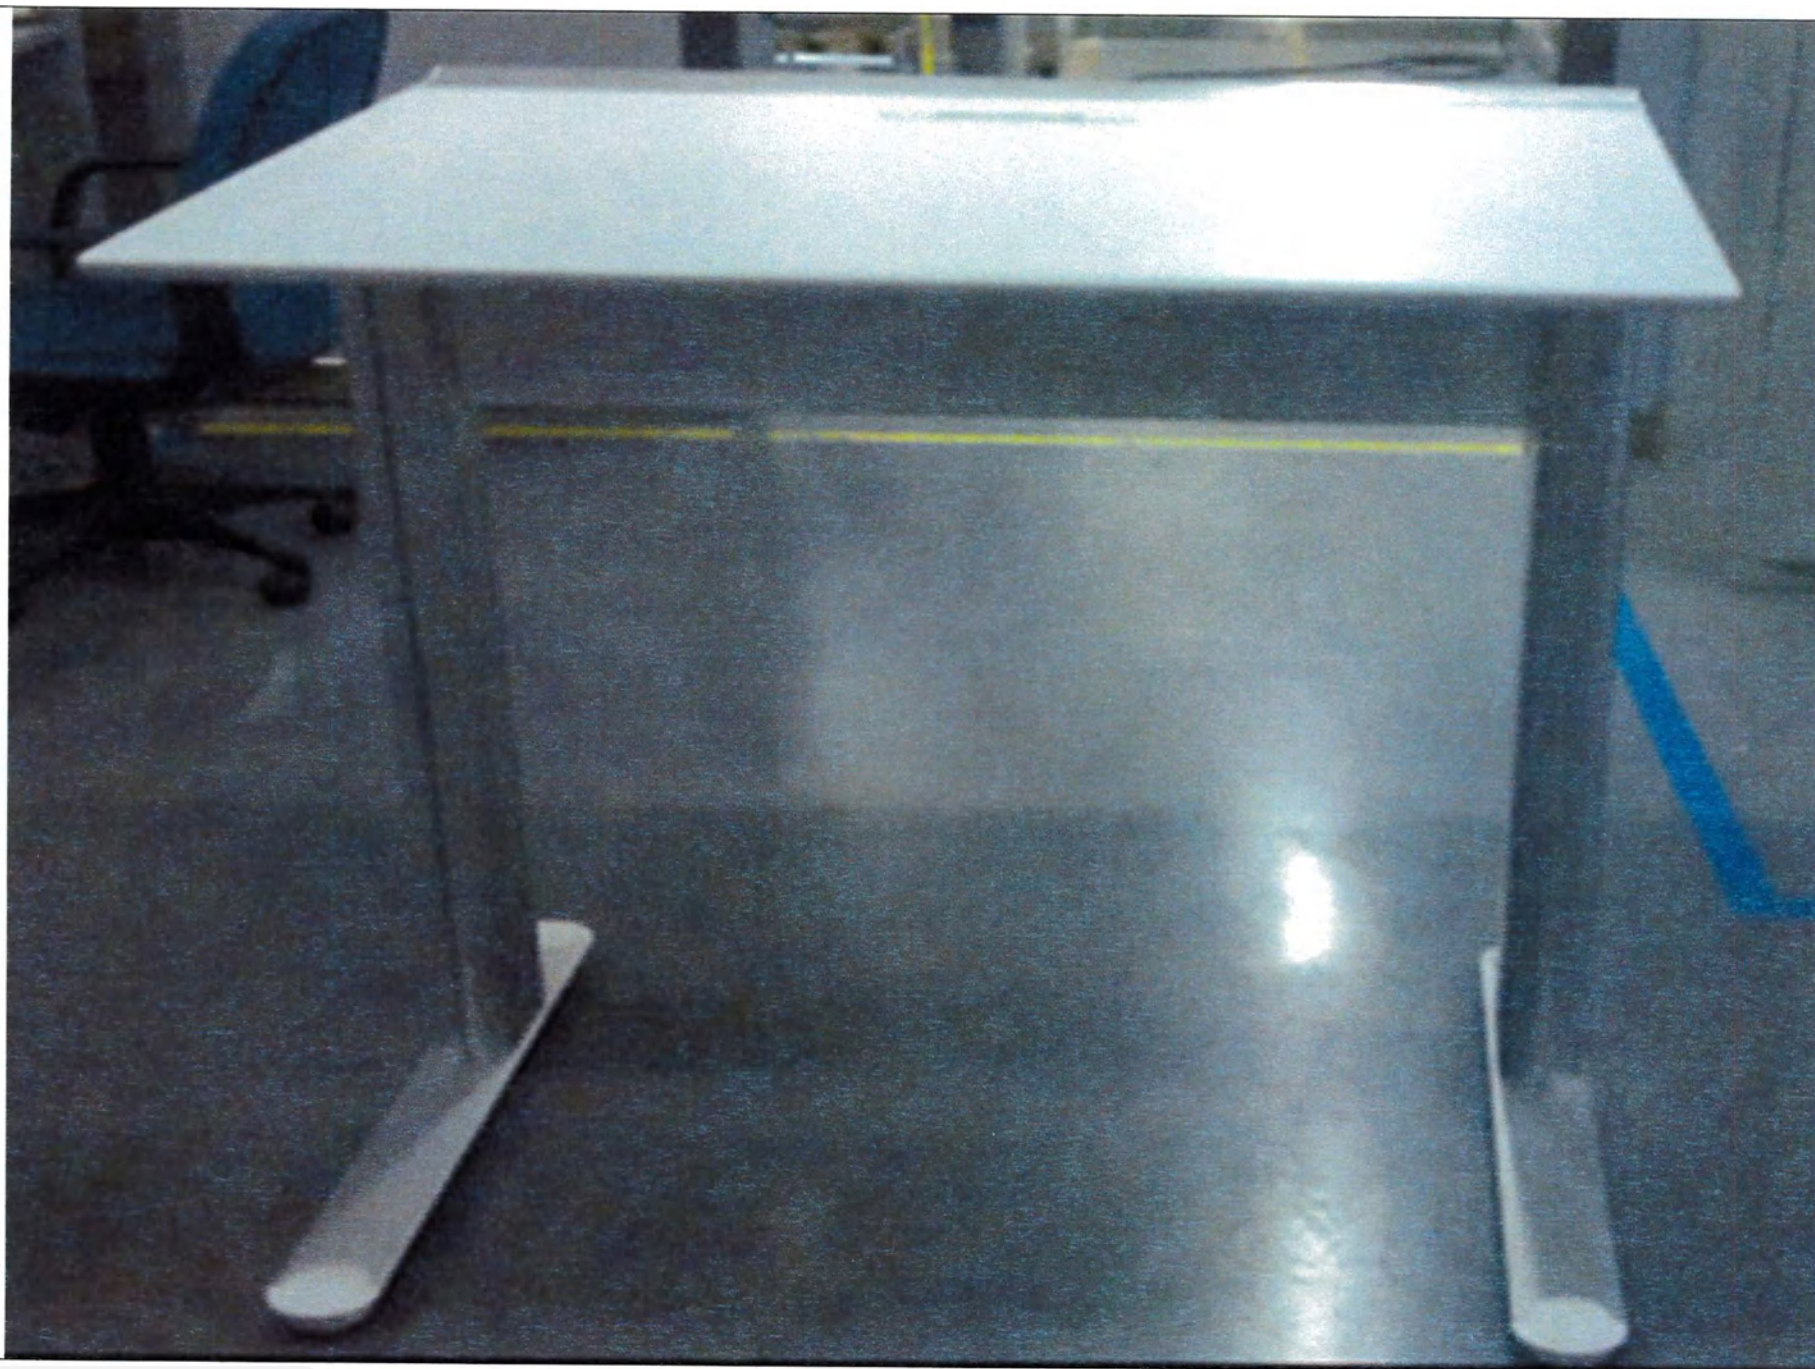

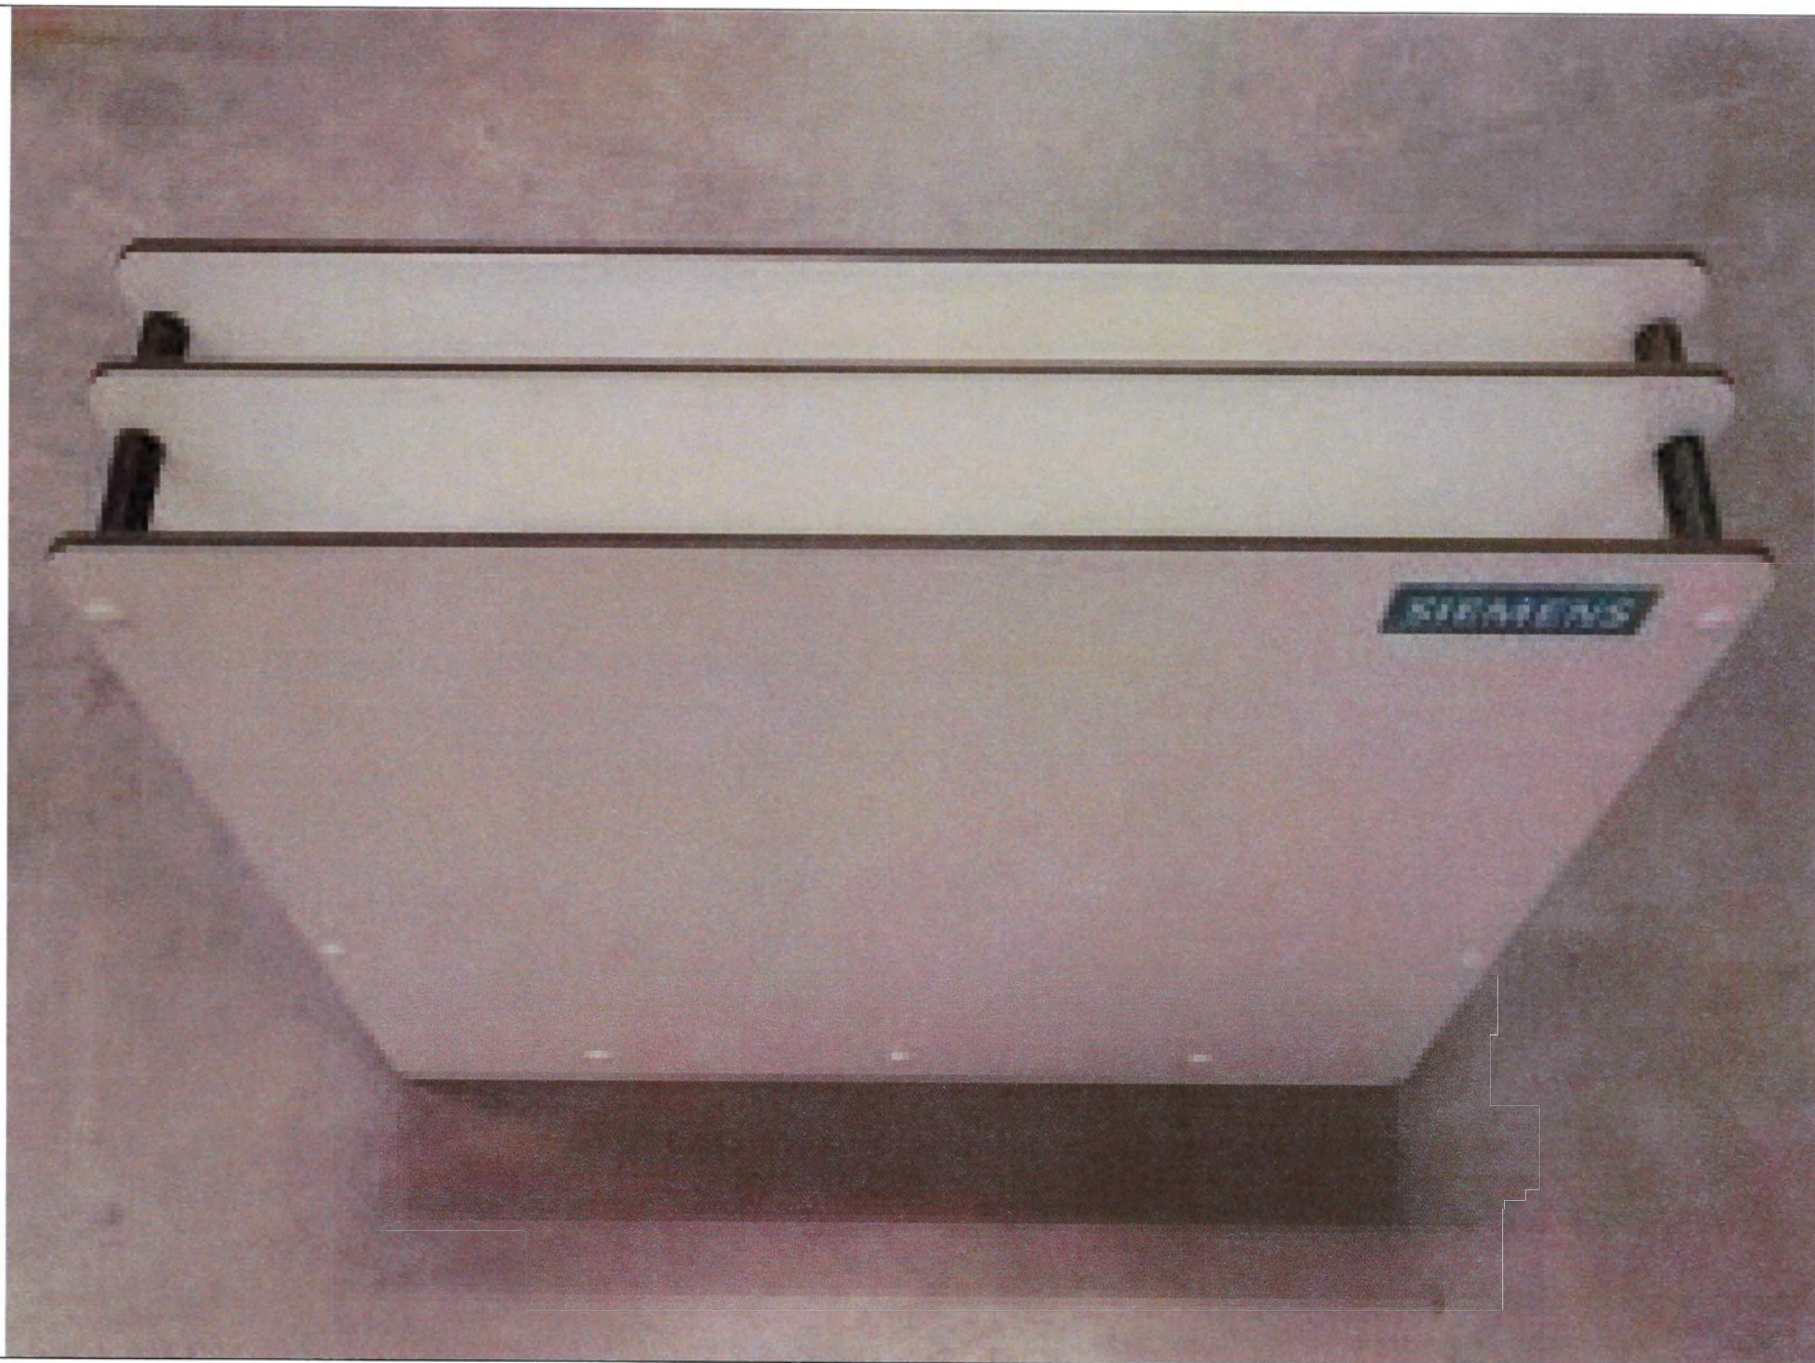





53. 1 Марки для разметки пленки.

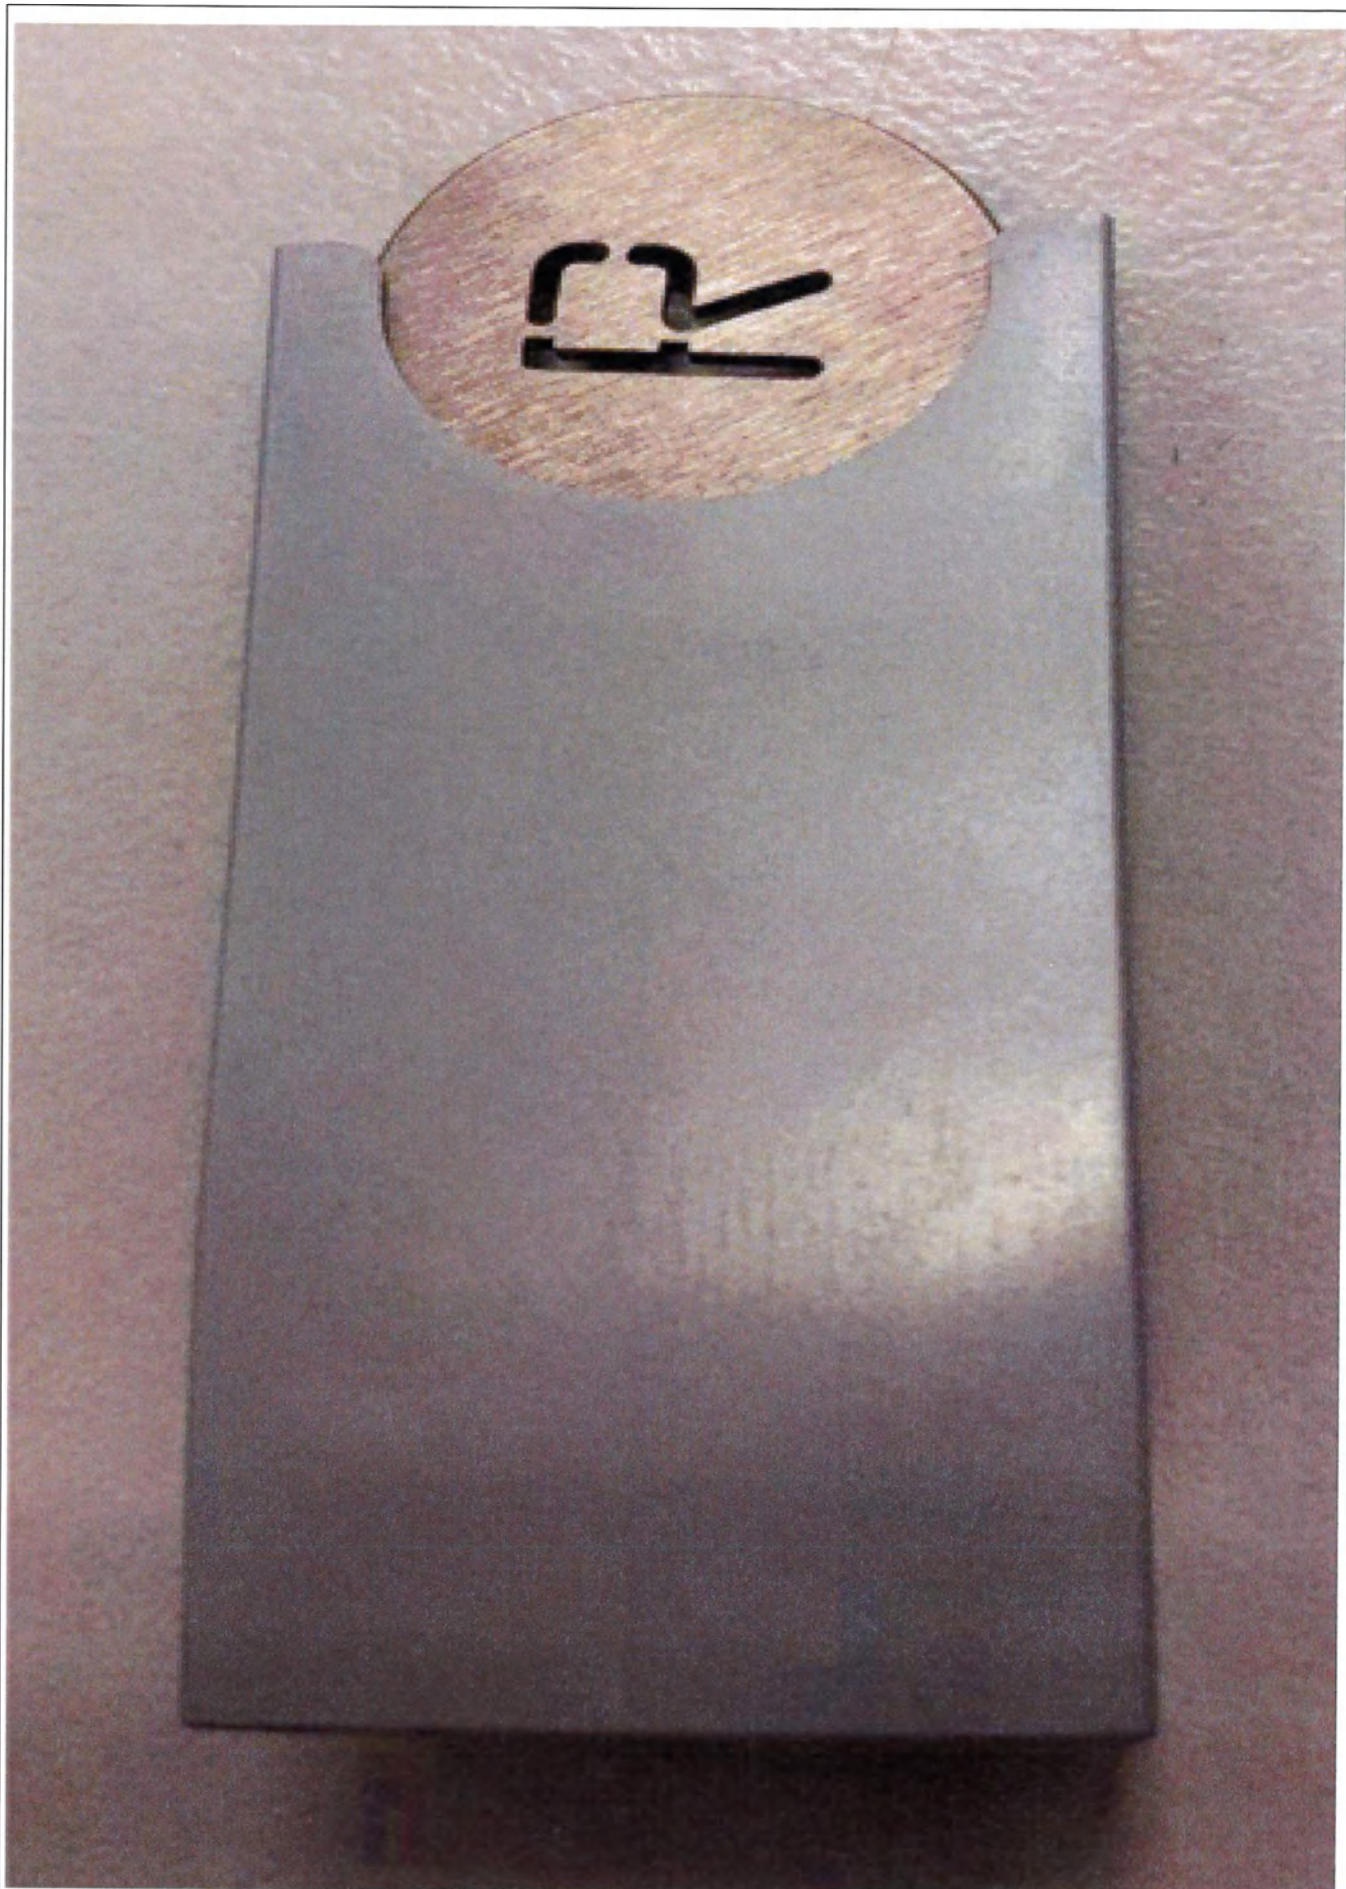



53. 2 Марки для разметки пленки.




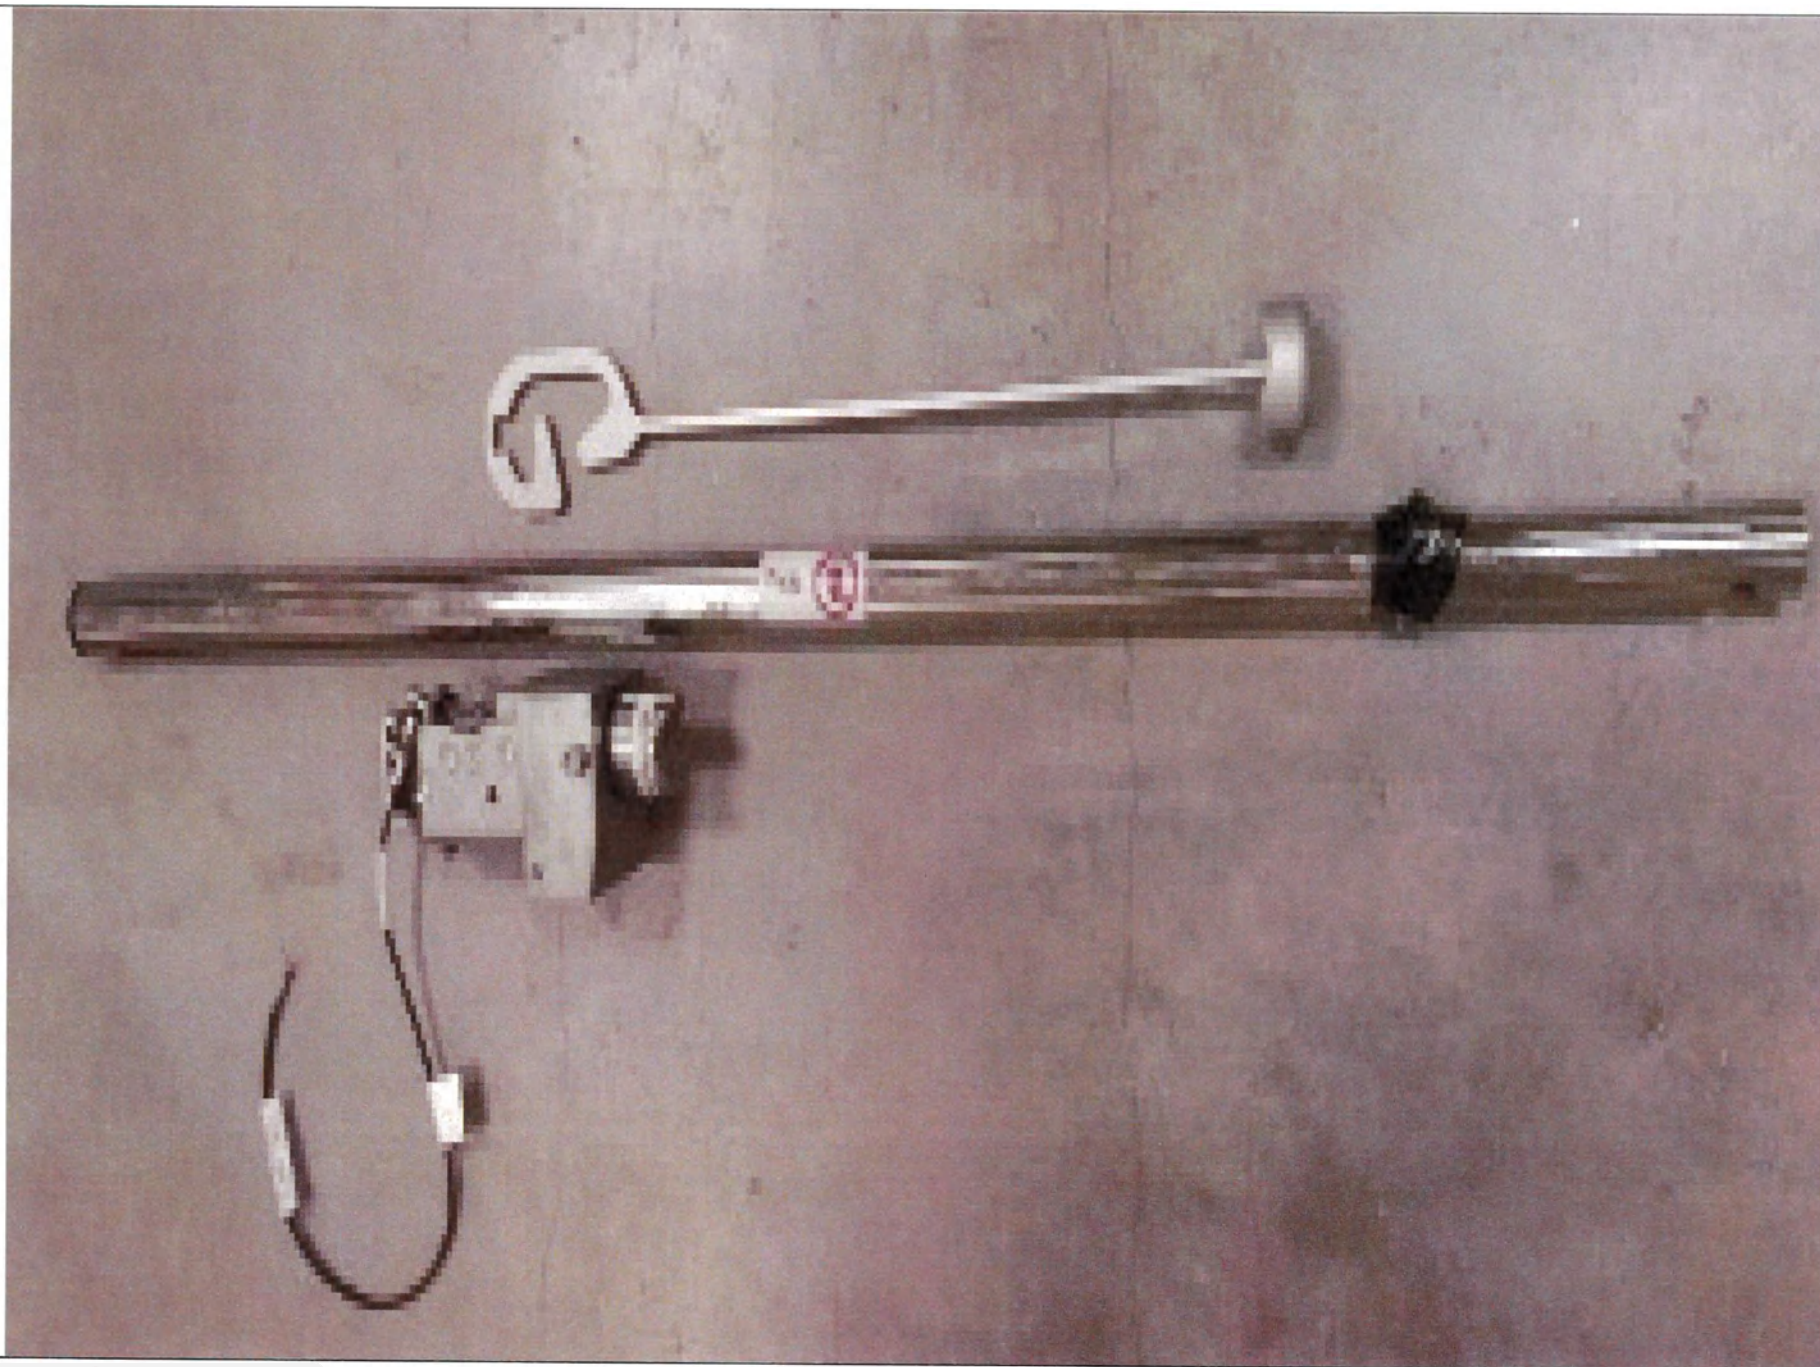

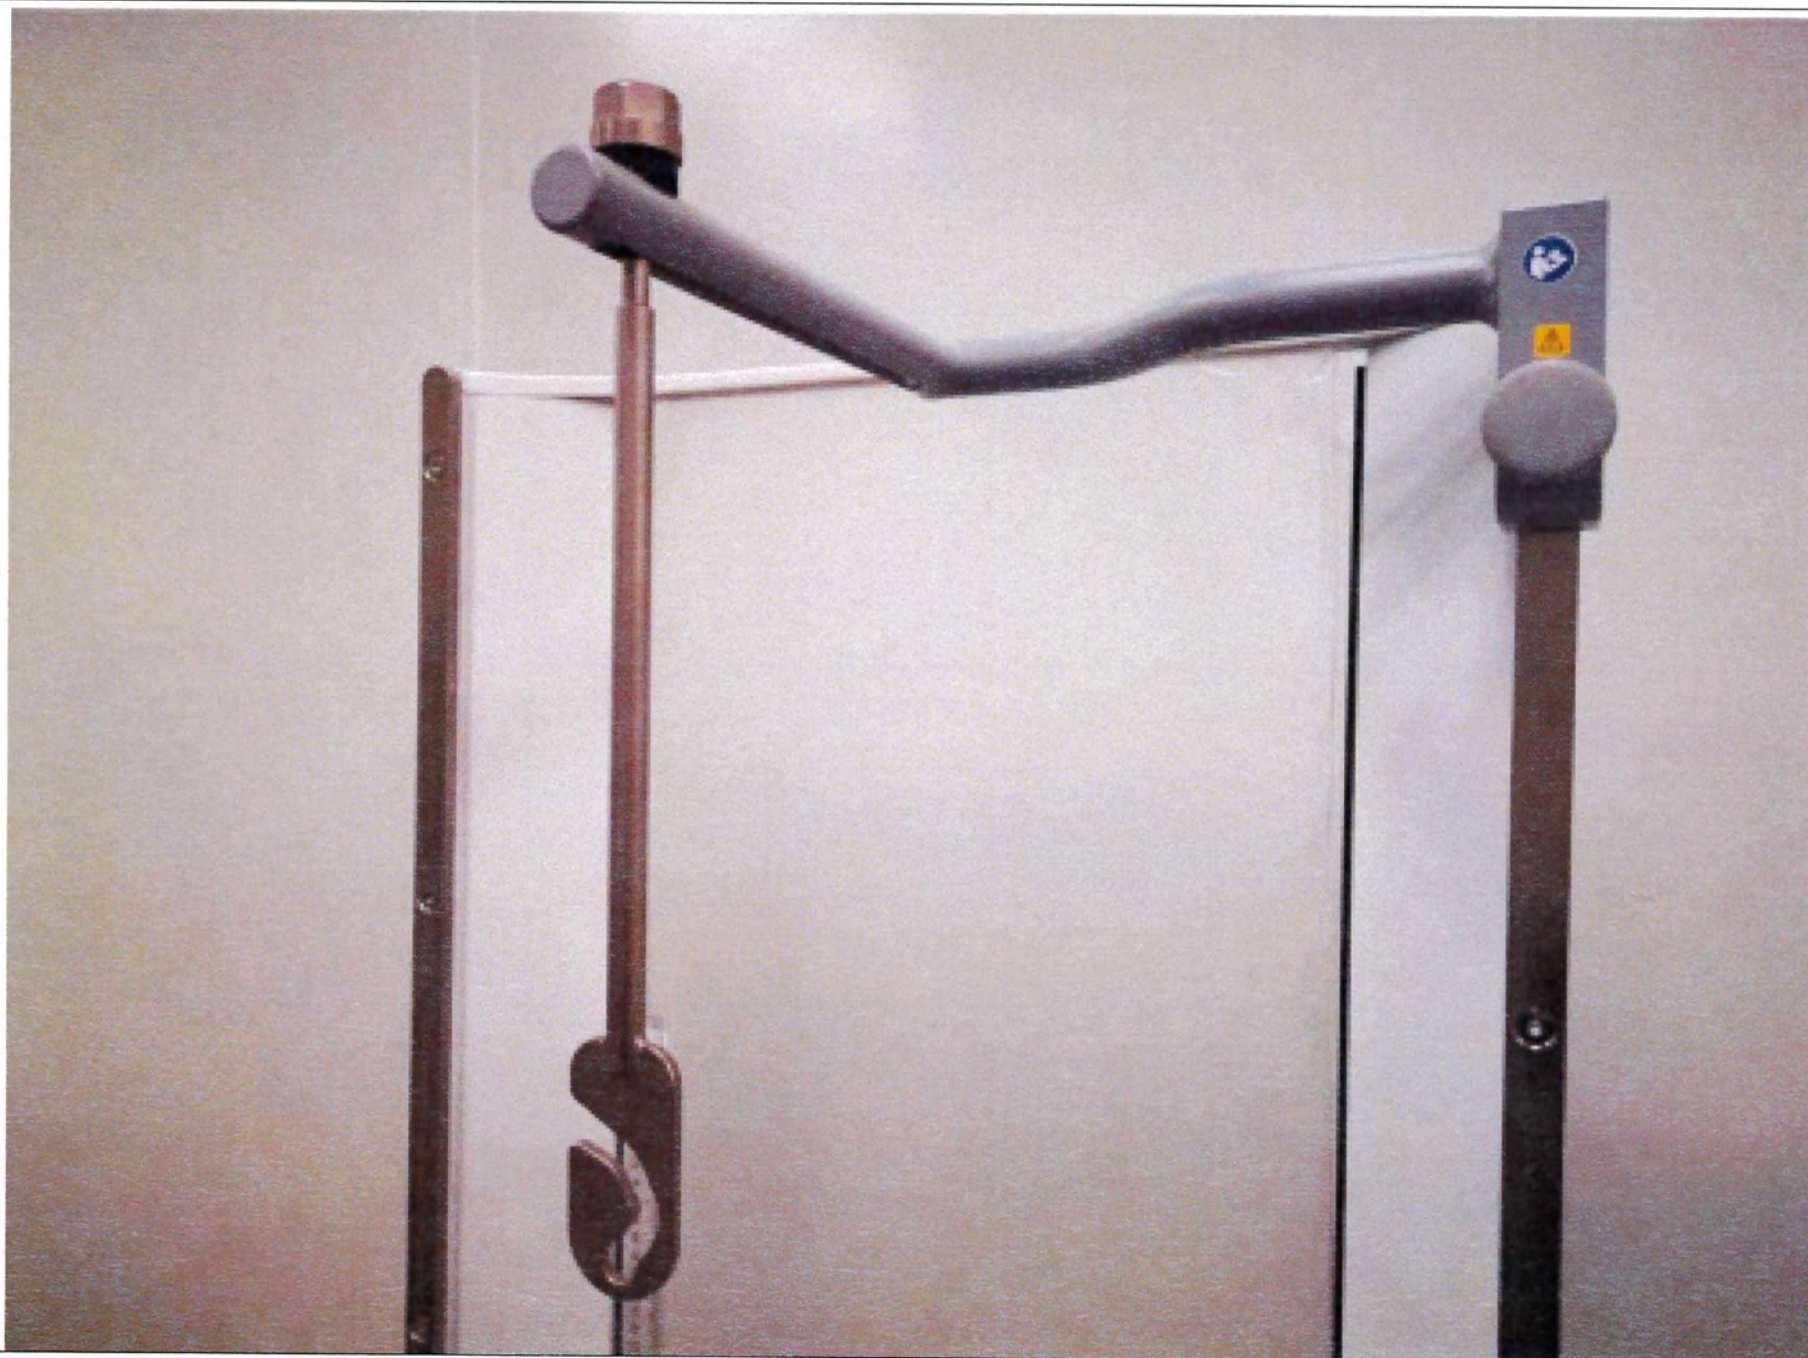

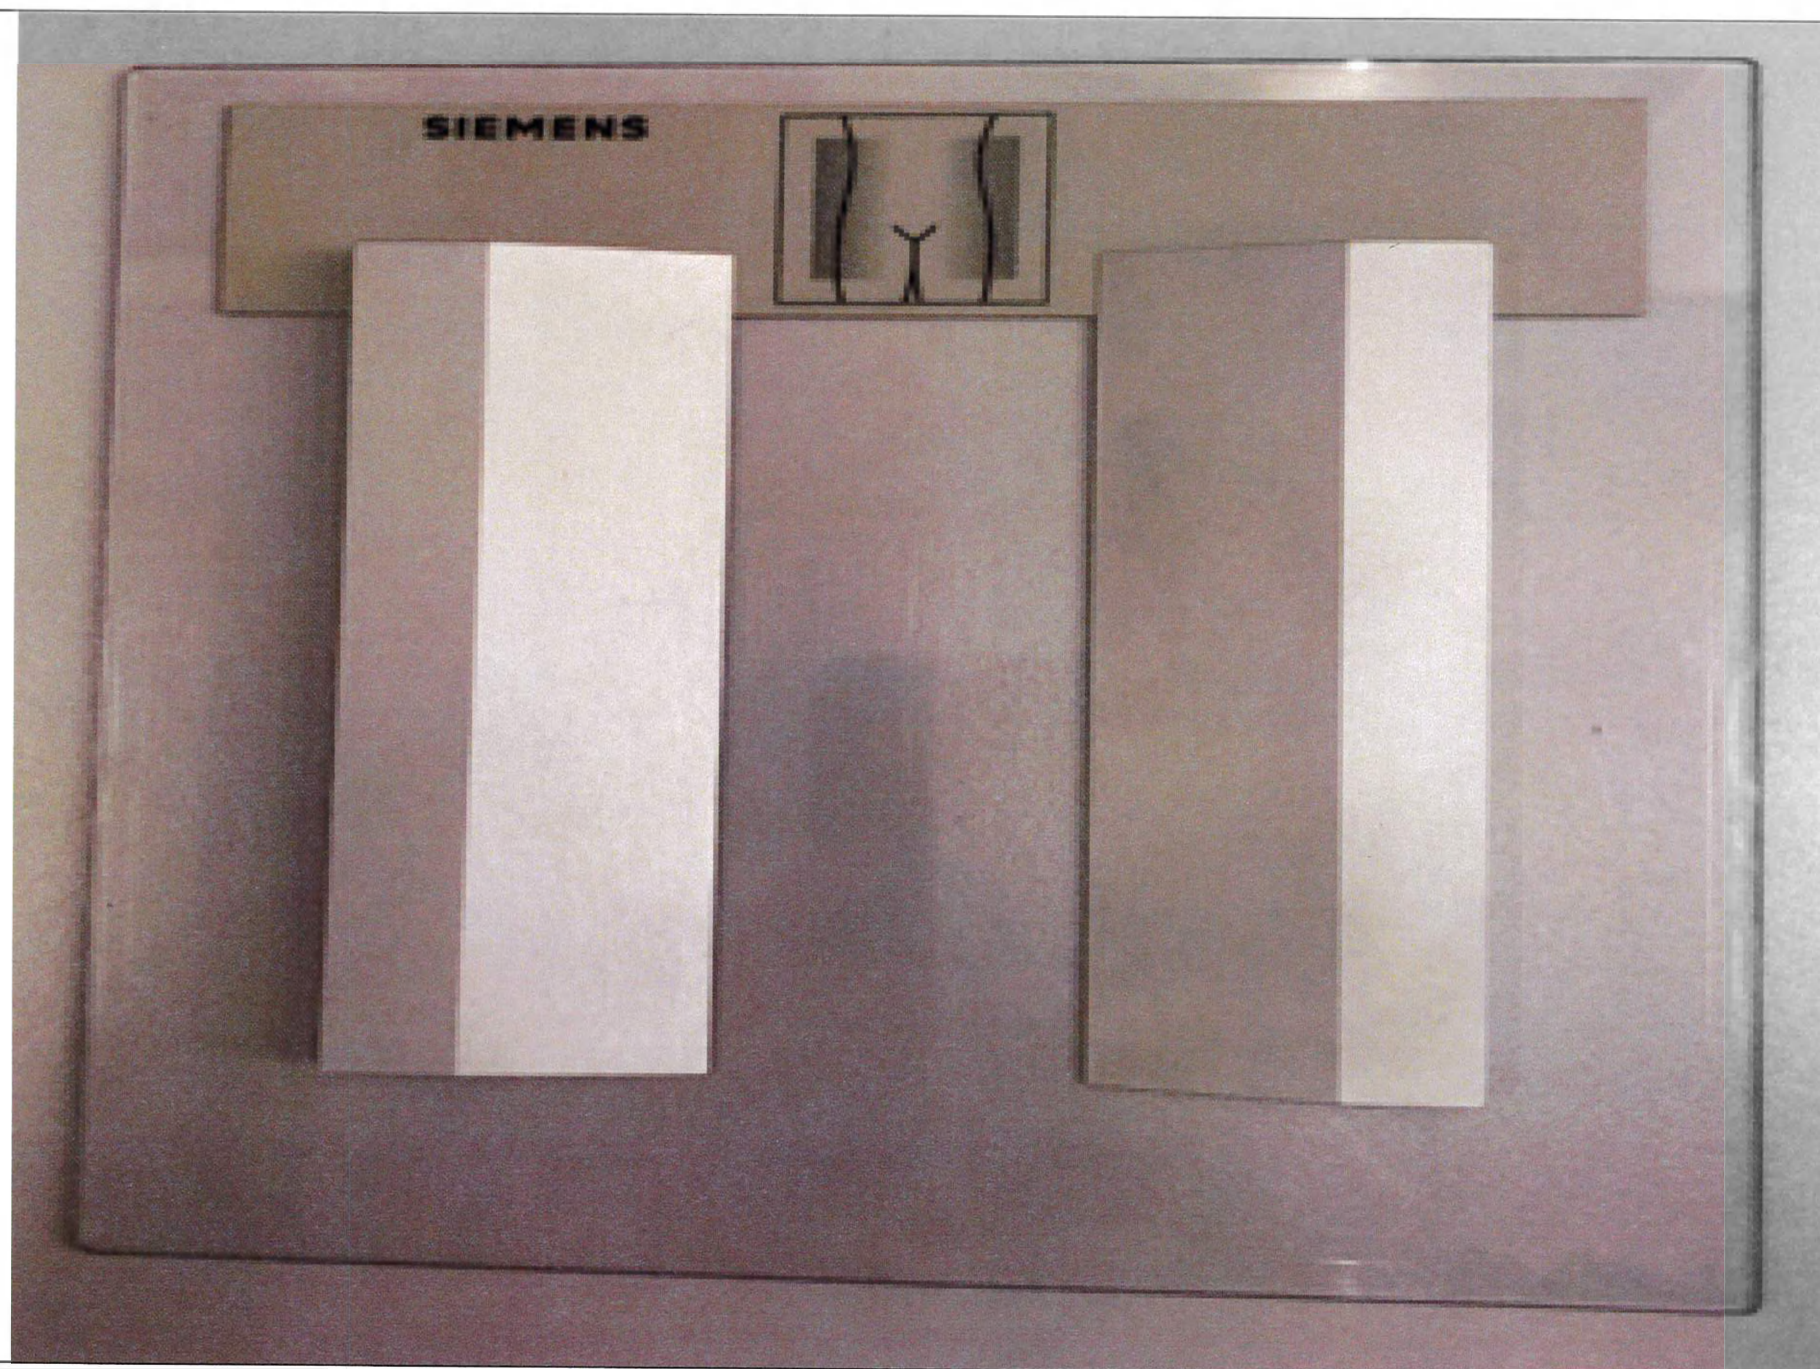


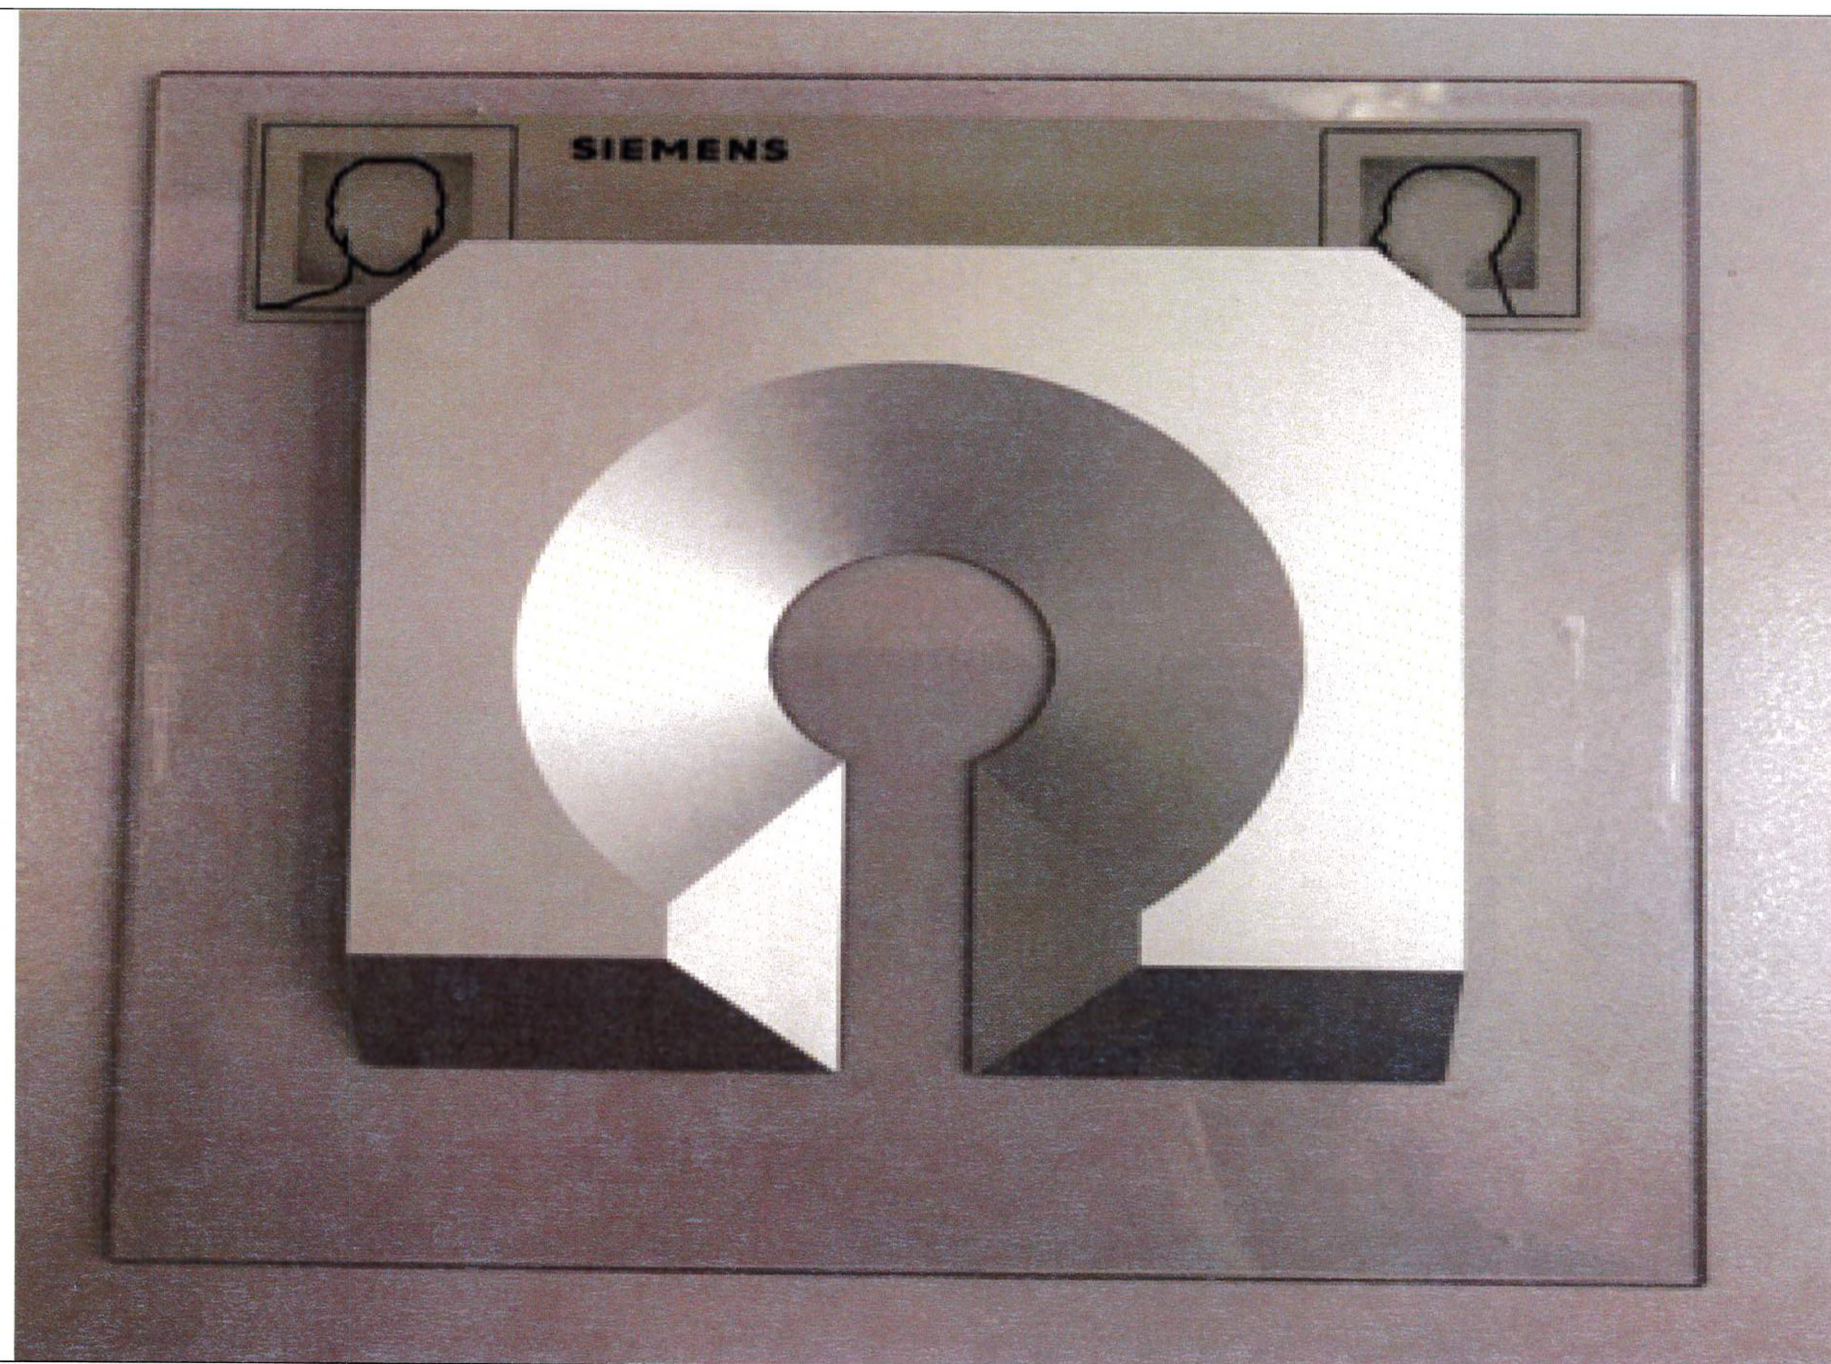

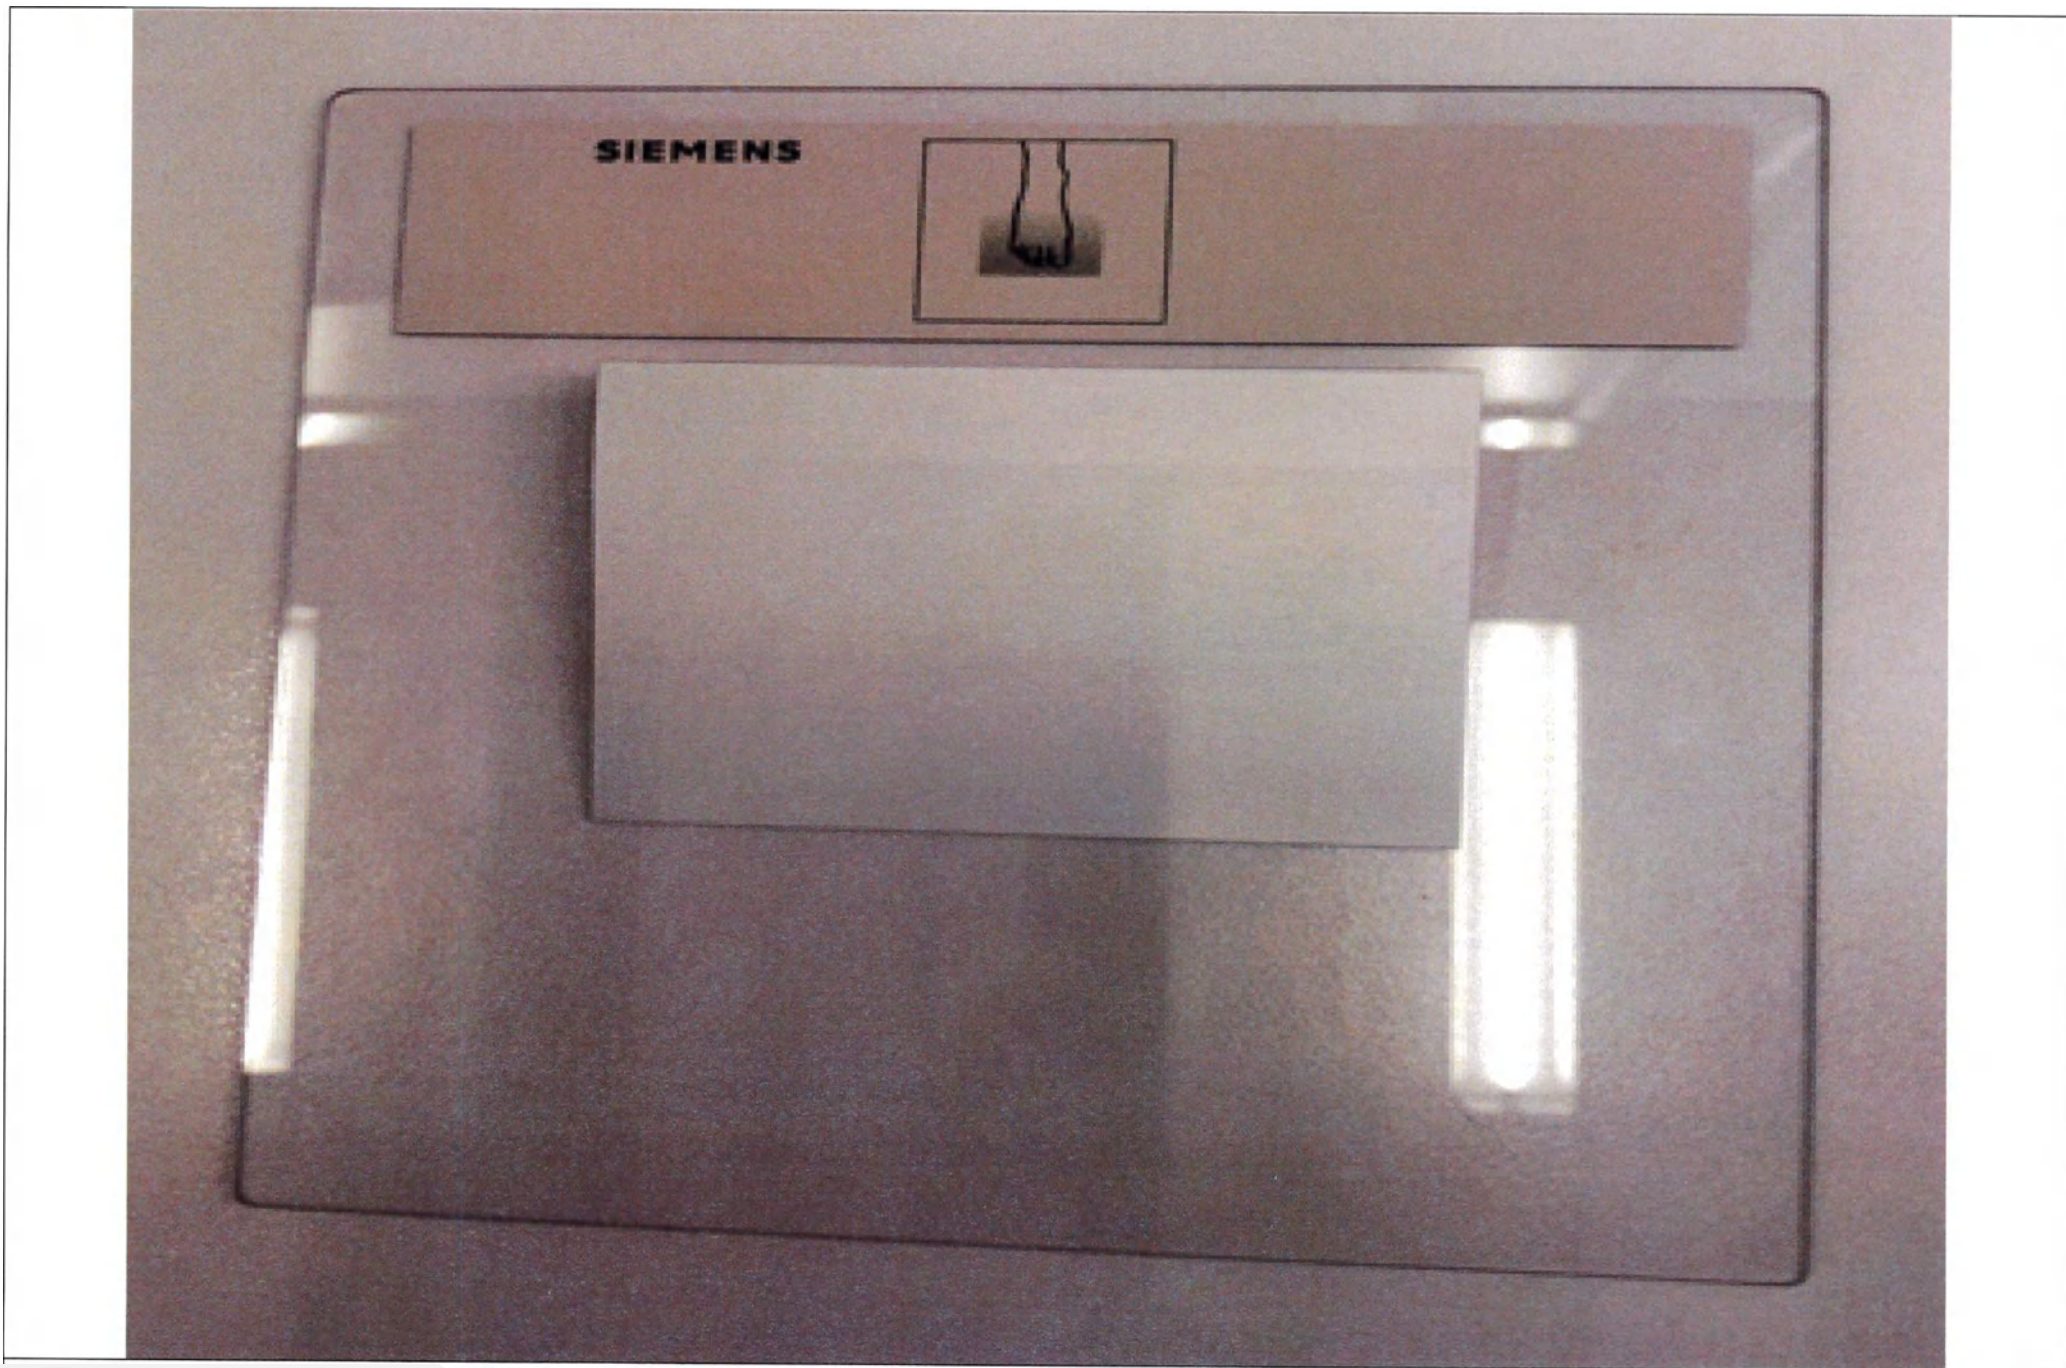






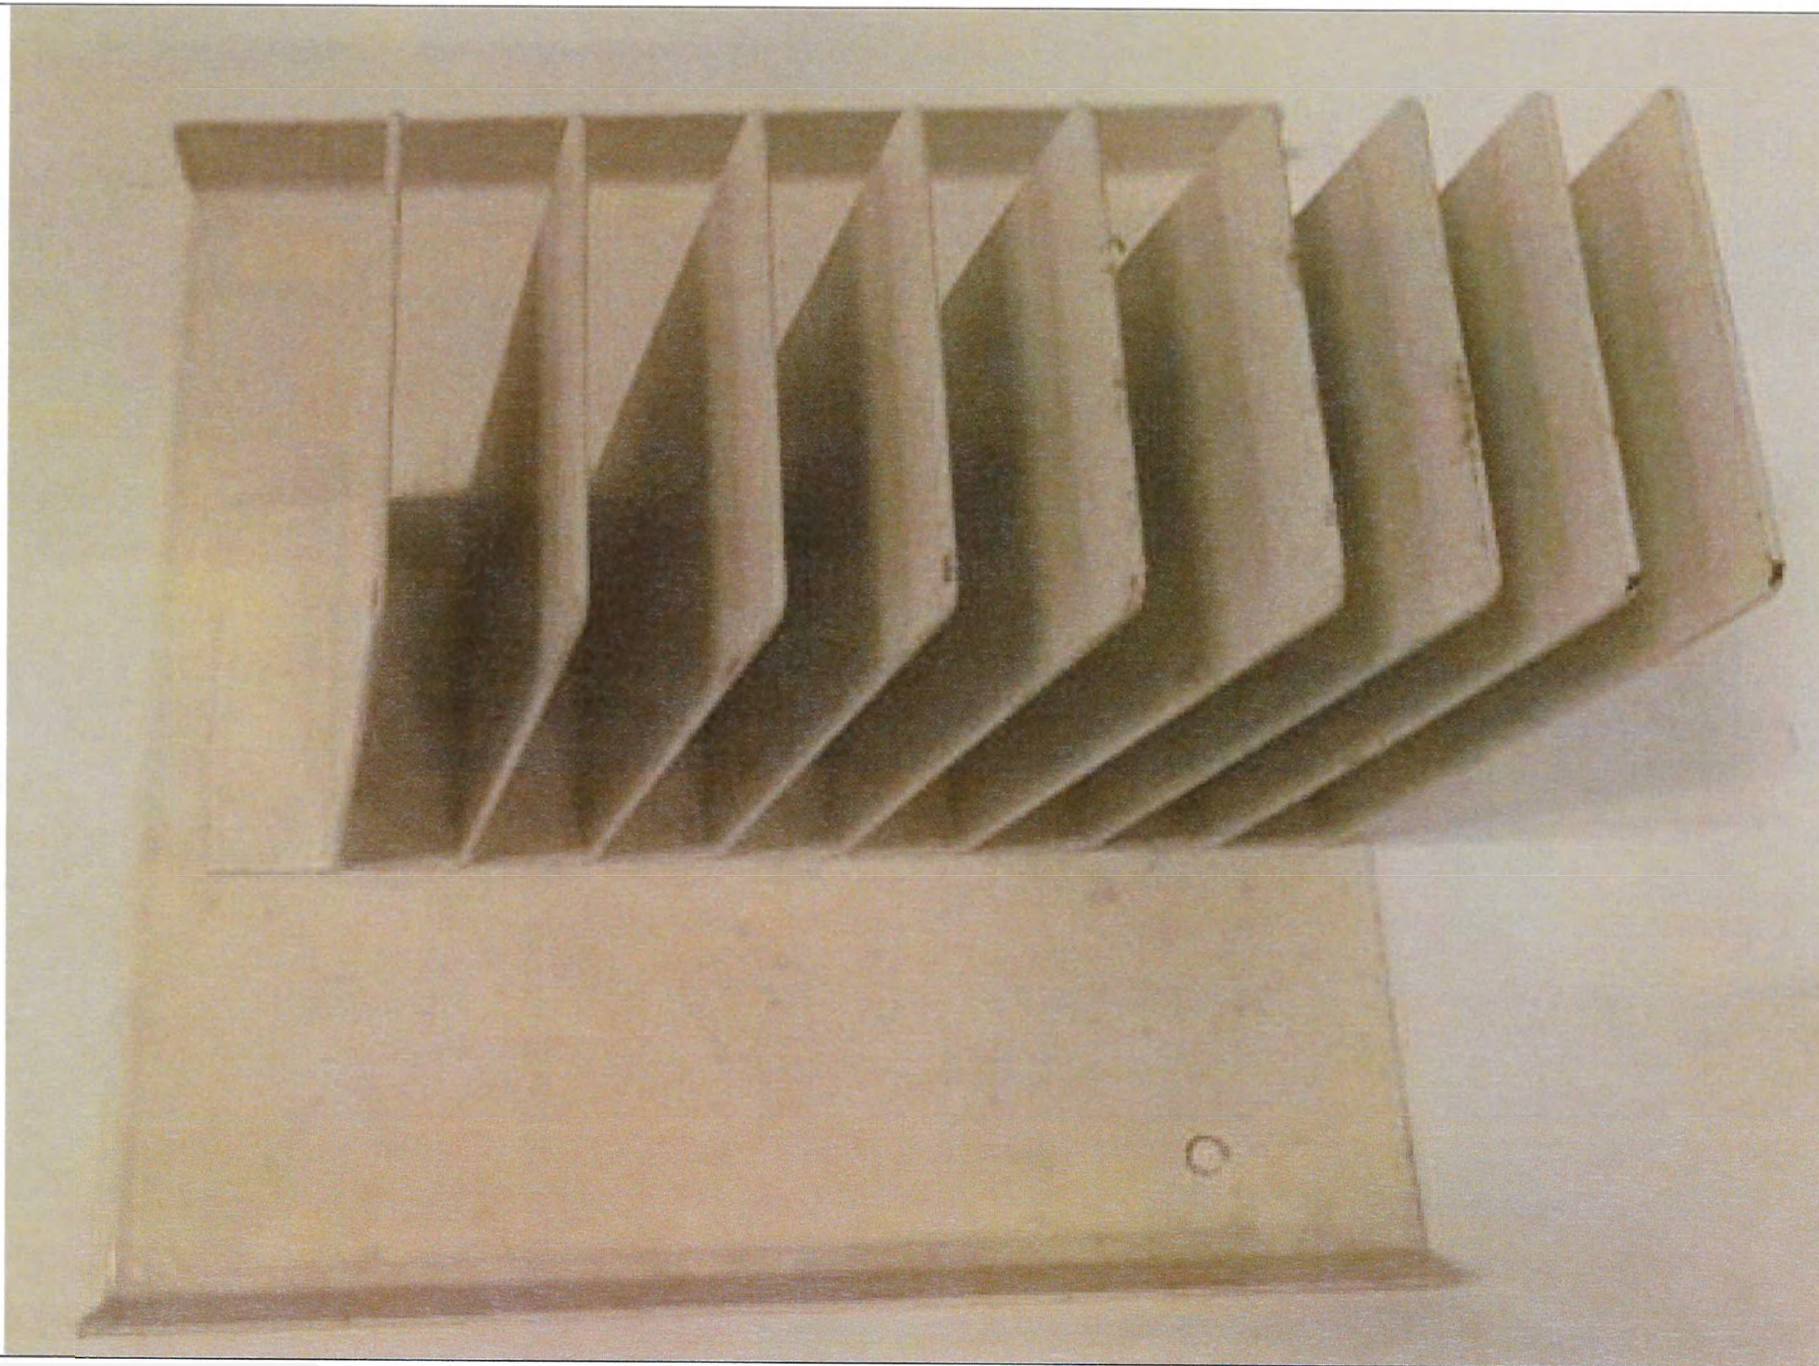


SIEMENS

BWS, lateral



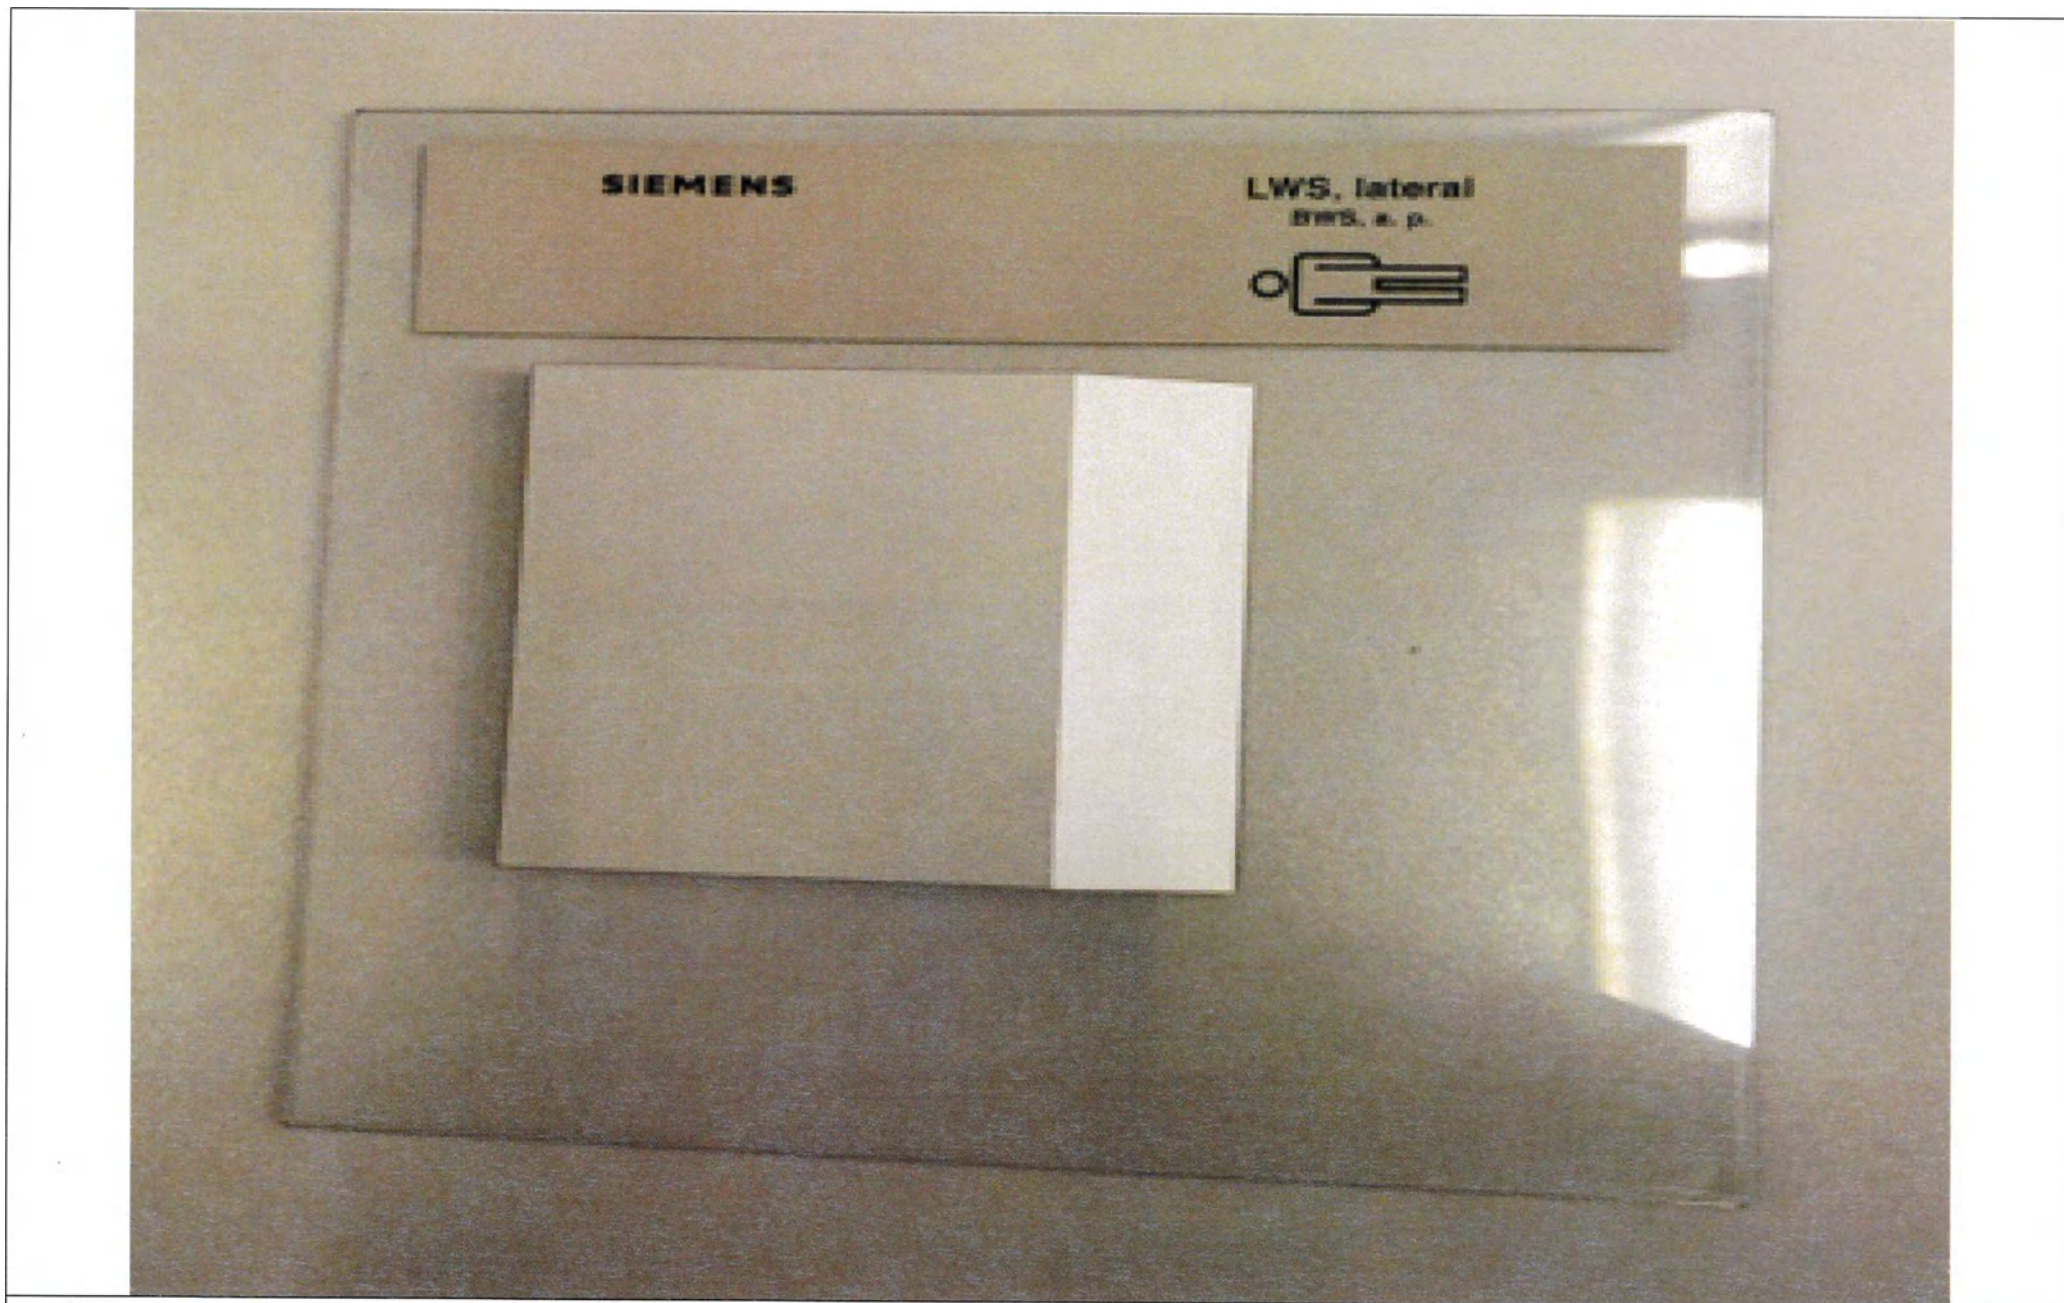

63. 2 Компенсационный фильтр, L-позвоночник.

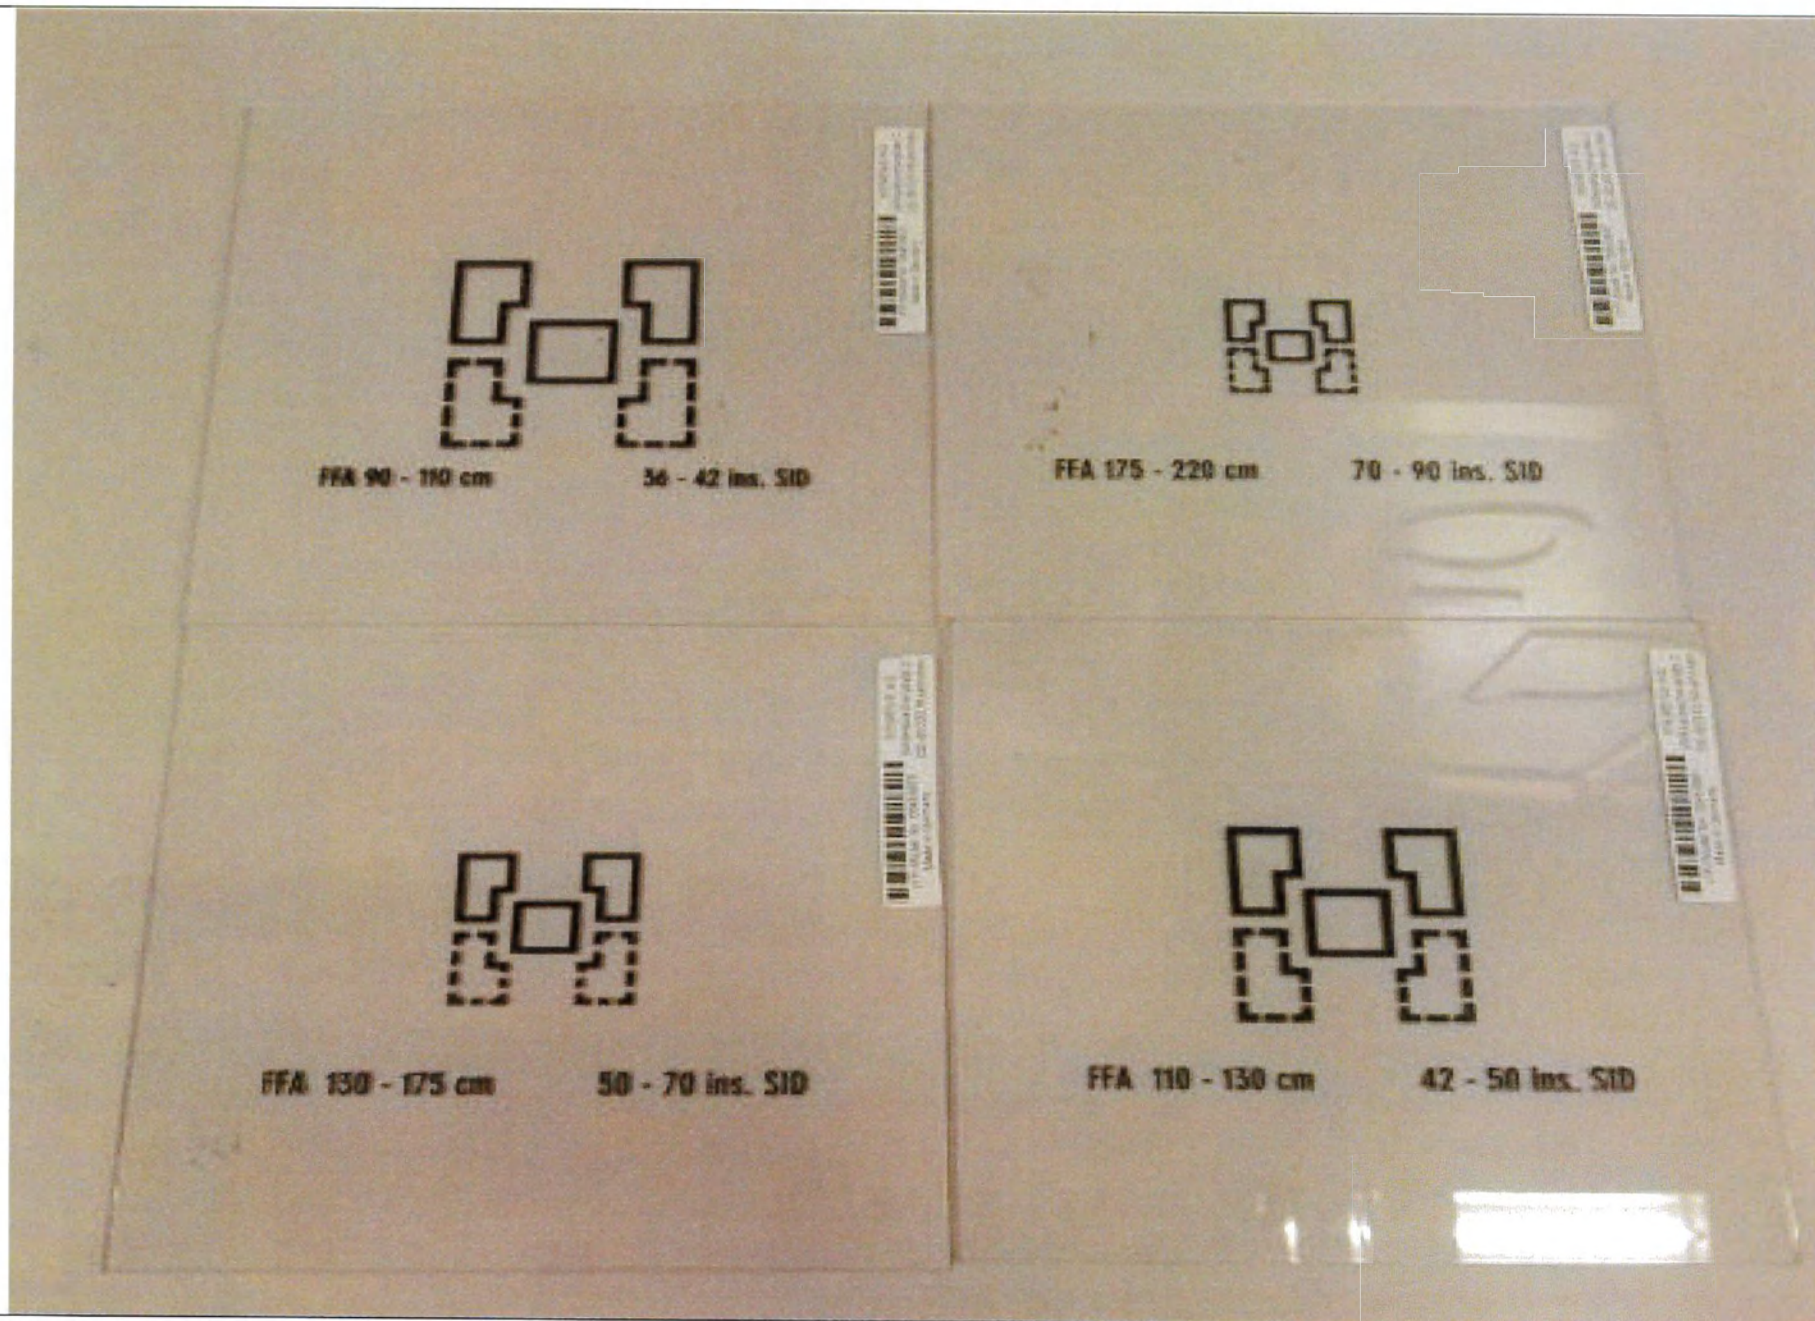

64. Трехпольные шаблоны.



65. Сумка для аксессуаров



66. Тест – комплект для контроля качества.



67. Настенное зарядное устройство.

Маркировка:

Система рентгенографическая цифровая MULTIX Impact C в исполнениях с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Официальный производитель: 278 Zhou Zhu Road, Bldg. 2, 3, 4, 5, 7, Pudong New Area, Shanghai, P.R.China

Страна производства: Китай

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

3~, 380/400/440 В

50/60 Гц

127 кВА / 1,2 кВА

3~, 480 В

60 Гц

Макет маркировки на русском языке для систем, произведенных в Китае

Система рентгенографическая цифровая MULTIX Impact C в исполнениях с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от dd.мм.гггг

Официальный производитель: 278 Zhou Zhu Road, Bldg. 2, 3, 4, 5, 7, Pudong New Area, Shanghai, P.R.China

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

3~, 380/400/440 В

50/60 Гц

127 кВА / 1,2 кВА

3~, 480 В

60 Гц

Макет маркировки на русском языке для систем, произведенных в Германии



Всего прошито и пронумеровано
99
листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

