

ООО «Примус»

192012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литер А, помещение 451П,

офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru

Согласовано

Генеральный директор ООО «ПРИМУС»

Яковлев А.Г.

Подпись

Дата 02.02.2024



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных
процедур Angiorpower

производства

Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

1. Наименование изделия

Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower

2. Производство

Производитель

ЛЕПУ МЕДИКАЛ ТЕХНОЛОДЖИ (ПЕКИН) КО., ЛТД No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200, P.R. China/ №37 Улица Чаоцянь, район Чанпин, 102200 Пекин, Китайская Народная Республика

Тел: 86 10-80120666. Факс: 86 10-80120600 Website: www.lepumedical.com

Место производства:

ЛЕПУ МЕДИКАЛ ТЕХНОЛОДЖИ (ПЕКИН) КО., ЛТД No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200, P.R. China/ №37 Улица Чаоцянь, район Чанпин, 102200 Пекин, Китайская Народная Республика

3. Варианты исполнения.

I. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower 20 мл 30 атм
Состав:

1. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower, объем 20 мл., давление 30 атм с – 1 шт.;
2. Инструкция – 1 шт.;
3. Трехходовой краник – 1 шт. (при необходимости);
4. Y-образный гемостатический клапан Push-Pull – 1 шт. (при необходимости);
5. Y-образный гемостатический клапан Push-Pull с удлинительной линией 20/или 25/или 30/или 35/или 40/или 45/или 50/или 55/или 60/или 65/или 70/или 75/или 80/или 85/или 90/или 95/или 100/или 105/или 110/или 115/или 120 см – 1 шт. (при необходимости);
6. Y-образный гемостатический клапан Rotating – 1 шт. (при необходимости);
7. Y-образный гемостатический клапан Rotating с удлинительной линией 20/или 25/или 30/или 35/или 40/или 45/или 50/или 55/или 60/или 65/или 70/или 75/или 80/или 85/или 90/или 95/или 100/или 105/или 110/или 115/или 120 см – 1 шт. (при необходимости);
8. Устройство для введения проводника – 1 шт. (при необходимости);
9. Устройство для вращения проводника – 1 шт. (при необходимости);

II. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower 20 мл 40 атм.
Состав:

1. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower, объем 20 мл., давление 40 атм с – 1 шт.;
2. Инструкция – 1 шт.;
3. Трехходовой краник – 1 шт. (при необходимости);
4. Y-образный гемостатический клапан Push-Pull – 1 шт. (при необходимости);
5. Y-образный гемостатический клапан Push-Pull с удлинительной линией 20/или 25/или 30/или 35/или 40/или 45/или 50/или 55/или 60/или 65/или 70/или 75/или 80/или 85/или 90/или 95/или 100/или 105/или 110/или 115/или 120 см – 1 шт. (при необходимости);
6. Y-образный гемостатический клапан Rotating – 1 шт. (при необходимости);
7. Y-образный гемостатический клапан Rotating с удлинительной линией 20/или 25/или 30/или 35/или

ООО «Примус»

2012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,
офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru

40/или 45/или 50/или 55/или 60/или 65/или 70/или 75/или 80/или 85/или 90/или 95/или 100/или 105/или 110/или 115/или 120 см – 1 шт. (при необходимости);

8. Устройство для введения проводника – 1 шт. (при необходимости);

9. Устройство для вращения проводника – 1 шт. (при необходимости);

III. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower 28 мл 30 атм.

Состав:

1. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower, объем 28 мл., давление 30 атм с – 1 шт.;

2. Инструкция – 1 шт.;

3. Трехходовой краник – 1 шт. (при необходимости);

4. Y-образный гемостатический клапан Push-Pull – 1 шт. (при необходимости);

5. Y-образный гемостатический клапан Push-Pull с удлинительной линией 20/или 25/или 30/или 35/или 40/или 45/или 50/или 55/или 60/или 65/или 70/ или 75/или 80/или 85/или 90/или 95/или 100/или 105/или 110/или 115/или 120 см – 1 шт. (при необходимости);

6. Y-образный гемостатический клапан Rotating– 1 шт. (при необходимости);

7. Y-образный гемостатический клапан Rotating с удлинительной линией 20/или 25/или 30/или 35/или 40/или 45/или 50/или 55/или 60/или 65/или 70/или 75/или 80/или 85/или 90/или 95/или 100/или 105/или 110/или 115/или 120 см – 1 шт. (при необходимости);

8. Устройство для введения проводника – 1 шт. (при необходимости);

9. Устройство для вращения проводника – 1 шт. (при необходимости);

ООО «Примус»

2012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,
офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 1. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiropower 20 мл 30 атм общий вид в упаковке.



Фото 2. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiropower 20 мл 30 атм общий вид в упаковке с маркировкой.

ООО «Примус»

2012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,
офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 3. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angioper 20 мл 30 атм общий вид.



Фото 4. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angioper 20 мл 40 атм общий вид в упаковке.

ООО «Примус»

2012, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,

офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 5. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower 20 мл 40 атм общий вид в упаковке с маркировкой.



Фото 6. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower 20 мл 40 атм общий вид.



Фото 7. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiower 28 мл 30 атм общий вид в упаковке.



Фото 8. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiower 28 мл 30 атм общий вид в упаковке с маркировкой.

ООО «Примус»

12. г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,
офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 9. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower 28 мл 30 атм общий вид.

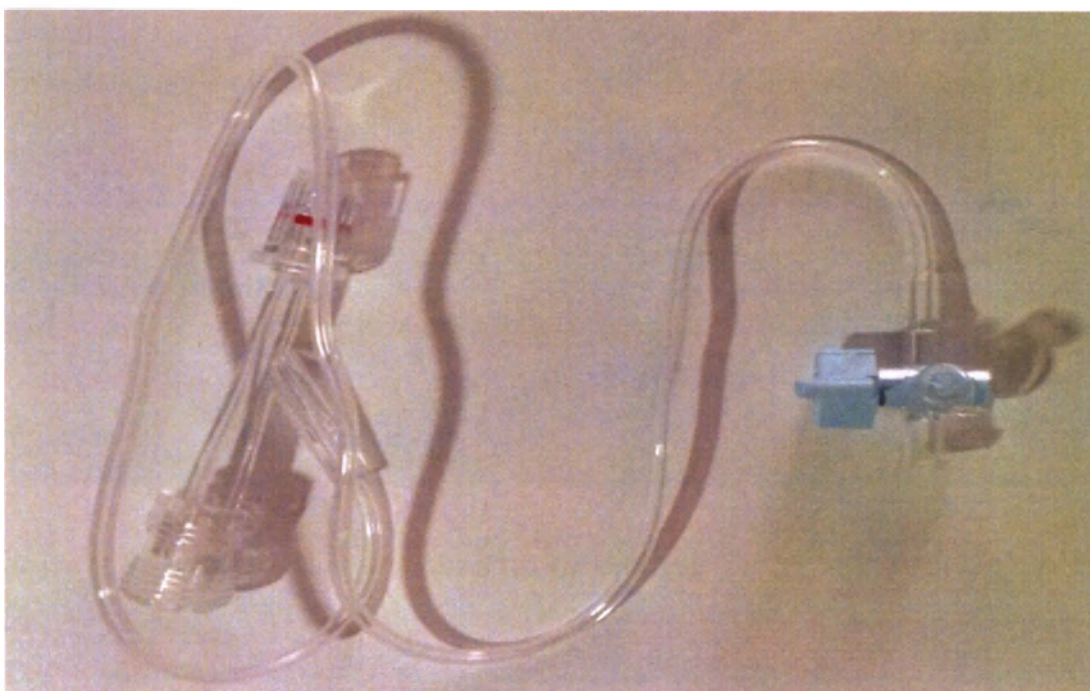


Фото 10. Y-образный гемостатический клапан с удлинительной линией и трехходовым краником

ООО «Примус»

2012 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,
офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru

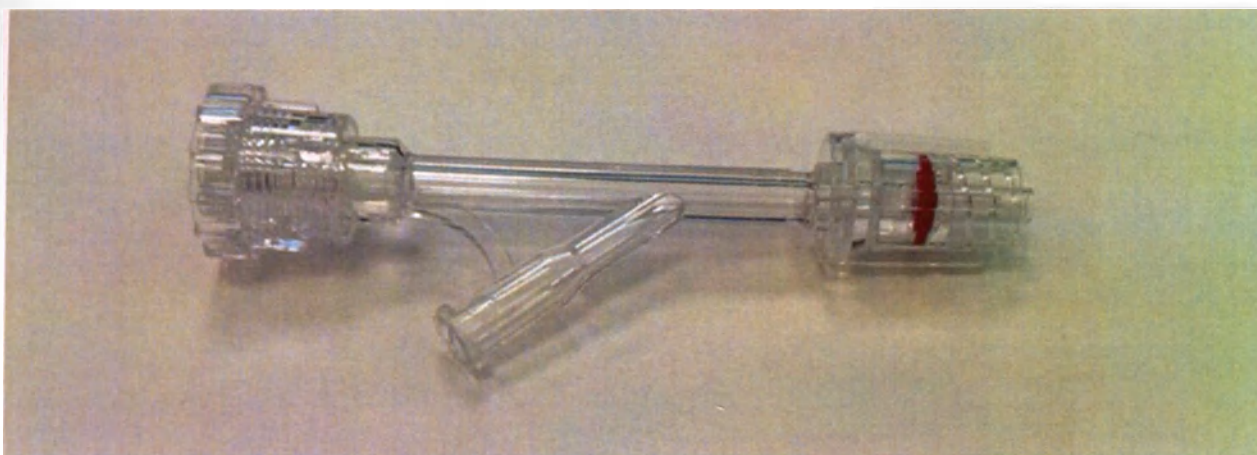


Фото 11. Y-образный гемостатический клапан Rotating

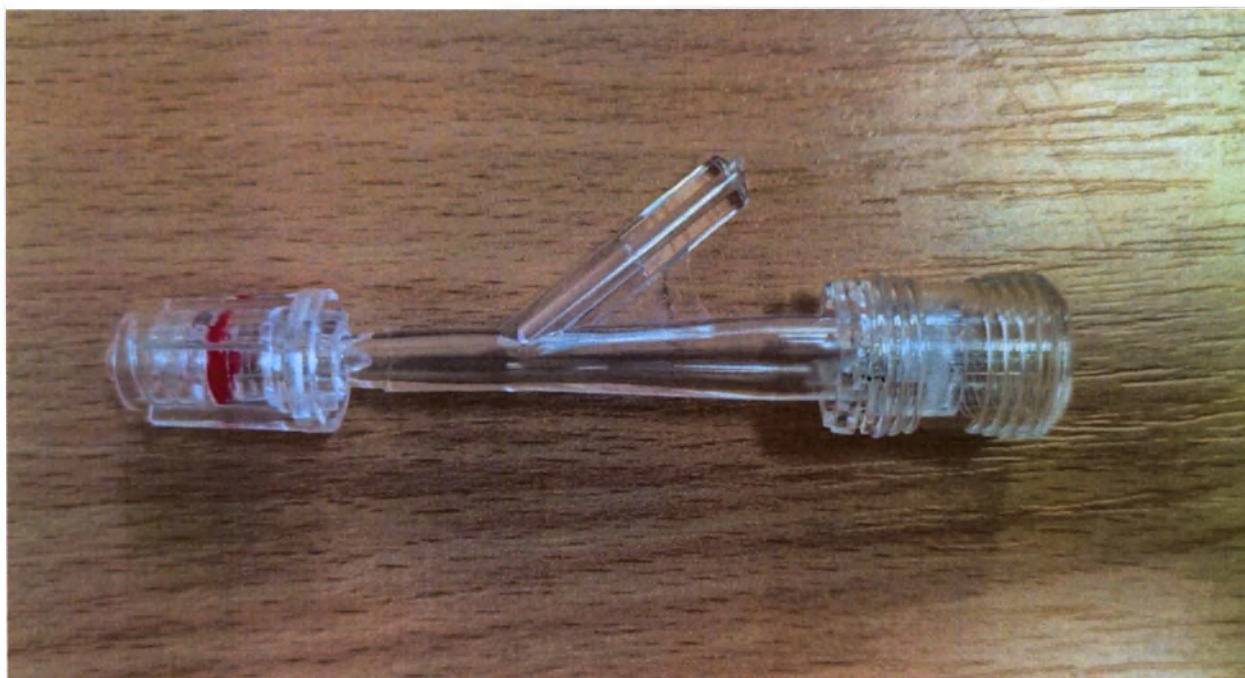


Фото 12 Y-образный гемостатический клапан Push-Pull

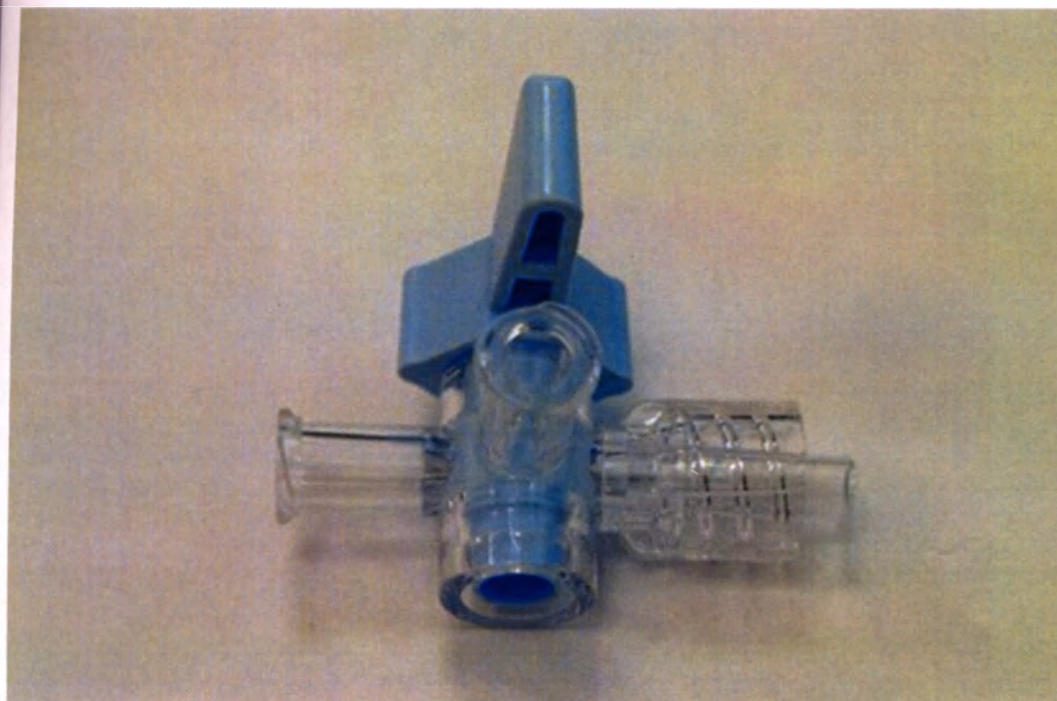


Фото 13 Трехходовой краник

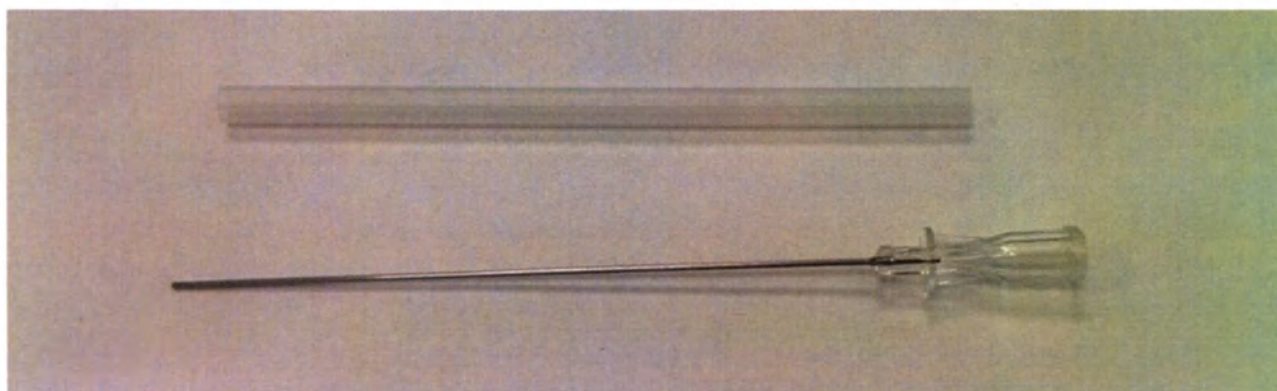


Фото 14 Устройство для введения проводника

ООО «Примус»

12, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,

офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 15 Устройство для вращения проводника

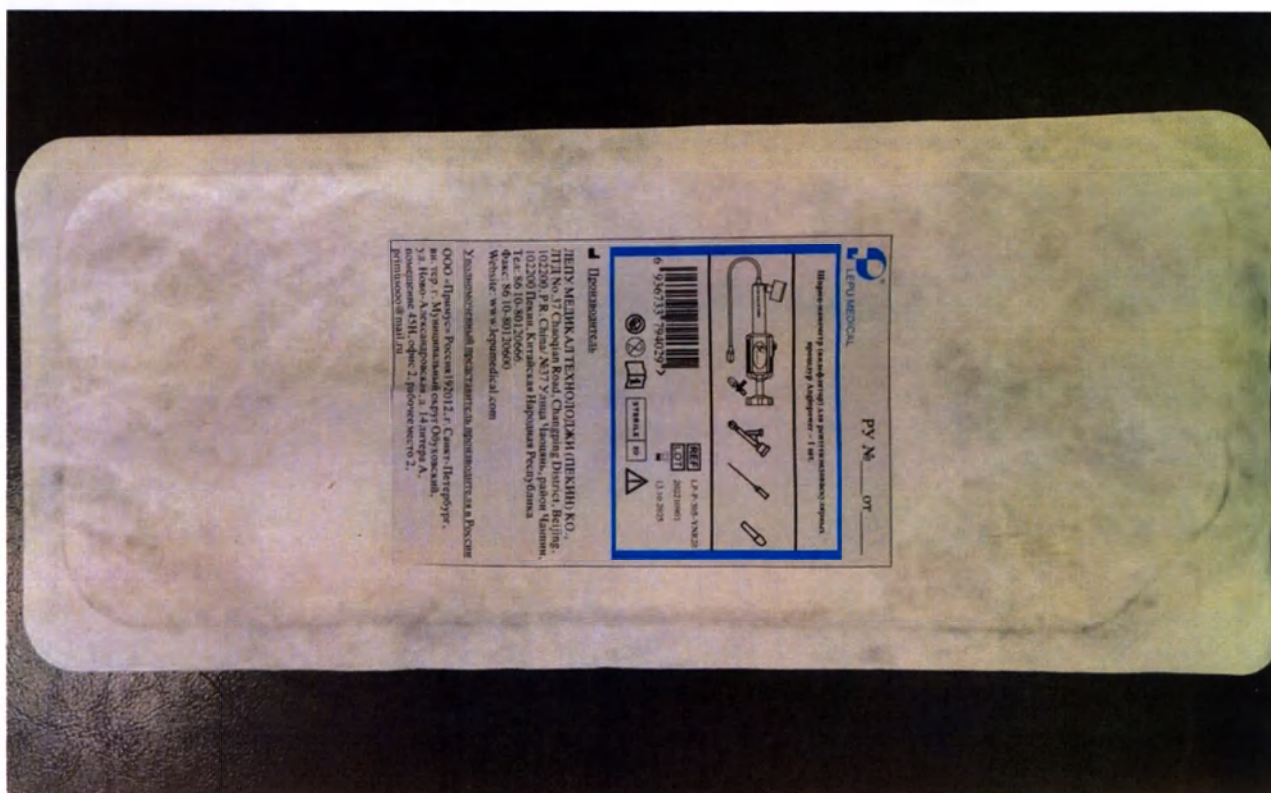


Фото 16. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiogram 20 мл 30 атм – общий вид индивидуальной упаковки с маркировкой, согласованной для РФ.

ООО «Примус»

г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,

офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 17. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angioprover 20 мл 30 атм – маркировка индивидуальной упаковки, согласованная для РФ.

ООО «Примус»

12. г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,
офис 2, рабочее место 2.
Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 18. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiower 20 мл 30 атм – общий вид средней упаковки с маркировкой, согласованной для РФ.

ООО «Примус»


12, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,
офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru

 **ЛЕПУ МЕДИКАЛ**


РУ № _____ ОТ _____

Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower – 5 шт.

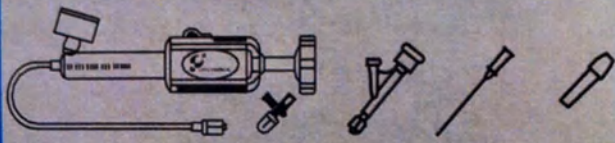

 6 936733 794029 >

REF	LP-P-30S-YNR20
LOT	202210901
	13.10.2025

 **STERILE** **EO** 

Производитель

ЛЕПУ МЕДИКАЛ ТЕХНОЛОДЖИ (ПЕКИН) КО.,
ЛТД No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing,
102200, P.R. China/ №37 Улица Чаоцянь, район Чанпин,
102200 Пекин, Китайская Народная Республика
Тел: 86 10-80120666.
Факс: 86 10-80120600
Website: www.lepumedical.com

Уполномоченный представитель производителя в России

ООО «Примус» Россия 192012, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский,
ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А,
помещение 45Н, офис 2, рабочее место 2,
primusooo@mail.ru

Фото 19. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopower 20 мл 30 атм – маркировка средней упаковки, согласованной для РФ.

ООО «Примус»

12, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,
офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru



Фото 20. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiopotter 20 мл 30 атм – общий вид транспортной упаковки с маркировкой, согласованной для РФ.

ООО «Примус»


г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н,
офис 2, рабочее место 2.

Тел. +7 902 330 94 77 ИНН 7811754121 КПП 781101001 ОГРН 1207800173591 e-mail: primusooo@mail.ru

РУ № _____ ОТ _____

 **LEPU MEDICAL**

Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiower – 20 шт.

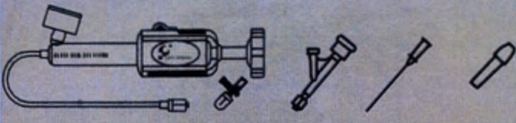

6 936733 794029 >

REF	LP-P-30S-YNR20
LOT	202210901
	13.10.2025

STERILE EO

Производитель

ЛЕПУ МЕДИКАЛ ТЕХНОЛОДЖИ (ПЕКИН) КО.,
ЛТД No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing,
102200, P.R. China/ №37 Улица Чаоцянь, район Чанпин,
102200 Пекин, Китайская Народная Республика
Тел: 86 10-80120666.
Факс: 86 10-80120600
Website: www.lepumedical.com

Уполномоченный представитель производителя в России

ООО «Примус» Россия 192012, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. Муниципальный округ Обуховский,
ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А,
помещение 45Н, офис 2, рабочее место 2,
primusooo@mail.ru

Фото 21. Шприц-манометр (индефлятор) для рентгенэндоваскулярных процедур Angiower 20 мл 30 атм – маркировка транспортной упаковки, согласованной для РФ.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 16 листов
Подпись _____

