

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




 Хусаинов М.Д.


«21» октября 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ
КЛАССА М К ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
(ВектоЦМВ-IgM)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)»
(ВектоЦМВ-IgM)
 (серия 1)

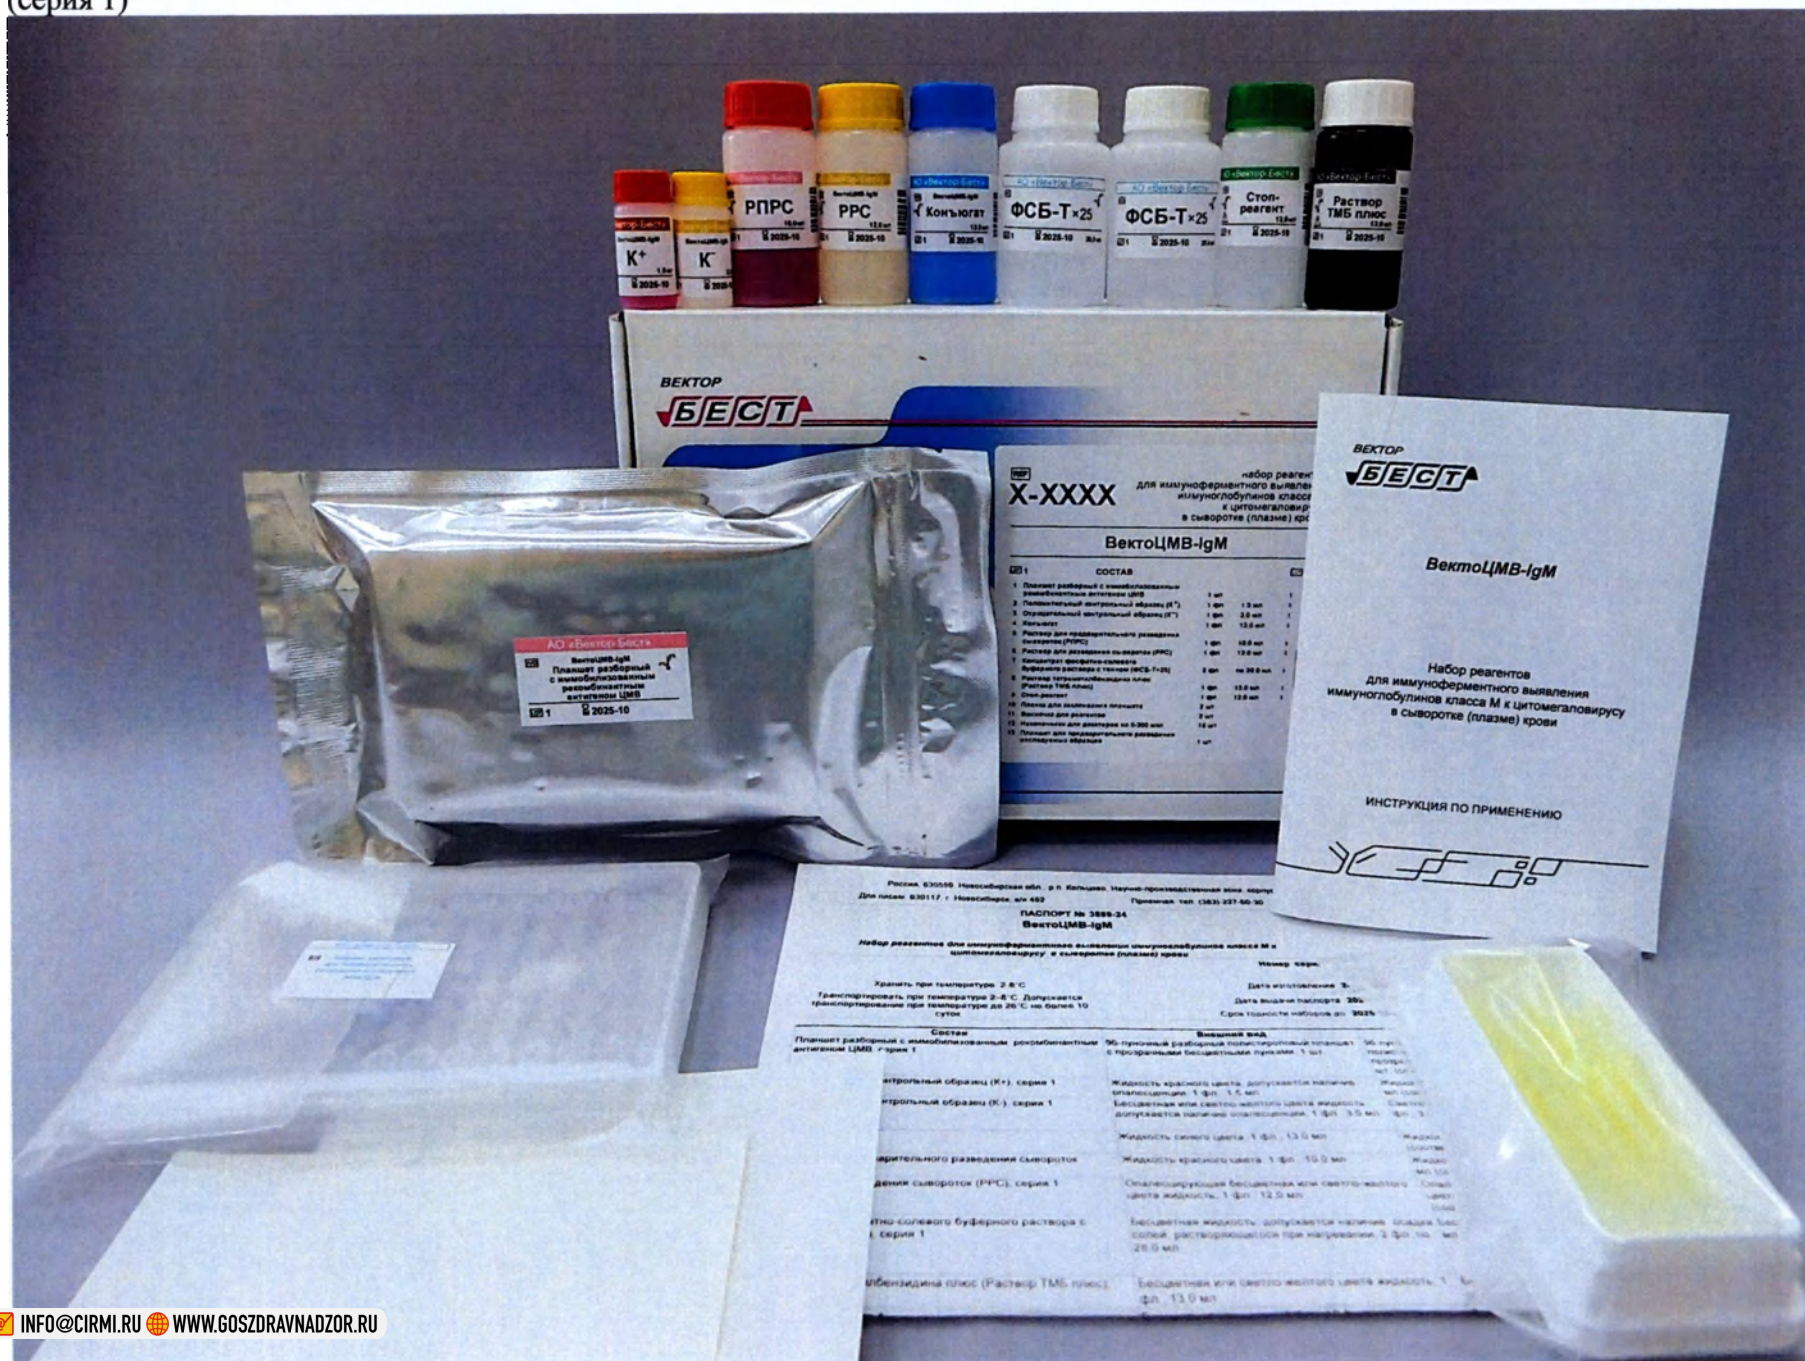

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)
(ВектоЦМВ-IgM)» №1
(серия 1)

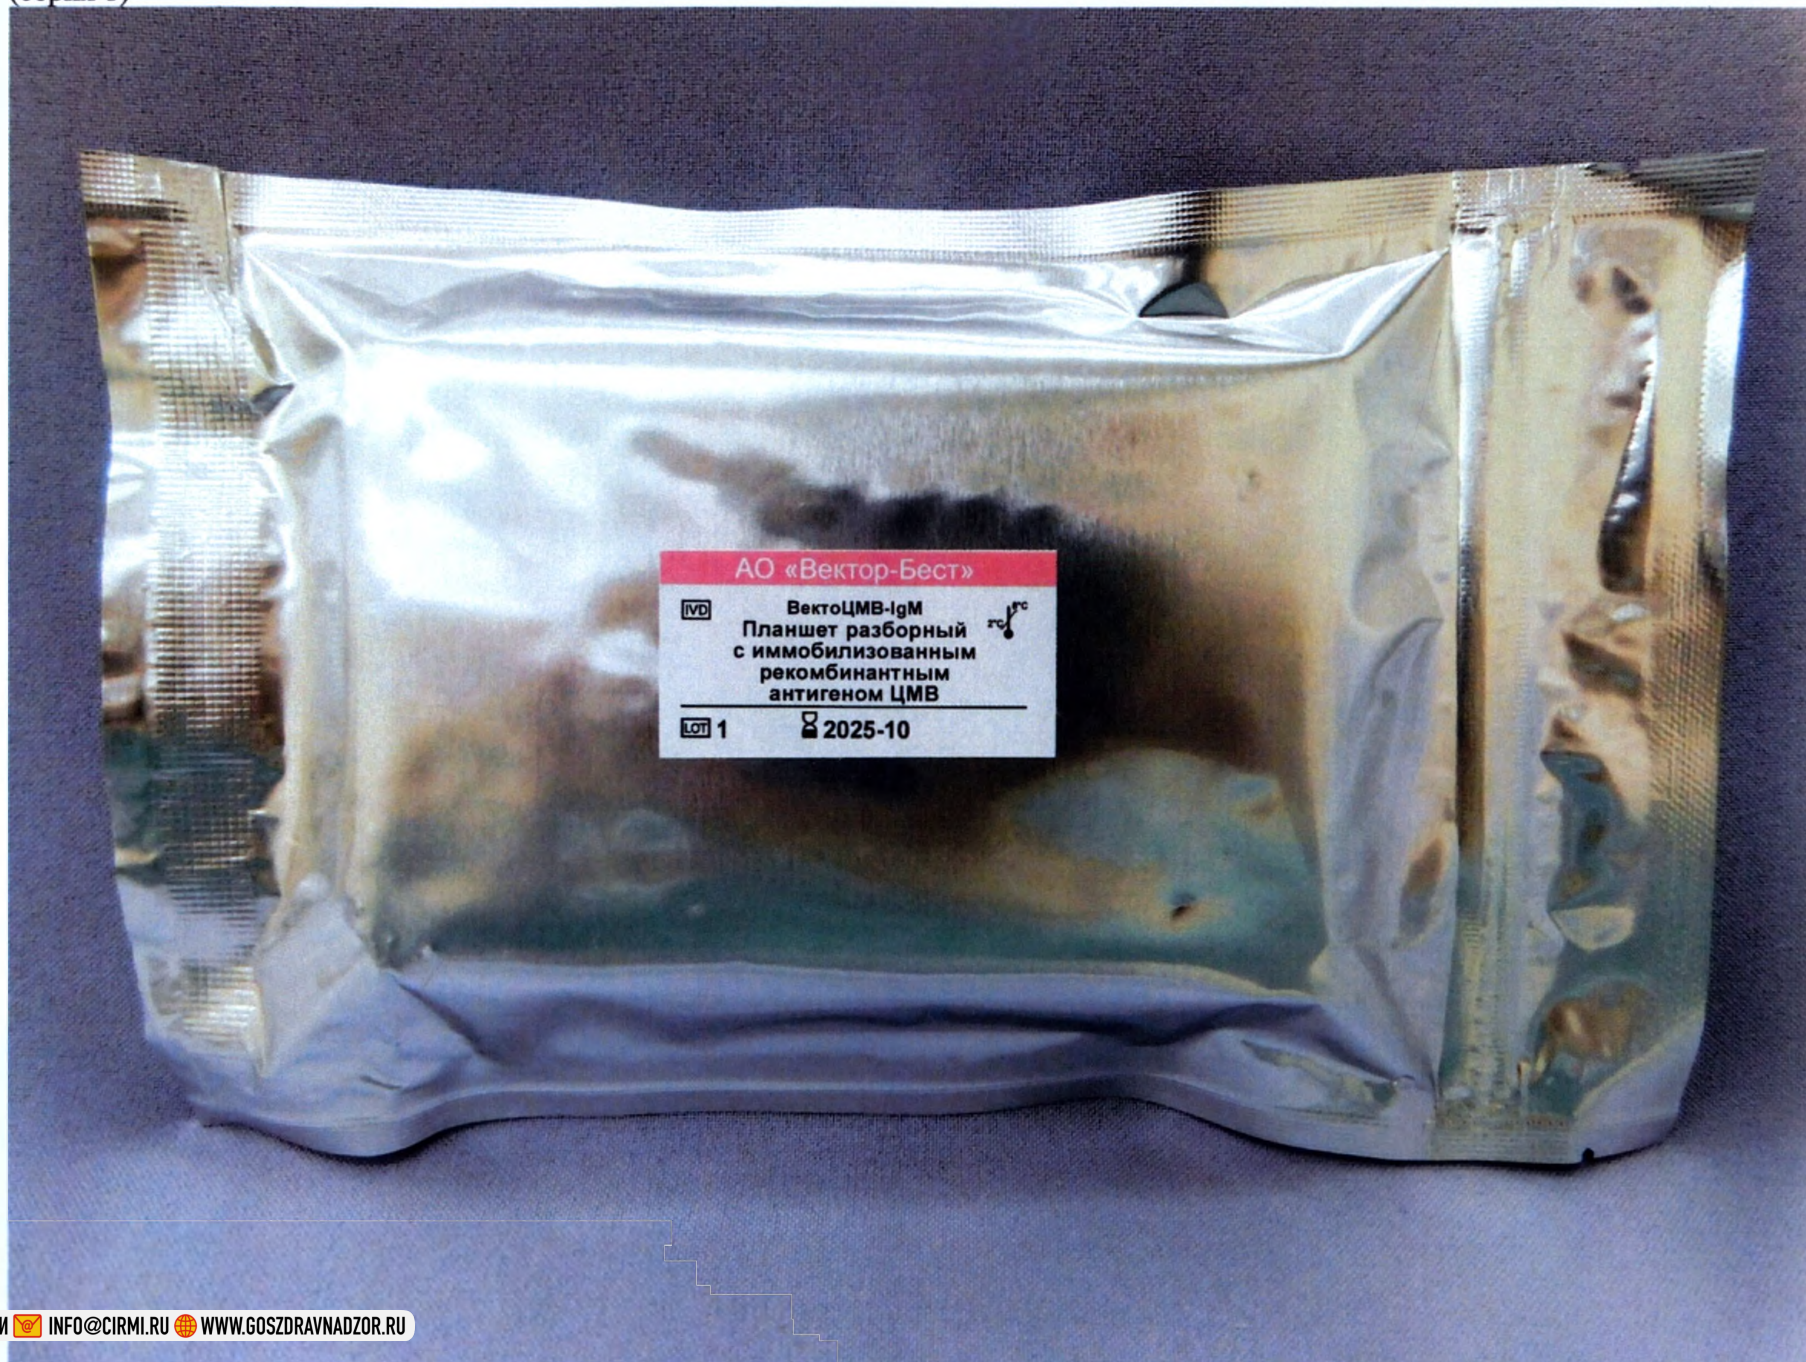

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)
(ВектоЦМВ-IgM)» №2

(серия 1)





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)
(ВектоЦМВ-IgM)» №3
(серия 1)





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)
(ВектоЦМВ-IgM)» №4
(серия 1)






Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)
(ВектоЦМВ-IgM)» №5
(серия 1)




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)
(ВектоЦМВ-IgM)» №6
(серия 1)

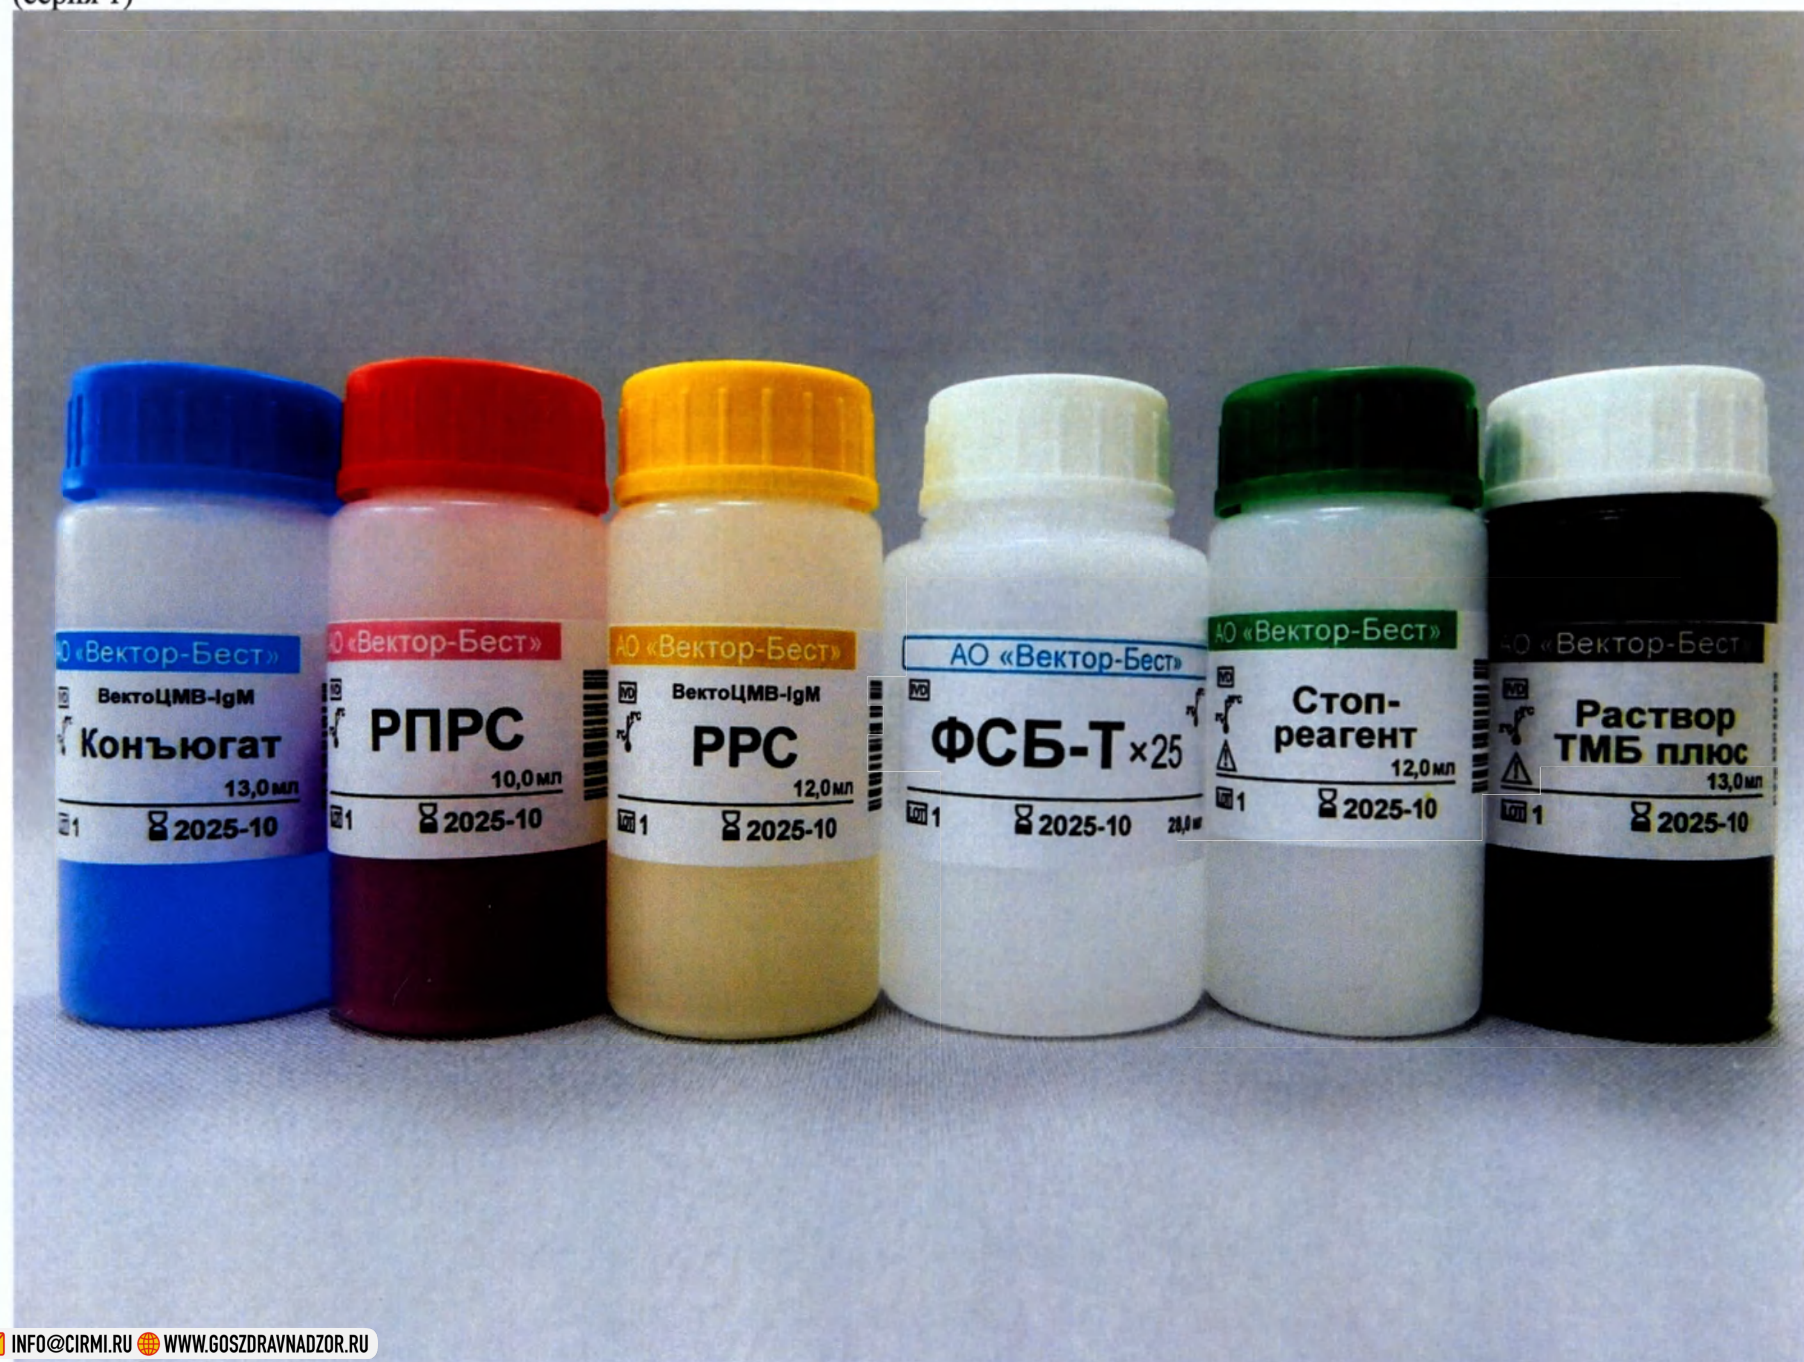

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)
(ВектоЦМВ-IgM)» №7
(серия 1)




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)
(ВектоЦМВ-IgM)» №8
(серия 1)

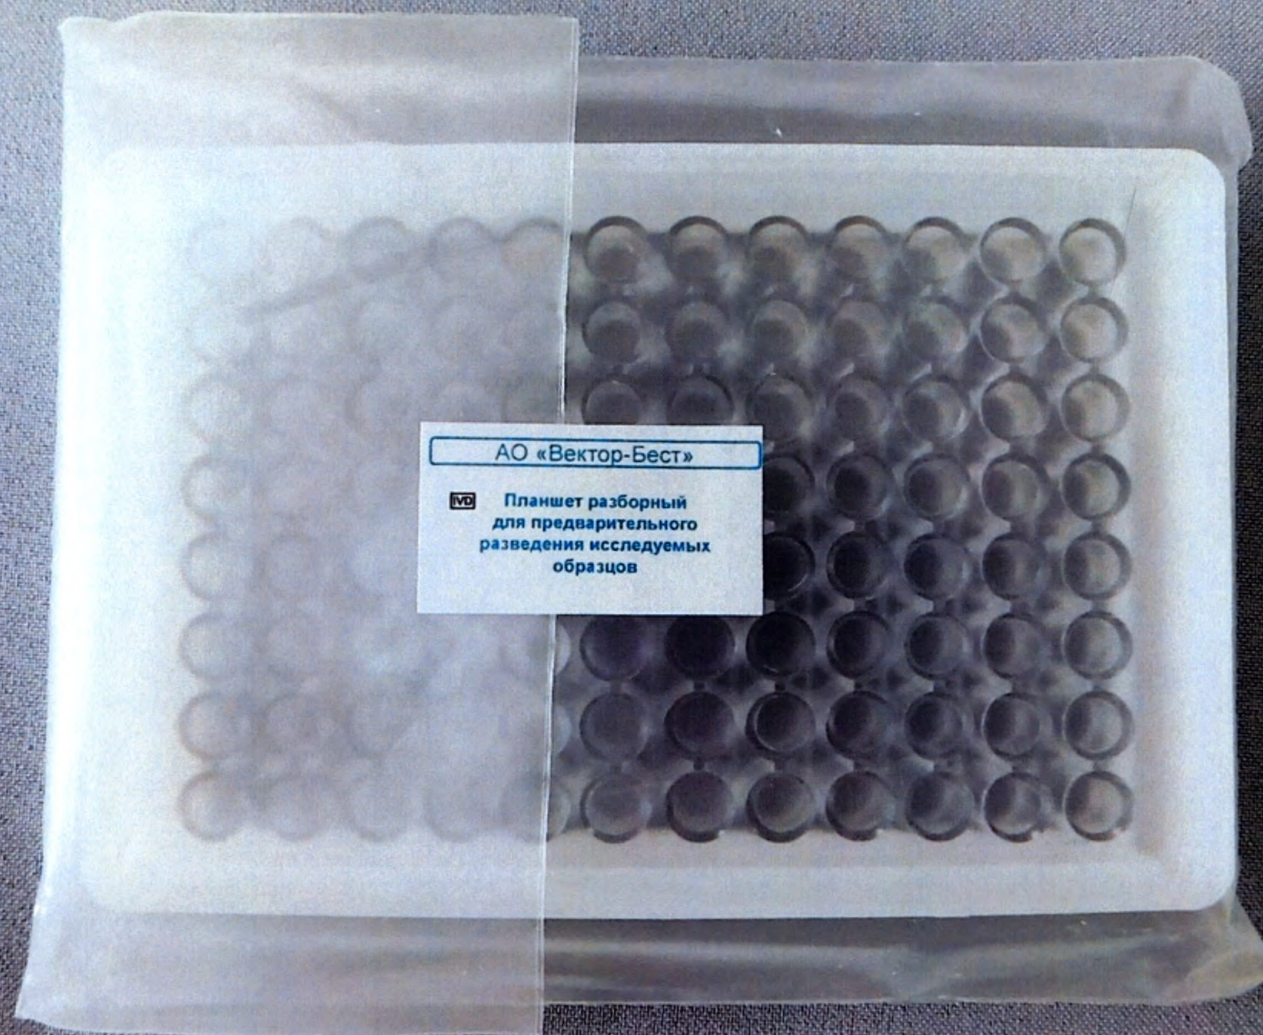




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)
(ВектоЦМВ-IgM)» №9
(серия 1)

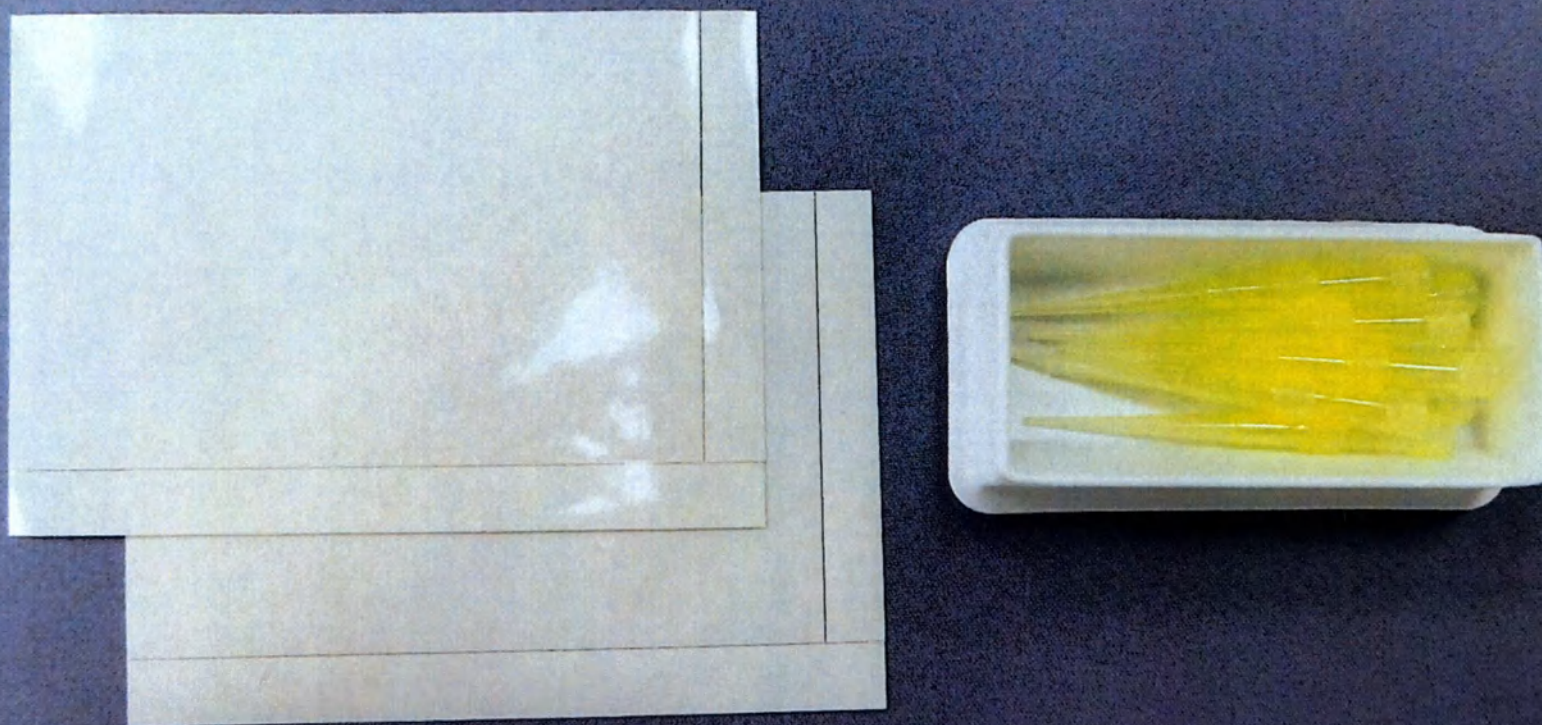

ВЕКТОР

БЕСТ

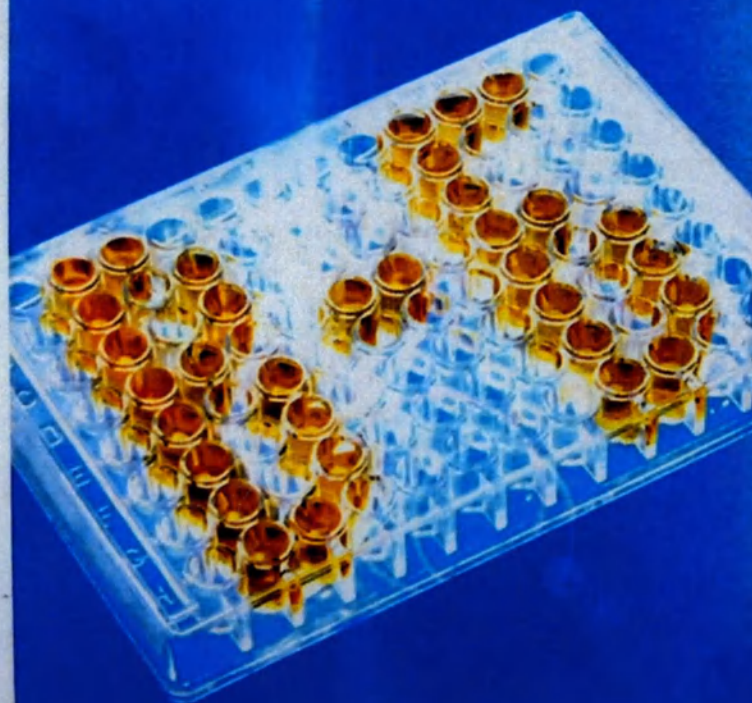

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к цитомегаловирусу
в сыворотке (плазме) крови

ВектоЦМВ-IgM

LOT 1

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном ЦМВ	1 шт	1
2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл 1,5 мл	1
3. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл 3,0 мл	1
4. Конъюгат	1 фл 13,0 мл	1
5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)	1 фл 10,0 мл	1
6. Раствор для разведения сывороток (РРС)	1 фл 12,0 мл	1
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	2 фл по 28,0 мл	1
8. Раствор тетраметилбензидина плюс (Раствор ТМБ плюс)	1 фл 13,0 мл	1
9. Стоп-реагент	1 фл 12,0 мл	1
10. Пленка для заклеивания планшета	2 шт	
11. Ванночка для реагентов	2 шт	
12. Наконечники для дозаторов на 5-200 мкл	16 шт	
13. Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)
(ВектоЦМВ-IgM)» №2
(серия 1)



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме)
(ВектоЦМВ-IgM)» №3

(серия 1)



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 14 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго Масяго А.В.
«11» 11 2024 г.