



Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
(ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»


Б.С. Хышиктуев

2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Система инъекционная для магнитно-резонансной томографии
SinoMRI-BP**

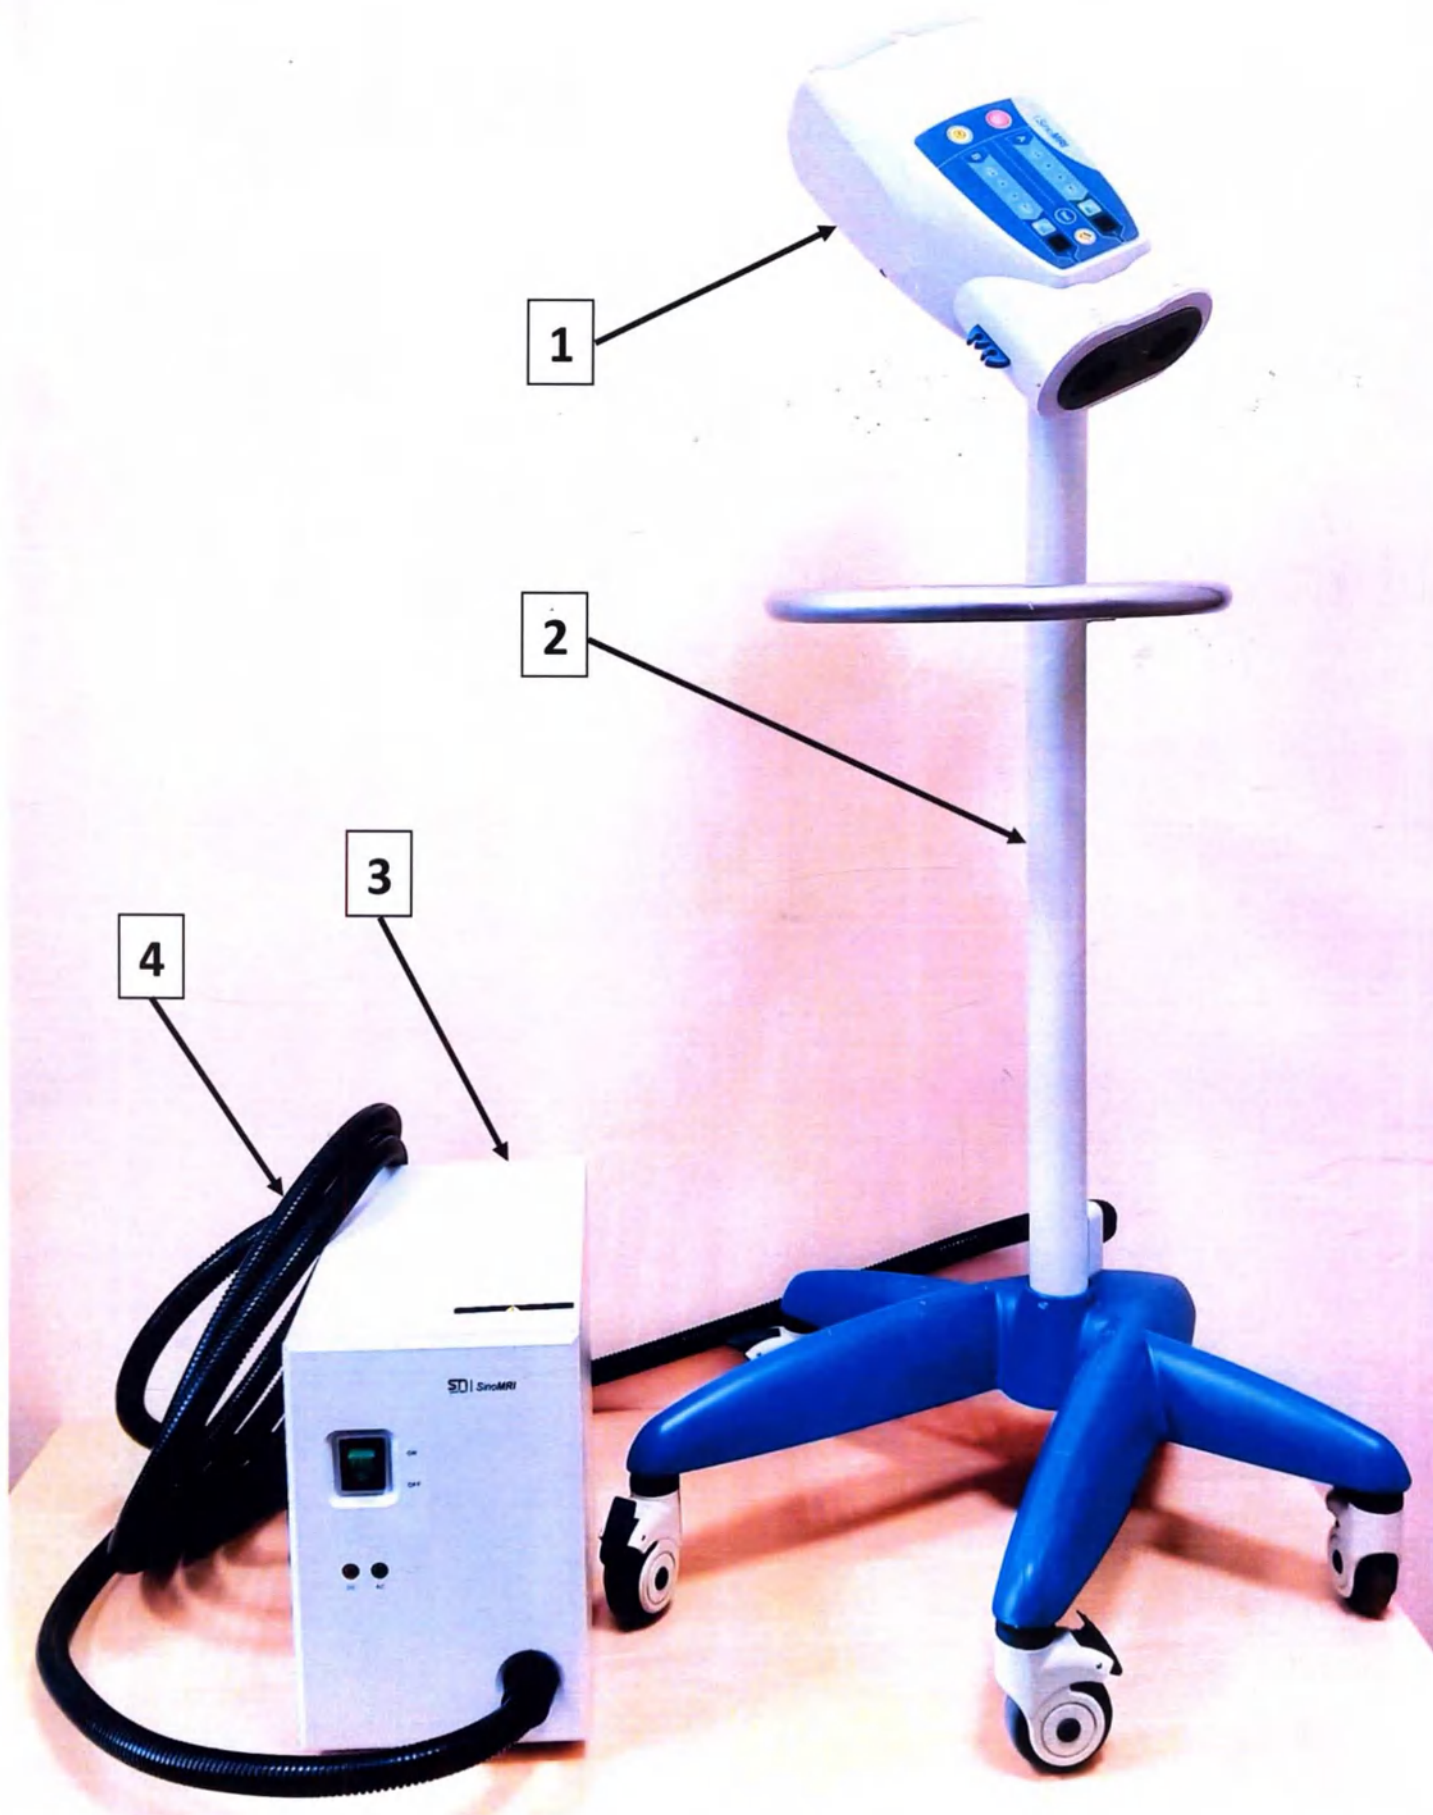

Фотографическое изображение основного блока системы инъекционной для магнитно-резонансной томографии SinoMRI-BP в составе: инъекционная головка (1), блок управления (3), соединительный кабель (4), мобильная стойка (2).



Фотографическое изображение блока управления (вид сзади).

1




2




Фотографическое изображение панели управления (1) и информационного стикера (2) на задней стороне панели управления.

1

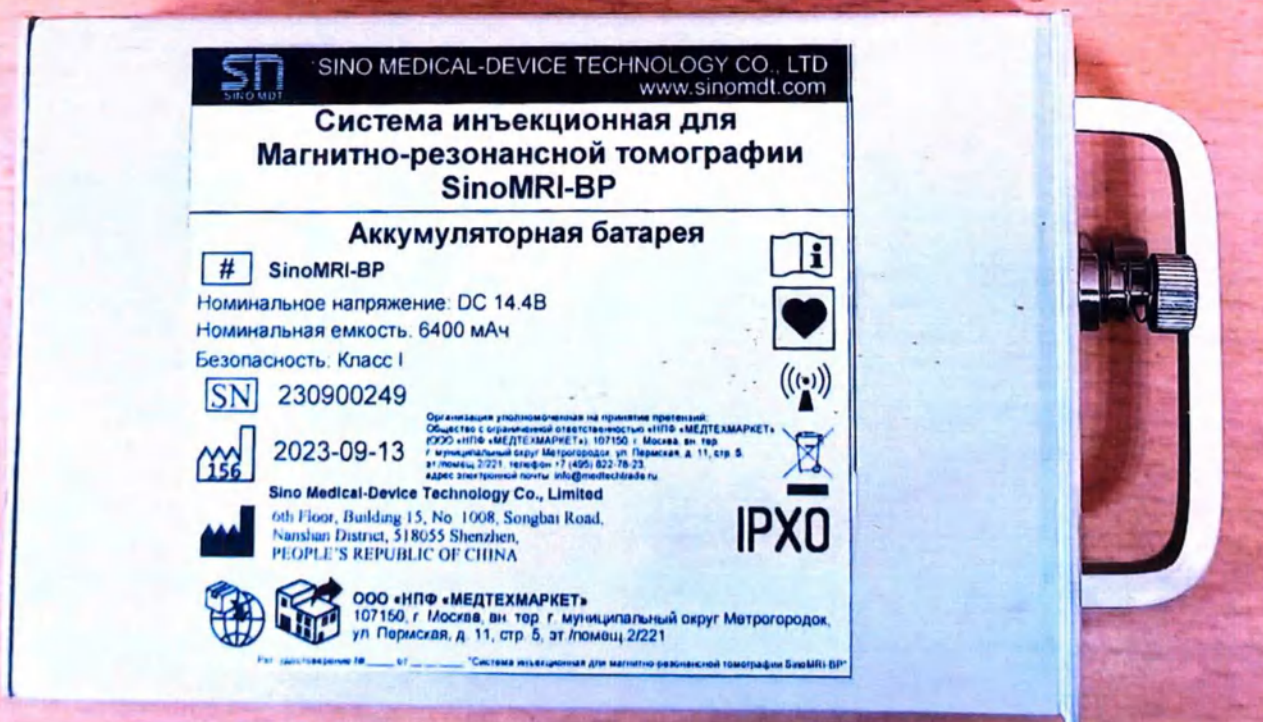

2

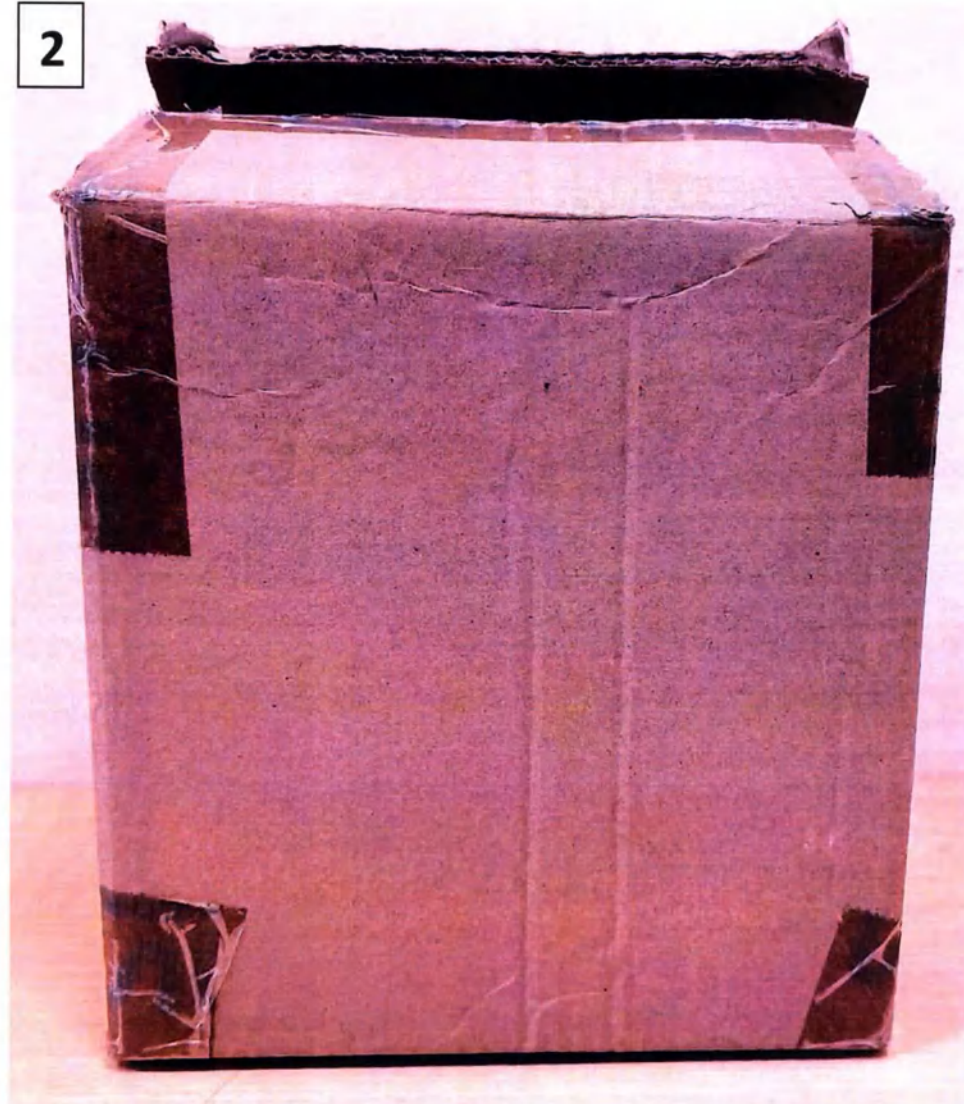

Фотографическое изображение аккумуляторной батареи (1) и упаковки (2) для нее.

1

2

3



 SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD www.sinomdt.com	
Система инъекционная для Магнитно-резонансной томографии SinoMRI-BP	
#	SinoMRI-BP
LOT	23091338
156	2023-09-13
Организация уполномоченная на принятие претензий: Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ» (ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»), 107150, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ. 2/221, телефон +7 (495) 822-78-23, адрес электронной почты: info@medtechtrade.ru	
Sino Medical-Device Technology Co., Limited 6th Floor, Building 15, No. 1008, Songbai Road, Nanshan District, 518055 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
	ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ» 107150, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ. 2/221
Рег. удостоверение № _____ от _____ Система инъекционная для магнитно-резонансной томографии SinoMRI-BP	

Фотографическое изображение лотка (1) и его упаковки (2) с информационным стикером.

1



2



SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD
www.sinomdt.com

Система инъекционная для Магнитно-резонансной томографии SinoMRI-BP

Кабель оптический

SinoMRI-BP

LOT 23091326 156 2023-09-13

Организация уполномоченная на принятие претензий:
Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
(ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»), 107150, г. Москва, вн. тер.
г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ. 2/221,
телефон +7 (495) 822-78-23, адрес электронной почты: info@medtechtrade.ru

Sino Medical-Device Technology Co., Limited



6th Floor, Building 15, No. 1008, Songbai Road, Nanshan District,
518055 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
107150, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ. 2/221


Рег. удостоверение № _____ от _____ "Система инъекционная для магнитно-резонансной томографии SinoMRI-BP"

Фотографическое изображение кабеля оптического (1) и его информационного стикера (2).



Фотографическое изображение кабеля оптического в упаковке.

1

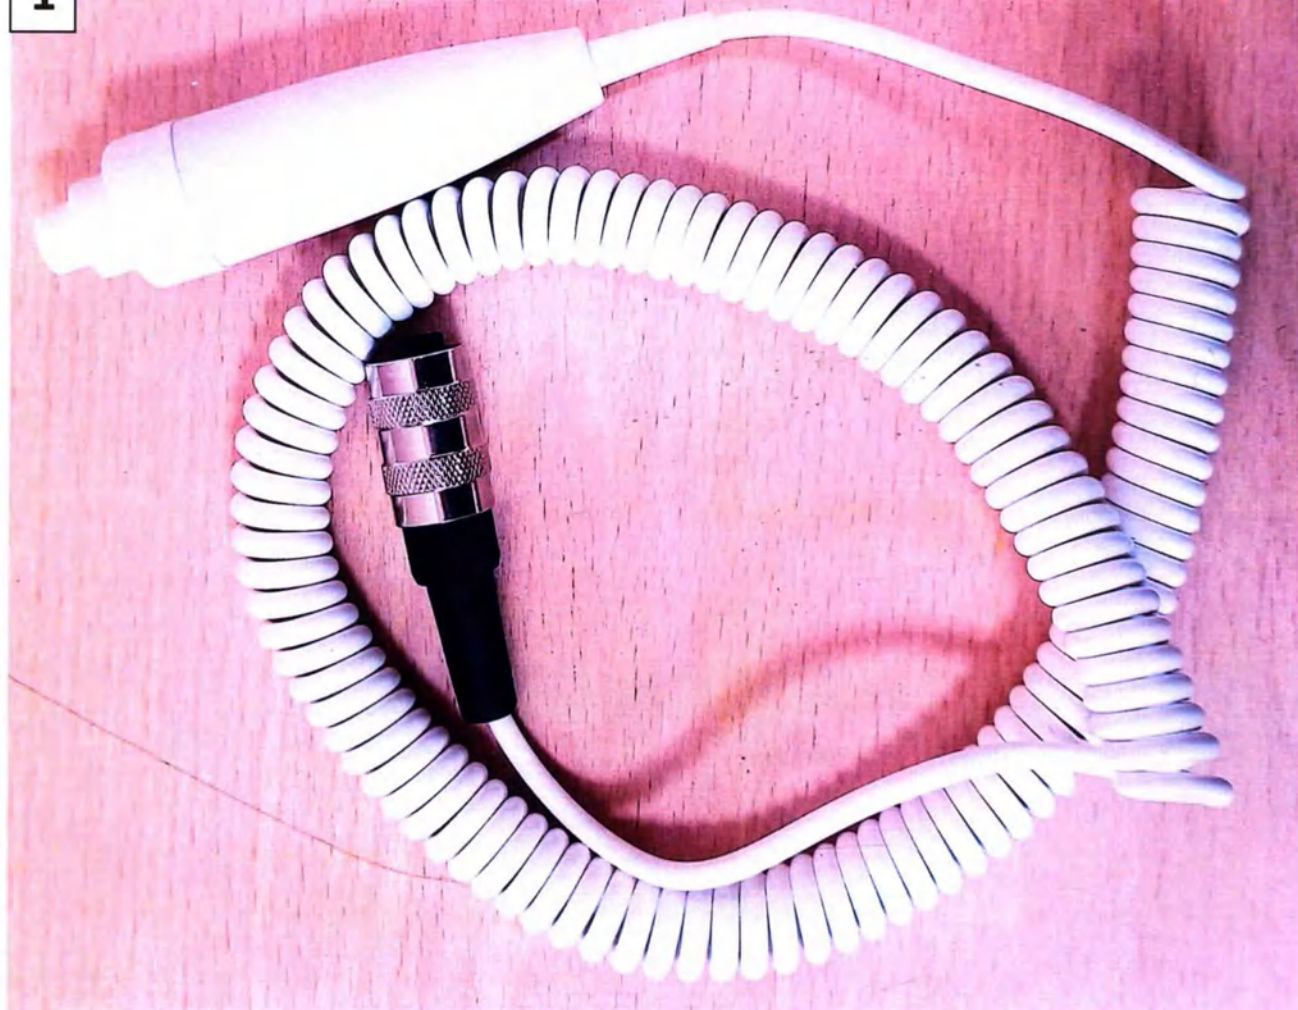

2



SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD
www.sinomdt.com

Система инъекционная для Магнитно-резонансной томографии SinoMRI-BP

Ручной переключатель



SinoMRI-BP



23091326



2023-09-13

Организация уполномоченная на принятие претензий:
Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
(ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»), 107150, г. Москва, вн. тер.
г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ.2/221,
телефон +7 (495) 822-78-23, адрес электронной почты: info@medtechtrade.ru.

Sino Medical-Device Technology Co., Limited




6th Floor, Building 15, No. 1008, Songbai Road, Nanshan District,
518055 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
107150, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ.2/221

Рег. удостоверение № _____ от _____ "Система инъекционная для магнитно-резонансной томографии SinoMRI-BP"

Фотографическое изображение ручного переключателя (1) и его информационного стикера (2).

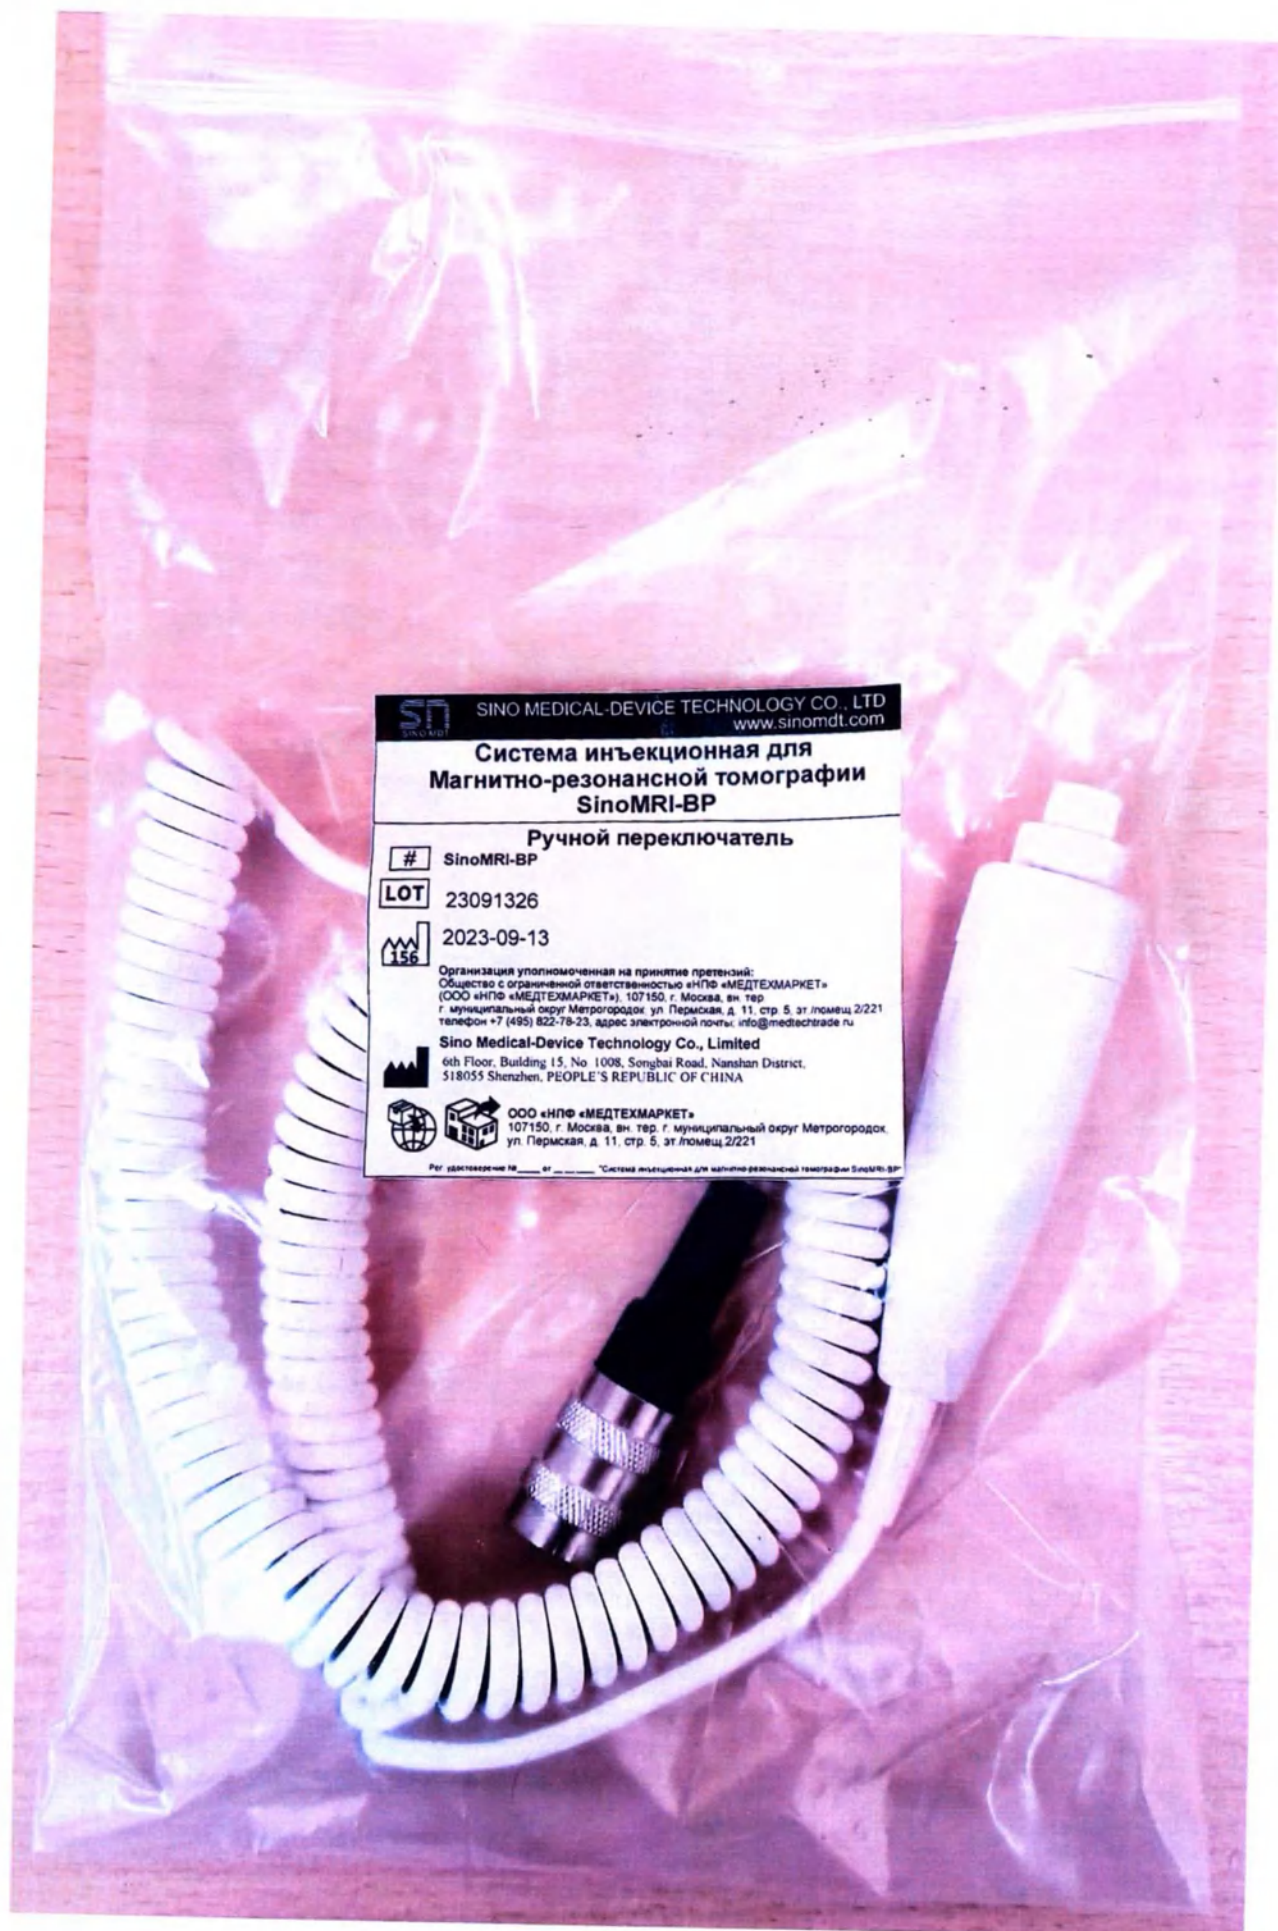

Фотографическое изображение ручного переключателя в упаковке.

1



2


Система инъекционная для
Магнитно-резонансной
томографии SinoMRI-BP

Адаптер сетевого питания
для панели управления

SinoMRI-BP

Входное напряжение:
AC 100-240В, 50/60 Гц
Выходное напряжение:
DC 12В, 2.5А

SN 230900356



IPX0



Фотографическое изображение адаптера сетевого питания для панели управления (1) и его информационного стикера (2).



Фотографическое изображение адаптера сетевого питания для панели управления в упаковке.

1



2

Система инъекционная для Магнитно-резонансной томографии SinoMRI-BP

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи

SinoMRI-BP

Входное напряжение: AC 100-240В, 50/60 Гц

Выходное напряжение: DC 16,8В, 2,5А

Безопасность: Класс I

SN 230900101




IPX0

Фотографическое изображение зарядного устройства для аккумуляторной батареи (1) и его информационного стикера (2).

1



2

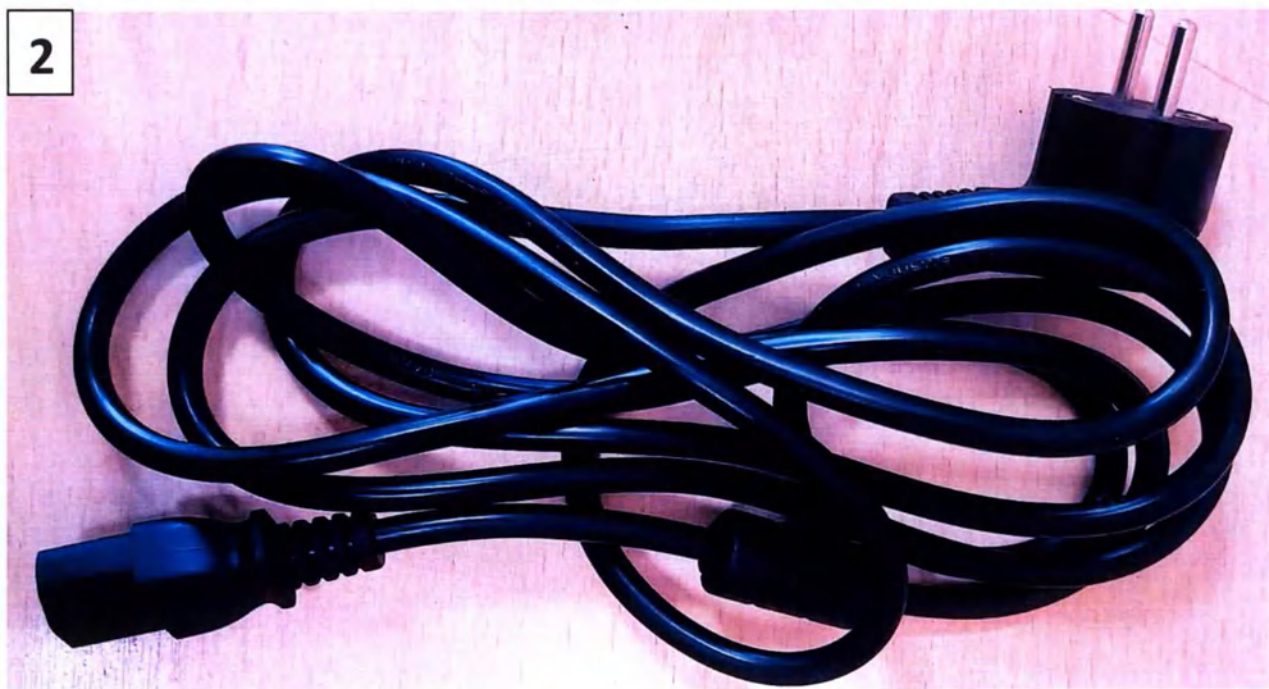

Фотографическое изображение зарядного устройства для аккумуляторной батареи в упаковке (1) и кабеля питания для зарядного устройства (2).



SN
SINO MDT

SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD
www.sinomdt.com

**Система инъекционная для
Магнитно-резонансной томографии
SinoMRI-BP**

**Кабель питания
для зарядного устройства**

SinoMRI-BP

LOT 23091305 156 2023-09-13


Организация уполномоченная на принятие претензий:
Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»
(ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»»), 107150, г. Москва, вн. тер.
г. муниципальный округ Метрогородок, ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ 2/221,
телефон +7 (495) 822-78-23, адрес электронной почты: info@medtechtrade.ru

Sino Medical-Device Technology Co., Limited
6th Floor, Building 15, No. 1008, Songba Road, Nanshan District,
518055 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

 **ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»**
107150, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Метрогородок,
ул. Пермская, д. 11, стр. 5, эт./помещ 2/221

Рег. удостоверение № _____ от _____ Система инъекционная для магнитно-резонансной томографии SinoMRI-BP

Фотографическое изображение кабеля питания для зарядного устройства в упаковке.

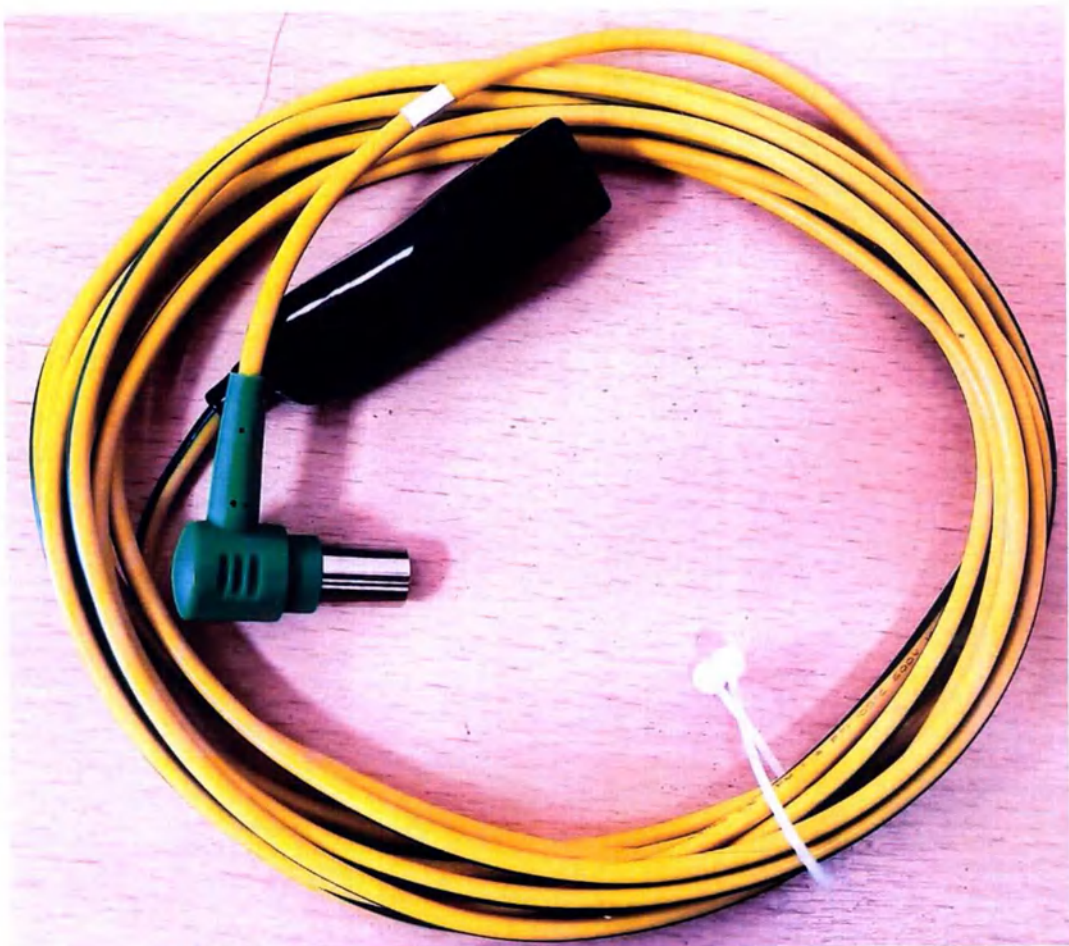

Фотографическое изображение кабеля эквипотенциального без упаковки и в упаковке.



深圳圣诺医疗设备股份有限公司
Sino Medical Device Technology Co., Ltd.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система инъекционная для магнитно-резонансной томографии
SinoMRI-BP

Дата выпуска редакции: 11.08.2024

Паспорт изделия

Идентификация изделия

Наименование	Система инъекционная для магнитно-резонансной томографии
Модель	SinoMRI-BP
Производитель	«Сино Медикал-Девайс Текнолоджи Ко., Лимитед», КНР
Сериальный номер	1033230913A00001
Дата выпуска	2023-09-13

Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации

Дата приемки

Приемщик Савельев К.А.

Гарантия производителя

Гарантия производителя 12 месяцев

3

Таблица гарантийного талона

Характер неисправности	Модель	
Выполнение работы	Сериальный №	
Дата	Дата продажи	
Подпись мастера	Наименование и адрес выполняющей работы	
	Характер неисправности	
	Выполнение работы	
	Дата	
	Подпись мастера	

4



深圳圣诺医疗设备股份有限公司
Sino Medical Device Technology Co., Ltd.

Упаковочный лист

Система инъекционная для магнитно-резонансной томографии SinoMRI-BP

№	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	Основной блок, в составе инъекционная головка, блок управления, соединительный кабель, мобильная стойка	1	
2	Панель управления	1	
3	Аккумуляторная батарея	2	
4	Лоток	1	
5	Кабель оптический	1	
6	Ручной переключатель	1	
7	Адаптер сетевого питания для панели управления	1	
8	Зарядное устройство для аккумуляторной батареи	1	
9	Кабель питания для зарядного устройства	1	
10	Кабель экранированный	1	
11	Руководство по эксплуатации	1	
12	Паспорт	1	
13	Гарантийный талон	1	
14	Упаковочный лист	1	

Фотографическое изображение руководства по эксплуатации (1), паспорта (2), упаковочного листа (3) и гарантийного талона (4) системы инъекционной для магнитно-резонансной томографии SinoMRI-BP.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

17 _____ лист

Генеральный директор ООО
«НПО «МЕДТЕХМАРКЕТ»

Б.С. Хышиктуев

