


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Версия 1

**Материал контрольный для подтверждения качества обнаружения D-димера (D-Dimer/DD)
на анализаторах Succeeder для диагностики in vitro, в вариантах исполнения**

производства Beijing Succeeder Technology Inc., Tower 1A, No. 27 Chuangxin Rd, Tech Park Changping District,
102200 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

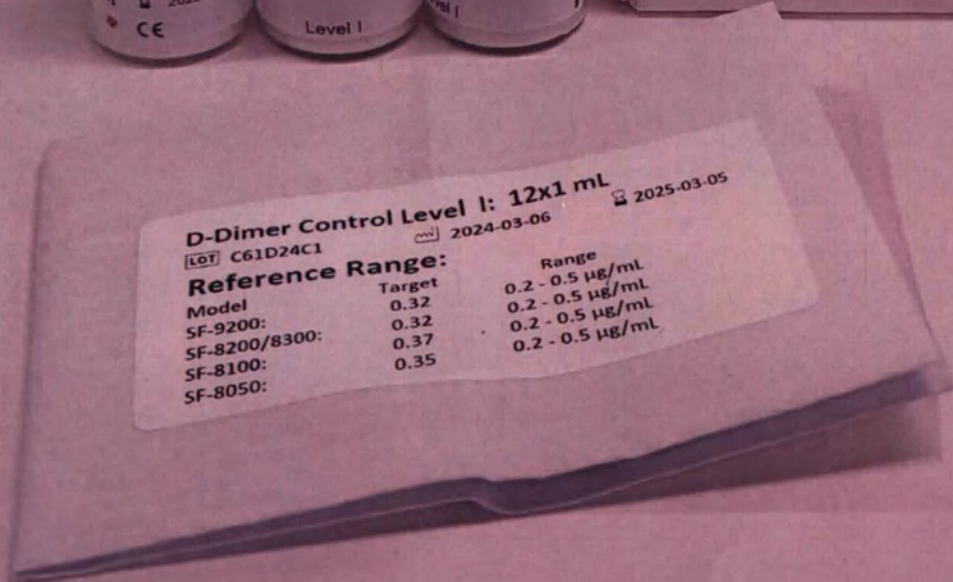

D-Dimer Control

D-Dimer Control Level I : 12×1 mL

2°C / 8°C

REF

SF-QD1-P1201



2024-03-06



LOT

C61D24C1



2025-03-05


IVD


EAN



CE

6 9 5 7 7 0 5 2 3 3 6 1 2

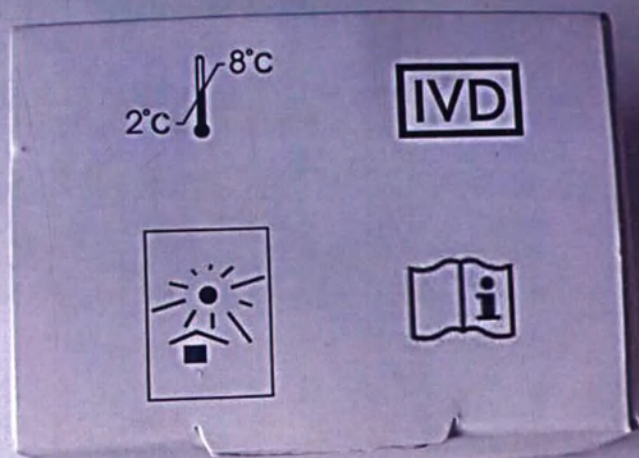



MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

SUCCEEDER



Beijing Succeder Technology INC.

Address of manufacturer: Tower 1A, No. 27 Chuangxin Rd,
Tech. Park, Changping District Beijing 102200 PRC.

Tel: +86-10-53855569 Fax: +86-10-53855570

Web: <http://www.succeder.com>

Email: service@succeder.com.cn


Вторичная упаковка (картонная коробка), вид сзади медицинского изделия «Материал контрольный для подтверждения качества обнаружения D-димера




Внешний вид флакона с контрольным материалом медицинского изделия «Материал контрольный для подтверждения качества обнаружения D-димера (D-димер)» на анализаторах Succeeder для диагностики in vitro, в вариантах исполнения», Вариант 1, сторона 1.



Внешний вид флакона с контрольным материалом медицинского изделия «Материал контрольный для подтверждения качества обнаружения D-димера (D-
Dimer/DD) на анализаторах Succeder для диагностики in vitro, в вариантах исполнения», Вариант 1, сторона 2.

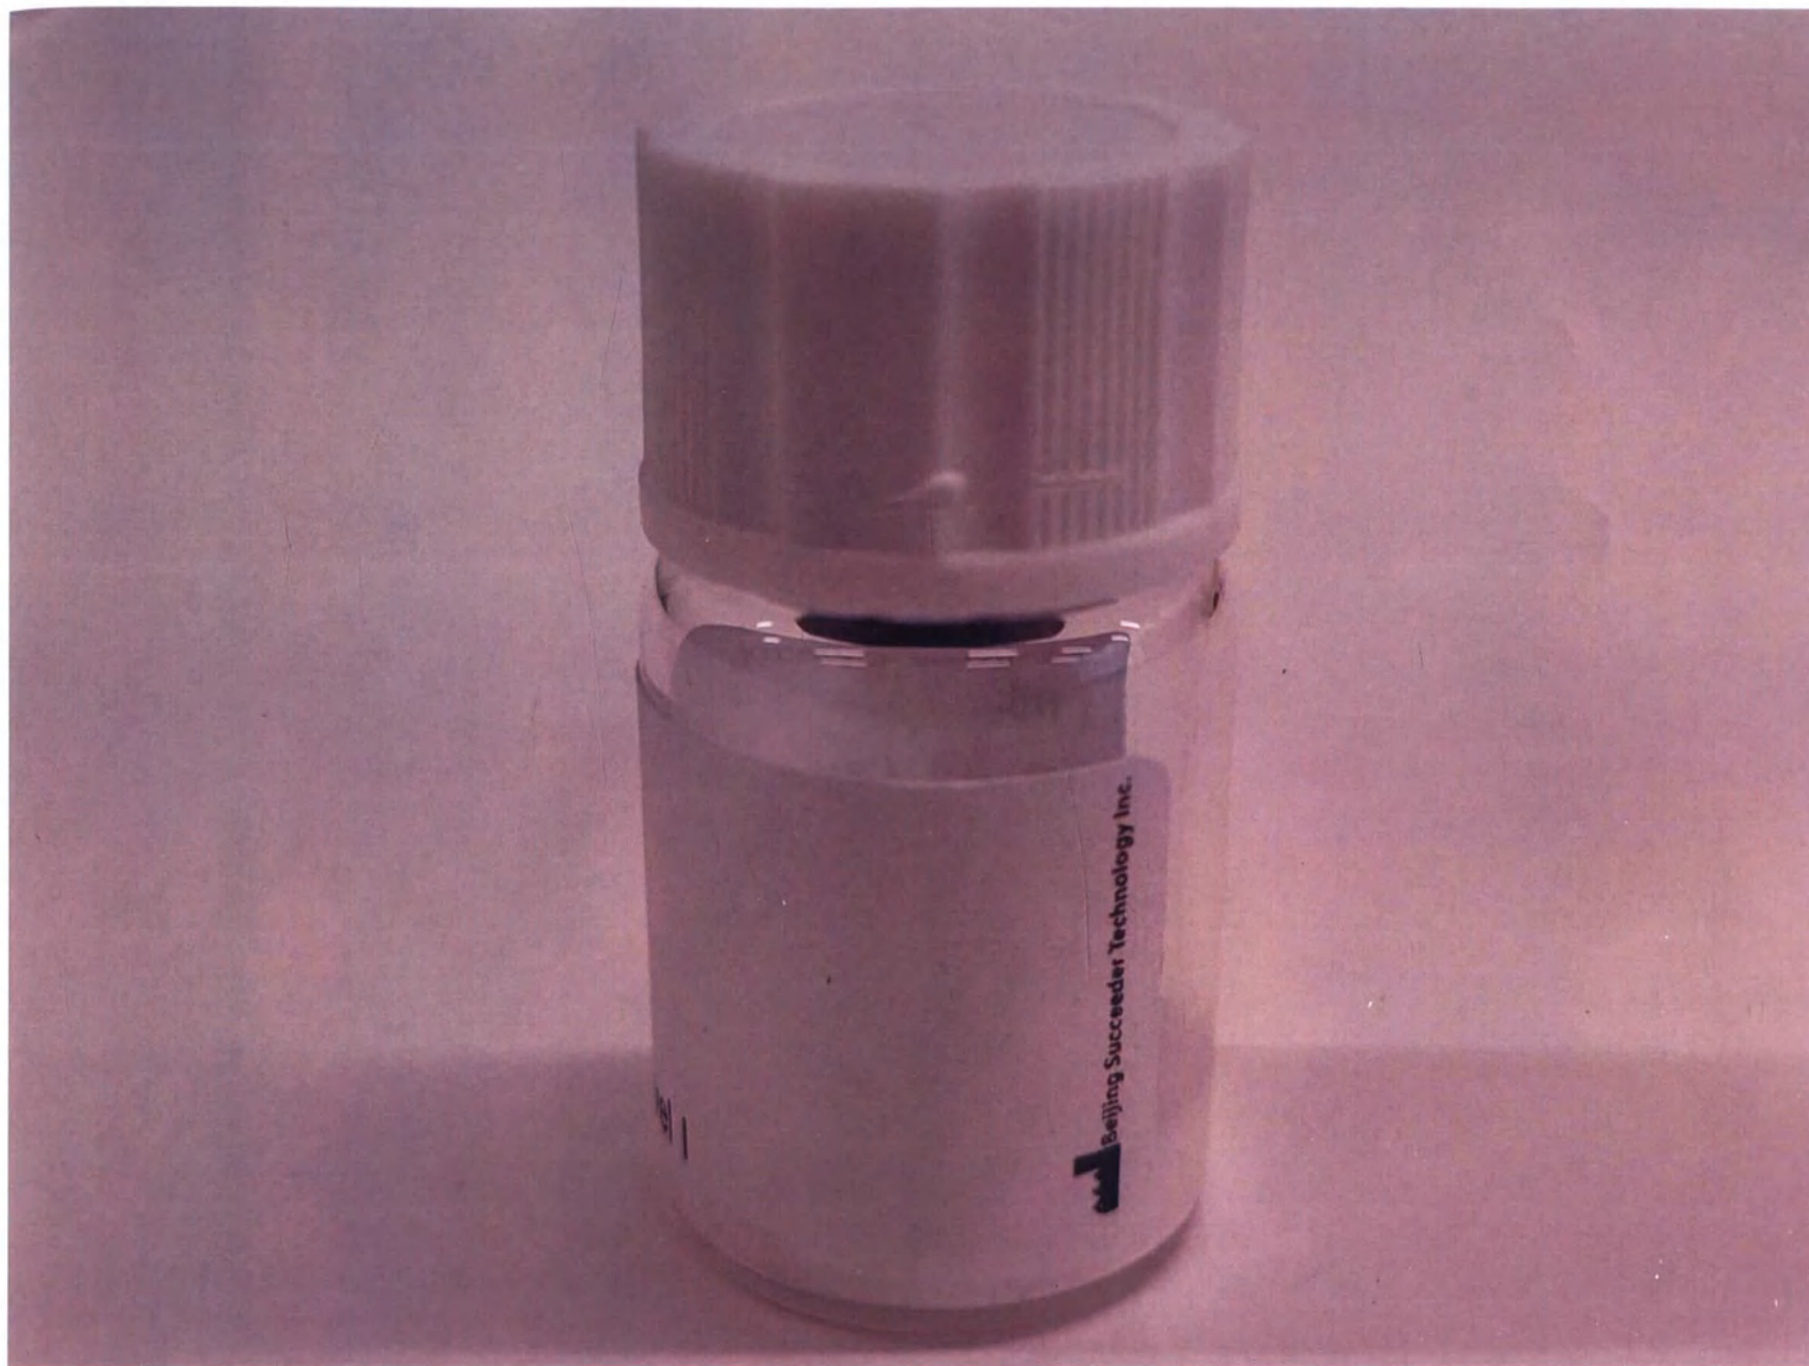

Внешний вид флакона с контрольным материалом медицинского изделия «Материал контрольный для подтверждения качества обнаружения D-димера (D-

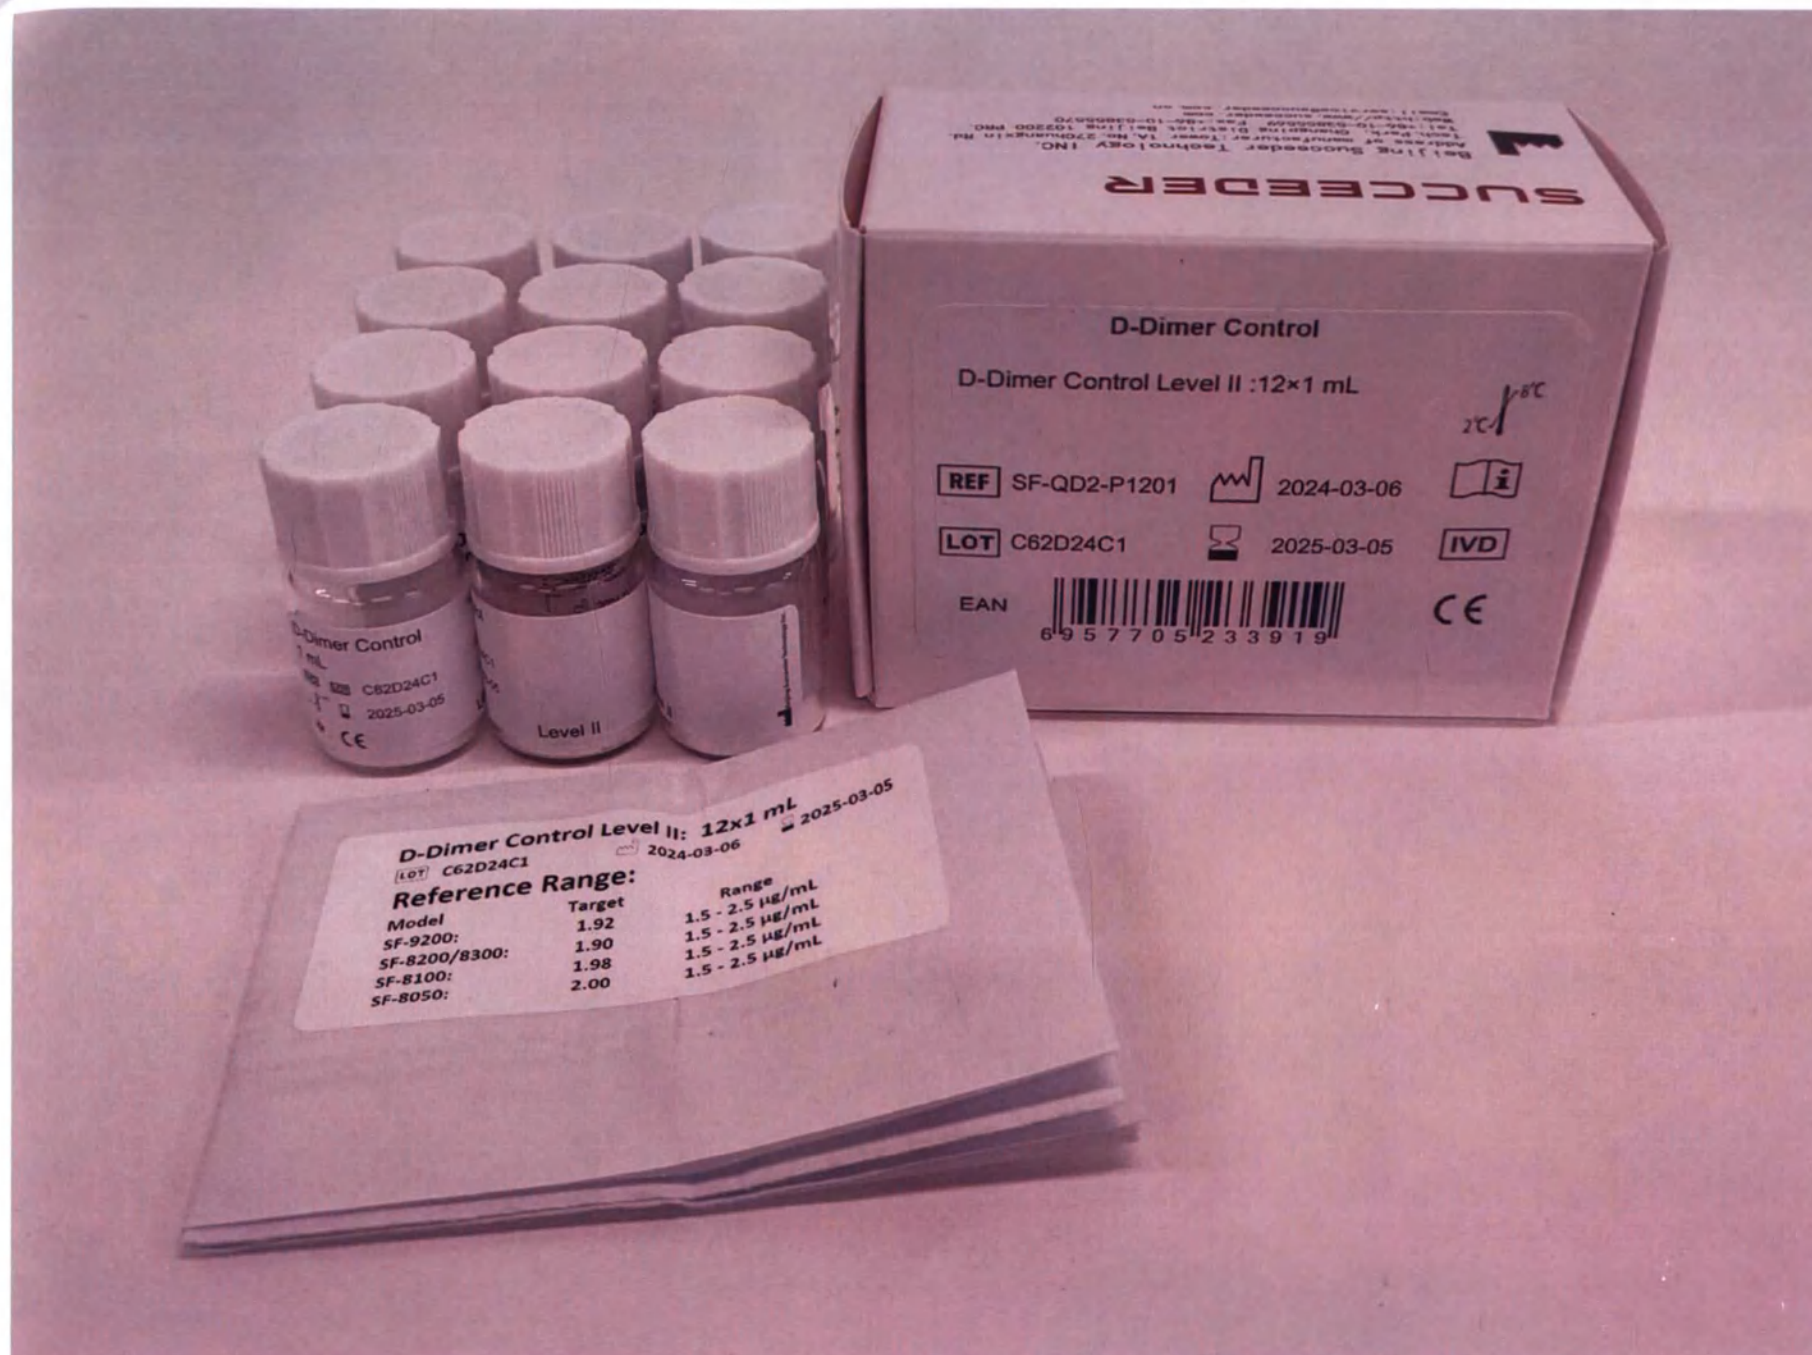

Общий вид медицинского изделия «Материал контрольный для подтверждения качества обнаружения D-димера (D-Dimer/DD) на анализаторах Succeeder для диагностики in vitro, в вариантах исполнения», Вариант 2.

D-Dimer Control

D-Dimer Control Level II :12×1 mL

2°C / 8°C

REF SF-QD2-P1201



2024-03-06



LOT C62D24C1



2025-03-05

IVD


EAN



6 9 5 7 7 0 5 2 3 3 9 1 9

CE

Вторичная упаковка (картонная коробка), вид сверху медицинского изделия «Материал контрольный для подтверждения качества обнаружения D-димера (D-Dimer/DD) на анализаторах Succeeder для диагностики in vitro, в вариантах исполнения», Вариант 2.

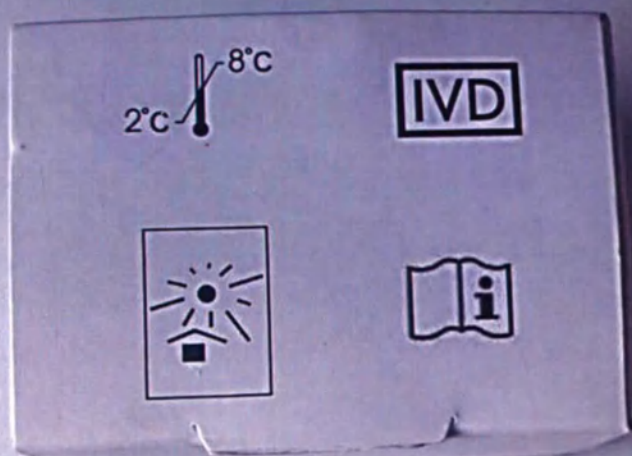



MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

SUCCEEDER



Beijing Succeeder Technology INC.

Address of manufacturer: Tower 1A, No. 27 Chuangxin Rd,
Tech. Park, Changping District Beijing 102200 PRC.

Tel: +86-10-53855569 Fax: +86-10-53855570

Web: <http://www.succeeder.com>

Email: service@succeeder.com.cn



Внешний вид флакона с контрольным материалом медицинского изделия медицинского изделия «Материал контрольный для подтверждения качества обнаружения D-димера (D-Dimer/DD) на анализаторах Succeeder для диагностики in vitro, в вариантах исполнения», Вариант 2, сторона 1.





Внешний вид флакона с контрольным материалом медицинского изделия «Материал контрольный для подтверждения качества обнаружения D-димера



Фото транспортной упаковки медицинского изделия «Материал контрольный для подтверждения качества обнаружения D-димера (D-Dimer/DD) на анализаторах Succeder для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» (вид сбоку).

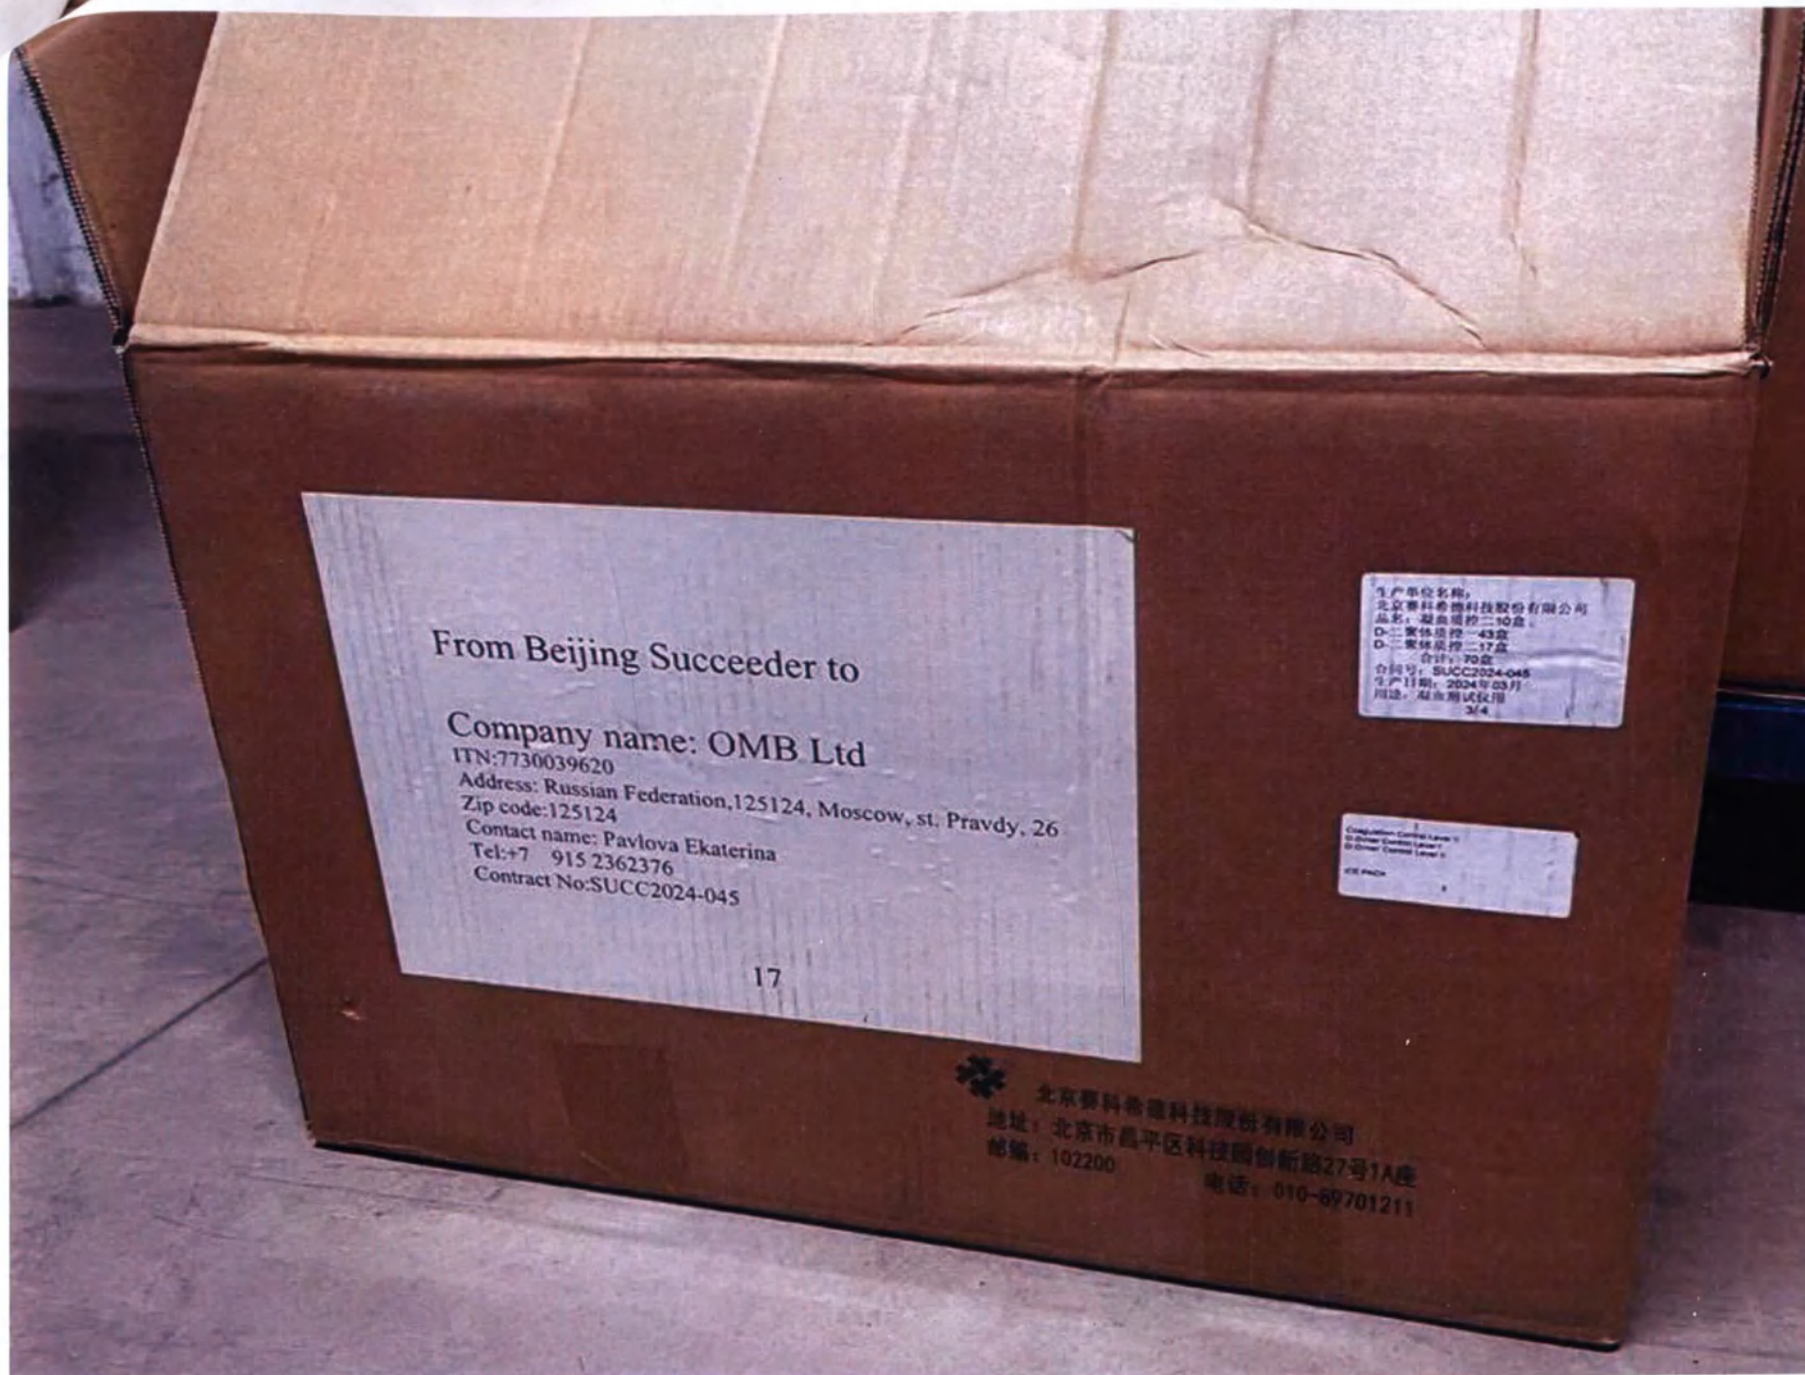


Фото транспортной упаковки медицинского изделия «Материал контрольный для подтверждения качества обнаружения D-димера (D-Dimer/DD) на анализаторах Succeder для диагностики in vitro, в вариантах исполнения» (вид спереди).

