



REGICOM
est. 2008



Address: Almaty, 050000, st. Abylai Khan
122, office 12/13

Phone: +7 (727) 267-31-20
Mobile: +7 701-786-82-79 (WhatsApp)
Mobile: +7 701-789-90-00
E-mail: i.kozlov@regicompany.com

Address: Moscow, Shmitovskiy proezd, house 39,
building 2, apartment 10

Phone: +7 495 609-41-15
Mobile: +7 969-197-44-33
Mobile: +7 701-786-82-79 (WhatsApp)
E-mail: i.kozlov@regicompany.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РЕГИКОМ»

Козлов И.

2024 г.




Фотографические изображения Версия 2


Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга pEGASUS HPC, в вариантах исполнения
производства компании / manufactured by the company
femtос GmbH («фемтос ГмбХ»)

мм x 30 мм, в составе:

1.1. Саморасширяющийся стент - 1 шт.

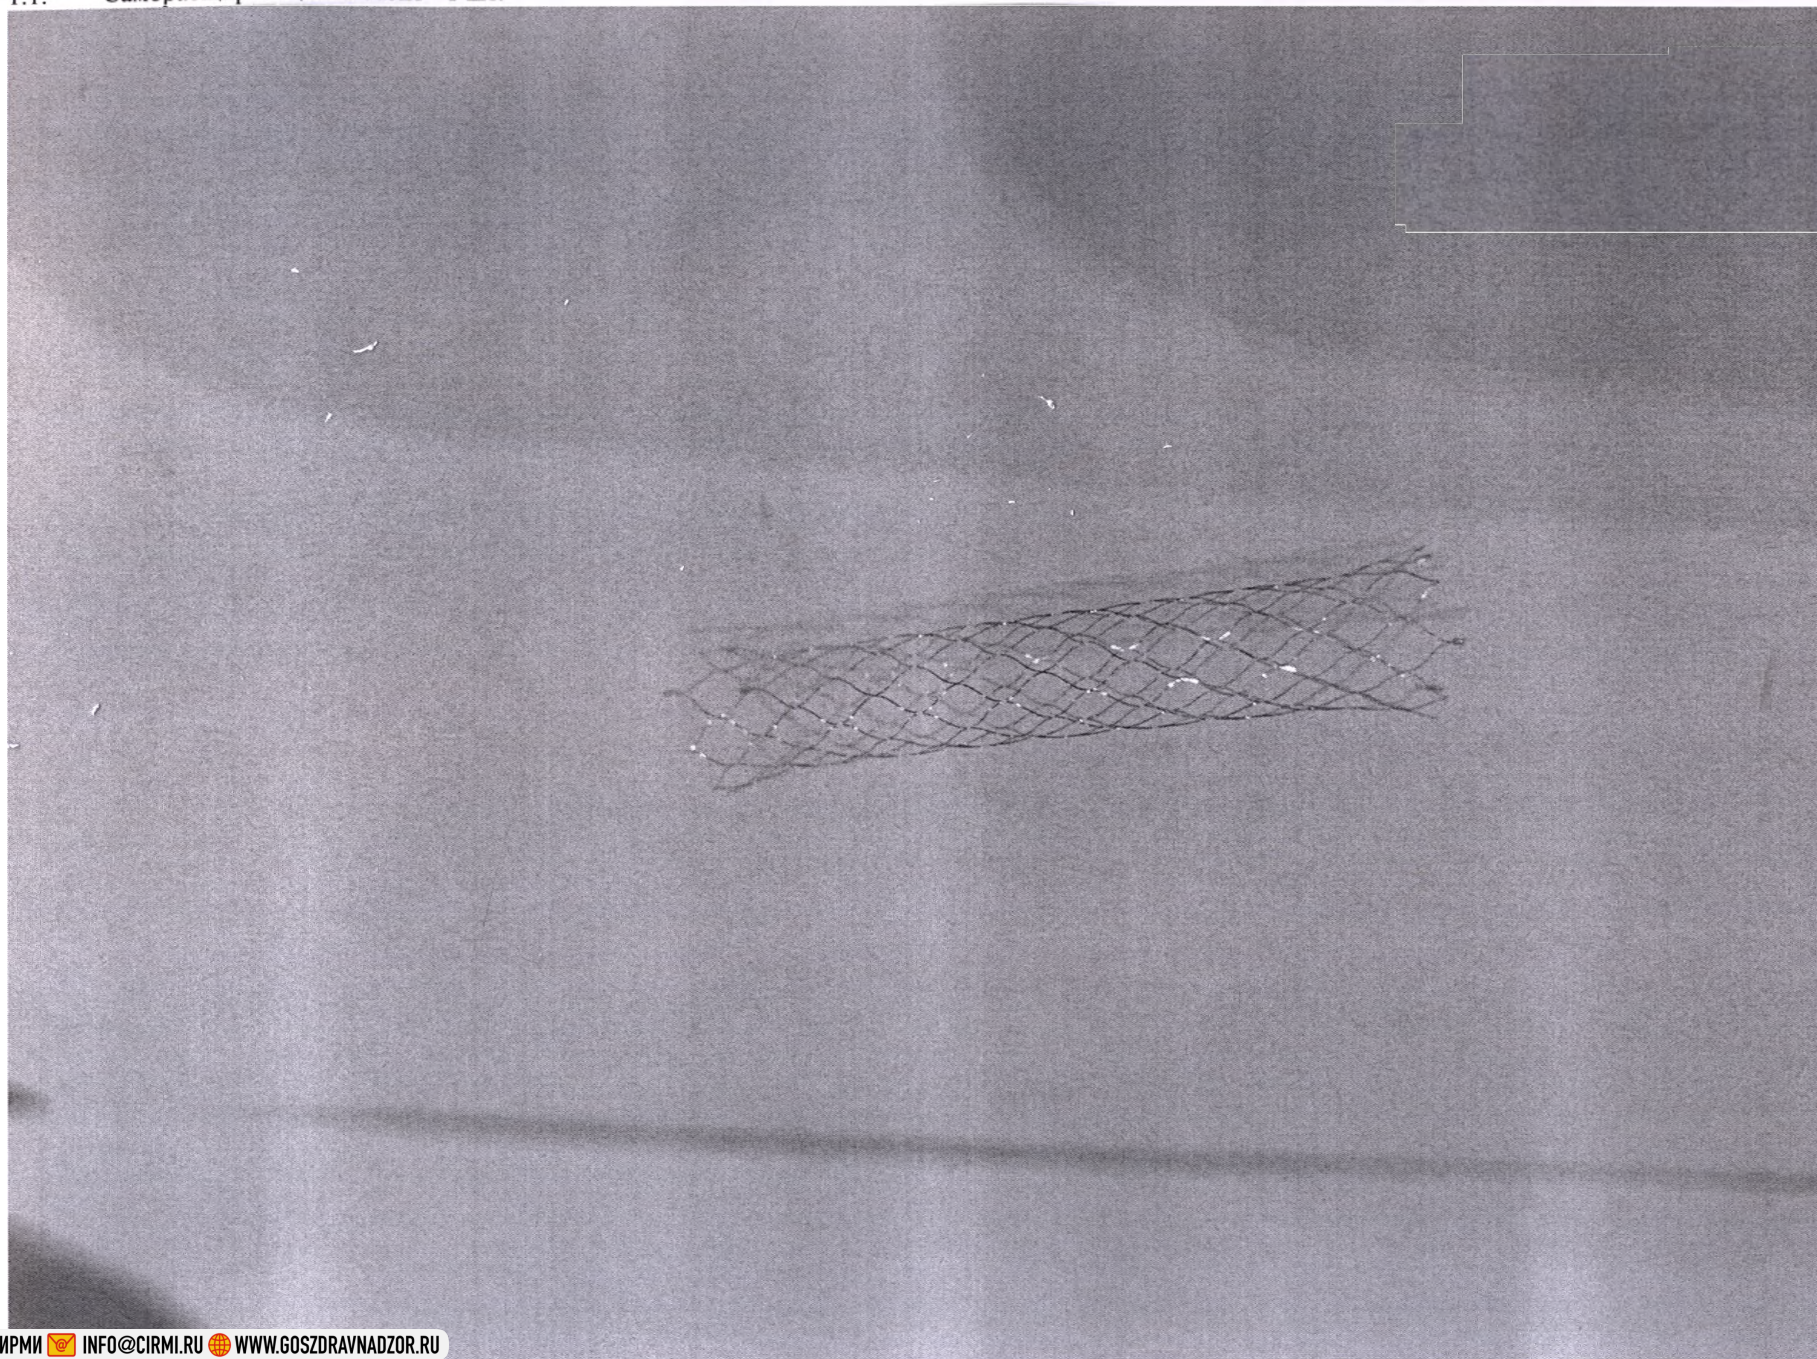


диаметр 0,69 мм; длина 500 мм - 1 шт.

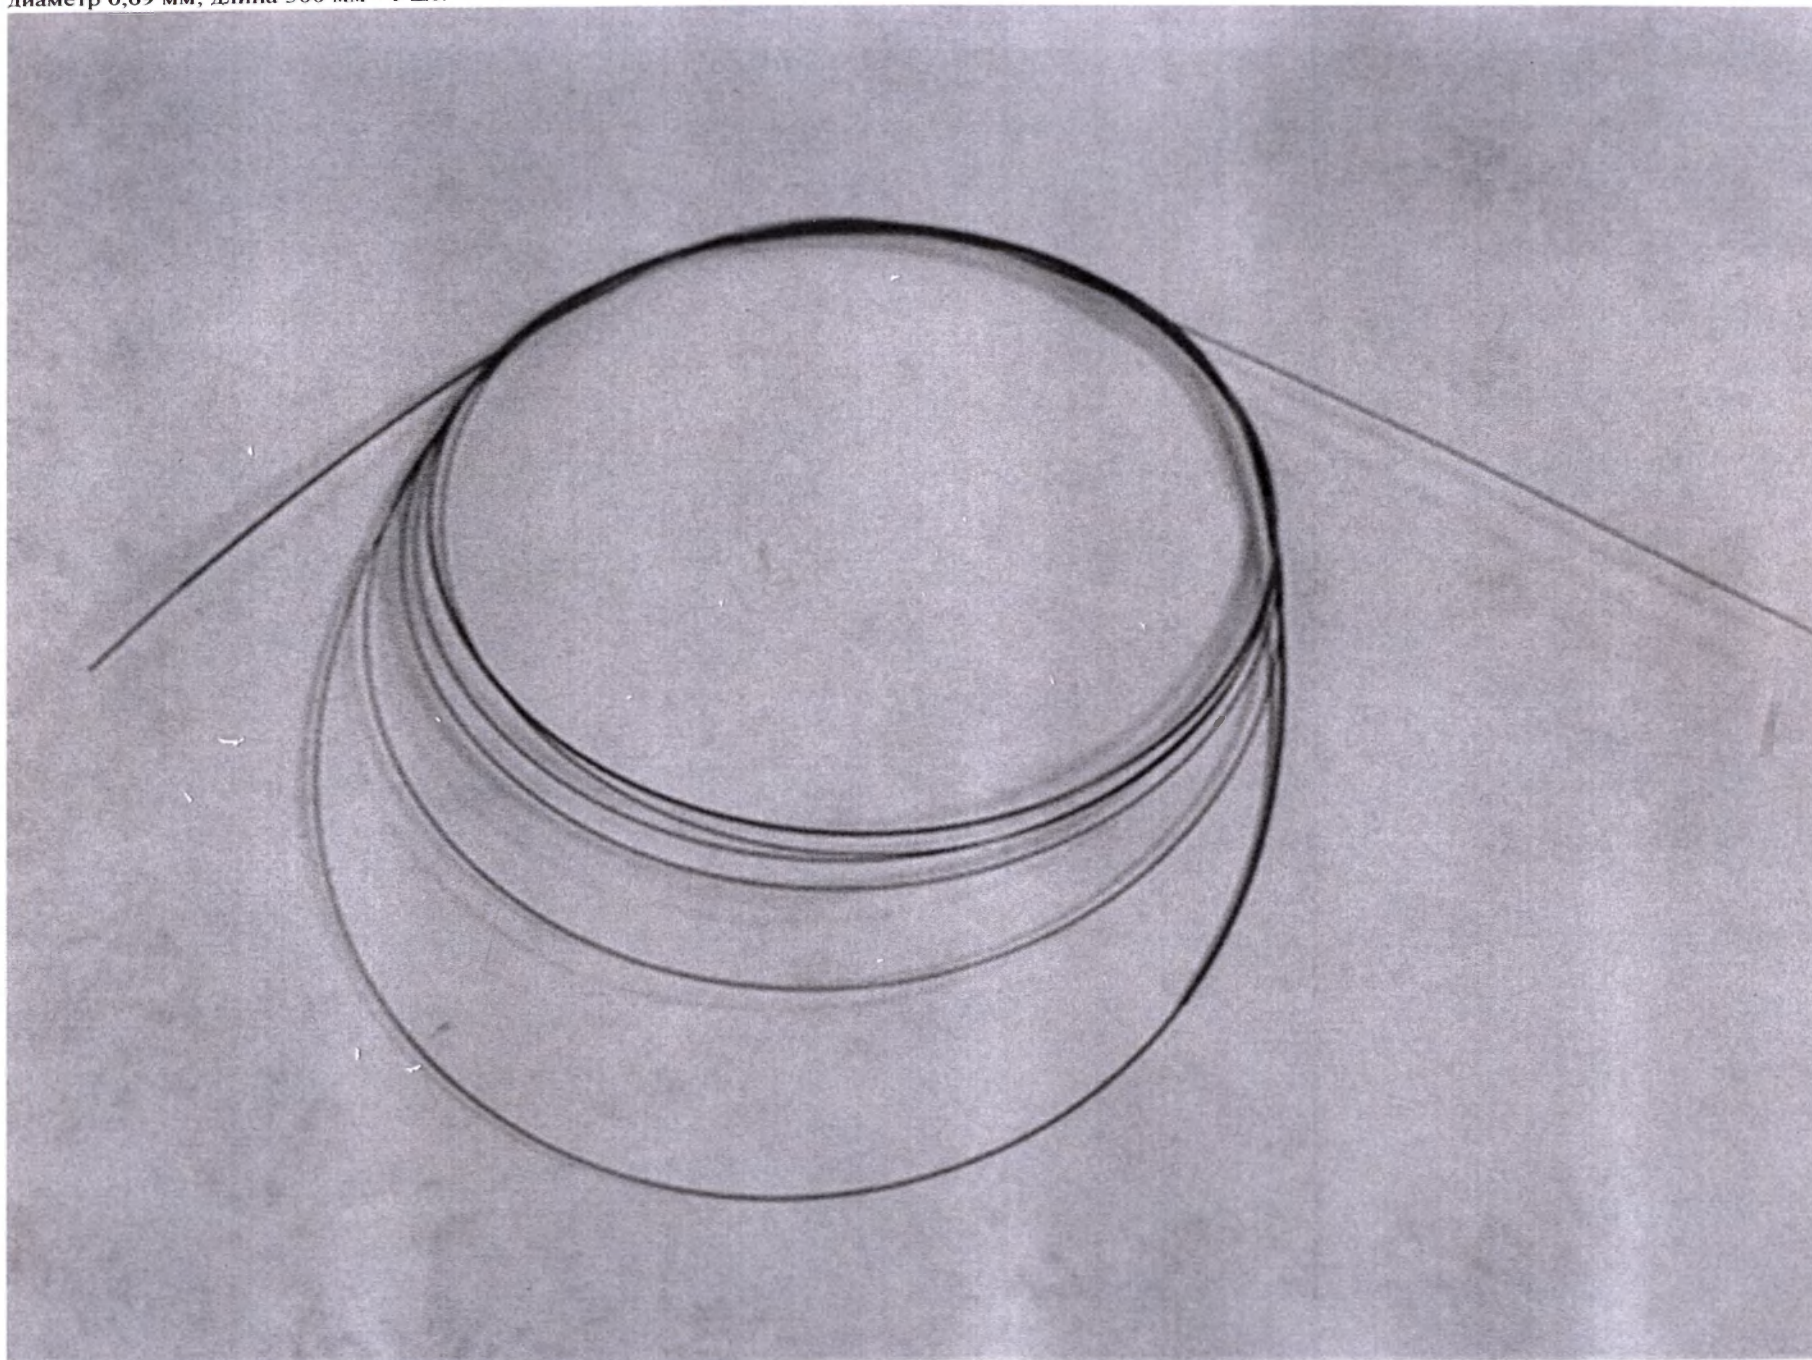

femtos

pEGASUS Stent System
INSTRUCTIONS FOR USE

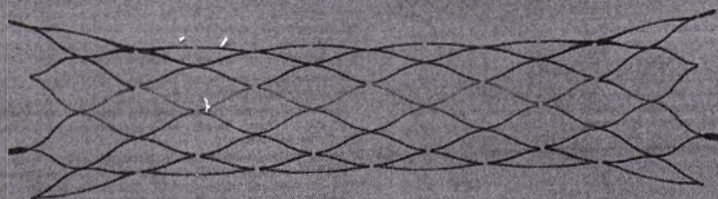

- 2 DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG
- 5 ENGLISH
INSTRUCTIONS FOR USE
- 8 FRANÇAIS
MODE D'EMPLOI
- 11 ITALIANO
ISTRUZIONI PER L'USO
- 14 ESPAÑOL
INSTRUCCIONES DE USO
- 17 NEDERLANDS
GEBRUIKSAANWIJZING

Explanation

EN Explanation / BG Обяснение / CZ Vysvětlení / DK Forklaring / DE Erläuterung / EE Selgitus /
 ES Explicación / FI Selitys / FR Explication / GR Εξήγηση / HR Obrazloženje /
 HU Magyarázás / IT Spiegazione / LT Paaiškinimas / LV Paskaidrojums / NL Uitleg /
 NO Forklaring / PL Wyjaśnienie / PT Explicação / RO Explicație / RU Объяснение /
 SE Explicación / SI Pojasnilo / SK Vysvetlenie / AR رِسَالَة



EN Patient name / BG Име на пациента / CZ Jméno pacienta / DK Patientens navn / DE Patientenname / EE Patsiendi nimi /
 ES Nombre del paciente / FI Potilaan nimi / FR Nom du patient / GR Ονομα του ασθενούς / HR Ime pacijenta / HU A beteg neve /
 IT Nome del paziente / LT Paciento vardas / LV Pacienta vārds / NL Patient naam / NO Pasientnavn / PL Imię pacjenta / PT Nome do
 paciente / RO Numele pacientului / RU Имя пациента / SE Patientnamn / SI Ime pacienta / SK Meno pacienta / AR مِسْمِيَّةُ الْمَرِيضِ



EN Date of implantation / BG Дата на имплантиране / CZ Datum implantace / DK Dato for implantation / DE Implantationsdatum /
 EE Implantaatsiooni kuupäev / ES Fecha de implantación / FI Istutuksen päivämäärä / FR Date d'implantation / GR Εγκαταστάσιμος ημερομηνία / HR Datum implantacije / HU A beültetés dátuma / IT Data di impianto / LT Implantacijos data / LV Implantācijas datums /
 NL Datum van implantatie / NO Dato for implantasjon / PL Data implantacji / PT Data de implantação / RO Data implantării /
 RU Дата имплантации / SE Implantatdatum / SI Datum implantacije / SK Dátum implantácie / AR تَارِيخُ زَرْعَانِ



EN Health facility / BG Здравно заведение / CZ Zdravotnické zařízení / DK Sundhedsfacilitet / DE Gesundheitseinrichtung /
 EE Terviseasutus / ES Facultad de salud / FI Terveystulos / FR Etablissement de santé / GR Εγκαταστάσιμος υγειονομικός / HR Zdravstvena
 ustanova / HU Egészségügyi létesítmény / IT Struttura sanitaria / LT Sveikatos įstaiga / LV Veselības aprūpes iestāde /
 NL Gezondheidsfaciliteit / NO Helseanlegg / PL Placówka zdrowia / PT Estabelecimento de saúde / RO Unitatea de sănătate /
 RU Учреждение здравоохранения / SE Hälsoanläggning / SI Zdravstvena ustanova / SK Zdravotnícke zariadenie / AR مَوْضِعُ الْبَرِيَّةِ



EN MR conditional / BG MR условно подходящ / CZ MR podmíněně vhodně / DK MR betinget egnet / DE MR bedingt geeignet /
 EE MR tingitud sobiv / ES MR condicionalmente adecuado / FI MR ehdollisesti sopiva / FR MR adapté sous condition /
 GR MR υπό όρους κατάλληλο / HR MR uvjetno pogodan / HU MR feltételeken alkalmas / IT MR condizionalmente adatto /
 LT MR sąlyginai tinkas / LV MR nosacīti piemērots / NL MR voorwaardelijk geschikt / NO MR betinget egnet /
 PL MR warunkowo odpowiedni / PT MR condicionalmente adequado / RO MR adecvat condițional / RU MR условно подходящий /
 SE MR viskligt lämplig / SI MR pogojno primerna / SK MR podmienenčne vhodné / AR مَرْكَبِيَّةٌ عَشْرَةٌ




EN Further patient information / BG По-далечна информация за пациента / CZ Více informací o pacientech /
 DE Weitere Patienteninformationen / DK Flere patientoplysninger / EE Rohkem teavet patsiendi kohta / ES Mas información para el
 paciente / FI Lisä tiedot potilaista / FR Informations complémentaires pour les patients / GR Περισσότερες πληροφορίες για τον ασθενή /
 HR Više informacija o pacijentu / HU További beteginformációk / IT Ulteriori informazioni per i pazienti / LT Daugiau informacijos apie
 pacientus / LV Pārdzīvotāja informācija par pacientiem / NL Verdere patiëntinformatie / NO Mer pasientinformasjon / PL Dalsze informacje
 dla pacjentów / PT Mais informação ao paciente / RO Mai multe informații despre pacienți / RU Дополнительная информация для
 пациента / SE Mer patientinformation / SI Več informacij o pacientih / SK Väč informácií o pacientoch / AR مَعْلُومَاتٌ تَتَابَعُهَا الْمَرِيضُ



EN Medication instructions for the patient / BG Инструкции за лечение на пациента / CZ Pokyny k léčbě pacienta /
 DE Medikationshinweise für den Patienten / DK Medicinestruktioner til patienten / EE Ravimeetused patsientide / ES Instrucciones de
 medicación para el paciente / FI Lääkitysohjeet potilaalle / FR Instructions de médication pour le patient / GR Οδηγίες φαρμακευτικής
 αγωγής για τον ασθενή / HR Upute za lijekove za pacijenta / HU Gyógyszeres utasítások a beteg számára / IT Istruzioni per l'uso per il
 paziente / LT Vaistų vartojimo instrukcijos pacientams / LV Zāļu lietošanas instrukcijas pacientam / NL Medicatie-instructies voor de patiënt /
 NO Legemiddelinstruksjoner for pasienten / PL Instrukcje dotyczące leków dla pacjenta / PT Instruções de medicação para o paciente /
 RO Instrucțiuni de medicament pentru pacient / RU Инструкции по лекарствам для пациента / SE Läkemedelsinstruktioner för patienten /
 SI Navodila za zdravlje za pacienta / SK Pokyny pre lieky pre pacienta / AR مَرْكَبِيَّةٌ دَوَائِيَّةٌ



EN Implant location (blood vessel) / BG Местоположение на импланта (крвоносен съд) / CZ Umístění implantátu (krevní céva) /
 DE Implantationsstelle (Blutgefäß) / DK Implantatplacering (blodkar) / EE Implantatsiooni asukoht (veresoone) / ES Ubicación del implante
 (vaso sanguíneo) / FI Implantin sijainti (verisuoni) / FR Emplacement de l'implant (vaisseau sanguin) / GR Τοποθεσία εμφύτευματος
 (αγγείο αίματος) / HR Mjesto implantata (krvna žila) / HU Az implantátum helye (vérerősz) / IT Posizione dell'implanto (vaso sanguigno) /
 LT Implantu vieta (kraujagys) / LV Implantā ievietošanas vieta (asinsvads) / NL Implantaat locatie (bloedvat) / NO Implantatsted (blodkar) /
 PL Lokalizacja implantu (naczynie krwionośne) / PT Localização do implante (vaso sanguíneo) / RO Localizarea implantului (vas de sânge) /
 RU Местоположение имплантата (кровеносный сосуд) / SE Implantplats (blodkärl) / SI Lokacija vada (krvna žila) / SK Umiestnenie
 implantátu (krvná cieva) / AR مَوْضِعُ زَرْعَانِ (عُرْوَةُ دَمٍ)

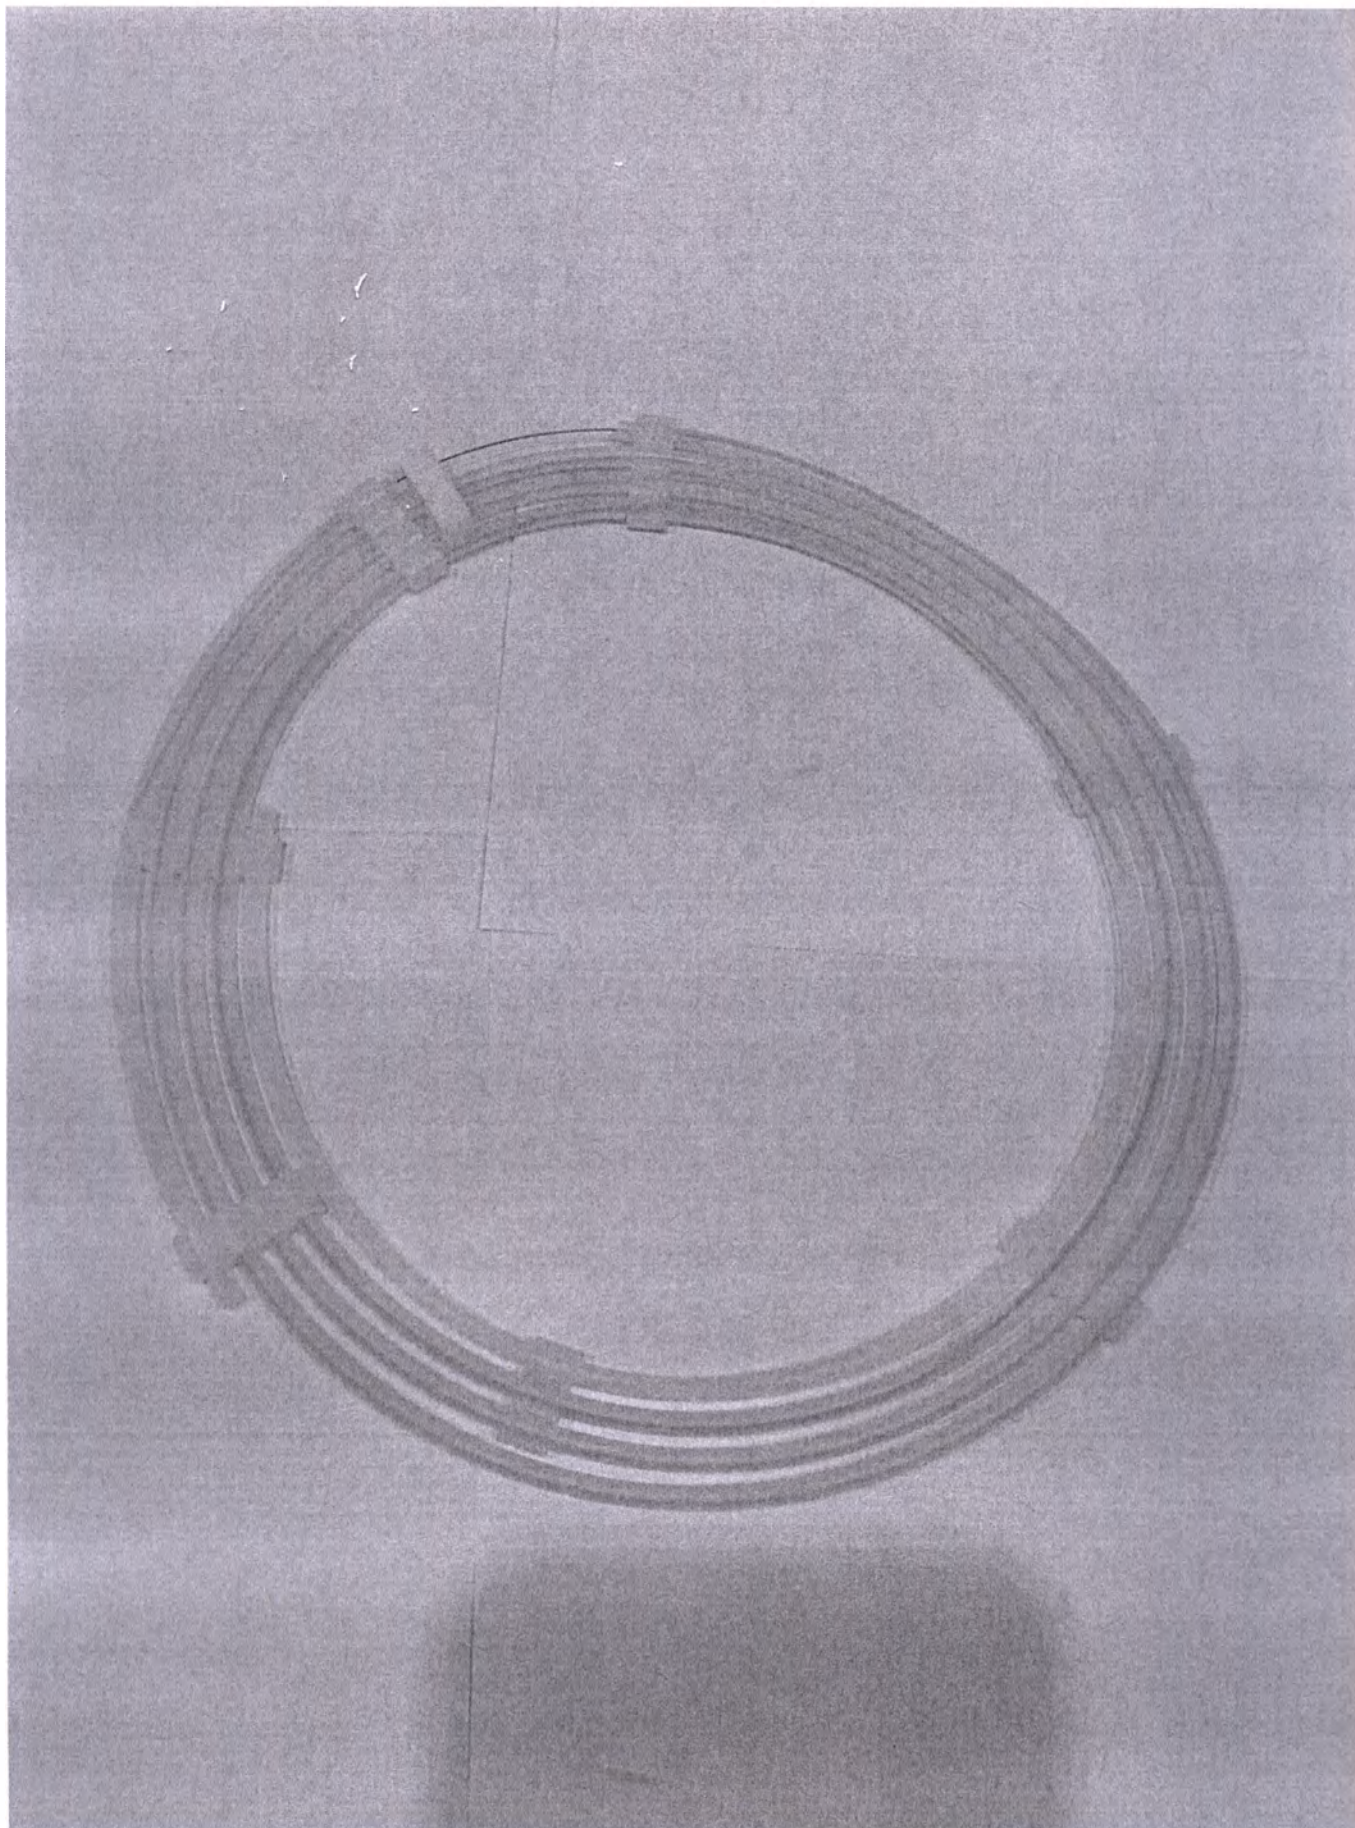

pEGASUS HPC Stent System

PEGASUS-450-30-HPC

Herstellernamen, Marken, Logos, Gütezeichen, etc. sind Eigentum der
Hersteller und sind nicht übertragbar. Die Hersteller sind für die
Angaben verantwortlich.

Hersteller:
Jentico GmbH
Luisenpark-Str. 11, 44001 Bochum, Germany
Tel: +49 (0) 23 1 30019-0, Fax: +49 (0) 23 1 30019-10
www.jentico.de

Jentico GmbH
Luisenpark-Str. 11, 44001 Bochum, Germany
Tel: +49 (0) 23 1 30019-0, Fax: +49 (0) 23 1 30019-10
www.jentico.de


4.5 mm x 30 mm

Stent O Stent Length

ID 0.0105" 3.50 x 5.50 mm

Microcatheter Vessel ID

HPC - Hydrophilic Polymer Coating



A Stent Diameter unconstrained	B Stent Length	max. Catheter Length	Microcatheter Compatibility	Stent Surface	Min. Vessel Diameter	Max. Vessel Diameter
5.0 mm	30 mm	150cm	0.0185" (0.42mm) 0.0177" (0.43mm)	HPC	3.50 mm	4.50 mm

REF PEGASUS-450-30-HPC

LOT 478727

2026-02-27

CONT 1x pEGASUS HPC

pEGASUS HPC REF PEGASUS-450-30-HPC LOT 478727



(01)04270001836472(17)260227(10)478727



PEGASUS HPC Jentico GmbH, www.jentico.de
REF PEGASUS-450-30-HPC
LOT 478727 2026-02-27
(01)04270001836472(17)260227(10)478727



PEGASUS HPC Jentico GmbH, www.jentico.de
REF PEGASUS-450-30-HPC
LOT 478727 2026-02-27
(01)04270001836472(17)260227(10)478727

PEGASUS HPC Jentico GmbH, www.jentico.de
REF PEGASUS-450-30-HPC
LOT 478727 2026-02-27
(01)04270001836472(17)260227(10)478727

PEGASUS HPC Jentico GmbH, www.jentico.de
REF PEGASUS-450-30-HPC
LOT 478727 2026-02-27
(01)04270001836472(17)260227(10)478727



pEGASUS HPC

4.5 mm x 30 mm

REF PEGASUS-450-30-HPC

LOT 478727

2026-02-27

pEGASUS HPC Stent System **PEGASUS-450-30-HPC**

Stentsystem, Stent System, Sistema de stent, Système de stent, Sistema di stent, Stentsysteem, Stent-systeem, Stent-system, Stent System

Distributed by:
phenox GmbH
Lieserstrasse 31 · 44061 Bochum, Germany
Tel: +49 (0) 234 / 3099-0 · Fax: +49 (0) 234 / 3099-19
www.phenox.de

femtos GmbH
Universitätsstraße 136 · 44789 Bochum, Germany
www.femtos.de

4.5 mm x 30 mm

Stent O


Stent Length

ID 0.0165" 3.50-4.50 mm

Microcatheter

Vessel O

HPC - Hydrophilic Polymer Coating



A: Stent Diameter unconstrained	B: Stent Length	max. Catheter Length	Microcatheter Compatibility	Stent Surface	Min. Vessel Diameter	Max. Vessel Diameter
5.0 mm	30 mm	150cm	0.0165" (0.42mm) 0.0170" (0.43mm)	HPC	3.50 mm	4.50 mm

REF PEGASUS-450-30-HPC

LOT 478727

2026-02-27

CONT 1x pEGASUS HPC

pEGASUS HPC **REF** PEGASUS-450-30-HPC **LOT** 478727



(01)04270001836472(17)260227(10)478727



pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-450-30-HPC

LOT 478727 2026-02-27

(01)04270001836472(17)260227(10)478727



0297

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-450-30-HPC

LOT 478727 2026-02-27

(01)04270001836472(17)260227(10)478727

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-450-30-HPC

LOT 478727 2026-02-27

(01)04270001836472(17)260227(10)478727

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-450-30-HPC

LOT 478727 2026-02-27

(01)04270001836472(17)260227(10)478727



Phenox GmbH

Lieserstr.

NET

STERILE EO

Single Use

Do not reuse

Do not touch

Do not touch

Do not touch

Do not touch

Do not touch

Do not touch

LWL 00418-000-000

PEGASUS HPC Stent System

4,5 mm x 30 mm



REF PEGASUS-450-30-HPC

LOT 478727

EXP 2026-02-27

pEGASUS HPC Stent System

PEGASUS-450-25-HPC

Stentsystem, Stent System, Sistema de stent, Système de stent, Sistema di stent, Stentsysteem, СТЕНТ-СИСТЕМА, Stent-system, Stent Sistemi

Distributed by:
phenox GmbH

Lise-Meitner-Allee 31 · 44801 Bochum, Germany
Tel: +49 (0) 234 / 36919-0 · Fax: +49 (0) 234 / 36919-19
www.phenox.net

femtos GmbH

Universitätsstraße 136 · 44799 Bochum, Germany
www.femtos.de

4.5 mm x 25 mm

Stent Ø


Stent Length

ID 0.0165" 3.50-4.50 mm

Microcatheter

Vessel Ø

HPC - Hydrophilic Polymer Coating

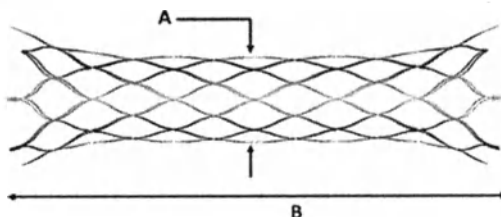

A: Stent Diameter unconstrained	B: Stent Length	max. Catheter Length	Microcatheter Compatibility	Stent Surface	Min. Vessel Diameter	Max. Vessel Diameter
5.0 mm	25 mm	150cm	0.0165" (0.42mm) 0.0170" (0.43mm)	HPC	3.50 mm	4.50 mm

REF PEGASUS-450-25-HPC

LOT 123456

2024-00-00

CONT 1x pEGASUS HPC

pEGASUS HPC REF PEGASUS-450-25-HPC

LOT 123456



(01)04270001836465(17)240000(10)123456



pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de



REF PEGASUS-450-25-HPC

LOT 123456

2024-00-00

(01)04270001836465(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de



REF PEGASUS-450-25-HPC

LOT 123456

2024-00-00

(01)04270001836465(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de



REF PEGASUS-450-25-HPC

LOT 123456

2024-00-00

(01)04270001836465(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de



REF PEGASUS-450-25-HPC

LOT 123456

2024-00-00

(01)04270001836465(17)240000(10)123456




Pneumatically applied



Latex-free



NiTi



Sterilized with Ethylene Oxide Gas



Consult instructions for use



Caution



Do not reuse



Keep dry



Keep away from sunlight



Do not use if the packaging is damaged



Do not repackage



Non-sterile

LAB_100418-000-000

pEGASUS HPC Stent System

4.5 mm x 25 mm



REF PEGASUS-450-25-HPC

LOT 123456

2024-00-00

pEGASUS HPC Stent System

PEGASUS-450-15-HPC

Stentsystem, Stent System, Sistema de stent, Système de stent, Sistema di stent, Stentsysteem, Стент-система, Stent-system, Stent System


Distributed by:
phenox GmbH
Lise-Meitner-Allee 31 - 44801 Bochum, Germany
Tel: +49 (0) 234 / 36919-0 - Fax: +49 (0) 234 / 36919-19
www.phenox.net

femtos GmbH
Universitätsstraße 136 - 44799 Bochum, Germany
www.femtos.de

4.5 mm x 15 mm
Stent Ø Stent Length

ID 0.0165" 3.50-4.50 mm
Microcatheter Vessel Ø

HPC - Hydrophilic Polymer Coating

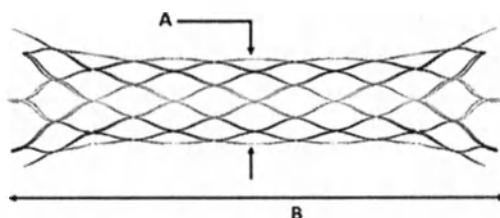

A: Stent Diameter unconstrained	B: Stent Length	max. Catheter Length	Microcatheter Compatibility	Stent Surface	Min. Vessel Diameter	Max. Vessel Diameter
5.0 mm	15 mm	150cm	0.0165" (0.42mm) 0.0170" (0.43mm)	HPC	3.50 mm	4.50 mm

REF PEGASUS-450-15-HPC

LOT 123456

EXP 2024-00-00

CONT 1x pEGASUS HPC

pEGASUS HPC **REF** PEGASUS-450-15-HPC

LOT 123456



(01)04270001836441(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-450-15-HPC
LOT 123456 **EXP** 2024-00-00
(01)04270001836441(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-450-15-HPC
LOT 123456 **EXP** 2024-00-00
(01)04270001836441(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-450-15-HPC
LOT 123456 **EXP** 2024-00-00
(01)04270001836441(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-450-15-HPC
LOT 123456 **EXP** 2024-00-00
(01)04270001836441(17)240000(10)123456




Do not reuse



Do not use



NiTi



Sterilized with Ethylene Oxide Gas



Consult instructions for use



Caution



Do not touch



Keep dry



Keep away from sunlight



Do not use if the packaging is damaged



Do not resterilize



Non-pyrogenic

LAB_100418-000-000

pEGASUS HPC Stent System

4.5 mm x 15 mm



REF PEGASUS-450-15-HPC

LOT 123456

EXP 2024-00-00

pEGASUS HPC Stent System

PEGASUS-350-30-HPC

Stentsystem, Stent System, Sistema de stent, Système de stent, Sistema di stent, Stentsysteem, СТЕНТ-СИСТЕМА, Stent-system, Stent Sistemi


Distributed by:
phenox GmbH
Lise-Meitner-Allee 31 - 44801 Bochum, Germany
Tel: +49 (0) 234 / 36919-0 - Fax: +49 (0) 234 / 36919-19
www.phenox.net

femtos GmbH
Universitätsstraße 136 - 44799 Bochum, Germany
www.femtos.de

3.5 mm x 30 mm
Stent Ø Stent Length

ID 0.0165" 2.50-3.50 mm
Microcatheter Vessel Ø

HPC - Hydrophilic Polymer Coating

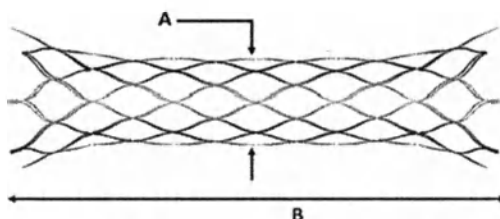

A: Stent Diameter unconstrained	B: Stent Length	max. Catheter Length	Microcatheter Compatibility	Stent Surface	Min. Vessel Diameter	Max. Vessel Diameter
4.0 mm	30 mm	150cm	0.0165" (0.42mm) 0.0170" (0.43mm)	HPC	2.50 mm	3.50 mm

REF PEGASUS-350-30-HPC

LOT 123456

2024-00-00

CONT 1x pEGASUS HPC

pEGASUS HPC REF PEGASUS-350-30-HPC

LOT 123456



(01)04270000054181(17)240000(10)123456

MD
Medical Device

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de
REF PEGASUS-350-30-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054181(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de
REF PEGASUS-350-30-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054181(17)240000(10)123456

CE
0297

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de
REF PEGASUS-350-30-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054181(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de
REF PEGASUS-350-30-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054181(17)240000(10)123456



LAB_100418-000-000

pEGASUS HPC Stent System

3.5 mm x 30 mm



REF PEGASUS-350-30-HPC

LOT 123456

2024-00-00

PEGASUS HPC Stent System

PEGASUS-350-25-HPC

Stent System, Stent System, Sistema de stent, Système de stent, Sistema di stent, Stentsystem, Стент-система, Stent System, Stent System


Distributed by:
phenox GmbH
Lise-Meitner-Allee 31 - 44801 Bochum, Germany
Tel: +49 (0) 234 / 36919-0 - Fax: +49 (0) 234 / 36919-19
www.phenox.net

femtos GmbH
Universitätsstraße 136 - 44799 Bochum, Germany
www.femtos.de

3.5 mm x 25 mm
Stent Ø Stent Length

ID 0.0165" 2.50-3.50 mm
Microcatheter Vessel Ø

HPC - Hydrophilic Polymer Coating

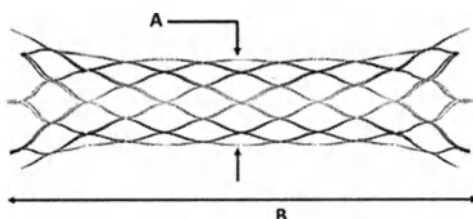

A: Stent Diameter unconstrained	B: Stent Length	max. Catheter Length	Microcatheter Compatibility	Stent Surface	Min. Vessel Diameter	Max. Vessel Diameter
4.0 mm	25 mm	150cm	0.0165" (0.42mm) 0.0170" (0.43mm)	HPC	2.50 mm	3.50 mm

REF PEGASUS-350-25-HPC

LOT 123456

2024-00-00

CONT 1x pPEGASUS HPC

pPEGASUS HPC REF PEGASUS-350-25-HPC

LOT 123456



(01)04270000054174(17)240000(10)123456

pPEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-350-25-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054174(17)240000(10)123456

pPEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-350-25-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054174(17)240000(10)123456

pPEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-350-25-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054174(17)240000(10)123456

pPEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-350-25-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054174(17)240000(10)123456

MD

CE 0297



LAB_100418-000-000

pPEGASUS HPC Stent System

3.5 mm x 25 mm



REF PEGASUS-350-25-HPC

LOT 123456

2024-00-00

PEGASUS HPC Stent System

PEGASUS-350-15-HPC

Stent System, Sistema de stent, Système de stent, Sistema di stent, Stentsystem, Стент-система, Stent System


Distributed by:
phenox GmbH
Lise-Meitner-Allee 31 - 44801 Bochum, Germany
Tel. +49 (0) 234 / 36919-0 - Fax: +49 (0) 234 / 36919-19
www.phenox.net

femtos GmbH
Universitätsstraße 136 - 44799 Bochum, Germany
www.femtos.de

3.5 mm x 15 mm
Stent Ø Stent Length

ID 0.0165" 2.50-3.50 mm
Microcatheter Vessel Ø

HPC - Hydrophilic Polymer Coating

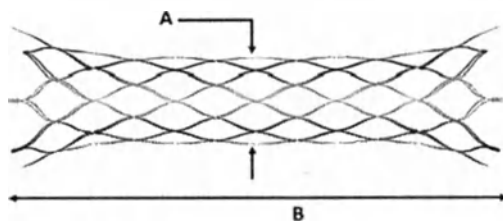

A: Stent Diameter unconstrained	B: Stent Length	max. Catheter Length	Microcatheter Compatibility	Stent Surface	Min. Vessel Diameter	Max. Vessel Diameter
4.0 mm	15 mm	150cm	0.0165" (0.42mm) 0.0170" (0.43mm)	HPC	2.50 mm	3.50 mm

REF PEGASUS-350-15-HPC

LOT 123456

2024-00-00

CONT 1x pEGASUS HPC

pEGASUS HPC REF PEGASUS-350-15-HPC

LOT 123456



(01)04270000054150(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-350-15-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054150(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-350-15-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054150(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-350-15-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054150(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de

REF PEGASUS-350-15-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270000054150(17)240000(10)123456



LAB_100418-000-000

pEGASUS HPC Stent System
3.5 mm x 15 mm



REF PEGASUS-350-15-HPC
LOT 123456 2024-00-00

PEGASUS HPC Stent System

PEGASUS-450-30-HPC

Stentsystem, Stent System, Sistema de stent, Système de stent, Sistema di stent, Stentsysteem, СТЕНТ-СИСТЕМА, Stent-system, Stent Sistemi


Distributed by:
phenox GmbH
Lise-Meitner-Allee 31 - 44801 Bochum, Germany
Tel: +49 (0) 234 / 36919-0 - Fax: +49 (0) 234 / 36919-19
www.phenox.net

femtos GmbH
Universitätsstraße 136 - 44799 Bochum, Germany
www.femtos.de

4.5 mm x 30 mm
Stent Ø Stent Length

ID 0.0165" 3.50-4.50 mm
Microcatheter Vessel Ø

HPC - Hydrophilic Polymer Coating

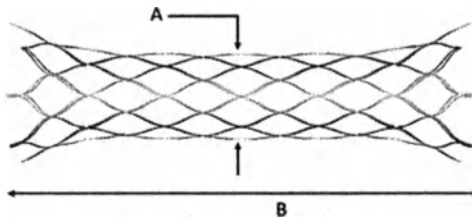

A: Stent Diameter unconstrained	B: Stent Length	max. Catheter Length	Microcatheter Compatibility	Stent Surface	Min. Vessel Diameter	Max. Vessel Diameter
5.0 mm	30 mm	150cm	0.0165" (0.42mm) 0.0170" (0.43mm)	HPC	3.50 mm	4.50 mm

REF PEGASUS-450-30-HPC

LOT 123456

2024-00-00

CONT 1x pEGASUS HPC

pEGASUS HPC REF PEGASUS-450-30-HPC

LOT 123456



(01)04270001836472(17)240000(10)123456



pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de
REF PEGASUS-450-30-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270001836472(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de
REF PEGASUS-450-30-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270001836472(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de
REF PEGASUS-450-30-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270001836472(17)240000(10)123456

pEGASUS HPC femtos GmbH: www.femtos.de
REF PEGASUS-450-30-HPC
LOT 123456 2024-00-00
(01)04270001836472(17)240000(10)123456




No sharp



No latex



NiTi



Sterilized with Ethylene Oxide Gas



Consult instructions for use



Caution



Do not reuse



Keep dry



Keep away from sunlight



Do not use if the packaging is damaged



Do not resterilize



Non-sterile

LAB_100418-000-000

pEGASUS HPC Stent System

4.5 mm x 30 mm



REF PEGASUS-450-30-HPC

LOT 123456

2024-00-00

Наименование: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга rEGASUS HPC, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга rEGASUS 350-15 HPC размером: 3,5 мм x 15 мм, в составе:

- 1.1. Саморасширяющийся стент - 1 шт.
- 1.2. Система доставки с рабочей длиной 1990 мм, в составе: Проводник наружный диаметр 0,35 мм – 1 шт.; интродьюсер, внутренний диаметр 0,43 мм; внешний диаметр 0,69 мм; длина 500 мм – 1 шт.
- 1.3. Инструкция по применению – 1 шт.
- 1.4. Карта имплантации стента – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский д. 39, к. 2, кв. 10

Тел.: + 7 (495) 609-41-15, +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com

Нетоксично. Апирагенно.

Наименование: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга rEGASUS HPC, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга rEGASUS 350-20 HPC размером: 3,5 мм x 20 мм, в составе:

- 1.1. Саморасширяющийся стент - 1 шт.
- 1.2. Система доставки с рабочей длиной 1990 мм, в составе: Проводник наружный диаметр 0,35 мм – 1 шт.; интродьюсер, внутренний диаметр 0,43 мм; внешний диаметр 0,69 мм; длина 500 мм – 1 шт.
- 1.3. Инструкция по применению – 1 шт.
- 1.4. Карта имплантации стента – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский д. 39, к. 2, кв. 10

Тел.: + 7 (495) 609-41-15, +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com

Нетоксично. Апирагенно.

Вариант исполнения: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга rEGASUS 350-25 НРС размером: 3,5 мм х 25 мм, в составе:

- 1.1. Саморасширяющийся стент - 1 шт.
- 1.2. Система доставки с рабочей длиной 1990 мм, в составе: Проводник наружный диаметр 0,35 мм – 1 шт.; интродьюсер, внутренний диаметр 0,43 мм; внешний диаметр 0,69 мм; длина 500 мм – 1 шт.
- 1.3. Инструкция по применению – 1 шт.
- 1.4. Карта имплантации стента – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский д. 39, к. 2, кв. 10

Тел.: + 7 (495) 609-41-15, +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com

Нетоксично. Апирагенно.

Наименование: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга rEGASUS НРС, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга rEGASUS 350-30 НРС размером: 3,5 мм х 30 мм, в составе:

- 1.1. Саморасширяющийся стент - 1 шт.
- 1.2. Система доставки с рабочей длиной 1990 мм, в составе: Проводник наружный диаметр 0,35 мм – 1 шт.; интродьюсер, внутренний диаметр 0,43 мм; внешний диаметр 0,69 мм; длина 500 мм – 1 шт.
- 1.3. Инструкция по применению – 1 шт.
- 1.4. Карта имплантации стента – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский д. 39, к. 2, кв. 10

Тел.: + 7 (495) 609-41-15, +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com

Нетоксично. Апирагенно.

Наименование: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга rEGASUS HPC, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга rEGASUS 450-15 HPC размером: 4,5 мм x 15 мм, в составе:

- 1.1. Саморасширяющийся стент - 1 шт.
- 1.2. Система доставки с рабочей длиной 1990 мм, в составе: Проводник наружный диаметр 0,35 мм – 1 шт.; интродьюсер, внутренний диаметр 0,43 мм; внешний диаметр 0,69 мм; длина 500 мм – 1 шт.
- 1.3. Инструкция по применению – 1 шт.
- 1.4. Карта имплантации стента – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский д. 39, к. 2, кв. 10

Тел.: + 7 (495) 609-41-15, +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com

Нетоксично. Апирагенно.

Наименование: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга rEGASUS HPC, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга rEGASUS 450-20 HPC размером: 4,5 мм x 20 мм, в составе:

- 1.1. Саморасширяющийся стент - 1 шт.
- 1.2. Система доставки с рабочей длиной 1990 мм, в составе: Проводник наружный диаметр 0,35 мм – 1 шт.; интродьюсер, внутренний диаметр 0,43 мм; внешний диаметр 0,69 мм; длина 500 мм – 1 шт.
- 1.3. Инструкция по применению – 1 шт.
- 1.4. Карта имплантации стента – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский д. 39, к. 2, кв. 10

Тел.: + 7 (495) 609-41-15, +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com

Нетоксично. Апирагенно.

Наименование: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга pEGASUS HPC, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга pEGASUS 450-25 HPC размером: 4,5 мм x 25 мм, в составе:

1.1. Саморасширяющийся стент - 1 шт.

1.2. Система доставки с рабочей длиной 1990 мм, в составе: Проводник наружный диаметр 0,35 мм – 1 шт.; интродьюсер, внутренний диаметр 0,43 мм; внешний диаметр 0,69 мм; длина 500 мм – 1 шт.

1.3. Инструкция по применению – 1 шт.

1.4. Карта имплантации стента – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский д. 39, к. 2, кв. 10

Тел.: + 7 (495) 609-41-15, +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com

Нетоксично. Апирагенно.

Наименование: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга pEGASUS HPC, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения: Стент-система эндоваскулярная для сосудов головного мозга pEGASUS 450-30 HPC размером: 4,5 мм x 30 мм, в составе:

1.1. Саморасширяющийся стент - 1 шт.

1.2. Система доставки с рабочей длиной 1990 мм, в составе: Проводник наружный диаметр 0,35 мм – 1 шт.; интродьюсер, внутренний диаметр 0,43 мм; внешний диаметр 0,69 мм; длина 500 мм – 1 шт.

1.3. Инструкция по применению – 1 шт.

1.4. Карта имплантации стента – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Ответственный уполномоченный представитель в РФ:

ООО «РЕГИКОМ»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский д. 39, к. 2, кв. 10

Тел.: + 7 (495) 609-41-15, +7 (926) 385-56-11; e-mail: e.safety@regicompany.com

Нетоксично. Апирагенно.

Прошито и пронумеровано
22 листов

Генеральный директор
И. Козлов

