

Внешний вид «Набор реагентов для количественного определения D-димера в плазме крови (Тех-D-димер-авто) по ТУ 21.20.23-076-42349142-2018» Комплектация № 1

Серия №
Годен до
Дата
использования

11905002
11 2019
05 2018

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ТЕХ-D-ДИМЕР-AВТО

Хранить
при +2...+8 °С

100-250

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ D-ДИМЕРА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

ООО фирма «Технология-Стандарт»
а/я 1351 г.Барнаул, Алтайский край, 656037
Тел.факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-01, 22-99-37


ПАСПОРТ № 819

Набор реагентов для количественного определения D-димера в плазме крови
(Тех-D-димер-авто)

ТУ 21.20.23-076-42349142-2018

Серия Д805002

Годен до 11.2019

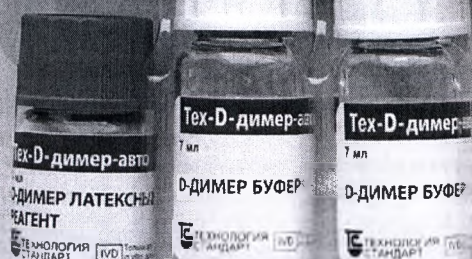


Тех-D-димер-авто

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для количественного определения D-димера
в плазме крови

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»  А.П. Момот



Внешний вид «Набор реагентов для количественного определения D-димера в плазме крови (Тех-D-димер-авто) по ТУ 21.20.23-076-42349142-2018» Комплектация № 2

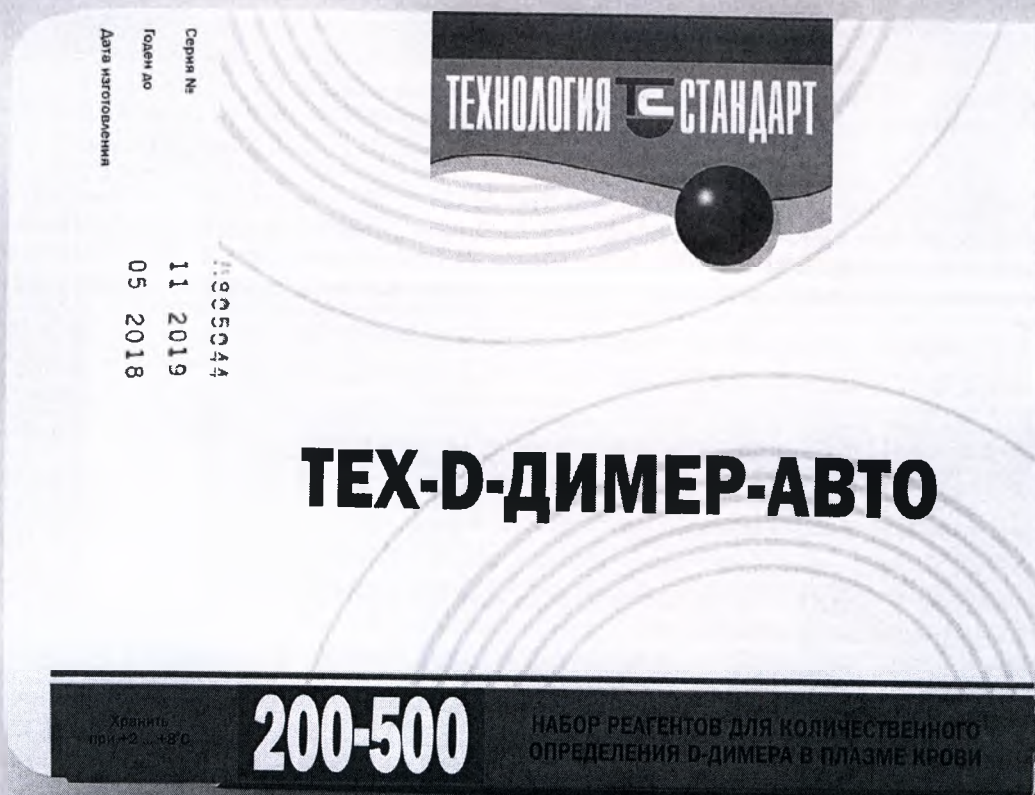

ООО фирма «Технология-Стандарт»
а/я 1351 г. Барнаул, Алтайский край, 656037
Тел. факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-01, 22-99-37

ПАСПОРТ № 821

Набор реагентов для количественного определения D-димера в плазме крови
(Тех-D-димер-авто)
ТУ 21.20.23-076-42349142-2018

Идентификация Д805004

Годен до 11.2019



Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

Момот



Внешний вид «Набор реагентов для количественного определения D-димера в плазме крови (Тех-D-димер-авто) по ТУ 21.20.23-076-42349142-2018» Комплектация № 3

Дата изготовления

Годен до

Серия №

11 2019
05 2018
11905005

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ТЕХ-D-ДИМЕР-AВТО

Хранить при +2...+8 °С

350-1000

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ D-ДИМЕРА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

ООО фирма «Технология-Стандарт»

г. Барнаул, Алтайский край, 656037
Тел./факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-01, 22-99-37

ПАСПОРТ № 809

Набор реагентов для количественного определения D-димера в плазме крови
(Тех-D-димер-авто)

ТУ 21.20.23-076-42349142-2018


Д805006

Годен до 11.2019



Тех-D-димер-авто

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для количественного определения D-димера
в плазме крови

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»  А.Г. Момот



Внешний вид «Набор реагентов для количественного определения D-димера в плазме крови (Тех-D-димер-авто) по ТУ 21.20.23-076-42349142-2018» Комплектация № 4

Серия №
1025008
Годен до
11 2019
Дата
изготовления
05 2018

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ТЕХ-D-ДИМЕР-AВТО

Хранить
при +2...+8°C

100-250

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ D-ДИМЕРА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

ООО фирма «Технология-Стандарт»
а/я 1351 г.Барнаул, Алтайский край, 656037
Тел.факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-01, 22-99-37

ПАСПОРТ № 820

Набор реагентов для количественного определения D-димера в плазме крови
(Тех-D-димер-авто)

ТУ 21.20.23-076-42349142-2018

Серия Д805008

Годен до 11.2019



Тех-D-димер-авто

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для количественного определения D-димера
в плазме крови

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»  А.П. Момот



Внешний вид «Набор реагентов для количественного определения D-димера в плазме крови (Тех-D-димер-авто) по ТУ 21.20.23-076-42349142-2018» Комплектация № 5

Серия №
Годен до
Дата изготовления

11805010
11 2019
05 2018

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ТЕХ-D-ДИМЕР-AВТО

200-500

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ D-ДИМЕРА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

ООО фирма «Технология-Стандарт»

а/л 1351 г.Барнаул, Алтайский край, 656037

Тел.факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-01, 22-99-37

ПАСПОРТ № 822

Набор реагентов для количественного определения D-димера в плазме крови
(Тех-D-димер-авто)

ТУ 21.20.23-076-42349142-2018

Серия D805010

Годен до 11.2019



Тех-D-димер-авто

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для количественного определения D-димера
в плазме крови

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот




Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов
Руководитель *И.И. Мухомов*
23 » октября 2018 г.




Макет этикеток медицинского изделия «Набор реагентов для количественного определения D-димера в плазме крови (Тех-D-димер-авто) по ТУ 21.20.23-076-42349142-2018».

Комплектация № 1


Макет этикетки реагента «D-димер латексный реагент»

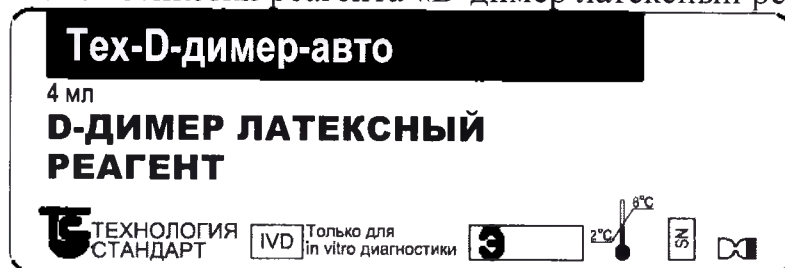


Макет этикетки реагента «D-димер буфер»

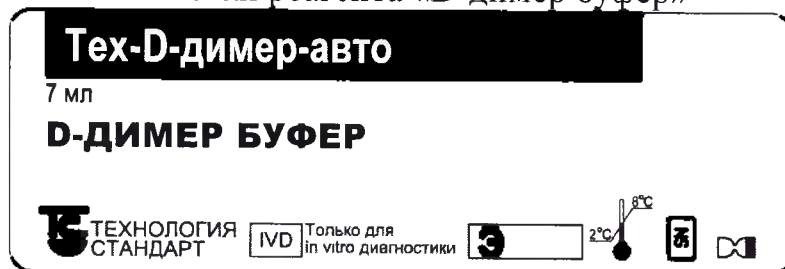

Макет этикетки реагента «D-димер дилуэнт»

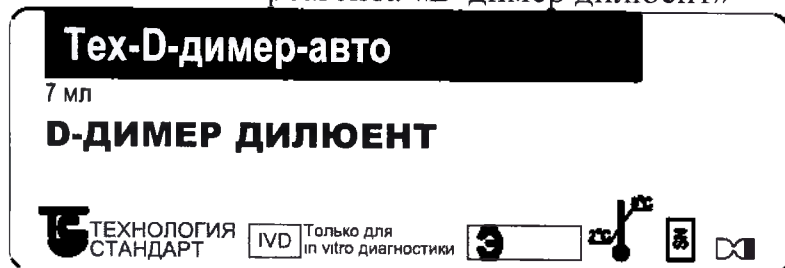


Макет этикетки реагента «D-димер калибратор»

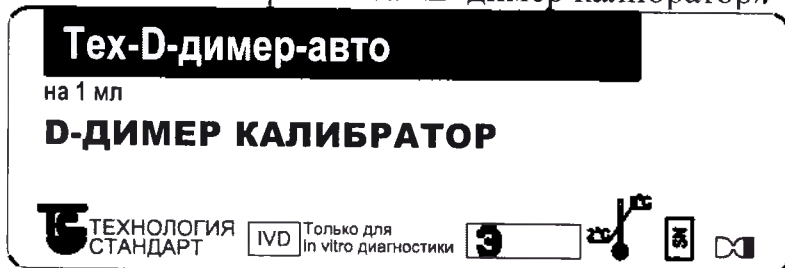


Комплектация № 2


Макет этикетки реагента «D-димер латексный реагент»

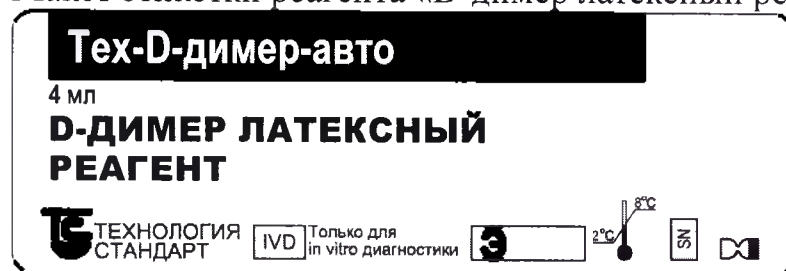


Макет этикетки реагента «D-димер буфер»

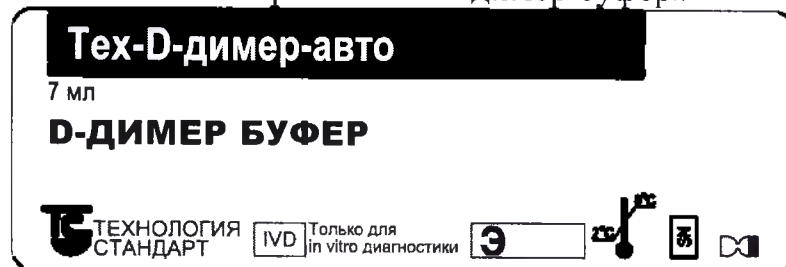

Макет этикетки реагента «D-димер дилуэнт»

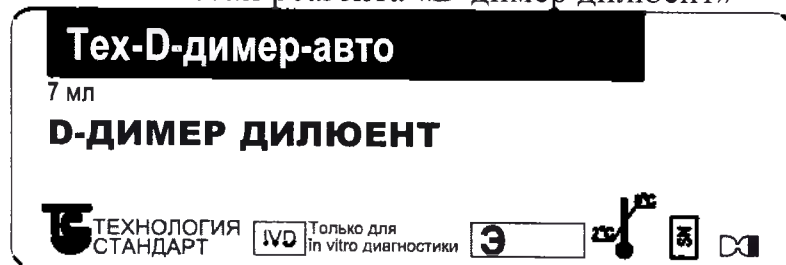


Макет этикетки реагента «D-димер калибратор»

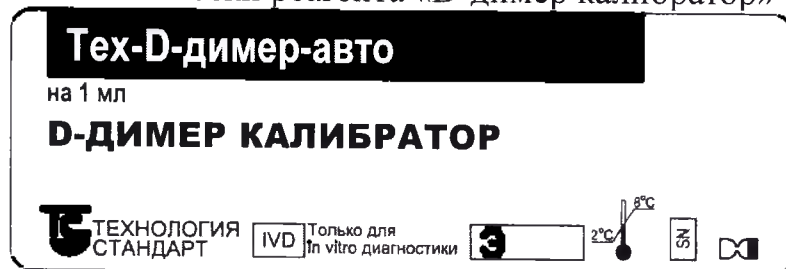


Комплектация № 3


Макет этикетки реагента «D-димер латексный реагент»

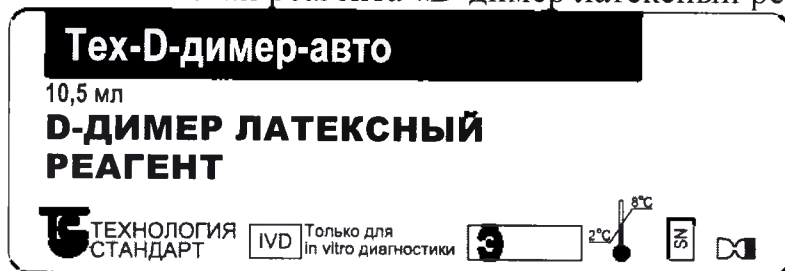


Макет этикетки реагента «D-димер буфер»

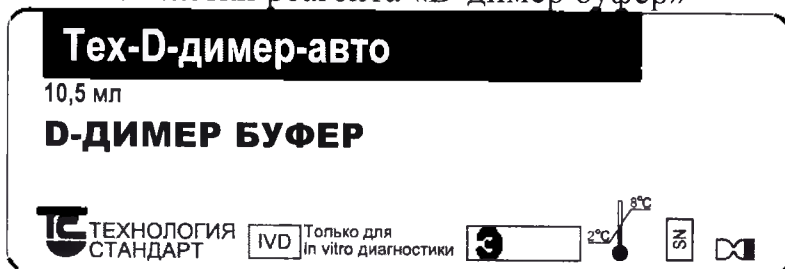

Макет этикетки реагента «D-димер дилуэнт»

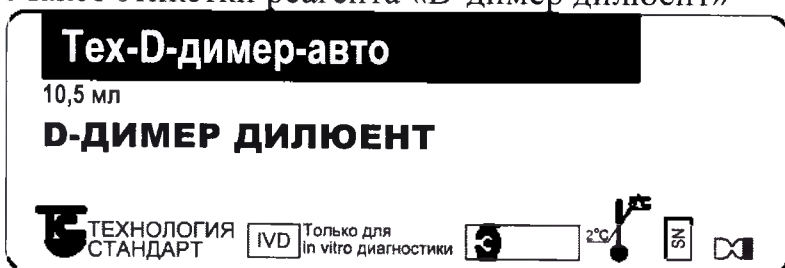


Макет этикетки реагента «D-димер калибратор»

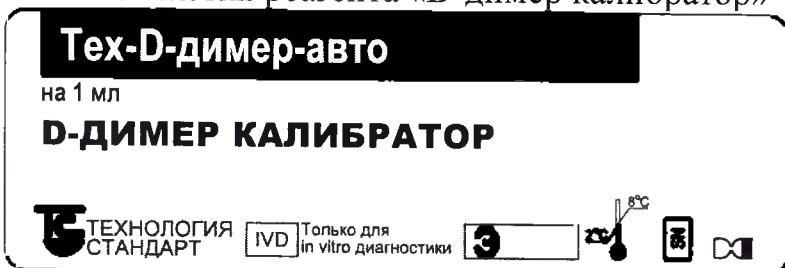


Комплектация № 4


Макет этикетки реагента «D-димер латексный реагент»

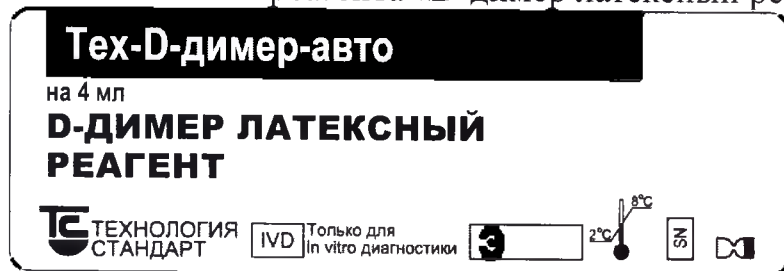


Макет этикетки реагента «D-димер буфер»

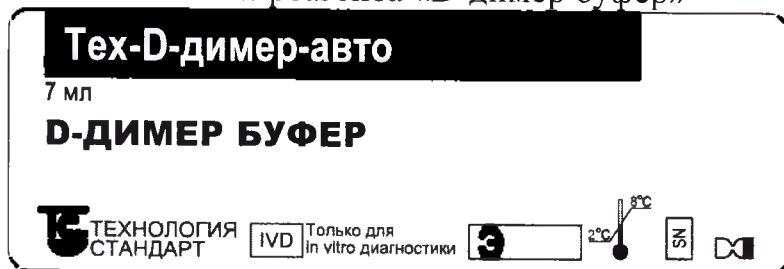

Макет этикетки реагента «D-димер дилуэнт»

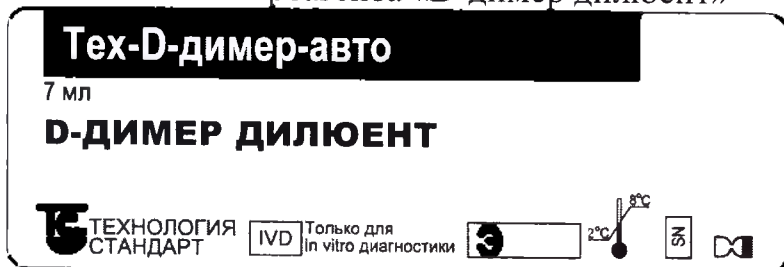


Макет этикетки реагента «D-димер калибратор»

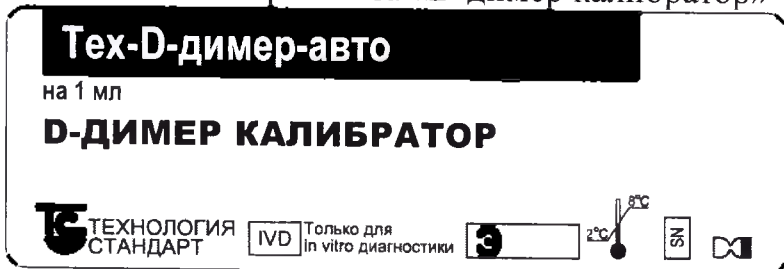


Комплектация № 5


Макет этикетки реагента «D-димер латексный реагент»

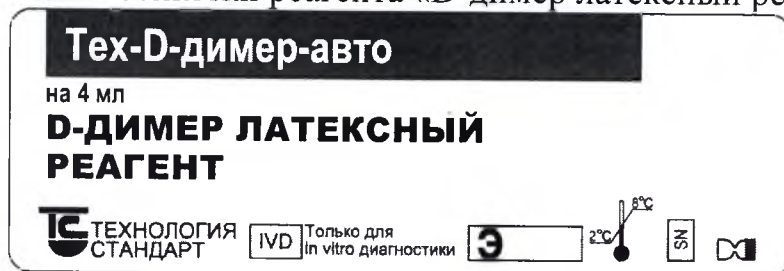


Макет этикетки реагента «D-димер буфер»

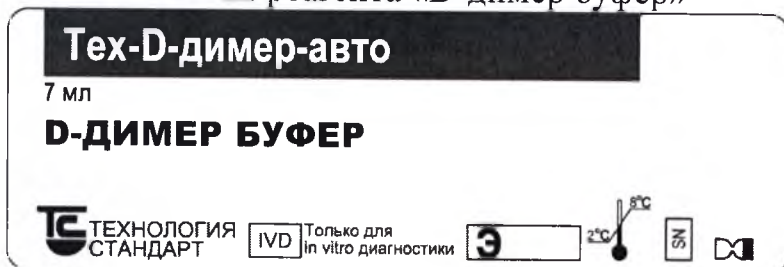

Макет этикетки реагента «D-димер дилуэнт»

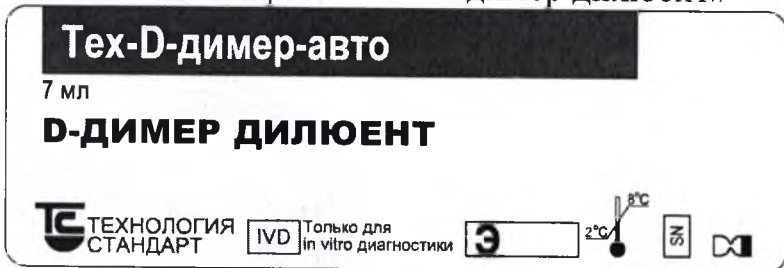

Макет этикетки реагента «D-димер калибратор»

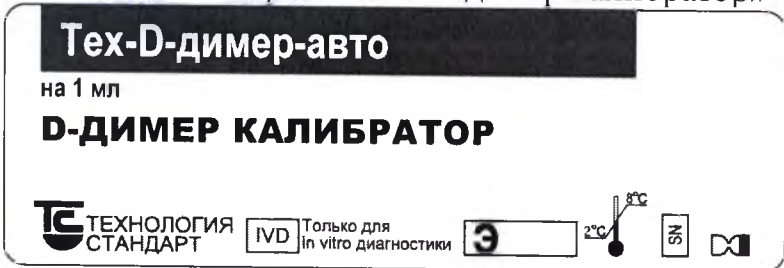

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



5 (28 см)
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (28 см) листов
Руководитель *А.В. Мещеряков*
«23» *августа* 20 *18* г.

