


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2021 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор реагентов для определения активности фактора VIII в плазме
крови (Тех-Фактор VIII-тест)» по ТУ 21.20.23-111-42349142-2021**

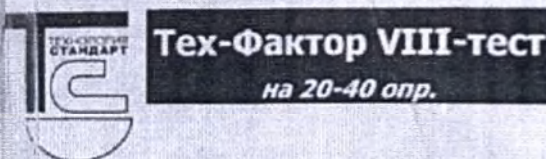

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для определения активности фактора VIII
в плазме крови
(Тех-Фактор VIII-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения активности фактора VIII в плазме крови (Тех-Фактор VIII-тест) предназначен для определения активности коагуляционного фактора VIII (FVIII) в плазме крови. Определение фактора VIII используется для диагностики гемофилии А, контроля заместительной терапии




ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 274
набора реагентов для определения активности фактора VIII
в плазме крови
(Тех-Фактор VIII-тест)
ТУ 21.20.23-111-42349142-2021

Серия E218012

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Дефицитная по фактору VIII плазма (внешний)	Пористая масса	Пористая масса

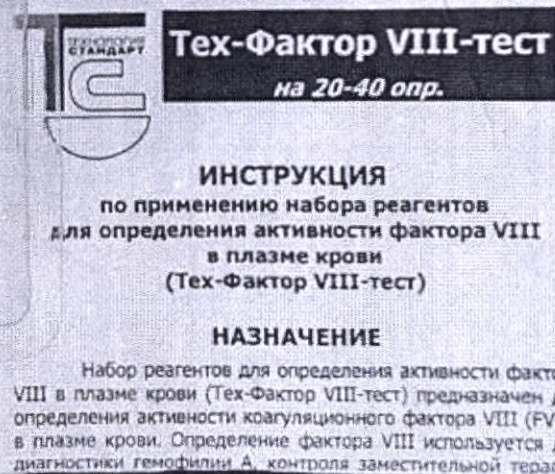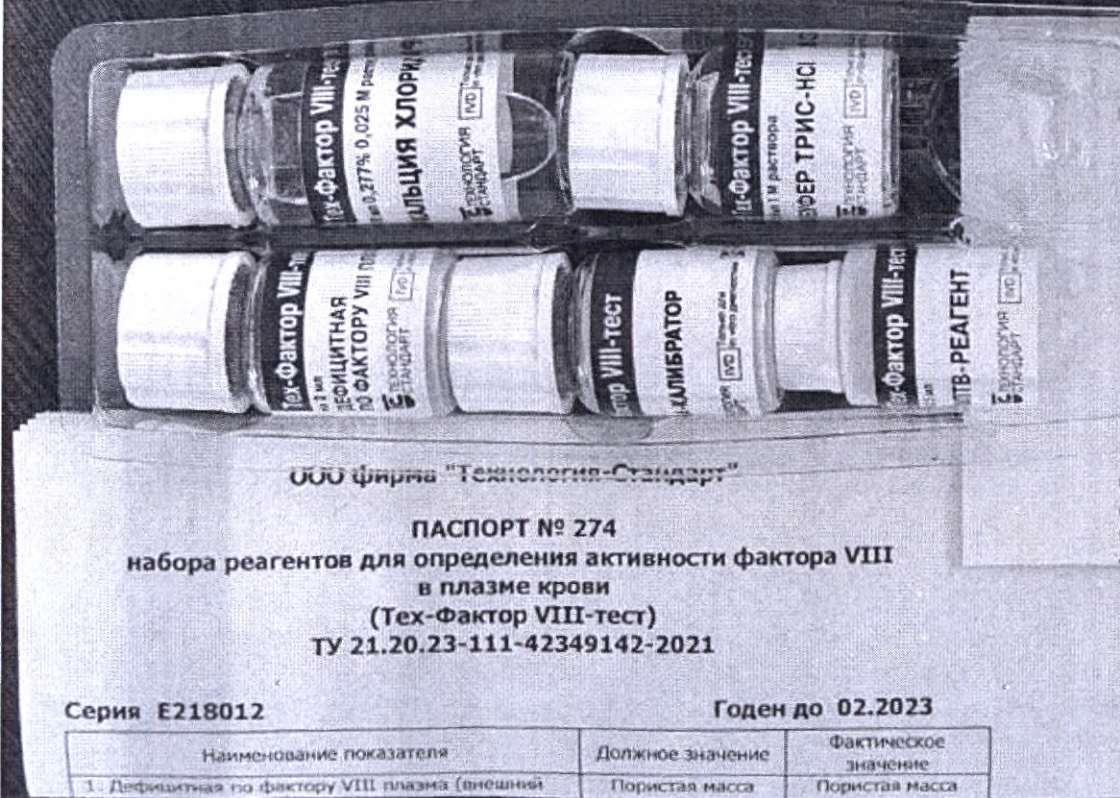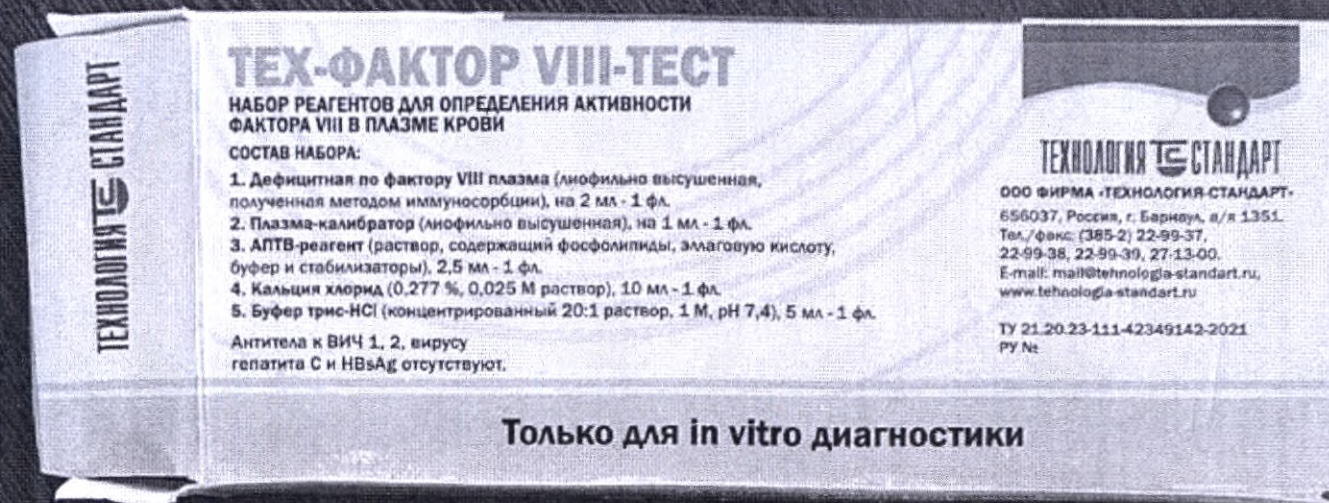

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3

(три) листов

10 октября 2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

