

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

Аппарат для автоматизированного перитонеального диализа NOVADIAL

производства

Jiangsu JARI Medical Technology Co., Ltd.
(Цзянсу ДЖАРИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)

УТВЕРЖДАЮ

НЕПОМНЯЩАЯ Е.В.
по доверенности № 03/ИД
от 08.07.2024 г.

Генеральный директор ООО «Новадиял»
Катаев А.Н.

« 26 » ноября 2024 г.



Аппарат для автоматизированного перитонеального диализа NOVADIAL (вид спереди)



Аппарат для автоматизированного перитонеального диализа NOVADIAL (вид сзади)



Кабель электропитания - 1 шт.




Карта активации - 1 шт.



Предохранитель - 2 шт.



Макет маркировки Аппарата для автоматизированного перитонеального диализа NOVADIAL (на корпусе)

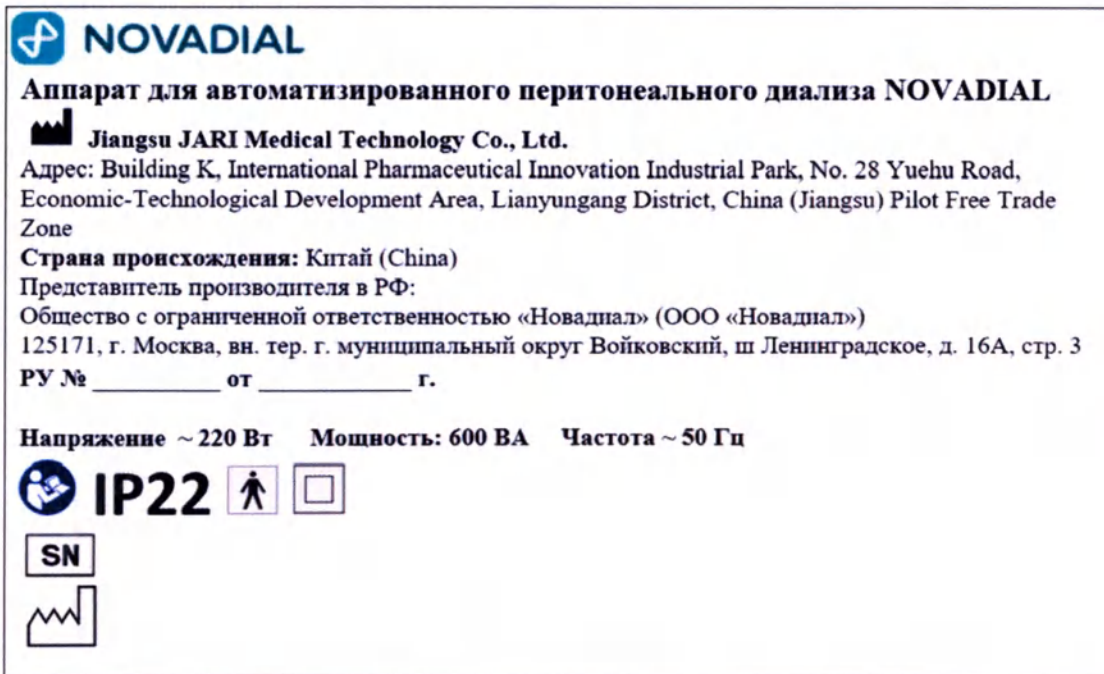

Макет маркировки транспортной упаковки Аппарата для автоматизированного перитонеального диализа NOVADIAL

**Аппарат для автоматизированного перитонеального диализа NOVADIAL****Jiangsu JARI Medical Technology Co., Ltd.**

Адрес: Building K, International Pharmaceutical Innovation Industrial Park, No. 28 Yuehu Road,
Economic-Technological Development Area, Lianyungang District, China (Jiangsu) Pilot Free Trade
Zone

Страна происхождения: Китай (China)**Представитель производителя в РФ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Новадиял» (ООО «Новадиял»)

125171, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ш Ленинградское, д. 16А, стр. 3


РУ № _____ **от** _____ **г.****Количество:** 1 шт.**Напряжение** ~ 220 Вт **Мощность:** 600 ВА **Частота** ~ 50 Гц**IP22****Климатические условия транспортировки и хранения:**

Температура: от -40 °С до +70 °С

Относительная влажность: от 10 % до 100 % (включая конденсат)

SN

Аппарат для автоматизированного перитонеального диализа NOVADIAL (транспортная упаковка)

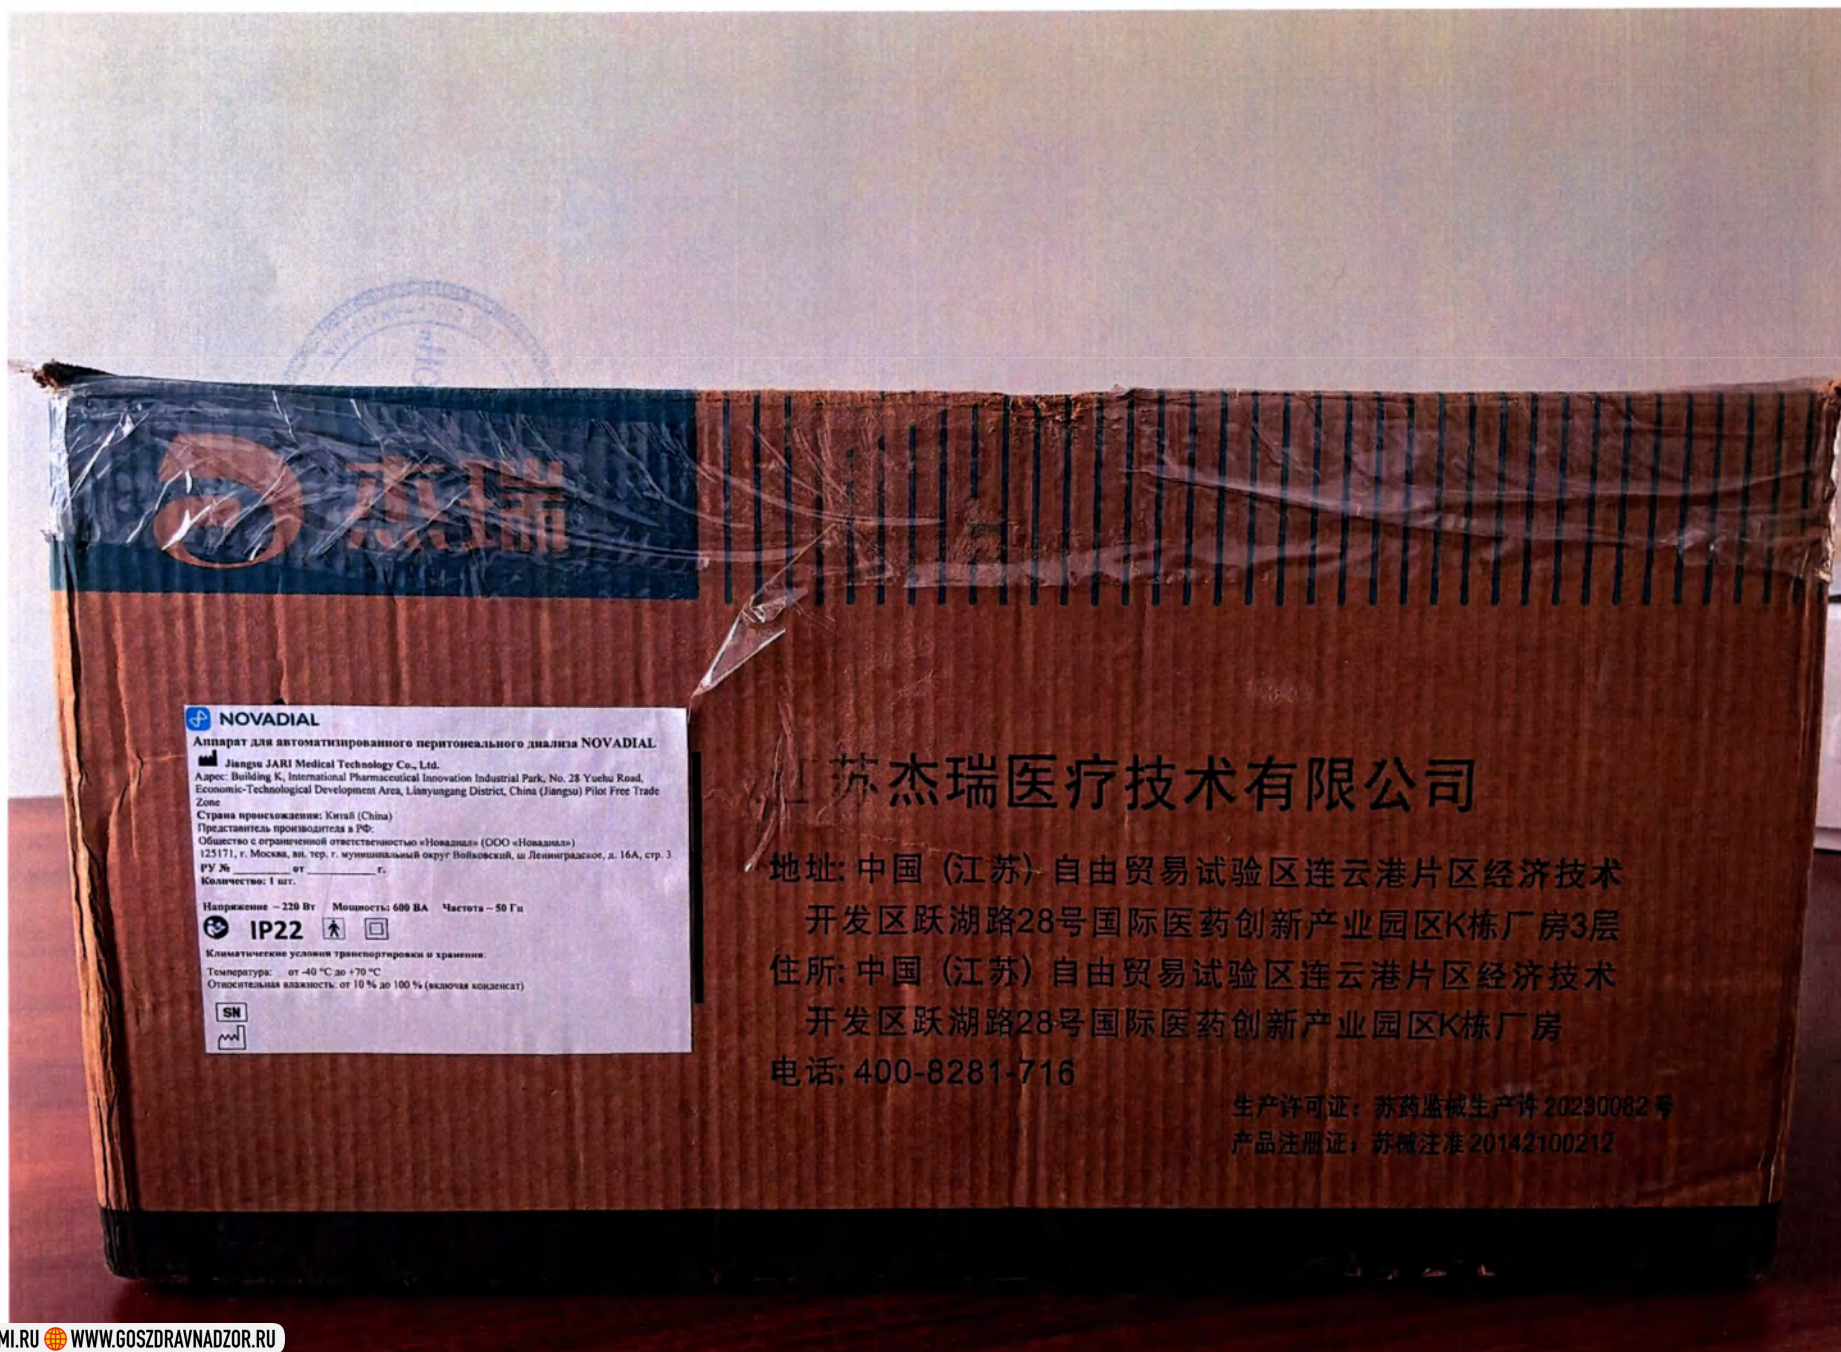

НЕПОМНЯЩАЯ Е.В.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 03/НЛ
ОТ 08.07.2024 Г.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 9 листов
Генеральный директор ООО «Новадиял»

Катаев А.Н.

Дата 16.11.2024

