

# «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС» ООО

«COMEN MEDICAL RUS» LLC Russia, Moscow

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 52, стр. 3, офис 401, E-mail: Andrew.s@szcomen.com, тел. +7(900)645-69-61

## Фотографические изображения медицинского изделия *Видеопроцессор медицинского эндоскопа, в вариантах исполнения*

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»

Шварёв А.В.

«28» \_\_\_\_\_ 2024 г.








Видеопроцессор EIS-2000U (вид спереди)




Видеопроцессор EIS-2000Pro (вид спереди)







**Видеопроцессор EIS-2000S (вид спереди)**



Видеопроцессор EIS-2000X (вид-спереди)



Видеопроцессор медицинского эндоскопа, в вариантах исполнения (вид сзади)

SN


 SNMMDDYYNNN  
 DD-MM-YYYY

COMEN

## Видеопроцессор медицинского эндоскопа

Вариант исполнения :

EIS-2000C

Номинальное входное напряжение:

100- 240В~

Номинальная частота:

50/60Гц

Номинальный входной ток:

0.5-0.2A

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXXг.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:


ООО "КОМЕН МЕДИКАЛ РУС", РОССИЯ,

117342, Г. МОСКВА, ВЛ. ТЕР. 1, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 52.


Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

 Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building  
 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District,  
 Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R. China

Tel: +86-0755-26431236



Макет маркировки видеопроцессора на примере Варианта исполнения: «Видеопроцессор EIS-2000U»

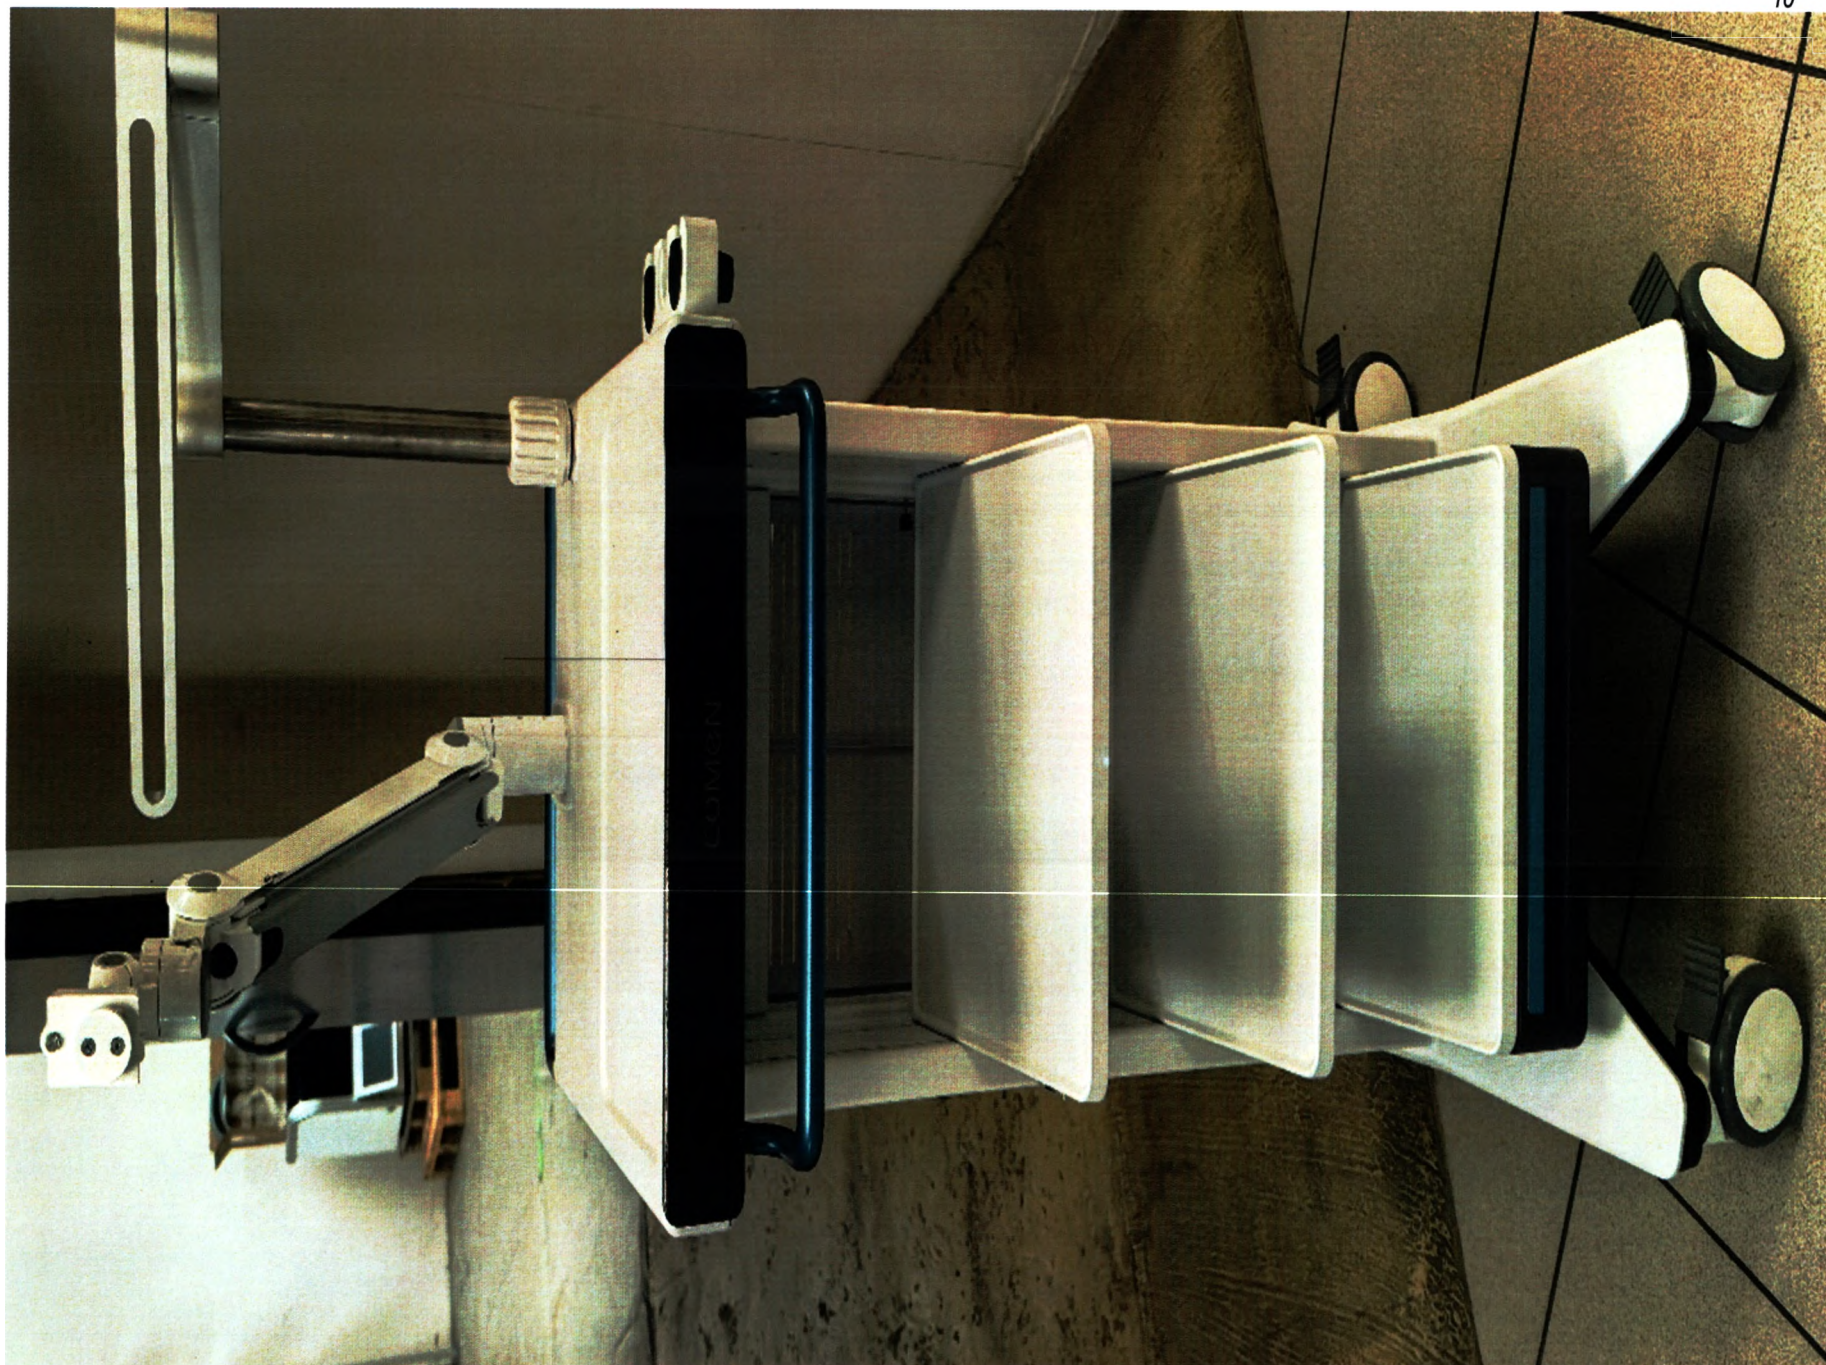

Тележка эндоскопическая ETL-2000

# COMEN

**LOT**

ET1220927001

**REF**

115-00006229-00



27.09.2022

**Тележка эндоскопическая ETL-2000**
**Масса нетто: 82 кг**

 Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. (Шэньчжэнь Комен  
Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

 Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to  
Floor 5 of Buildings 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,  
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106,  
P.R.China.

Уполномоченный представитель на территории РФ:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ  
РУС»**
**(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)**

 Адрес: 117342, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
КОНЬКОВО, УЛ ОБРУЧЕВА, Д. 52, СТР. 3

Номера телефонов: +7(900)645-69-61

Регистрационное удостоверение №



Транспортная упаковка тележки эндоскопической ETL-2000

Тележка эндоскопическая ETL-2000

# COMEN

Размеры: 184 см (длина) x 75 см (ширина) x 75 см (высота)

Вес нетто: 82 кг Вес брутто: 114 кг Количество в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R.China, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной ответственностью «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС» (ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС») 117342, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, УЛ ОБРУЧЕВА, Д. 52, СТР. 3




SN



EL1220928005



28.09.2022



O/N:




12345678

P/N:



12345678


Маркировка транспортной упаковки тележки эндоскопической ETL-2000

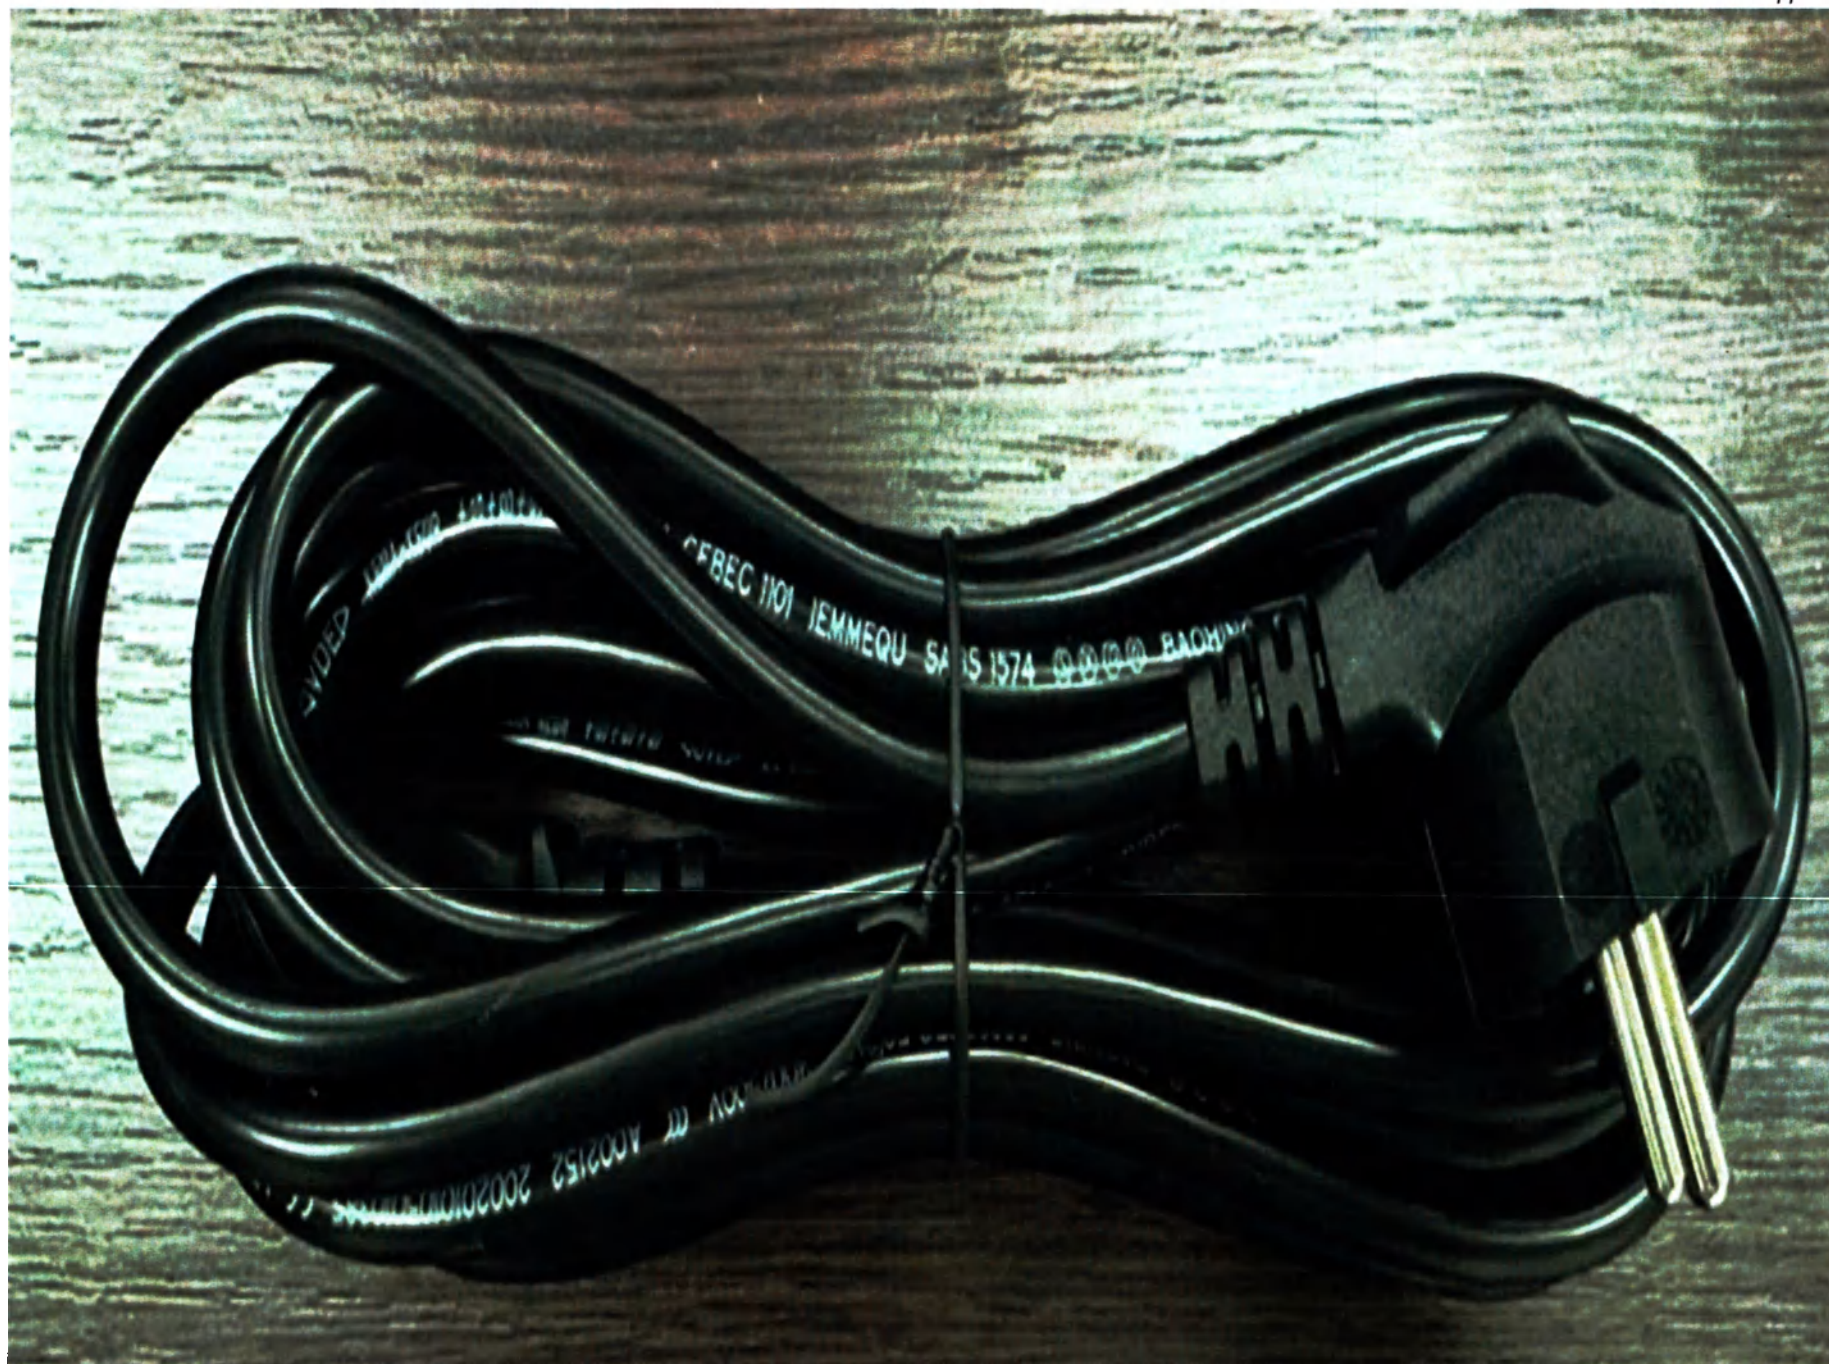

Шнур питания (Общий вид)



Шнур питания (Маркировка)

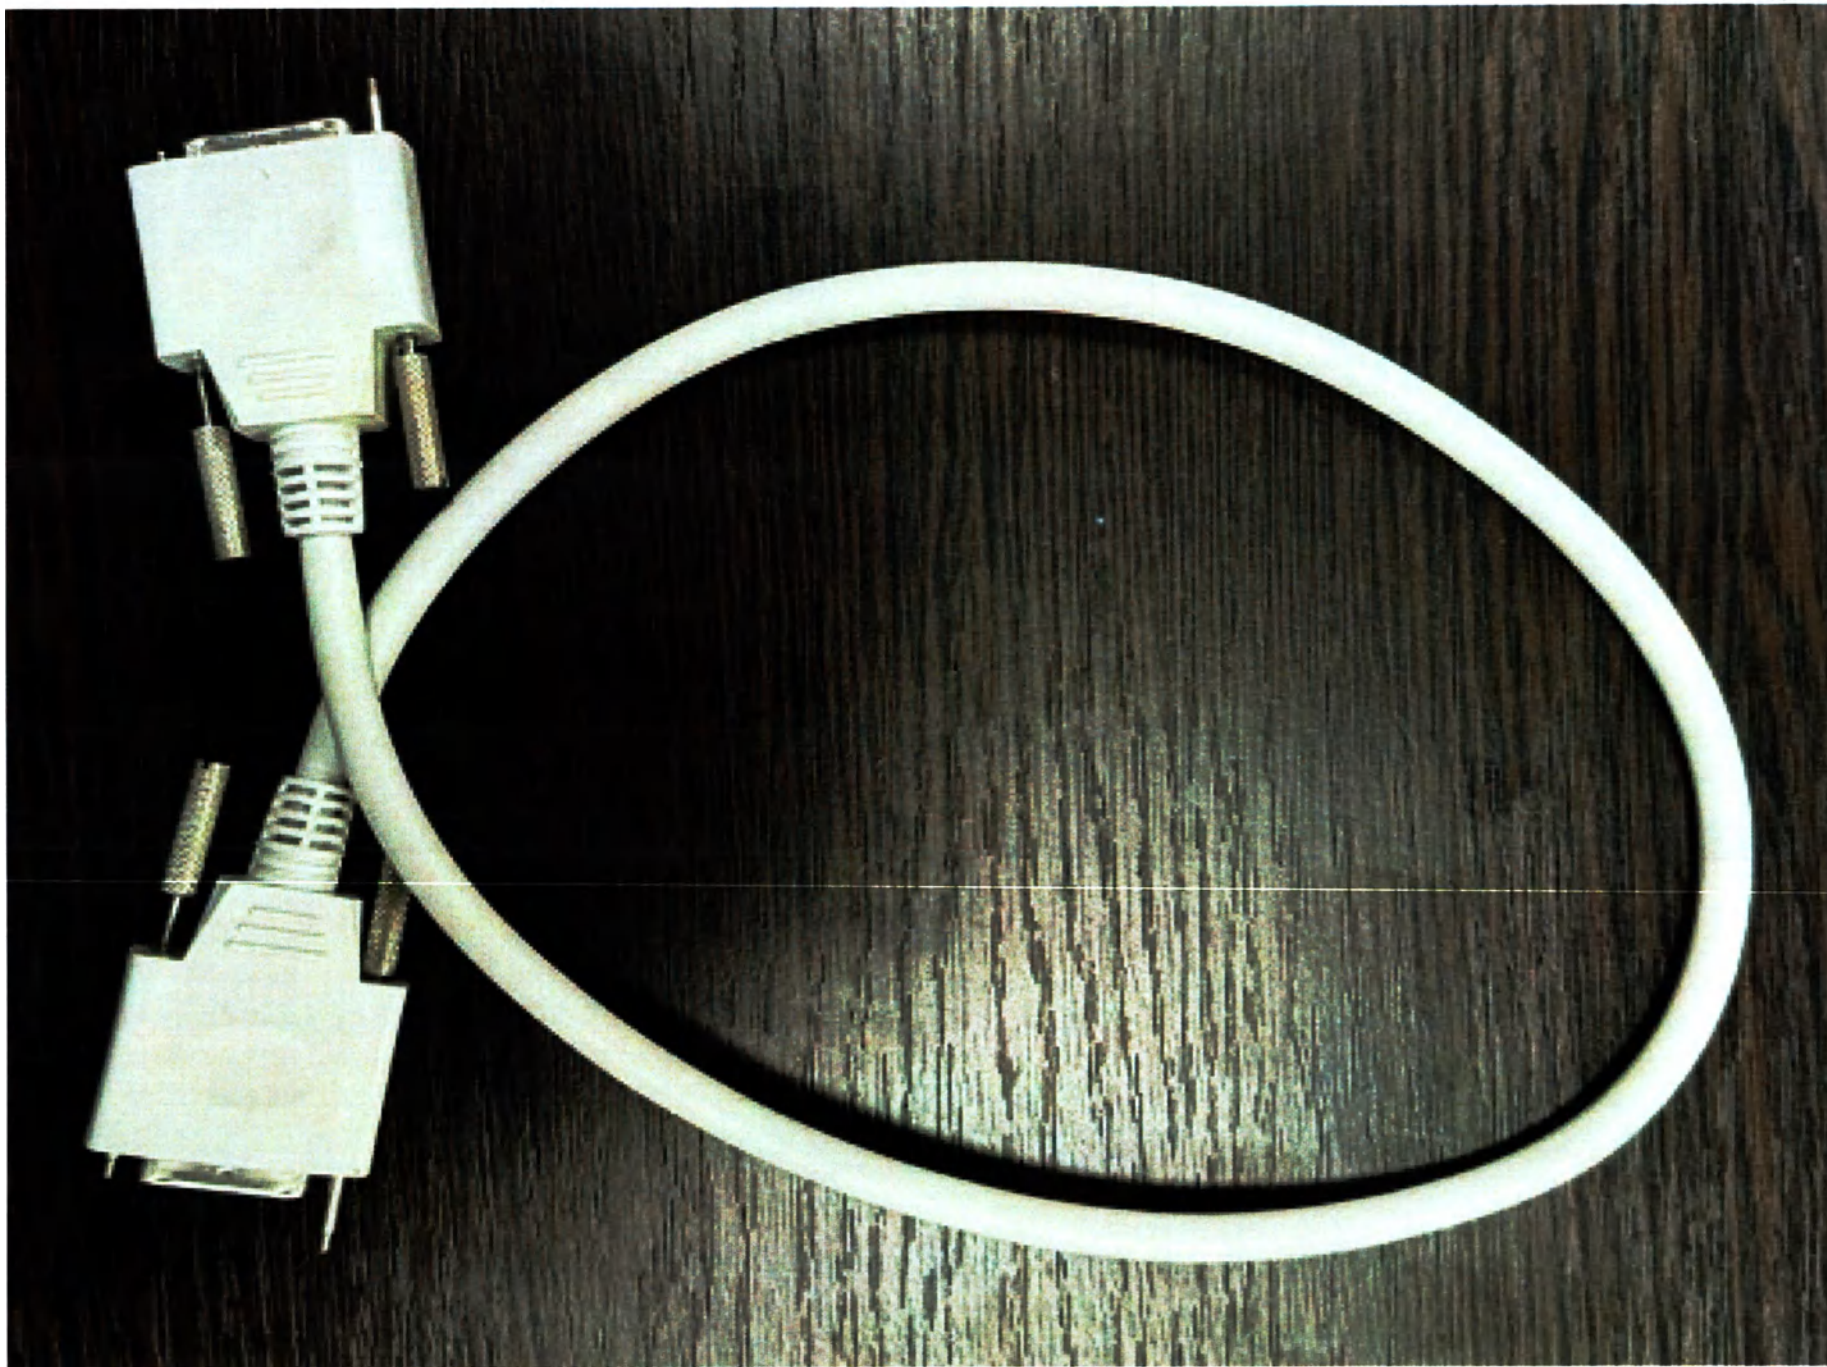

**Кабель коммуникационный (Общий вид)**

**COMEN**

**LOT** 20220925030


**REF** 009-00002008-00

 25.09.2022

Кабель коммуникационный  
Количество изделий в упаковке: 1 шт.

 Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building  
1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
Building, Nanshan Avenue, Matian Sub-district,  
Guangming District, Shenzhen, P.R. China  
(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
Авеню, ФИЙТА Таймпис Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)  
Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
стр. 3, офис 401  
Номера телефонов: +7(900)645-69-61  
Регистрационное удостоверение №

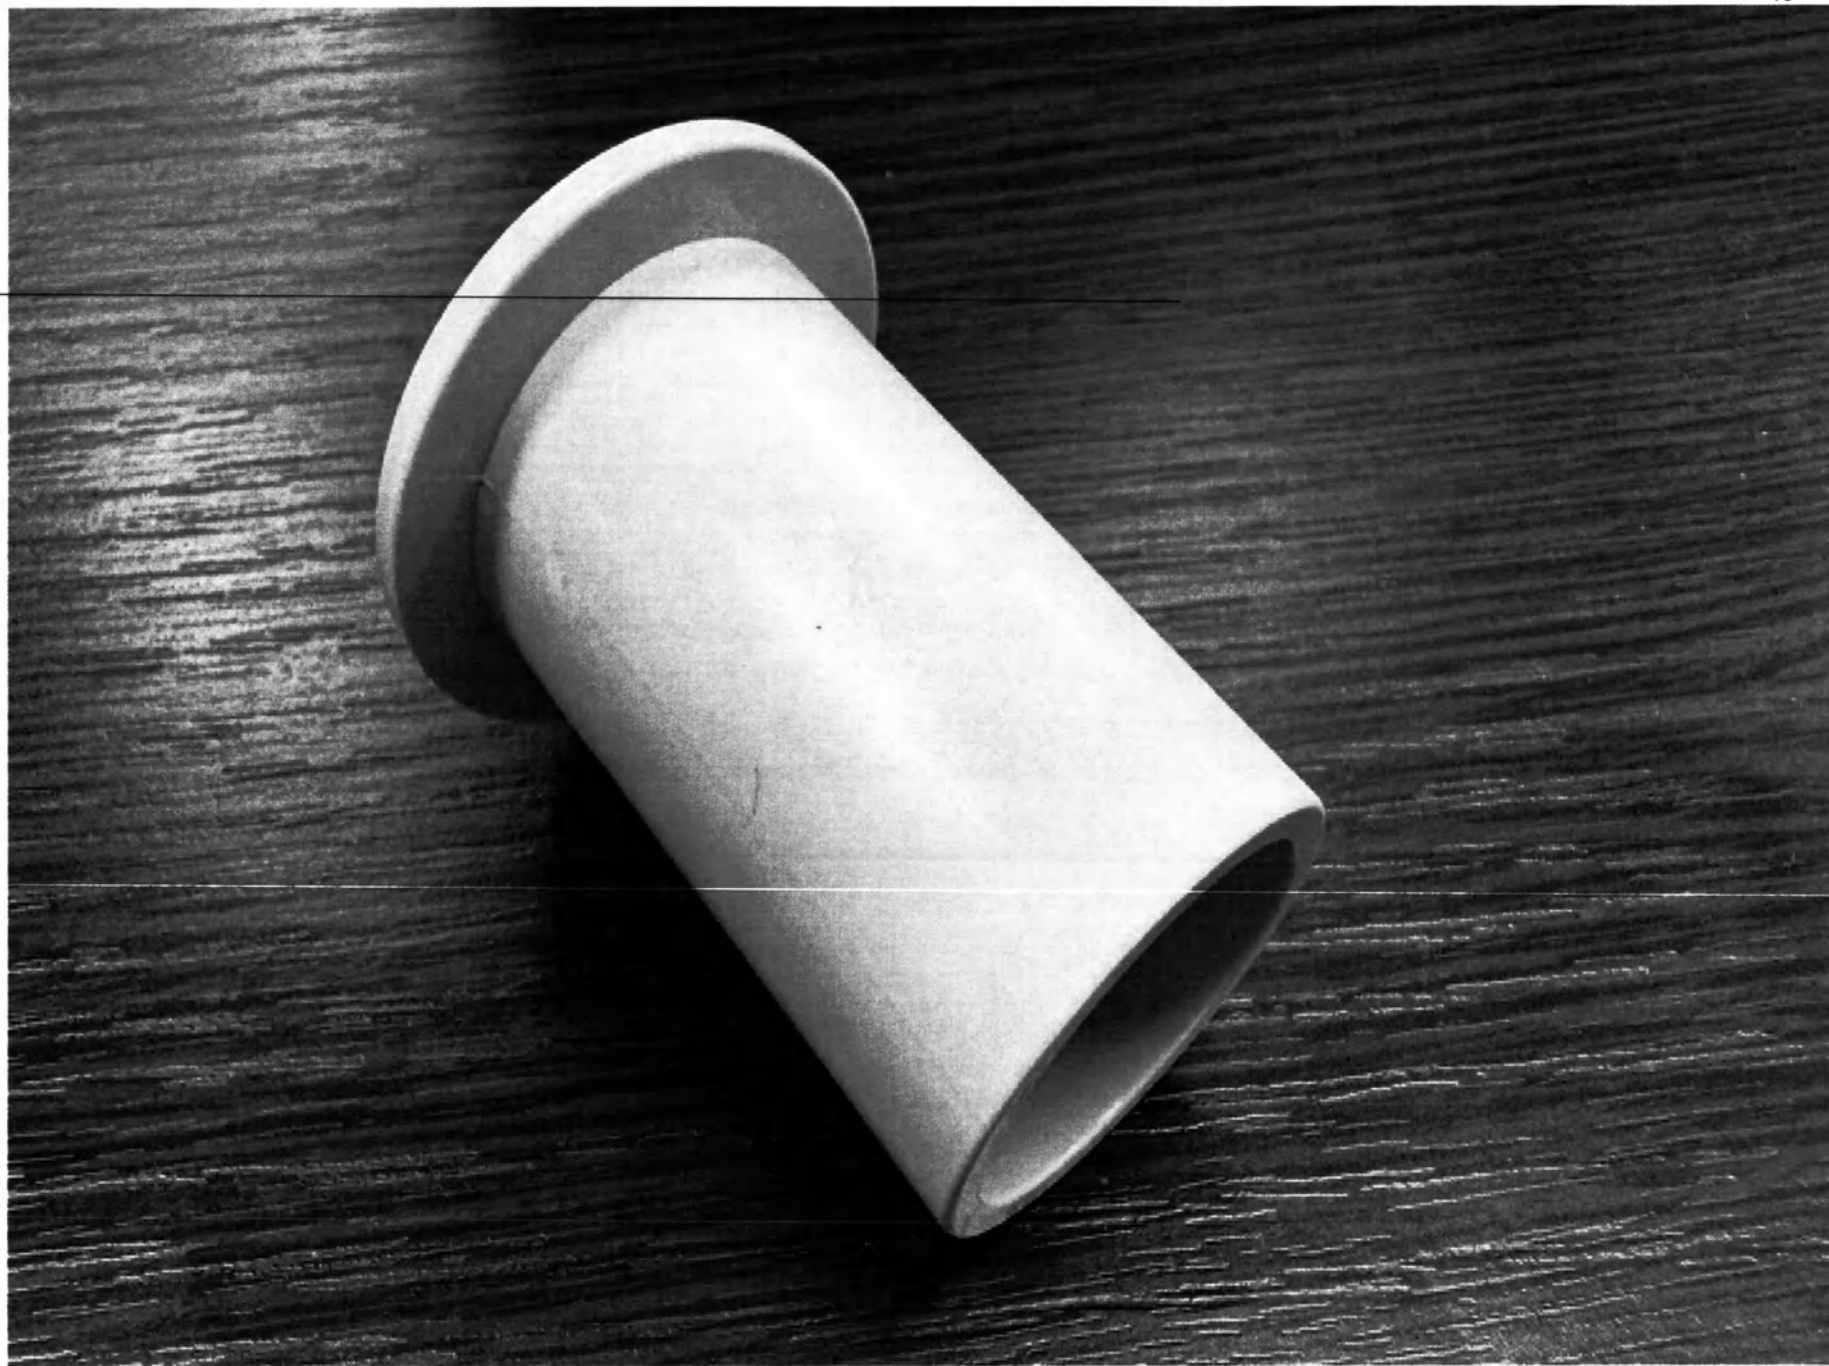


**Крышка баланса белого (Общий вид)**

**COMEN**

**LOT** 20220927100

**REF** 043-00007512-00



27.09.2022

Крышка баланса белого

Количество изделия в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building  
1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,  
Guangming District, Shenzhen, P.R. China

(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
Авеню, ФИЙТА Таймпис Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)

Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
стр. 3, офис 401

Номера телефонов: +7(900)645-69-61

Серийное удостоверение №

Крышка баланса белого (Маркировка)



Держатель крышки баланса белого (Общий вид)

# COMEN

**LOT** 20220927200

**REF** 043-00005808-00



27.09.2022

Держатель крышки баланса белого  
Количество изделия в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A  
& Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming  
District, Shenzhen, P.R. China  
(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
Авеню, ФИЙТА Таймпис Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)

Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
стр. 3, офис 401

Номера телефонов: +7(900)645-69-61

Регистрационное удостоверение №

Держатель крышки баланса белого (Маркировка)




Кабель SDI (Общий вид)





Монитор жидкокристаллический, тип 1 (модель MDAC-2327) (Вид спереди)

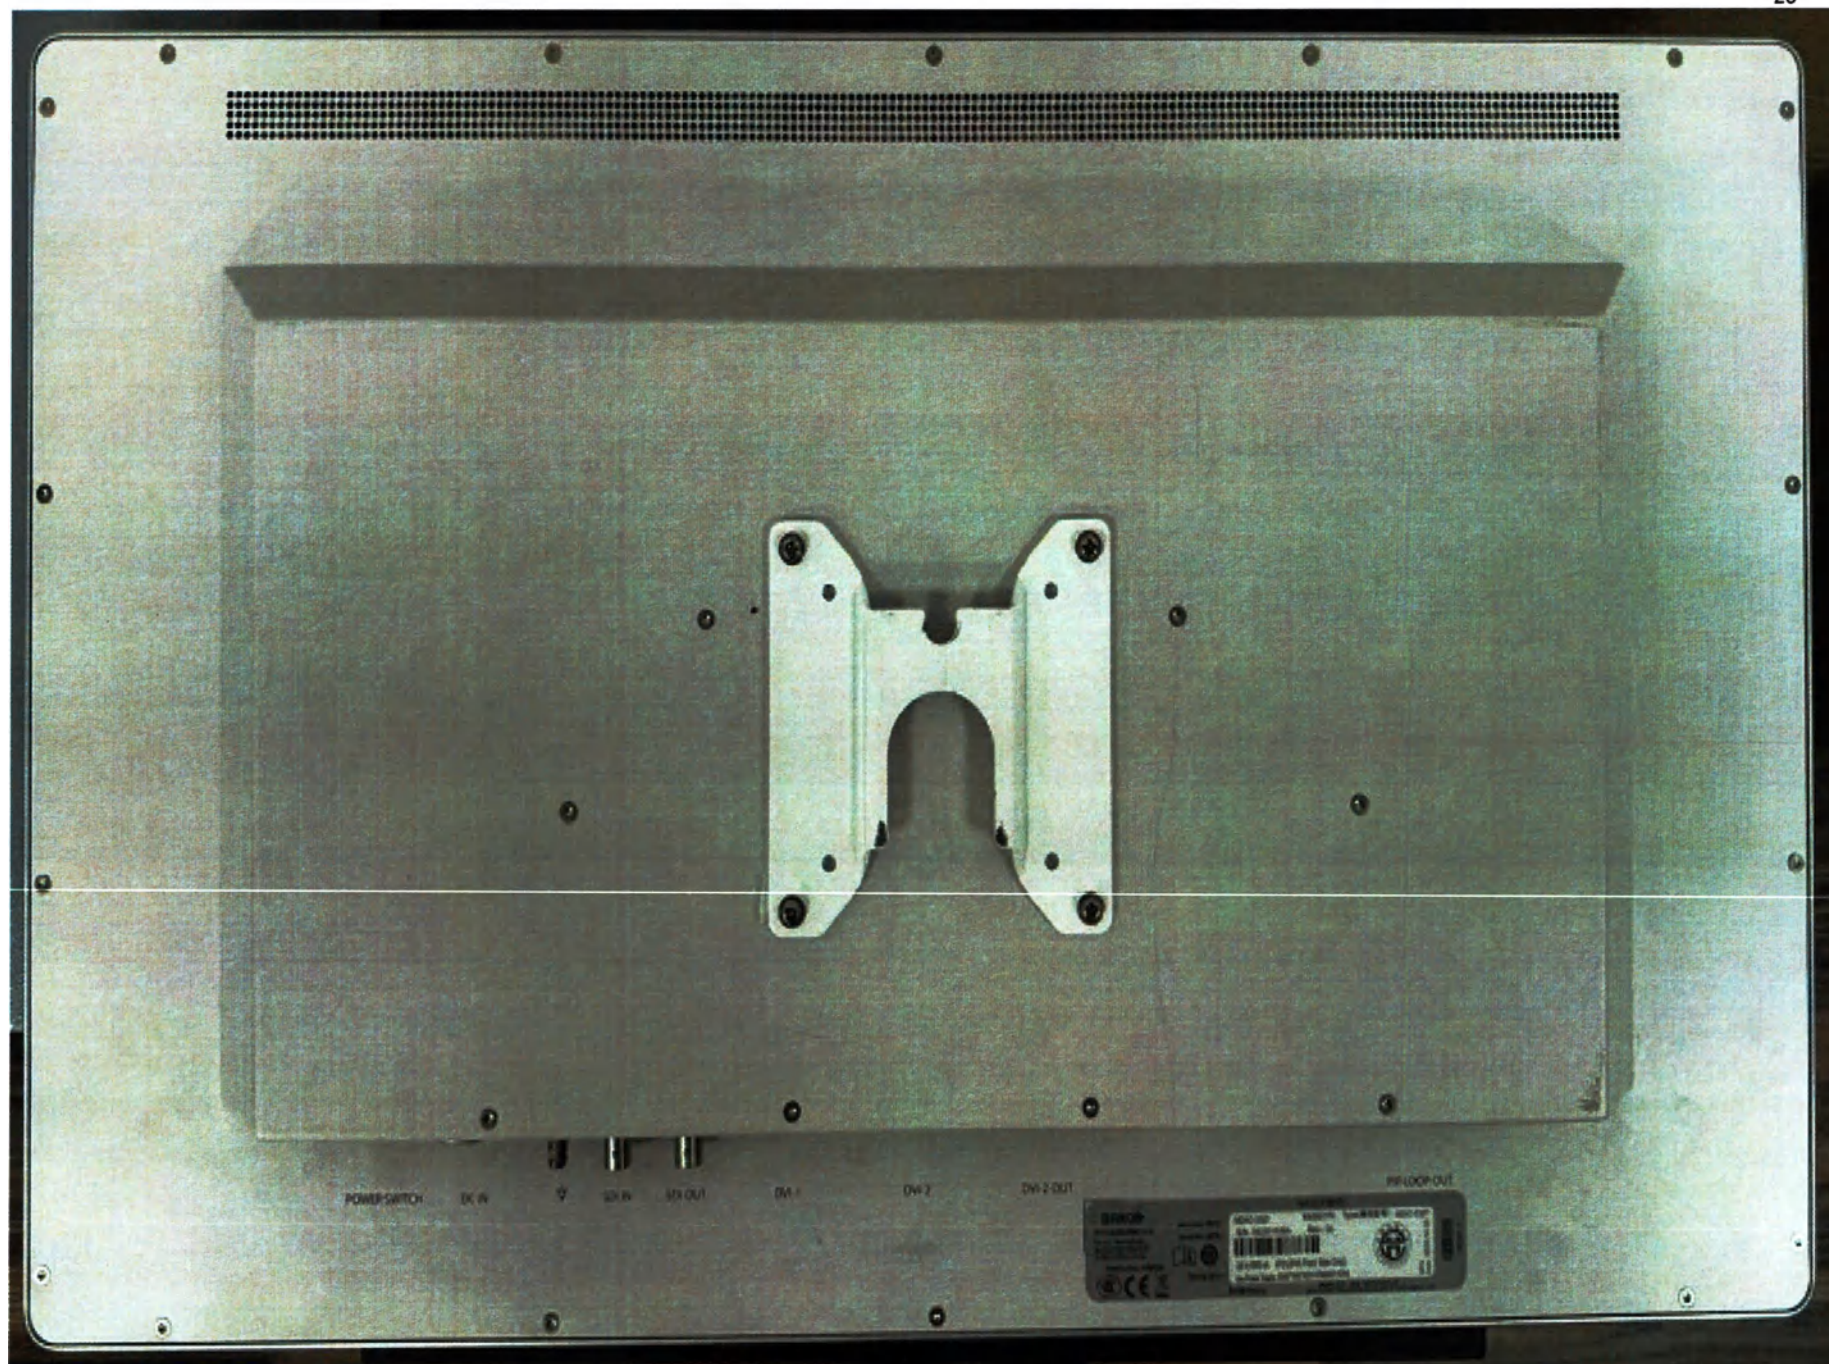

Монитор жидкокристаллический, тип 1 (модель MDAC-2327) (Вид сзади)

-OUT

PIP-LOOP-OUT

**BARCO**  
 苏州工业园区苏桐路111号  
 No.111, Sutong Road,  
 Suzhou Industrial Park,  
 215021 Suzhou China  
 Made in China (中国制造)

Model No. (型号): MDAC-2327  
 Serial No. (序号): S/N 3423518304

Part No. (产品料号): K9350775  
 Type (商用型号): MDAC-2327  
 Rev.: 00

25 V  $\equiv$  4A IP21(IP45 Front Side Only)  
 Use Power Supply: ADAPTWETECH ATM200T-P250

Rating (输入):

显示器/Display

(制造商): 巴可 (苏州) 医疗科技有限公司  
 Manufacturer: Barco (Suzhou) Healthcare Technology Co., Ltd.

MFG Date 2023-12-25

R8796713

Маркировка Монитор жидкокристаллический, тип 1 (модель MDAC-2327)



**COMEN**

**LOT** 20221125004

**REF** 040-000293-00

 25.11.2022

Шнур питания


Количество изделия в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A  
& Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming  
District, Shenzhen, P.R. China  
(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
Авеню, ФИЙТА Таймпис Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)  
Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
3, офис 401  
Телефоны: +7(900)645-69-61  
Сертификатное удостоверение №

Шнур питания (Маркировка)



Провод эквипотенциального заземления (Общий вид)



Провод эквипотенциального заземления (Маркировка)



Кабель DVI (Общий вид)

**COMEN****LOT** 65SA0-2000**REF** 023-00000283-00

09.03.2024

Кабель DVI

Количество изделий в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
 (Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)  
 Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A  
 & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
 Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming  
 District, Shenzhen, P.R. China  
 (Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
 Авеню, ФИЙТА Таймпиес Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
 здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
 Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
 (ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)  
 Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
 стр. 3, офис 401  
 Номера телефонов: +7(900)645-69-61  
 Регистрационное удостоверение №

**Кабель DVI (Маркировка)**



Адаптер (Общий вид)

 ADAPTER TECH.



Medical Power Supply 电源适配器

Model(型号): ATM200T-P250

INPUT(输入): 100-240~50-60Hz 2.5-0.9A

OUTPUT(输出): 25.0V --- 8.0A 200.0W

<http://www.adaptertech.com.tw>

Manufacturer(制造商): 阿达特科技股份有限公司

仅限室内使用

此产品用于信息技术设备

R768164102006



A82310900160



IS13252(Part1)/  
IEC 60950-1



본 장치를 인증한  
공인 업체 ATM200T-P250  
제품명: 25.0V AC 100-240V AC 50-60Hz 2.5A max  
10.0V DC 8.0A  
제 조 사 Adapter Technology Co., Ltd.  
제 조 공 장 Hsin Yang Electronics Co., Ltd.  
A동 3층 303호 (Tel: +82-2-522-19858)  
KCC 인증번호: KCC-2023-03

KCC 인증번호: KCC-2023-03



R-41013177  
[www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in)



SIN:2310900160



JET Barco Co., Ltd

I/P: 100-240V AC 50-60Hz 220VA-235VA 2.8A  
O/P: 25V DC 8A 必ず接地接続を行って下さい



MADE IN CHINA

ID NO. A

CPC

中国制造

Адаптер (маркировка)

**COMEN****LOT** 2310900160**REF** 023-00000284-00 20.12.2023


Адаптер

Количество изделия в упаковке: 1 шт.




Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
 (Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)  
 Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A  
 & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
 Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming  
 District, Shenzhen, P.R. China  
 (Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
 Авеню, ФИЙТА Таймпие Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
 здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
 Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
 (ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)  
 Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
 стр. 3, офис 401  
 Номера телефонов: +7(900)645-69-61  
 Регистрационное удостоверение №

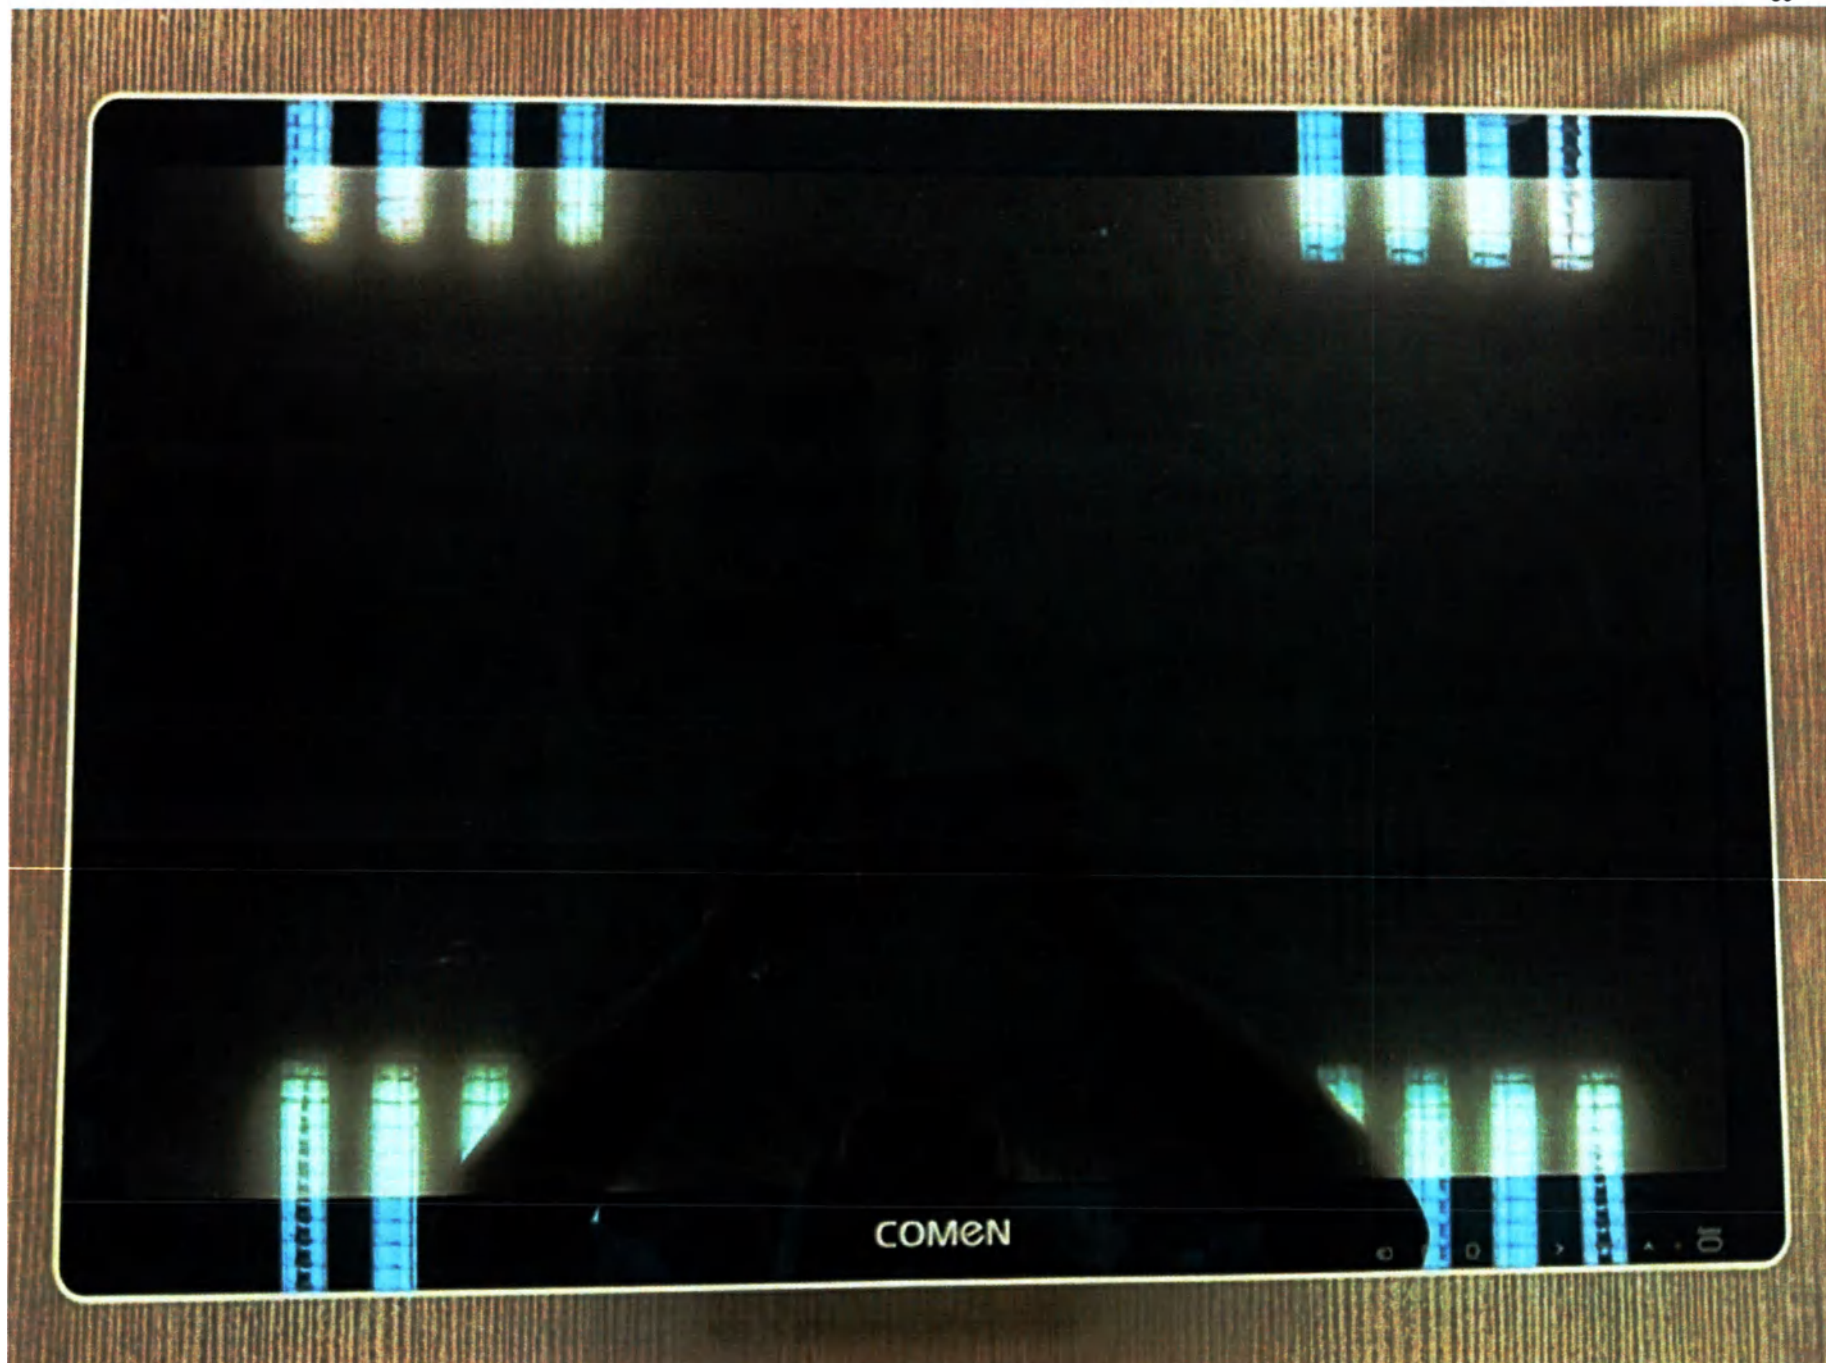

Монитор жидкокристаллический, тип 2 модель S271P (Вид спереди)

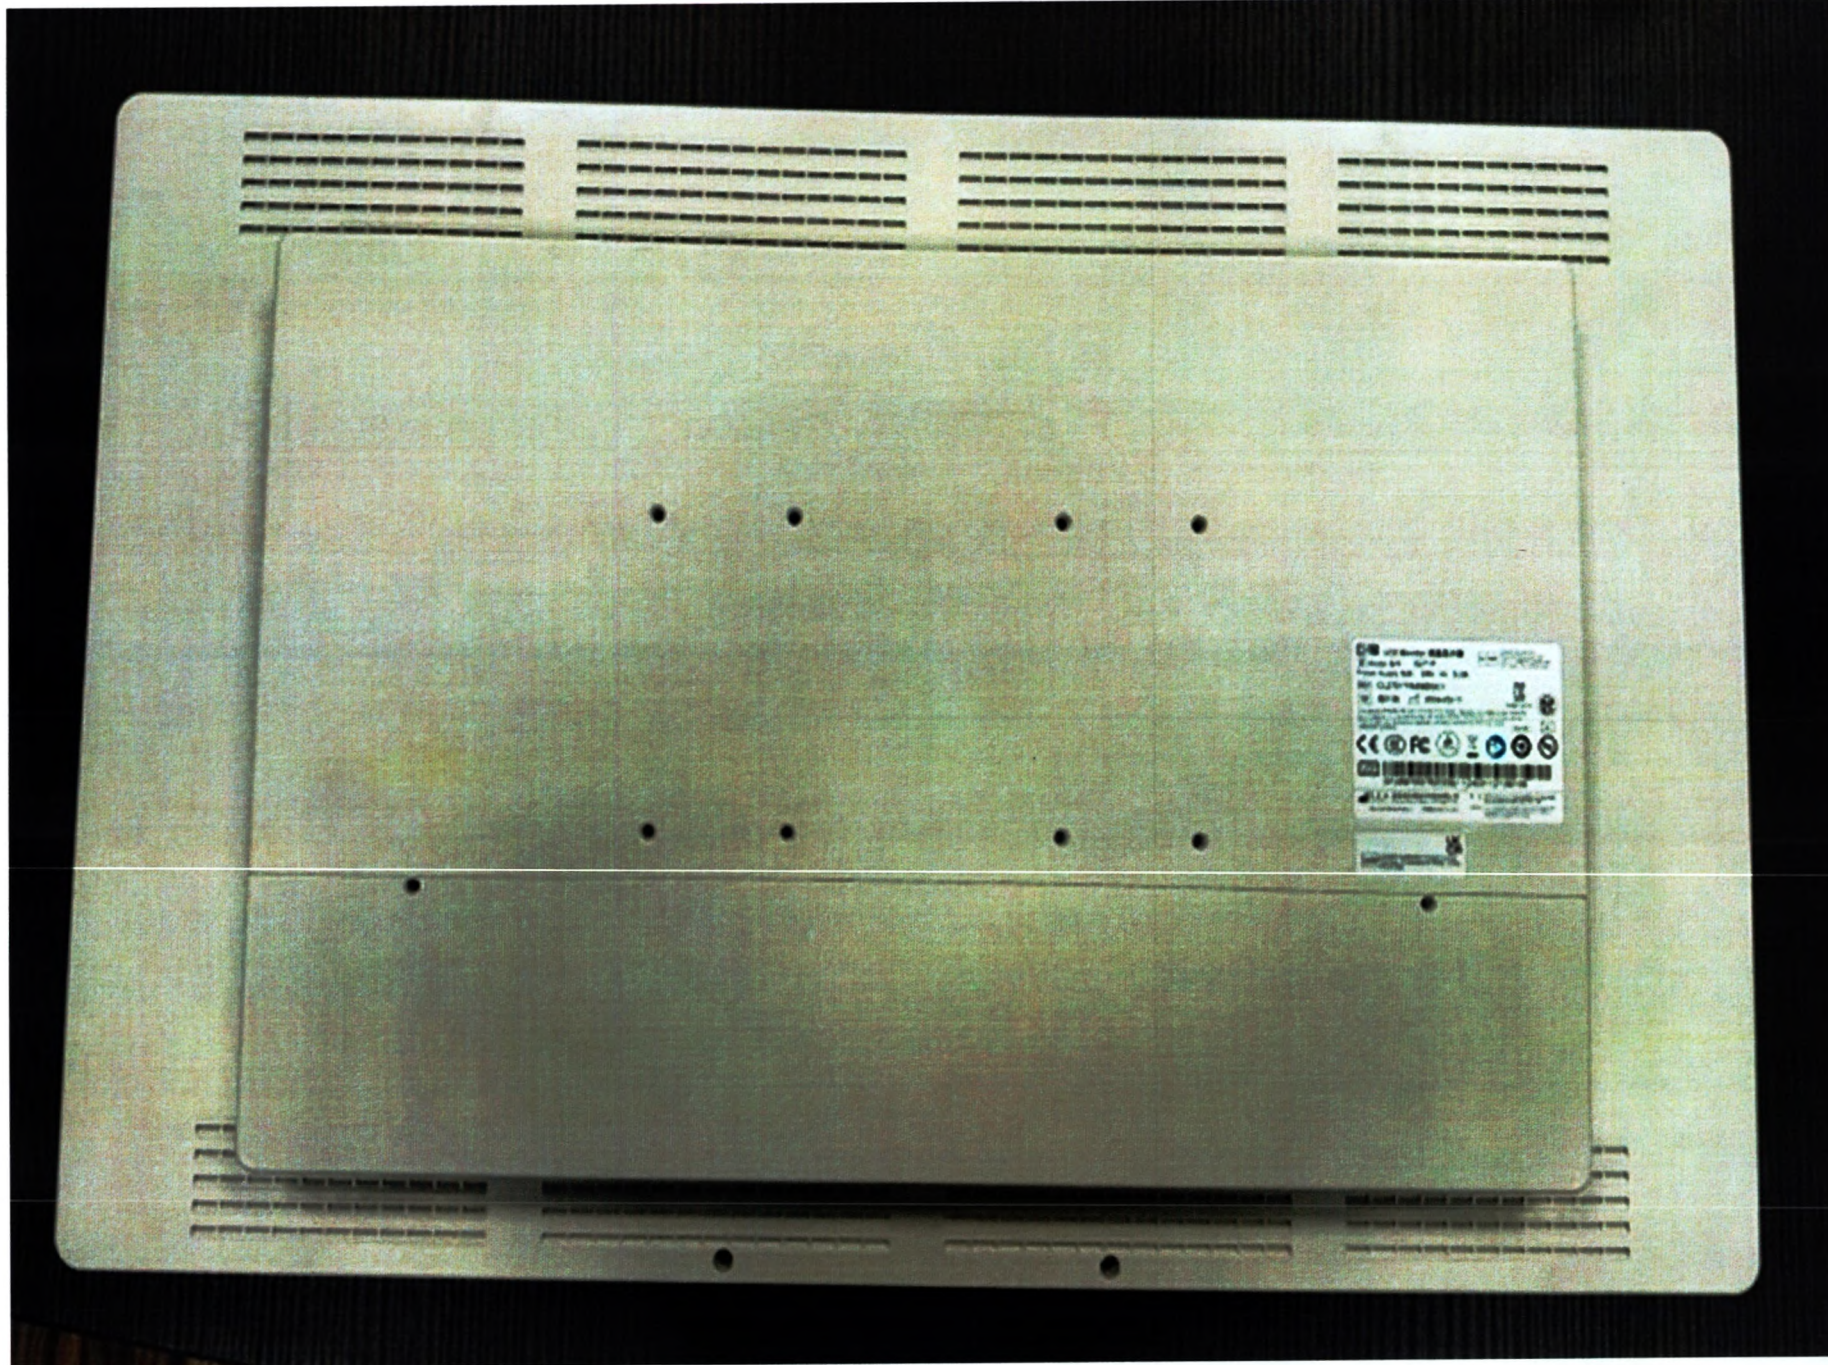

Монитор жидкокристаллический, тип 2 модель S271P (Вид сзади)

巨峰 LCD Monitor 液晶显示器

# Model 型号: S271P

Power Supply 电源: 24V = 5.0A

REF CL2701\*YAKMZQC1

SN B0138 2024-03-11



SUNGO Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522,  
Unit 1.7, 2809VA Capelle aan  
den IJssel, The Netherlands



R-R-B01-S271P



RoHS

MD

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



(01)06970027820339(11)240311(21)B0138

制造商: 深圳市巨峰显示科技有限公司  
Manufacturer: Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd.

Web: www.beacon-display.cn 中国制造 MADE IN CHINA

地址: 深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁  
恒大时尚慧谷大厦(东区)6栋15层

Address: 15F, Building 6, Hengda Shishang Huigu(East),  
Fulong Road, Dalang Subdistrict, Longhua,  
Shenzhen, 518109, P.R. China

UK  
CA



SUNGO Certification Company Limited  
3rd floor, 70 Gracechurch Street, London.  
EC3V 0HR.

Маркировка Монитор жидкокристаллический, тип 2 модель S271P



Шнур питания (Общий вид)

**COMEN**

**LOT**

20221125024

**REF**

040-000293-00



25.11.2022

Шнур питания

Количество изделия в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building  
1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timespiece  
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,  
Guangming District, Shenzhen, P.R. China  
(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Нанхуан  
Авеню, ФИЙТА Таймпиес Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)

Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
стр. 3, офис 401

Номера телефонов: +7(900)645-69-61

Регистрационное удостоверение №

Шнур питания (Маркировка)



Провод эквипотенциального заземления (Общий вид)



Провод эквипотенциального заземления (Маркировка)



Кабель DVI (Общий вид)

**COMEN**

**LOT** 20240120010

**REF** 040-00002377-00

 20.01.2024

Кабель DVI

Количество изделия в упаковке: 1 шт.

 Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building  
1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,  
Guangming District, Shenzhen, P.R. China  
(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
Авеню, ФИЙТА Таймпиес Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)  
Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
стр. 3, офис 401  
Номера телефонов: +7(900)645-69-61  
Регистрационное свидетельство №



Адаптер (Общий вид)

# BEACON

Power Supply 电源适配器



Model (型号): ATM160T-P240

INPUT (输入): 100-240V ~ 50-60Hz 1.8-0.9A

OUTPUT (输出): 24.0V = 6.6A 158.4W

<http://www.adaptertech.com.tw>

Manufacturer (制造商): 阿达特科技股份有限公司



IS13252(Part1)/  
 IEC 60950-1




C **UL** US  
 E225703



R-41170003  
[www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in)

FCC CE

MADE IN CHINA  
 ID NO. A  
 CPC



中国制造

SIN: 2402000749

Адаптер (маркировка)



**COMEN**

**LOT** 2402000749

**REF** 023-00000283-00

 07.02.2024


Адаптер

Количество изделий в упаковке: 1 шт.

 Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building  
1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,  
Guangming District, Shenzhen, P.R. China  
(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
Авеню, ФИЙТА Таймпие Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)  
Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
стр. 3, офис 401  
Номера телефонов: +7(900)645-69-61  
Регистрационное удостоверение №

Адаптер (Маркировка)

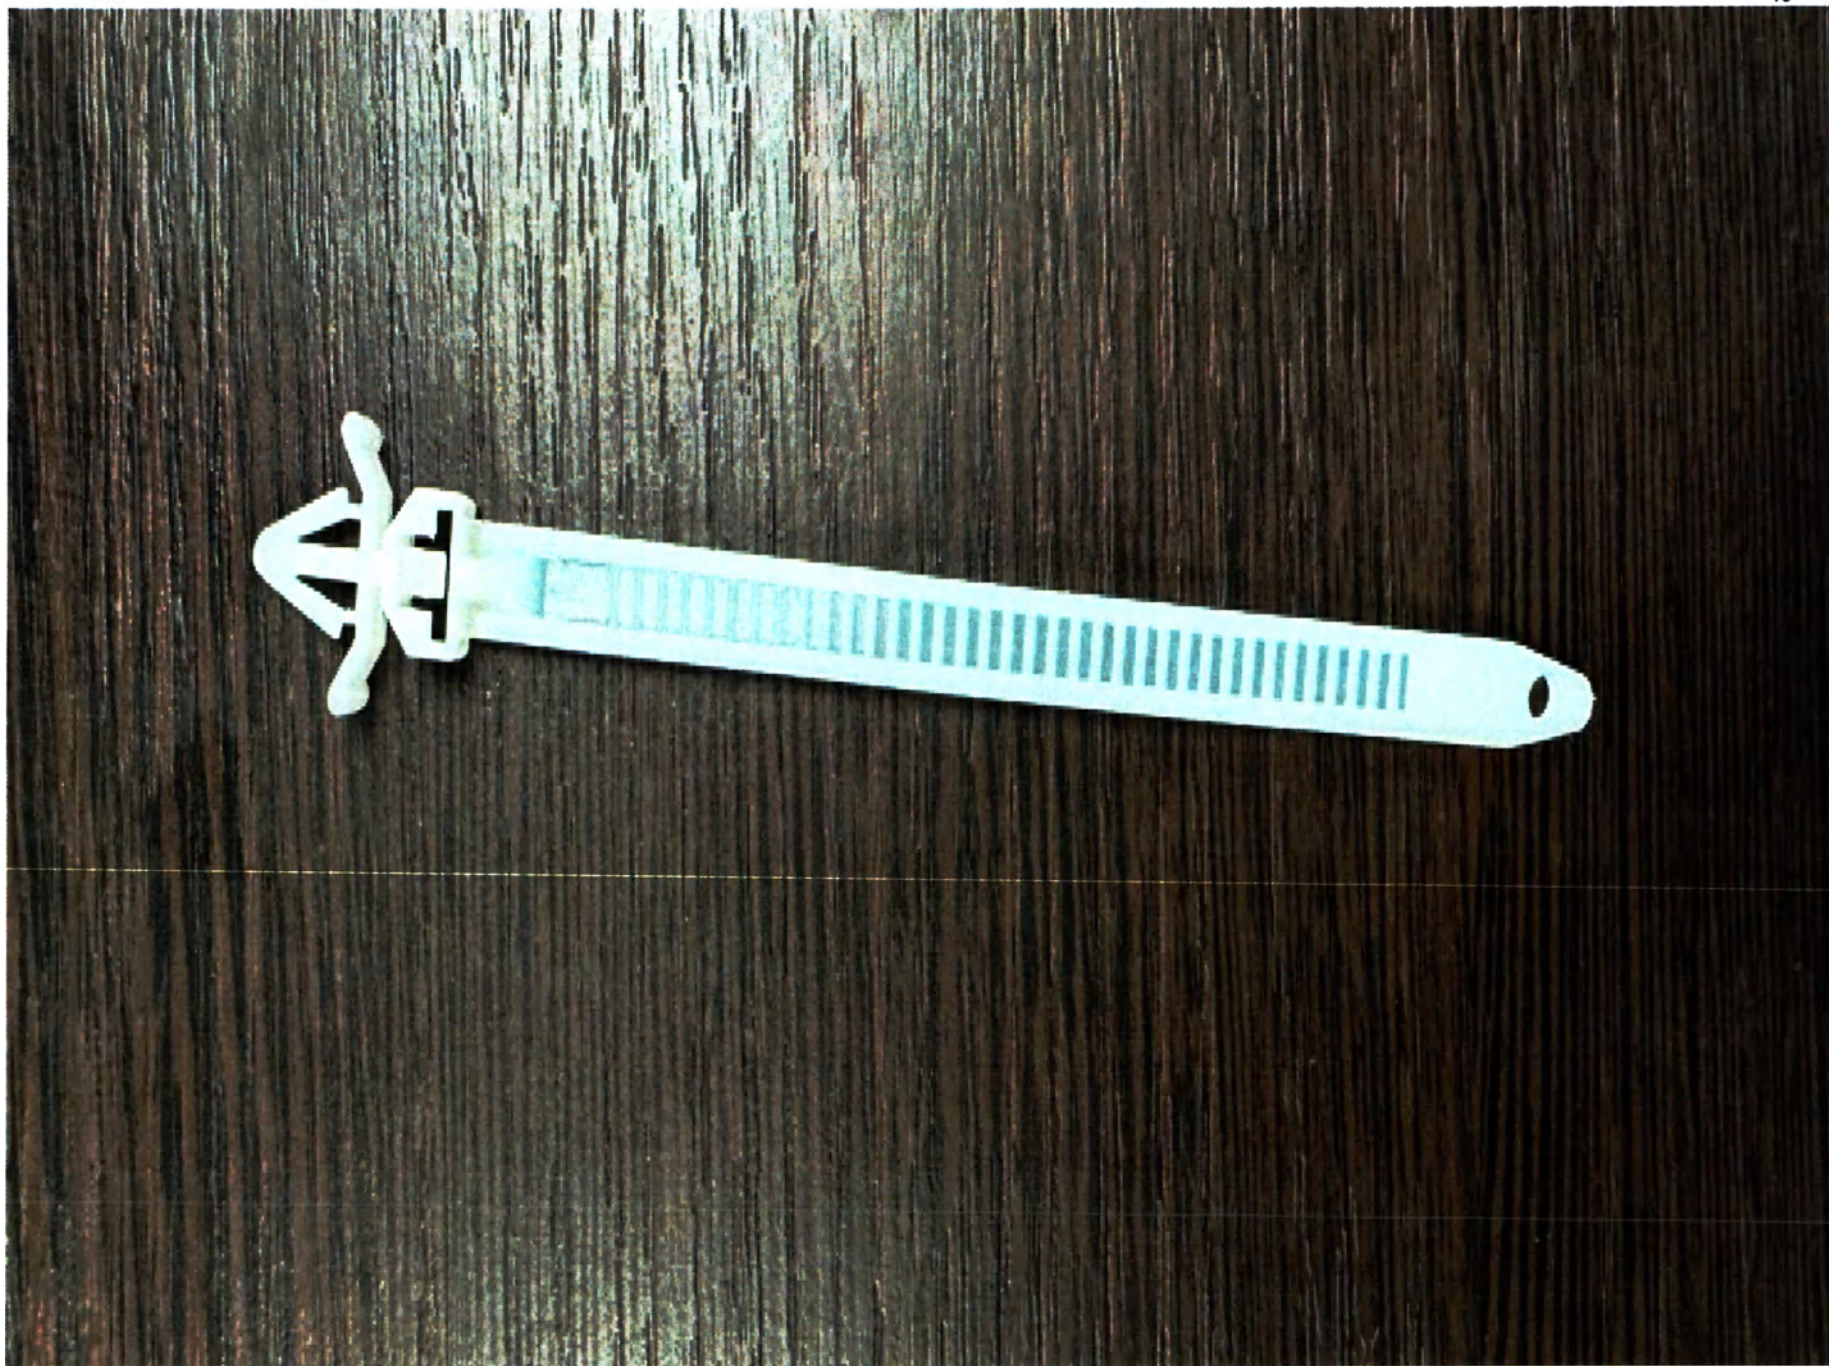

Лента бандажной проволоки (Общий вид)

**COMEN**

**LOT** 20240118003

**REF** 023-00000283-00

 18.01.2024

Лента бандажной проволоки  
Количество изделия в упаковке: 1 шт.

 Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A  
& Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming  
District, Shenzhen, P.R. China

(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
Авеню, ФИЙТА Таймпис Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)

Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
стр. 3, офис 401

Номера телефонов: +7(900)645-69-61

Регистрационное удостоверение №

Лента бандажной проволоки (Маркировка)

Revision 1 / Редакция 1

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ»<br/>Director General / Генеральный директор<br/>Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./<br/>Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.</p> <p> Yi Yong (И Юн)</p> <p>« 17 » 2024 г.</p> <p>Stamp/печать</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**USER MANUAL OF MEDICAL DEVICE/  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**



**Video processor of a medical endoscope, in versions/  
Видеопроцессор медицинского эндоскопа, в вариантах исполнения**

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./  
Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.



Клавиатура (Общий вид)

# COMEN

**LOT**

20230820010

**REF**

023-00000290-00



20.08.2023

Клавиатура

Количество изделия в упаковке: 1 шт.




Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building  
1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,  
Guangming District, Shenzhen, P.R. China  
(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
Авеню, ФИЙТА Таймпис Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)

Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
стр. 3, офис 401

Номера телефонов: +7(900)645-69-61

Регистрационное удостоверение №

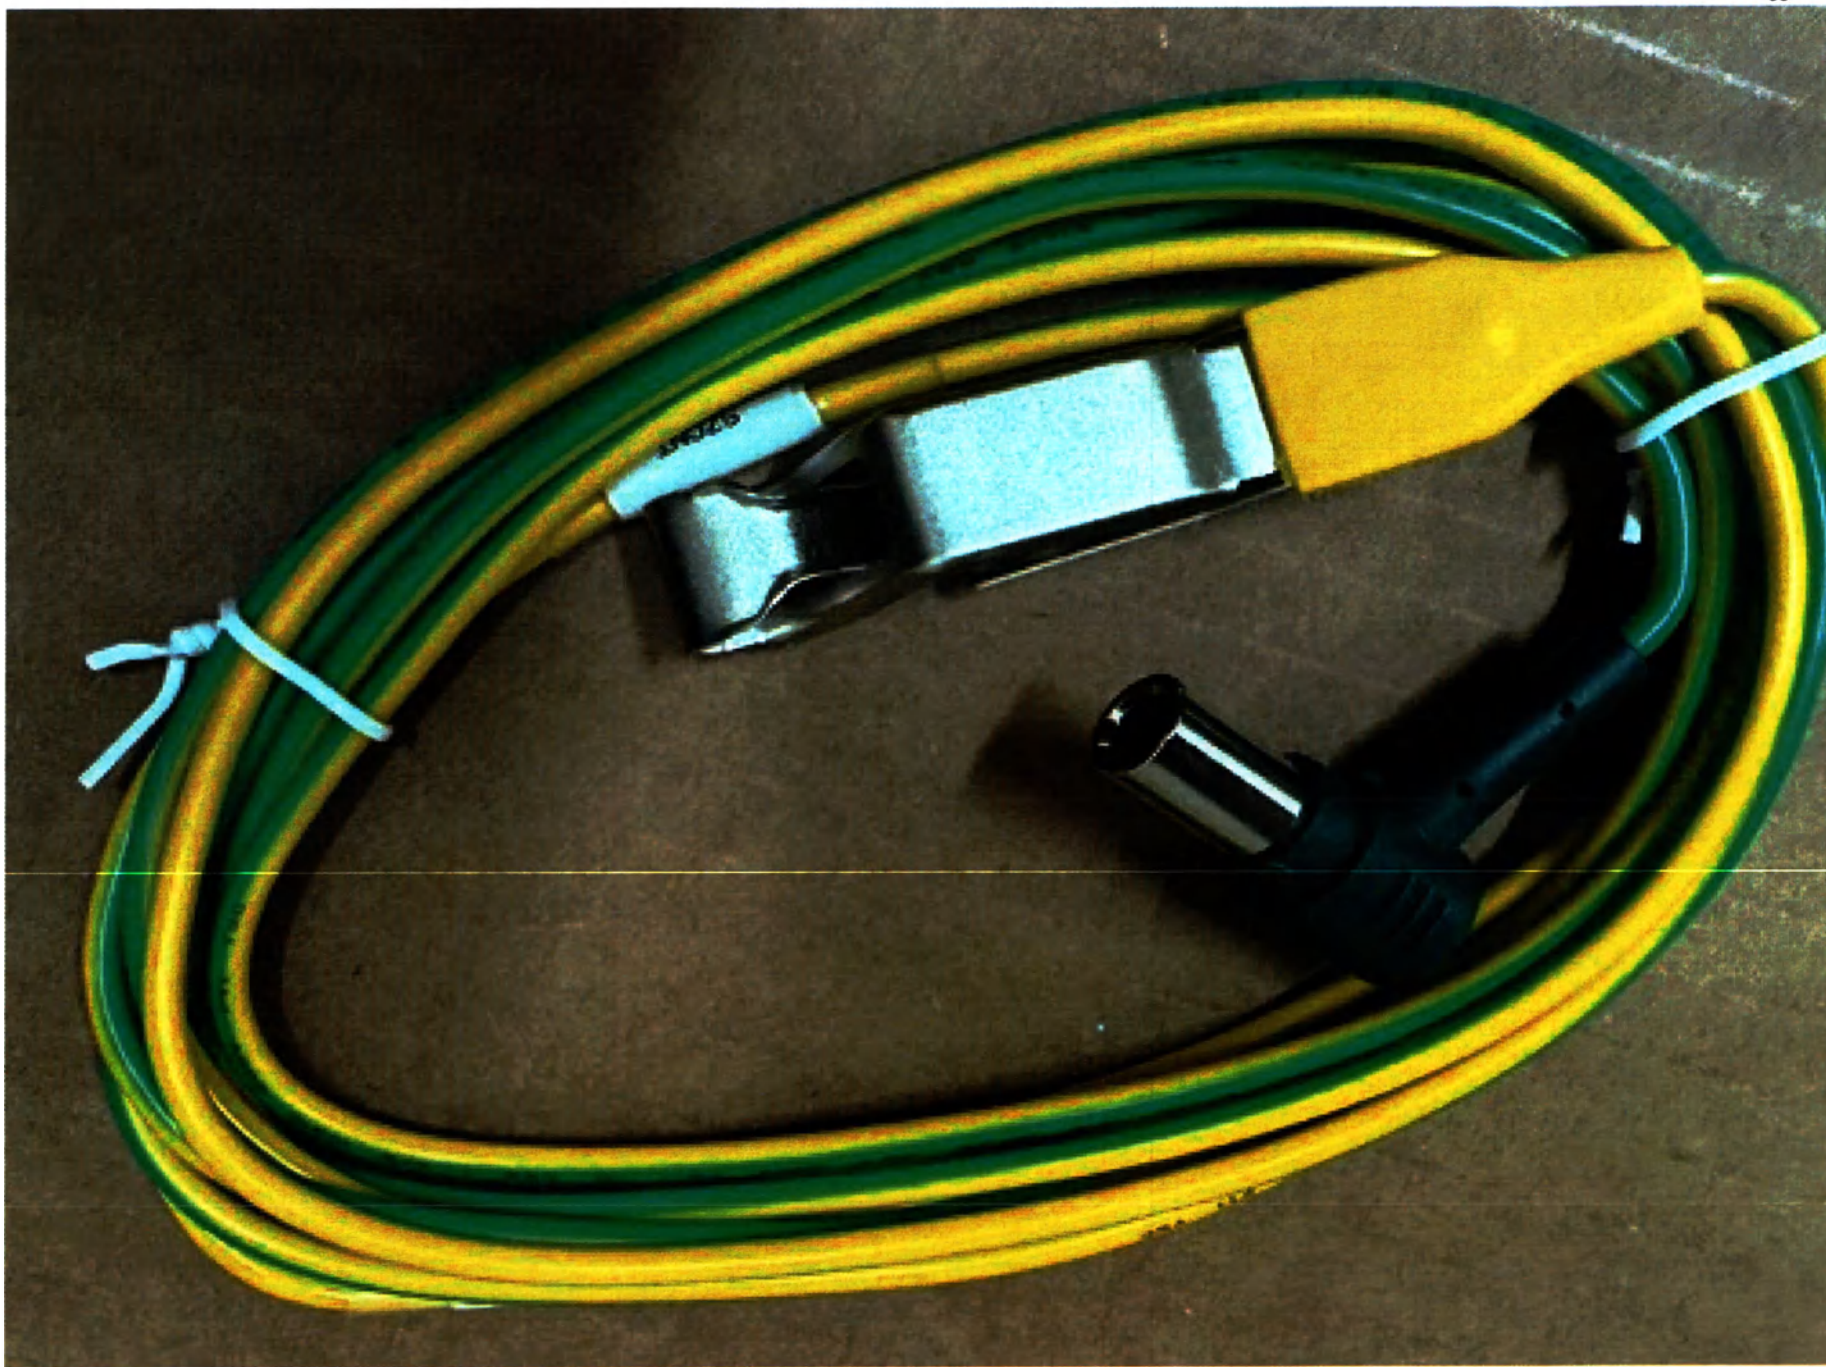

Провод эквипотенциального заземления (Общий вид)

**COMEN**

**LOT** 202308-01

**REF** 040-000008-00

 01.08.2023

Провод эквипотенциального заземления  
Количество изделия в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Times Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China  
(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Иньхуань Авеню, ФИЙТА Таймпис Билдинг, этаж 10-12 здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)  
Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручевского, д. 2, стр. 3, офис 401  
Номера телефонов: +7(900)645-69-61  
Регистрационное удостоверение №



Переключатель ножной (Общий вид)

# SUNS

Model: FS-82-SP-W-2-20/4S-S


**REF** 20220420

10A 125/250VAC

IEC 60601-1

IP X8 (1.2m)

**SN** 7499858



2022/06




[WWW.SUNS-USA.COM](http://WWW.SUNS-USA.COM)

Маркировка Переключатель ножной

# COMEN

**LOT** 7499858

**REF** 010-00000026-00

 30.06.2022

Переключатель ножной  
Количество изделия в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A  
& Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming  
District, Shenzhen, P.R. China  
(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
Авеню, ФИЙТА Таймпис Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)  
Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
стр. 3, офис 401  
Номера телефонов: +7(900)645-69-61  
Регистрационное удостоверение №

# Видеопроцессор медицинского эндоскопа COMEN

Вариант исполнения : EIS-2000C

Размеры: 510 мм(длина)×495 мм(ширина)×285 мм(высота)

Вес нетто: 7.10 кг Вес брутто: 9.65 кг Количество в упаковке: 1 шт.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXXг.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО "КОМЕН МЕДИКАЛ РУС", РОССИЯ, Г. МОСКВА,






117342, Г.МОСКВА, ВЛТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, УЛ ОБРУЧЕВА, Д. 52,  
СТР. 3

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.




Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5  
of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,  
Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R. China

Tel:+86-0755-26431236



Вариант исполнения : EIS-2000C



YYYY-MM-DD

Order No. :




ON\*\*\*\*\*

Serial No. :



SNMMDDYYNNN

Вариант исполнения : EIS-2000C



YYYY-MM-DD

Order No. :



ON\*\*\*\*\*

Serial No. :



SNMMDDYYNNN

Макет транспортной упаковки (Видеопроцессор медицинского эндоскопа, в вариантах исполнения)




Транспортная упаковка «Монитор жидкокристаллический, тип 1 модель MDAC-2327)»

# COMEN

**LOT** 3423518304

**REF** 023-00000284-00



25.12.2023

Монитор жидкокристаллический, тип 1, модель (MDAC-2327)

Количество изделия в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, P.R. China  
(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань Авеню, ФИЙТА Таймпис Билдинг, этаж 10-11 и 12С здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)

Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52, стр. 3, офис 401

Номера телефонов: +7(900)645-69-61

Регистрационное удостоверение №

Маркировка транспортной упаковки «Монитор жидкокристаллический, тип 1 модель MDAC-2327»



Транспортная упаковка «Монитор жидкокристаллический, тип 2 модель S271P»


**COMEN**

**LOT**

B0138

**REF**

023-00000283-00



11.03.2024

Монитор жидкокристаллический, тип 1, модель (S271P)  
Количество изделия в упаковке: 1 шт.



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
(Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.)  
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A  
& Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming  
District, Shenzhen, P.R. China  
(Шэньчжэнь, округ Гуанмин, район Матянь, Наньхуань  
Авеню, ФИЙТА Таймпис Билдинг, этаж 10-11 и 12С  
здания 1А, этаж 1-5 здания 2, Китайская Народная  
Республика)

Уполномоченный представитель на территории РФ:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»  
(ООО «КОМЕН МЕДИКАЛ РУС»)

Адрес: 117342, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52,  
стр. 3, офис 401

Номера телефонов: +7(900)645-69-61

Регистрационное удостоверение №



Транспортная упаковка (Видеопроцессор медицинского эндоскопа, в вариантах исполнения)

ПРОШЕЛО СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
ЛИСТ(-А,-ОВ)



генеральный директор

Шварёв А. В.

МП