

Фотографические изображения.


**Перчатки нитриловые диагностические нестерильные
неопудренные текстурированные BioAncore® по ТУ 22.19.60-
001-31887864-2019 в вариантах исполнения**

Производства ООО «Альянс Плюс»

Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioApscore® с покрытием Алоэ вера, цвет зеленый;



Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore® с покрытием Алоэ вера, цвет зеленый;

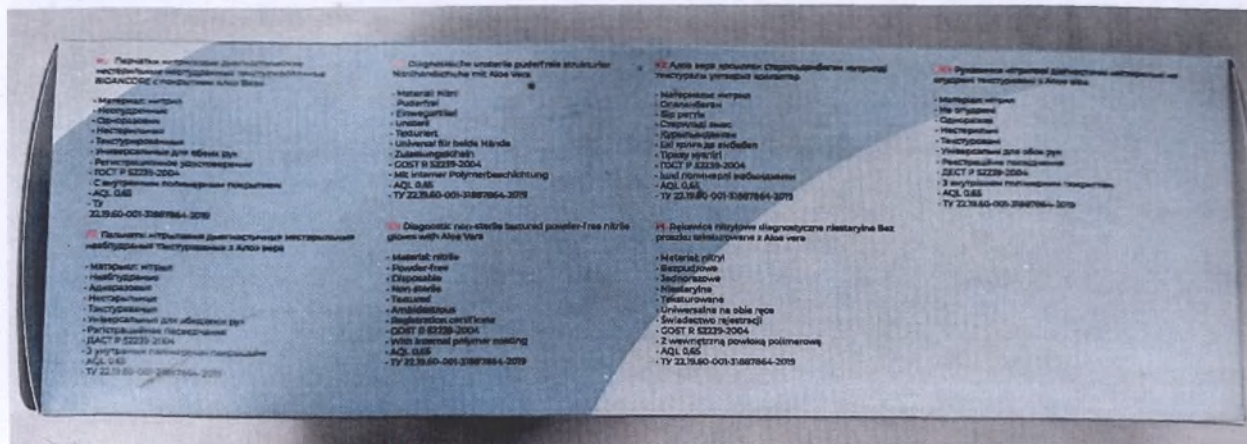



EN
WARNING: Do not use these gloves if you have a known allergy to chemical components. Be sure to consult a specialist.
Keep away from oxidizing allocation. Keep away from direct sunlight, heat over 35°C and humidity 85%



BE
УВАГА! Не використовуйте ці рукавички у випадку підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся зі спеціалістом.
Зберігайте далекі від окислюючих речовин. Берегти від потрапляння прямих сонячних променів і від нагрівання більш 35°C, а так же вологості 85%



DE
ACHTUNG! Verwenden Sie diese Handschuhe bei bestätigter Allergie gegenüber chemischen Bestandteilen nicht. Befragen Sie unbedingt einen Fachmann.
Von oxidierenden Substanzen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Erwärmung über 35°C und 85% Luftfeuchtigkeit schützen



KZ
НАЗАР АУДАРЫНЫЗ Осы қолғапты химиялық компоненттерге аллергия расталған жағдайда пайдаланбаңыз. Міндетті түрде маманмен кеңесіңіз.
Тынықтырушы заттардан алыста сақтау керек. Тікелей күн сәулелерінің түсуінен және 35°C-ден жоғары температурада 85% ылғалдылықтан қорғаныңыз.



PL
UWAGA! Nie należy używać tych rękawiczek w przypadku potwierdzonej alergii na składniki chemiczne. Koniecznie należy skonsultować się ze specjalistą.
Trzymać z dala od substancji utleniających. Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ogrzewania powyżej 35°C, a także 85% wilgotności



UKR
Не використовуйте ці рукавички у разі підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем.
Зберігати далеко від окислюючих речовин. Берегти від попадання прямих сонячних променів і від нагрівання більше 35°C, а так же вологості 85%

Регистрационное удостоверение

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004

Производитель:
ООО «Анкор-Мед», Россия 141304,
обл. Московская, г. Сергиев Посад, Московское ш.,
д. 2 стр. 1, офис 5

Назначено для: ООО «Анкор-Мед», 141313, Московская
Область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 3, офис 5

Тел.: +7 (495) 215-57-87
ancommed.ru
msk@ancommed.ru

LOT	



BioAncore®
СДЕЛАНО В РОССИИ

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
BIOANCORE С ПОКРЫТИЕМ АЛОЭ ВЕРА ЗЕЛЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не используйте эти перчатки в случае подтвержденной аллергии на химические компоненты.
Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Хранить вдали от окисляющих веществ.
Бережь от попадания прямых солнечных лучей, нагревания более 35°C и влажности более 85%.

BioAncore®



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
BIOANCORE С ПОКРЫТИЕМ АЛОЭ ВЕРА ЗЕЛЕНЫЕ



S

Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAnso® с покрытием Алоэ вера, цвет голубой



Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore® с покрытием Алоэ вера, цвет голубой

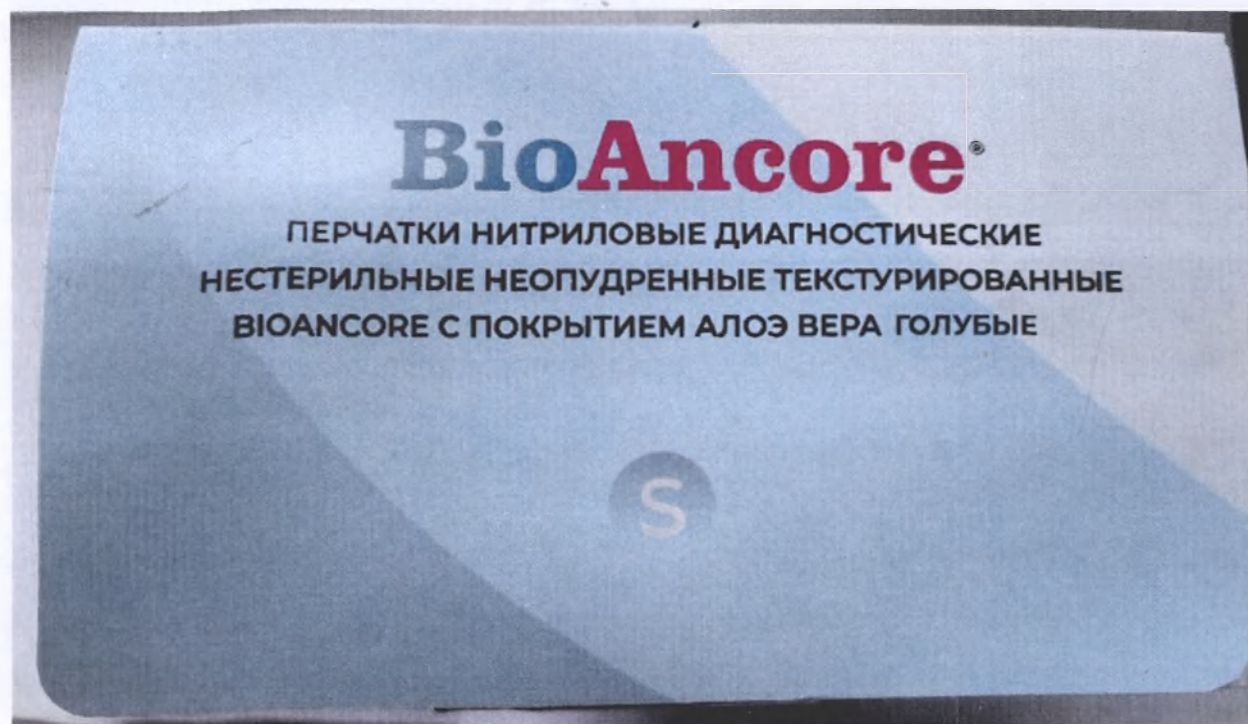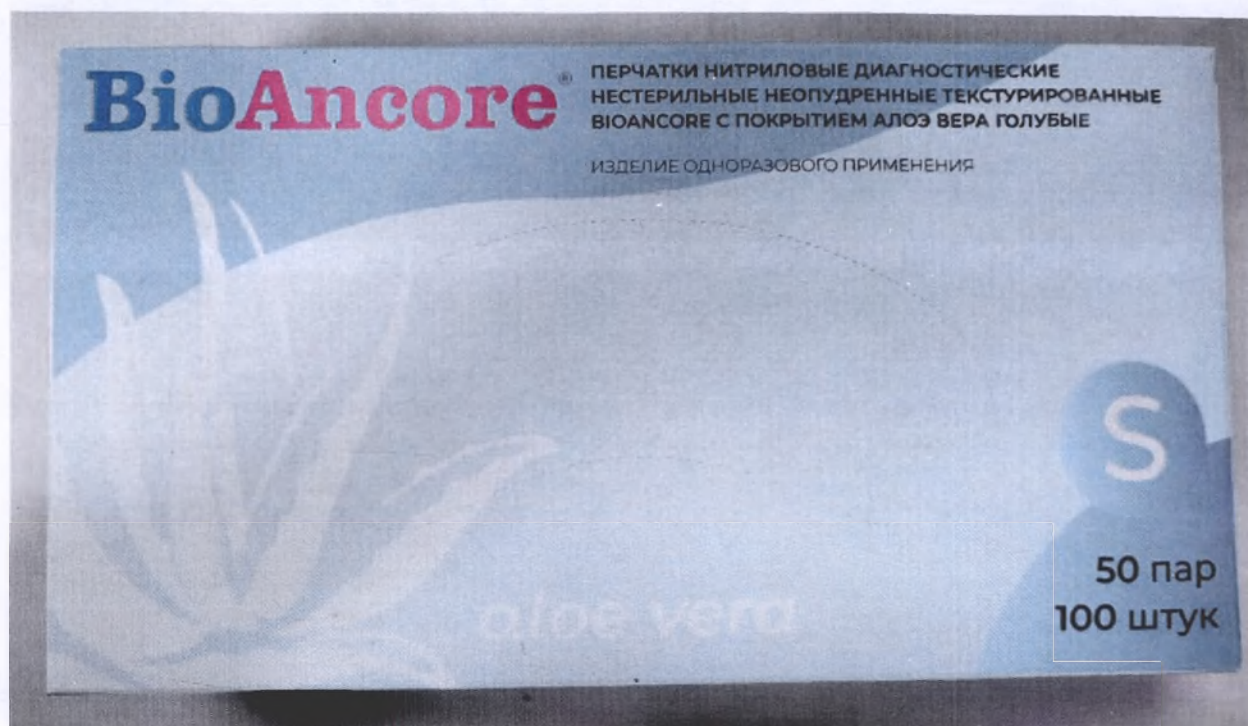

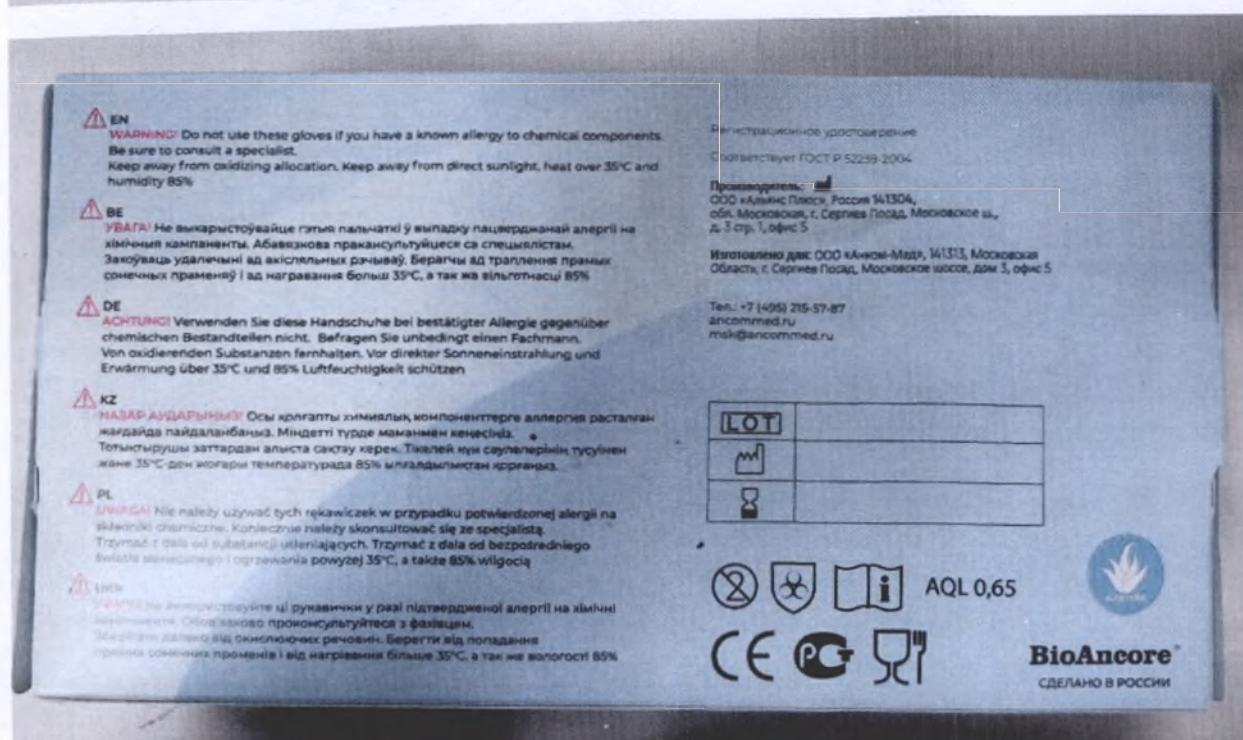
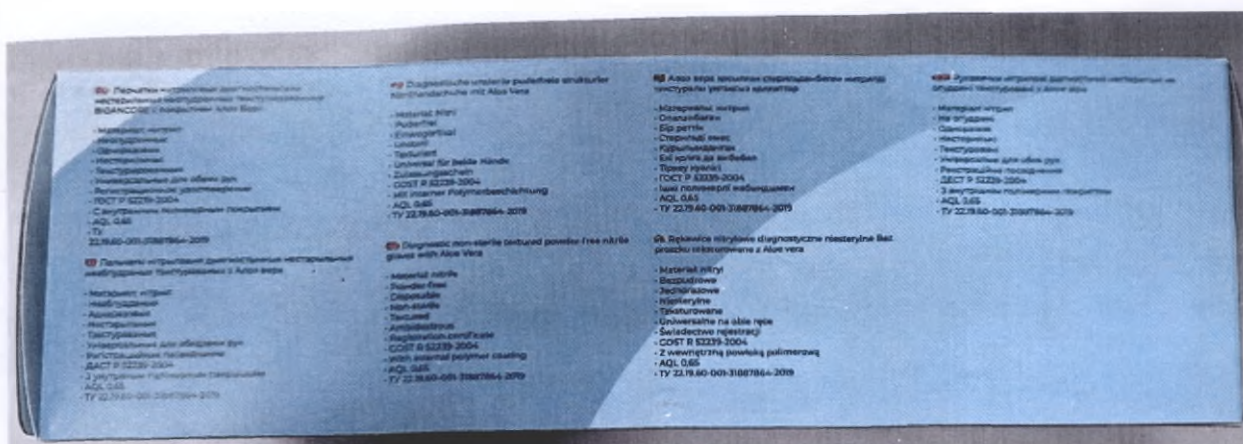


Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore® с покрытием Алоэ вера, цвет бирюзовый;



Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore® с покрытием Алоэ вера, цвет бирюзовый;





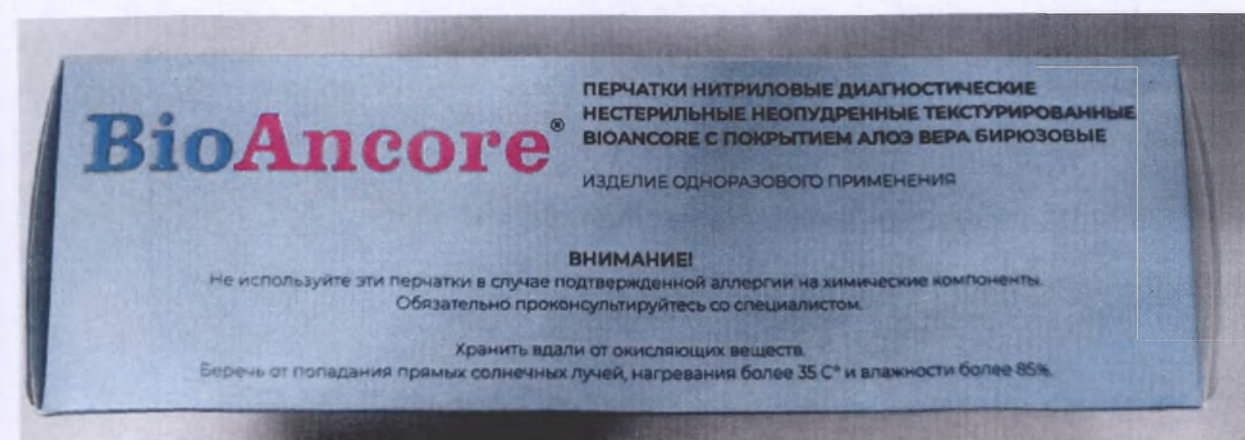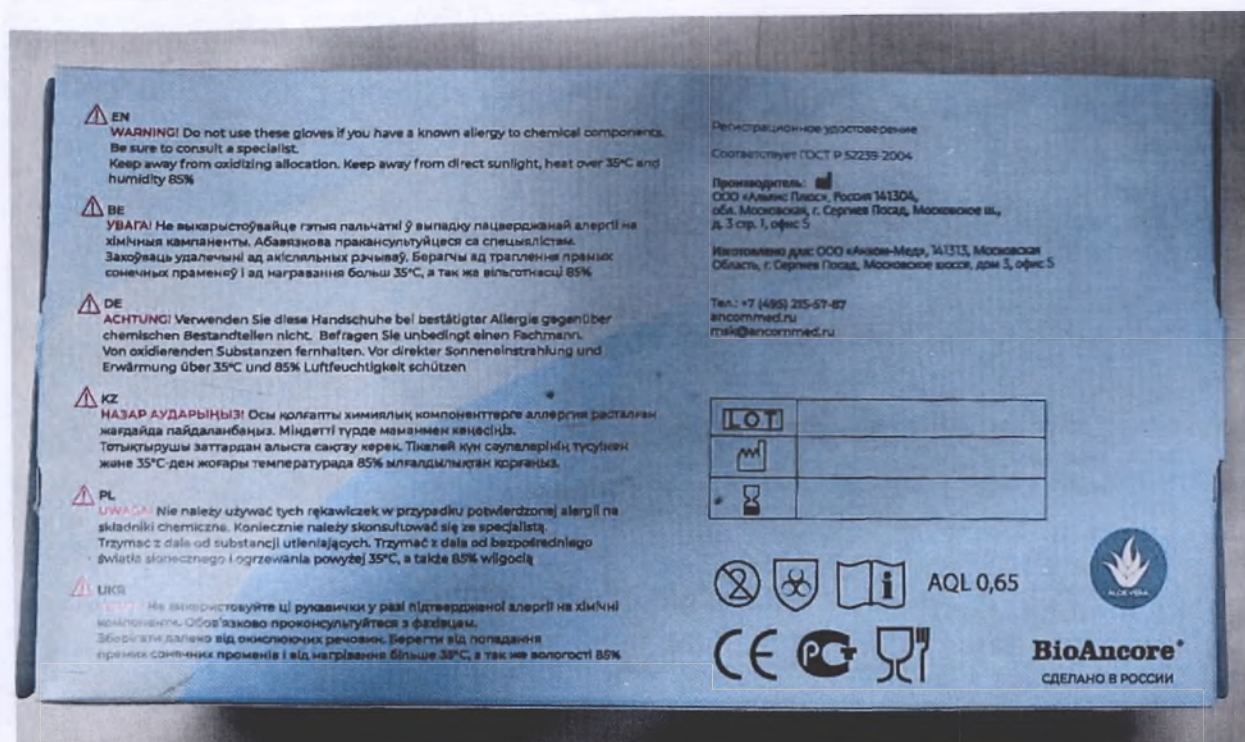

Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore® с покрытием Алоэ вера, цвет лиловый



Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore® с покрытием Алоэ вера, цвет лиловый

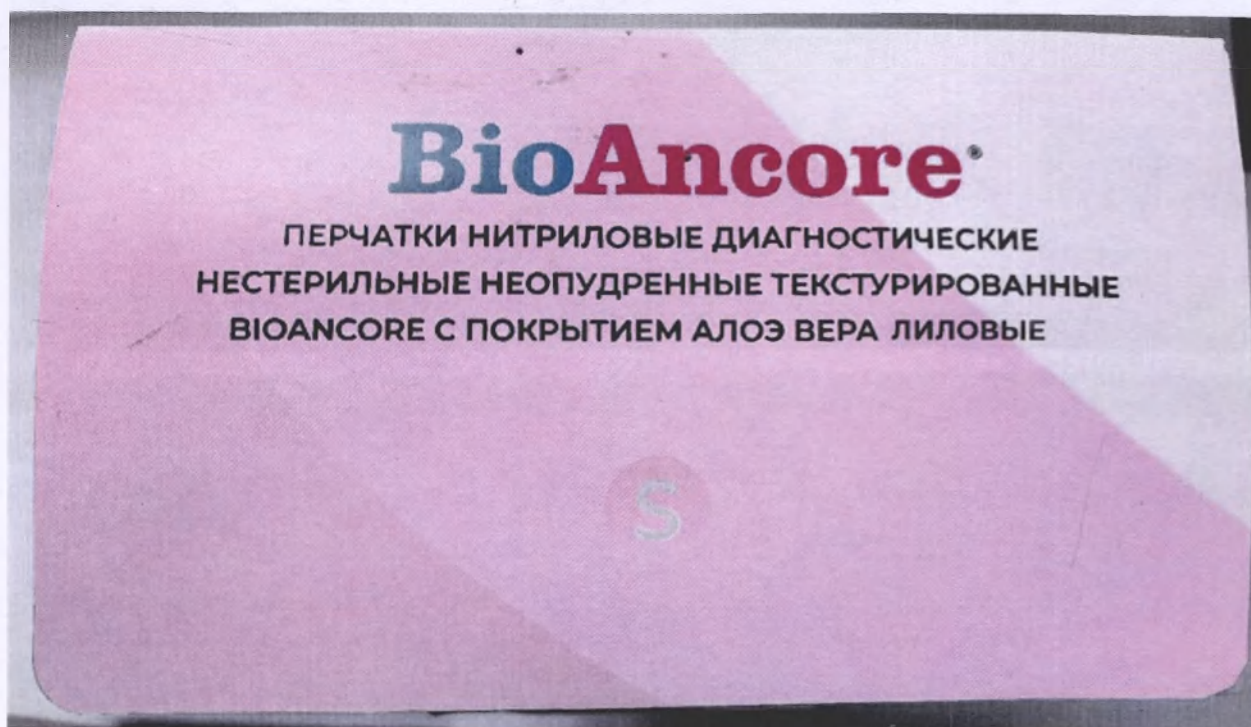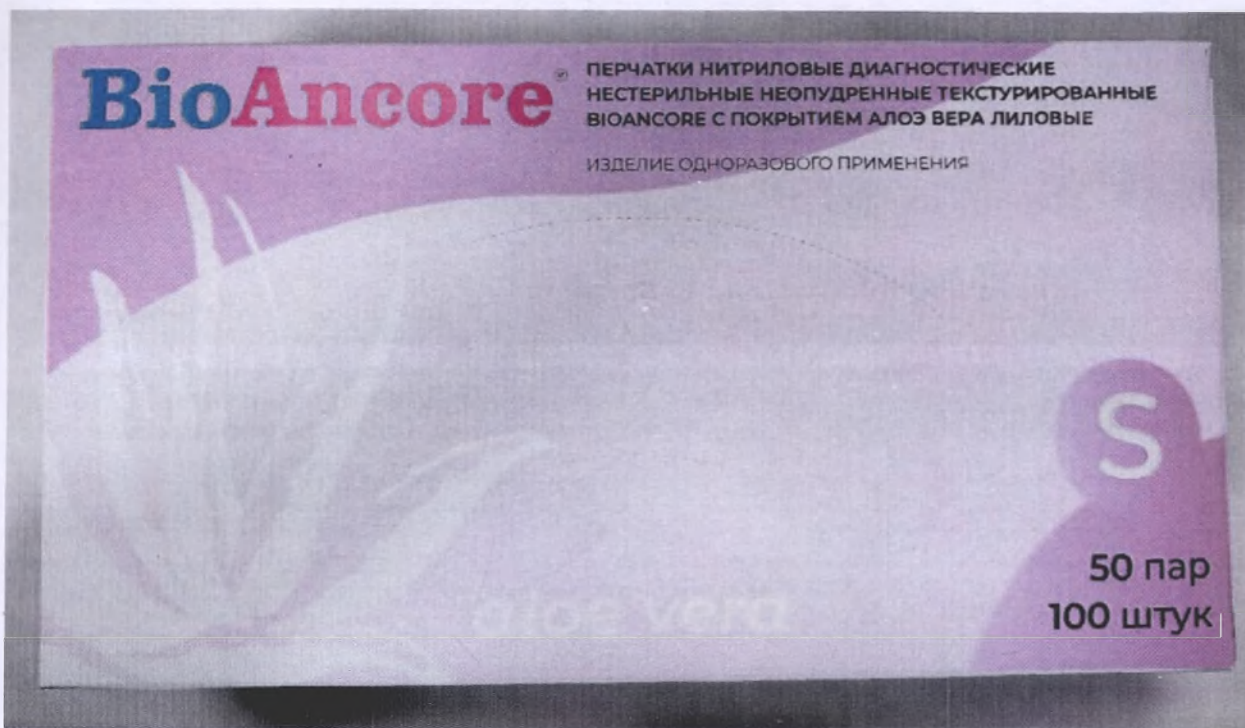

Материалы и методы
Несколько десятков
Автомобильных
Несколько десятков
Технологических
Информационных для образования
Результаты исследования
ДАН 1999-2000
1. Результаты исследования
АВ 1999
Ст. 22. 1999-2000

- Material Nitri
- Pulverfrei
- Einwegartikel
- Latexfrei
- Reduziert
- Universell für beide Hände
- Zuluftungsloch
- CE-Zertifikat W 00329-2004
- Mit Innere Polymerbeschichtung
- AQI 0,85

- Material nitrile
- Powder free
- Disposable
- Non-sterile
- Textured
- Ambidextrous
- Registration certificate
- CGST R 32239-2004
- With internal polymer coating
- AQL Q45
- Tel: 27 2823 005, 2827664, 2095

- Материалдык көмөктөш
- Ойго чыгаруу
- Бир рөлгө
- Стендизди жасап
- Күрөңдүктөрдү
- Көз көрүүгө да жетишет
- Токтоу кылат
- ТӨКП № 22338-2604
- 100% жана 100% жана 100%
- АЛ. А.А.
- ТУ. 22.11.2004-001 22.11.2004-001

- Materiał nityl
- Bezspodrowe
- Jasniorazowe
- Hlekaryjne
- Teksturowane
- Uniwersalne na obsie rpej
- Świadczyce rejestracji
- GOST R 52339-2004
- Z uwzględnieniem powielki polimerowej
- AQZ 0,65
- Tm 17,18 do 200, 11,87 i 16,4 - 200

- математический анализ
- геометрия
- алгебра
- тригонометрия
- теория вероятностей
- статистика
- дифференциальное и интегральное исчисление
- математическая физика
- численные методы
- математическое моделирование
- математическая логика
- математическая информатика
- математическая лингвистика
- математическая психология
- математическая социология
- математическая экономика
- математическая биология
- математическая медицина
- математическая педагогика
- математическая философия
- математическая история
- математическая культура
- математическая эстетика
- математическая этика
- математическая религия
- математическая политика
- математическая юриспруденция
- математическая журналистика
- математическая литература
- математическая музыка
- математическая живопись
- математическая скульптура
- математическая архитектура
- математическая инженерия
- математическая техника
- математическая промышленность
- математическая торговля
- математическая транспортная система
- математическая связь
- математическая энергетика
- математическая экология
- математическая безопасность
- математическая оборона
- математическая наука
- математическая культура
- математическая философия
- математическая история
- математическая культура
- математическая эстетика
- математическая этика
- математическая религия
- математическая политика
- математическая юриспруденция
- математическая журналистика
- математическая литература
- математическая музыка
- математическая живопись
- математическая скульптура
- математическая архитектура
- математическая инженерия
- математическая техника
- математическая промышленность
- математическая торговля
- математическая транспортная система
- математическая связь
- математическая энергетика
- математическая экология
- математическая безопасность
- математическая оборона
- математическая наука

Увага! Не використовуйте ці рукавички у разі підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Рішуче відмовою проконсультуйтеся з фахівцем.
Зберігати далеко від окислюючих речовин. Березти від попадання прямих сонячних променів і від нагрівання більше 35°C, а так же вологості 85%

LOT	
	
	





BioAncore®
СДЕЛАНО В РОССИИ

Хранить вдали от окисляющих веществ
Беречь от попадания прямых солнечных лучей, нагревания более 35 °С и влажности более 85%

Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore® с покрытием Алоэ вера, цвет розовый



Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore® с покрытием Алоэ вера, цвет розовый

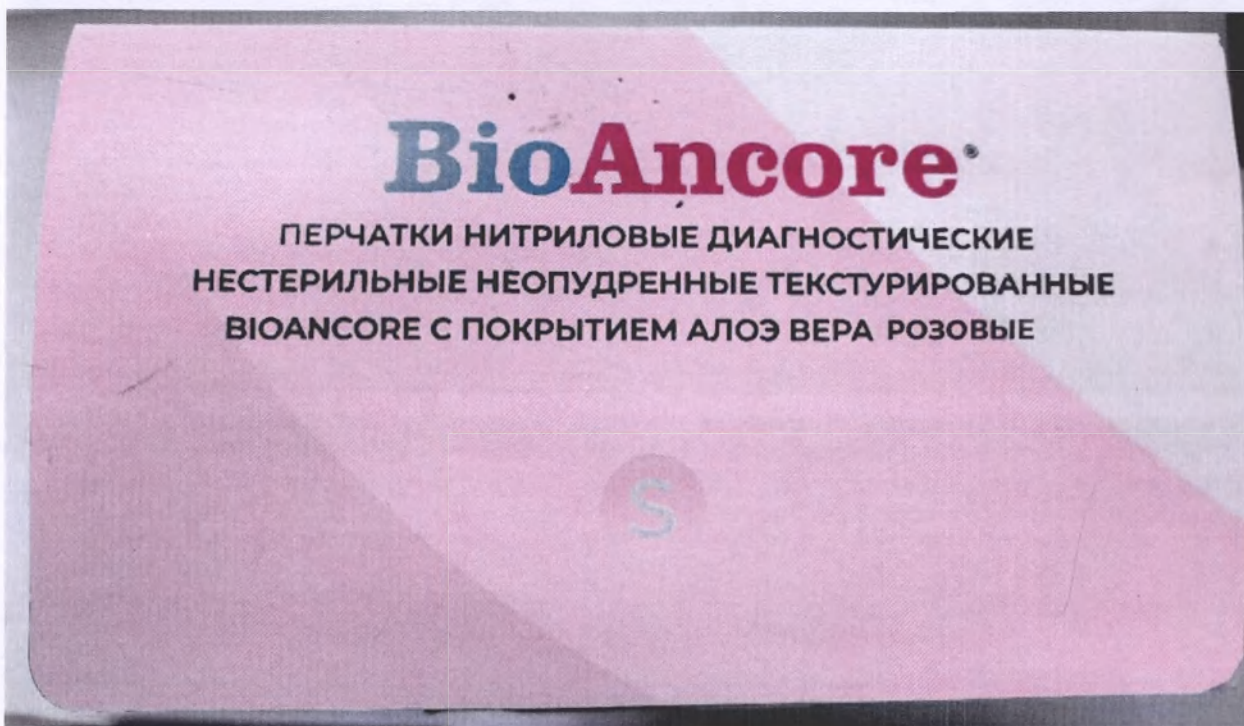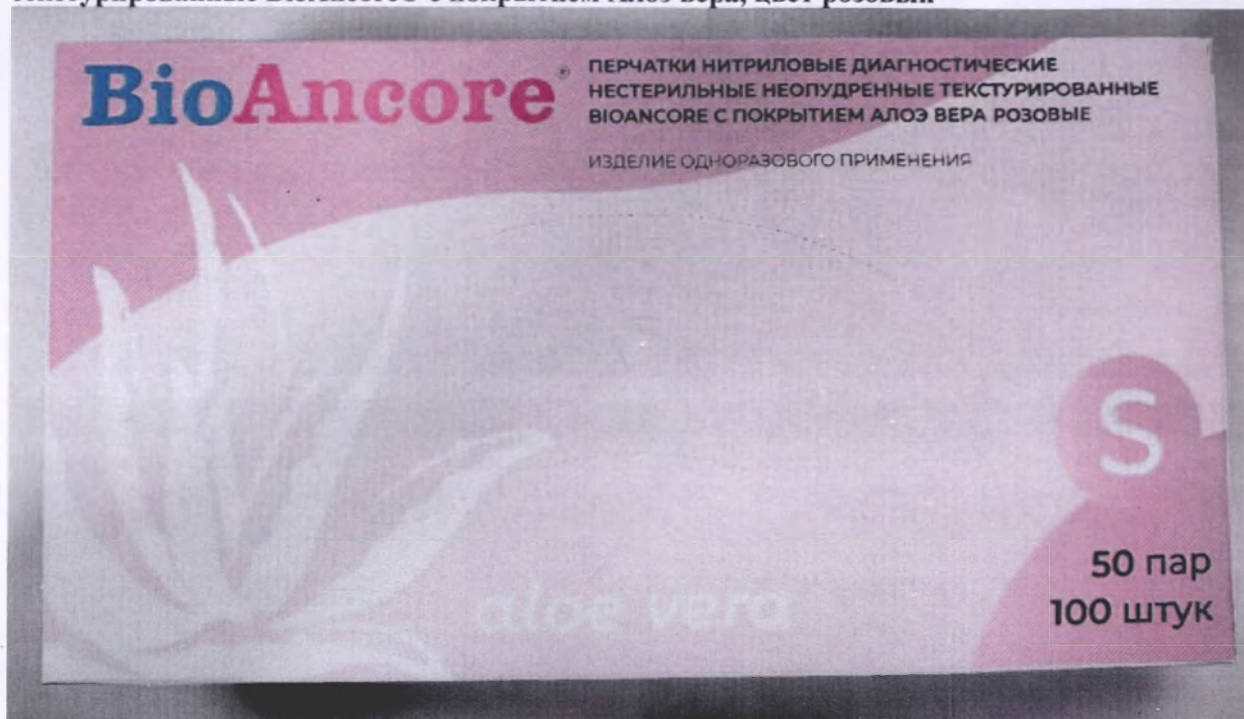

ВН Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BIOANCORE с покрытием Aloe Vera

• Материал: нитрил
• Не стерильно
• Одноразовые
• Непудренные
• Текстурированные
• Универсальные для обеих рук
• Регистрационное удостоверение
• ГОСТ Р 52239-2004
• Соответствие Национальным Стандартам
• AQL 0,65
• TY 22.95.40-001-2007964-2019

EN Пальчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные с Aloe Vera

• Material: nitril
• Niet-steriel
• Eenmalig
• Niet-poedert
• Textuurde
• Universeel voor beide handen
• Registratiecertificaat
• NEN-EN 455
• Ty 22.95.40-001-2007964-2019

DE Diagnostische nitrile powderfreie steriltlose Handschuhe mit Aloe Vera

• Material: Nitril
• Nicht-steril
• Einmalig
• Unpudert
• Universell für beide Hände
• Registrierzertifikat
• EN 455
• Ty 22.95.40-001-2007964-2019

PL Diagnostyczne nitrilowe diagnostyczne niesterylne bez proszku rękawiczki z Aloe Vera

• Materiał: nitril
• Nie sterylne
• Jednorazowe
• Nieposredekowane
• Uniwersalne na obie ręce
• Certyfikat rejestracji
• EN 455
• Ty 22.95.40-001-2007964-2019

RU Aloe vera покрытие стерильных перчаток

• Материал: нитрил
• Стерильные
• Одноразовые
• С покрытием Aloe Vera
• Универсальные для обеих рук
• Регистрационное удостоверение
• AQL 0,65
• TY 22.95.40-001-2007964-2019

UA Рукавички нитрилові діагностичні нестерильні неопудрені з алое вера

• Матеріал: нитрил
• Не стерильні
• Одноразові
• Нестерильні
• Текстуризовані
• Універсальні для обох рук
• Реєстраційне посвідчення
• AQL 0,65
• TY 22.95.40-001-2007964-2019

EN

WARNING! Do not use these gloves if you have a known allergy to chemical components. Be sure to consult a specialist. Keep away from oxidizing allocation. Keep away from direct sunlight, heat over 35°C and humidity 85%

BE

UWAGA! Nie wykorzystujcie gątkich palczatki u wypadku potwierdzonej alergii na chemiczne komponenty. Abazakowa prokonsumulujecie sa specjalistam. Zakończajcie uwalczanie ad okislających rączkowie. Beragchi ad trapienia pramych sonicznych promieni i ad nagrawania bolisz 35°C, a tak na wylagotnasci 85%

DE

ACHTUNG! Verwenden Sie diese Handschuhe bei bestätigter Allergie gegenüber chemischen Bestandteilen nicht. Befragen Sie unbedingt einen Fachmann. Von oxidierenden Substanzen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Erwärmung über 35°C und 85% Luftfeuchtigkeit schützen

KZ

HAZAR AUDARYNY! Osi kolkalty chymialyk komponentterge allergia rastalga jarda paldalybany. Minietti turde mamannen menjisiz. Topkyruşy zatardan alista saktu kerex. Tikeliy huk saupalyrnyk tustuen jone 35°C-den jogary temperatura 85% mlyadlylyktan korqany.

PL

UWAGA! Nie należy używać tych rękawiczek w przypadku potwierdzonej alergii na składniki chemiczne. Koniecznie należy skonsultować się ze specjalistą. Trzymać z dala od substancji utleniających. Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ogrzewania powyżej 35°C, a także 85% wilgotności

UKP

УВАГА! Не використовуйте ці рукавички у разі підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем. Зберігати далеко від окислюючих речовин. Берігти від попадання прямих сонячних променів і від нагрівання більше 35°C, а так же вологості 85%

Регистрационное удостоверение

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004

Производитель: ООО «Анкор Мед», Россия 141304, обл. Московская, г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 3, стр. 1, офис 5

Надано для ООО «Анкор Мед», 141313, Московская Область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 3, офис 5

Тел: +7 (495) 215-57-87
ancommed.ru
msk@ancommed.ru

LOT	



BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
BIOANCORE С ПОКРЫТИЕМ АЛОЭ ВЕРА РОЗОВЫЕ

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!


Не используйте эти перчатки в случае подтвержденной аллергии на химические компоненты. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Хранить вдали от окисляющих веществ.
Беречь от попадания прямых солнечных лучей, нагревания более 35 °C и влажности более 85%.

Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAnsove® с покрытием Алоэ вера, цвет салатный



Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore® с покрытием Алоэ вера, цвет салатовый

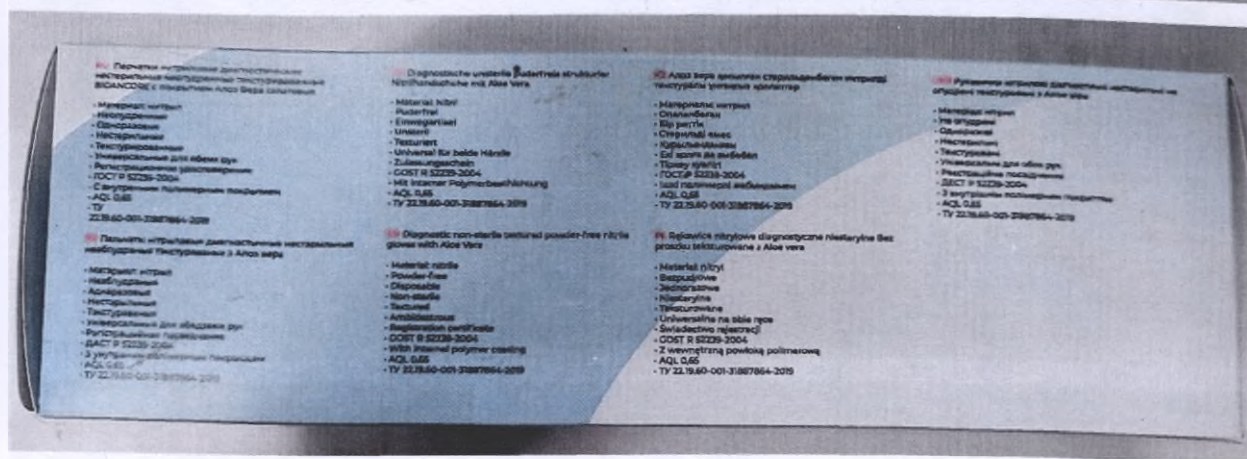

EN
WARNING: Do not use these gloves if you have a known allergy to chemical components. Be sure to consult a specialist. Keep away from oxidizing allocation. Keep away from direct sunlight, heat over 35°C and humidity 85%

BE
УВАГА! Не використовуйте ці рукавички у випадку підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся зі спеціалістом. Зберігайте далекі від окислюючих речовин. Берегти від попадання прямих сонячних променів і від нагрівання більш 35°C, а так же вологості 85%

DE
ACHTUNG! Verwenden Sie diese Handschuhe bei bestätigter Allergie gegenüber chemischen Bestandteilen nicht. Befragen Sie unbedingt einen Fachmann. Von oxidierenden Substanzen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Erwärmung über 35°C und 85% Luftfeuchtigkeit schützen

KZ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы қолғапты химиялық компоненттерге аллергия расталған жағдайда пайдаланбаңыз. Міндетті түрде маманмен кеңесіңіз. Тотықтырушы заттардан алыста сақтау керек. Тікелей күн сәулелерінің түсуінен және 35°C-ден жоғары температурада 85% ылғалдылықтан қорғаныңыз.

PL
UWAGA! Nie należy używać tych rękawiczek w przypadku potwierdzonej alergii na składniki chemiczne. Konieczne należy skonsultować się ze specjalistą. Trzymać z dala od substancji utleniających. Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ogrzewania powyżej 35°C, a także 85% wilgotności

UKR
УВАГА! Не використовуйте ці рукавички у разі підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем. Зберігати далеко від окислюючих речовин. Берегти від попадання прямих сонячних променів і від нагрівання більш 35°C, а так же вологості 85%

Регистрационное удостоверение

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004

Производитель: ООО «Анкор-Мед», Россия 141304, обл. Московская, г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 3 стр. 1, офис 5

Изготовлено для: ООО «Анкор-Мед», 141313, Московская Область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 3, офис 5

Тел.: +7 (495) 215-57-87
ancommed.ru
msk@ancommed.ru

LOT	

AQL 0,65



BioAncore®
СДЕЛАНО В РОССИИ

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
BIOANCORE С ПОКРЫТИЕМ АЛОЭ ВЕРА САЛАТОВЫЕ

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не используйте эти перчатки в случае подтвержденной аллергии на химические компоненты. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Хранить вдали от окисляющих веществ.

Бережь от попадания прямых солнечных лучей, нагревания более 35°C и влажности более 85%.

BioAncore®



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
BIOANCORE С ПОКРЫТИЕМ АЛОЭ ВЕРА САЛАТОВЫЕ



Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет зеленый



Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет зеленый

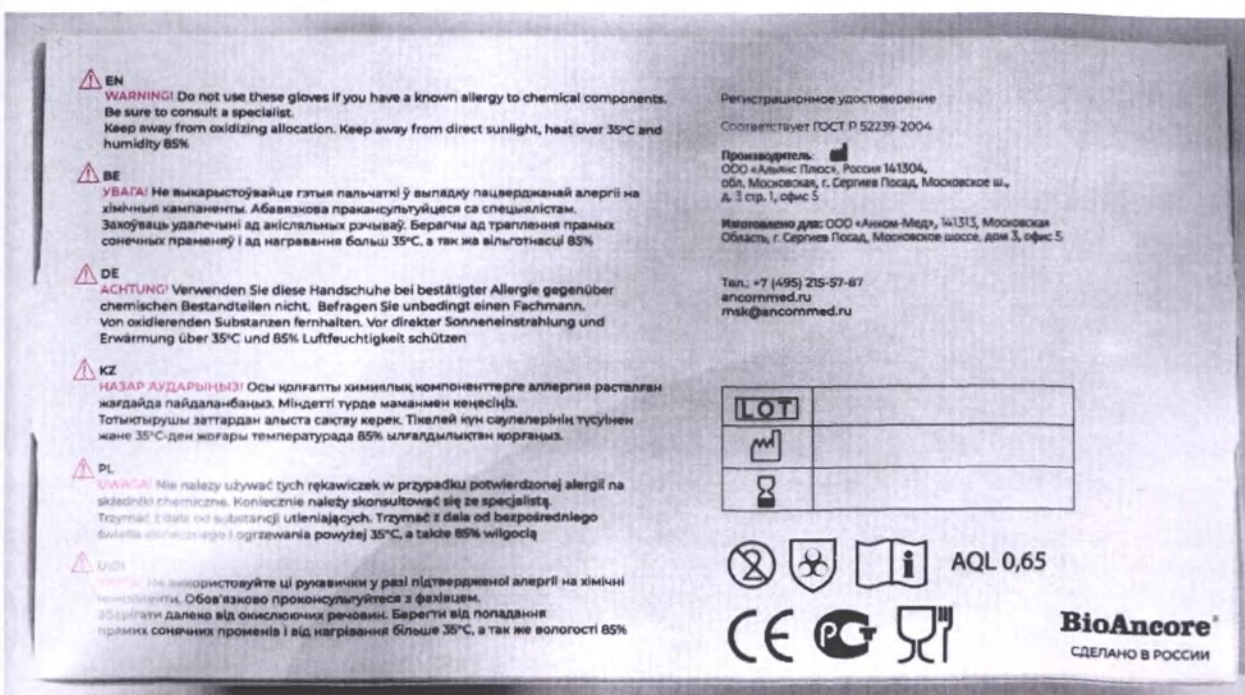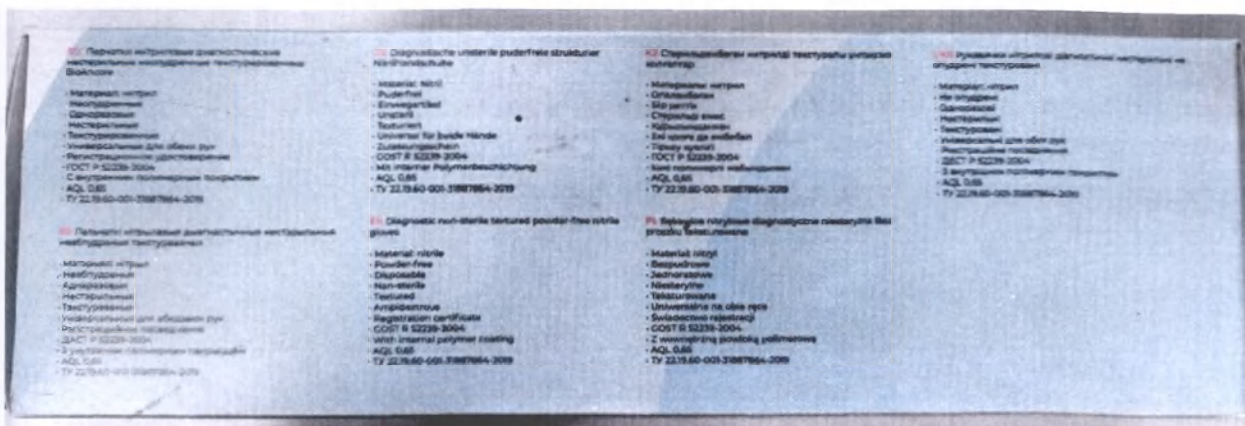

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE ЗЕЛЕНЫЕ

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не используйте эти перчатки в случае подтвержденной аллергии на химические компоненты.
Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Хранить вдали от окисляющих веществ.
Беречь от попадания прямых солнечных лучей, нагревания более 35 С° и влажности более 85%.

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE ЗЕЛЕНЫЕ



Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет голубой



Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет голубой



EN Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные голубые

- Материал: нитрил
- Неопудренные
- Одноразовые
- Нестерильные
- Текстурированные
- Универсальный для обеих рук
- Регистрационное удостоверение РОСТ R 52239-2004
- С внутренним полимерным покрытием
- AQL 0,65
- ТУ 22.94.60-001.31887864-2019

DE Diagnostische unsterile puderfreie strukturierte Nitrilhandschuhe

- Material: Nitril
- Puderfrei
- Einwegartikel
- Unsteril
- Texturiert
- Universal für beide Hände
- Zulassungszertifikat
- GOST R 52239-2004
- Mit innerer Polymerbeschichtung
- AQL 0,65
- ТУ 22.94.60-001.31887864-2019

KZ Стерильно-белые нитриды текстурированные голубые

- Материал: нитрил
- Спиральное
- Без резины
- Стерильный белый
- Карманчатый
- Без колпака на пальцах
- Ткань: хлопок
- ТУ 22.94.60-001.31887864-2019

PL Rękawiczki nitrilowe diagnostyczne niesterylne nieopudrowane niebieskie

- Materiał: nitril
- Nie opudrowane
- Jednorazowe
- Nesterylne
- Teksturyzowane
- Uniwersalne dla obu rąk
- Wzrostowe posiadanie
- DOST R 52239-2004
- Z wewnętrzną powłoką polimerową
- AQL 0,65
- ТУ 22.94.60-001.31887864-2019

EN Пальчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные

- Материал: нитрил
- Неопудренные
- Одноразовые
- Нестерильные
- Текстурированные
- Универсальный для обеих рук
- Регистрационное удостоверение РОСТ R 52239-2004
- С внутренним полимерным покрытием
- AQL 0,65
- ТУ 22.94.60-001.31887864-2019

DE Diagnostische non-sterile textured powder-free nitrile gloves

- Material: nitril
- Powder-free
- Disposable
- Non-sterile
- Textured
- Ambidextrous
- Registration certificate
- GOST R 52239-2004
- With internal polymer coating
- AQL 0,65
- ТУ 22.94.60-001.31887864-2019

PL Rękawiczki nitrilowe diagnostyczne niesterylne bez proszku teksturyzowane

- Materiał: nitril
- Bez proszku
- Jednorazowe
- Nesterylne
- Teksturyzowane
- Uniwersalne na obie ręce
- Posiadanie pozwolenia
- GOST R 52239-2004
- Z wewnętrzną powłoką polimerową
- AQL 0,65
- ТУ 22.94.60-001.31887864-2019

EN **WARNING!** Do not use these gloves if you have a known allergy to chemical components. Be sure to consult a specialist. Keep away from oxidizing allocation, Keep away from direct sunlight, heat over 35°C and humidity 85%.

DE **WICHTIG!** Nie używajcie tych rękawiczek w przypadku potwierdzonej alergii na chemiczne składniki. Obowiązkowo skonsultujcie się ze specjalistą. Zakończcie udalenie od utleniających renowin. Beretny від попадання прямих сонячних променів і від нагрівання більш 35°C, а так же вологості 85%.

DE **ACHTUNG!** Verwenden Sie diese Handschuhe bei bestätigter Allergie gegenüber chemischen Bestandteilen nicht. Befragen Sie unbedingt einen Fachmann. Von oxidierenden Substanzen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Erwärmung über 35°C und 85% Luftfeuchtigkeit schützen.

KZ **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Осы колгалты химиялык компоненттерге аллергия расталган жагдайда пайдаланбаңыз. Міндетті түрде маманмен кеңесіңіз. Топтырушы заттардан алыста сақтау керек. Тікелей кун сәулелерінің түсуінен және 35°C-ден жоғары температурада 85% ылғалдылыстан қорғаныз.

PL **UWAGA!** Nie należy używać tych rękawiczek w przypadku potwierdzonej alergii na składniki chemiczne. Koniecznie należy skonsultować się ze specjalistą. Trzymać z dala od substancji utleniających. Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ogrzewania powyżej 35°C, a także 85% wilgotności.

UKR **УВАГА!** Не використовуйте ці рукавички у разі підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем. Зберіть далі від окислюючих речовин. Беретти від попадання прямих сонячних променів і від нагрівання більше 35°C, а так же вологості 85%.

Регистрационное удостоверение

Соответствует ГОСТ R 52239-2004


Производитель: ООО «Альянс Плюс», Россия 141304, обл. Московская, г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 3 стр. 1, офис 5

Наготовлено для: ООО «Альянс Плюс», 141313, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 3, офис 5

Тел: +7 (495) 215-57-87
ancommed.ru
msk@ancommed.ru

LOT	
1	
2	

AQL 0,65



BioAncore®
СДЕЛАНО В РОССИИ

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE ГОЛУБЫЕ

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не используйте эти перчатки в случае подтвержденной аллергии на химические компоненты. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Хранить вдали от окисляющих веществ.
Беречь от попадания прямых солнечных лучей, нагревания более 35 °C и влажности более 85%.

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE ГОЛУБЫЕ



Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет бирюзовый



Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет бирюзовый



BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE БИРЮЗОВЫЕ

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не используйте эти перчатки в случае подтвержденной аллергии на химические компоненты.
Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Хранить вдали от окисляющих веществ.

Беречь от попадания прямых солнечных лучей, нагревания более 35 °C и влажности более 85%.



EN
WARNING! Do not use these gloves if you have a known allergy to chemical components.
Be sure to consult a specialist.
Keep away from oxidizing allocation. Keep away from direct sunlight, heat over 35°C and humidity 85%.



BE
УВАГА! Не використовуйте ці рукавички у випадку підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся зі спеціалістом.
Захищайтеся від впливу окислюючих речовин, безпосереднього потрапляння прямих сонячних променів і від нагрівання більш 35°C, а так же вологості 85%.



DE
ACHTUNG! Verwenden Sie diese Handschuhe bei bestätigter Allergie gegenüber chemischen Bestandteilen nicht. Befragen Sie unbedingt einen Fachmann.
Von oxidierenden Substanzen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Erwärmung über 35°C und 85% Luftfeuchtigkeit schützen.



KZ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы қолғапты химиялық компоненттерге аллергия расталған жағдайда пайдаланбаңыз. Міндетті түрде маманмен кеңесіңіз.
Тотықанды заттардан алыста сақтау керек. Тікелей күн сәулелерінің түсуінен және 35°C-ден жоғары температурада 85% ылғалдылықтан қорғаныңыз.



PL
UWAGA! Nie należy używać tych rękawiczek w przypadku potwierdzonej alergii na składniki chemiczne. Konieczne należy skonsultować się ze specjalistą.
Trzymać z dala od substancji utleniających. Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ogrzewania powyżej 35°C, a także 85% wilgotności.



UKR
УВАГА! Не використовуйте ці рукавички у разі підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем.
Зберігати далеко від окислюючих речовин. Берігати від потрапляння прямих сонячних променів і від нагрівання більш 35°C, а так же вологості 85%.

Регистрационное удостоверение

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004

Производитель: ООО «Альмис Плюс», Россия 141304,
обл. Московская, г. Сергиев Посад, Московское ш.,
д. 3 стр. 1, офис 5

Изготовлено для: ООО «Анком-Мед», 141313, Московская
Область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 3, офис 5

Тел: +7 (495) 215-57-87

ancommed.ru

msk@ancommed.ru

LOT	



BioAncore®
СДЕЛАНО В РОССИИ

1. Перчатки нитриловые для диагностики лабораторных исследований, нестерильные, неопудренные, текстурированные, бирюзовые.

Материал: нитрил
Конструкция: перчаточная
Свойства: нестерильные, неопудренные, текстурированные
Упаковка: индивидуальная, для одного использования
Внешний вид: бирюзовые, одноразовые
ГОСТ Р 52239-2004
С сертификатами соответствия требованиям
АQL 0,65
ТУ 22.940-001-2007/05-2009

2. Перчатки нитриловые для диагностики лабораторных исследований, нестерильные, неопудренные, текстурированные, бирюзовые.

Материал: нитрил
Конструкция: перчаточная
Свойства: нестерильные, неопудренные, текстурированные
Упаковка: индивидуальная, для одного использования
Внешний вид: бирюзовые, одноразовые
ГОСТ Р 52239-2004
С сертификатами соответствия требованиям
АQL 0,65
ТУ 22.940-001-2007/05-2009

3. Перчатки нитриловые для диагностики лабораторных исследований, нестерильные, неопудренные, текстурированные, бирюзовые.

Материал: нитрил
Конструкция: перчаточная
Свойства: нестерильные, неопудренные, текстурированные
Упаковка: индивидуальная, для одного использования
Внешний вид: бирюзовые, одноразовые
ГОСТ Р 52239-2004
С сертификатами соответствия требованиям
АQL 0,65
ТУ 22.940-001-2007/05-2009

4. Перчатки нитриловые для диагностики лабораторных исследований, нестерильные, неопудренные, текстурированные, бирюзовые.

Материал: нитрил
Конструкция: перчаточная
Свойства: нестерильные, неопудренные, текстурированные
Упаковка: индивидуальная, для одного использования
Внешний вид: бирюзовые, одноразовые
ГОСТ Р 52239-2004
С сертификатами соответствия требованиям
АQL 0,65
ТУ 22.940-001-2007/05-2009

5. Перчатки нитриловые для диагностики лабораторных исследований, нестерильные, неопудренные, текстурированные, бирюзовые.

Материал: нитрил
Конструкция: перчаточная
Свойства: нестерильные, неопудренные, текстурированные
Упаковка: индивидуальная, для одного использования
Внешний вид: бирюзовые, одноразовые
ГОСТ Р 52239-2004
С сертификатами соответствия требованиям
АQL 0,65
ТУ 22.940-001-2007/05-2009

6. Перчатки нитриловые для диагностики лабораторных исследований, нестерильные, неопудренные, текстурированные, бирюзовые.

Материал: нитрил
Конструкция: перчаточная
Свойства: нестерильные, неопудренные, текстурированные
Упаковка: индивидуальная, для одного использования
Внешний вид: бирюзовые, одноразовые
ГОСТ Р 52239-2004
С сертификатами соответствия требованиям
АQL 0,65
ТУ 22.940-001-2007/05-2009

7. Перчатки нитриловые для диагностики лабораторных исследований, нестерильные, неопудренные, текстурированные, бирюзовые.

Материал: нитрил
Конструкция: перчаточная
Свойства: нестерильные, неопудренные, текстурированные
Упаковка: индивидуальная, для одного использования
Внешний вид: бирюзовые, одноразовые
ГОСТ Р 52239-2004
С сертификатами соответствия требованиям
АQL 0,65
ТУ 22.940-001-2007/05-2009

8. Перчатки нитриловые для диагностики лабораторных исследований, нестерильные, неопудренные, текстурированные, бирюзовые.

Материал: нитрил
Конструкция: перчаточная
Свойства: нестерильные, неопудренные, текстурированные
Упаковка: индивидуальная, для одного использования
Внешний вид: бирюзовые, одноразовые
ГОСТ Р 52239-2004
С сертификатами соответствия требованиям
АQL 0,65
ТУ 22.940-001-2007/05-2009

BioAncore®


ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
BIOANCORE БИРЮЗОВЫЕ



Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет лиловый



Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет лиловый

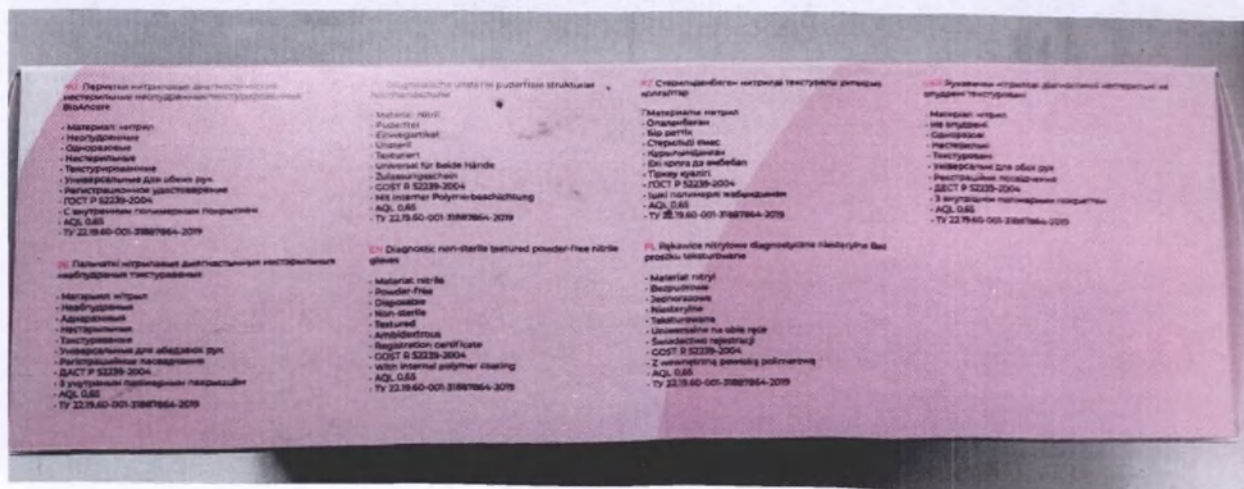

EN
WARNUNG: Do not use these gloves if you have a known allergy to chemical components. Be sure to consult a specialist. Keep away from oxidizing allocation. Keep away from direct sunlight, heat over 35°C and humidity 85%.

BE
VERBODEN: Не используйте эти перчатки у людей с подтвержденной аллергией на химические компоненты. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Хранить вдали от окисляющих веществ. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и от нагревания больше 35°C, а также влажности 85%.

DE
ACHTUNG: Verwenden Sie diese Handschuhe bei bestätigter Allergie gegenüber chemischen Bestandteilen nicht. Befragen Sie unbedingt einen Fachmann. Von oxidierenden Substanzen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Erwärmung über 35°C und 85% Luftfeuchtigkeit schützen.

KZ
HAZAR ALDABAYAN: Осы қолғапты химиялық компоненттерге аллергия расталған жағдайда пайдаланбаңыз. Міндетті түрде маманмен кеңесіңіз. Топтырылушы заттардан алыста сақтау керек. Тікелей күн сәулелерінің түсуінен және 35°C-ден жоғары температурада 85% ылғалдылықтан қорғаңыз.

PL
UWAGA: Nie należy używać tych rękawiczek w przypadku potwierdzonej alergii na składniki chemiczne. Konieczne należy skonsultować się ze specjalistą. Trzymać z dala od substancji utleniających. Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ogrzewania powyżej 35°C, a także 85% wilgotności.

UKR
УВАГА: Не використовуйте ці рукавички у разі підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем. Зберігати далеко від окислюючих речовин. Берігти від попадання прямих сонячних променів і від нагрівання більше 35°C, а так же вологості 85%.

Регистрационное удостоверение

Свидетельство ГОСТ Р 52339-2004

Продавец:
 ООО «Анкор Плюс», Россия 141304,
 обл. Московская, г. Сергиев Посад, Московское ш.,
 д. 3 стр. 1, офис 5

Изготовлено для: ООО «Анкор-Мед», 141313, Московская
 Область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 3, офис 5

Тел: +7 (495) 215-87-87
 ancommed.ru
 msk@ancommed.ru

LOT	

AQL 0,65

BioAncore®
 СДЕЛАНО В РОССИИ

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
 НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
 ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE ЛИЛОВЫЕ
 ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ


ВНИМАНИЕ!

Не используйте эти перчатки в случае подтвержденной аллергии на химические компоненты.
 Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.


Хранить вдали от окисляющих веществ.
 Беречь от попадания прямых солнечных лучей, нагревания более 35°C и влажности более 85%.



Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет розовый

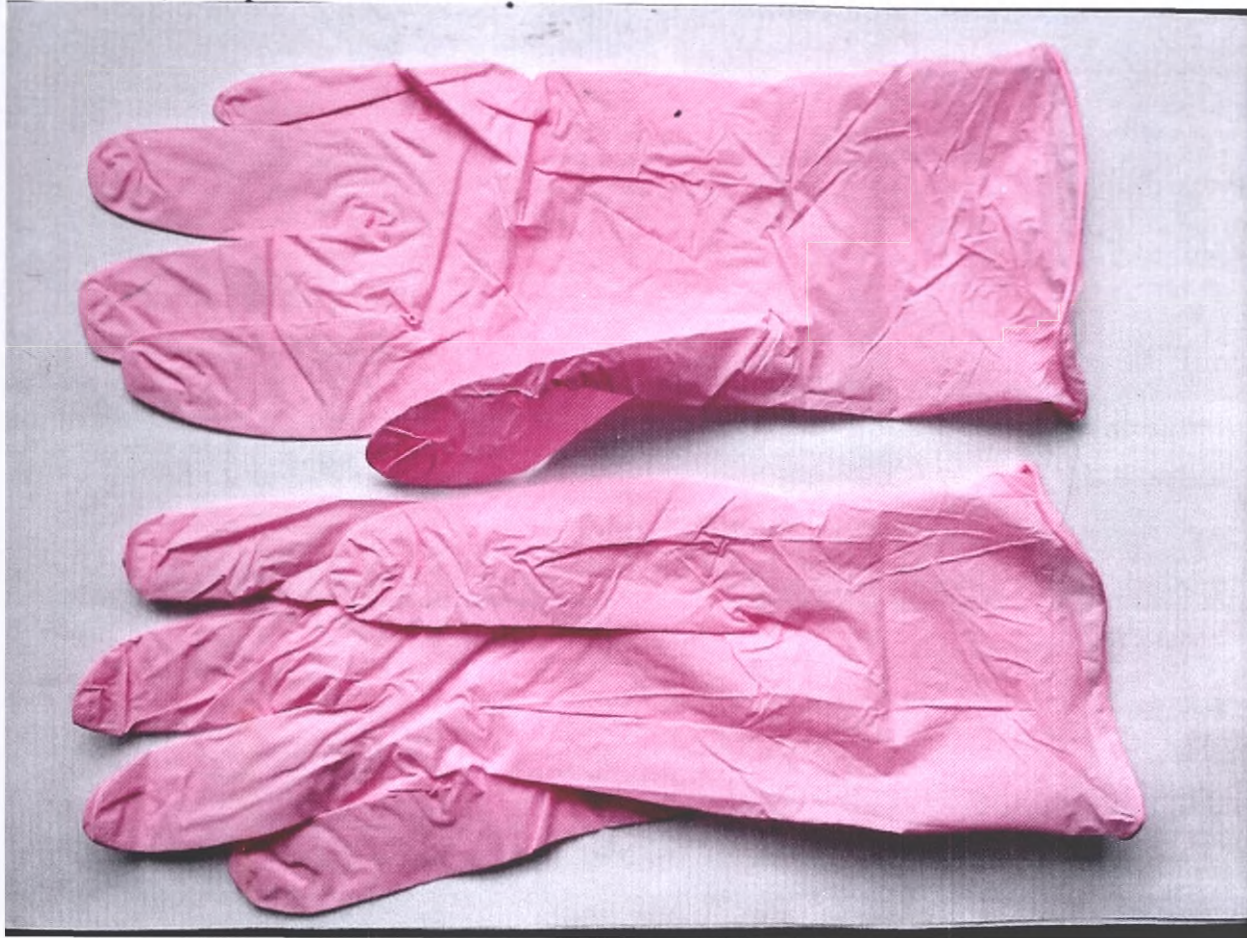

Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет розовый

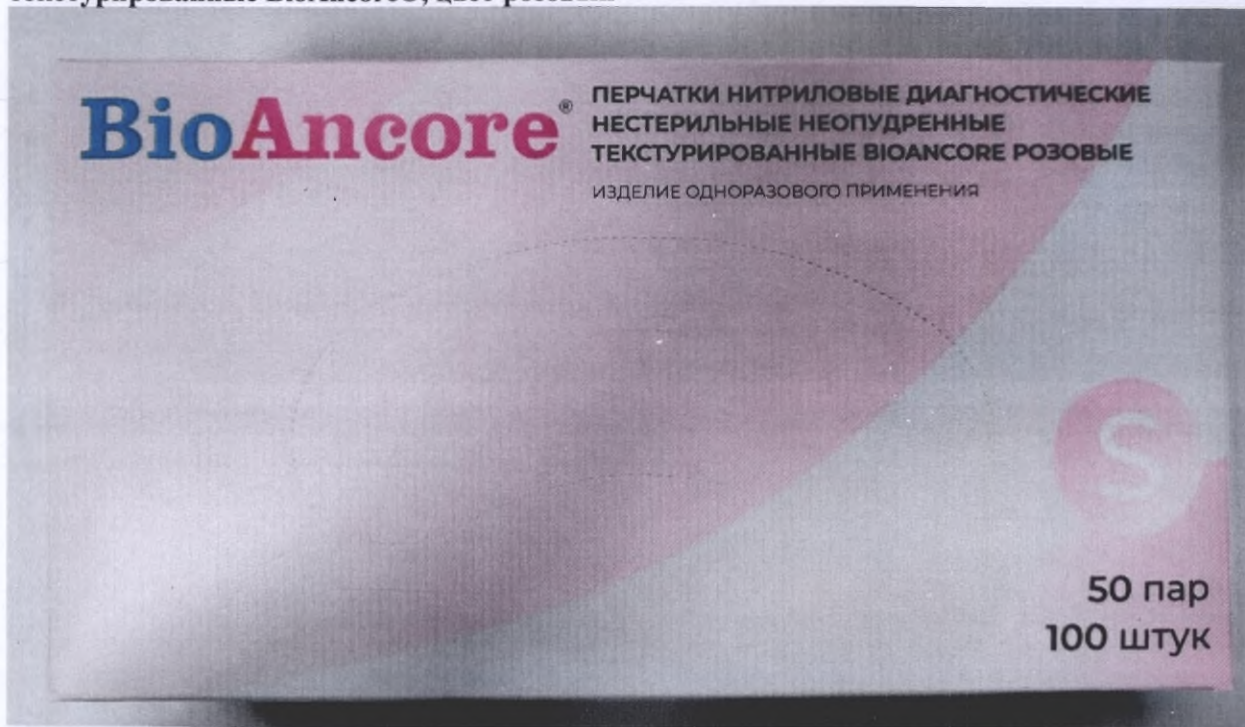

EN
WARNING! Do not use these gloves if you have a known allergy to chemical components. Be sure to consult a specialist.
Keep away from oxidizing allocation. Keep away from direct sunlight, heat over 35°C and humidity 85%

BE
УВАГА! Не використовуйте ці рукавички у випадку підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся зі спеціалістом.
Захищайтеся від окислювальних речовин. Беріть від впливу прямих сонячних променів і від нагрівання більш 35°C, а так же вологості 85%

DE
ACHTUNG! Verwenden Sie diese Handschuhe bei bestätigter Allergie gegenüber chemischen Bestandteilen nicht. Befragen Sie unbedingt einen Fachmann.
Von oxidierenden Substanzen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Erwärmung über 35°C und 85% Luftfeuchtigkeit schützen

KZ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы қолғапты химиялық компоненттерге аллергия расталған жағдайда пайдаланбаңыз. Міндетті түрде маманмен кеңесіңіз.
Тотығырушы заттардан алыста сақтау керек. Тікелей күн сәулелерінің түсуінен және 35°C-ден жоғары температурада 85% ылғалдылықтан қорғаныңыз.

PL
UWAGA! Nie należy używać tych rękawiczek w przypadku potwierdzonej alergii na składniki chemiczne. Koniecznie należy skonsultować się ze specjalistą.
Trzymać z dala od substancji utleniających. Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ogrzewania powyżej 35°C, a także 85% wilgotności

UKR
УВАГА! Не використовуйте ці рукавички у разі підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем.
Зберігайте далеко від окислювальних речовин. Беріть від попадання прямих сонячних променів і від нагрівання більше 35°C, а так же вологості 85%

Регистрационное удостоверение
Соответствует ГОСТ Р 52239-2004

Производитель:
ООО «Альпин Плюс», Россия 141304,
обл. Московская, г. Сергиев Посад, Московское ш.,
д. 3 стр. 1, офис 5

Назначено для: ООО «Аном-Мед», 141313, Московская
Область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 3, офис 5

Тел: +7 (495) 215-57-87
ancommed.ru
msk@ancommed.ru

LOT	

AQL 0,65

BioAncore®
СДЕЛАНО В РОССИИ

RU Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BIOANCORE

- Материал: нитрил
- Неопудренные
- Одноразовые
- Нестерильные
- Текстурированные
- Универсальные для обеих рук
- Регистрационный удостоверение
- ГОСТ Р 52239-2004
- С внутренним полимерным покрытием
- AQL 0,65
- TY 22.19.60-001-31887964-2019

RU Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные

- Материал: нитрил
- Неопудренные
- Одноразовые
- Нестерильные
- Текстурированные
- Универсальные для обеих рук
- Регистрационный удостоверение
- ГОСТ Р 52239-2004
- С внутренним полимерным покрытием
- AQL 0,65
- TY 22.19.60-001-31887964-2019

DE Diagnostische unsterile puderfreie strukturierte Nitrilhandschuhe

- Material: NBR
- Puderfrei
- Einwegartikel
- Unsteril
- Texturiert
- Universal für beide Hände
- Zulassungsgeschäft
- COST R 52239-2004
- Mit innerer Polymerbeschichtung
- AQL 0,65
- TY 22.19.60-001-31887964-2019

EN Diagnostic non-sterile textured powder-free nitrile gloves

- Material: nitrile
- Powder-free
- Disposable
- Non-sterile
- Textured
- Ambidextrous
- Registration certificate
- COST R 52239-2004
- With internal polymer coating
- AQL 0,65
- TY 22.19.60-001-31887964-2019

KZ Stereilyndelenen nitrilдіагностичні нестерильні неопудрені текстуровані рукавички

- Матеріал: нитрил
- Стерильні
- Біл реттлі
- Стерильні
- Асиметричні
- Єкі для двох рук
- Тривку вжитку
- ГОСТ Р 52239-2004
- Із внутрішнім полімерним покриттям
- AQL 0,65
- TY 22.19.60-001-31887964-2019

PL Rękawice nitrilowe diagnostyczne nesterylne bez proszku teksturyowane

- Materiał: nitril
- Bezproszkowe
- Jednorazowe
- Nesterylne
- Teksturyowane
- Uniwersalne na obie ręce
- Biobioaktywne
- COST R 52239-2004
- Z wewnętrzny powłoką polimerową
- AQL 0,65
- TY 22.19.60-001-31887964-2019

UKR Рукавиці нитрилові діагностичні нестерильні неопудрені текстуровані

- Матеріал: нитрил
- Не стерильні
- Одноразові
- Нестерильні
- Текстурировані
- Універсальні для обох рук
- Реєстраційне посвідчення
- ГОСТ Р 52239-2004
- З внутрішнім полімерним покриттям
- AQL 0,65
- TY 22.19.60-001-31887964-2019

BioAncore®

**ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE РОЗОВЫЕ**

BioAncore®

**ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE РОЗОВЫЕ**

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!




Не используйте эти перчатки в случае подтвержденной аллергии на химические компоненты.
Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Хранить вдали от окисляющих веществ.
Беречь от попадания прямых солнечных лучей, нагревания более 35 °C и влажности более 85%.

Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет салатовый



Диспенсер. Перчатки нитриловые диагностические нестерильные неопудренные текстурированные BioAncore®, цвет салатовый

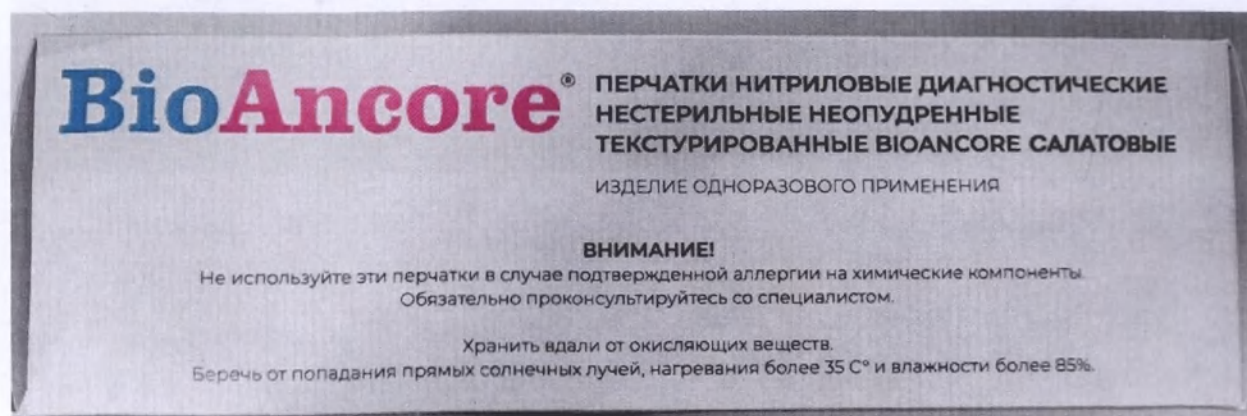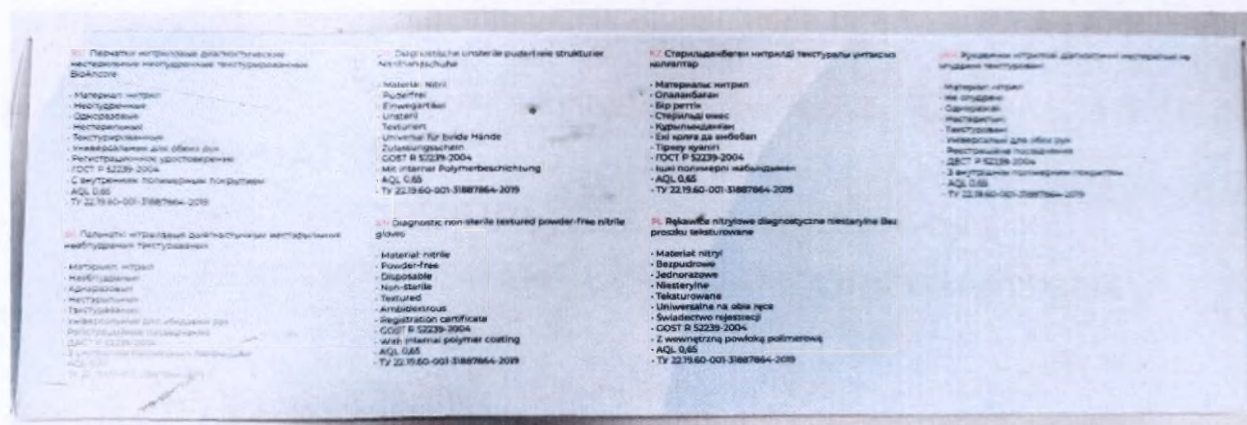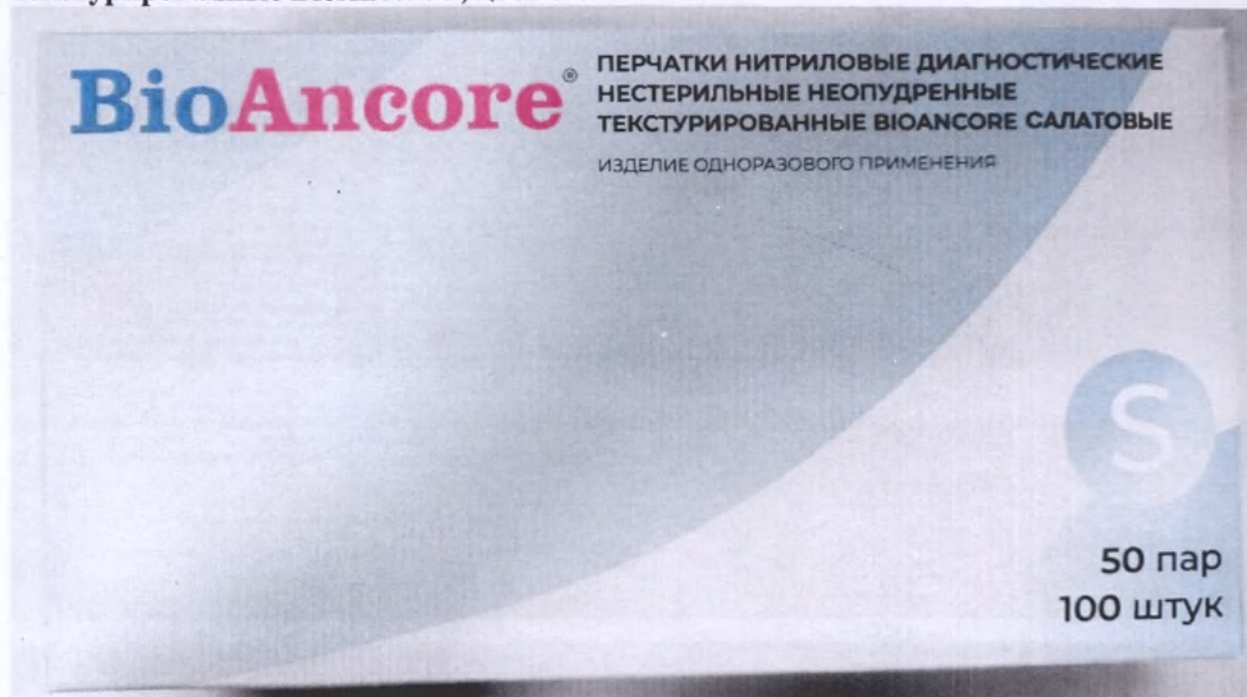

УВАГА! Не використовуйте ці рукавички у разі підтвердженої алергії на хімічні компоненти. Обов'язково проконсультуйтеся з фізіологом.
Зберігати далеко від окислюючих речовин. Бергти від попадання променів сонячних променів і від нагрівання більше 35°C, а так же вологості 85%

Tel.: +7 (495) 215-57-87
ancommed.ru
msk@ancommed.ru

LOT	
	
	



BioApsoge
СДЕЛАНО В РОССИИ

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANSCORE САЛАТОВЫЕ

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE®

Макет маркировки

**Перчатки нитриловые диагностические нестерильные
неопудренные текстурированные BioAncore® по ТУ 22.19.60-
001-31887864-2019 в вариантах исполнения**

Производства ООО «Альянс Плюс»

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE БИРЮЗОВЫЕ

- Материал: нитрил
- Цвет: бирюзовый
- Неопудренные
- Одноразовые
- Текстурированные
- Универсальные для обеих рук
- ГОСТ Р 52239-2004
- С внутренним полимерным покрытием
- AQL 0,65
- Стерилизация оксидом этилена
- ТУ 22.19.60-001-31887864-2019



50 пар

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE С ПОКРЫТИЕМ
АЛОЭ ВЕРА САЛАТОВЫЕ

- Материал: нитрил
- Цвет: салатный
- Неопудренные
- Одноразовые
- Текстурированные
- Универсальные для обеих рук
- ГОСТ Р 52239-2004
- С внутренним полимерным покрытием
- AQL 0,65
- Стерилизация оксидом этилена
- ТУ 22.19.60-001-31887864-2019

L

aloe vera

50 пар

BioAncore®

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE ЗЕЛЕНЫЕ

- Материал: нитрил
- Цвет: зеленые
- Неопудренные
- Одноразовые
- Текстурированные
- Универсальные для обеих рук
- ГОСТ Р 52239-2004
- С внутренним полимерным покрытием
- AQL 0,65
- Стерилизация оксидом этилена
- ТУ 22.19.60-001-31887864-2019


L

50 пар

BioAncore®

**ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ, ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE РОЗОВЫЕ**


- Материал: нитрил
- Цвет: розовый
- Неопудренные
- Одноразовые
- Текстурированные
- Универсальные для обеих рук
- ГОСТ Р 52239-2004
- С внутренним полимерным покрытием
- AQL 0,65
- Стерилизация оксидом этилена
- ТУ 22.19.60-001-31887864-2019

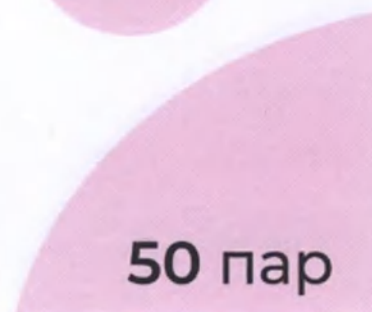

BioAncore®

**ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE ГОЛУБЫЕ**

- Материал: нитрил
- Цвет: голубой
- Неопудренные
- Одноразовые
- Текстурированные
- Универсальные для обеих рук
- ГОСТ Р 52239-2004
- С внутренним полимерным покрытием
- AQL 0,65
- Стерилизация оксидом этилена
- ТУ 22.19.60-001-31887864-2019

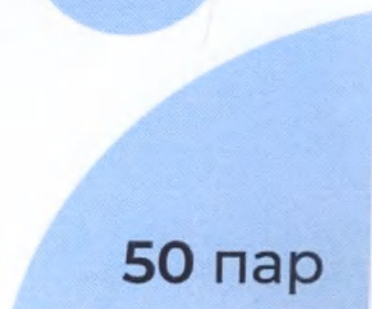

BioAncore®

**ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ BIOANCORE ЛИЛОВЫЕ**

- Материал: нитрил
- Цвет: лиловый
- Неопудренные
- Одноразовые
- Текстурированные
- Универсальные для обеих рук
- ГОСТ Р 52239-2004
- С внутренним полимерным покрытием
- AQL 0,65
- Стерилизация оксидом этилена
- ТУ 22.19.60-001-31887864-2019



Макет транспортной маркировки

«Перчатки нитриловые диагностические нестерильные с покрытием Алоэ вера неопудренные текстурированные BioAncore®	
ТУ 22.19.60-001-31887864-2019	
размер перчаток	М
количество пар перчаток	500
номер партии	BANPF000AV0S
дата изготовления	02.02.2020
гарантийный срок годности	3 года
масса-брутто	3,8 кг
Изготовитель: ООО «Альянс Плюс», 141304, обл. Московская, г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 3 стр. 1, офис 5	

30 июня 2021 г.



(Здравомитова А.Г.