

Фотографии медицинского изделия:

«Облучатель-рециркулятор «АРМЕД» AirCube по ТУ 32.50.50-032-13391002-2024 в вариантах исполнения»,
производство: ООО «НПЦ МТ «АРМЕД», Россия

Содержание:

- I. облучатель-рециркулятор 115-22 TOWER T (см. Приложение);
- II. облучатель-рециркулятор 115-22 M slim 3PT (см. Приложение);
- III. облучатель-рециркулятор 130-22 TOWER (см. Приложение);
- IV. облучатель-рециркулятор 130-22 TOWER T (см. Приложение);
- V. облучатель-рециркулятор 215-23 TUBE ПТ (см. Приложение);
- VI. облучатель-рециркулятор 215-22 MAX T, в составе (см. Приложение);
- VII. облучатель-рециркулятор 230-23 TUBE ПТ (см. Приложение);
- VIII. облучатель-рециркулятор 315-22 ROMB 3PT (см. Приложение);
- IX. облучатель-рециркулятор 315-24 CASE Metall T (см. Приложение);
- X. облучатель-рециркулятор 315-24 CASE Plastic T (см. Приложение);
- XI. макет этикетки (см. Приложение);
- XII. макет маркировки потребительской упаковки (см. Приложение).


Генеральный директор
ООО «НПЦ МТ «АРМЕД»




/ А.А. Щукарев /


Приложение

I. Облучатель-рециркулятор 115-22 TOWER T:








III. Облучатель-рециркулятор 130-22 TOWER:














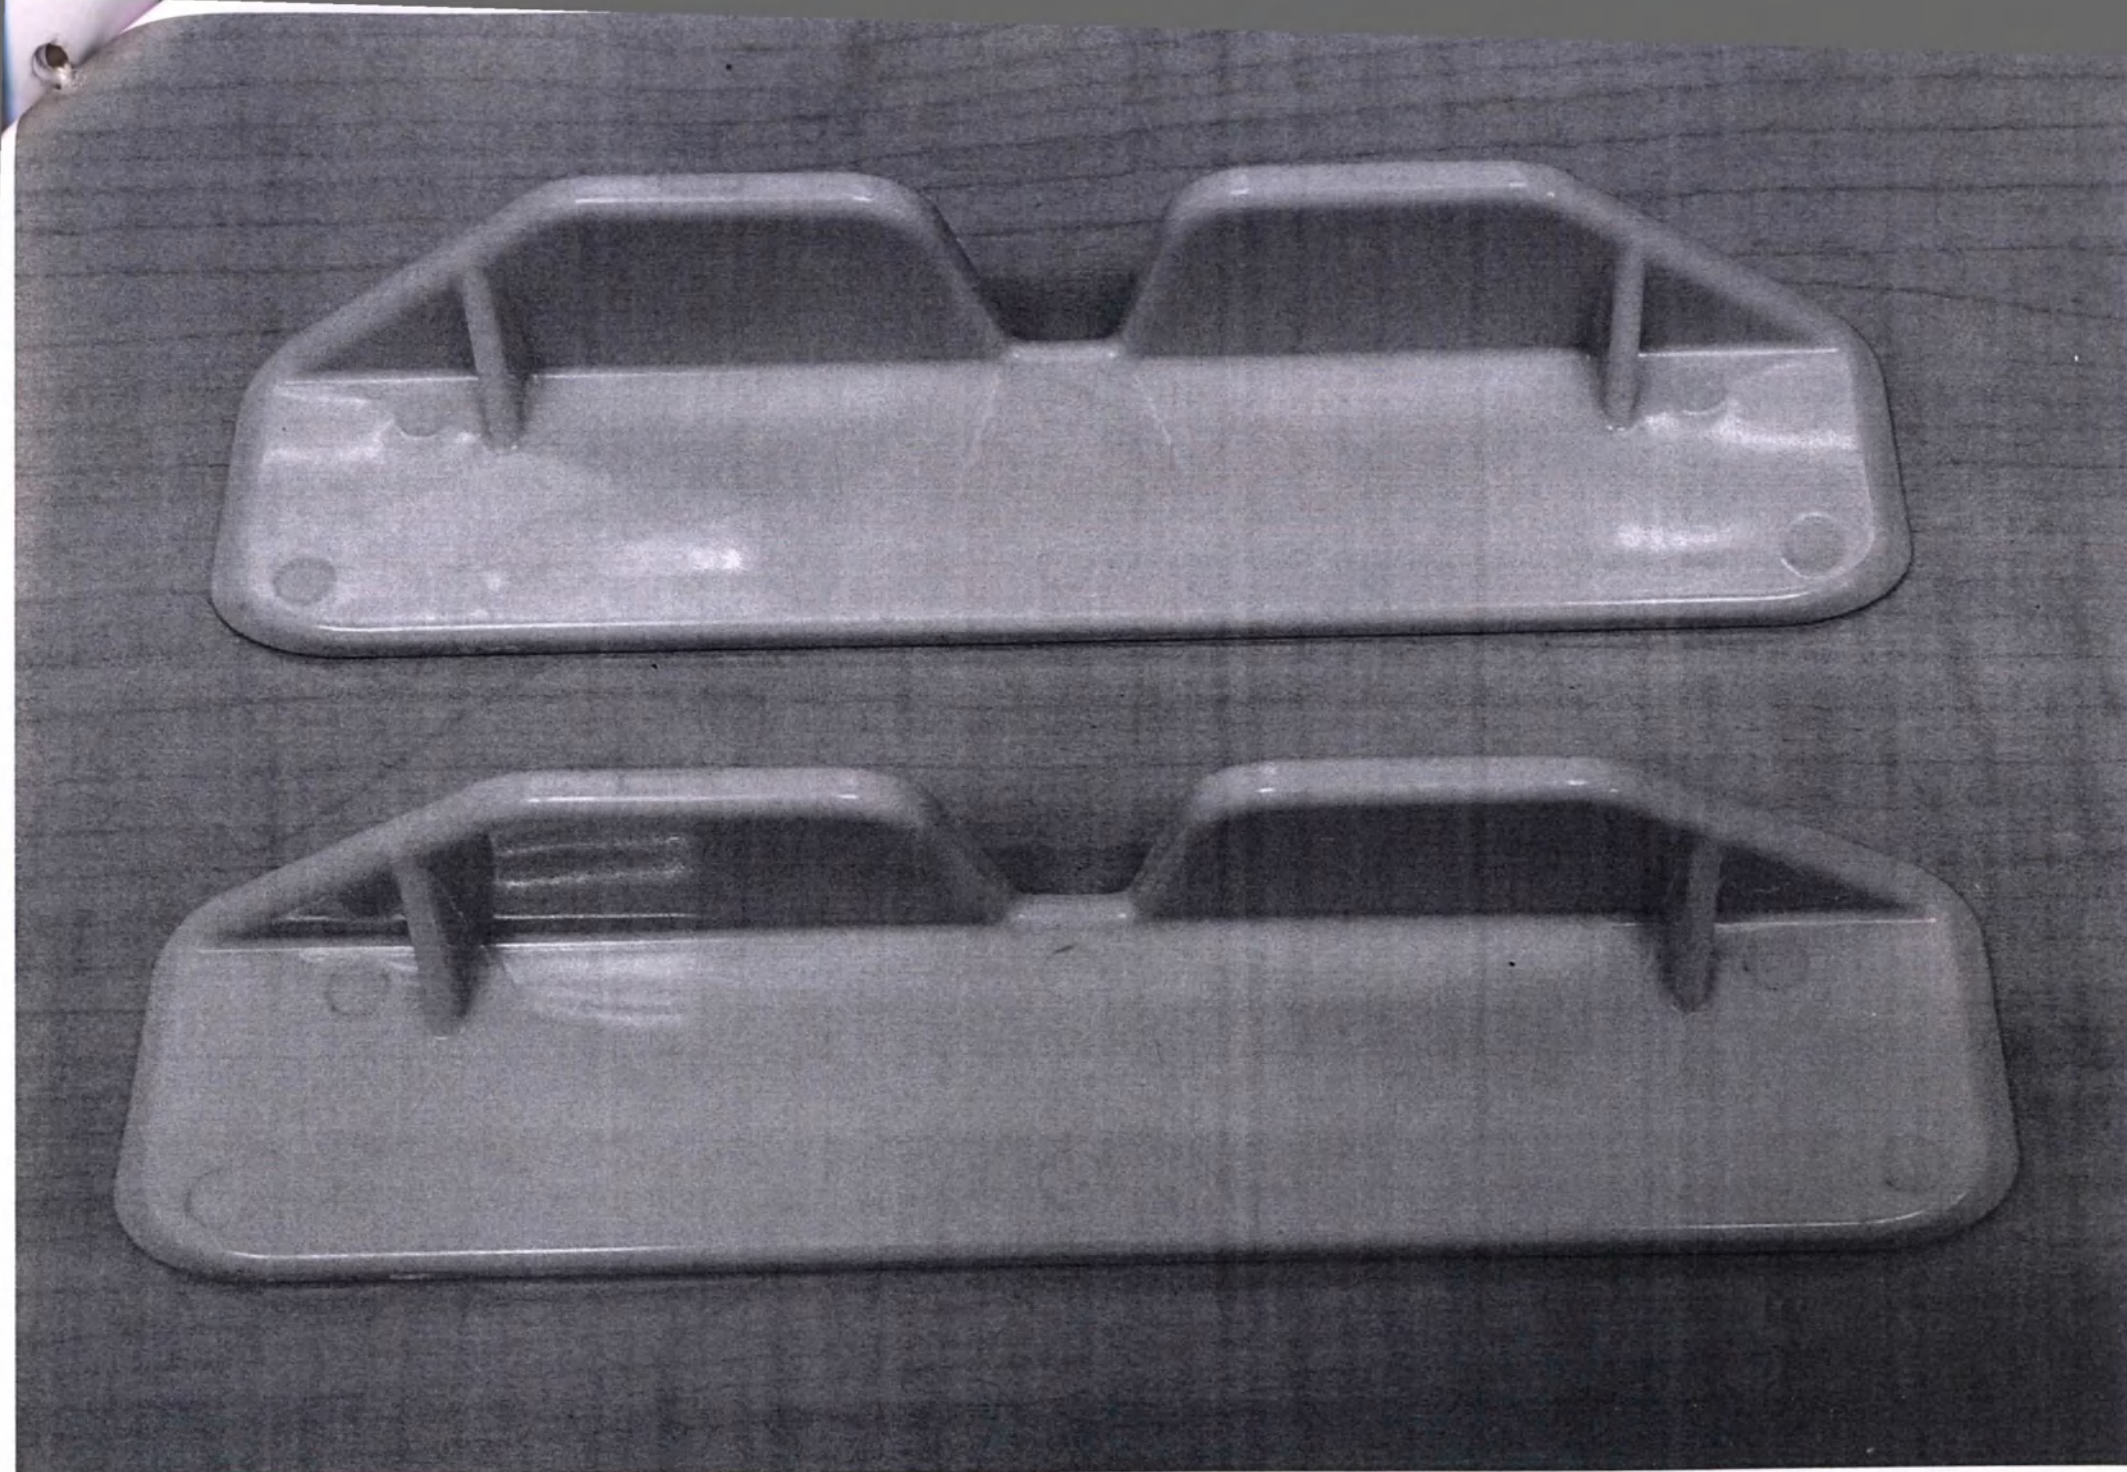


Рис. 6.3 – Подставка (2 шт.).











Облучатель-рециркулятор «АРМЕД» AirCube
по ТУ 32.50.50-032-13391002-2024,
вариант исполнения 115-22 TOWER T

Регистрационное удостоверение № _____ от

Произведено: ООО «НПЦ МТ «АРМЕД», Россия, 630091, г.о. город
Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, этаж 4, офис 406

Номинальное напряжение сети: **(230±23) В.**

Номинальная частота питающей сети: **(50±1) Гц.**

Потребляемая мощность при номинальном режиме
работы (±10%): **38 Вт.**




IP20



SN



Рециркулятор "Армед"
115-22 TOWER T



www.armed.ru

Перед применением внимательно изучите
руководство по эксплуатации


Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Полное наименование по РУ: Облучатель-рециркулятор «АРМЕД» AirCube по
ТУ 32.50.50-032-13391002-2024, вариант исполнения 115-22 TOWER T

Рис. 12 – Макет маркировки потребительской упаковки на примере облучателя-рециркулятора исполнения 115-22 TOWER T (вид спереди и сверху).

Рециркулятор "Армед"

115-22 TOWER T



www.armed.ru

Перед применением внимательно изучите
руководство по эксплуатации!

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

*Полное наименование по РУ: Облучатель-рециркулятор «АРМЕД» АЭСиде по
ТУ 32.50.50-032-13391002-2024, вариант исполнения 115-22 TOWER T



115-22 TOWER T

Рециркулятор "Армед"*

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

***Полное наименование по РУ:** Облучатель-рециркулятор «АРМЕД» AirCube по ТУ 32.50.50-032-13391002-2024, вариант исполнения 115-22 TOWER T

Дата упаковывания:

Перед применением
внимательно изучите руководство
по эксплуатации!





АРМЕД

115-22 TOWER T

Рециркулятор "Армед"*

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

***Полное наименование по РУ:** Облучатель-рециркулятор «АРМЕД» AirCube по ТУ 32.50.50-032-13391002-2024, вариант исполнения 115-22 TOWER T

Произведено: ООО «НПЦ МТ «АРМЕД», Россия, 630091, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, этаж 4, офис 406

Перед применением
внимательно изучите руководство
по эксплуатации!






ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР «АРМЕД»
AIRCUBE ПО ТУ 32.50.50-032-13391002-2024
115-22 TOWER T



Произведено: ООО «НПЦ МТ «АРМЕД», Россия, 630091, г.о. город
Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5, этаж 4, офис 406
РУ № _____ от _____ года

Перед применением внимательно изучите Руководство по эксплуатации!


Дата упаковывания:




www.armed.ru



условия хранения



условия транспортирования





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью *20*
(*двадцать*) листов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ИРМЕД»
ЖУКАРЕВА А.