

Маркировка на русском языке в зависимости от варианта исполнения

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика вытянутый крючкообразный (EH); длиной: 54 см

**Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480**

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUITY Pro

Катетер направляющий ACUITY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика вытянутый крючкообразный (EH); длиной: 45 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика вытянутый прямой правый крючкообразный (EH ST R); длиной: 54 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Негтоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика вытянутый прямой правый крючкообразный (EH ST R); длиной: 45 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Негтоксично

Амирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/clabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUITY Pro

Катетер направляющий ACUITY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика вытянутый правый крючкообразный (EH R); длиной: 54 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика вытянутый правый крючкообразный (EII R); длиной: 45 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика крючкообразный (II); длиной: 54 см

**Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480**

От:

Исотокично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/clabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика крючкообразный (П); длиной: 45 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUITY Pro

Катетер направляющий ACUITY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика Amplatz (A6); длиной: 54 см

Регистрационное удостоверение:

От:

РЗН 2017/6480

Нетоксично

Алирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUITY Pro

Катетер направляющий ACUITY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика Amplatz (A6); длиной: 45 см

**Регистрационное удостоверение:
РЗП 2017/6480**

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/labeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика прямой (ST); длиной: 54 см

**Регистрационное удостоверение:
РЗП 2017/6480**

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика прямой (ST); длиной: 45 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Нетоксично

Аллергенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/clabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика широки (W); длиной: 54 см

**Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480**

От:

Исотохсично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика широки (W); длиной: 45 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика универсальный (MP); длиной: 54 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 9F (3.1 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика универсальный (MP); длиной: 45 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней. Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 7F (2.5 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика 90 (IC 90) длиной: 69 см

**Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480**

От:

Нетоксично

Алирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUITY Pro

Катетер направляющий ACUITY Pro 7F (2.5 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика 90 (IC 90) длиной: 60 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUITY Pro

Катетер направляющий ACUITY Pro 7F (2.5 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика 130 (IC 130); длиной: 69 см

Регистрационное удостоверение:
РЗП 2017/6480

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Катетеры направляющие для системы доставки электродов ACUTY Pro

Катетер направляющий ACUTY Pro 7F (2.5 мм) для коронарного синуса с конфигурацией кончика 130 (IC 130); длиной: 60 см

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2017/6480

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.



ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
21 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.



Макеты маркировки упаковки в зависимости от варианта исполнения

9F
(3.1mm)
x54cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

EXTENDED HOOK (EH)

Guide Catheter

Catêter guia, Cathêter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekateter, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Záváděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekateter, Kilavuz Kateter

 Contents (1)

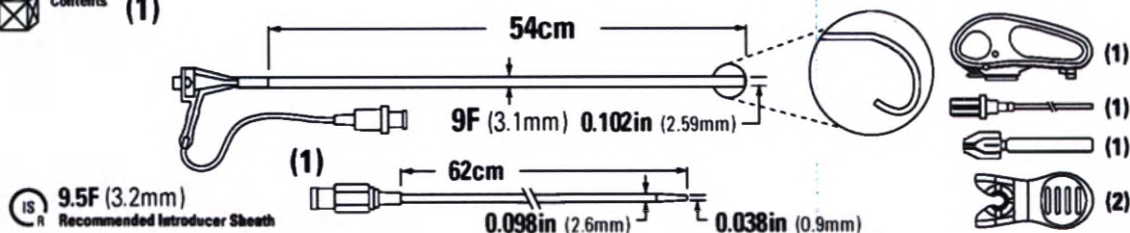

668104-752

GTIN

08714729932604

LOT

12345678

REF Catalog No.

8104

 Date of Manufacture 2000-01-01

 Use By 2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-02F



90810799-03



SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729932604
REF 8104
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729932604
REF 8104
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm

GTIN 08714729932604
REF 8104
LOT 12345678



(01)08714729932604(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

CE 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x45cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

EXTENDED HOOK (EH)

Guide Catheter

Catéter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekater, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Zaváděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekater, Kilavuz Kateter

 Contents (1)

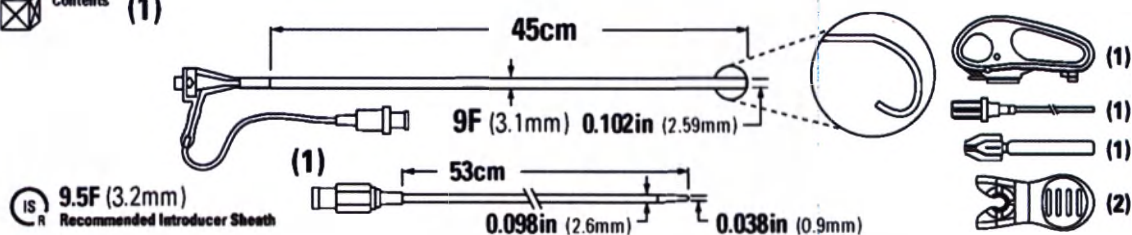

668105-752

GTIN

08714729932642

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8105



Date of Manufacture 2000-01-01



Use By 2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-05F



90810799-07



SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729932642
REF 8105
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729932642
REF 8105
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm

GTIN 08714729932642
REF 8105
LOT 12345678



(01;08714729932642;11;000101;17;101231;10;12345678

6S1

CE 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x54cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

EXTENDED HOOK STRAIGHT RIGHT (EH ST R)

Guide Catheter

Catéter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekater, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Zavaděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekater, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

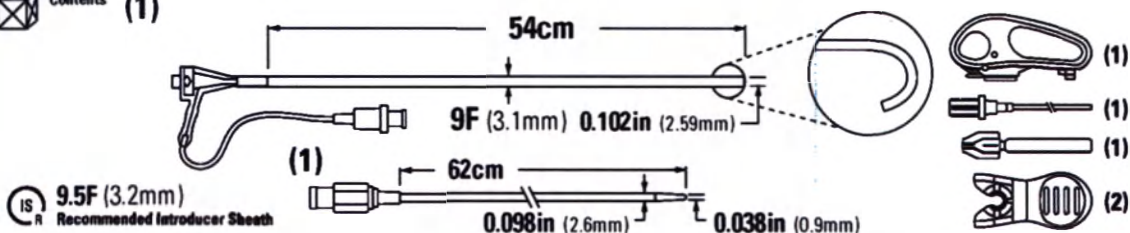

668106-752

GTIN

08714729932680

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8106

 Date of

Manufacture

2000-01-01

 Use By

2010-12-31



90740378 07

Internal BSC Bar Codes

90875071-08F



90810799-11



SS801120012345678XX

€ 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729932680
REF 8106
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729932680
REF 8106
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm

GTIN 08714729932680
REF 8106
LOT 12345678



(01)08714729932680(11)000101(17)10123110112345678

GS1

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x45cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

EXTENDED HOOK STRAIGHT RIGHT (EH ST R)

Guide Catheter

Catéter guía, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekateter, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Závádéci katéter, Cewnik prowadzący, Ledekateter, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

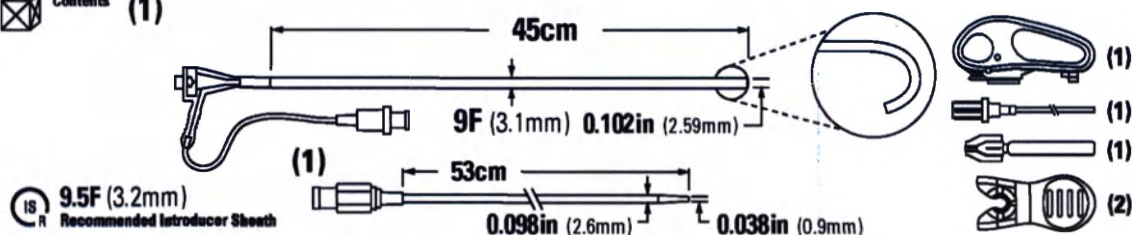

668107-752

GTIN

08714729932727

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8107

 Date of Manufacture

2000-01-01

 Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-11F



90875071-11F



+SS801120012345678XX

CE 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729932727
REF 8107
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729932727
REF 8107
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm

GTIN 08714729932727
REF 8107
LOT 12345678



(01)08714729932727(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

Boston
Scientific

9F
(3.1mm)
x54cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

EXTENDED HOOK RIGHT (EH R)

Guide Catheter

Catéter guía, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekateter, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Závádéci katéter, Cewnik prowadzący, Ledekateter, Kilavuz Kateter

 Contents (1)

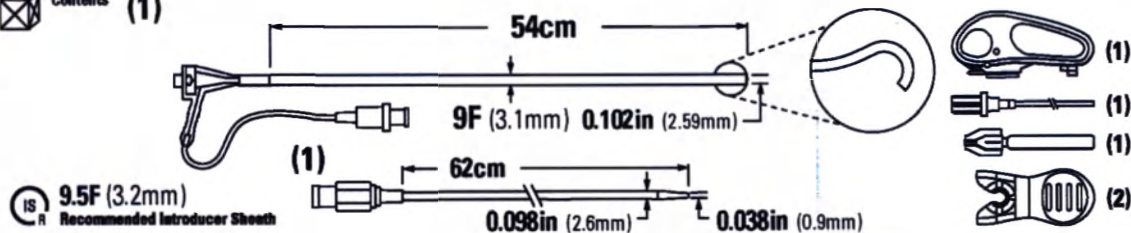

668108-752

GTIN

08714729932765

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8108

 Date of Manufacture

2000-01-01

 Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-14F



90875071-14F



+55801120012345678XX

CE 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729932765
REF 8108
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729932765
REF 8108
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm

GTIN 08714729932765
REF 8108
LOT 12345678



(01)08714729932765(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x45cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

EXTENDED HOOK RIGHT (EH R)

Guide Catheter

Catéter guía, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekater, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Záváděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekater, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

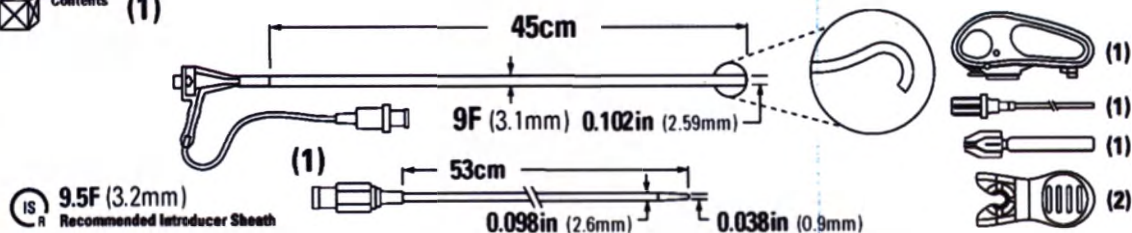

668109-752

GTIN

08714729932802

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8109

 Date of
Manufacture

2000-01-01

 Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-17F



90810799-23



SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729932802
REF 8109
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729932802
REF 8109
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm

GTIN 08714729932802
REF 8109
LOT 12345678



(01)08714729932802(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

CE 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE EO Sterilized using
ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x54cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

HOOK (H)

Guide Catheter

Cateter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekateter, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Závádéci katéter, Cewnik prowadzący, Ledekateter, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

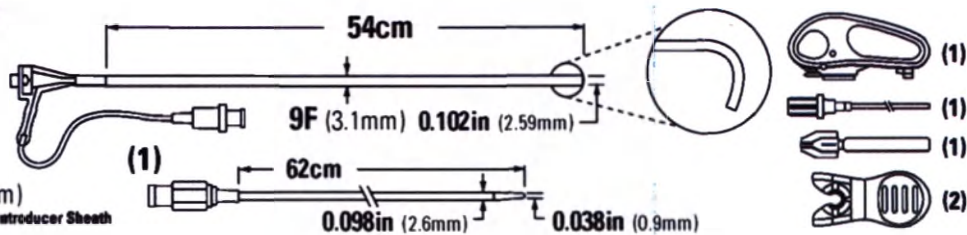

668114-752

GTIN

08714729933007

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8114

 Date of

Manufacture

2000-01-01

 Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-32F



90875071-43



+SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729933007
REF 8114
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729933007
REF 8114
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm

GTIN 08714729933007
REF 8114
LOT 12345678



(01)08714729933007(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

CE 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x45cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

HOOK (H)

Guide Catheter

Catéter guía, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekater, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Závádéci katéter, Cewnik prowadzący, Ledekater, Kilavuz Kateter

 Contents (1)

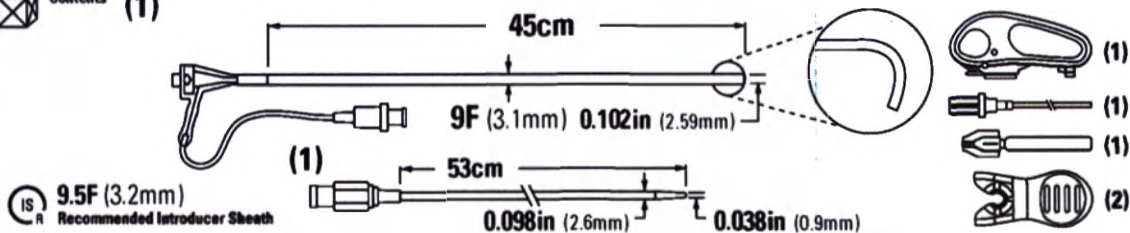

668115-752

GTIN

08714729933045

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8115

 Date of

Manufacture 2000-01-01

 Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-35F



90875071-35F



SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729933045
REF 8115
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729933045
REF 8115
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm

GTIN 08714729933045
REF 8115
LOT 12345678



(01)08714729933045(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

CE 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x54cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

AMPLATZ (A6)

Guide Catheter

Catéter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekater, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Závádéci katéter, Cewnik prowadzący, Ledekater, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

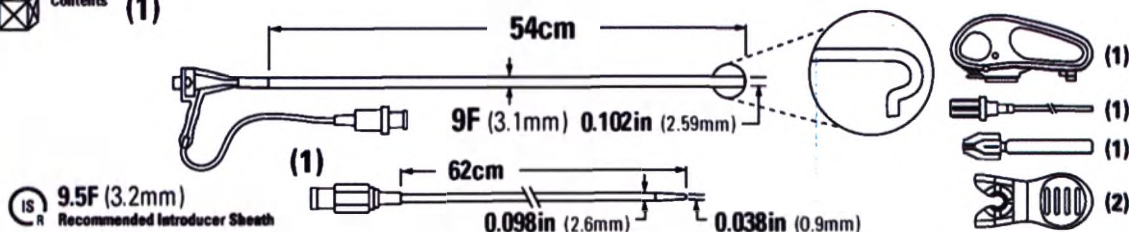

668116-752

GTIN

08714729933083

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8116



Date of
Manufacture

2000-01-01



Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-38F



90810799-51



SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729933083
REF 8116
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729933083
REF 8116
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm

GTIN 08714729933083
REF 8116
LOT 12345678



(01)08714729933083(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

CE 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x45cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

AMPLATZ (A6)

Guide Catheter

Catéter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekateter, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Strykateter, Vezetőkatéter, Zaváděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekateter, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

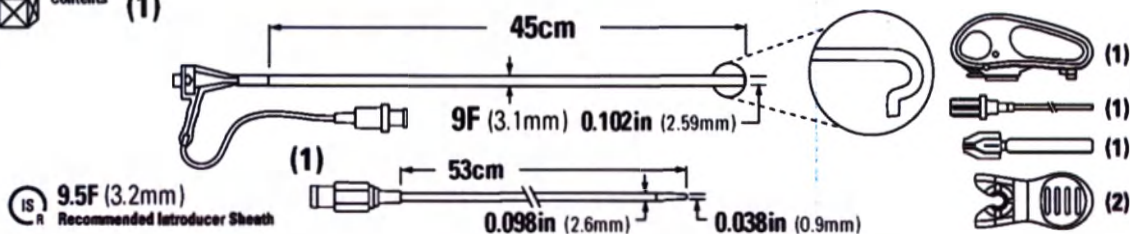

668117-752

GTIN

08714729933120

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8117



Date of
Manufacture

2000-01-01



Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-41F



90875071-41F



+SS801120012345678XX

€ 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729933120
REF 8117
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729933120
REF 8117
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm

GTIN 08714729933120
REF 8117
LOT 12345678



(01)08714729933120(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x54cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

STRAIGHT (ST)

Guide Catheter

Catéter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekateter, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Zaváděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekateter, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

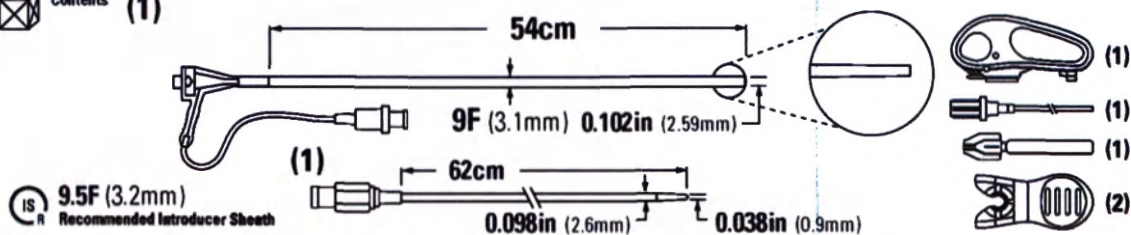

668118-752

GTIN

08714729933168

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8118



Date of Manufacture 2000-01-01



Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-44F



90810799-59



SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729933168
REF 8118
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729933168
REF 8118
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm

GTIN 08714729933168
REF 8118
LOT 12345678



(01)08714729933168(11)000101(17)101231(10)12345678 GS1

CE 2797

Made in USA
Two Scimed Place
Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE

EO

Sterilized using
ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x45cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

STRAIGHT (ST)

Guide Catheter

Catéter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekater, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Závádéci katéter, Cewnik prowadzący, Ledekater, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

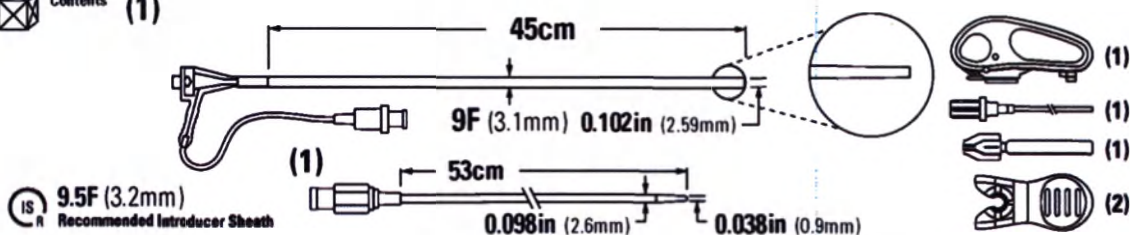

668119-752

GTIN

08714729933205

LOT

12345678

REF Catalog No.

8119

 Date of Manufacture 2000-01-01

 Use By 2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-47F



90810799-63



SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729933205
REF 8119
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729933205
REF 8119
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm

GTIN 08714729933205
REF 8119
LOT 12345678



(01)08714729933205(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

€ 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE  Sterilized using ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x54cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

WIDE (W)

Guide Catheter

Catéter guía, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekater, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Záváděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekater, Kılavuz Kateter

 **Contents (1)**

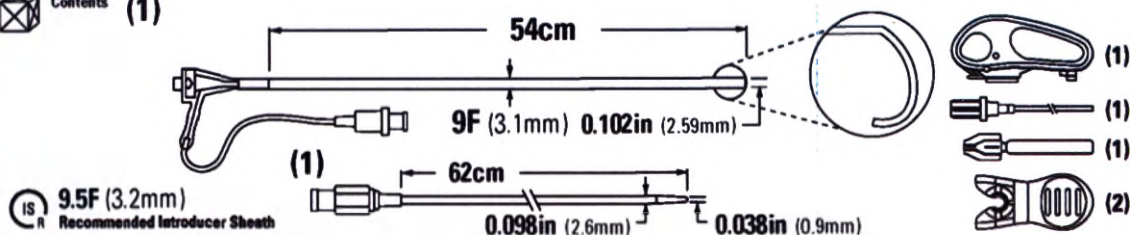

668110-752

GTIN

08714729932840

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8110

 Date of

Manufacture 2000-01-01

 Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-20F



90810799-27



SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729932840
REF 8110
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729932840
REF 8110
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm

GTIN 08714729932840
REF 8110
LOT 12345678



(01)08714729932840(11)000101(17)1012311012345678

GS1

CE 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE

Sterilized using
ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x45cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

WIDE (W)

Guide Catheter

Catéter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekater, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Záváděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekater, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

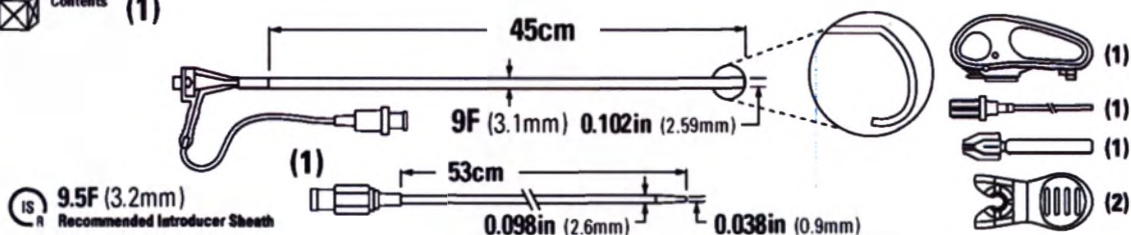

668111-752

GTIN

08714729932888

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8111

 Date of

Manufacture

2000-01-01

 Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-23F



90810799-31



SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729932888
REF 8111
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729932888
REF 8111
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm

GTIN 08714729932888
REF 8111
LOT 12345678



(01)08714729932888110001011711012311012345678

GS1

€ 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x54cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

MULTIPURPOSE (MP)

Guide Catheter

Catéter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekater, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Záváděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekater, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

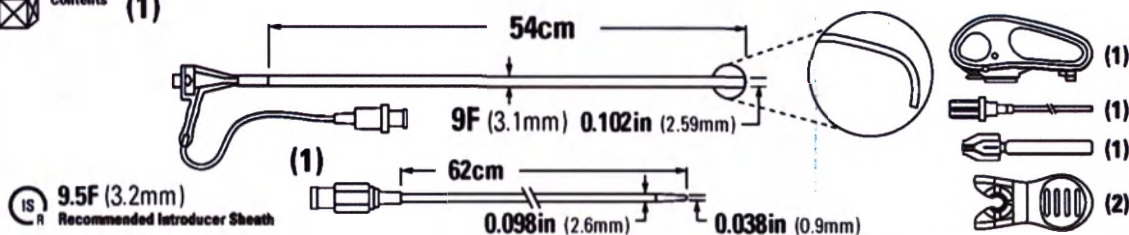

668112-752

GTIN

08714729932925

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8112

 Date of

Manufacture

2000-01-01

 Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-26F



90810799-35



SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729932925
REF 8112
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm
GTIN 08714729932925
REF 8112
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 54cm

GTIN 08714729932925
REF 8112
LOT 12345678



(01)08714729932925(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

€ 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

9F
(3.1mm)
x45cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

MULTIPURPOSE (MP)

Guide Catheter

Catéter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekateter, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Závádéci katéter, Cewnik prowadzący, Ledekateter, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

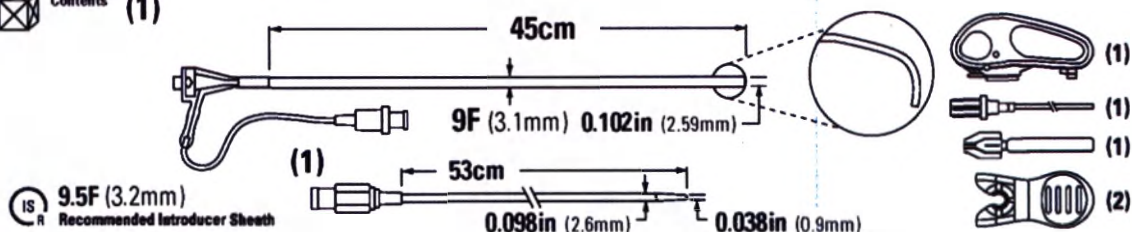

668113-752

GTIN

08714729932963

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8113



Date of
Manufacture 2000-01-01



Use By 2010-12-31



90240378 02

Internal BSC Bar Codes

90875071-29F



90810799-39



+SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729932963
REF 8113
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm
GTIN 08714729932963
REF 8113
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
9F (3.1mm) x 45cm

GTIN 08714729932963
REF 8113
LOT 12345678



(01)08714729932963(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

CE 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

Boston
Scientific

7F
(2.5mm)
x69cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

INNER CATHETER 90 (IC 90)

Guide Catheter

Catéter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekateter, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Zaváděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekateter, Kılavuz Kateter

 Contents (1)

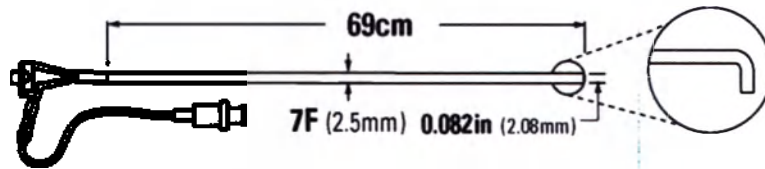

668100-751

GTIN

08714729932444

LOT

12345678

REF Catalog No.

8100



Date of
Manufacture 2000-01-01



Use By 2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-50F



90810798-03



+SS801120012345678XX

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 69cm
GTIN 08714729932444
REF 8100
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 69cm
GTIN 08714729932444
REF 8100
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 69cm

GTIN 08714729932444
REF 8100
LOT 12345678



(01)08714729932444(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

€ 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

Boston
Scientific

7F
(2.5mm)
x60cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

INNER CATHETER 90 (IC 90)

Guide Catheter

Catéter guia, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekater, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Záváděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekater, Kılavuz Kateter

 Contents **(1)**

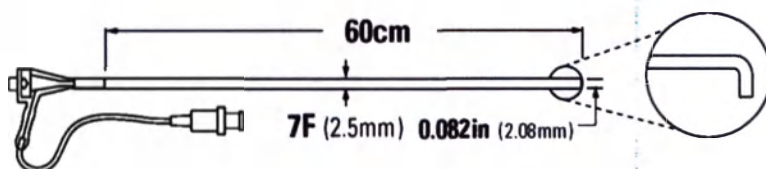

668101-751

GTIN

08714729932482

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8101



Date of

Manufacture

2000-01-01



Use By

2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-53F



90810798-07



+SS801120012345678XX

€ 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 60cm
GTIN 08714729932482
REF 8101
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 60cm
GTIN 08714729932482
REF 8101
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 60cm

GTIN 08714729932482
REF 8101
LOT 12345678



(01)08714729932482(11)000101(17)101231(10)12345678

GS1

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

Boston
Scientific

7F
(2.5mm)
x69cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

INNER CATHETER 130 (IC 130)

Guide Catheter

Catéter guía, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekateter, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Zaváděcí katétr, Cewnik prowadzący, Ledekateter, Kılavuz Kateter,

 Contents **(1)**

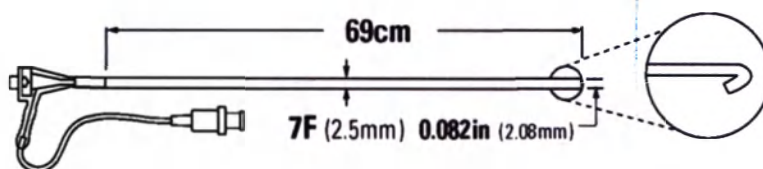

668102-751

GTIN

08714729932529

LOT

12345678

REF

Catalog No.

8102



Date of
Manufacture 2000-01-01



Use By 2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-56F



90810798-11



+SS801120012345678XX

€ 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 69cm
GTIN 08714729932529
REF 8102
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 69cm
GTIN 08714729932529
REF 8102
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 69cm

GTIN 08714729932529
REF 8102
LOT 12345678



(01)08714729932529(11)000101(17)1012311012345678

GS1

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

Boston
Scientific

7F
(2.5mm)
x60cm

ACUITY™ Pro


CORONARY SINUS

INNER CATHETER 130 (IC 130)

Guide Catheter

Catéter guía, Cathéter guide, Führungskatheter, Catetere guida, Geleidekatheter, Ledekateter, Οδηγός καθετήρας, Cateter-guia, Styrkateter, Vezetőkatéter, Závádéci katéter, Cewnik prowadzący, Ledekateter, Kilavuz Kateter,

 Contents **(1)**

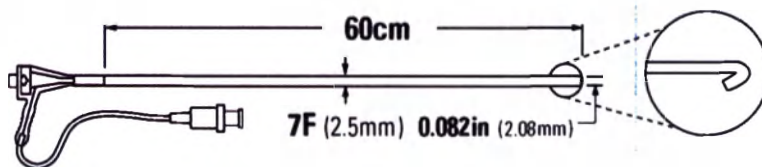

668103-751

GTIN

08714729932567

LOT

12345678

REF Catalog No.

8103



Date of Manufacture 2000-01-01



Use By 2010-12-31



90240378-02

Internal BSC Bar Codes

90875071-59F



90810798-15



S8801120012345678XX

CE 2797

Made in USA

Two Scimed Place

Maple Grove, MN 55311 USA

Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 60cm
GTIN 08714729932567
REF 8103
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 60cm
GTIN 08714729932567
REF 8103
LOT 12345678



Boston Scientific
ACUITY™ Pro
7F (2.5mm) x 60cm

GTIN 08714729932567
REF 8103
LOT 12345678




(01)08714729932567(11)000101(17)1012311012345678


GS1

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

Символы	Описание на английском	Описание
-	Boston Scientific	Бостон Сайентифик
-	Acuity Pro	Торговое название
-	Coronary Sinus	Для коронарного синуса
	Guide Catheter	Катетер направляющий
9F (3.1 mm) 7F (2.5 mm)	-	Наружный диаметр катетера направляющего (в соответствии с вариантом исполнения)
54 cm 45 cm 69 cm 60 cm	-	Длина катетера направляющего (в соответствии с вариантом исполнения)
-	Extended Hook (EH)	Конфигурация кончика вытянутый крючкообразный (EH)
-	Extended Hook Straight Right (EH ST R)	Конфигурация кончика вытянутый прямой правый крючкообразный (EH ST R)
-	Extended Hook Right (EH R)	Конфигурация кончика вытянутый правый крючкообразный (EH R)
-	Hook (H)	Конфигурация кончика крючкообразный (H)
-	Amplatz (A6)	Конфигурация кончика Amplatz (A6)
-	Straight (S)	Конфигурация кончика прямой (S)
-	Wide (W)	Конфигурация кончика широкий (W)
-	Multipurpose (MP)	Конфигурация кончика универсальный (MP)
-	Inner Catheter 90 (IC 90)	Конфигурация кончика 90
-	Inner Catheter 130 (IC 130)	Конфигурация кончика 130
 Contents (1)	Contents (1)	Содержимое (1 шт)
0.102 in (2.59 mm) 0.082 in (2.08 mm)	-	Внутренний диаметр катетера направляющего (в соответствии с вариантом исполнения)
	9.5 F (3.2 mm) Recommended Introducer Sheath	Рекомендуемая для использования гильза интродьюсера 9,5 F (3,2 мм)
62 mm 53 mm	-	Длина расширителя (в соответствии с вариантом исполнения)
0.098 in (2.6 mm)	-	Наружный диаметр расширителя 0,098 дюймов (2,6 мм)
0.038 in (0.9 mm)	-	Внутренний диаметр расширителя 0,038 дюймов (0,9 мм)

 (1)	-	Универсальный резак Acuity (1 шт.)
 (1)	-	Интродьюсер проводника (1 шт.)
 (1)	-	Устройство для вращения проводника (1 шт.)
 (2)	-	Чрезклапанный интродьюсер (TVI) (2 шт.)
 (1)	-	Расширитель (1 шт.)
GTIN	GTIN	Международный код маркировки и учёта логистических единиц
LOT	Lot Number	Код партии
REF	Catalog No.	Номер по каталогу
	Date of manufacture	Дата изготовления
	Use By	Использовать до
CE 2797	-	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
-	Made in USA	Сделано в США
-	Two Scimed Place, Maple Grove, MN 55311 USA	Ту Саймед Плейс, Мейпл Гроув, Миннесота 55311 США
STERILE EO	Sterilized using an ethylene oxide.	Стерилизация оксидом этилена
-	Internal BSC Bar Codes	Внутренние штрих-коды БСК

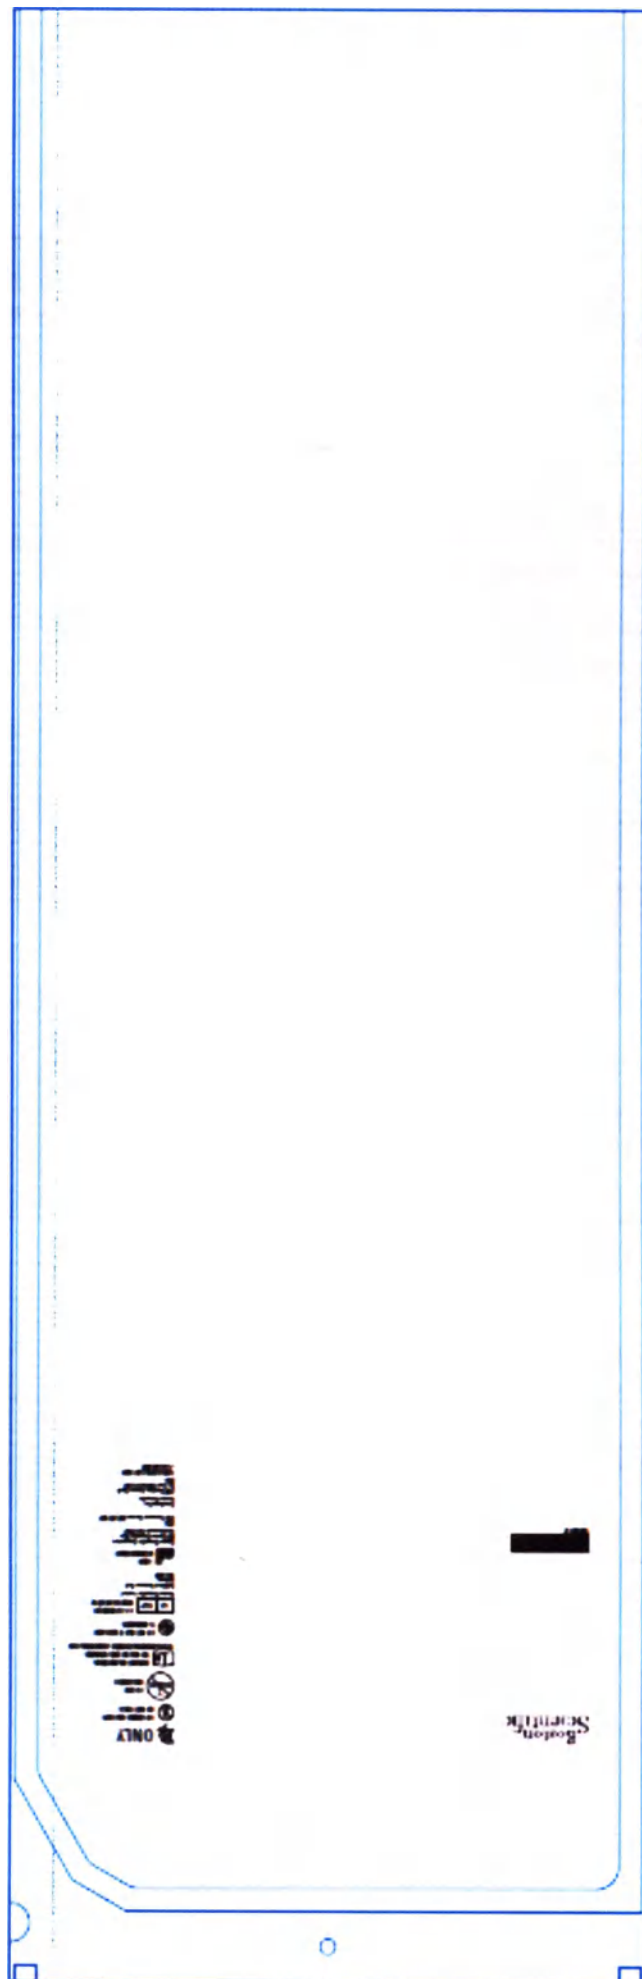

ONLY

Scout

**Boston
Scientific**



Rx ONLY

For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Resterilize

Consult instructions
for use on this website:
www.bostonscientific-elabeling.com

Do not use if package
is damaged.

EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

Legal
Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1901

Distributed by:
Boston Scientific
4190 Hamilton Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798
USA
1.800.CARDIAC (227 3422)
+1.651.582.4899

Символы	Описание на английском	Описание
-	Boston Scientific	Бостон Сайентифик
	-	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Федеральный закон (США) строго регламентирует продажу данного устройства только по предписанию врача
	For single use only. Do not reuse.	Запрет на повторное применение
	Do Not Resterilize	Не стерилизовать повторно
	Consult instructions for use on this website: www.bostonscientific-elabeling.com	Ознакомьтесь с инструкцией по применению на этом веб-сайте: www.bostonscientific-elabeling.com
	Do not use if package is damaged.	Не использовать при повреждении упаковки
	EU Authorized Representative	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
-	Boston Scientific Limited Ballybrit Business Park Galway IRELAND	Бостон Сайентифик Лимитед Бэллибрит Бизнес Парк Голуэй, Ирландия

	Legal Manufacturer	Изготовитель
-	Boston Scientific Corporation 300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752 USA	Бостон Сайентифик Корпорейшн 300 Бостон Сайентифик Уэй, Мальборо, Массачусетс 01752 США
-	USA Customer service 888-272-1001	Обслуживание клиентов США 888-272-1001
-	Distributed by: Boston Scientific 4100 Hamline Avenue North St. Paul, MN 55112-5798 USA 1.800.CARDIAC (227.3422) +1.651.582.4000	Распространяется: Бостон Сайентифик 4100 Хэмлайн-авеню, Северный Сент-Пол, Миннесота 55112-5798 США 1.800.КАРДИАК (227.3422) +1.651.582.4000

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
26 ЛИСТОВ

Генеральный директор

Шевчук Е.В.

