


**Фотографические изображения медицинского изделия:
«Светильник медицинский смотровой «Armed»,
производство: Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Китай**

- I. Светильник медицинский смотровой «Armed», вариант исполнения AR 01A LED, в составе (рис. 1-8).**
- II. Светильник медицинский смотровой «Armed», вариант исполнения AR-FS LED, в составе (рис. 9-15).**
- III. Светильник медицинский смотровой «Armed», вариант исполнения AR 200 LED, в составе (рис. 16-25).**
- IV. Макет шильда (рис. 26).**
- V. Макет маркировки потребительской упаковки (рис. 27-28).**

Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)




(Р.С. Жуков)
(И.О. Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «ОПОРА» (ООО «ОПОРА»)
(наименование организации-заявителя)

Приложение

I. Светильник медицинский смотровой «Armed», вариант исполнения AR 01A LED, в составе:

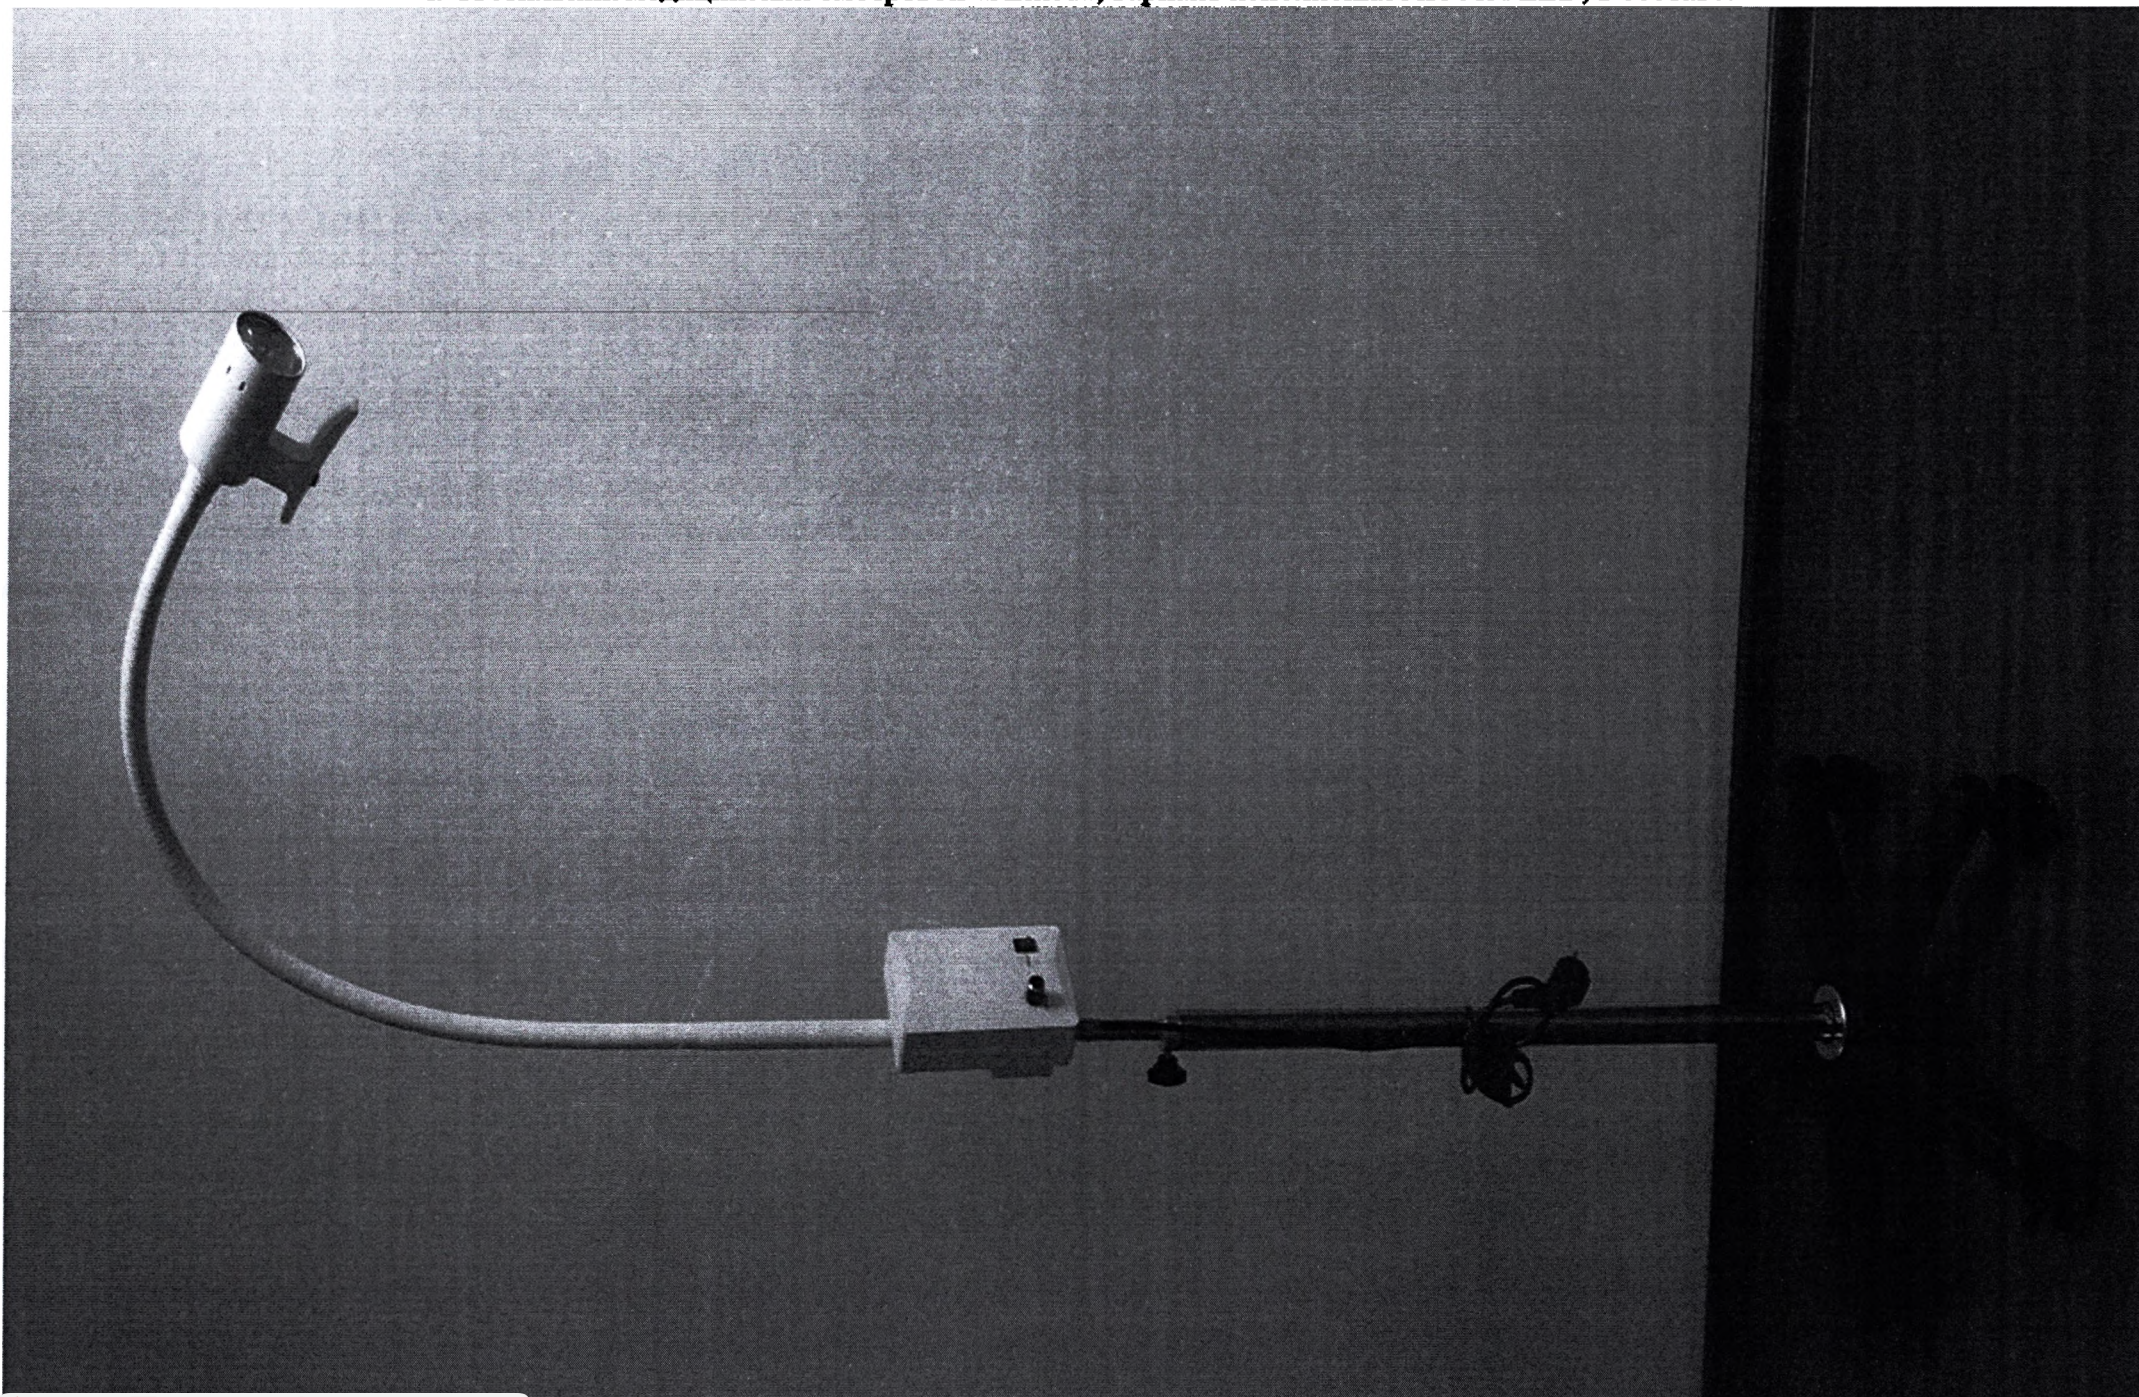

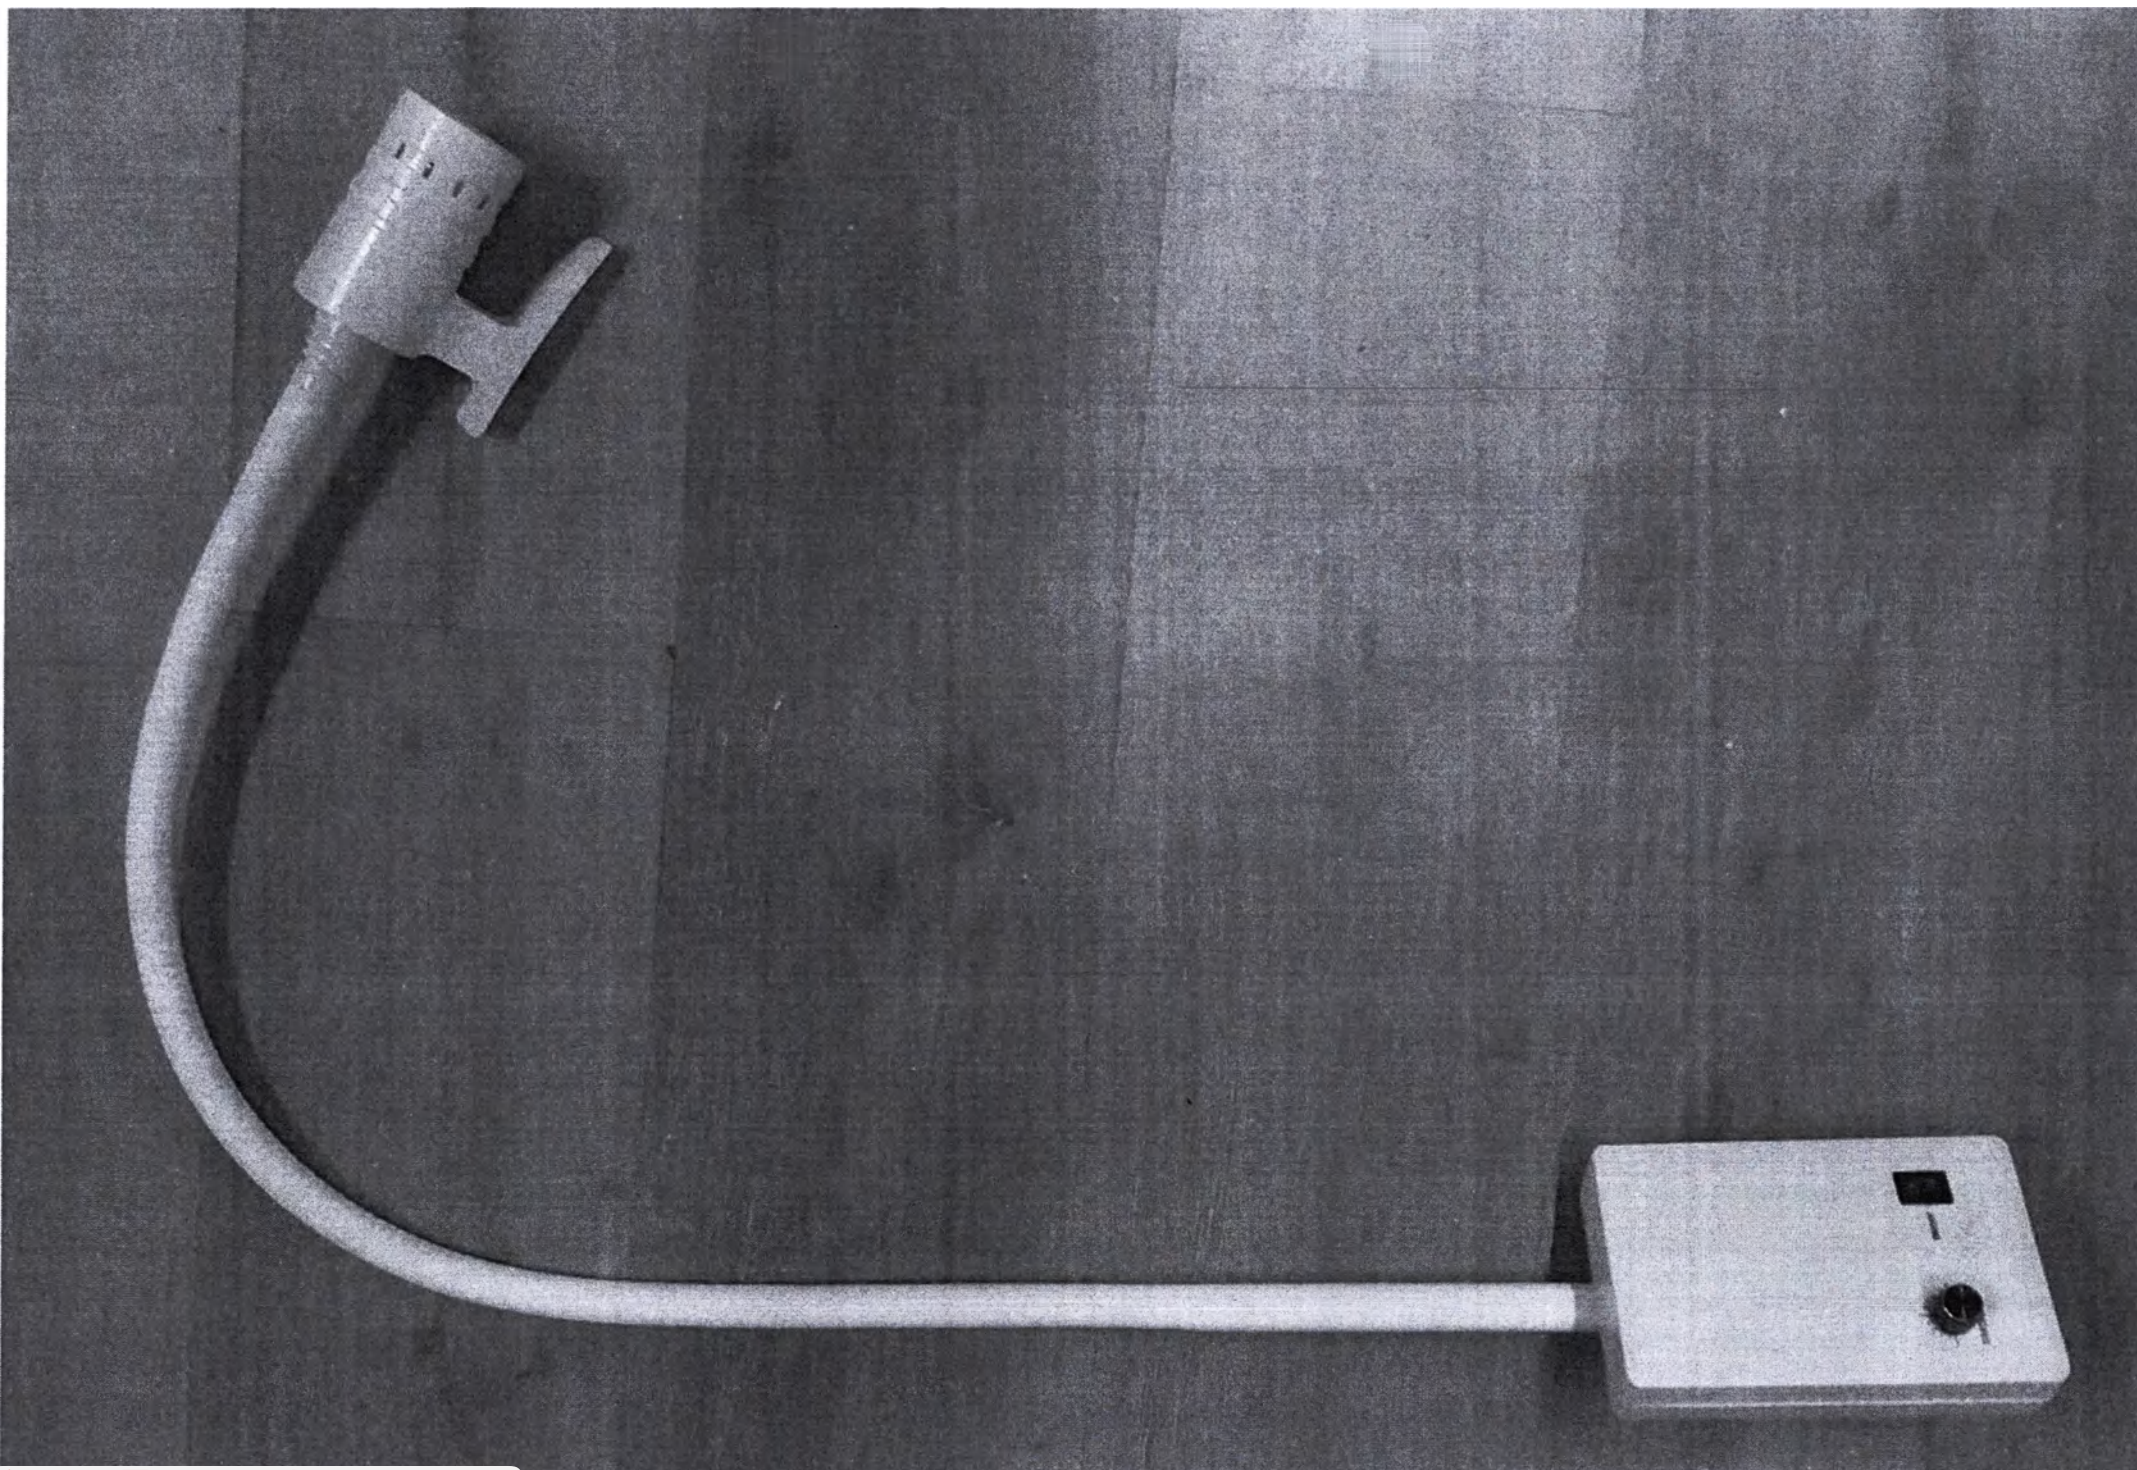
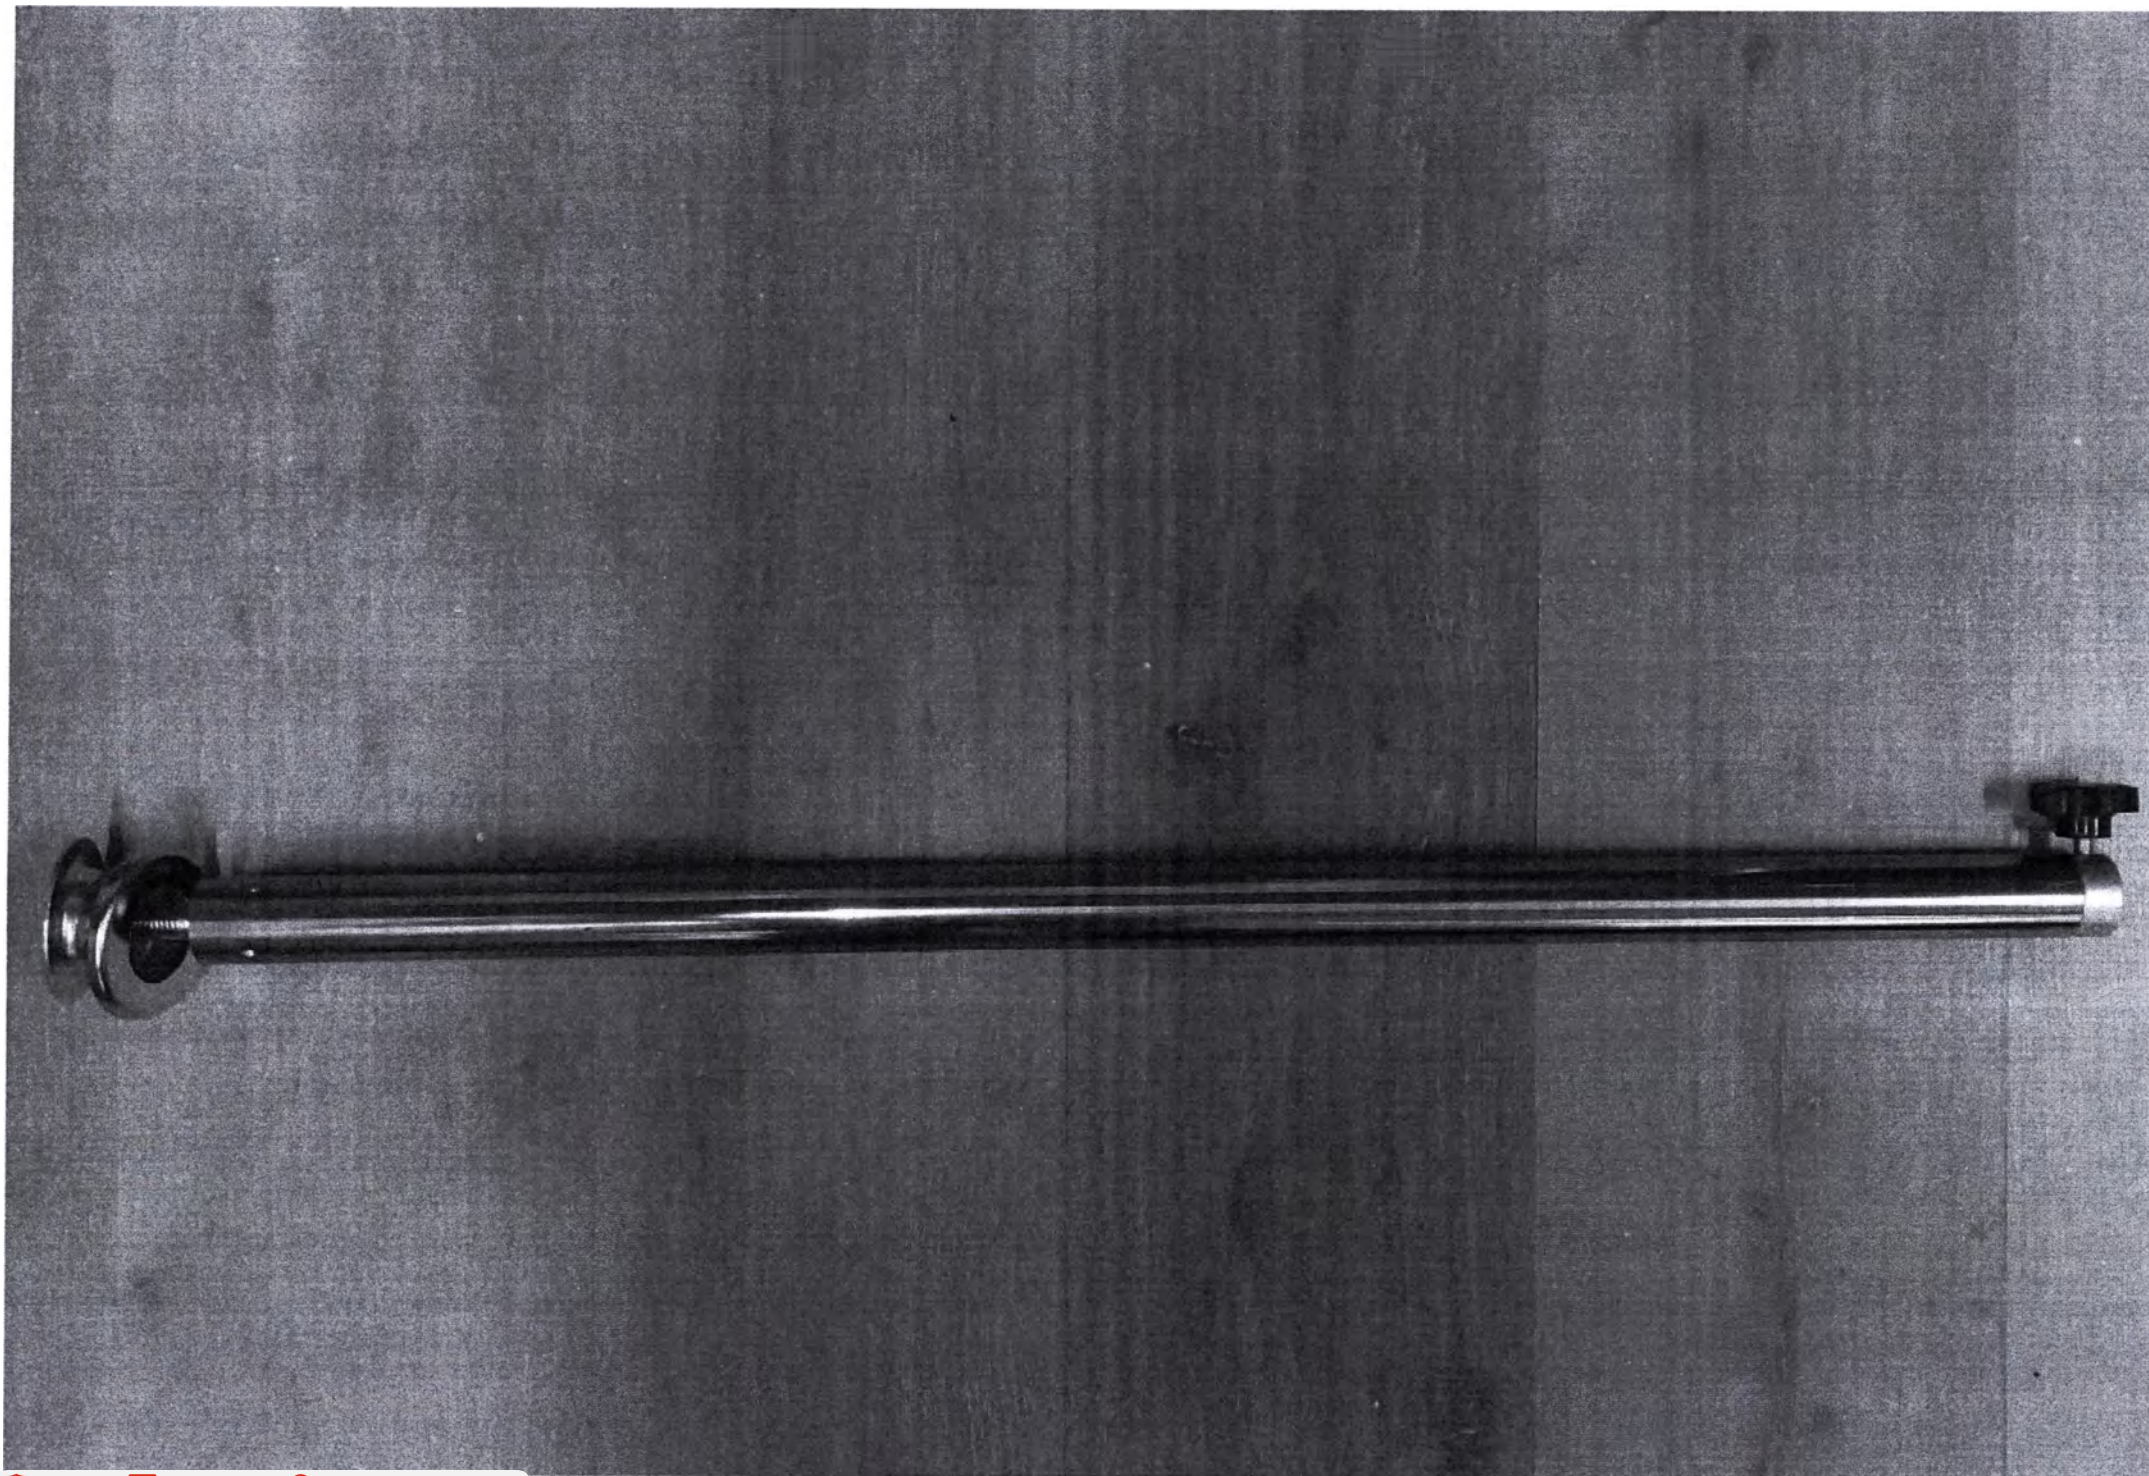


Рис. 2 – Штатив верхний с блоком управления и блоком освещения





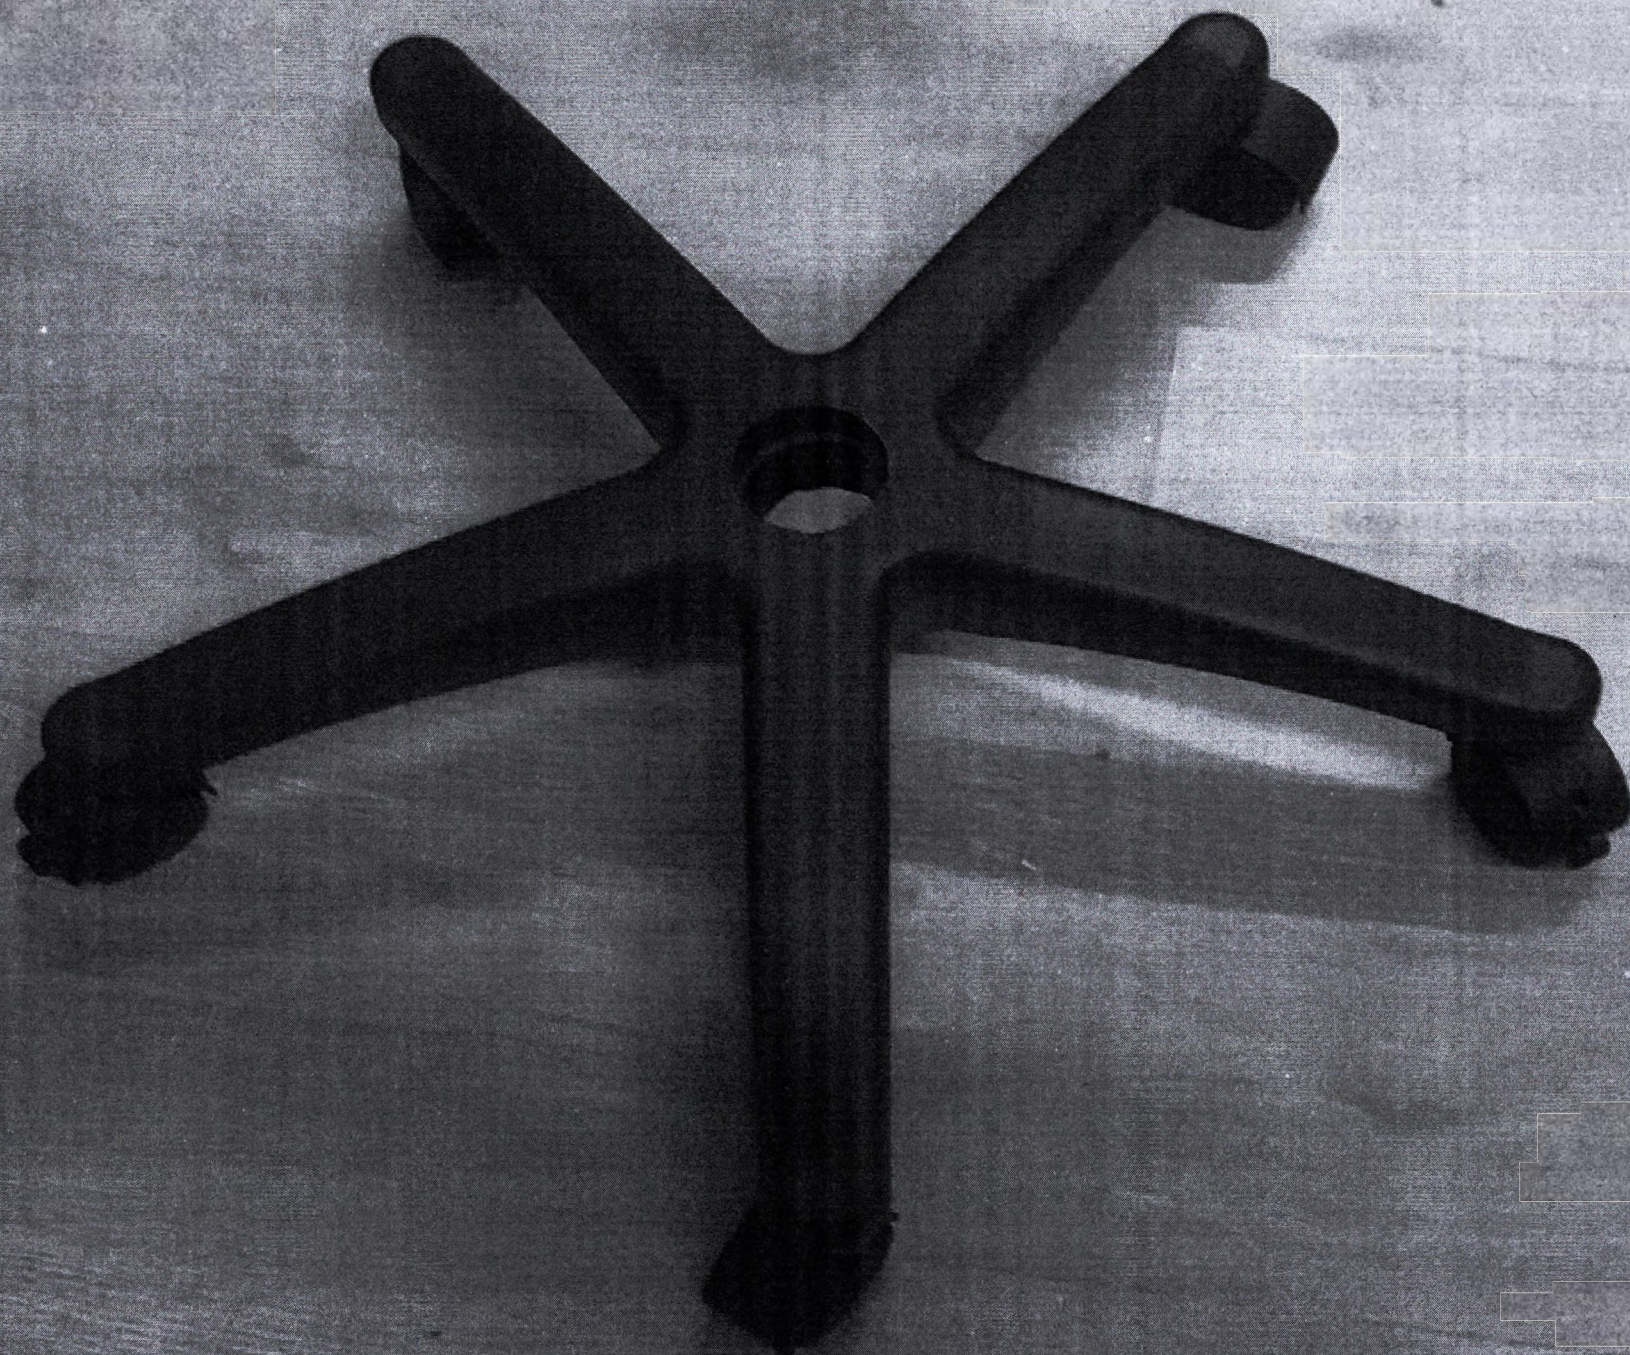


Рис. 5 – Основание с колесами

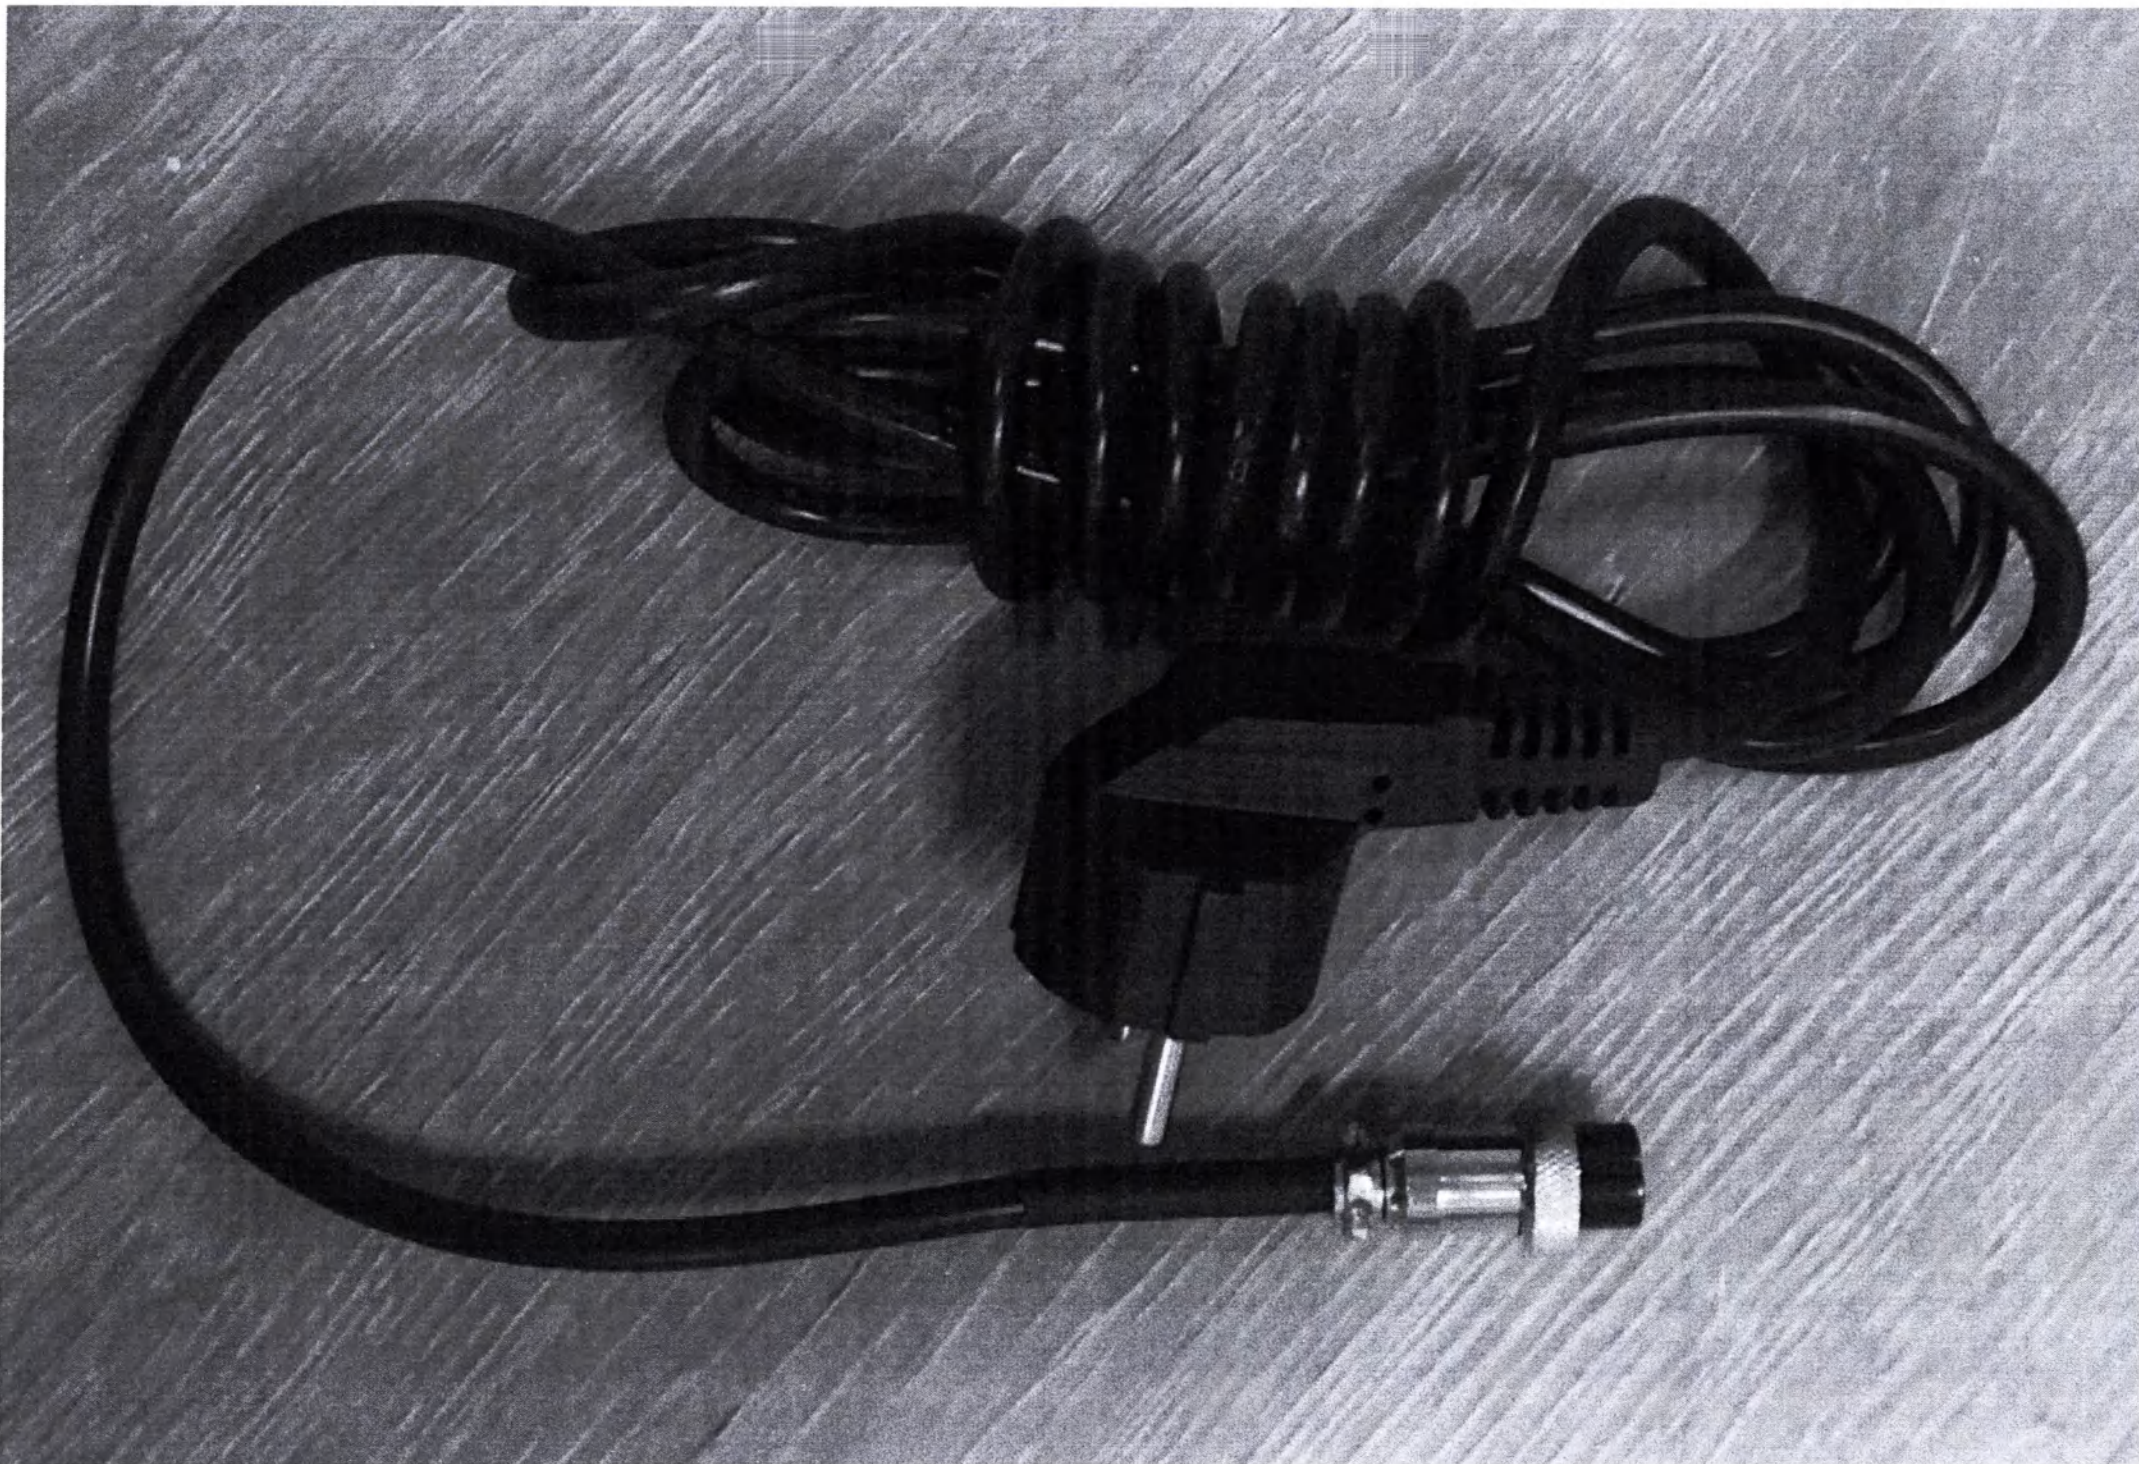


Рис. 6 – Шнур питания



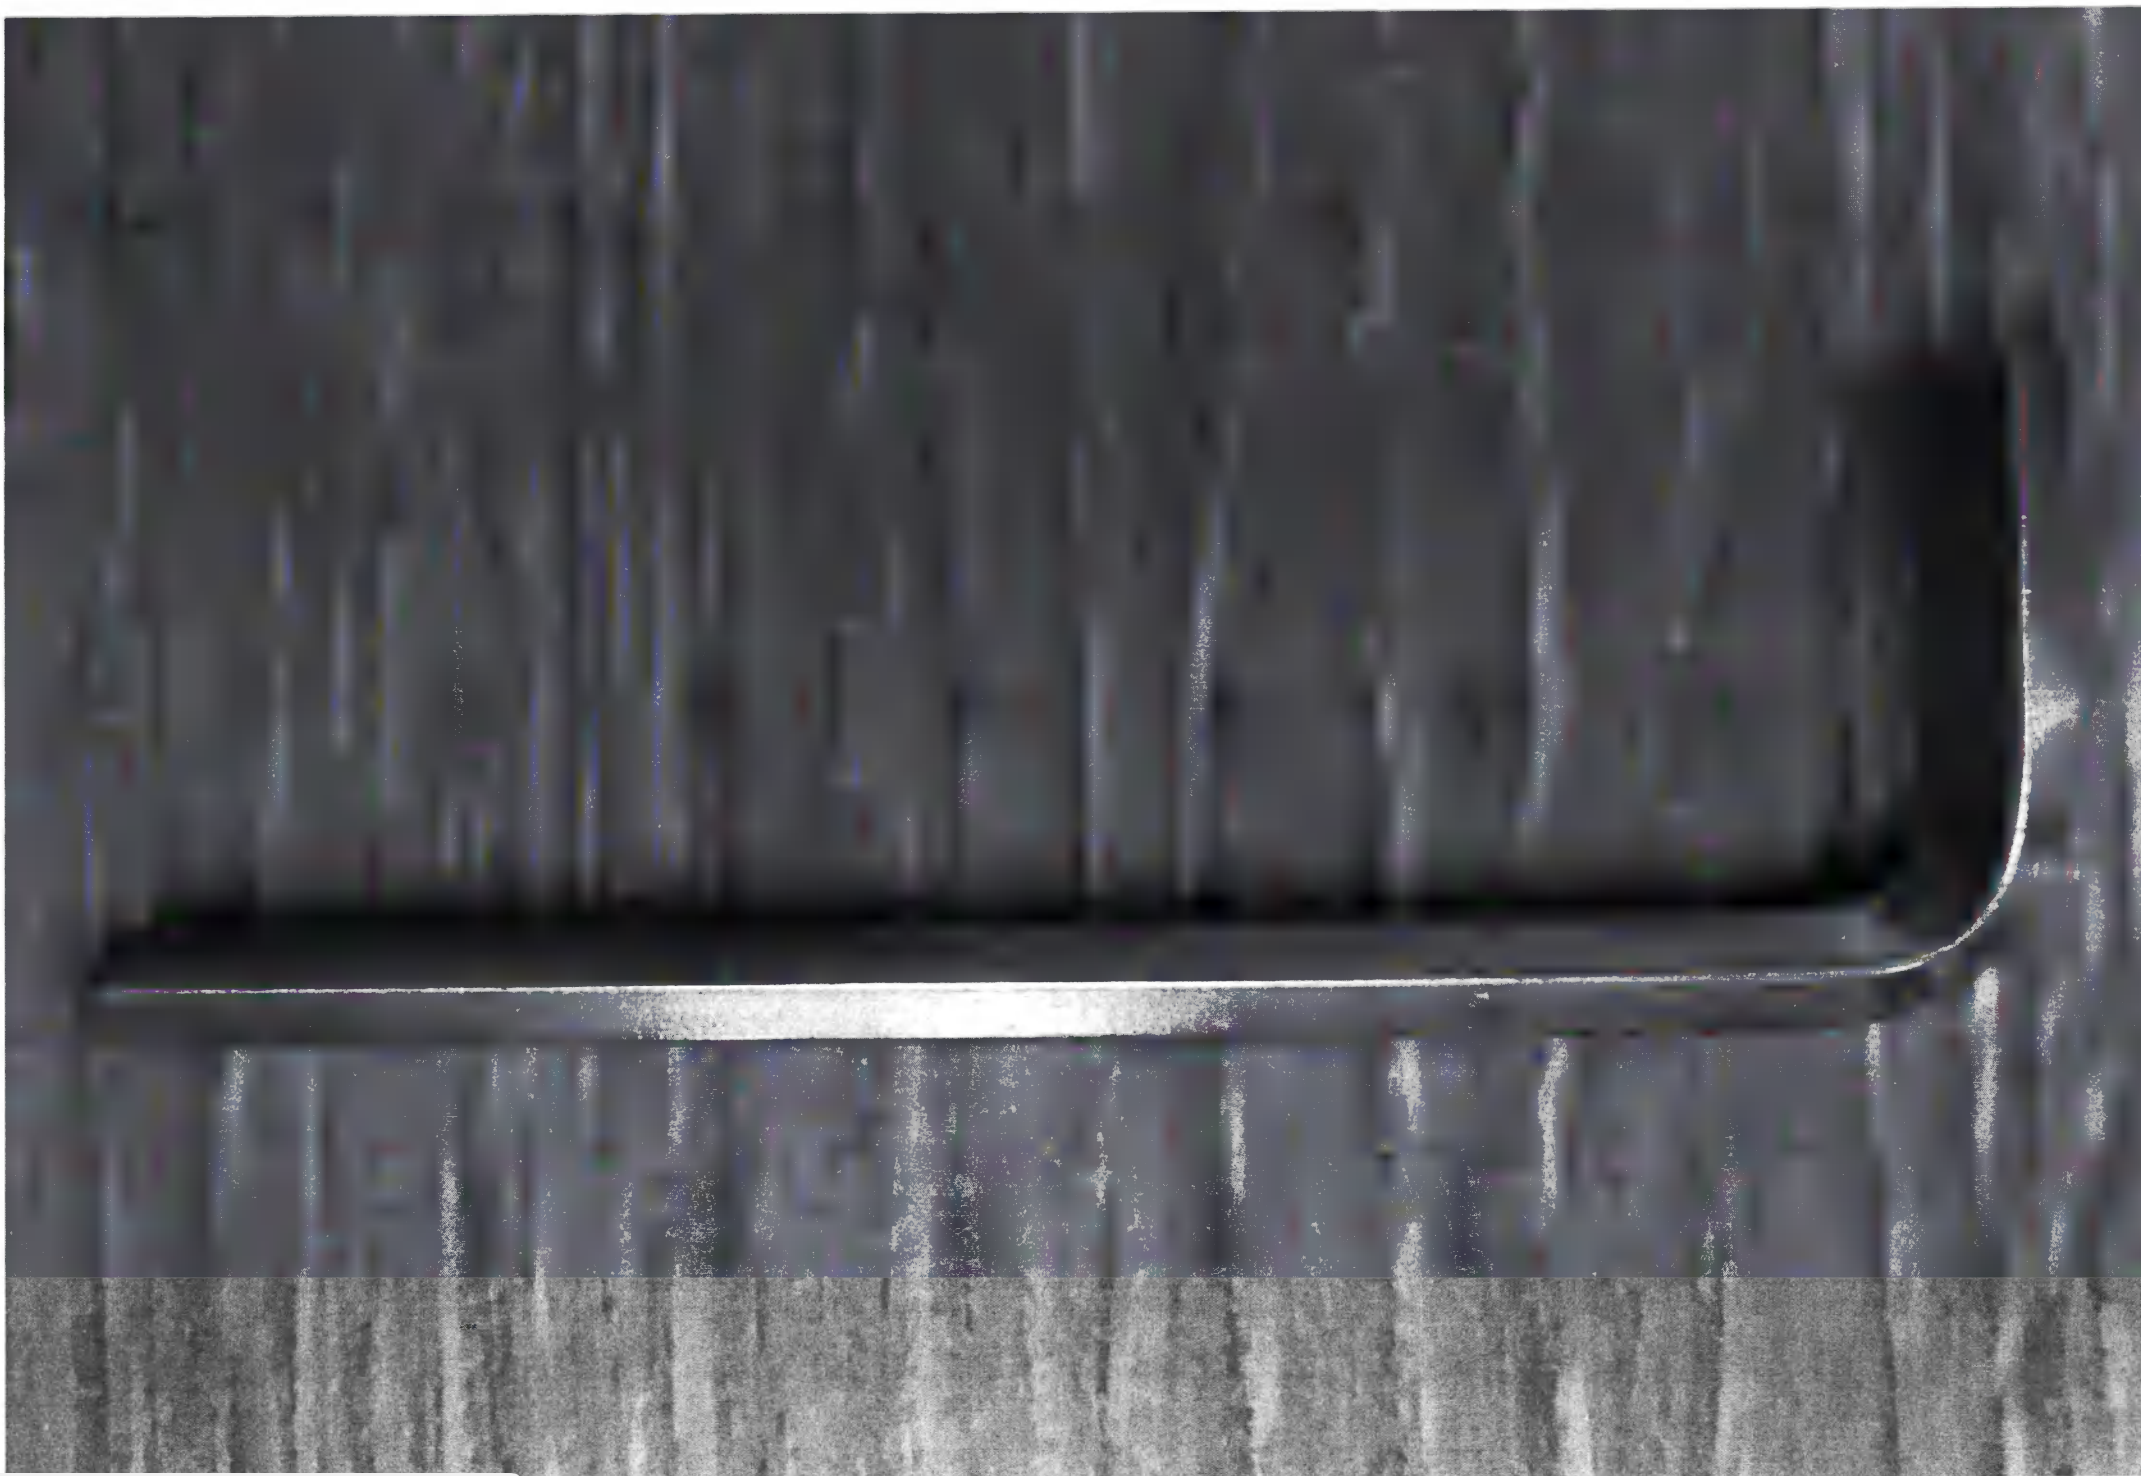


Рис. 7 – Ключ шестигранник

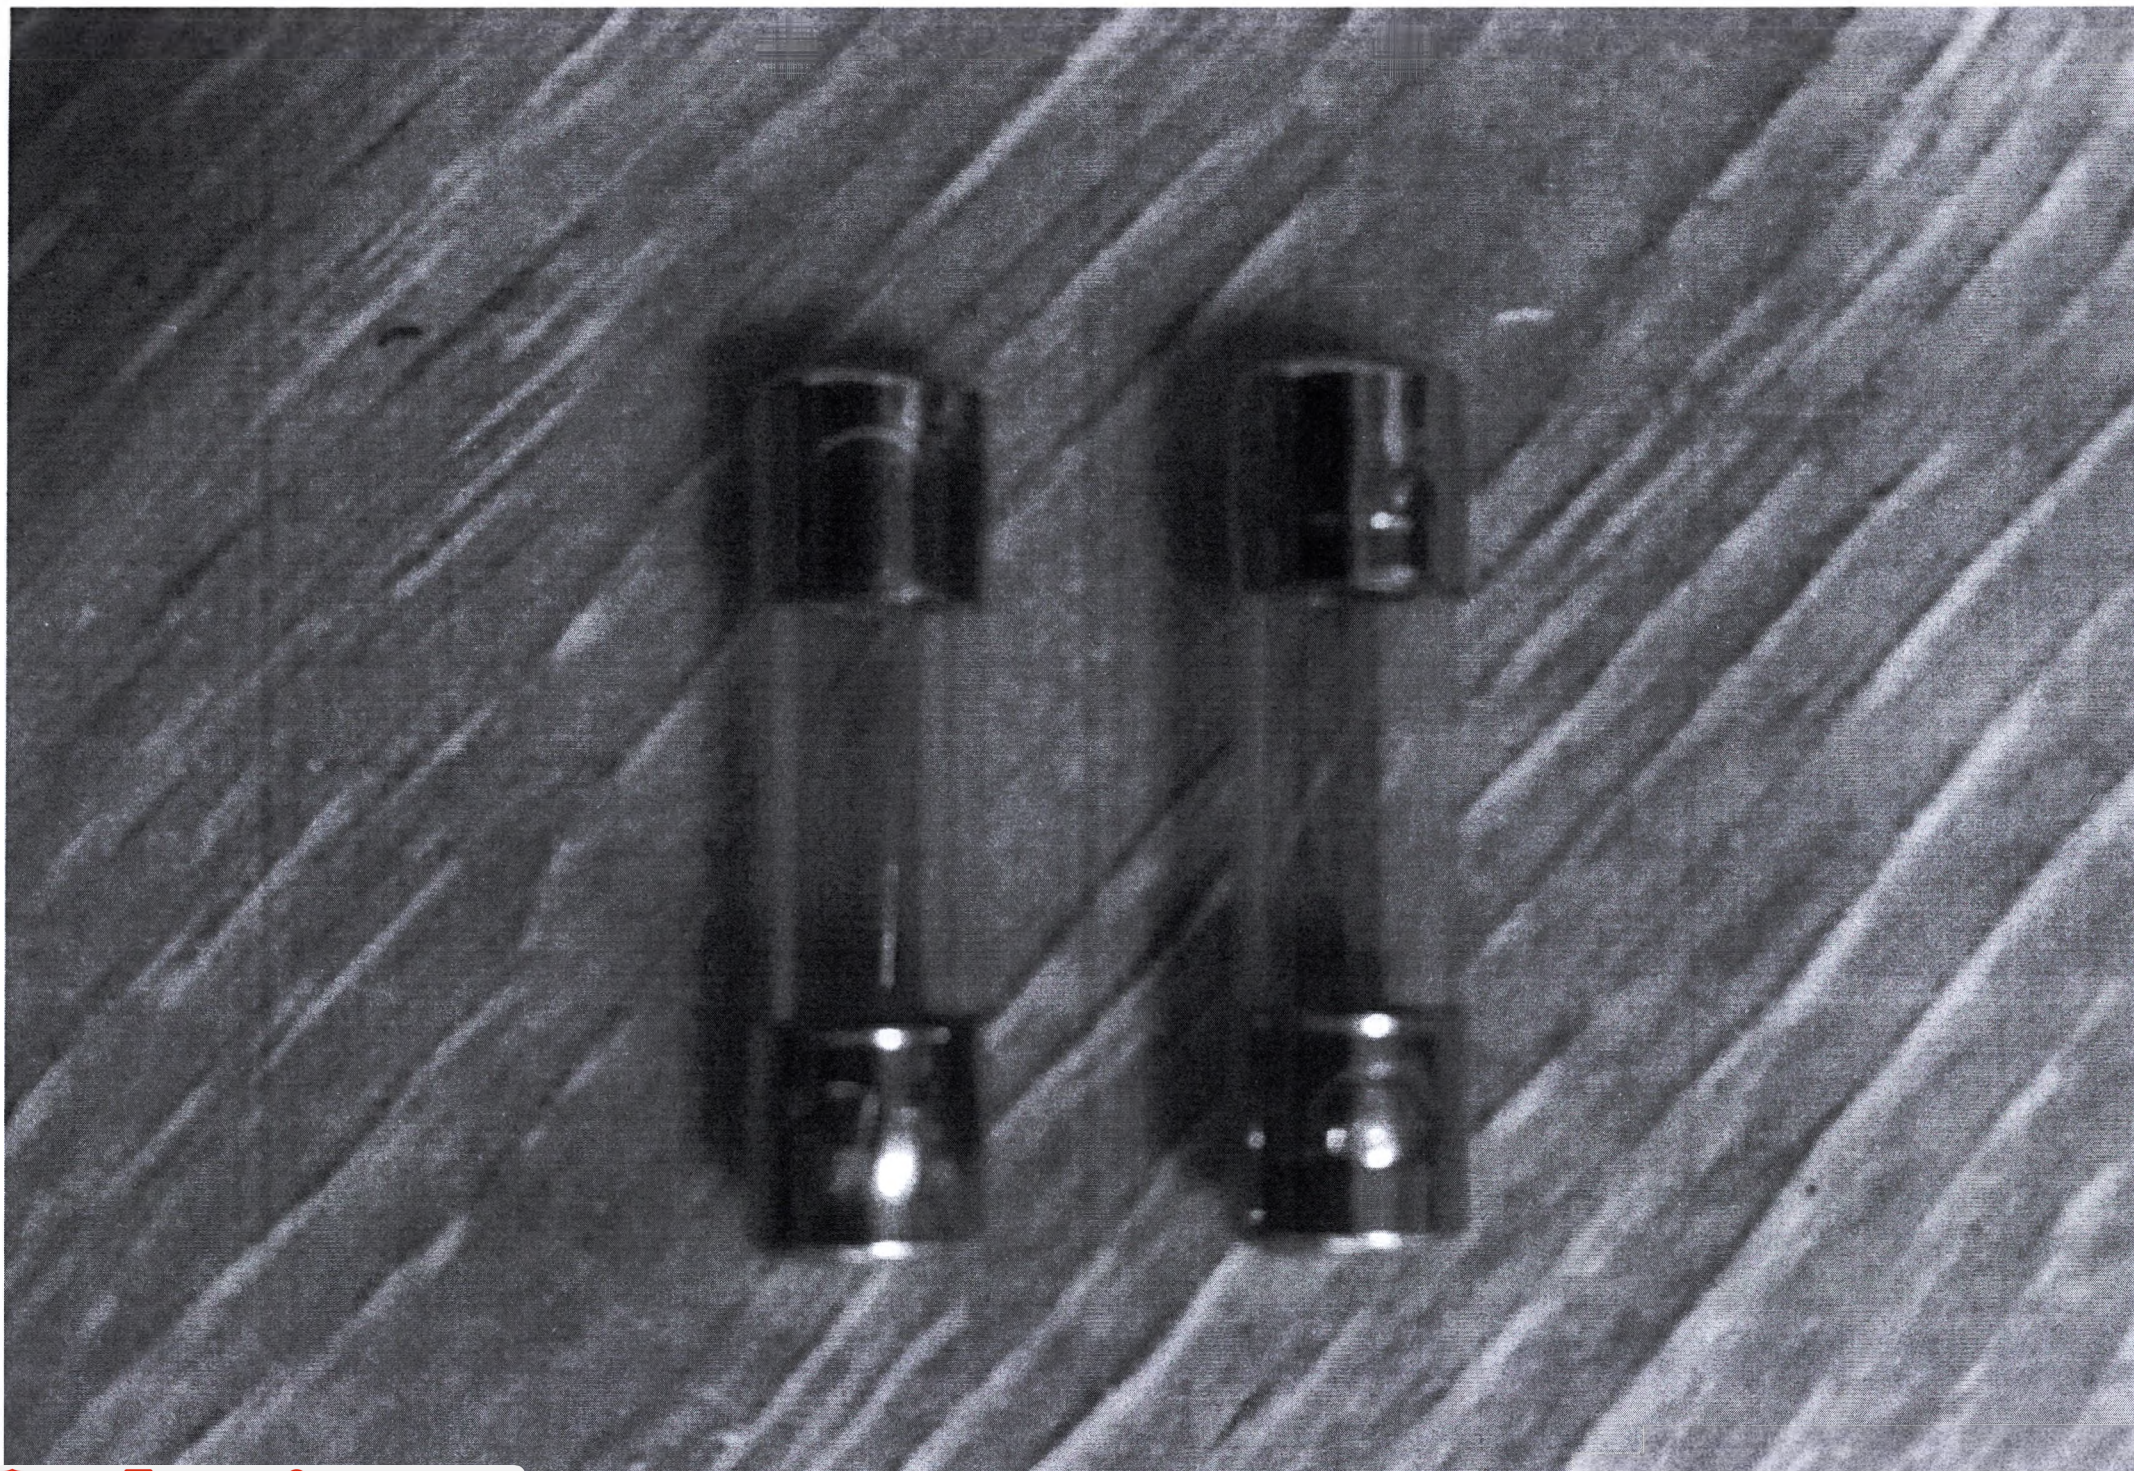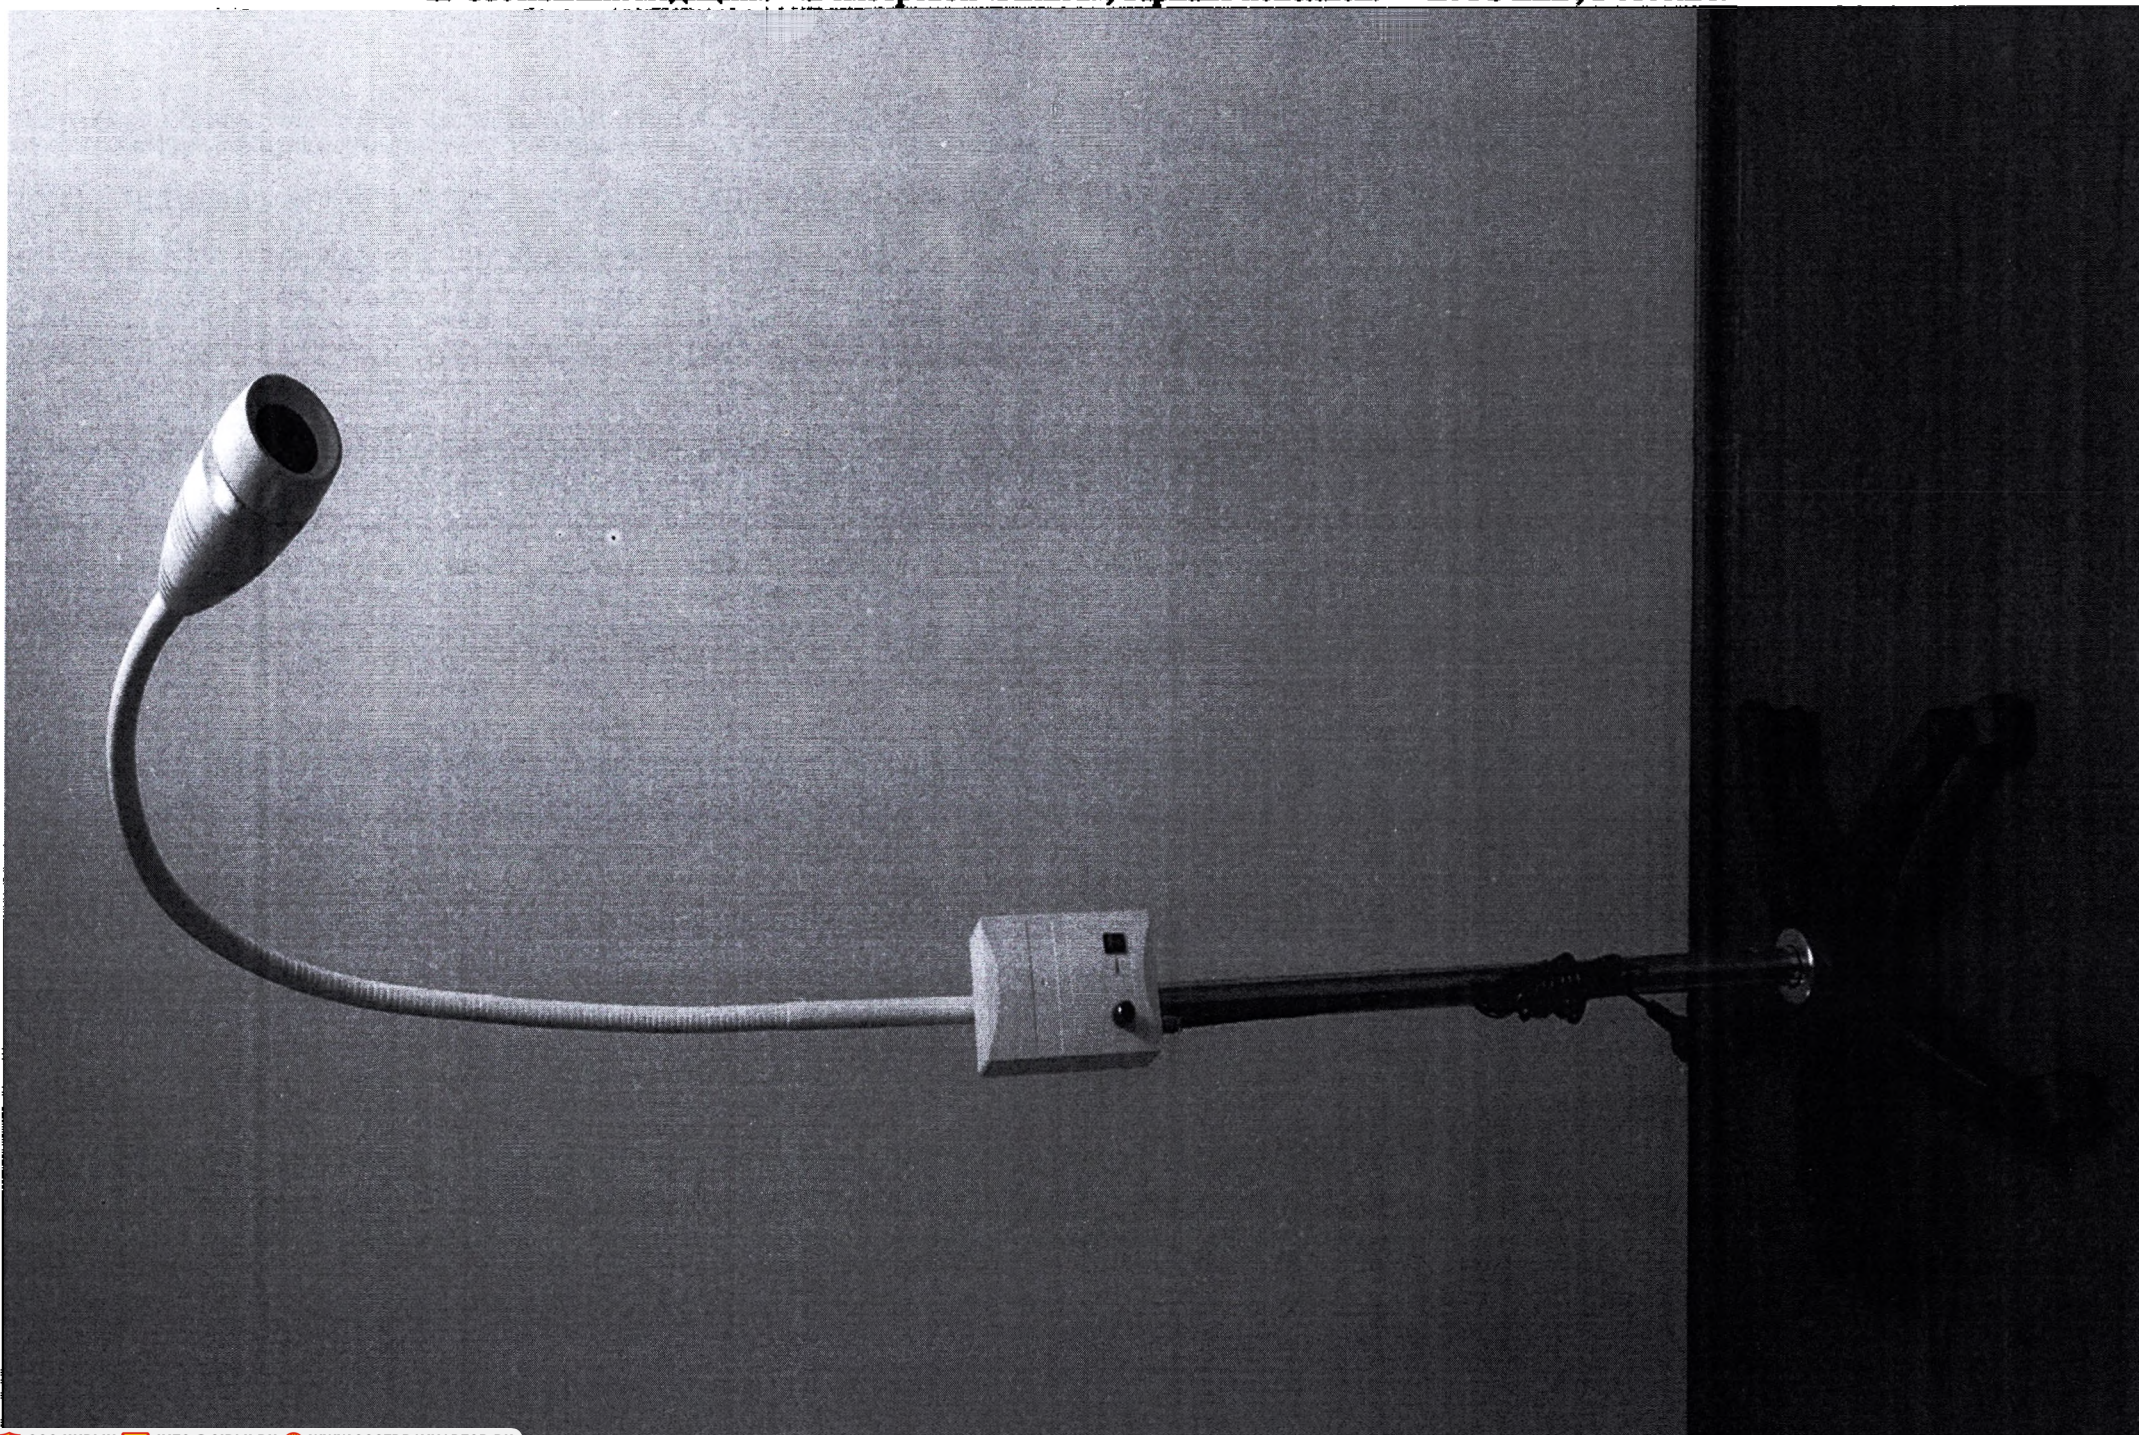

II. Светильник медицинский смотровой «Armed», вариант исполнения AR-FS LED, в составе:



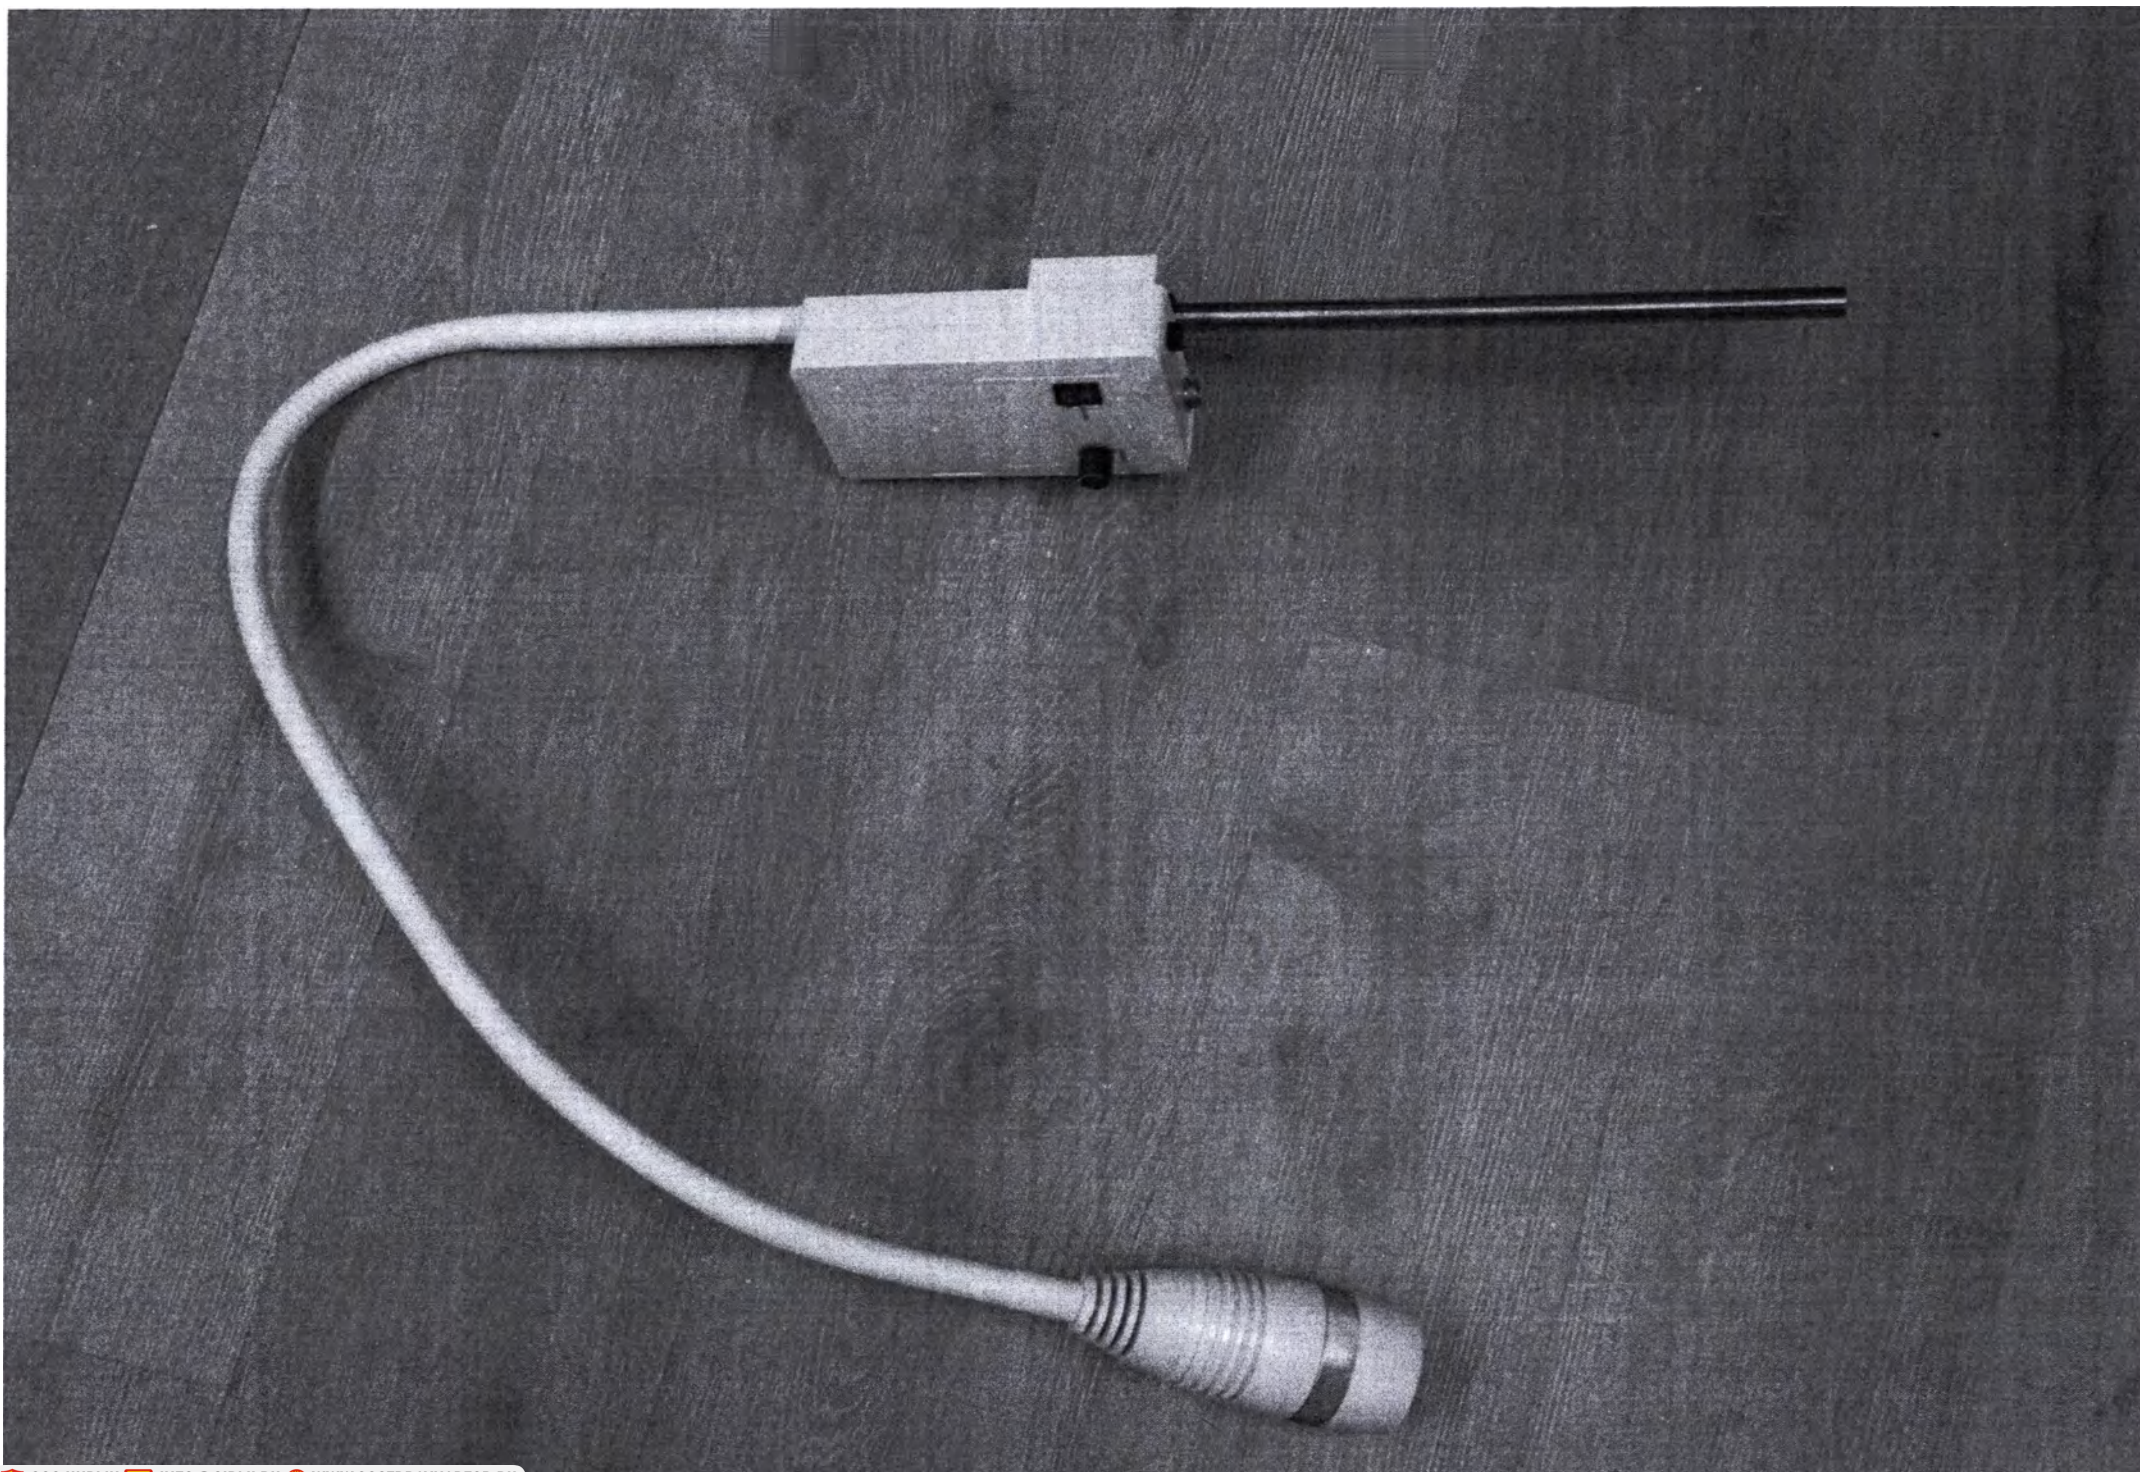
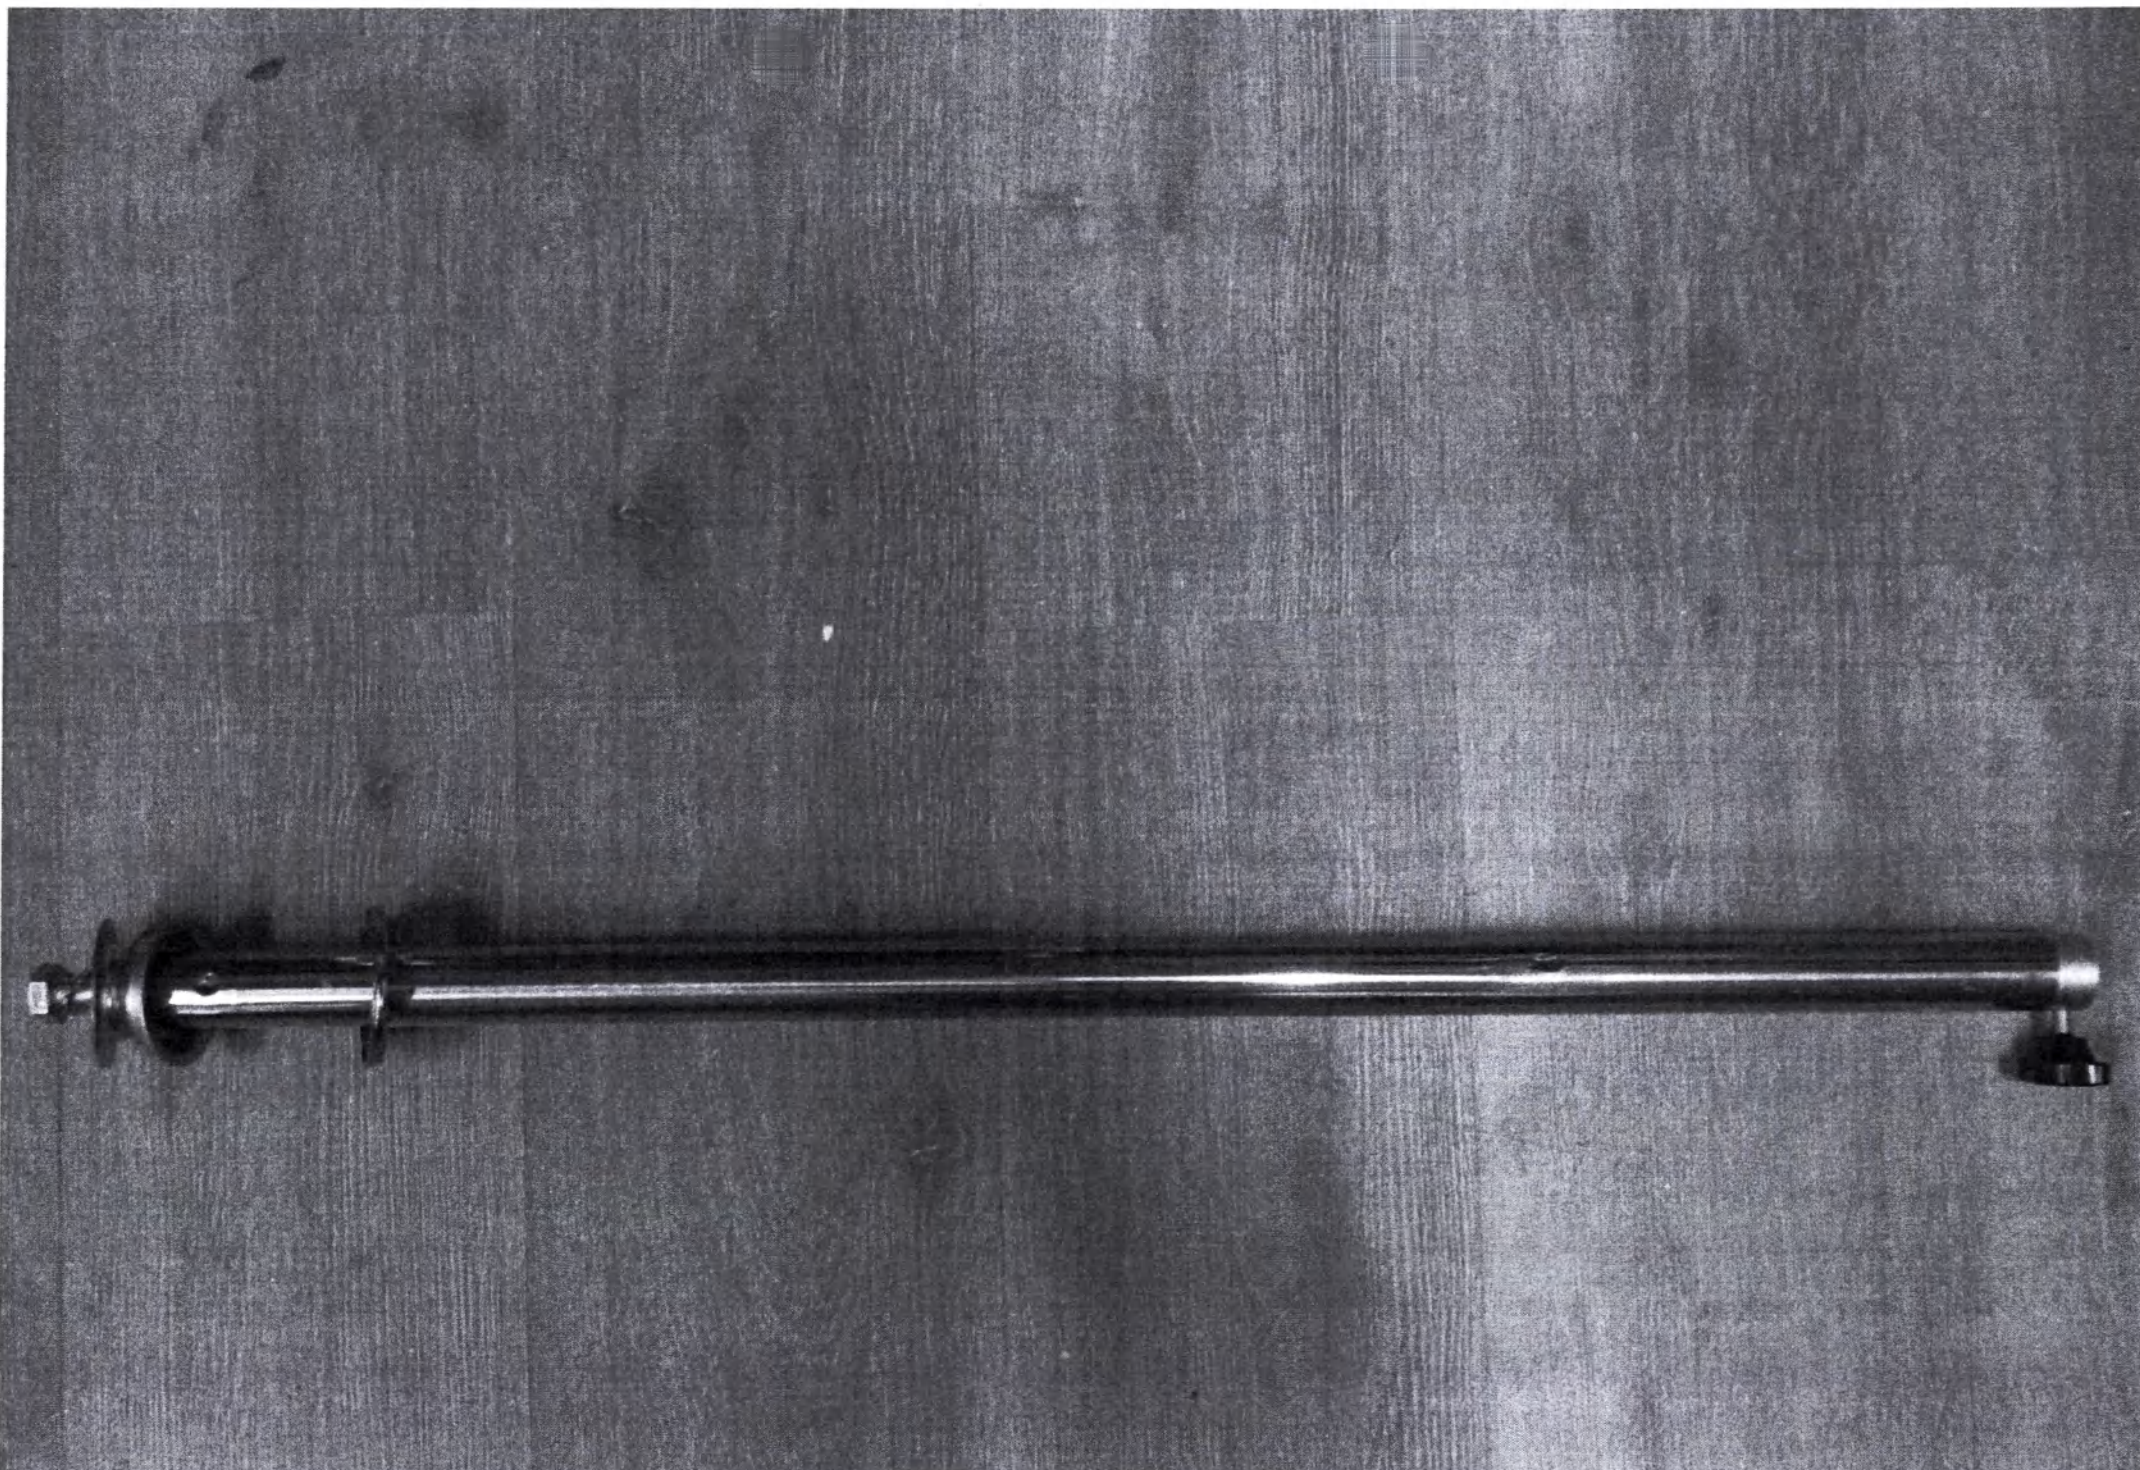
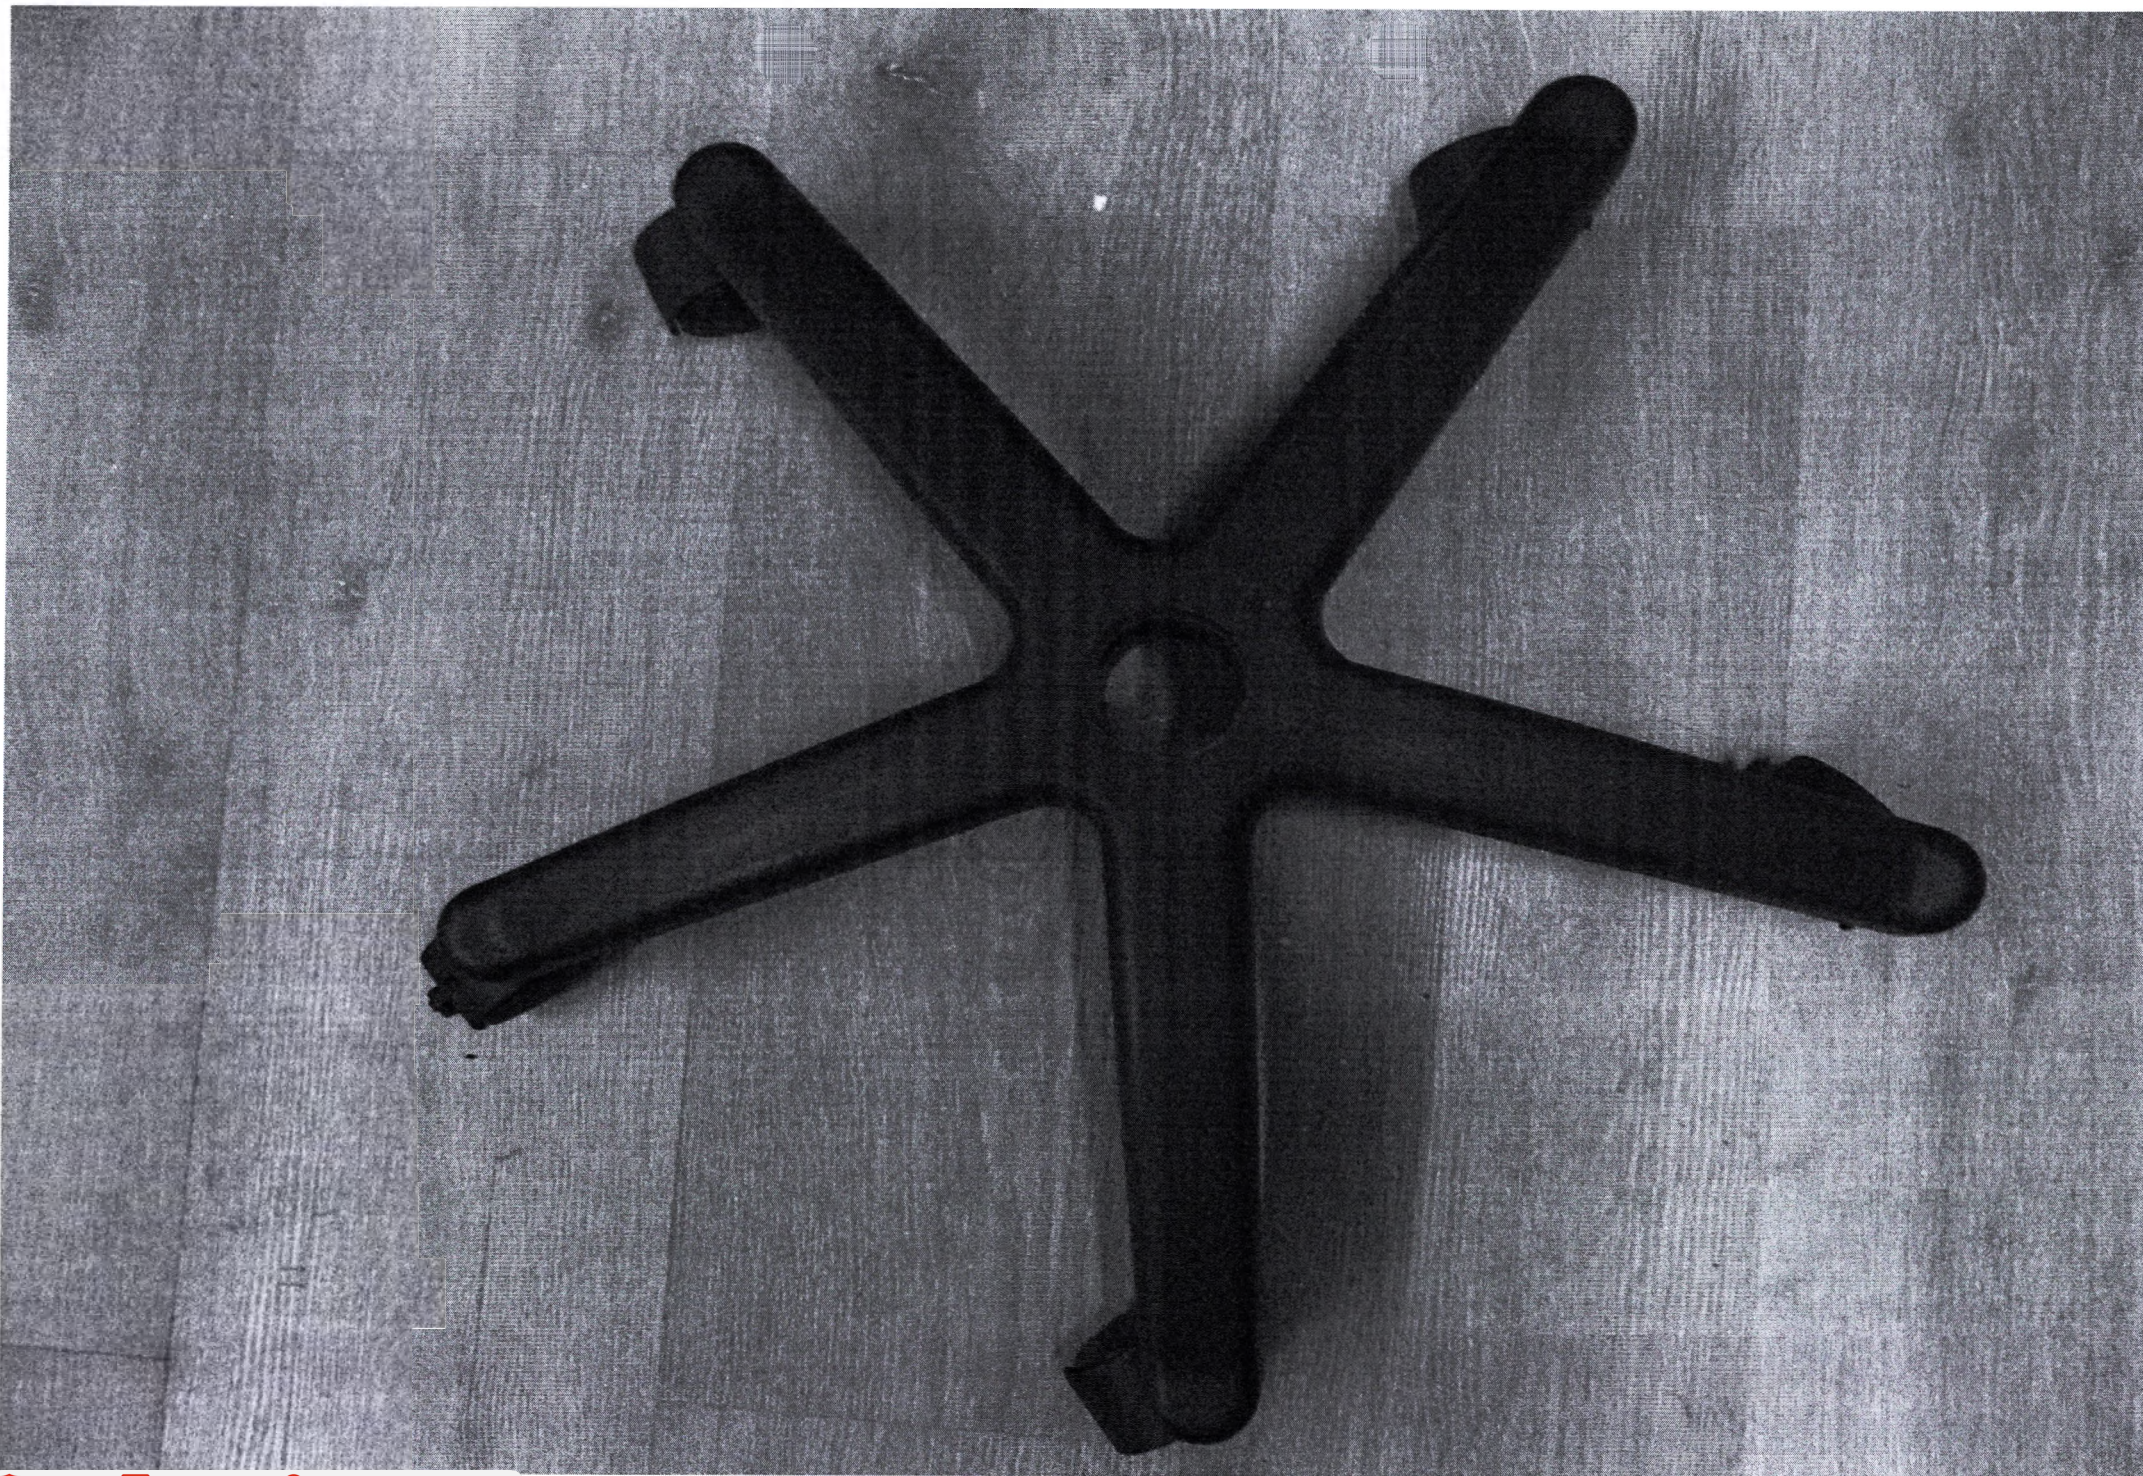


Рис. 10 – Штатив верхний с блоком управления и блоком освещения





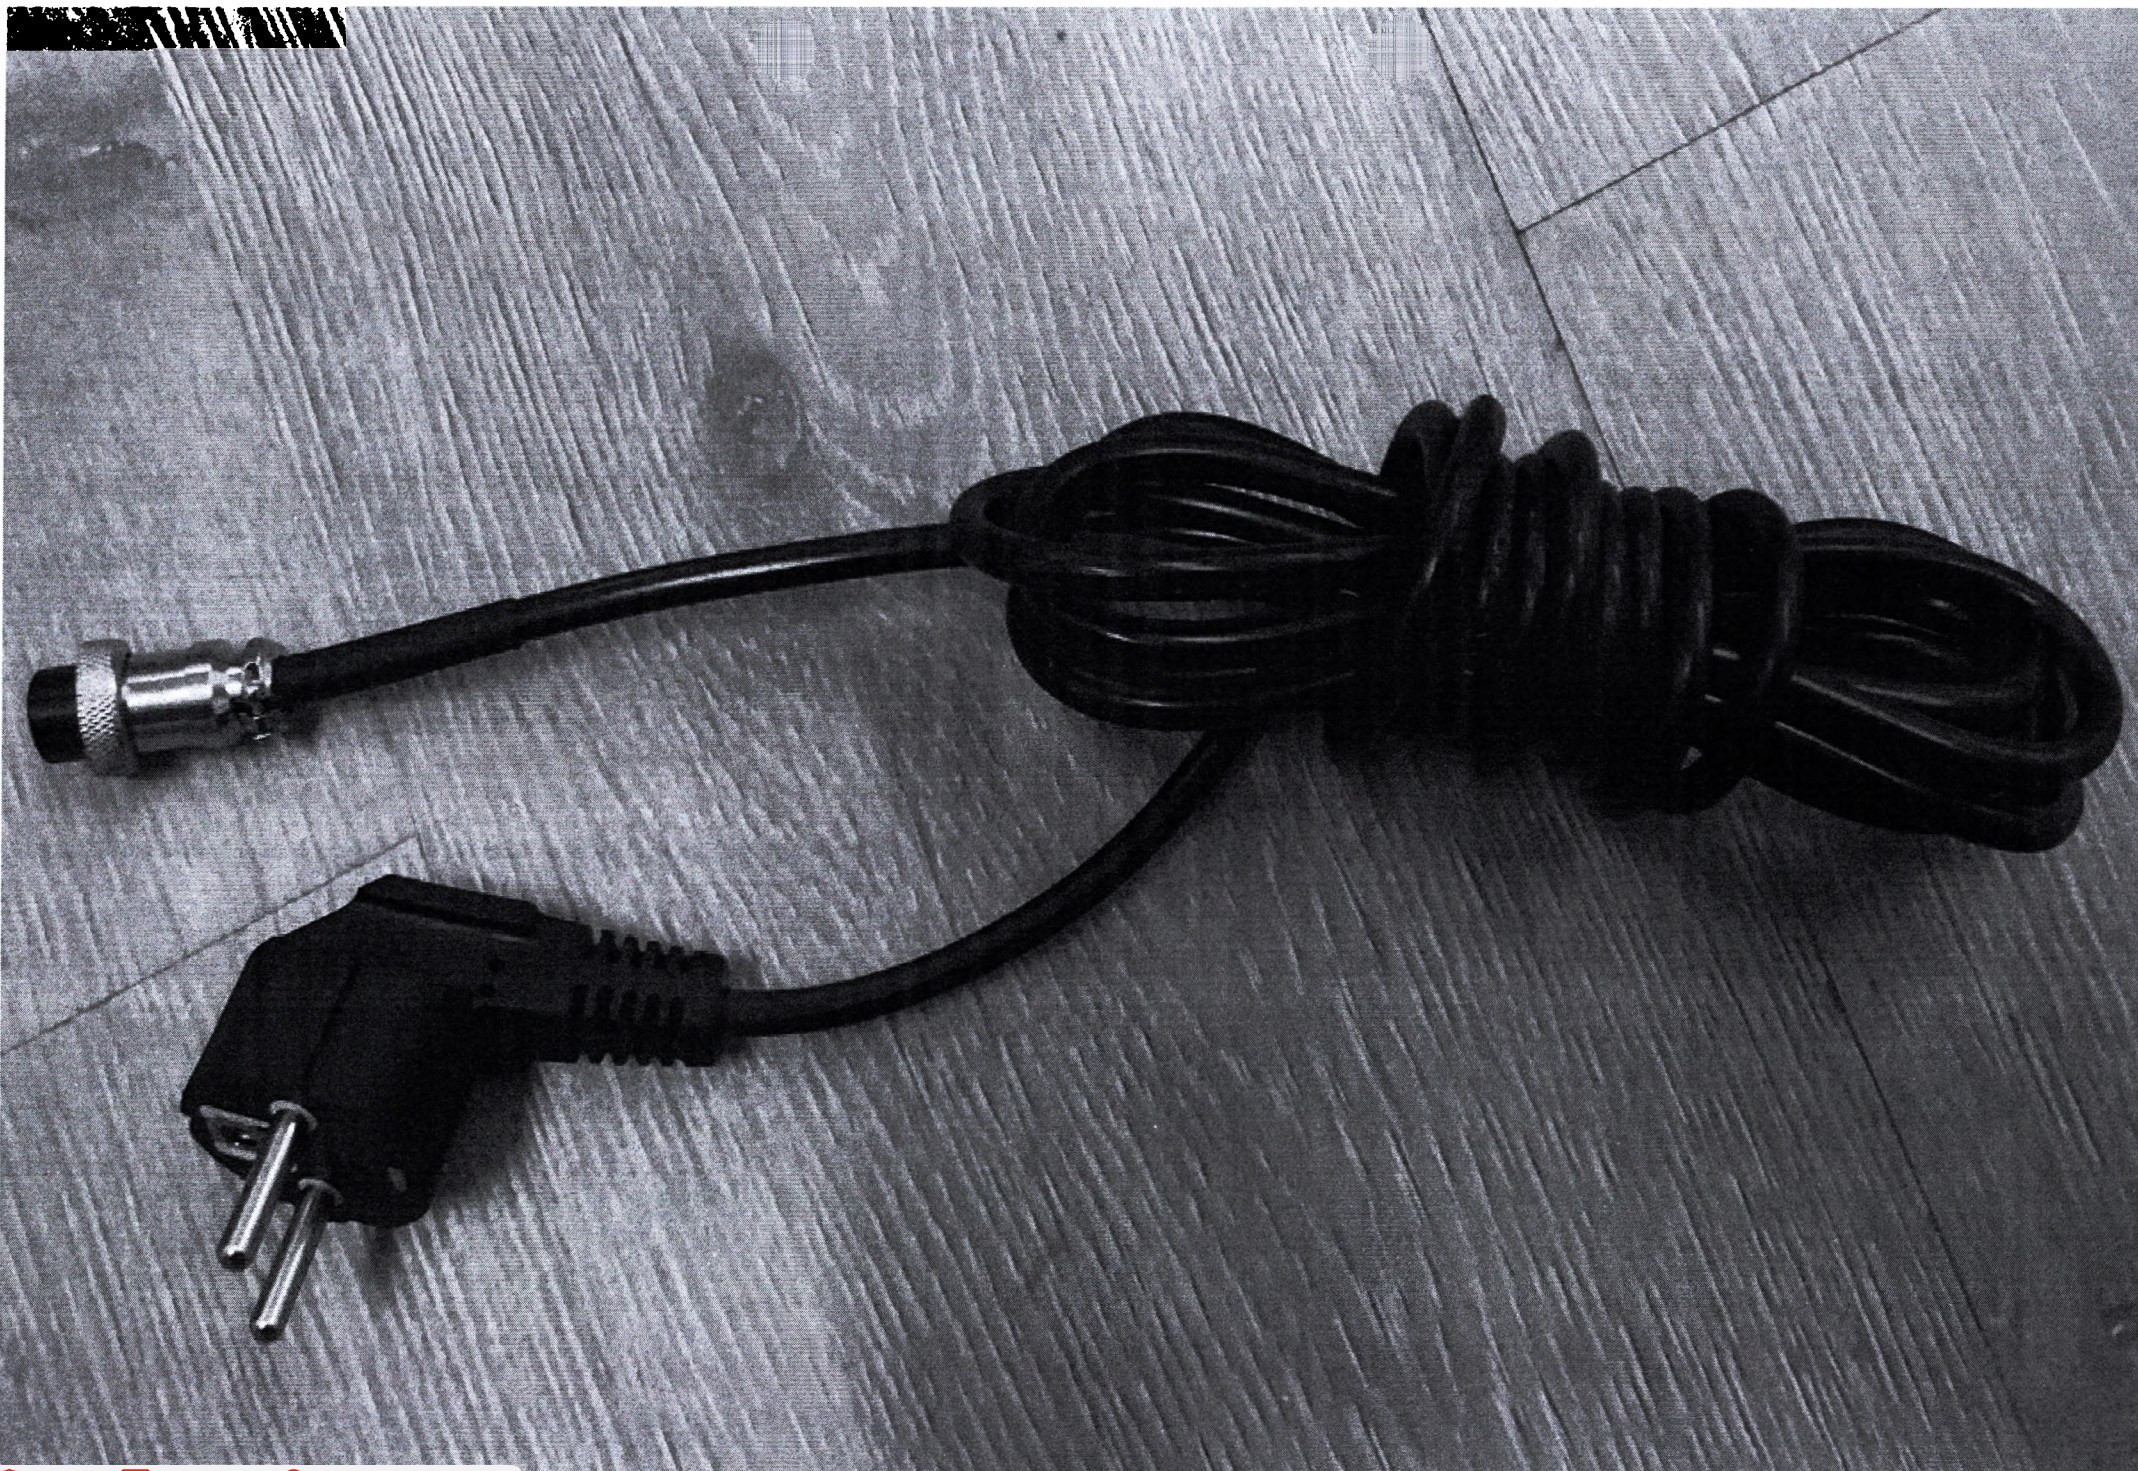


Рис. 13 – Шнур питания



Рис. 14 – Ключ шестигранник

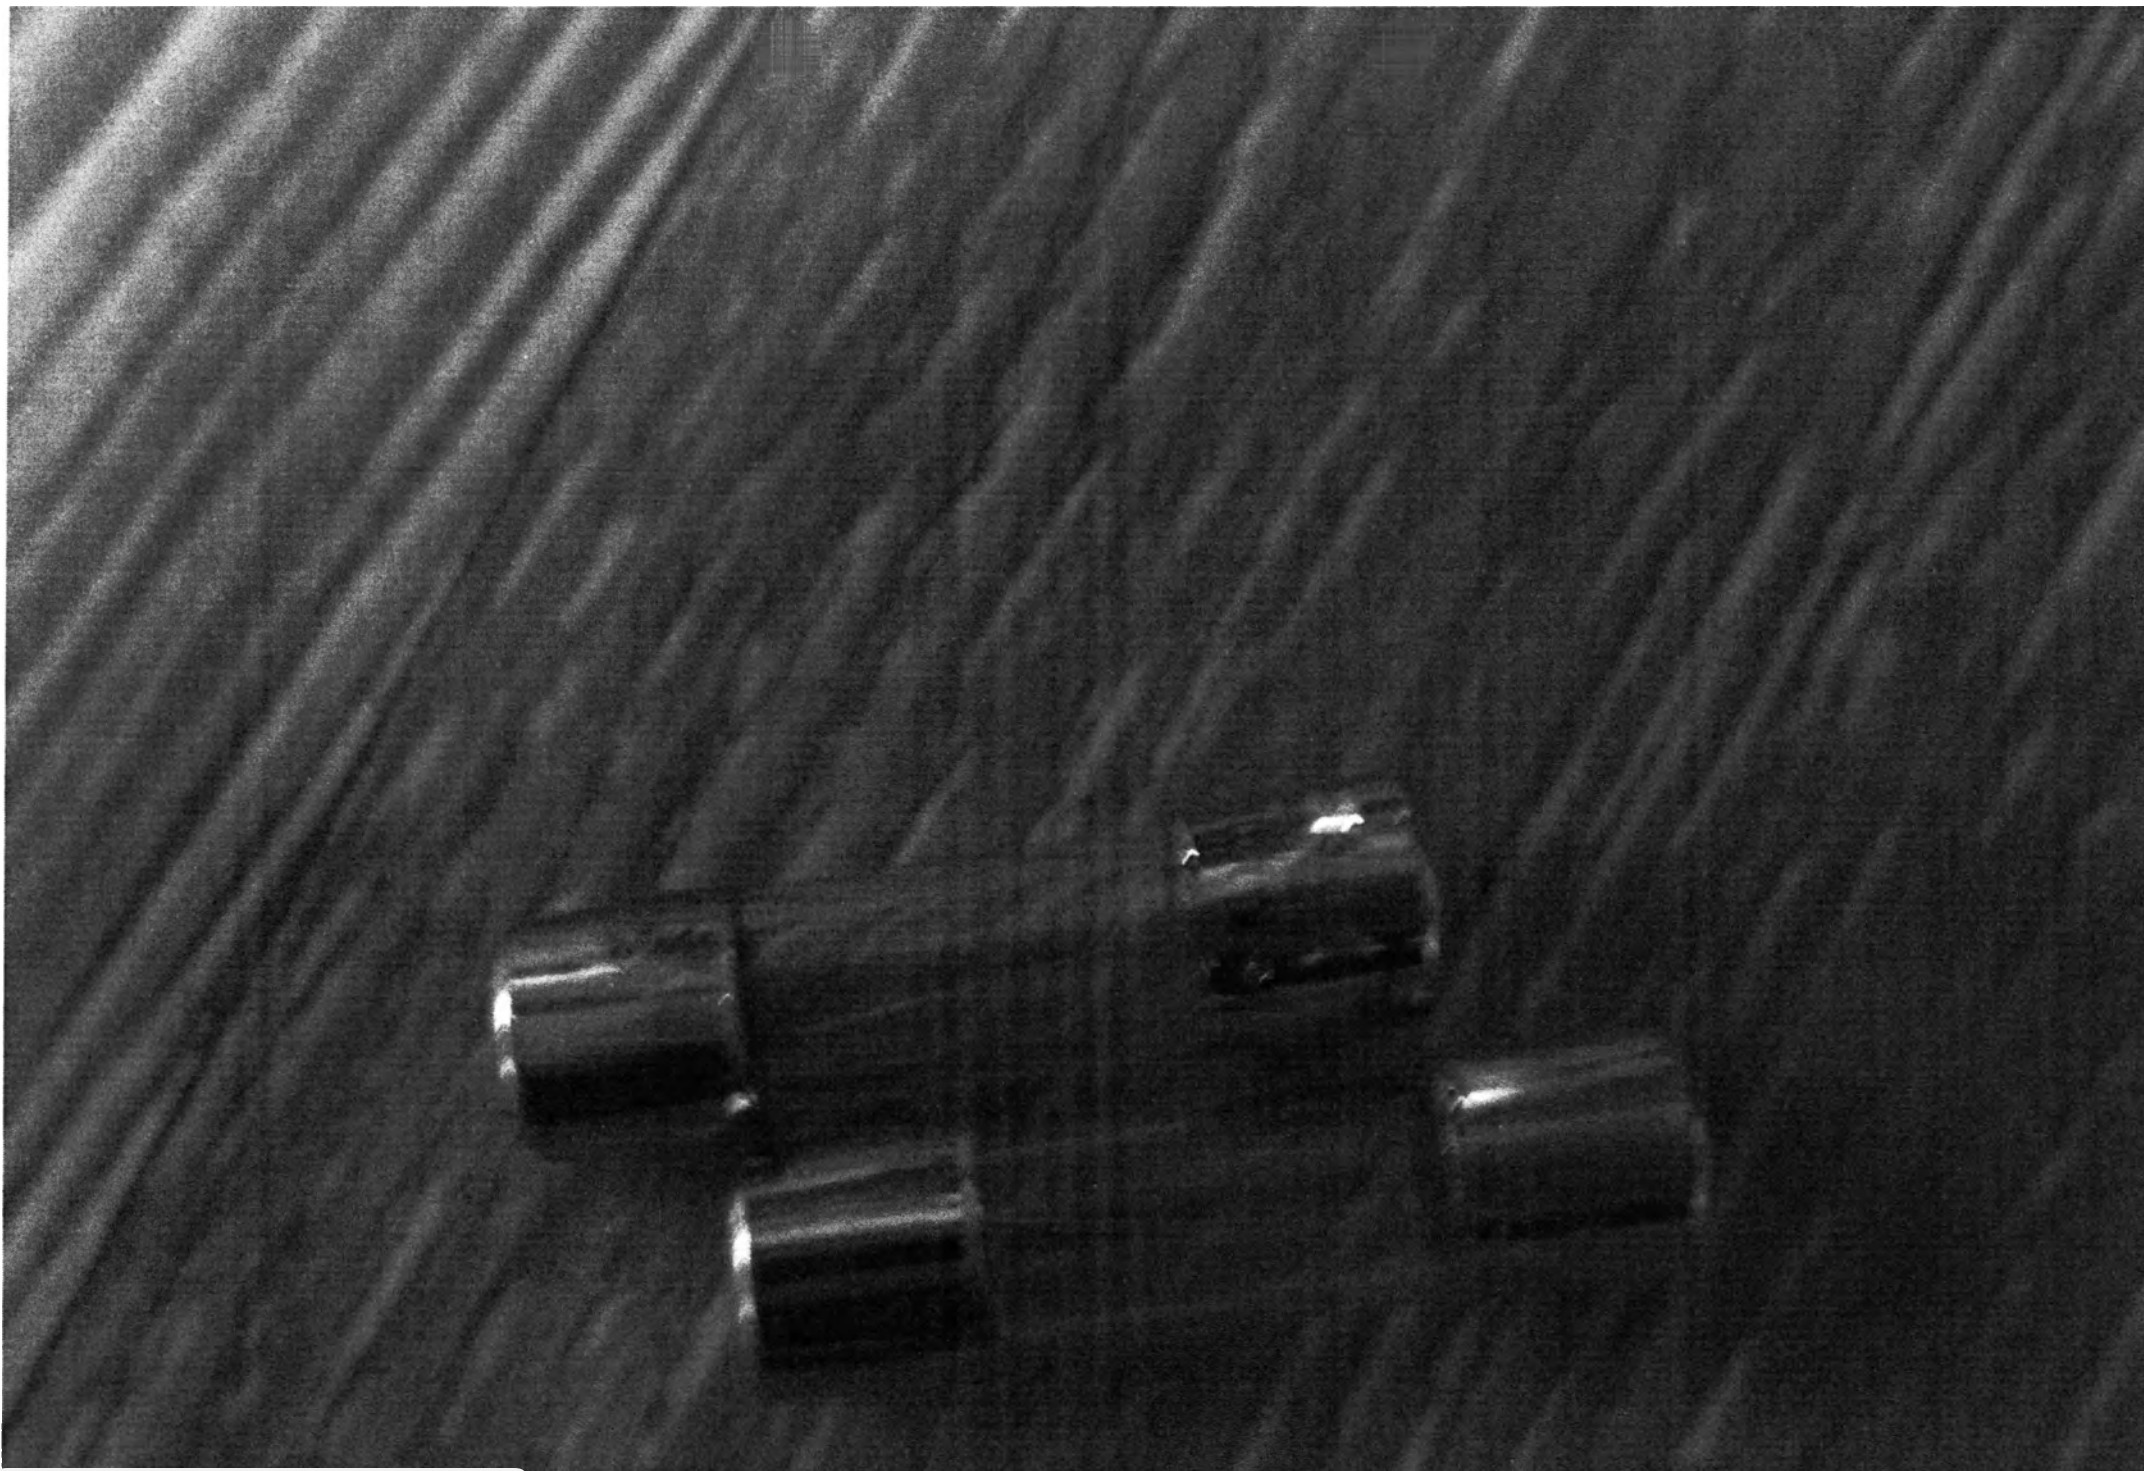
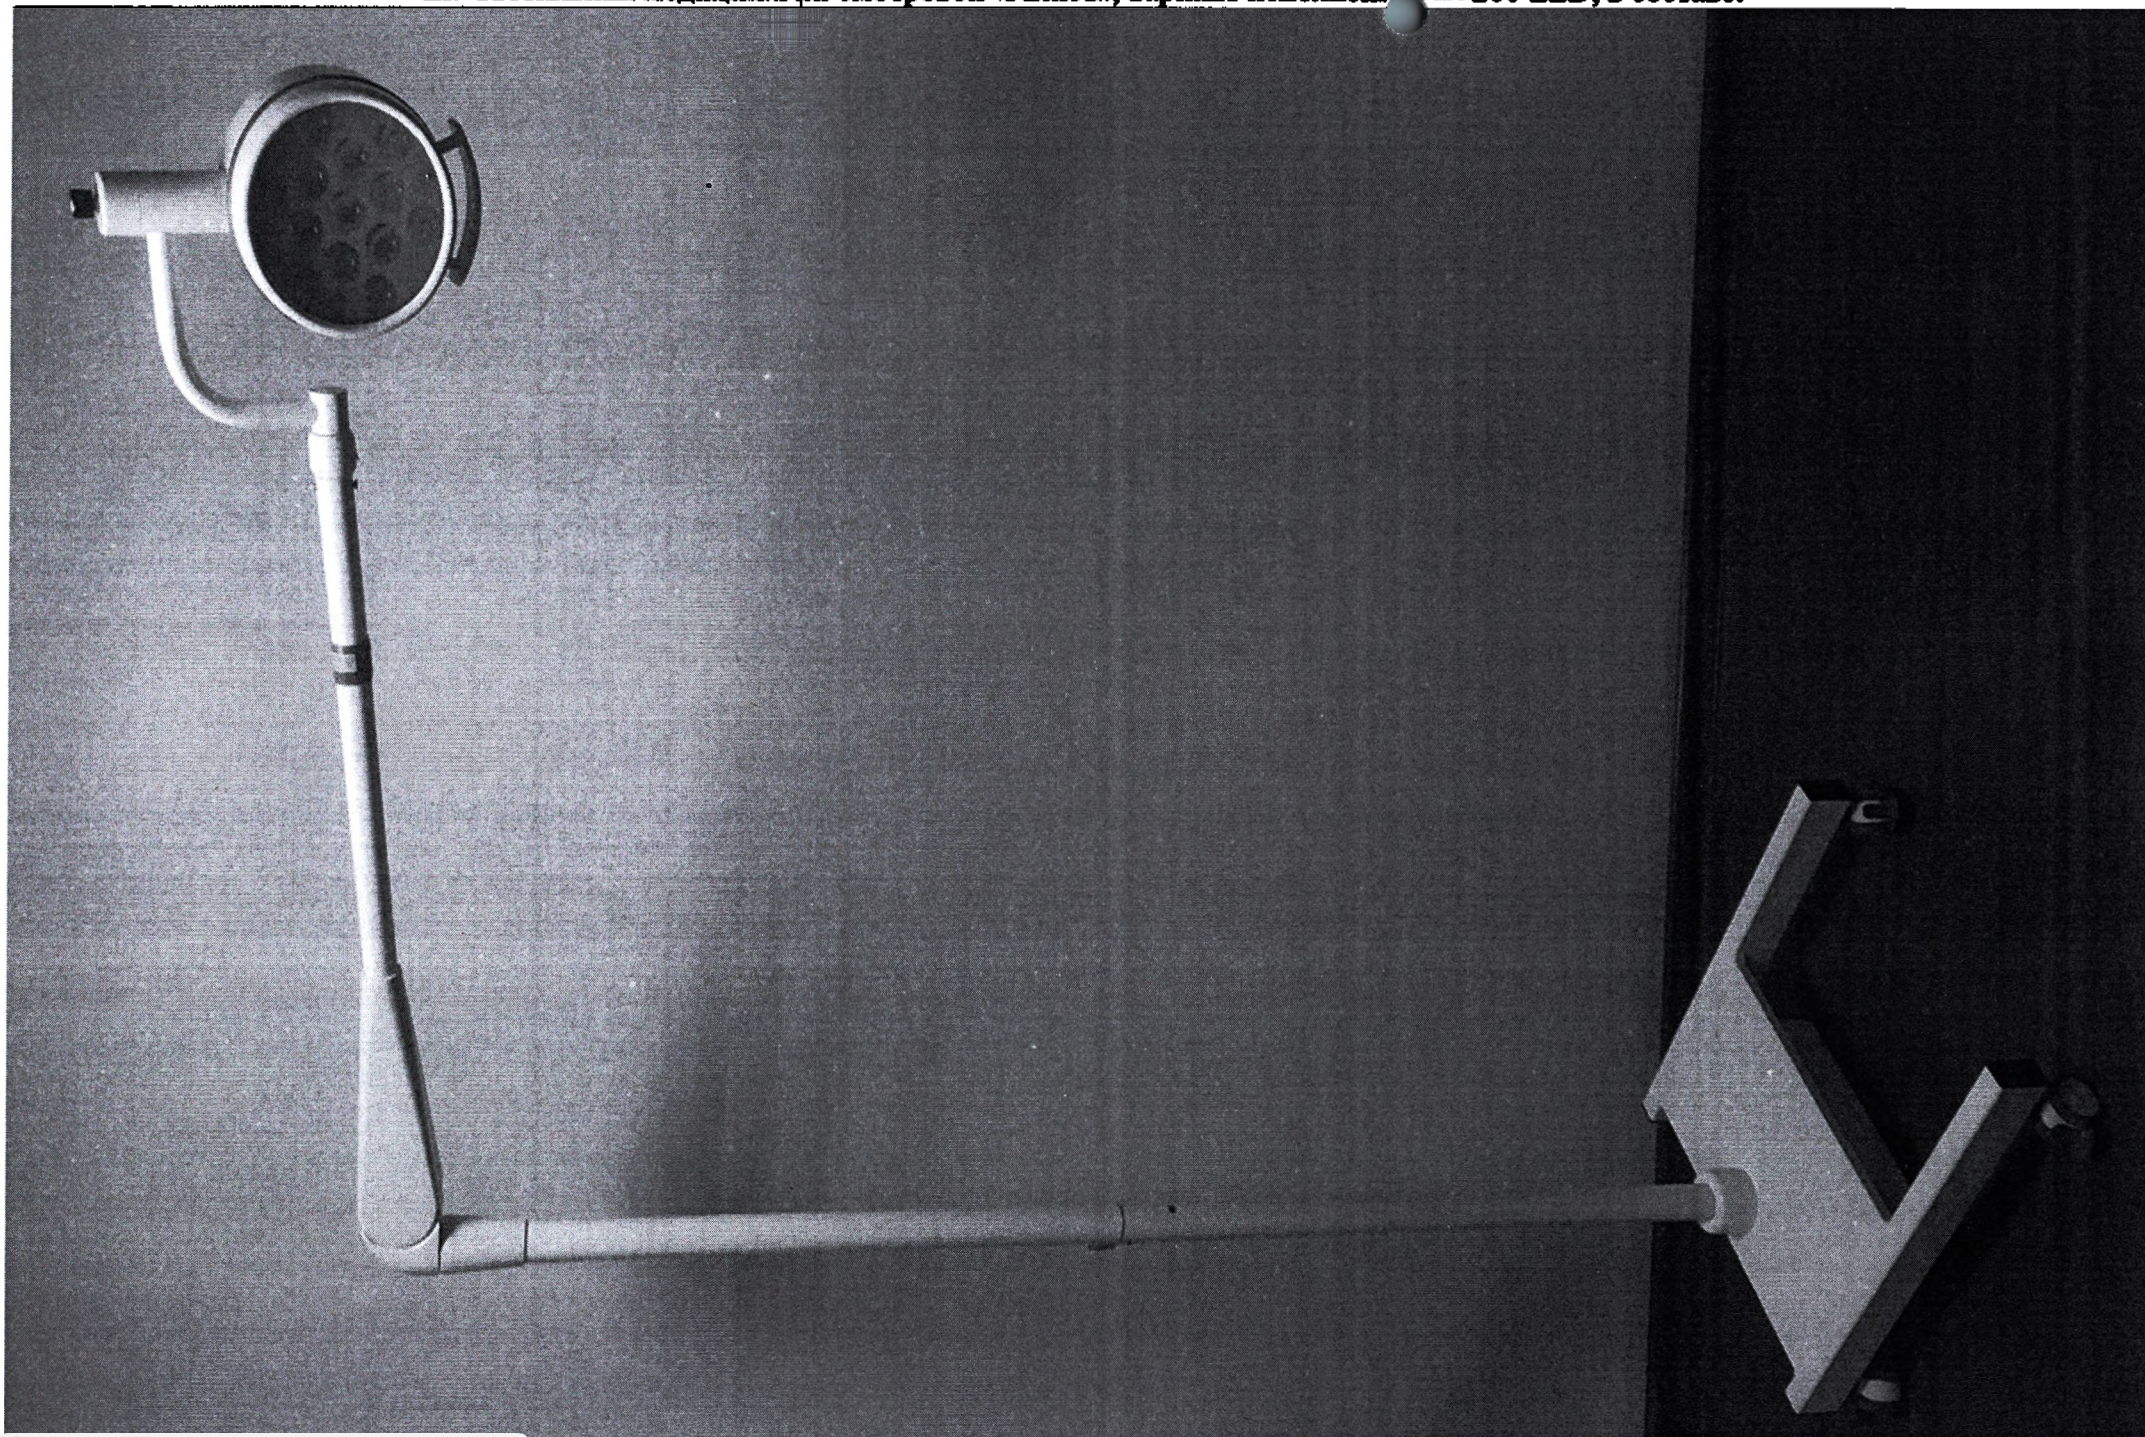
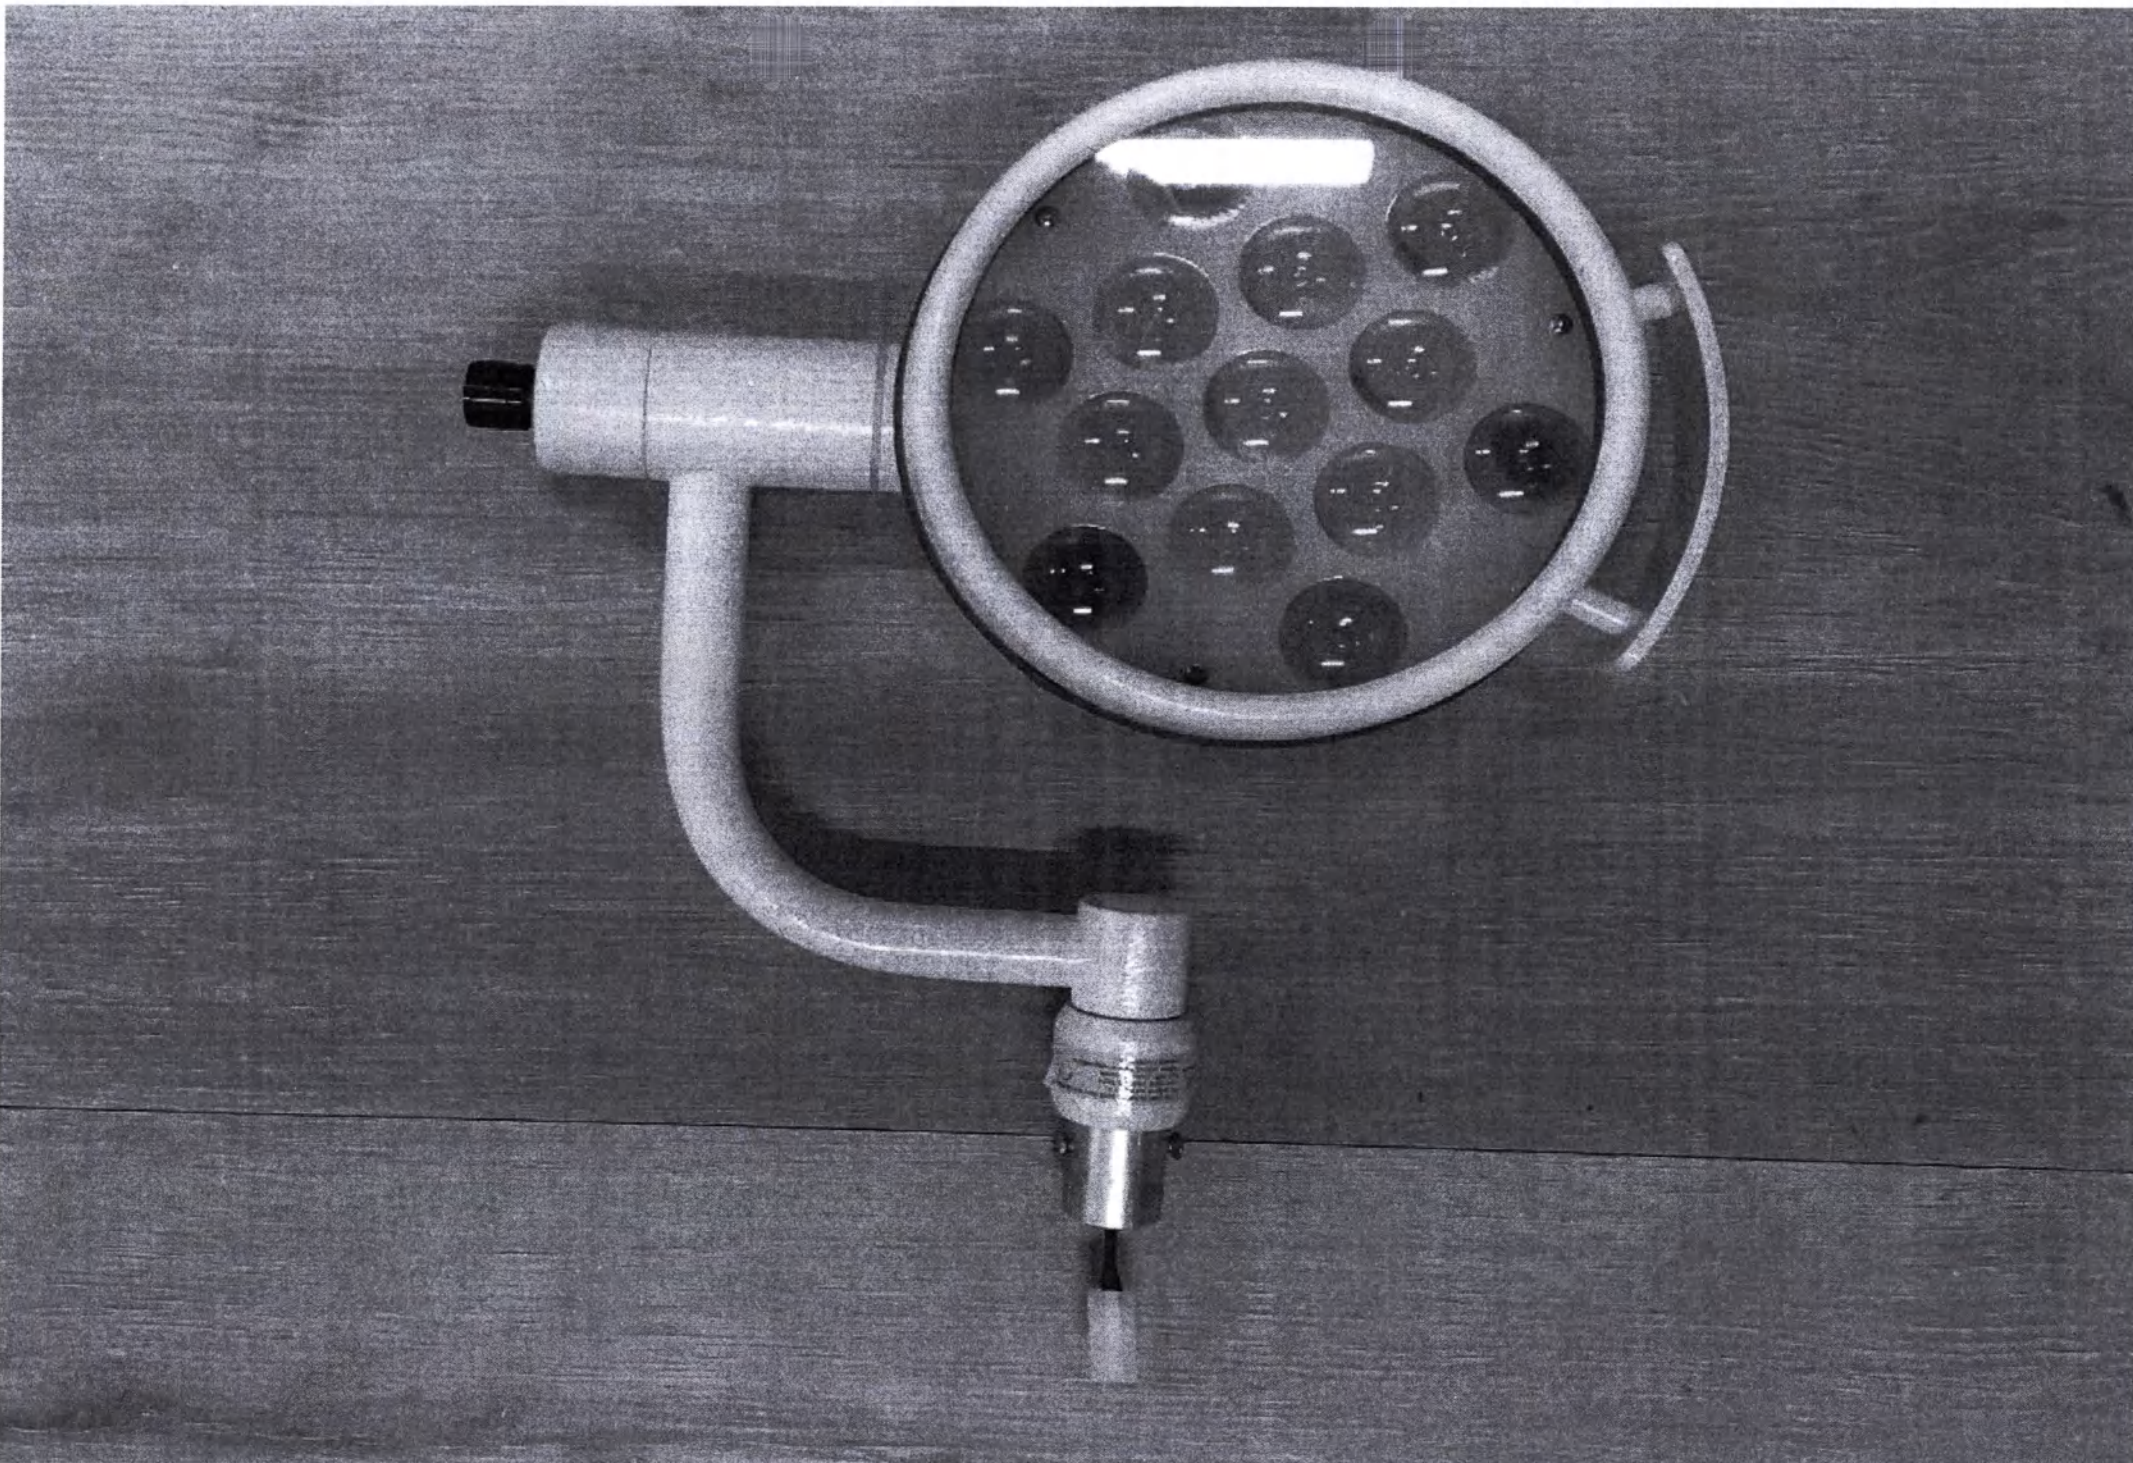
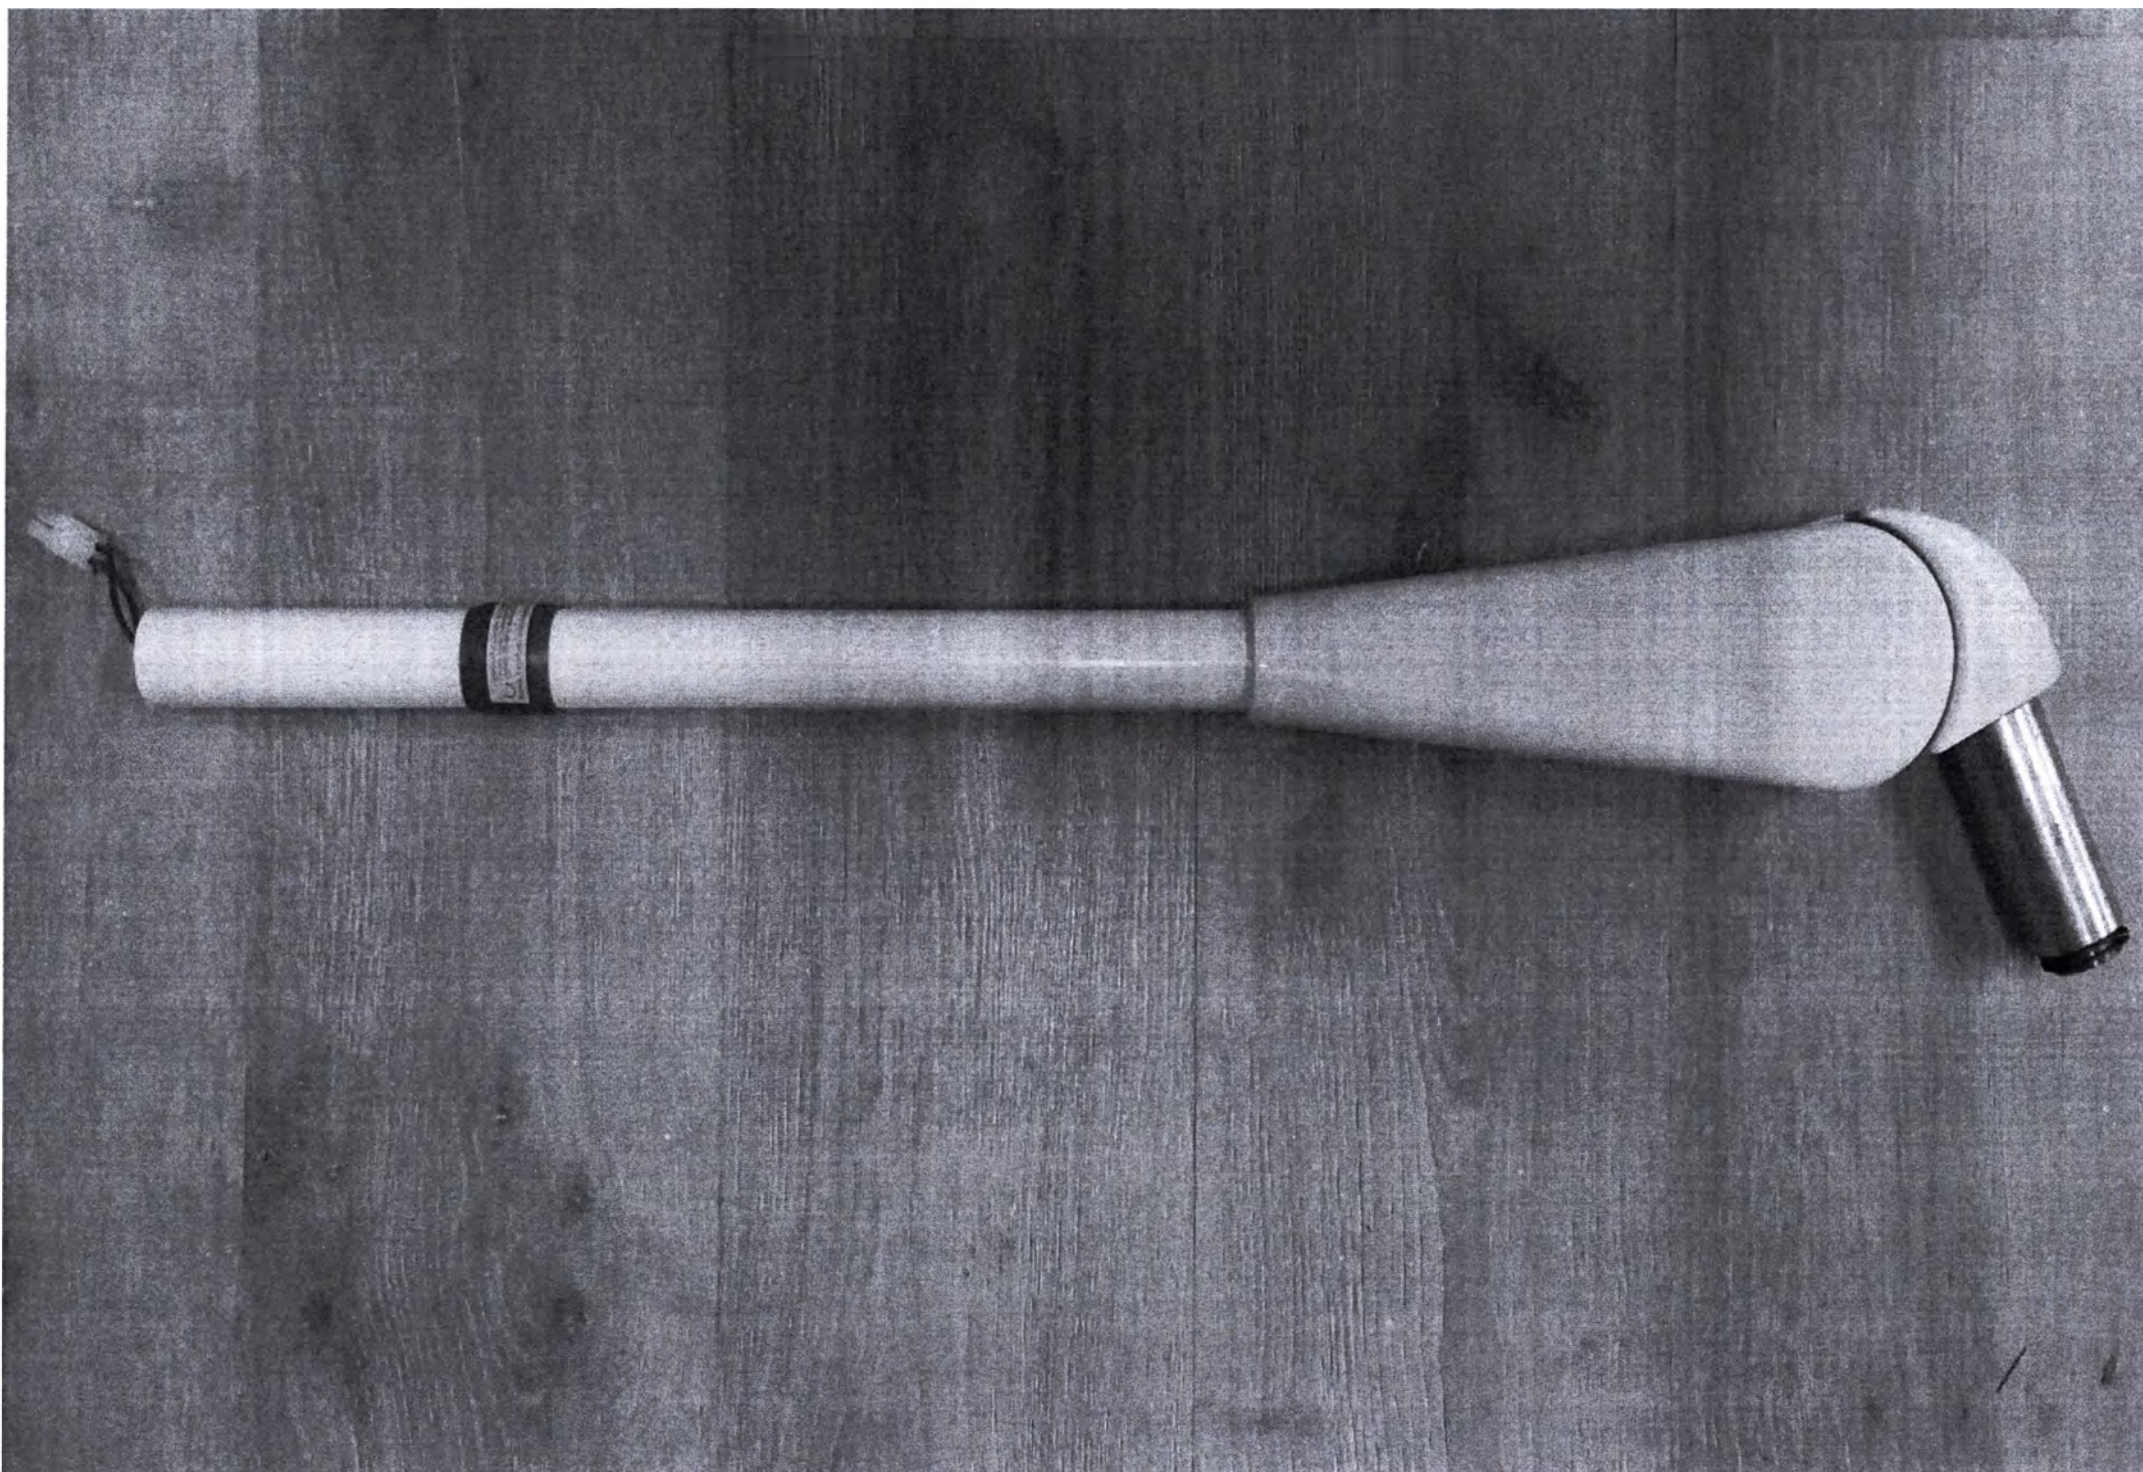



Рис. 15 – Предохранитель плавкий F1AL250V запасной (2 шт.)


III. Светильник медицинский смотровой «Armed», вариант исполнения AR 200 LED, в составе:









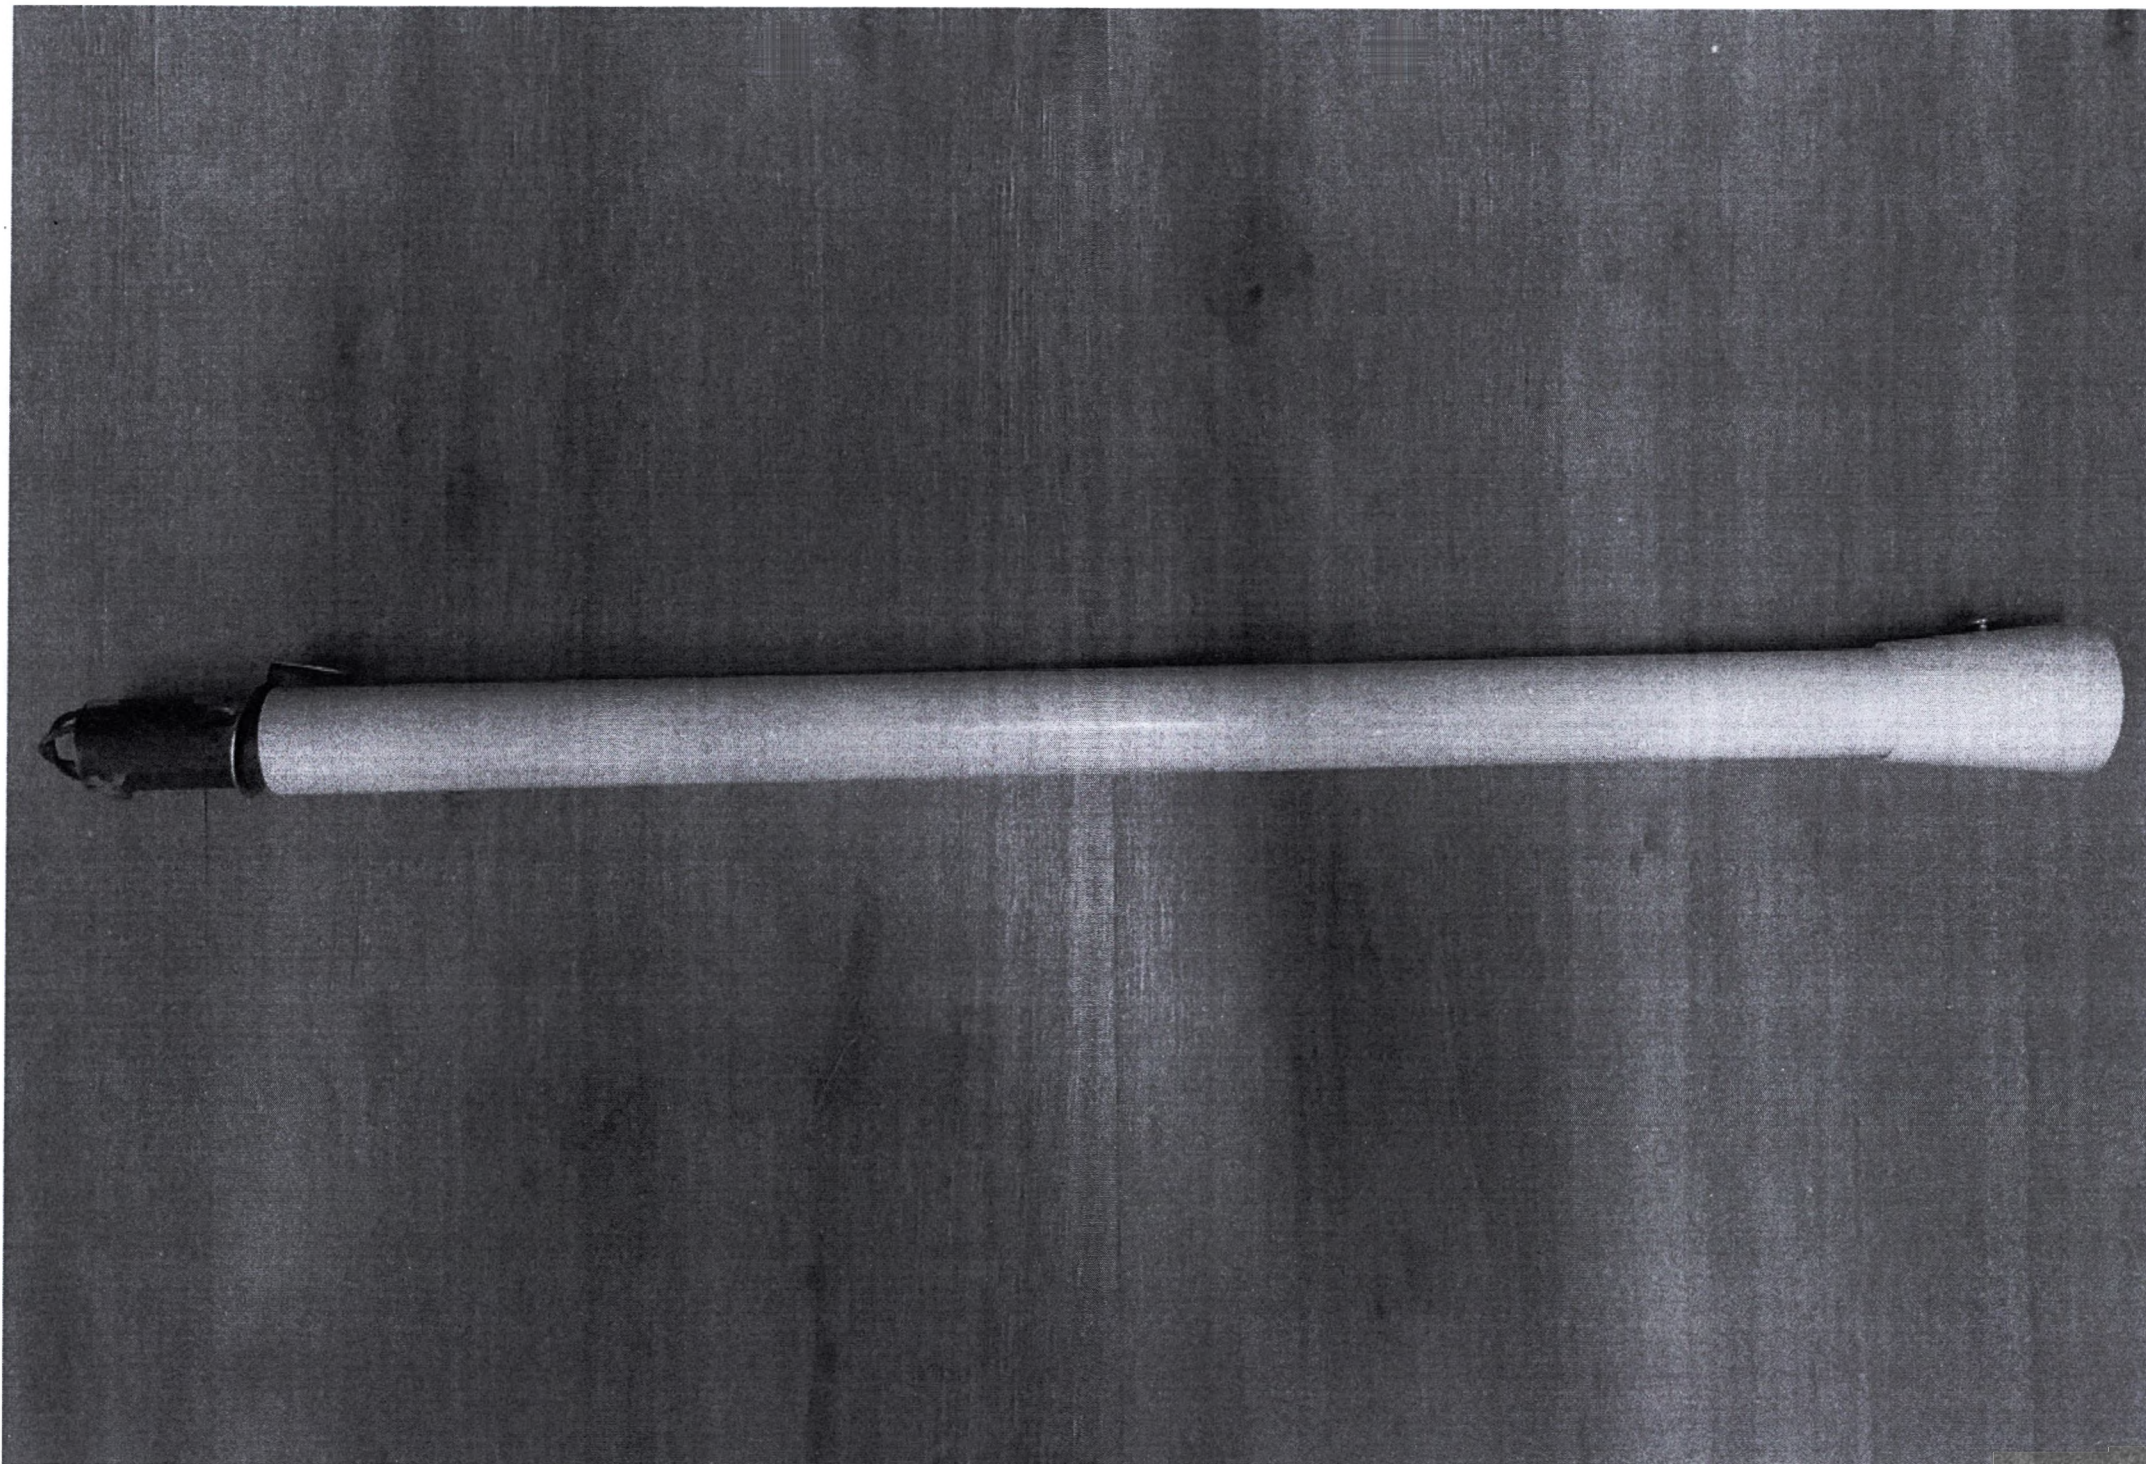

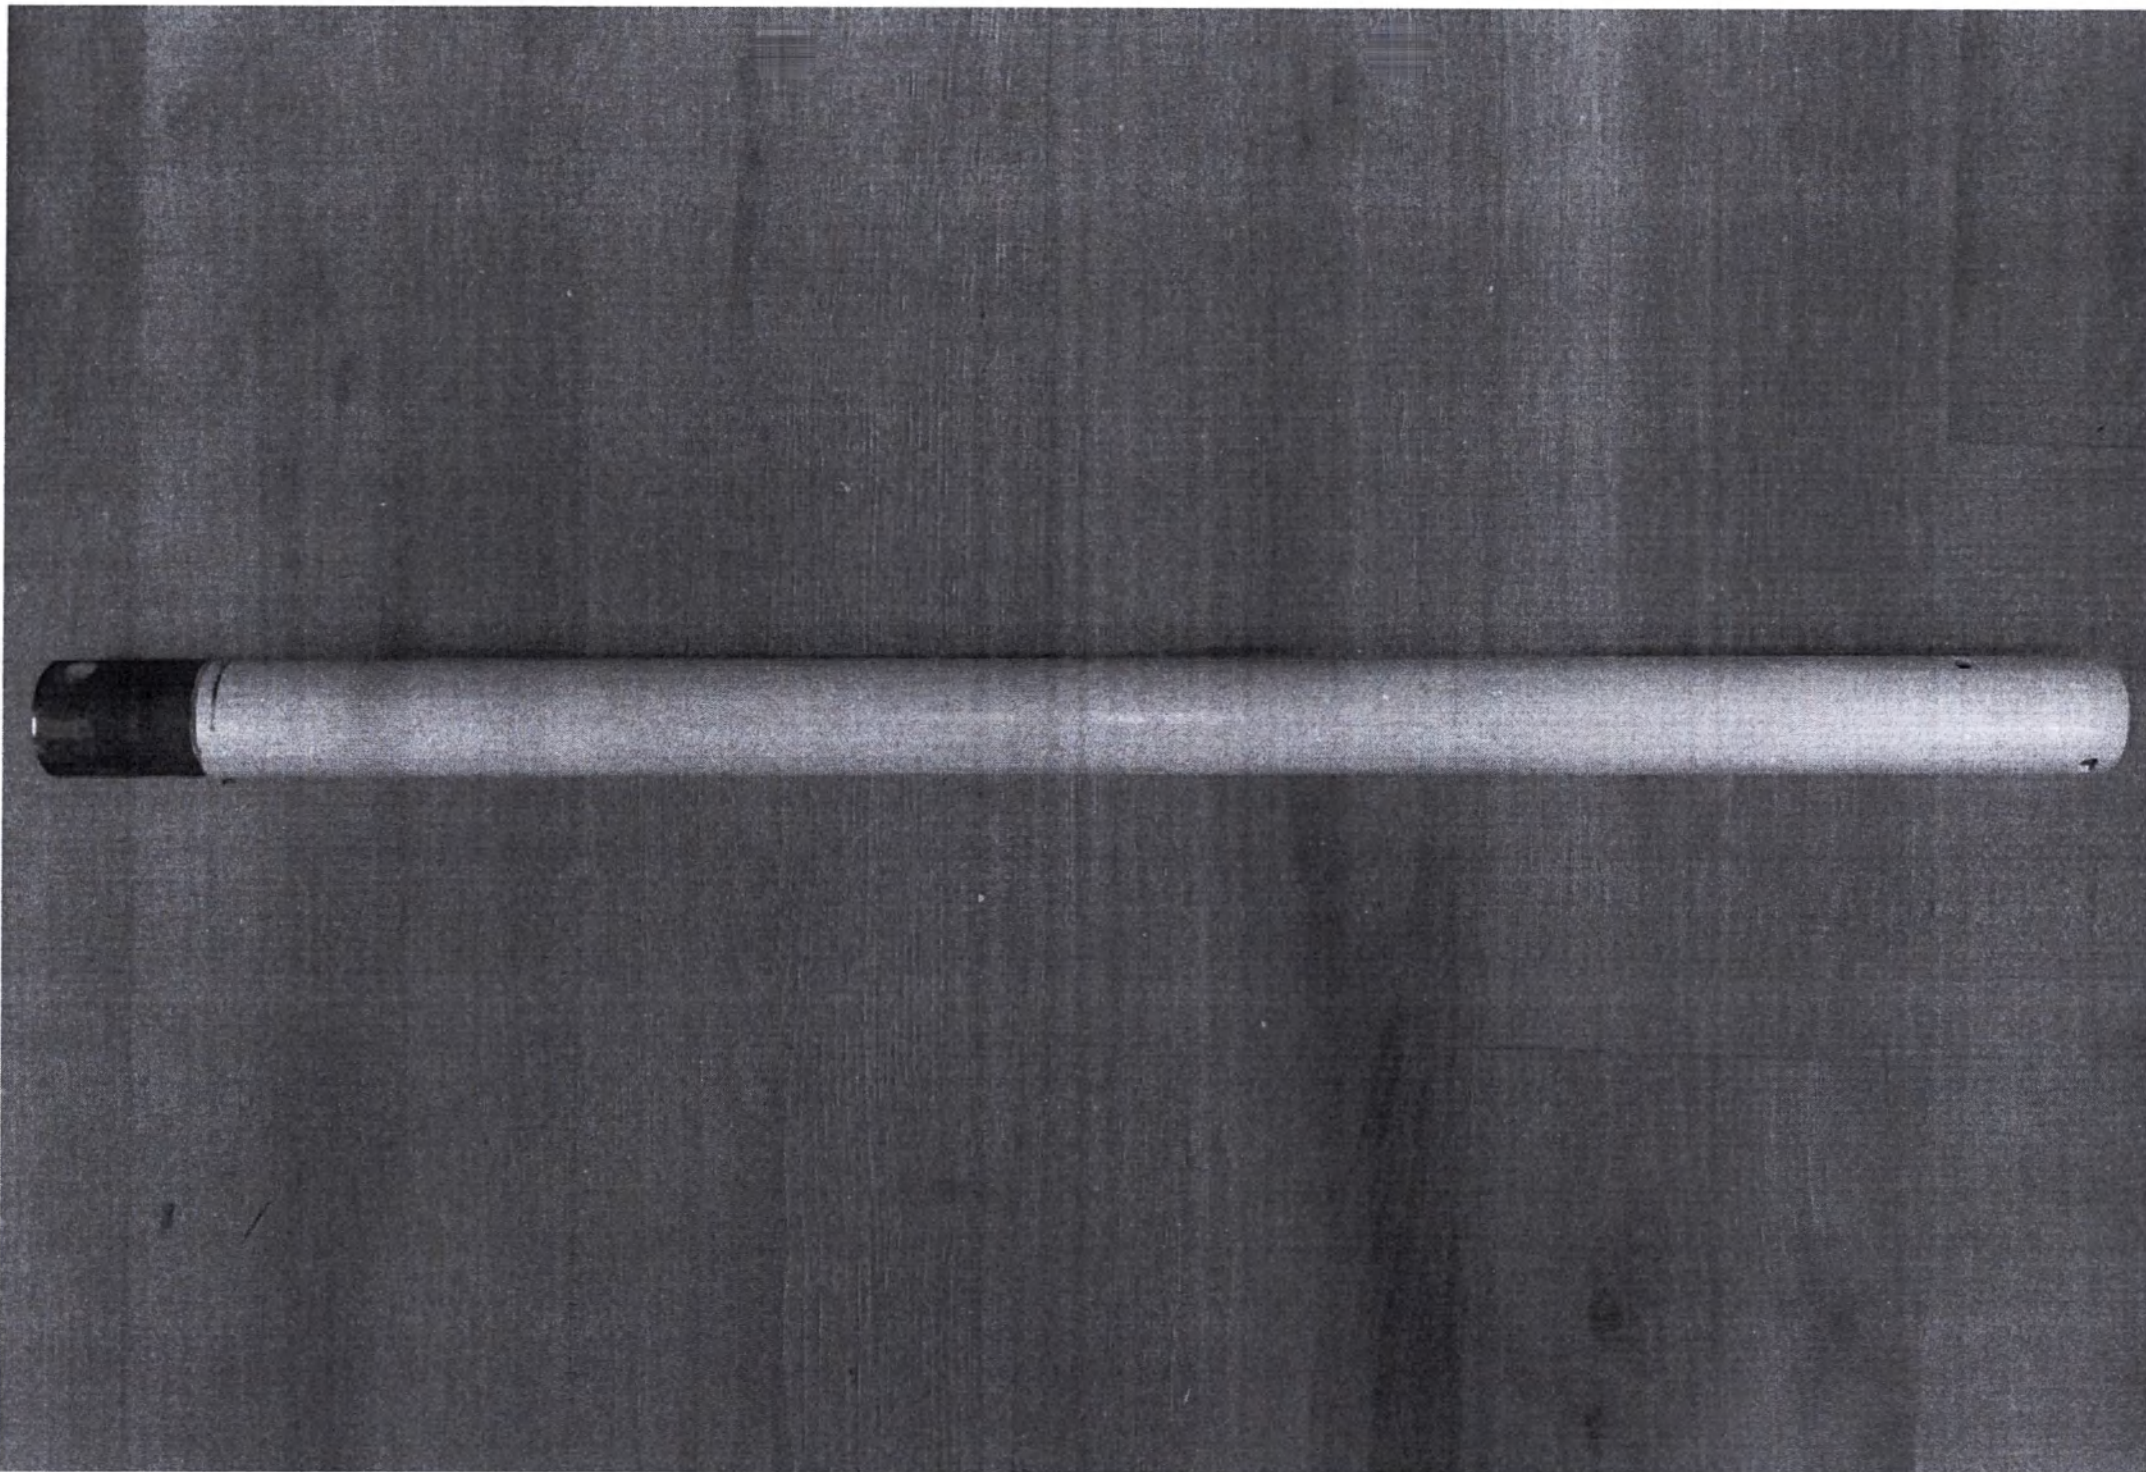

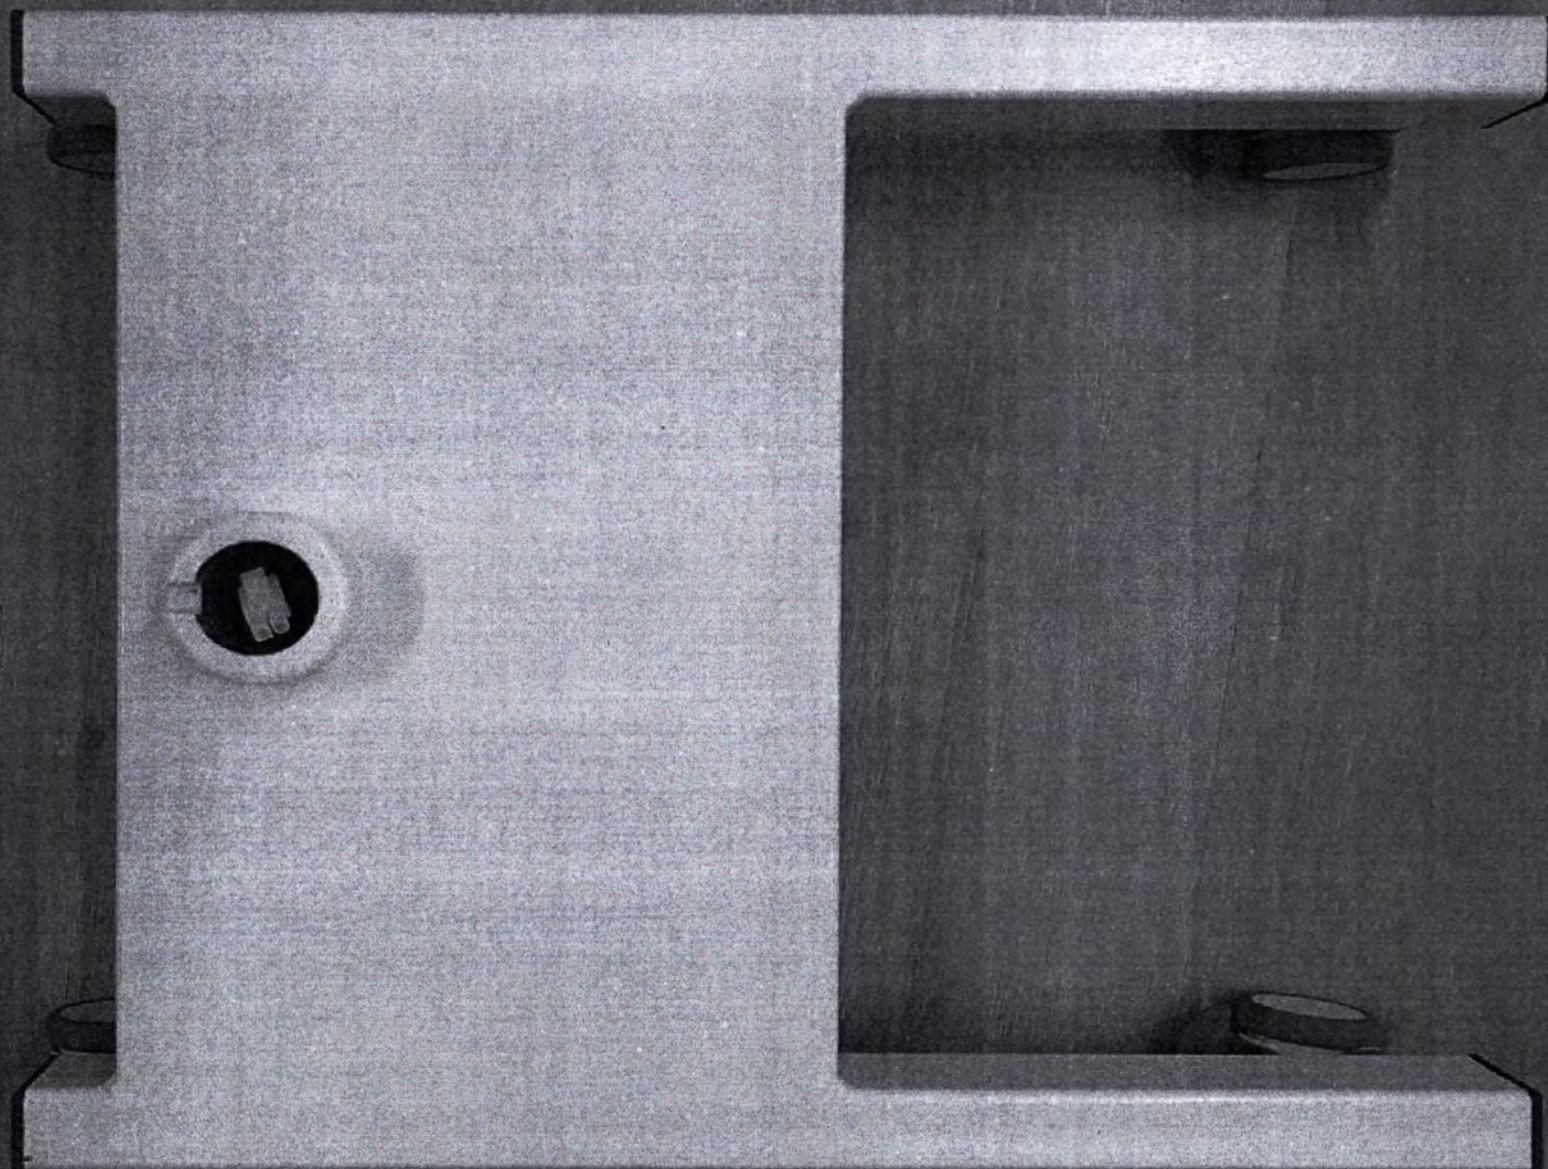

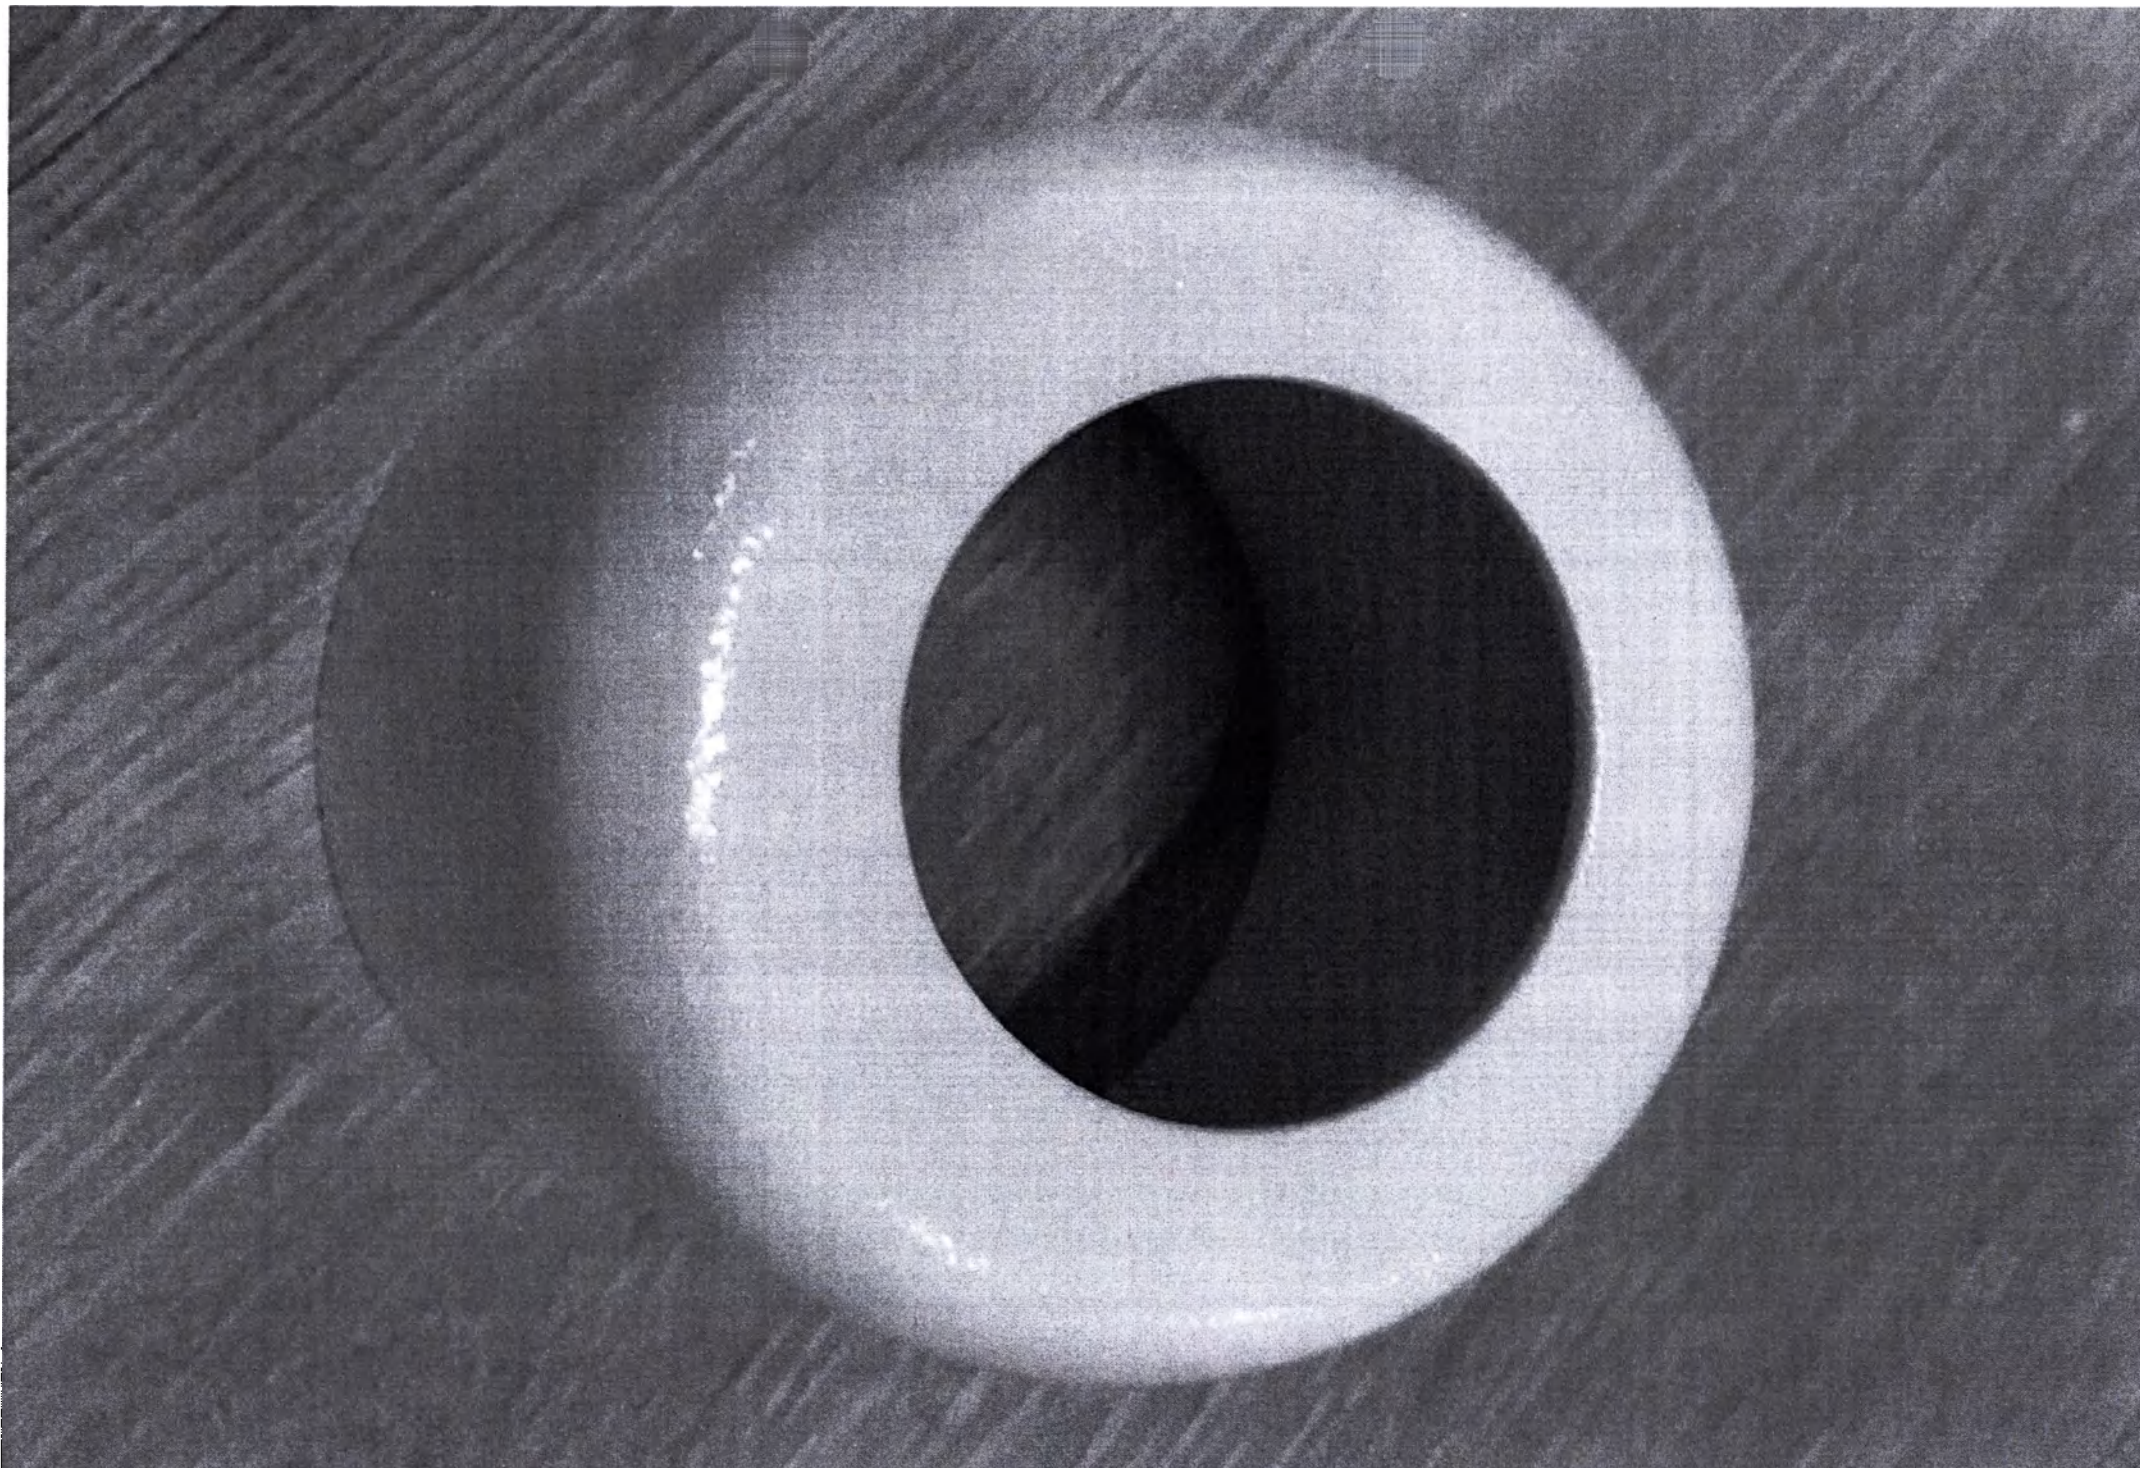

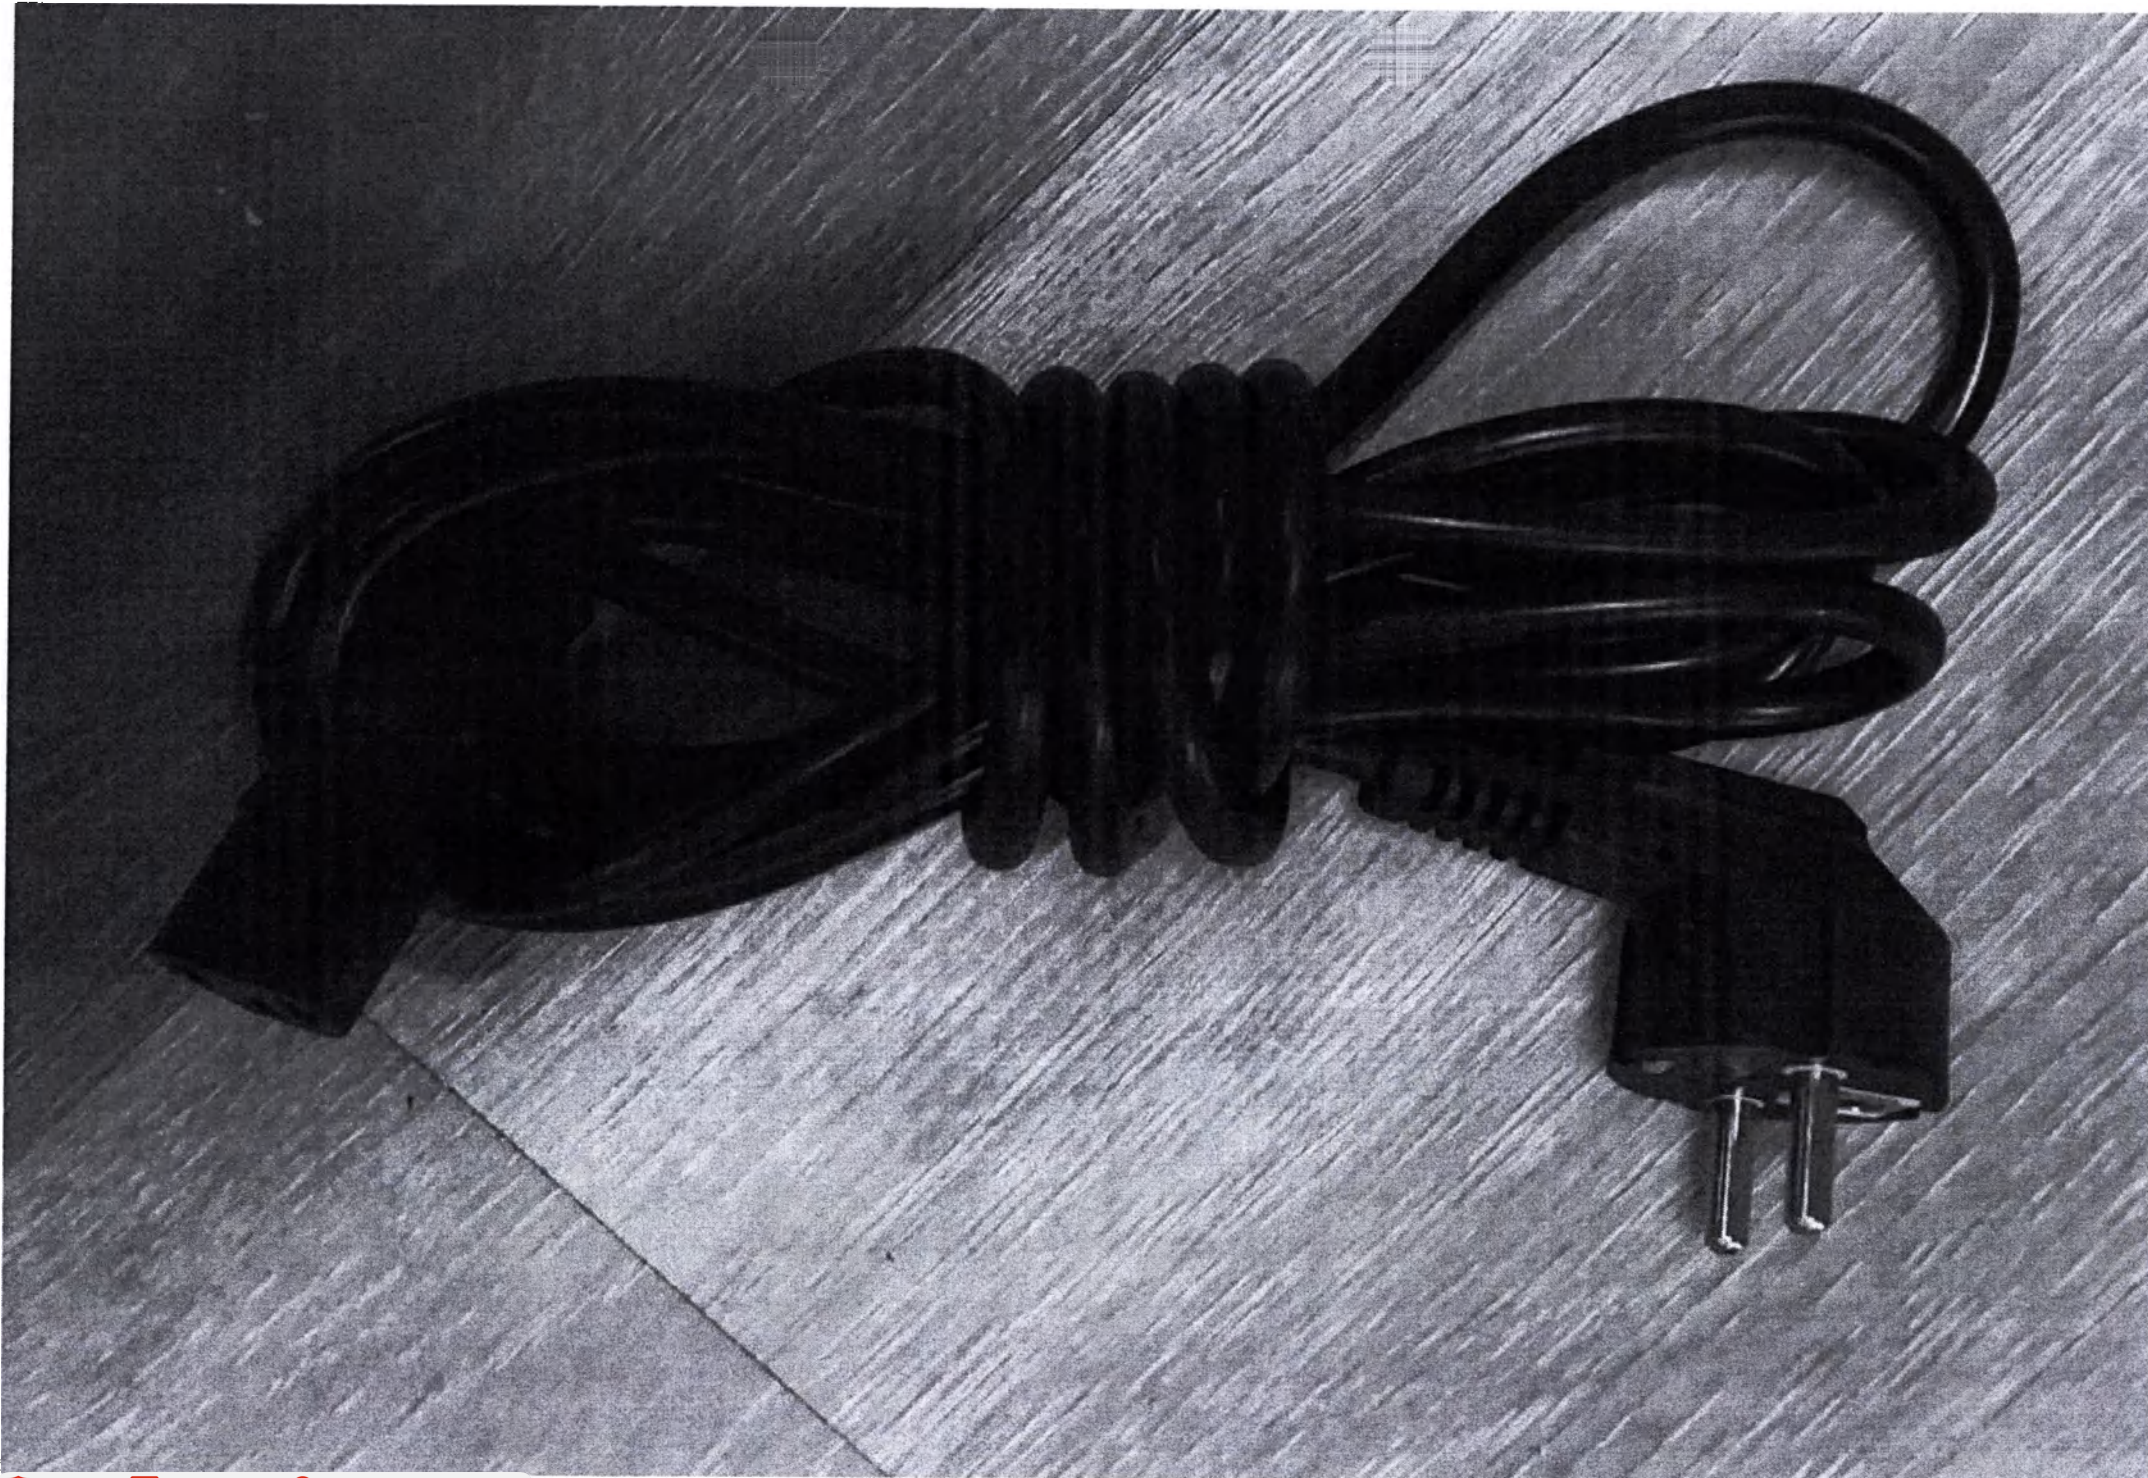


Рис. 23 – Шнур питания

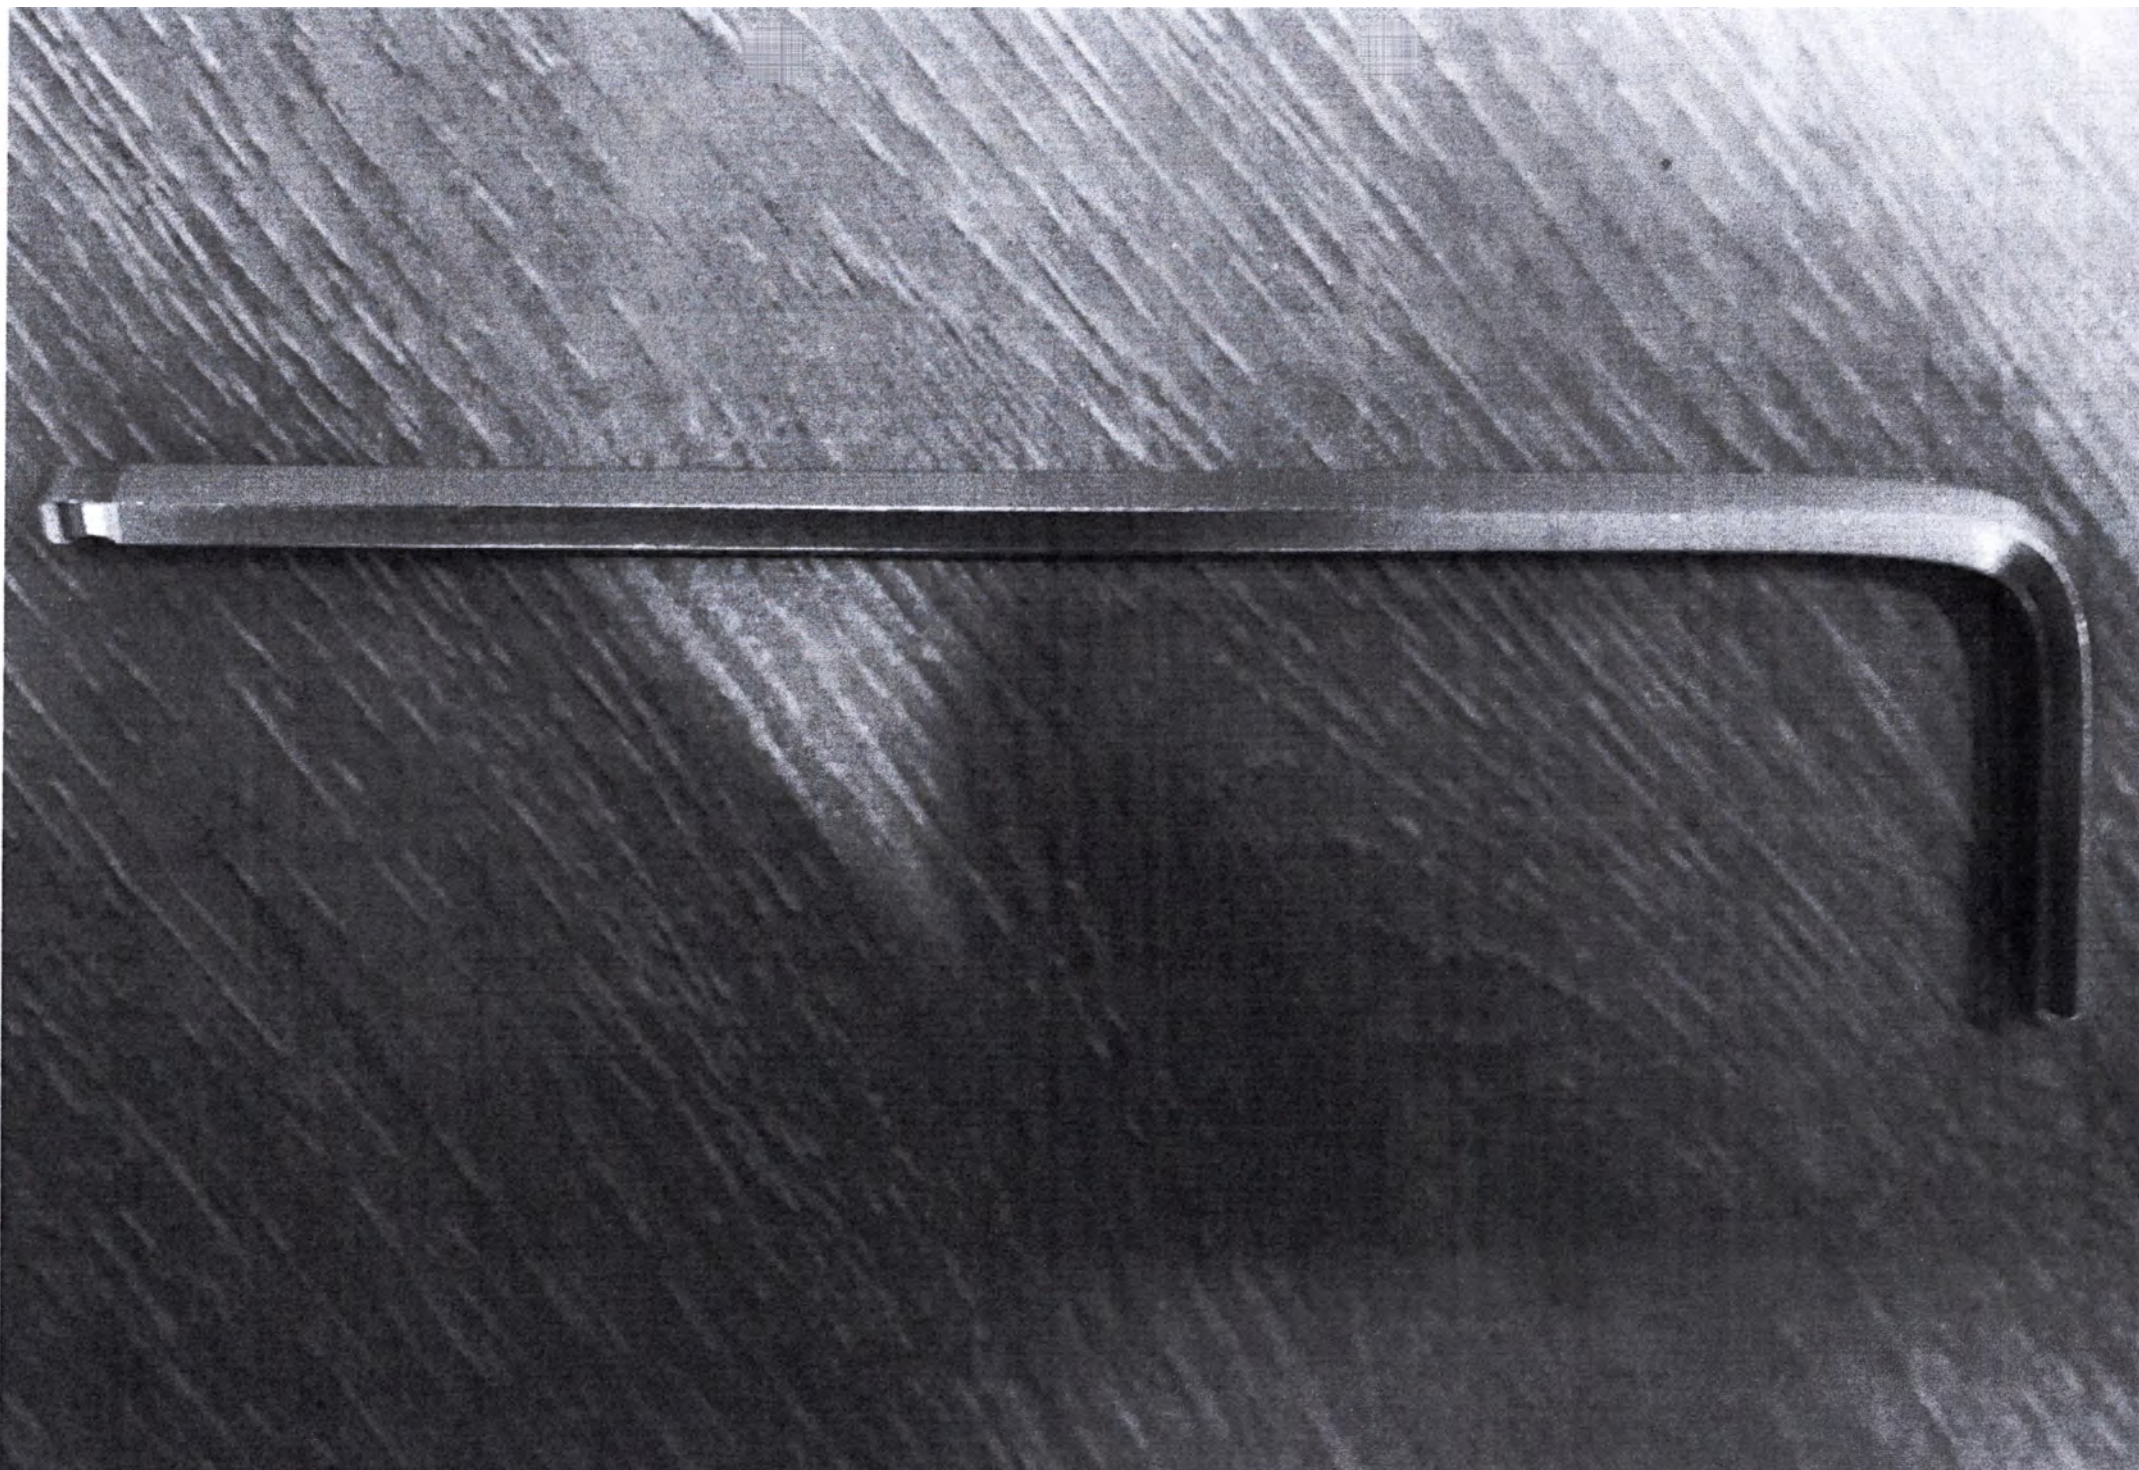


Рис. 24 – Ключ шестигранный

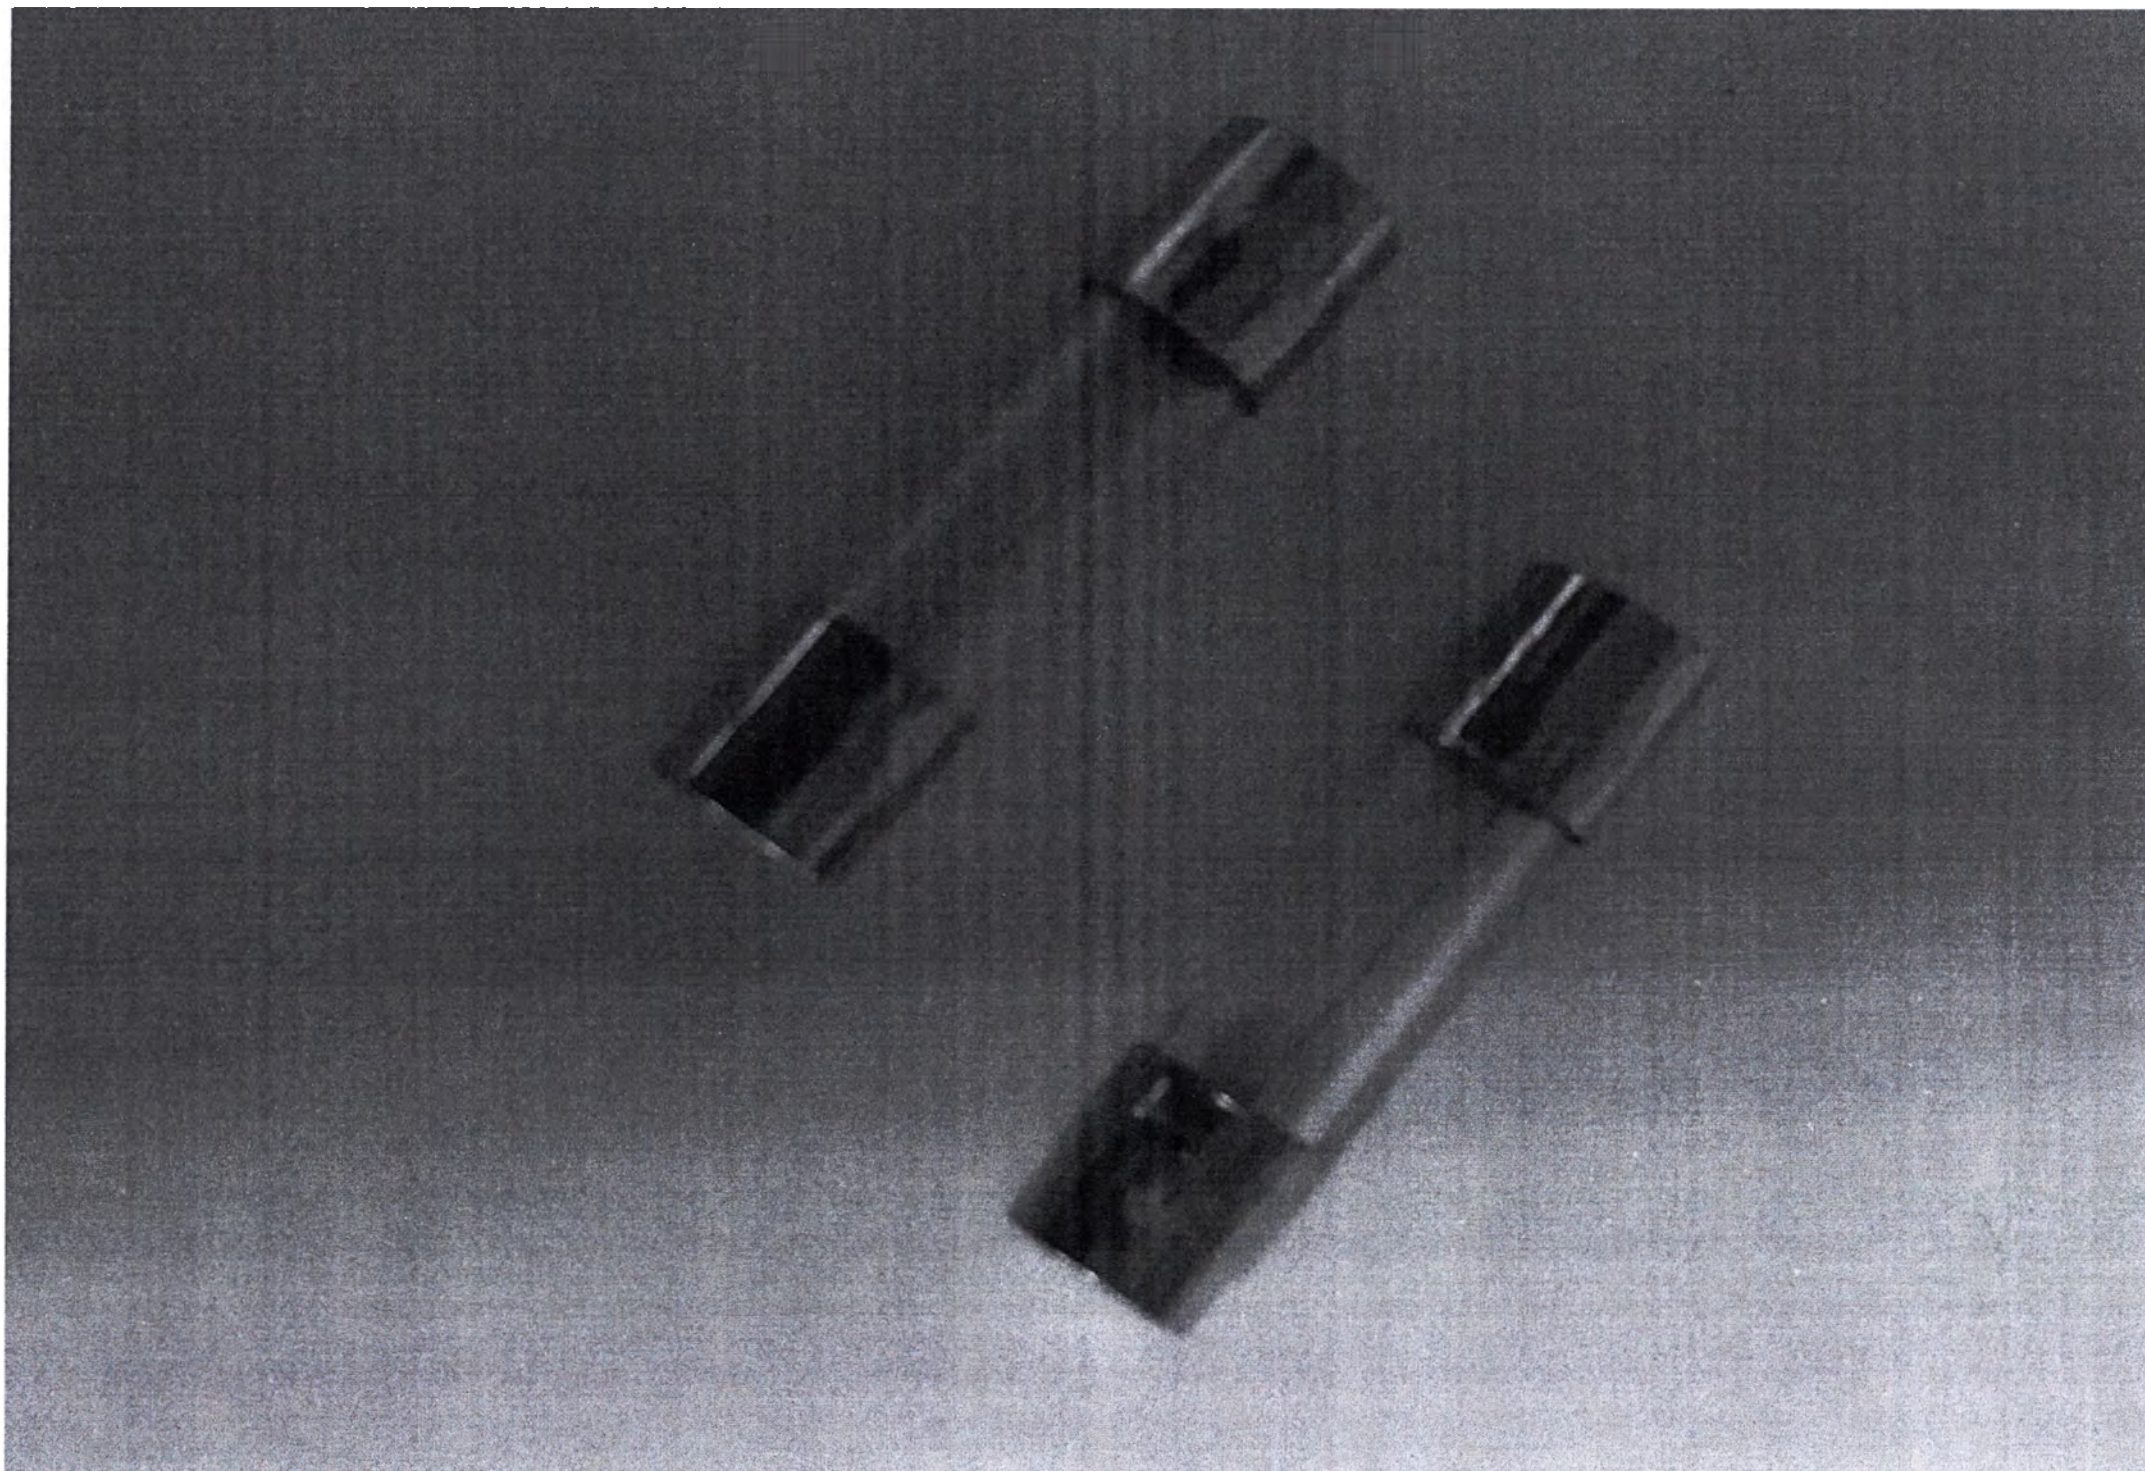


Рис. 25 – Предохранитель плавкий F1.5AL250V запасной (2 шт.)

Светильник медицинский смотровой «Armed» AR 01A LED

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Производитель: Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building No.2,
No.885, Qixing Road, Nisheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, China
(Шанхай Хуэйфэн Медикал Инструмент Ко., Лтд., корпус №2, №885, ул.
Цюсин, поселок Ничэн, новый район Пудун, 201306 Шанхай, Китай)

Импортер: ООО «ОПОРА», 630501, Новосибирская область, Новосибирский
район, р.п. Краснообск, ул. Северная, зд. 5, пом. 1.

Потребляемая мощность: 39 ВА ($\pm 10\%$)

Напряжение сети: 220 В ($\pm 10\%$)

Частота тока: 50 Гц ($\pm 2\%$)

Масса: 4,8 кг ($\pm 5\%$)

Серийный номер:

Дата выпуска:



СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СМОТРОВОЙ «ARMED» AR 01A LED

Произведено: Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building No.2, No.885, Qiuxing Road, Nicheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, China (Шанхай Хуэйфэн Медикал Инструмент Ко., Лтд., корпус №2, №885, ул. Цюсин, поселок Ничэн, новый район Пудун, 201306 Шанхай, Китай)
Импортёр: ООО «ОПОРА», 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, зд. 5, пом. 1
РУ № _____ **от** _____ **г.**

Перед применением внимательно изучите Руководство по эксплуатации!

Назначение: предназначен для освещения рабочего поля при проведении диагностических исследований, перевязок и осмотров пациента.

Сфера применения: лечебно-профилактические учреждения.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы: 10 лет.


Дата упаковывания:



www.armed.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1 нс. 27 – Макет маркировки потребительской упаковки на примере исполнения AR 01A LED

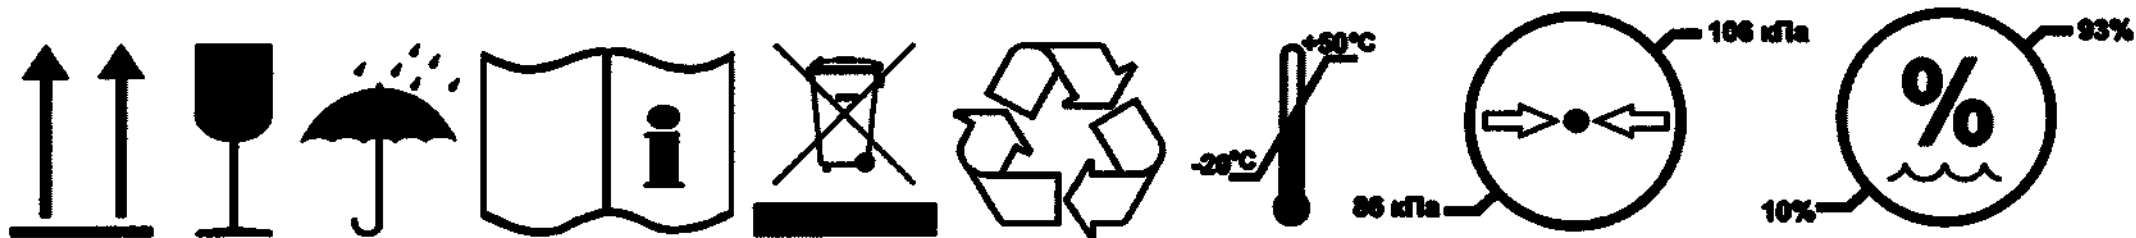

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью *29*
звучать
судить) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО "ОПОРА"
ЖУКОВ Р. С.

