

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»




Перцева Н. Н.

«14» ноября 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека (TSH CLIA Microparticles (TSH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo


Фотография общего вида медицинского изделия фасовка 50*2 тестов.

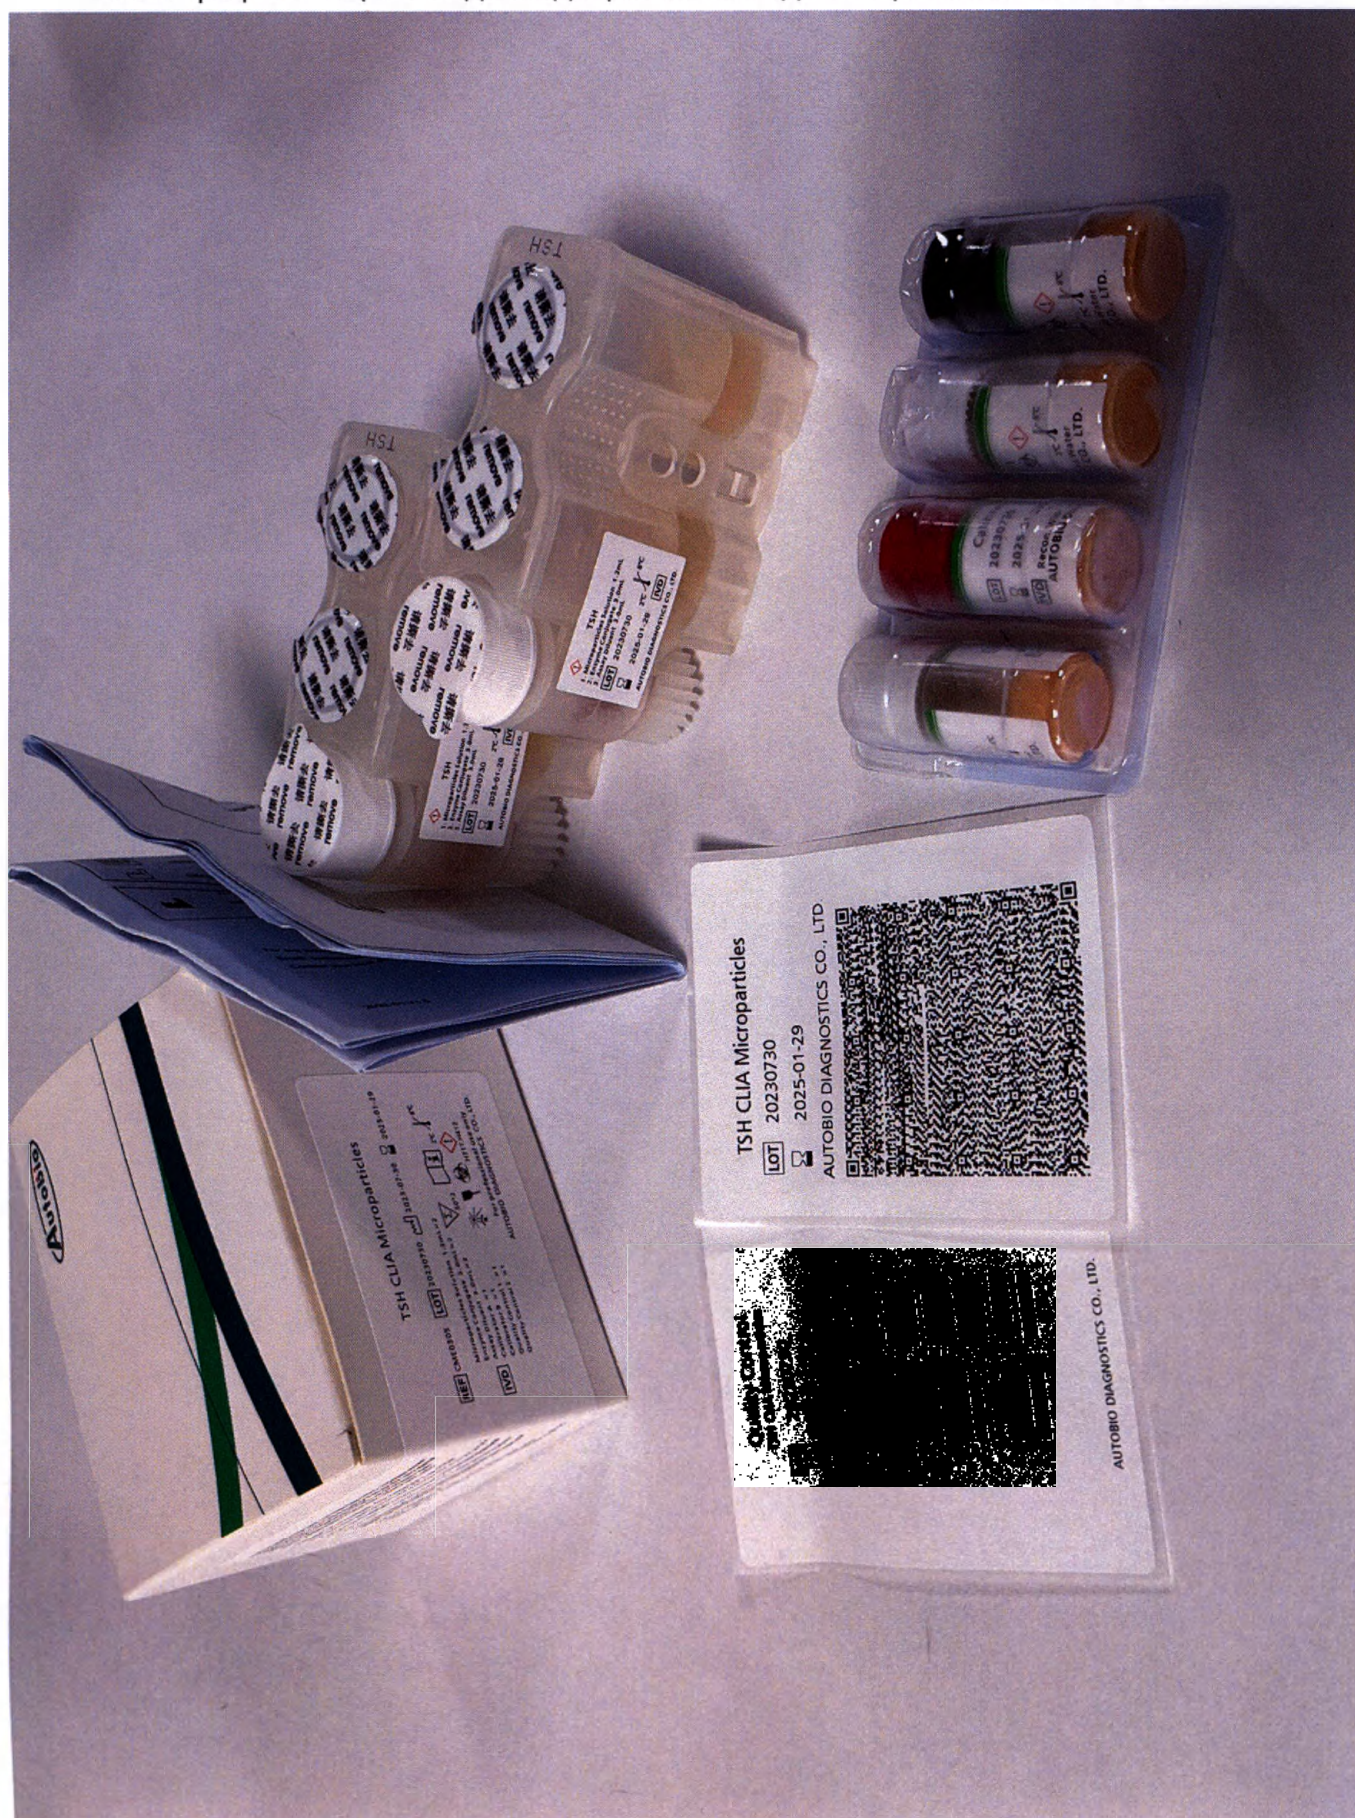

Фотография упаковки медицинского изделия фасовка 50*2 тестов.




Фотография общего вида медицинского изделия фасовка 100 тестов.

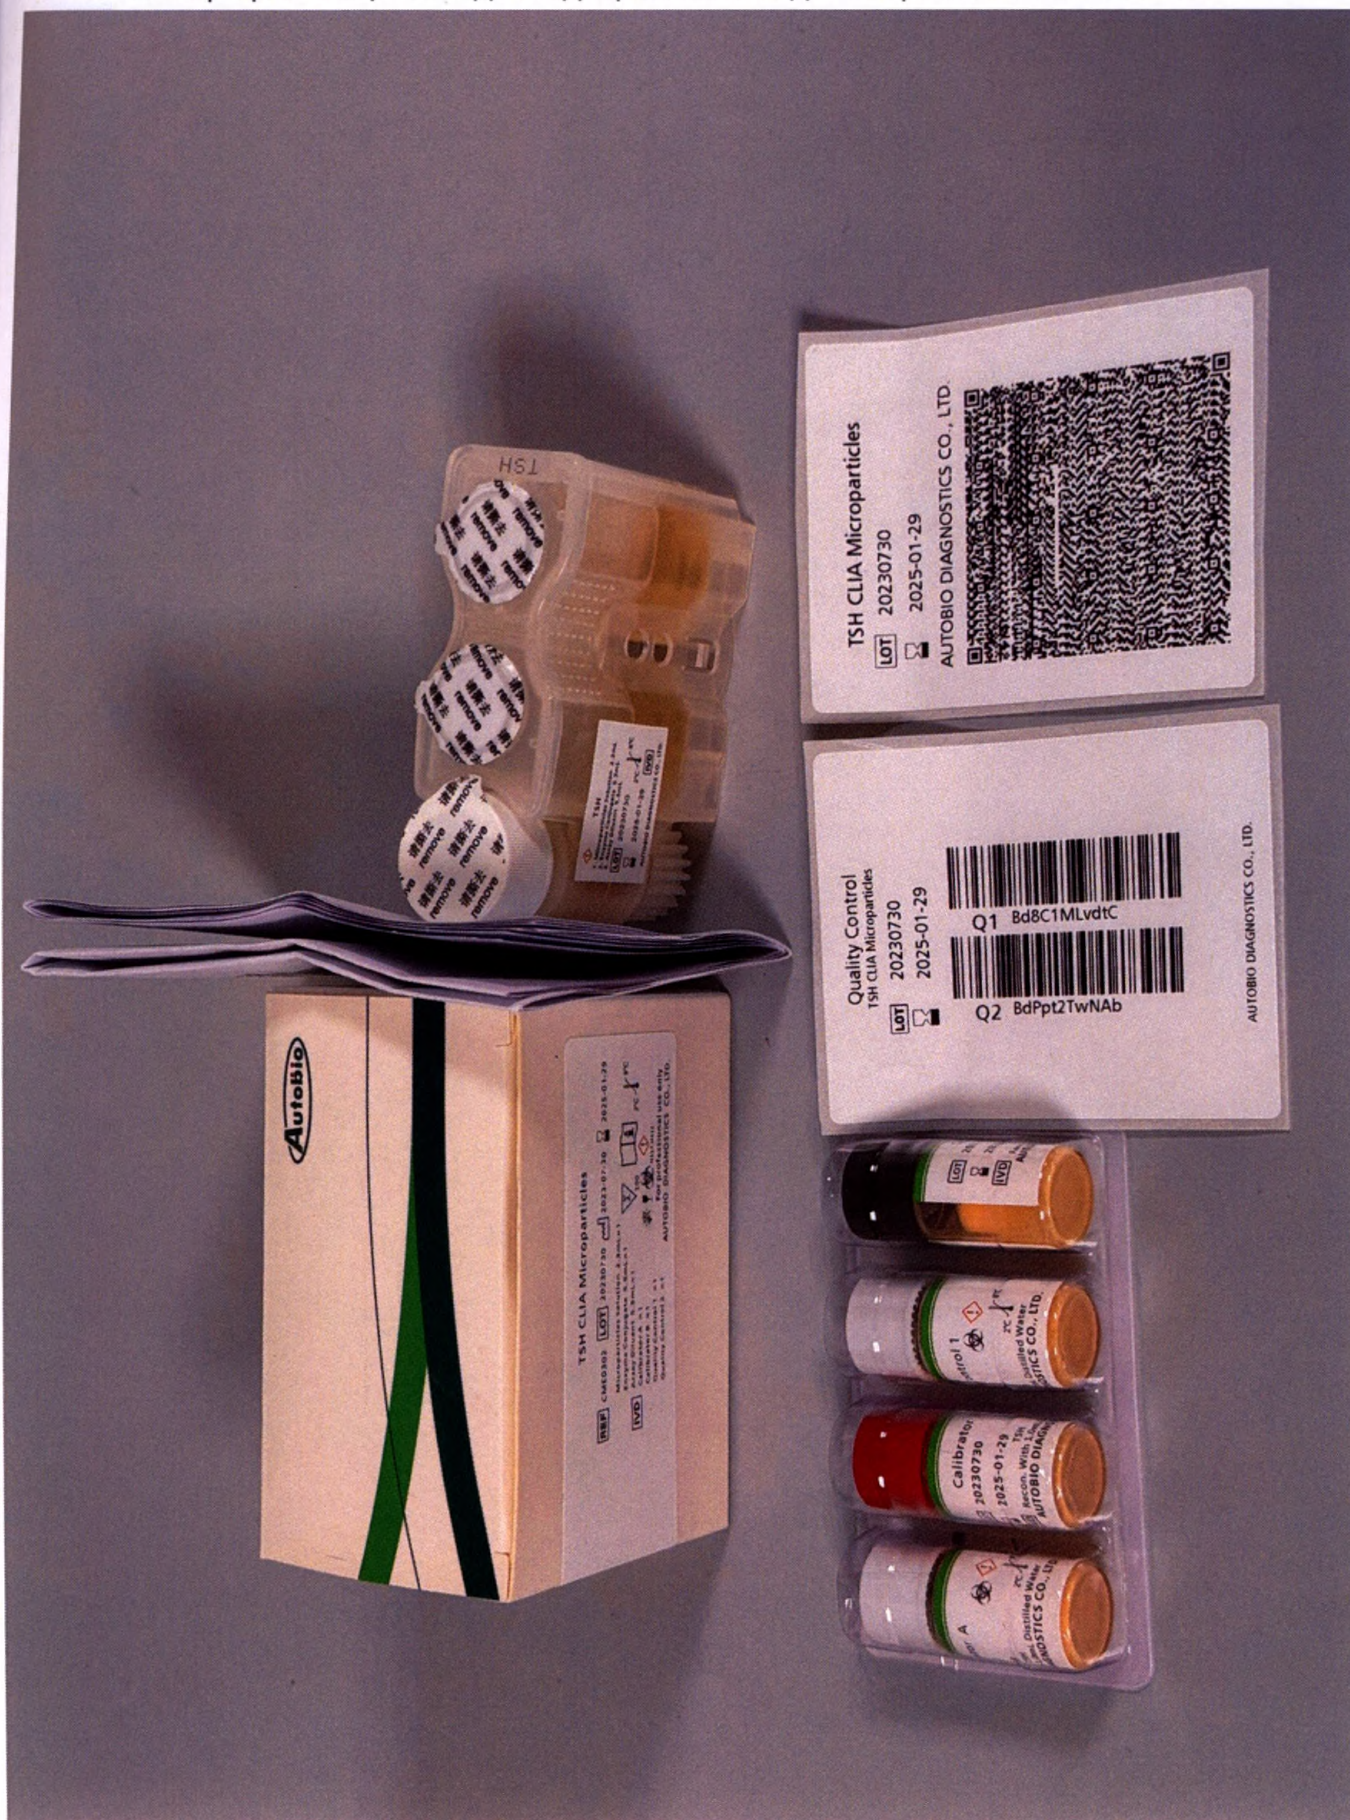

Фотография упаковки медицинского изделия фасовка 100 тестов.



Фотография общего вида медицинского изделия фасовка 100*2 тестов

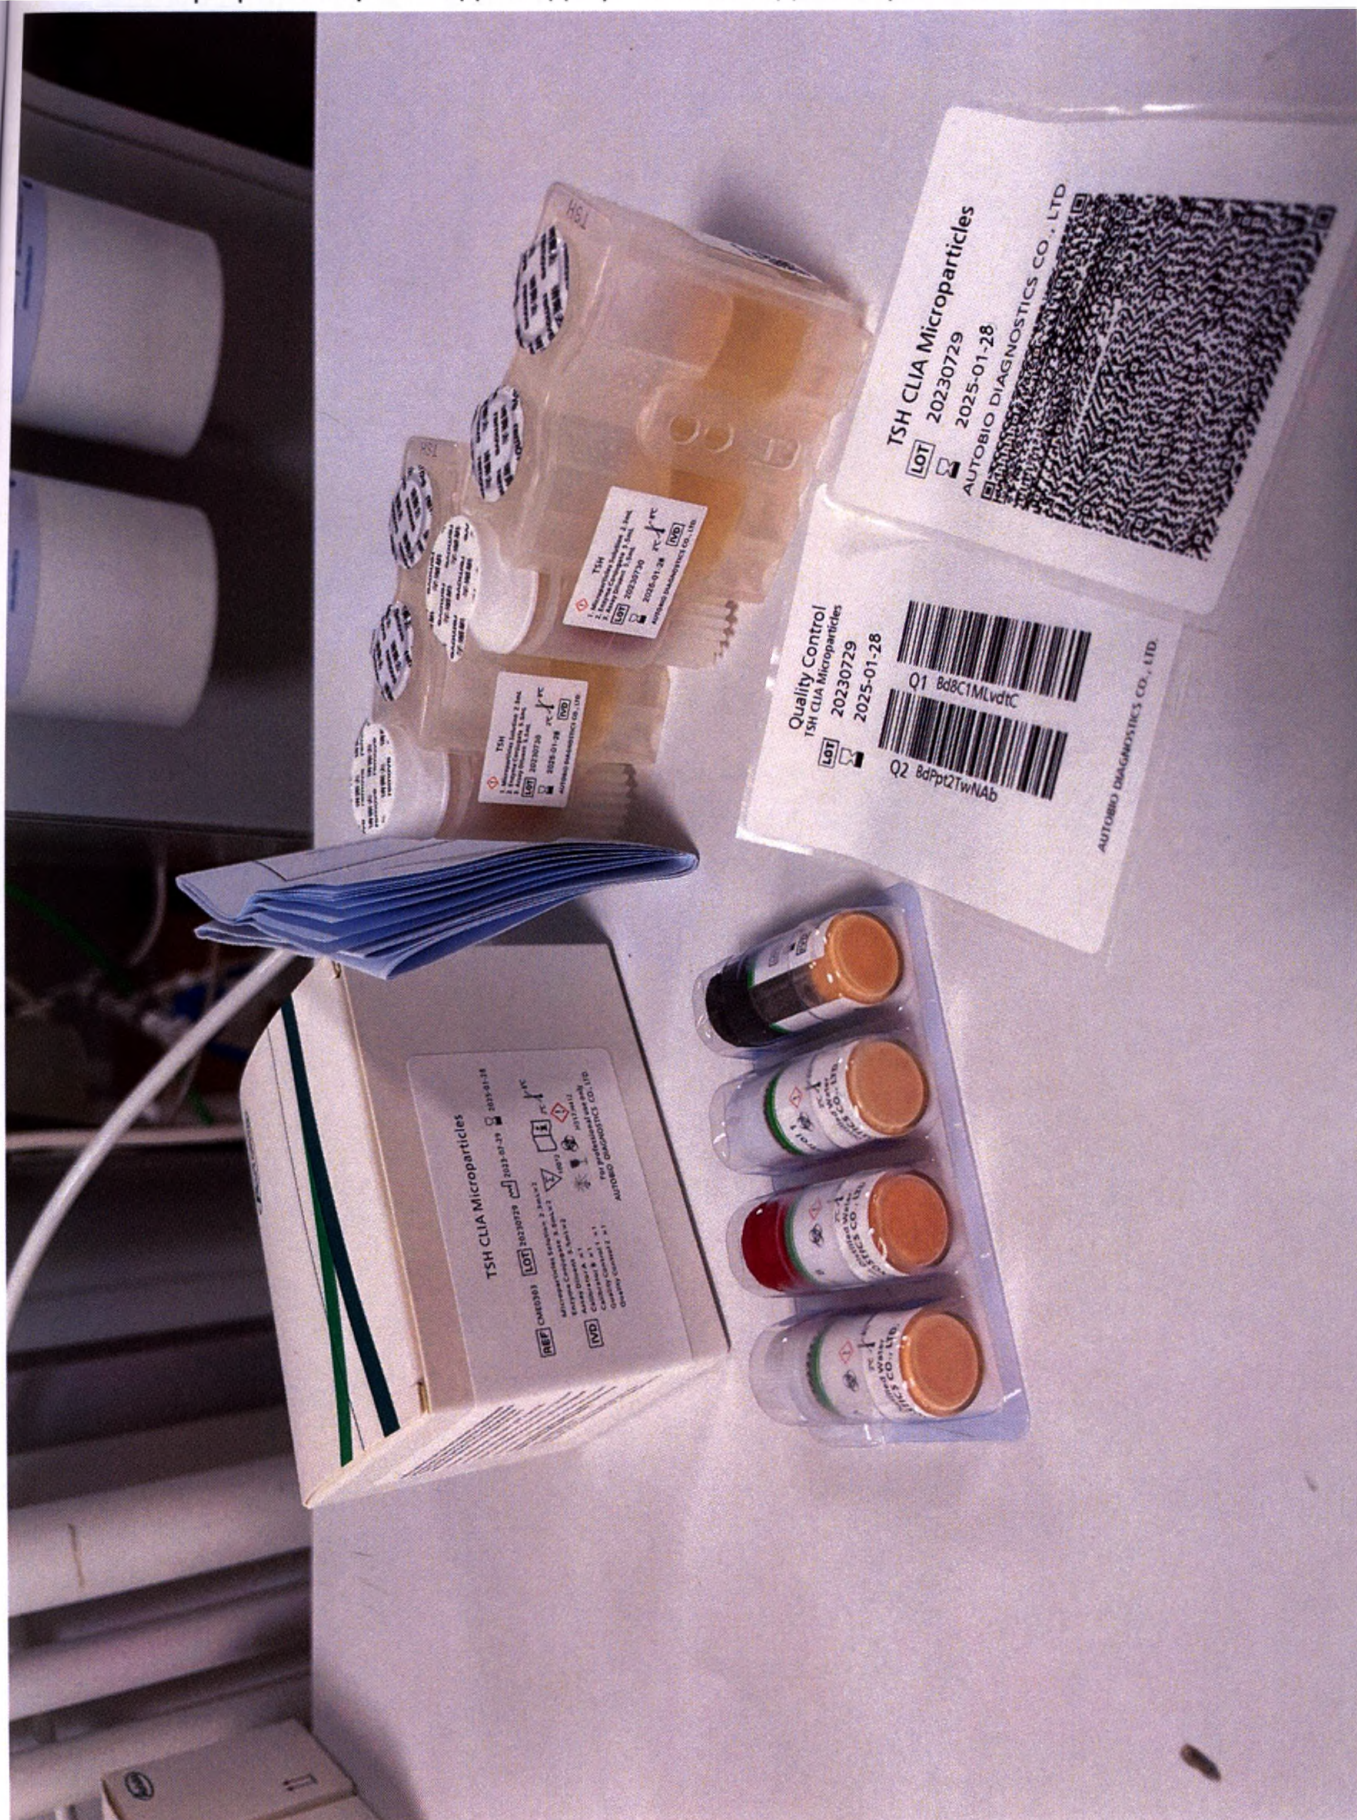

Фотография общего вида медицинского изделия фасовка 100*2 тестов.




Фотография общего вида медицинского изделия фасовка 100*5 тестов





Фотография общего вида медицинского изделия фасовка 100*5 тестов







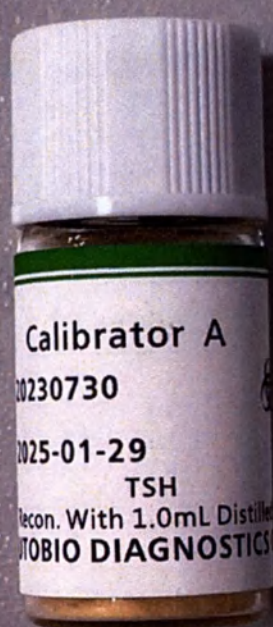


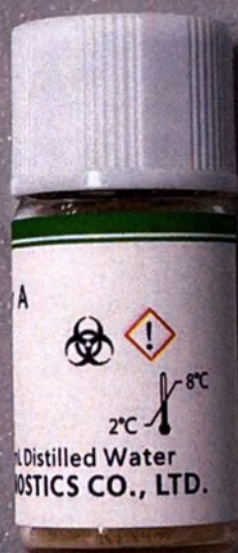

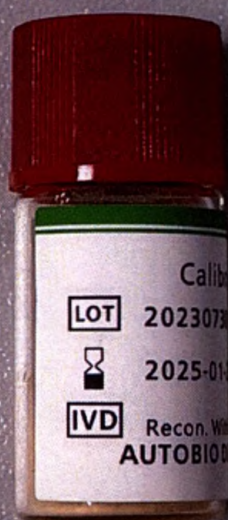

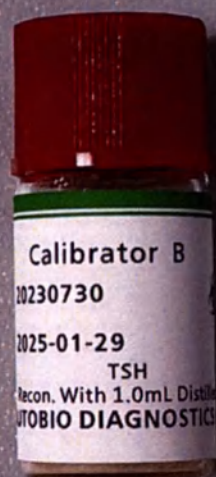

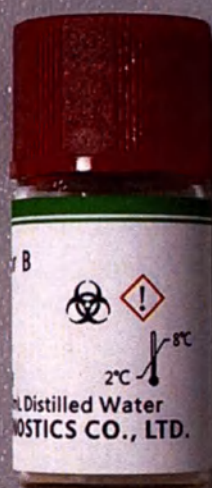

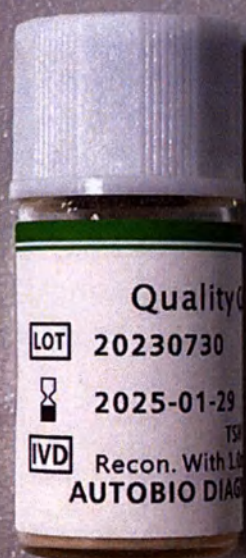










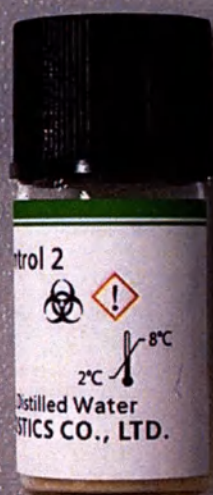





Фотографическое изображение примера транспортной упаковки медицинского изделия:



Макеты русскоязычной маркировки

Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека (TSH CLIA Microparticles (TSH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

1. Основной реагент TSH:
 - Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 1,2 мл – 2 шт.
 - Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 3,0 мл – 2 шт.
 - Разбавитель реагента (Assay Diluent), 3,0 мл – 2 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования
Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

TSH CLIA Microparticles

REF CME0305

LOT



Microparticles Solution 1.2mLx2

Enzyme Conjugate 3.0mLx2

Assay Diluent 3.0mLx2

Calibrator A x1

Calibrator B x1

Quality Control 1 x1

Quality Control 2 x1



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека (TSH CLIA Microparticles (TSH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

1. Основной реагент TSH:
 - Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 2,3 мл – 1 шт.
 - Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 5,5 мл – 1 шт.
 - Разбавитель реагента (Assay Diluent), 5,5 мл – 1 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

TSH CLIA Microparticles

REF CME0302

LOT



Microparticles Solution 2.3mLx1

Enzyme Conjugate 5.5mLx1

Assay Diluent 5.5mLx1

Calibrator A x1

Calibrator B x1

Quality Control 1 x1

Quality Control 2 x1



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека (TSH CLIA Microparticles (TSH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100*2 тестов

1. Основной реагент TSH:
 - Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 2,3 мл – 2 шт.
 - Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 5,5 мл – 2 шт.
 - Разбавитель реагента (Assay Diluent), 5,5 мл – 2 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

TSH CLIA Microparticles

REF CME0303

LOT



Microparticles Solution 2.3mLx2

Enzyme Conjugate 5.5mLx2

Assay Diluent 5.5mLx2

Calibrator A x1

Calibrator B x1

Quality Control 1 x1

Quality Control 2 x1



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека (TSH CLIA Microparticles (TSH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100*5 тестов

1. Основной реагент TSH:
 - Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 2,3 мл – 5 шт.
 - Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 5,5 мл – 5 шт.
 - Разбавитель реагента (Assay Diluent), 5,5 мл – 5 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Только для профессионального использования

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXX от XX.XX.XXXX

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

TSH CLIA Microparticles

REF CME0304

LOT



Microparticles Solution 2.3mLx5

Enzyme Conjugate 5.5mLx5

Assay Diluent 5.5mLx5

Calibrator A x1

Calibrator B x1

Quality Control 1 x1

Quality Control 2 x1



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 25

листах всего пять листов

