

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Эндомедиум+»

Гусев О. А.

«04» апреля 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
«Световод эндоскопический EndoGlance® ТУ 27.40.39-022-47086606-2024»

2024 г.



Рисунок 1 - Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024



Рисунок 2 - Световод эндоскопический EndoGlance®, М по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024



Рисунок 3 - Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

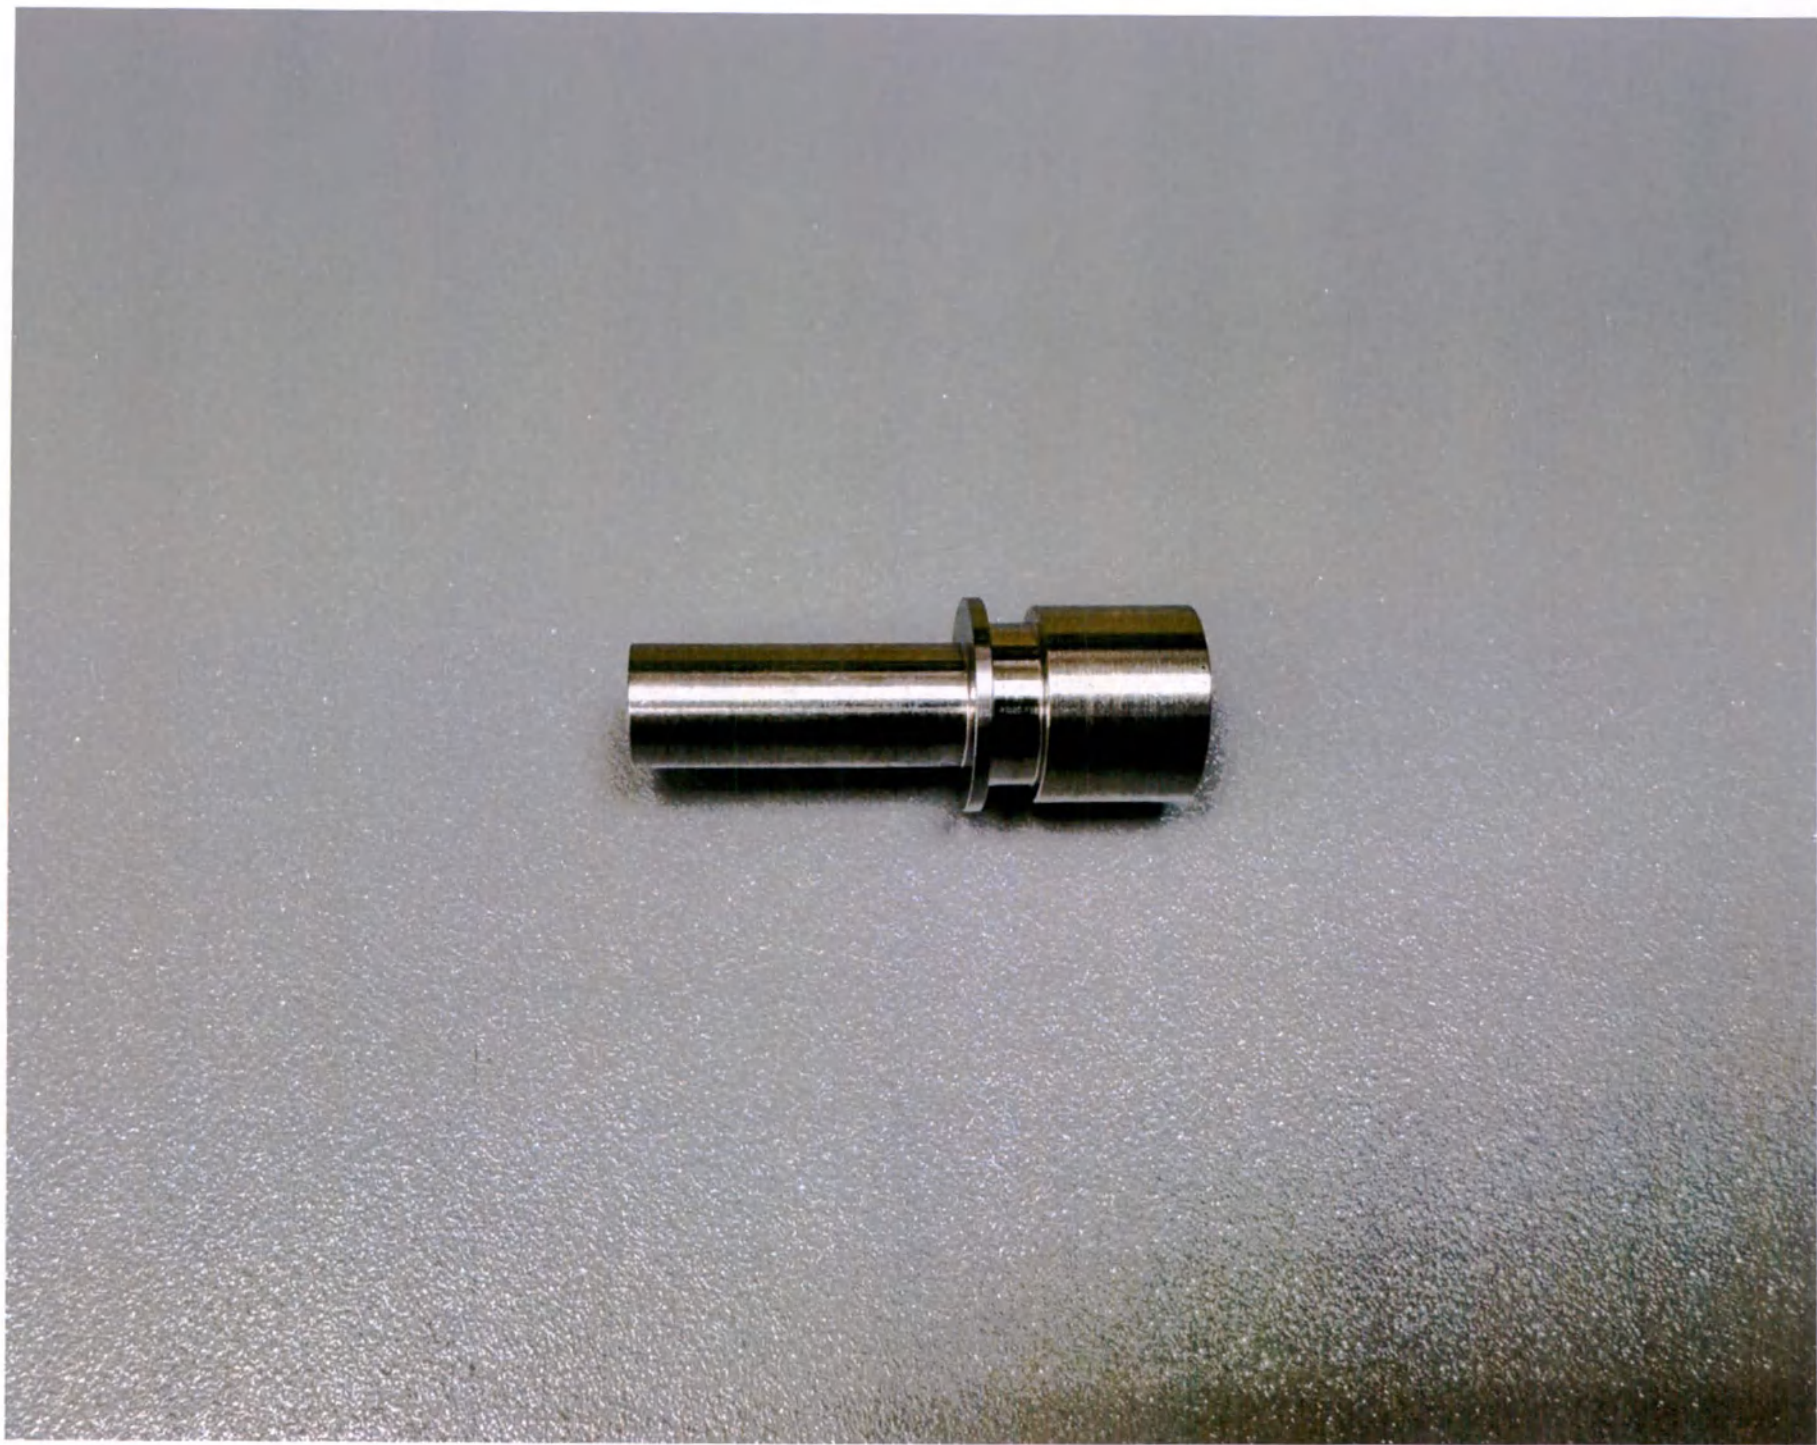


Рисунок 4 - Переходник для осветителей Storz, Эндомедиум



Рисунок 5 - Переходник для осветителей Olympus

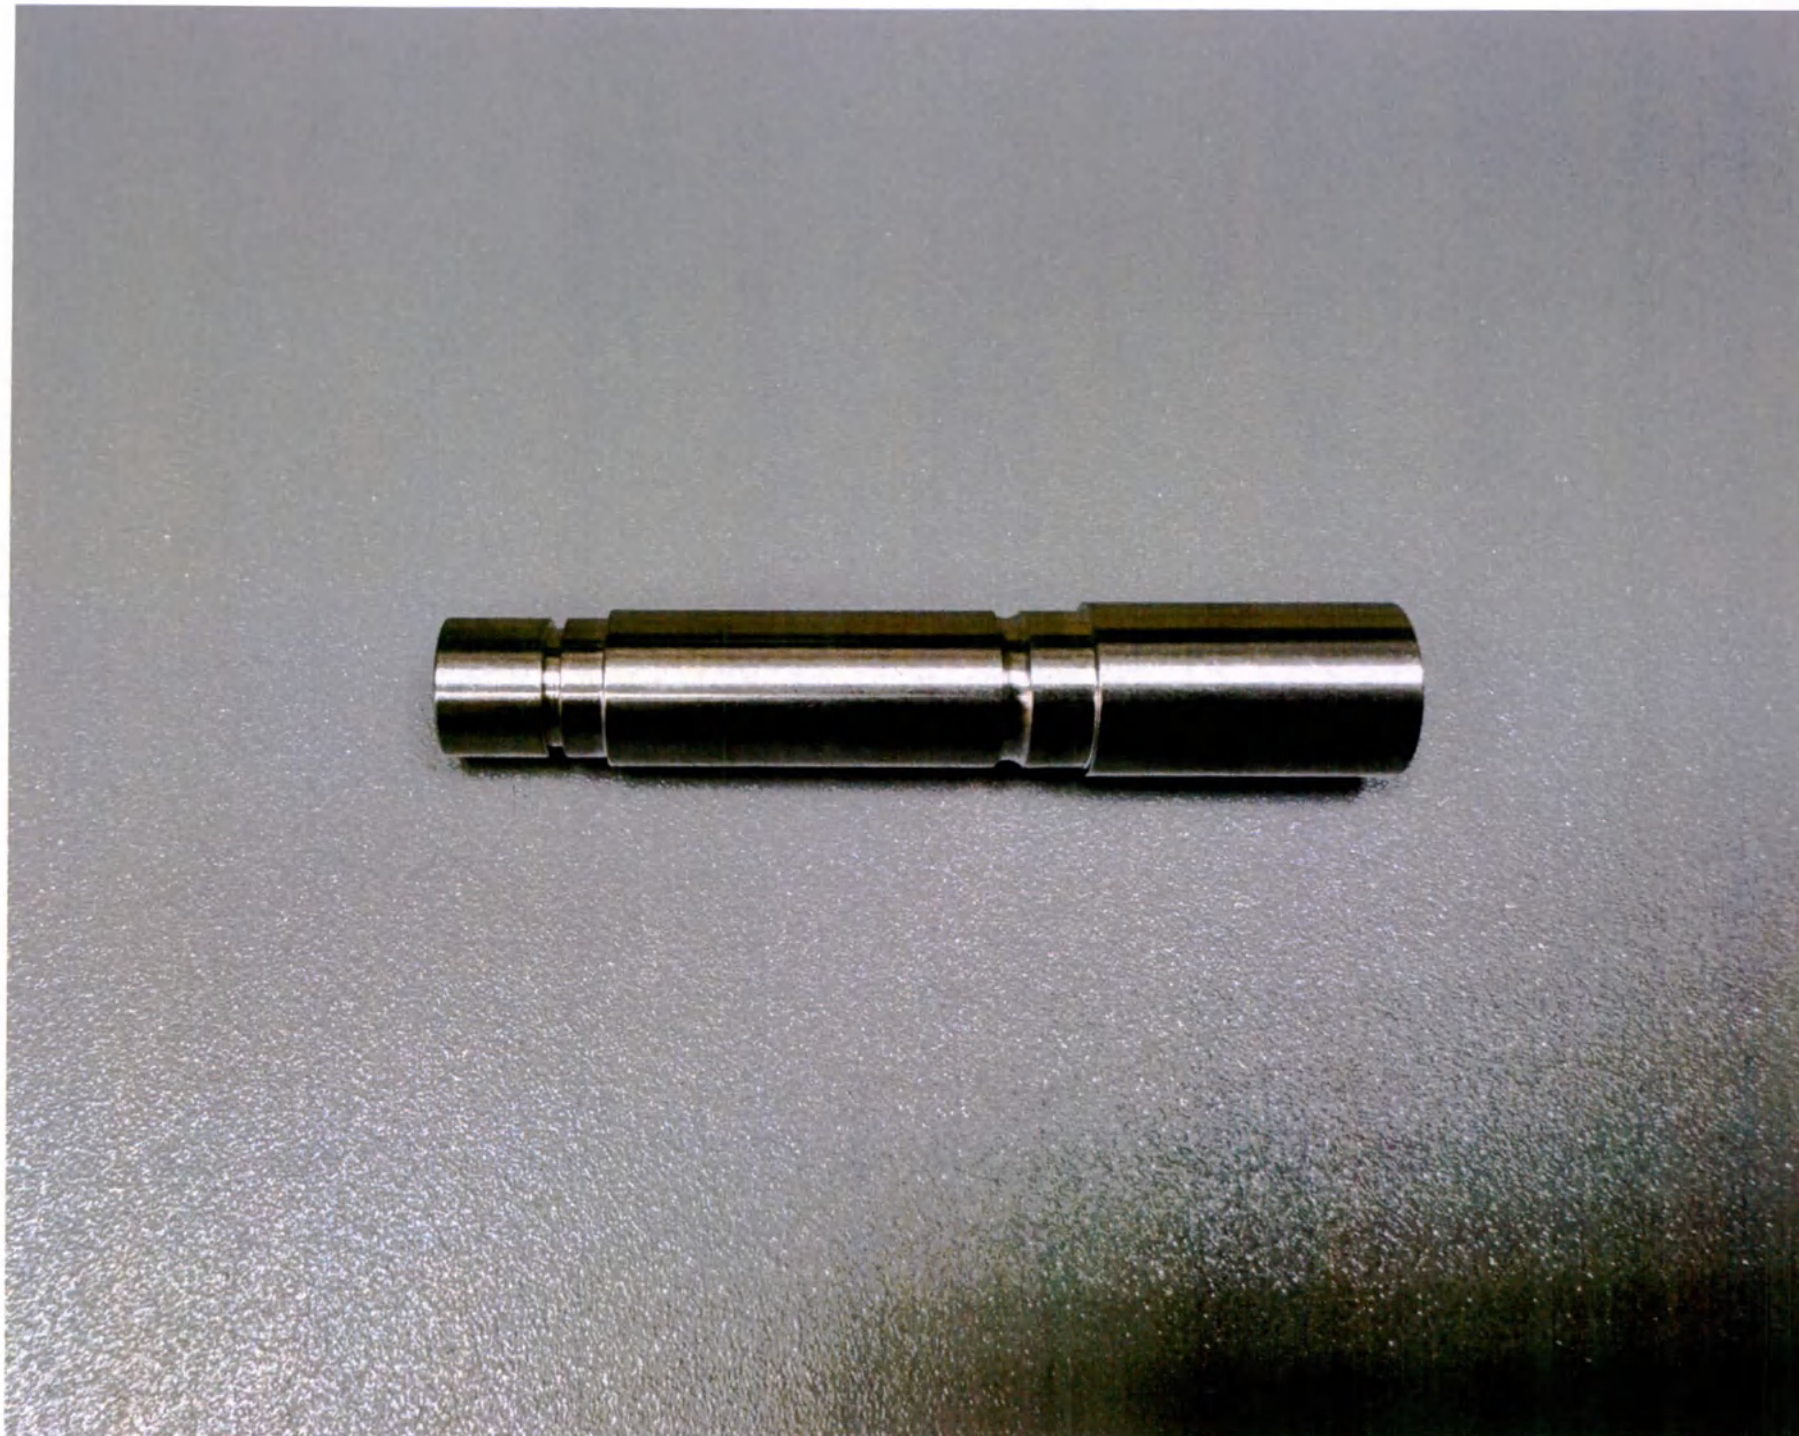


Рисунок 6 - Переходник для осветителей Wolf

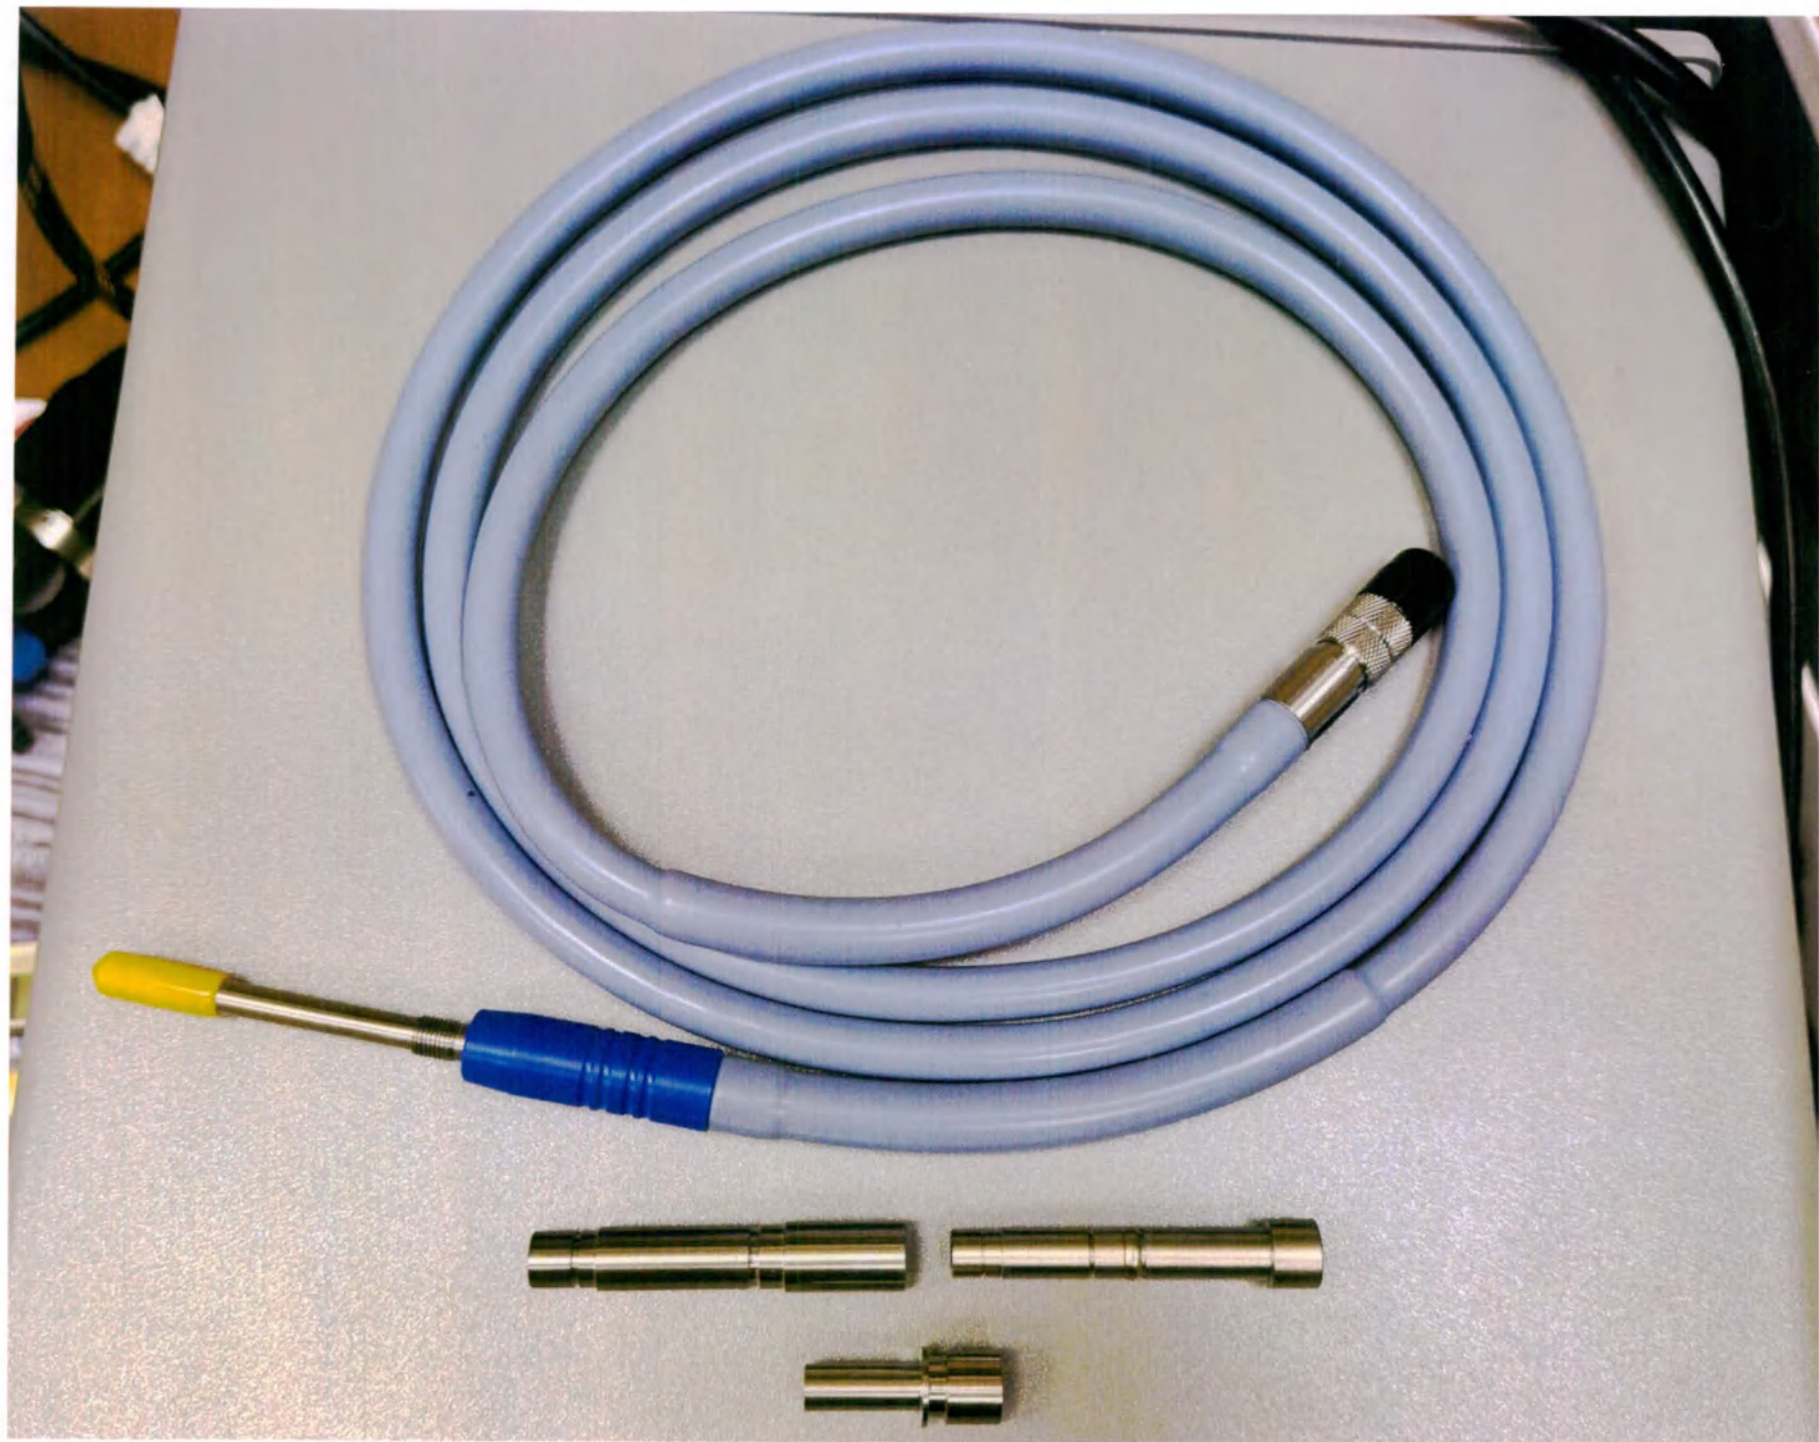


Рисунок 7 – Комплект поставки



Рисунок 8 – Образец упаковки. Световод с предустановленным переходником для осветителей Storz, Эндомедиум


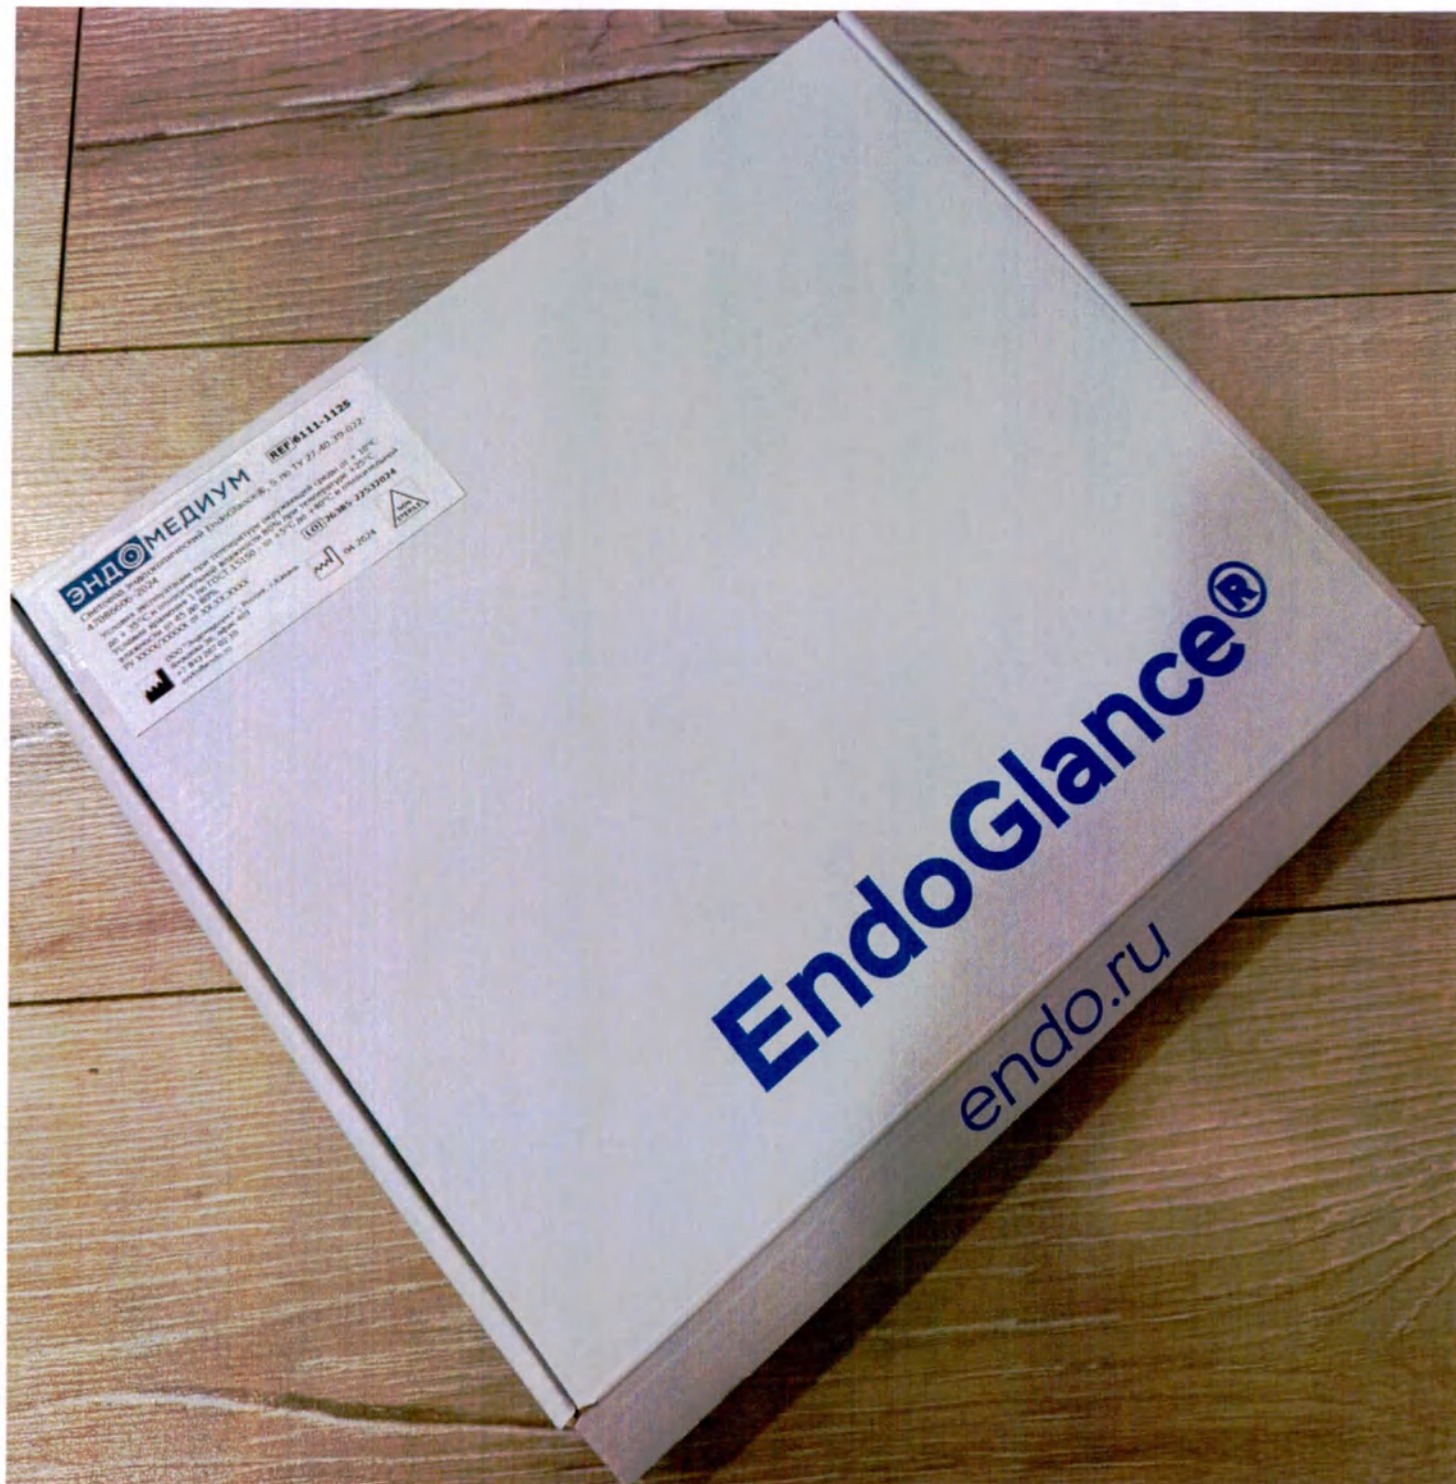


Рисунок 9 – Образец упаковки. Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024



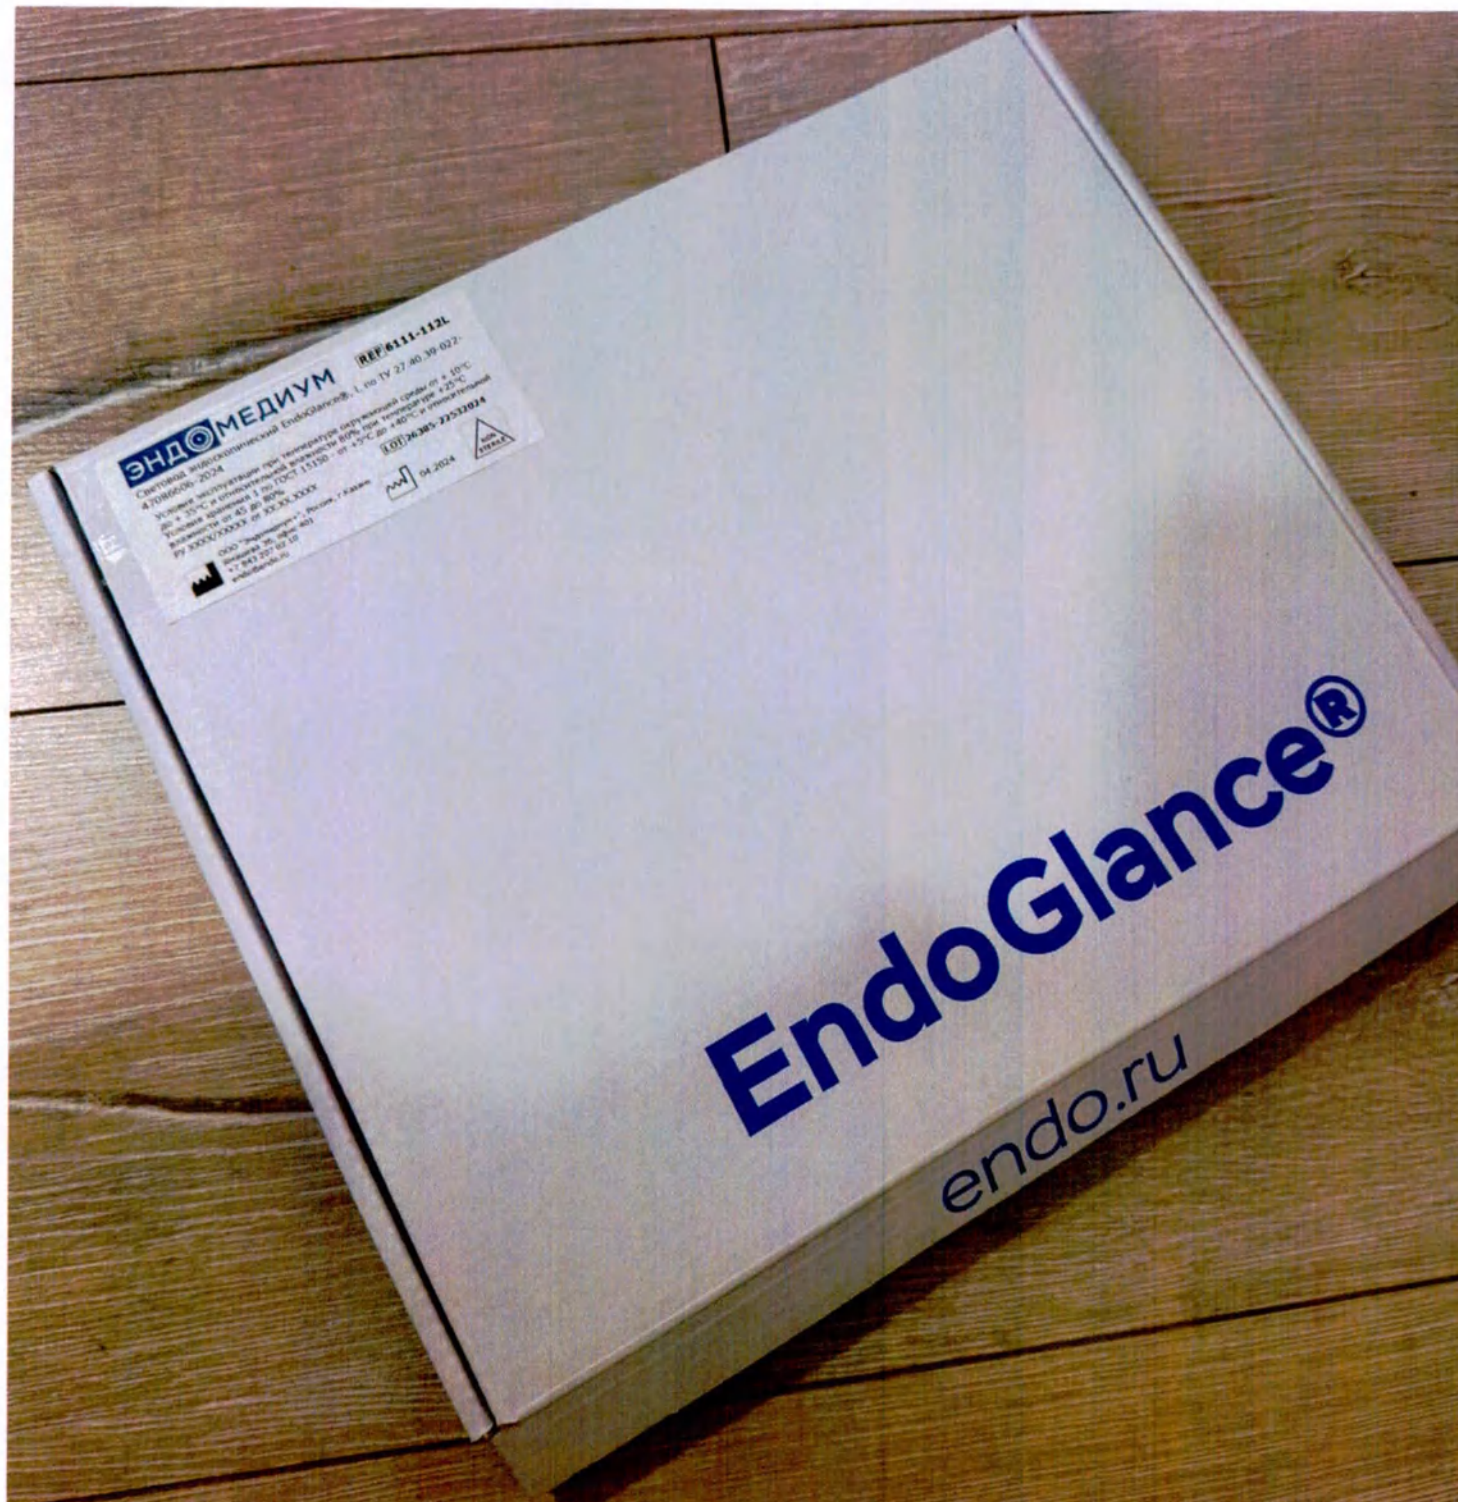

ЭНДОМЕДИУМ

REF 6111-112S

Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

Условия эксплуатации при температуре окружающей среды от + 10°C до + 35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 - от +5°C до +40°C и относительной влажности от 45 до 80%
РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

LOT 26385-22532024



ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru



04.2024



Рисунок 12 – Маркировка упаковки. Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

ЭНДОМЕДИУМ

REF 6111-112

Световод эндоскопический EndoGlance®, М по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

Условия эксплуатации при температуре окружающей среды от + 10°C до + 35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 - от +5°C до +40°C и относительной влажности от 45 до 80%
РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

LOT 26385-22532024



ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru



04.2024



Рисунок 13 – Маркировка упаковки. Световод эндоскопический EndoGlance®, М по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

ЭНДОМЕДИУМ

REF 6111-112L

Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

Условия эксплуатации при температуре окружающей среды от + 10°C до + 35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C
Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 - от +5°C до +40°C и относительной влажности от 45 до 80%
РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

LOT 26385-22532024



ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru



04.2024



Рисунок 14 – Маркировка упаковки. Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

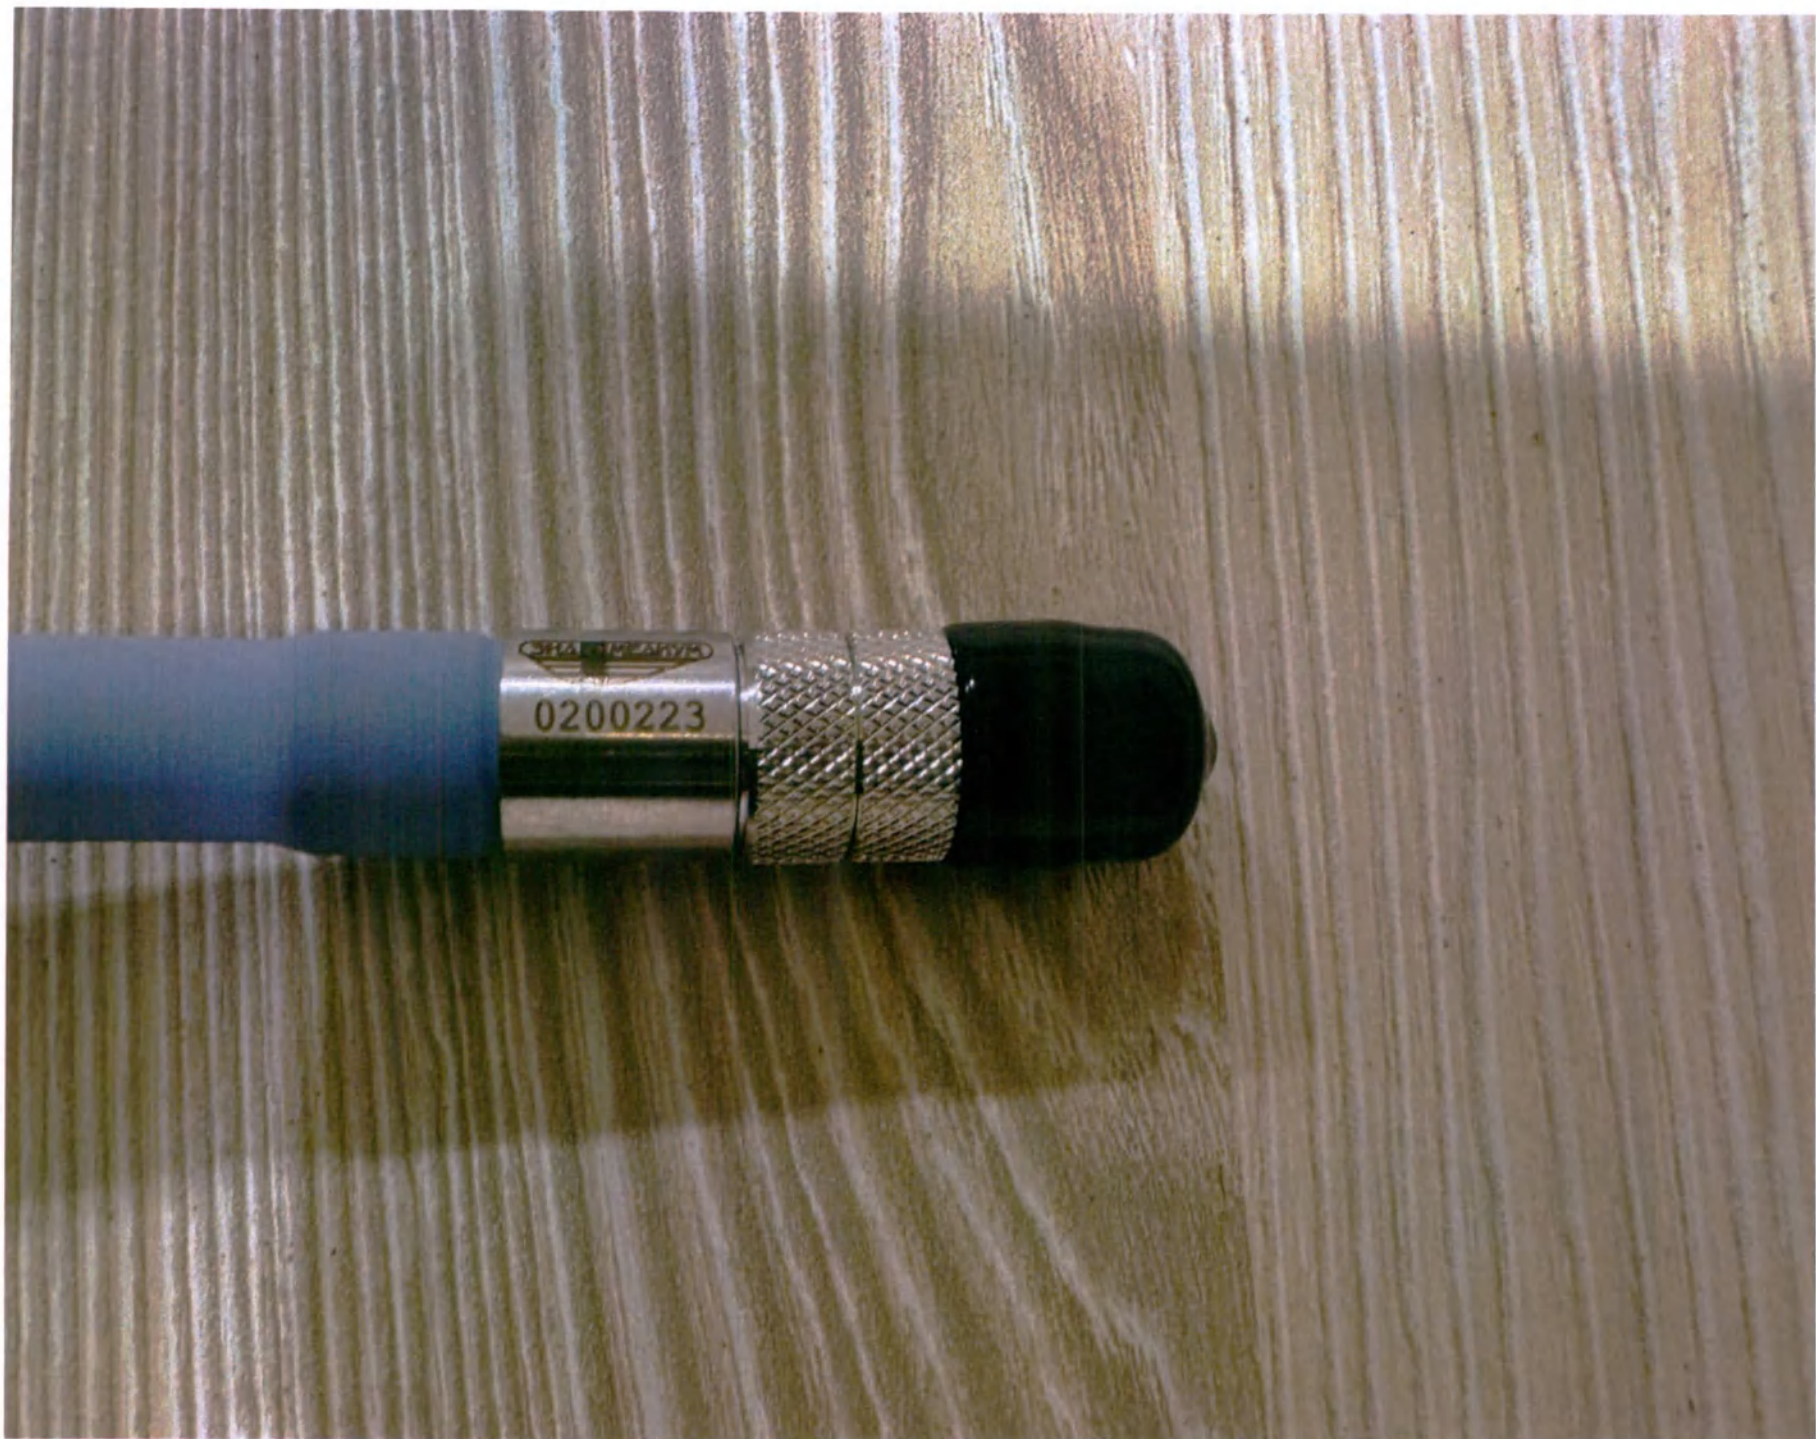


Рисунок 15 – Пример маркировки на световоде

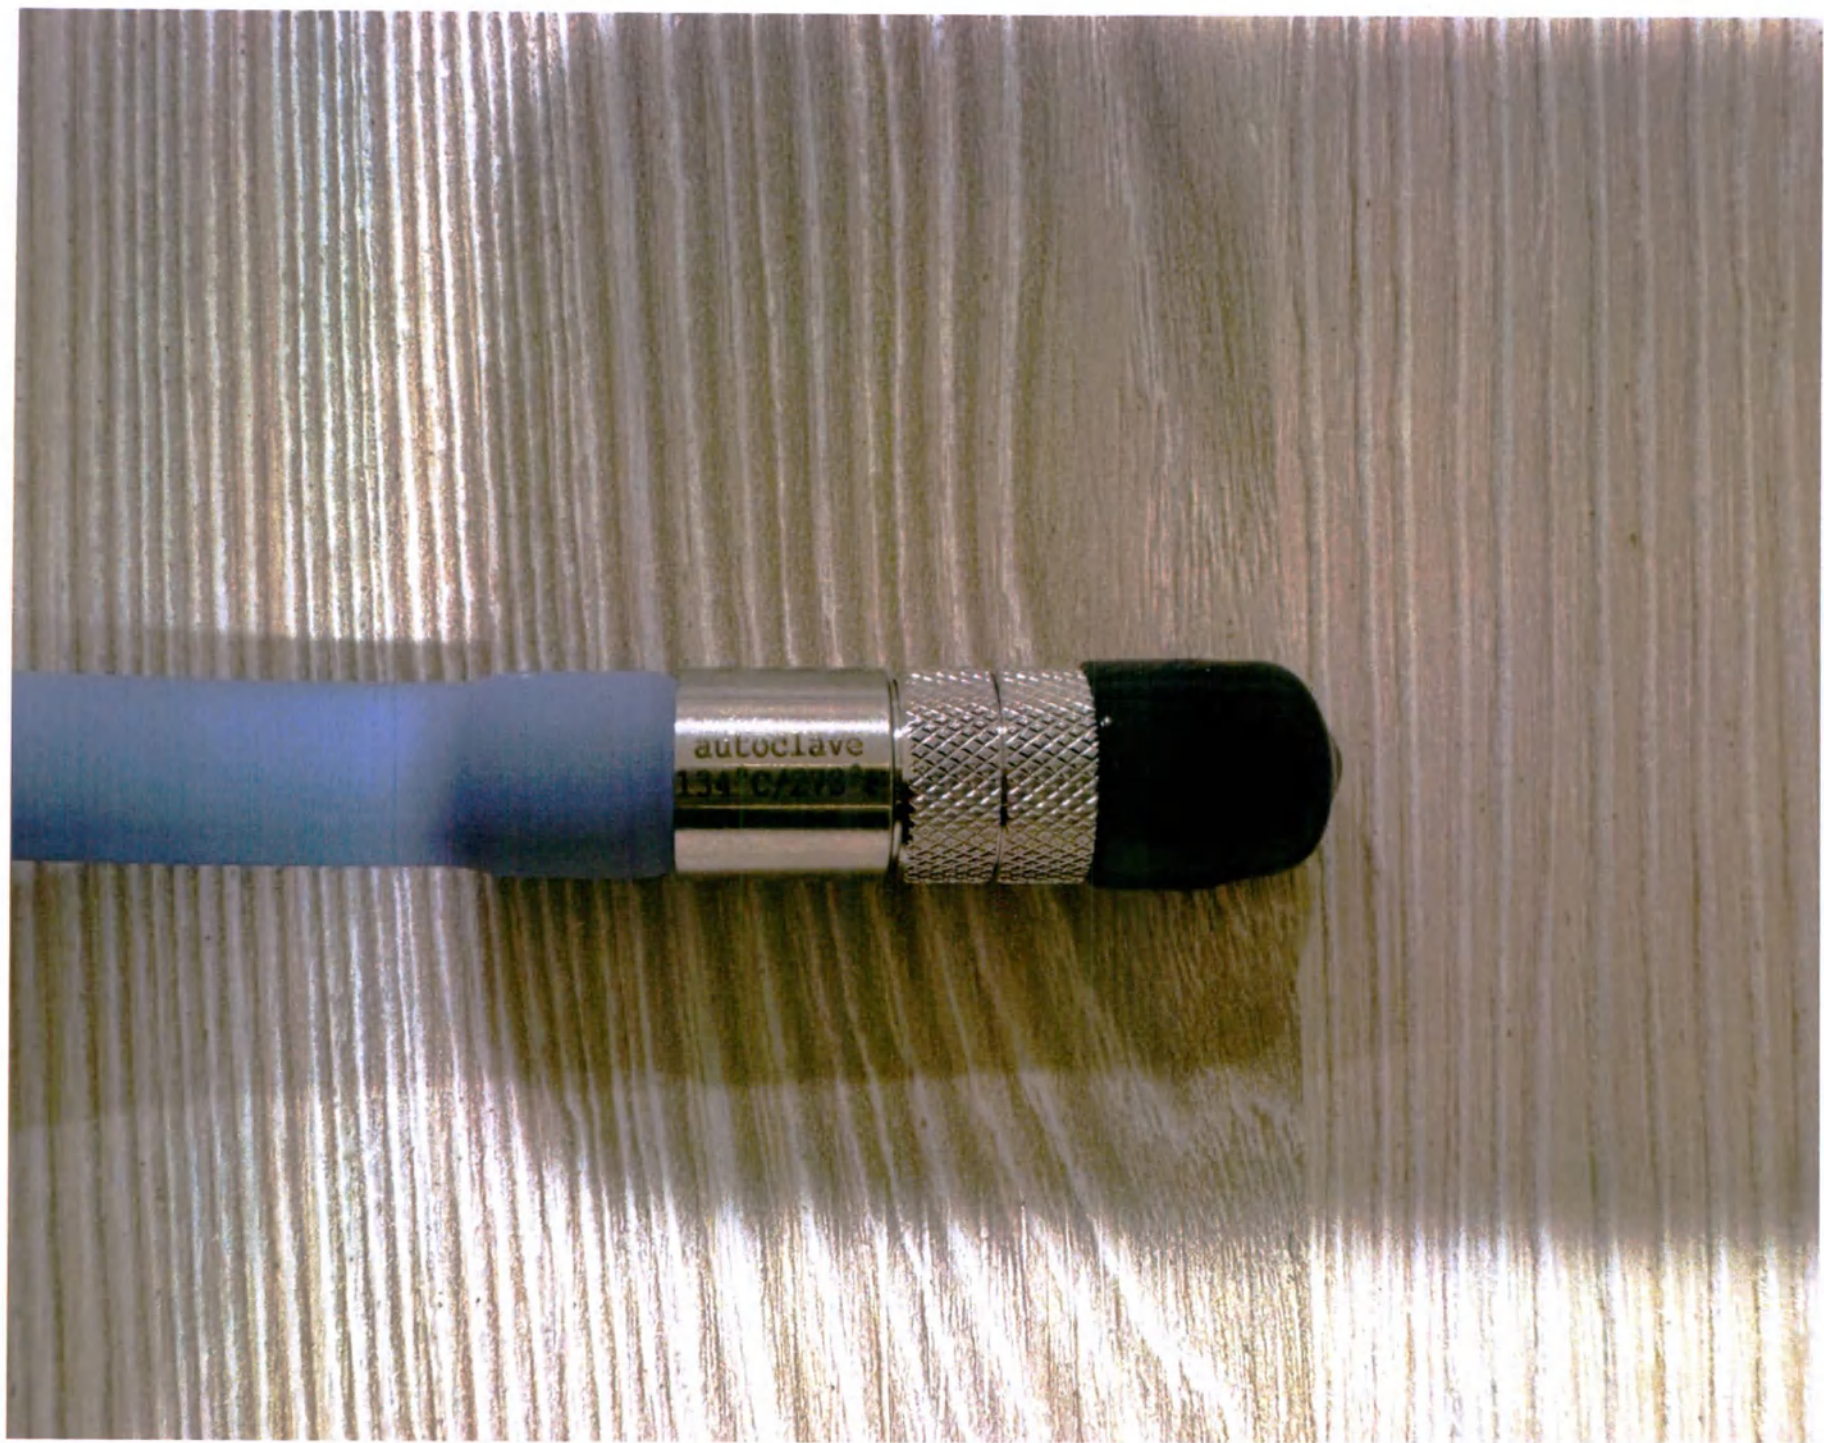


Рисунок 16 – Пример маркировки на световоде

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Спасибо
за Ваш выбор!** 

«Качество проверенное временем»

МЕДИУМ

ЭНДОМЕДИУМ

endo.ru



endo.ru

Тел.: +7 (843) 207-02-10
E-mail: endo@endo.ru www.endo.ru





Рисунок 18 – Транспортная тара. Общий вид



Производитель эндохирургического оборудования

ЭНДОМЕДИУМ

endo.ru

Световод эндоскопический
EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-
022-47086606-2024

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 - от +5°C
до +40°C и относительной влажности от 45
до 80%

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150 -
5 от -50°C до +50°C и относительной
влажности от 45 до 80%
ПУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



04.2024



ООО "Эндомедиум+"
Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru endo.ru



Рисунок 19 – Маркировка транспортной тары. Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024



Производитель эндохирургического оборудования

ЭНДОМЕДИУМ

endo.ru

Световод эндоскопический
EndoGlance®, М по ТУ 27.40.39-
022-47086606-2024

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 - от +5°C
до +40°C и относительной влажности от 45
до 80%

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150 -
5 от -50°C до +50°C и относительной
влажности от 45 до 80%
РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



04.2024



ООО "Эндомедиум+"
Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru endo.ru



Рисунок 20 – Маркировка транспортной тары. Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024



Производитель эндохирургического оборудования

ЭНДОМЕДИУМ

endo.ru

Световод эндоскопический
EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-
022-47086606-2024

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 - от +5°C
до +40°C и относительной влажности от 45
до 80%

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150 -
5 от -50°C до +50°C и относительной
влажности от 45 до 80%
ПУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



04.2024



ООО "Эндомедиум+"
Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru endo.ru



Рисунок 21 – Маркировка транспортной тары. Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024



Рисунок 22 – Макет маркировки на упаковке. Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

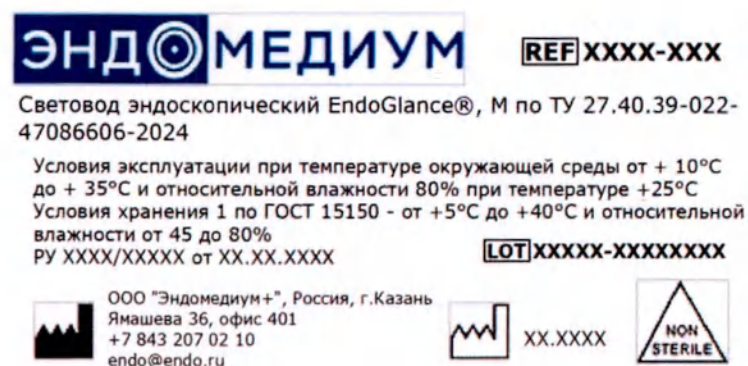


Рисунок 23 – Макет маркировки на упаковке. Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

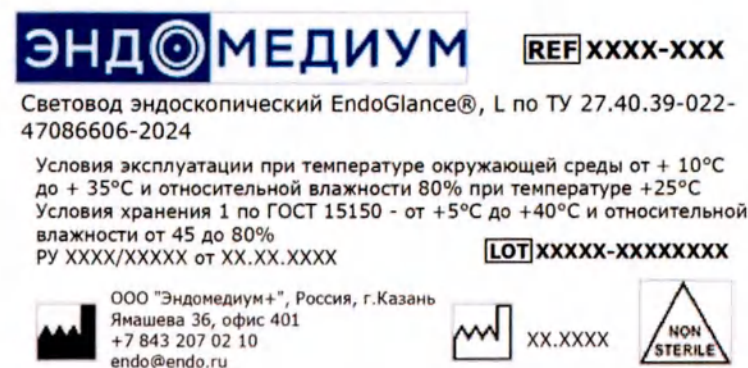


Рисунок 24 – Макет маркировки на упаковке. Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

Производитель эндохирургического оборудования



endo.ru

Световод эндоскопический
EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-
022-47086606-2024

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 - от +5°C
до +40°C и относительной влажности от 45
до 80%

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150 -
5 от -50°C до +50°C и относительной
влажности от 45 до 80%

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



XX.XXXX



ООО "Эндомедиум+"
Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru endo.ru



Рисунок 25 – Макет стикера транспортной упаковки. Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

Производитель эндохирургического оборудования



endo.ru

Световод эндоскопический
EndoGlance®, М по ТУ 27.40.39-
022-47086606-2024

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 - от +5°C
до +40°C и относительной влажности от 45
до 80%

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150 -
5 от -50°C до +50°C и относительной
влажности от 45 до 80%

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



XX.XXXX



ООО "Эндомедиум+"
Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru endo.ru



Рисунок 26 – Макет стикера транспортной упаковки. Световод эндоскопический EndoGlance®, М по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

Производитель эндохирургического оборудования



endo.ru

Световод эндоскопический
EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-
022-47086606-2024

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 - от +5°C
до +40°C и относительной влажности от 45
до 80%

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150 -
5 от -50°C до +50°C и относительной
влажности от 45 до 80%

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



XX.XXXX



ООО "Эндомедиум+"
Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru endo.ru



Рисунок 27 – Макет стикера транспортной упаковки. Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024

Всего в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 26 листов.

Директор ООО «Эндомедиум +»



О.А. Гусев