

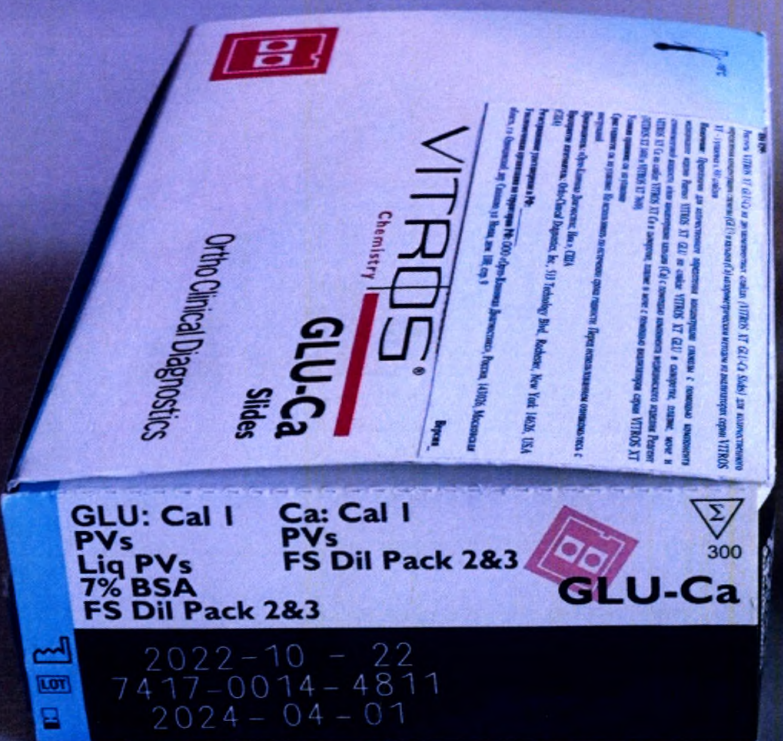


Фотографическое изображение медицинского изделия

Реагенты VITROS XT GLU-Ca на двухкомпонентных слайдах (VITROS XT GLU-Ca Slides) для количественного определения концентрации глюкозы (GLU) и кальция (Ca) колориметрическим методом на анализаторах серии VITROS XT

Реагенты VITROS XT GLU-Ca на двухкомпонентных слайдах





684 4295

Реагенты VITROS XT GLU-Ca на двухкомпонентных слайдах (VITROS XT GLU-Ca Slides) для количественного определения концентрации глюкозы (GLU) и кальция (Ca) колориметрическим методом на анализаторах серии VITROS XT – 1 упаковка х 300 слайдов.

Назначение: Предназначен для количественного определения концентрации глюкозы с помощью компонента медицинского изделия Реагент VITROS XT GLU на слайде VITROS XT GLU в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости, и/или концентрации кальция (Ca) с помощью компонента медицинского изделия Реагент VITROS XT Ca на слайде VITROS XT Ca в сыворотке, плазме и моче с помощью анализаторов серии VITROS XT (VITROS XT 3400 и VITROS XT 7600).

Условия хранения: см. на упаковке

Срок годности: см. на упаковке. Не использовать по истечении срока годности. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Производитель: «Орто-Клиникал Диагностика, Инк.», США

Предприятие изготовитель: Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 513 Technology Blvd., Rochester, New York 14626, USA (США)

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностика», Россия, 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Версия_

VITROS®
Chemistry

GLU-Ca
Slides

Ortho Clinical Diagnostics

Реагенты VITROS XT GLU-Са на двухкомпонентных слайдах. Картриджи со слайдами в упаковке из фольги.



Реагенты VITROS XT GLU-Ca на двухкомпонентных слайдах. Картридж со слайдами.



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

ВСЕГО 5 лист 06

" " 20__ г.

Генеральный директор

ООО "Орто-Клиникал-Диагностикс"

 В.К. Сергеевко

