

Фотографические изображения медицинского изделия:
«Светильник медицинский хирургический «Armed»,
производство: Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Китай

- I. Светильник медицинский хирургический «Armed», вариант исполнения AR 01-5 LED, в составе (рис. 1-13).
- II. Светильник медицинский хирургический «Armed», вариант исполнения AR 02-5 LED, в составе (рис. 14-23).
- III. Светильник медицинский хирургический «Armed», вариант исполнения AR-SY320C LED, в составе (рис. 24-33).
- IV. Светильник медицинский хирургический «Armed», вариант исполнения AR 700/500 LED, в составе (рис. 34-45).
- V. Светильник медицинский хирургический «Armed», вариант исполнения AR 500 LED, в составе (рис. 46-55).
- VI. Макет шильда (рис. 56-57).
- VII. Макет маркировки потребительской упаковки (рис. 58-59).

Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)



(Р.С. Жуков)
(И.О. Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «ОПОРА» (ООО «ОПОРА»)

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

(наименование организации-заявителя)

Приложение

I. Светильник медицинский хирургический «Armed», вариант исполнения AR 01-5 LED, в составе:

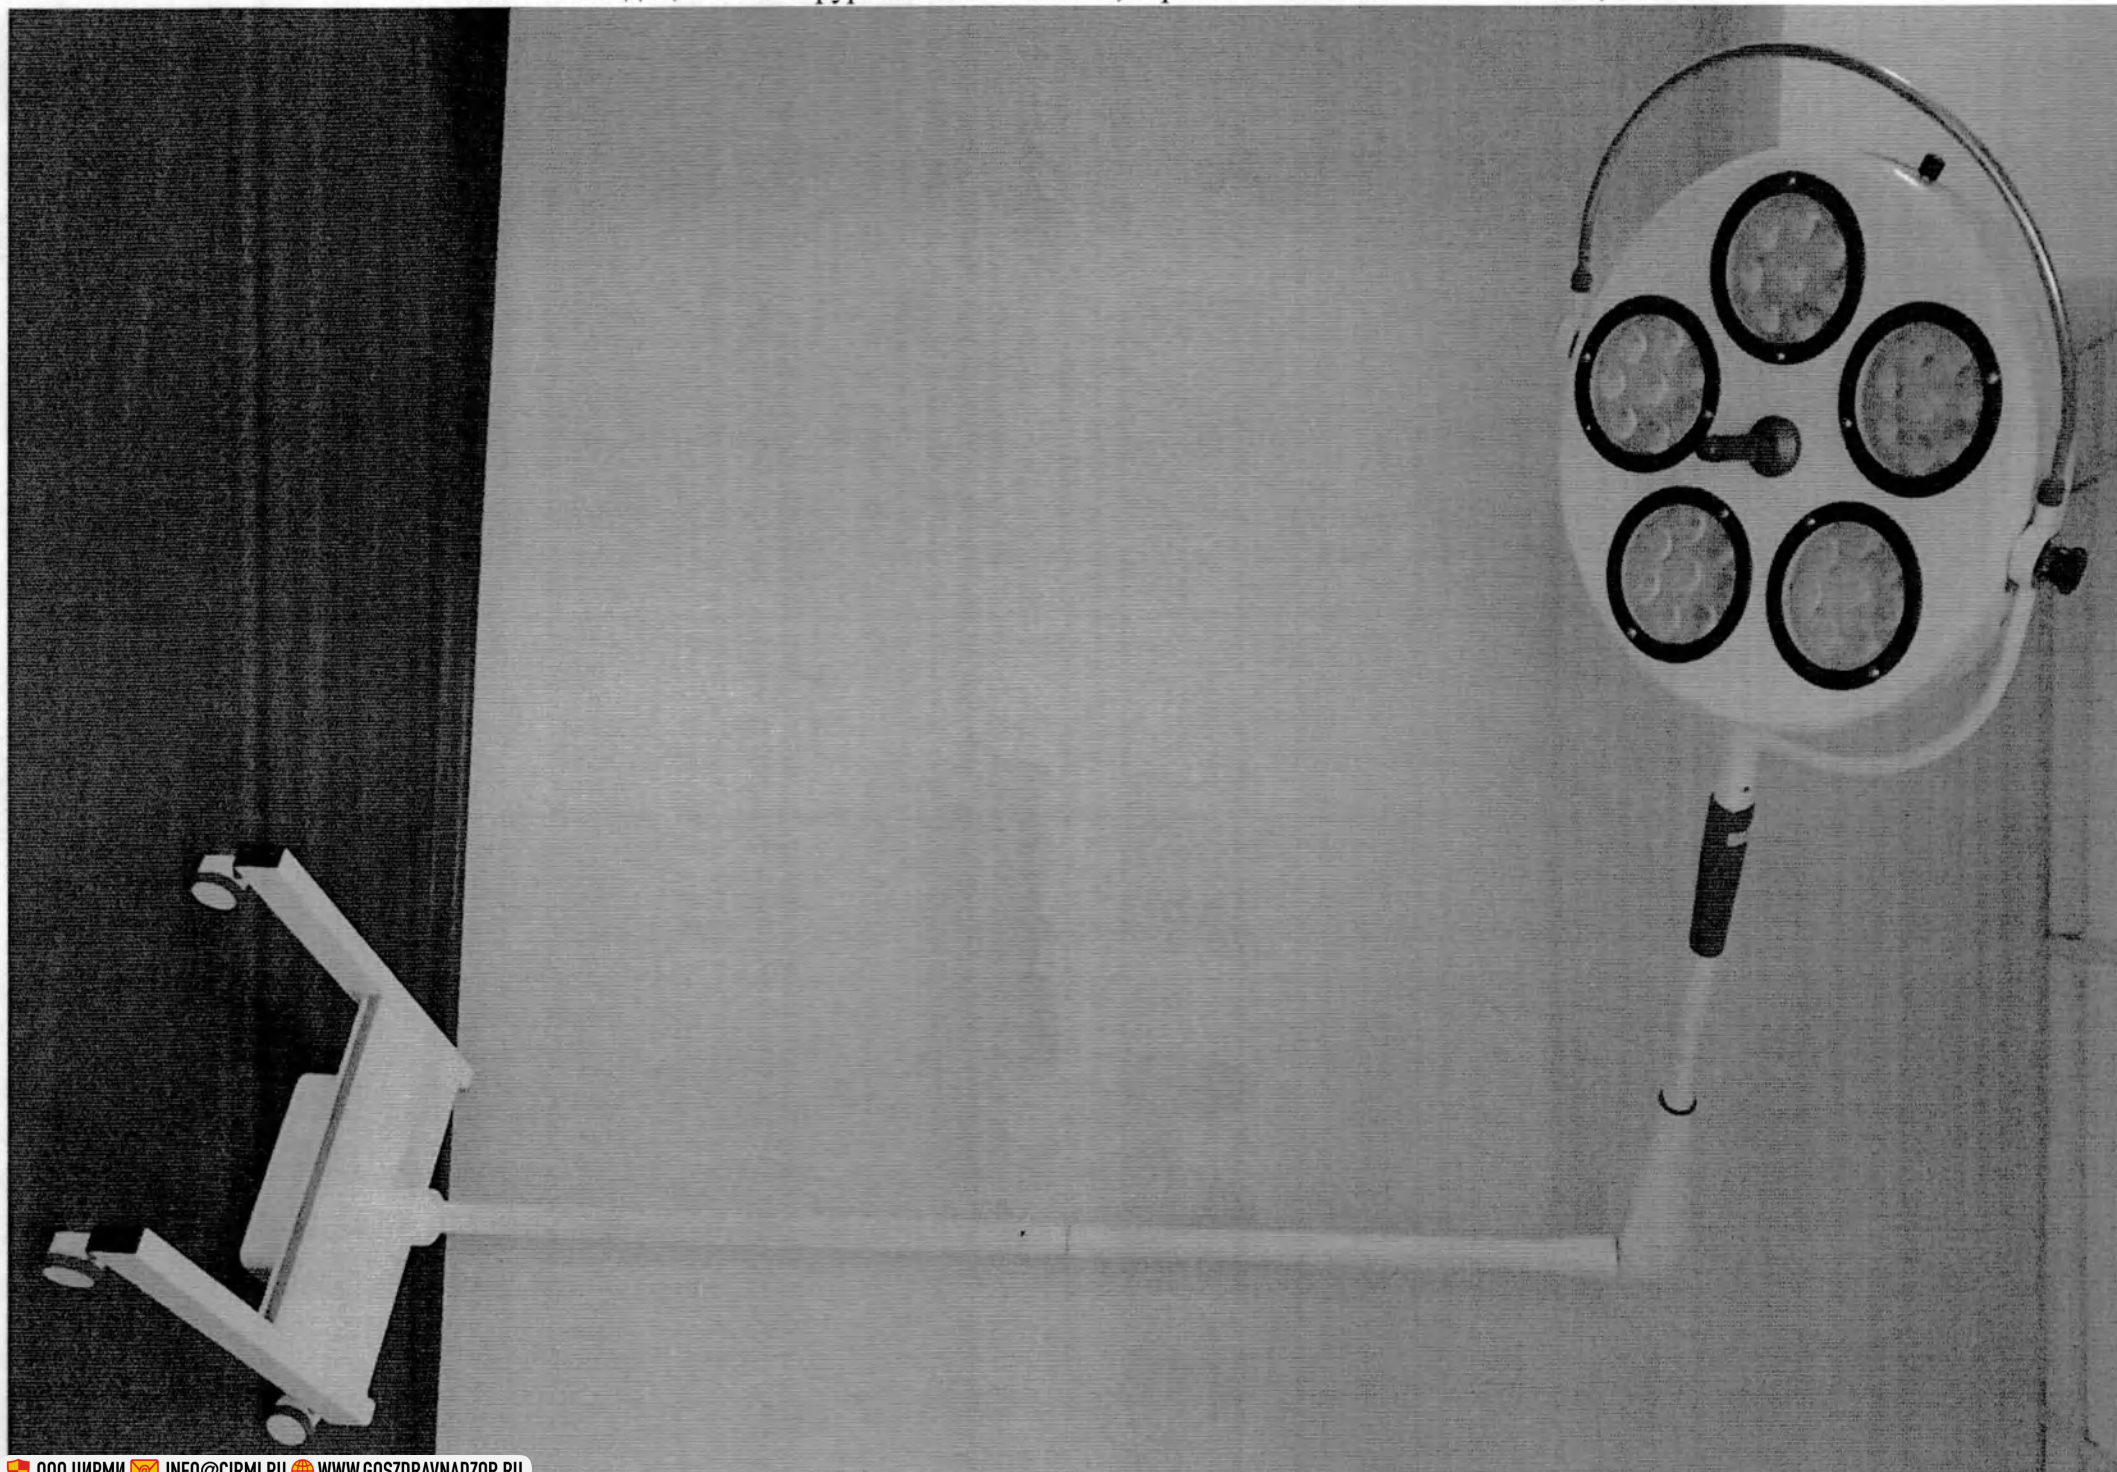


Рис. 1 – Светильник медицинский хирургический «Armed», вариант исполнения AR 01-5 LED (в сборе)

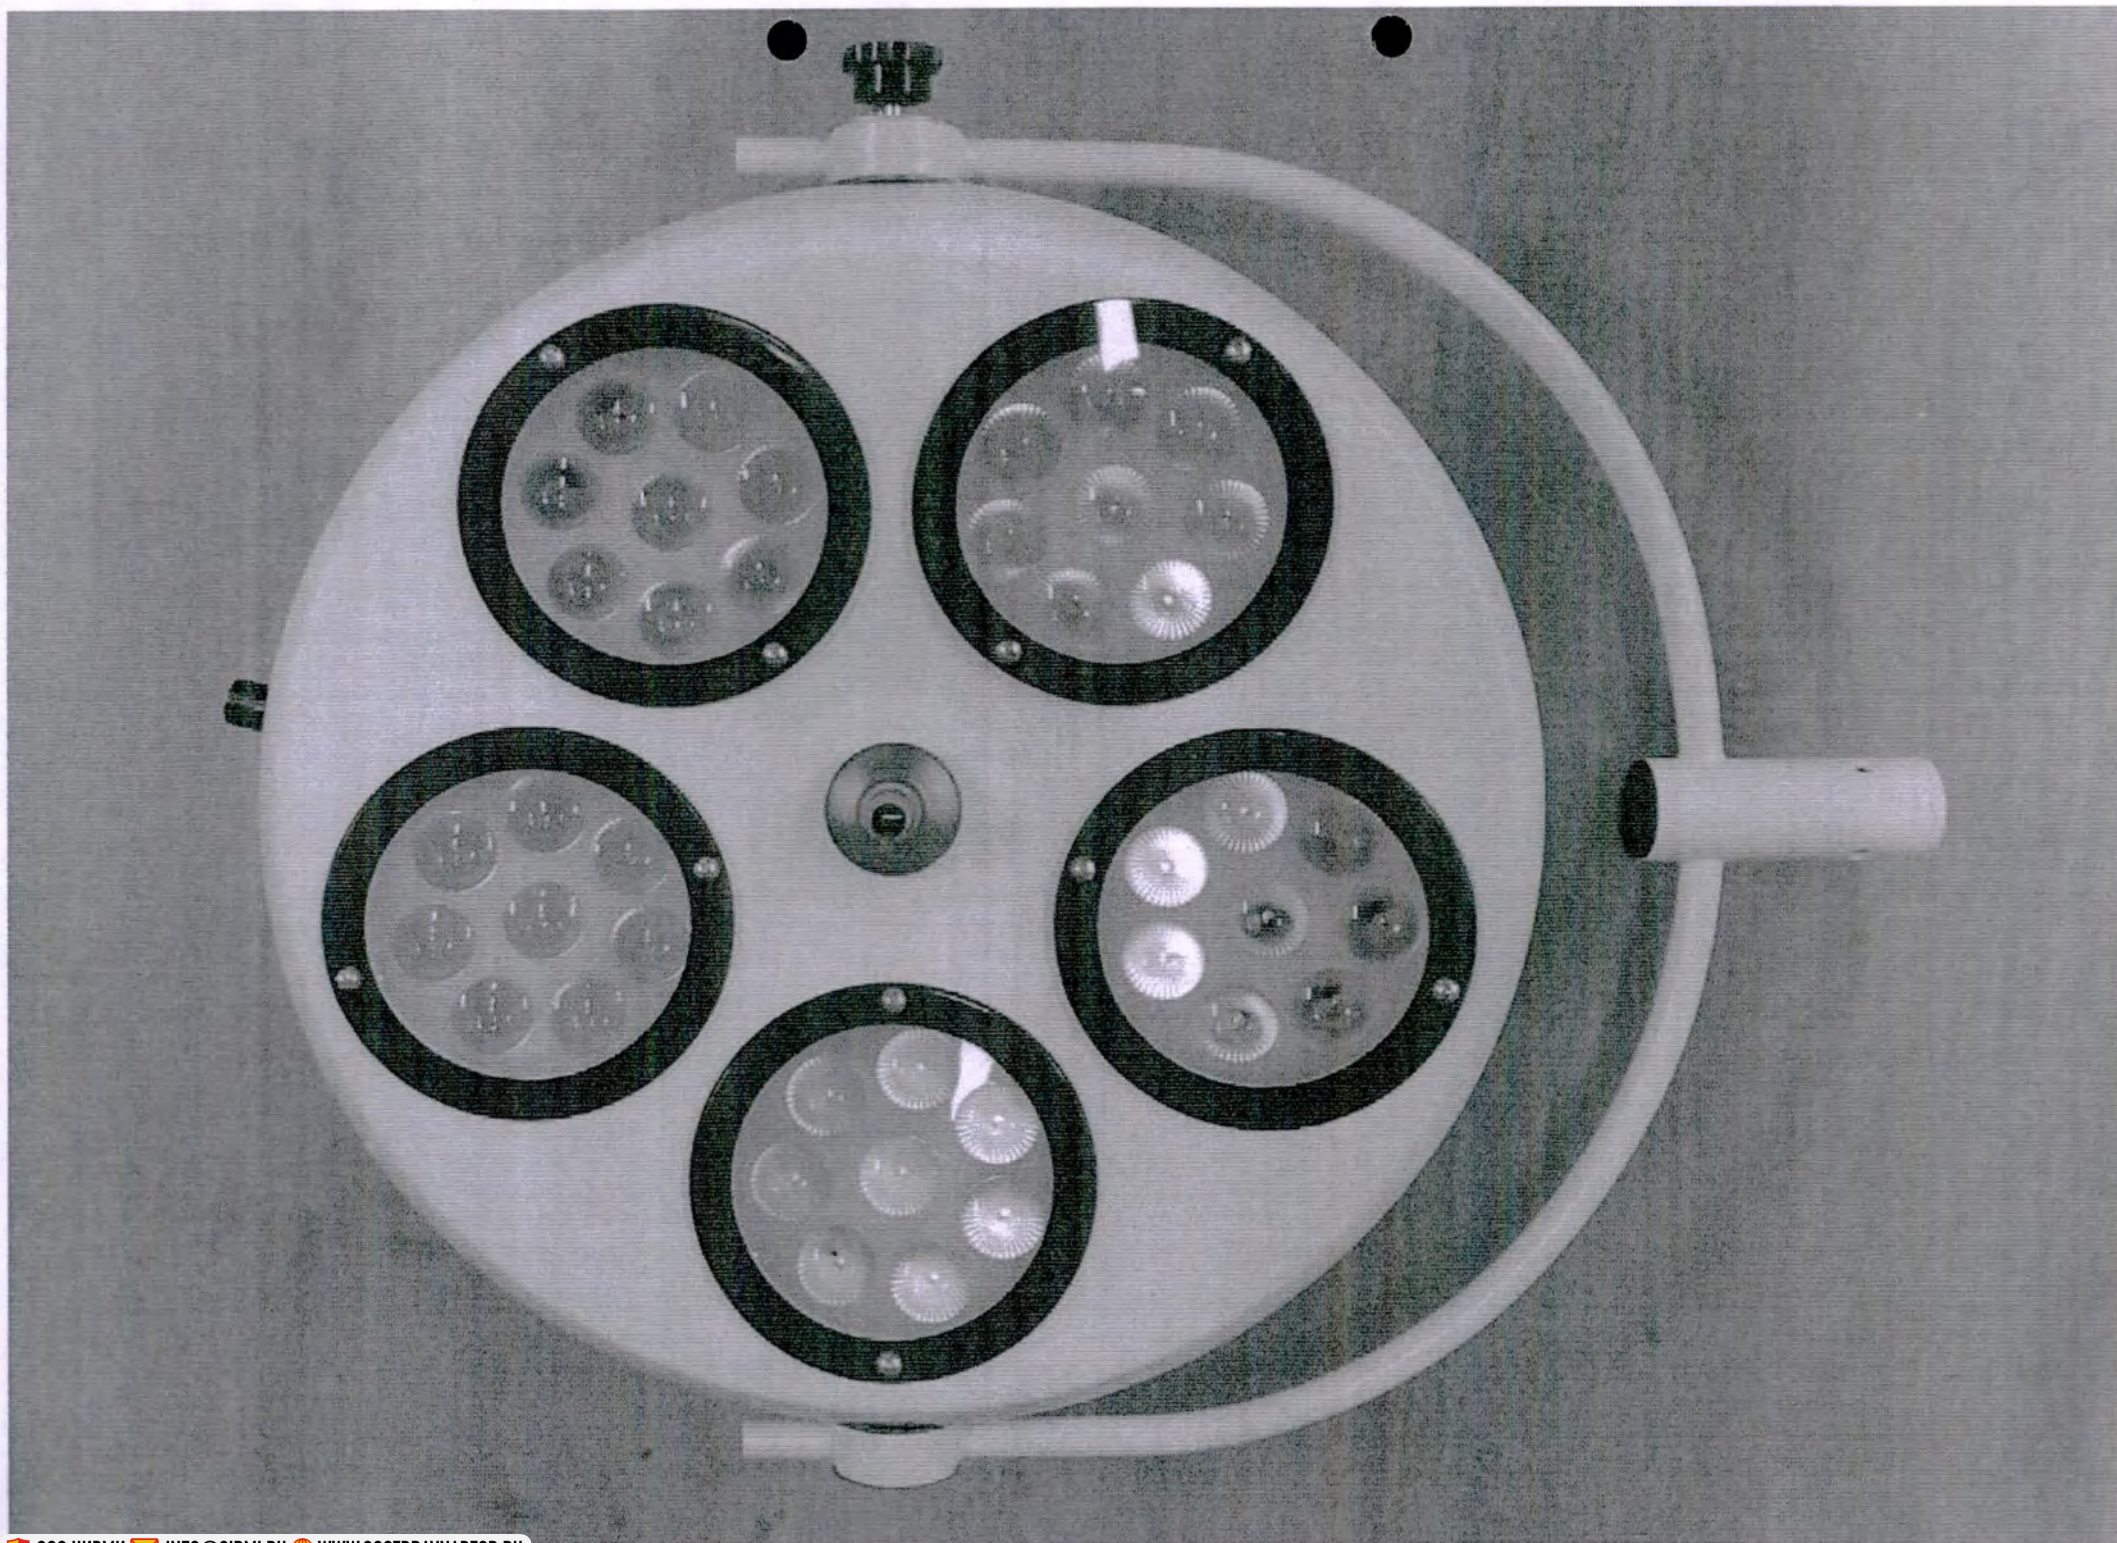
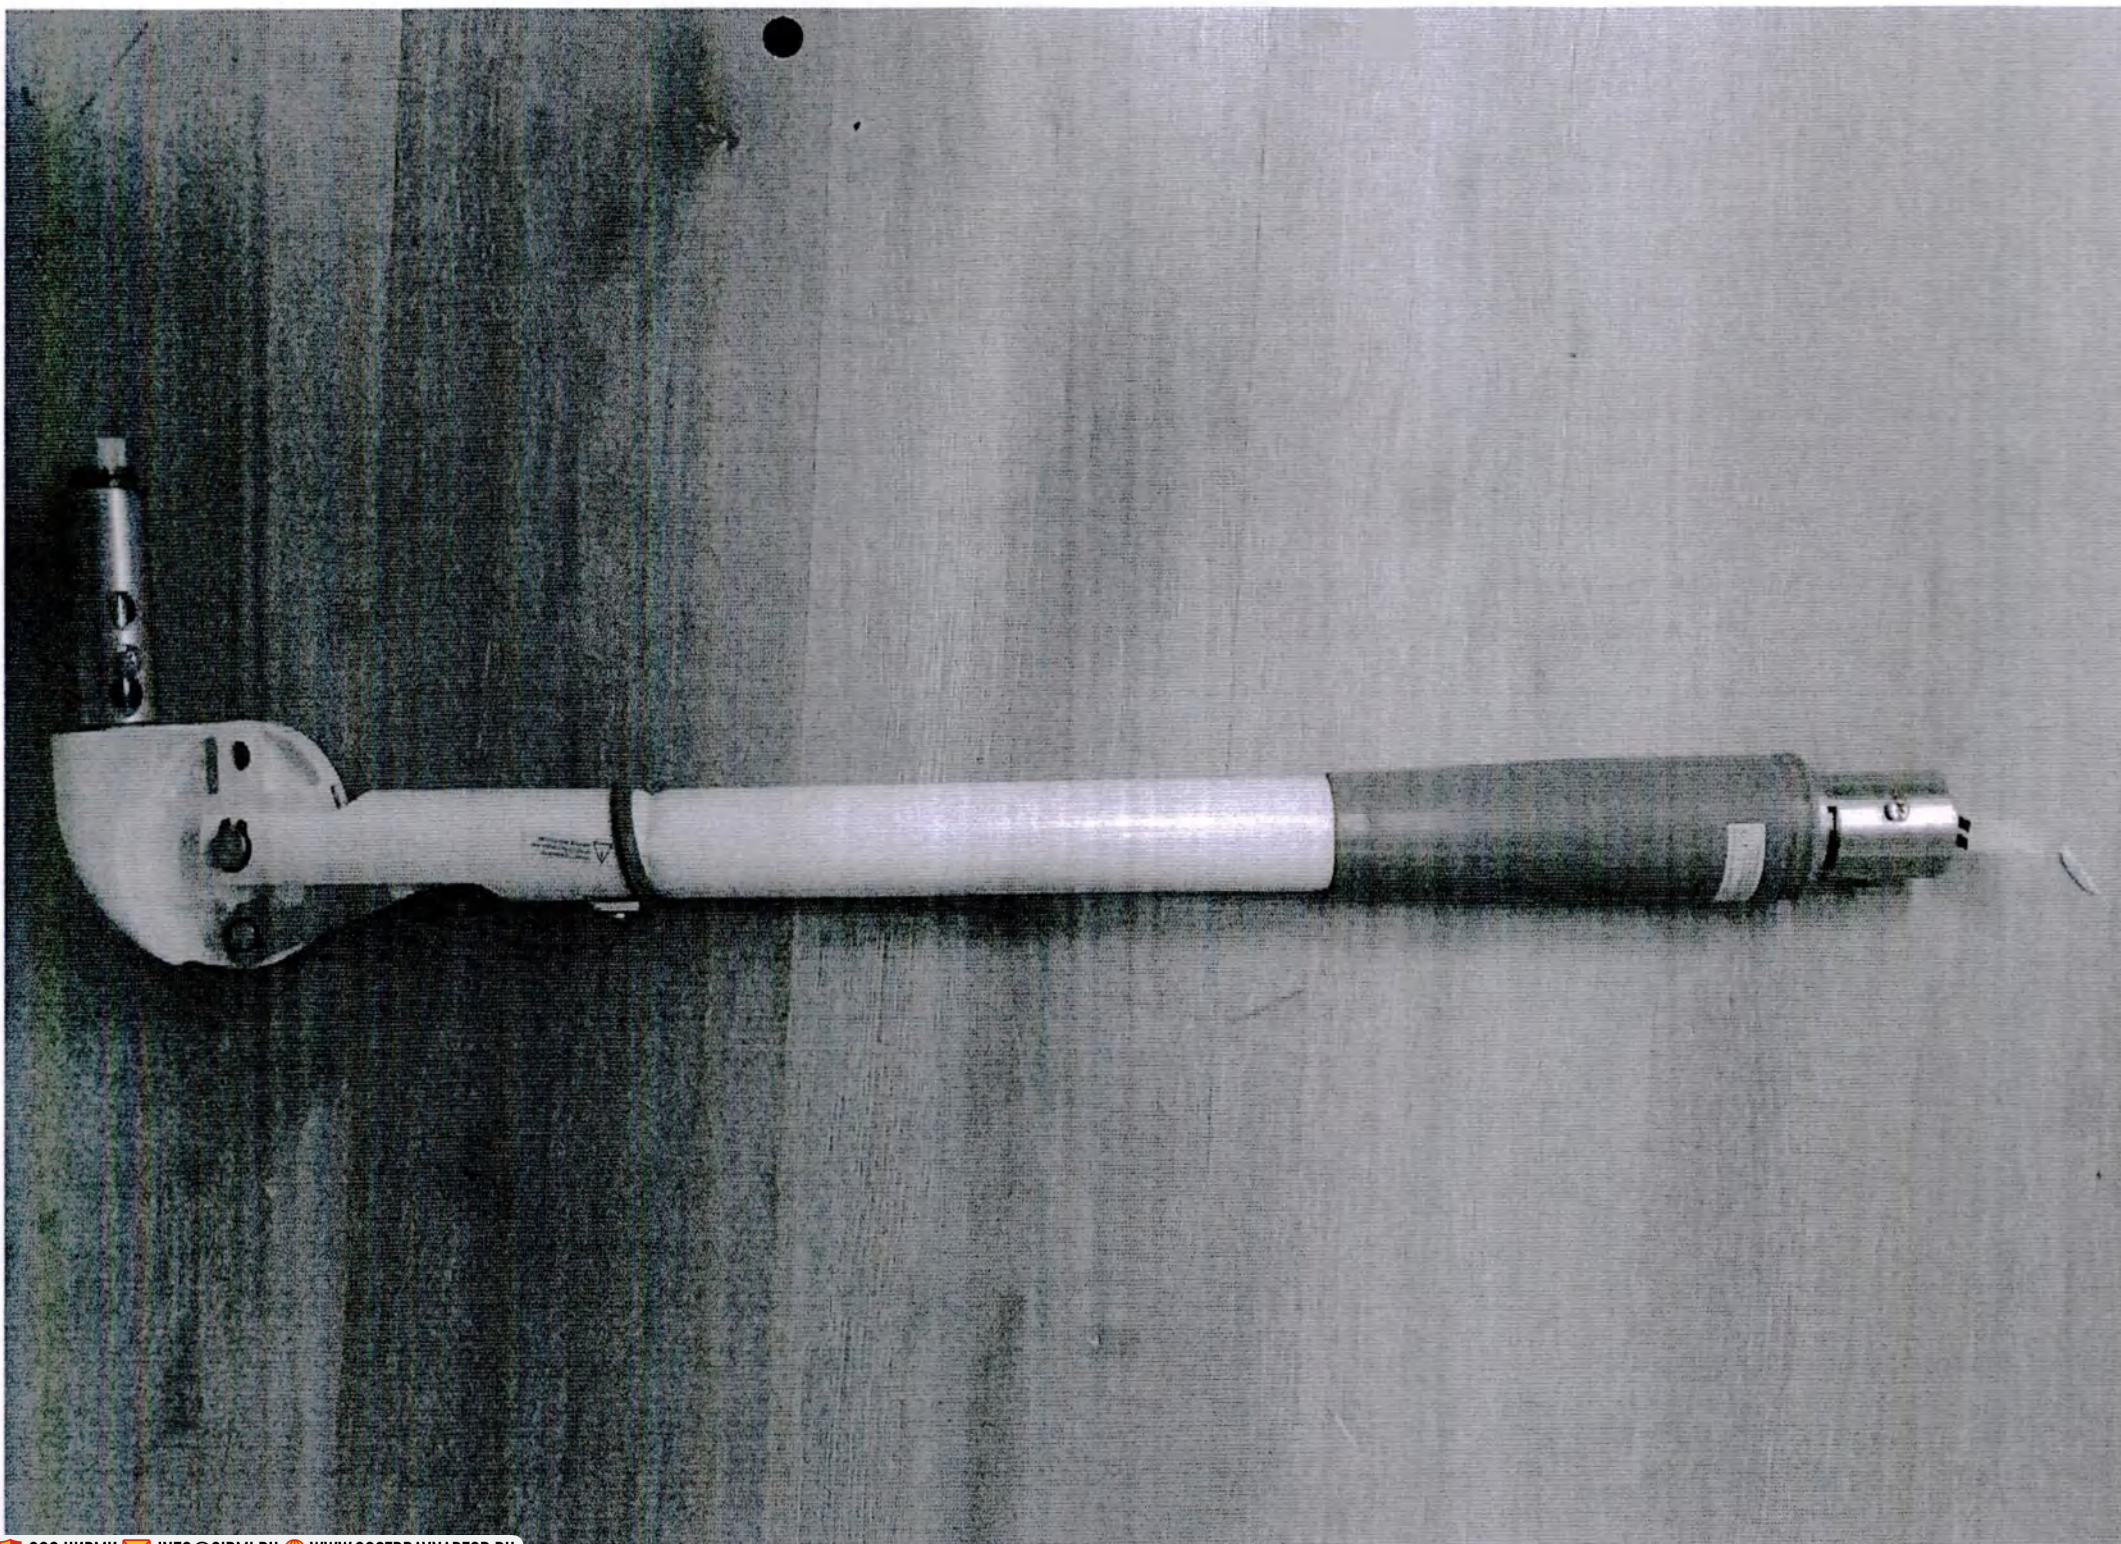


Рис. 2 – Блок освещения



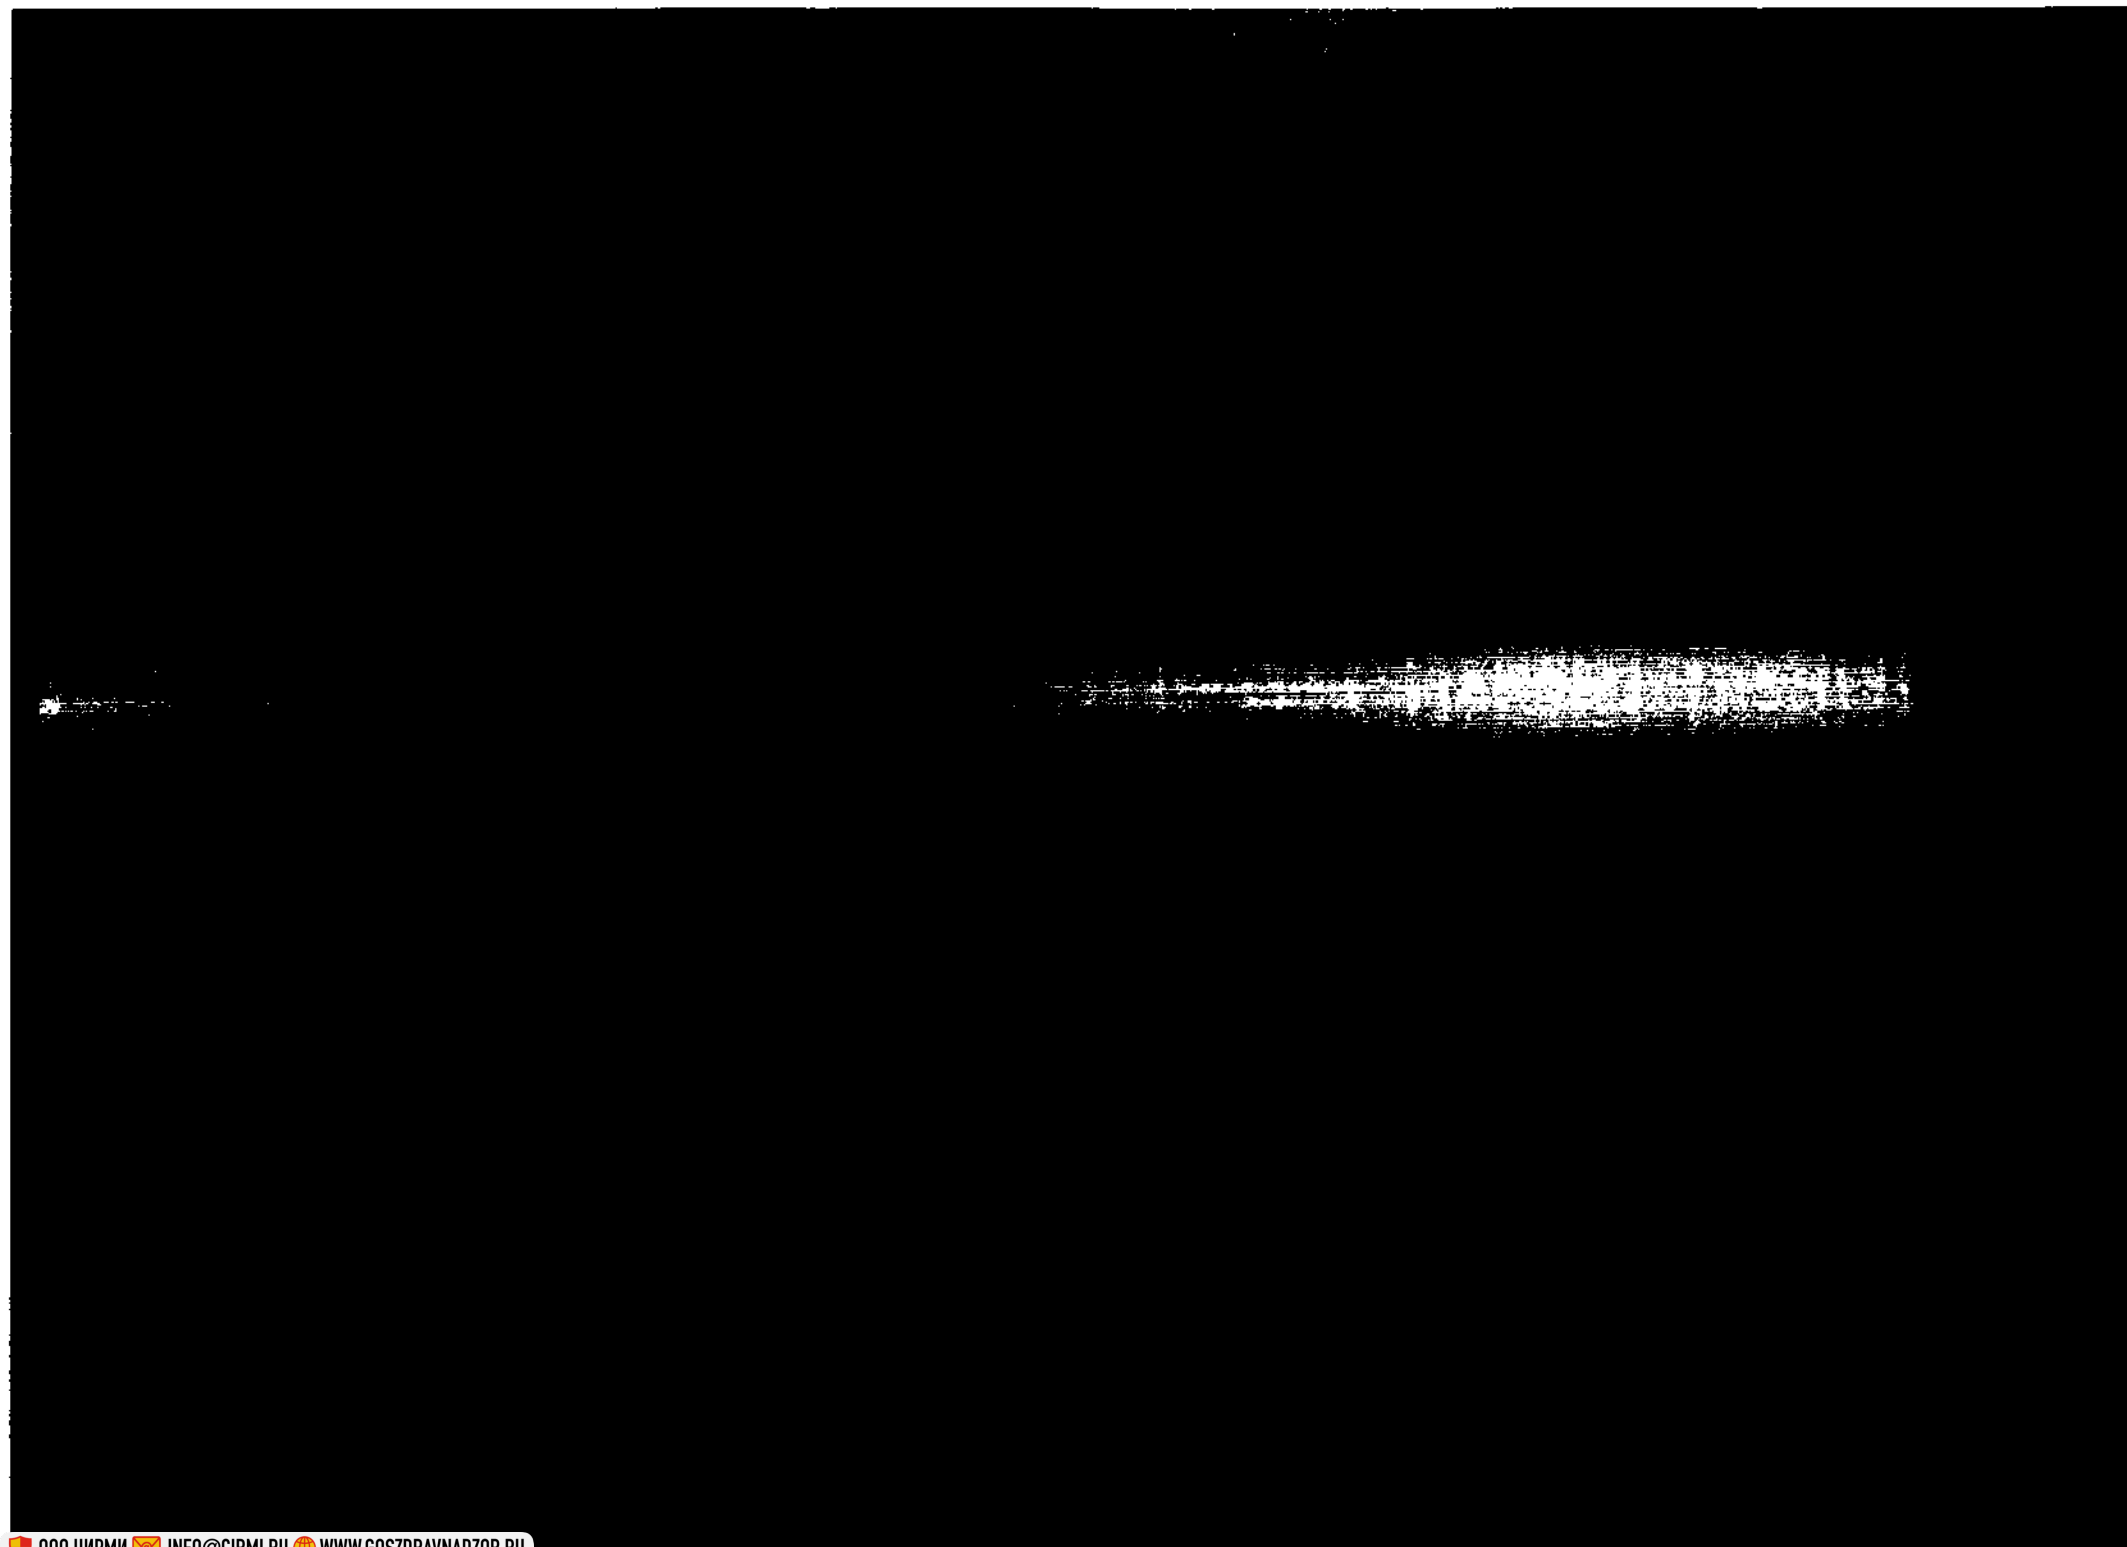
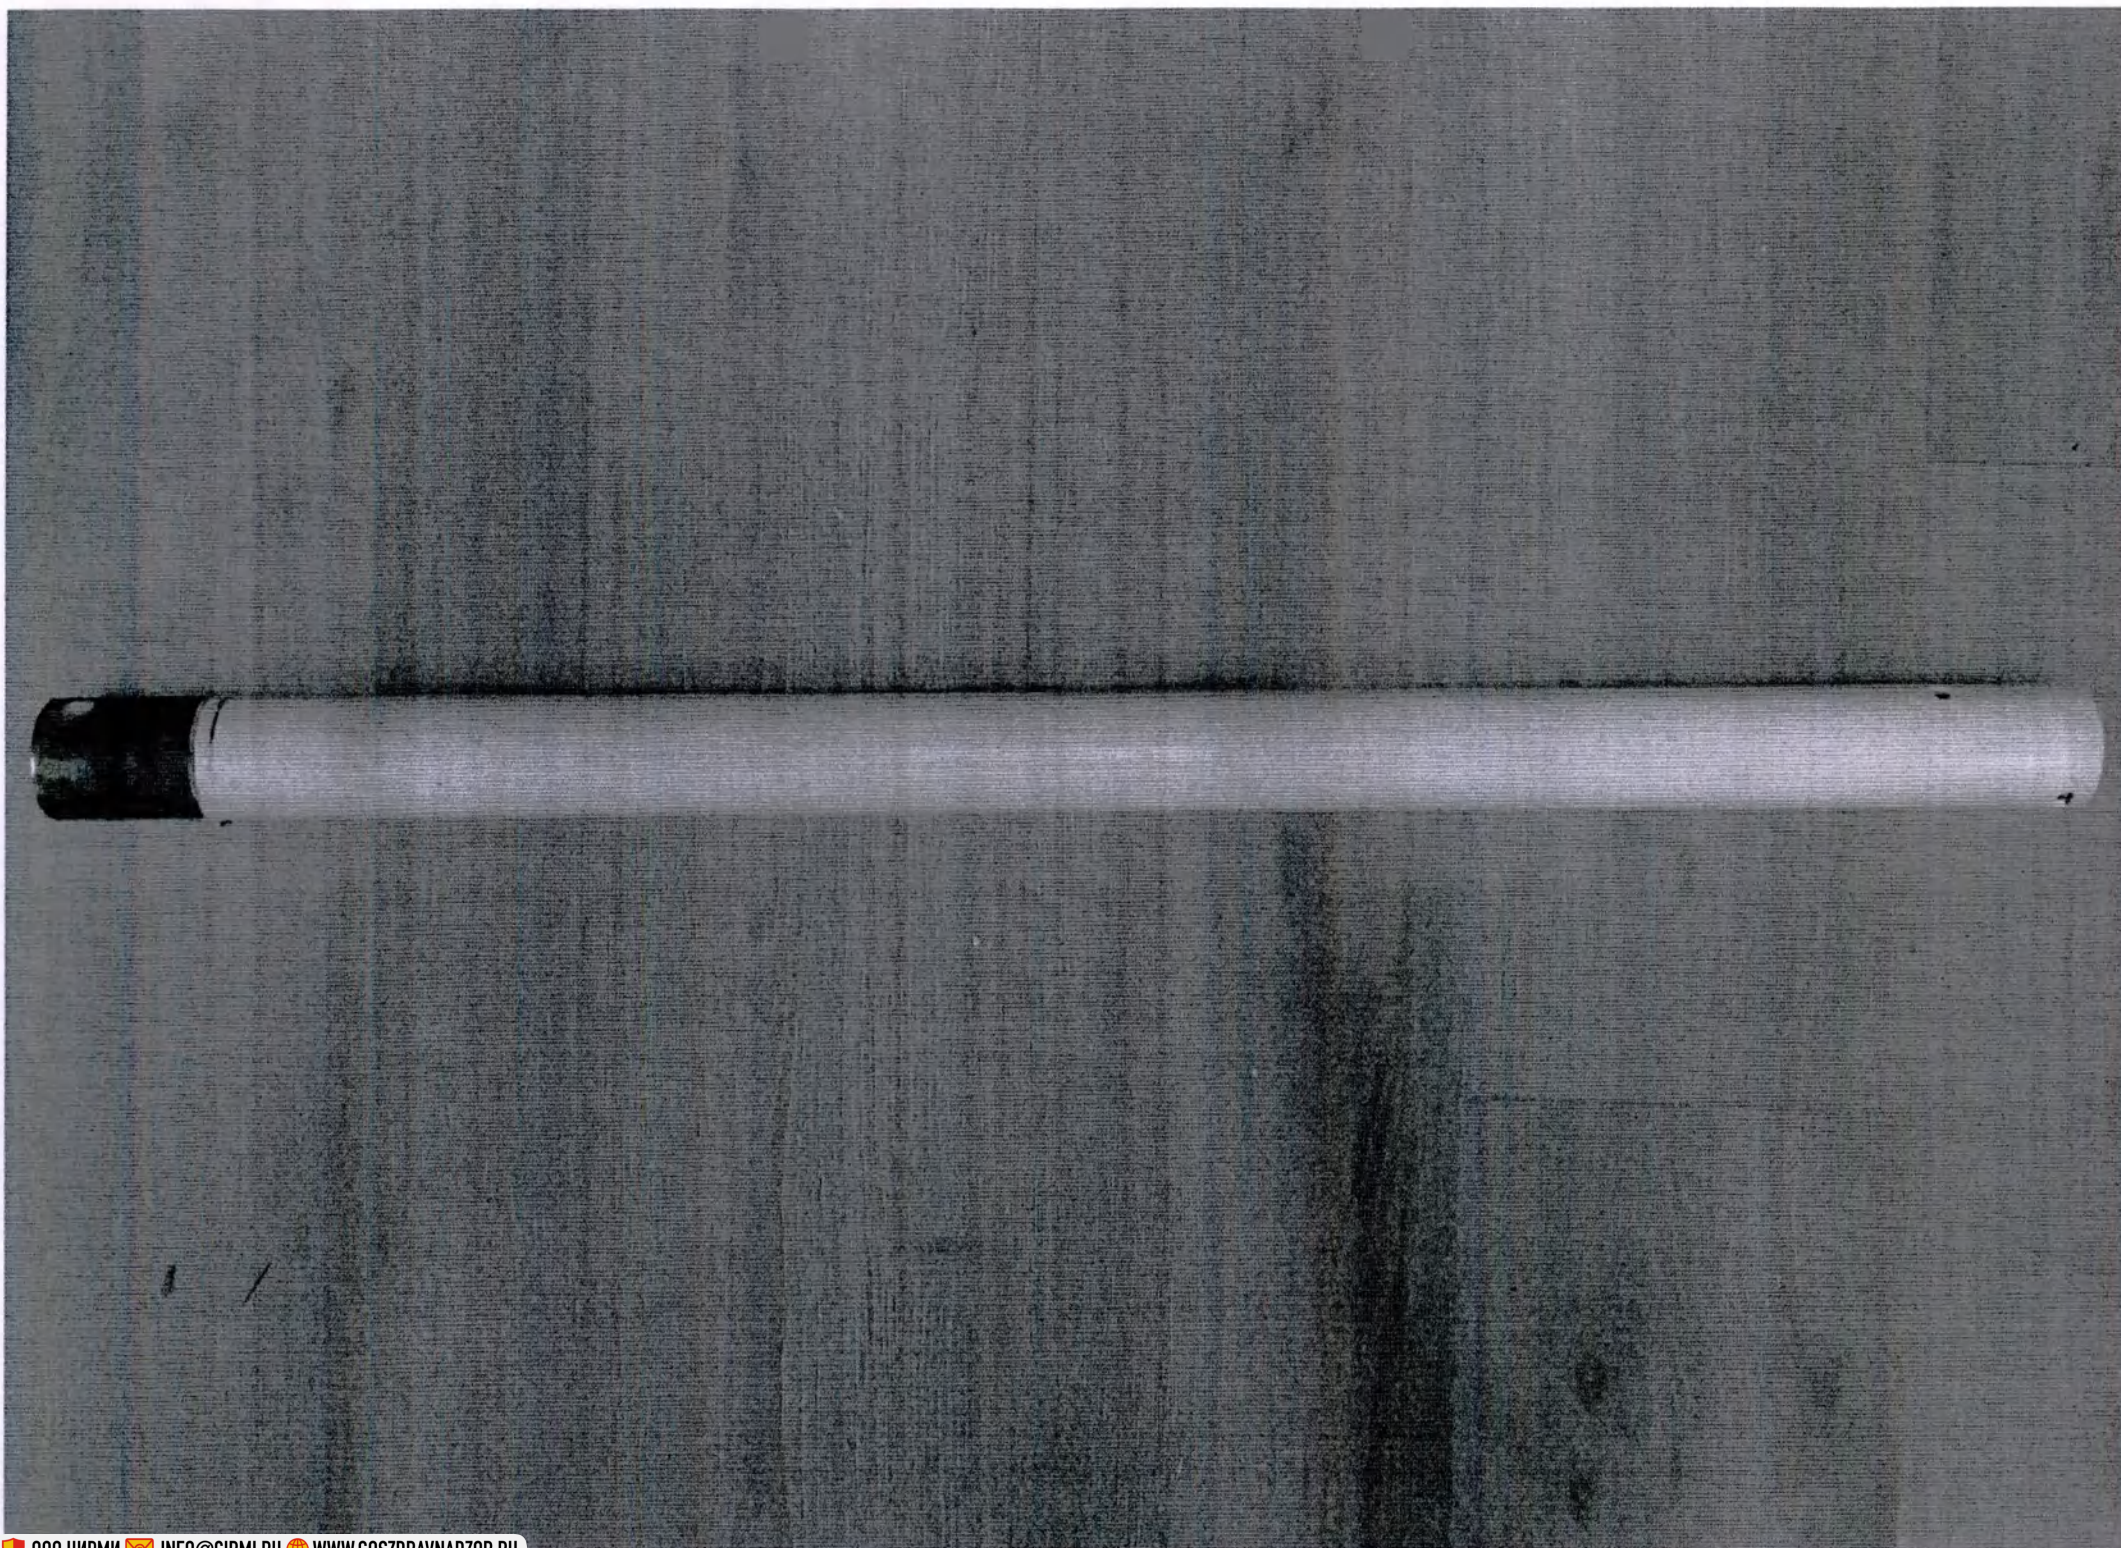


Рис. 4 – Штатив верхний



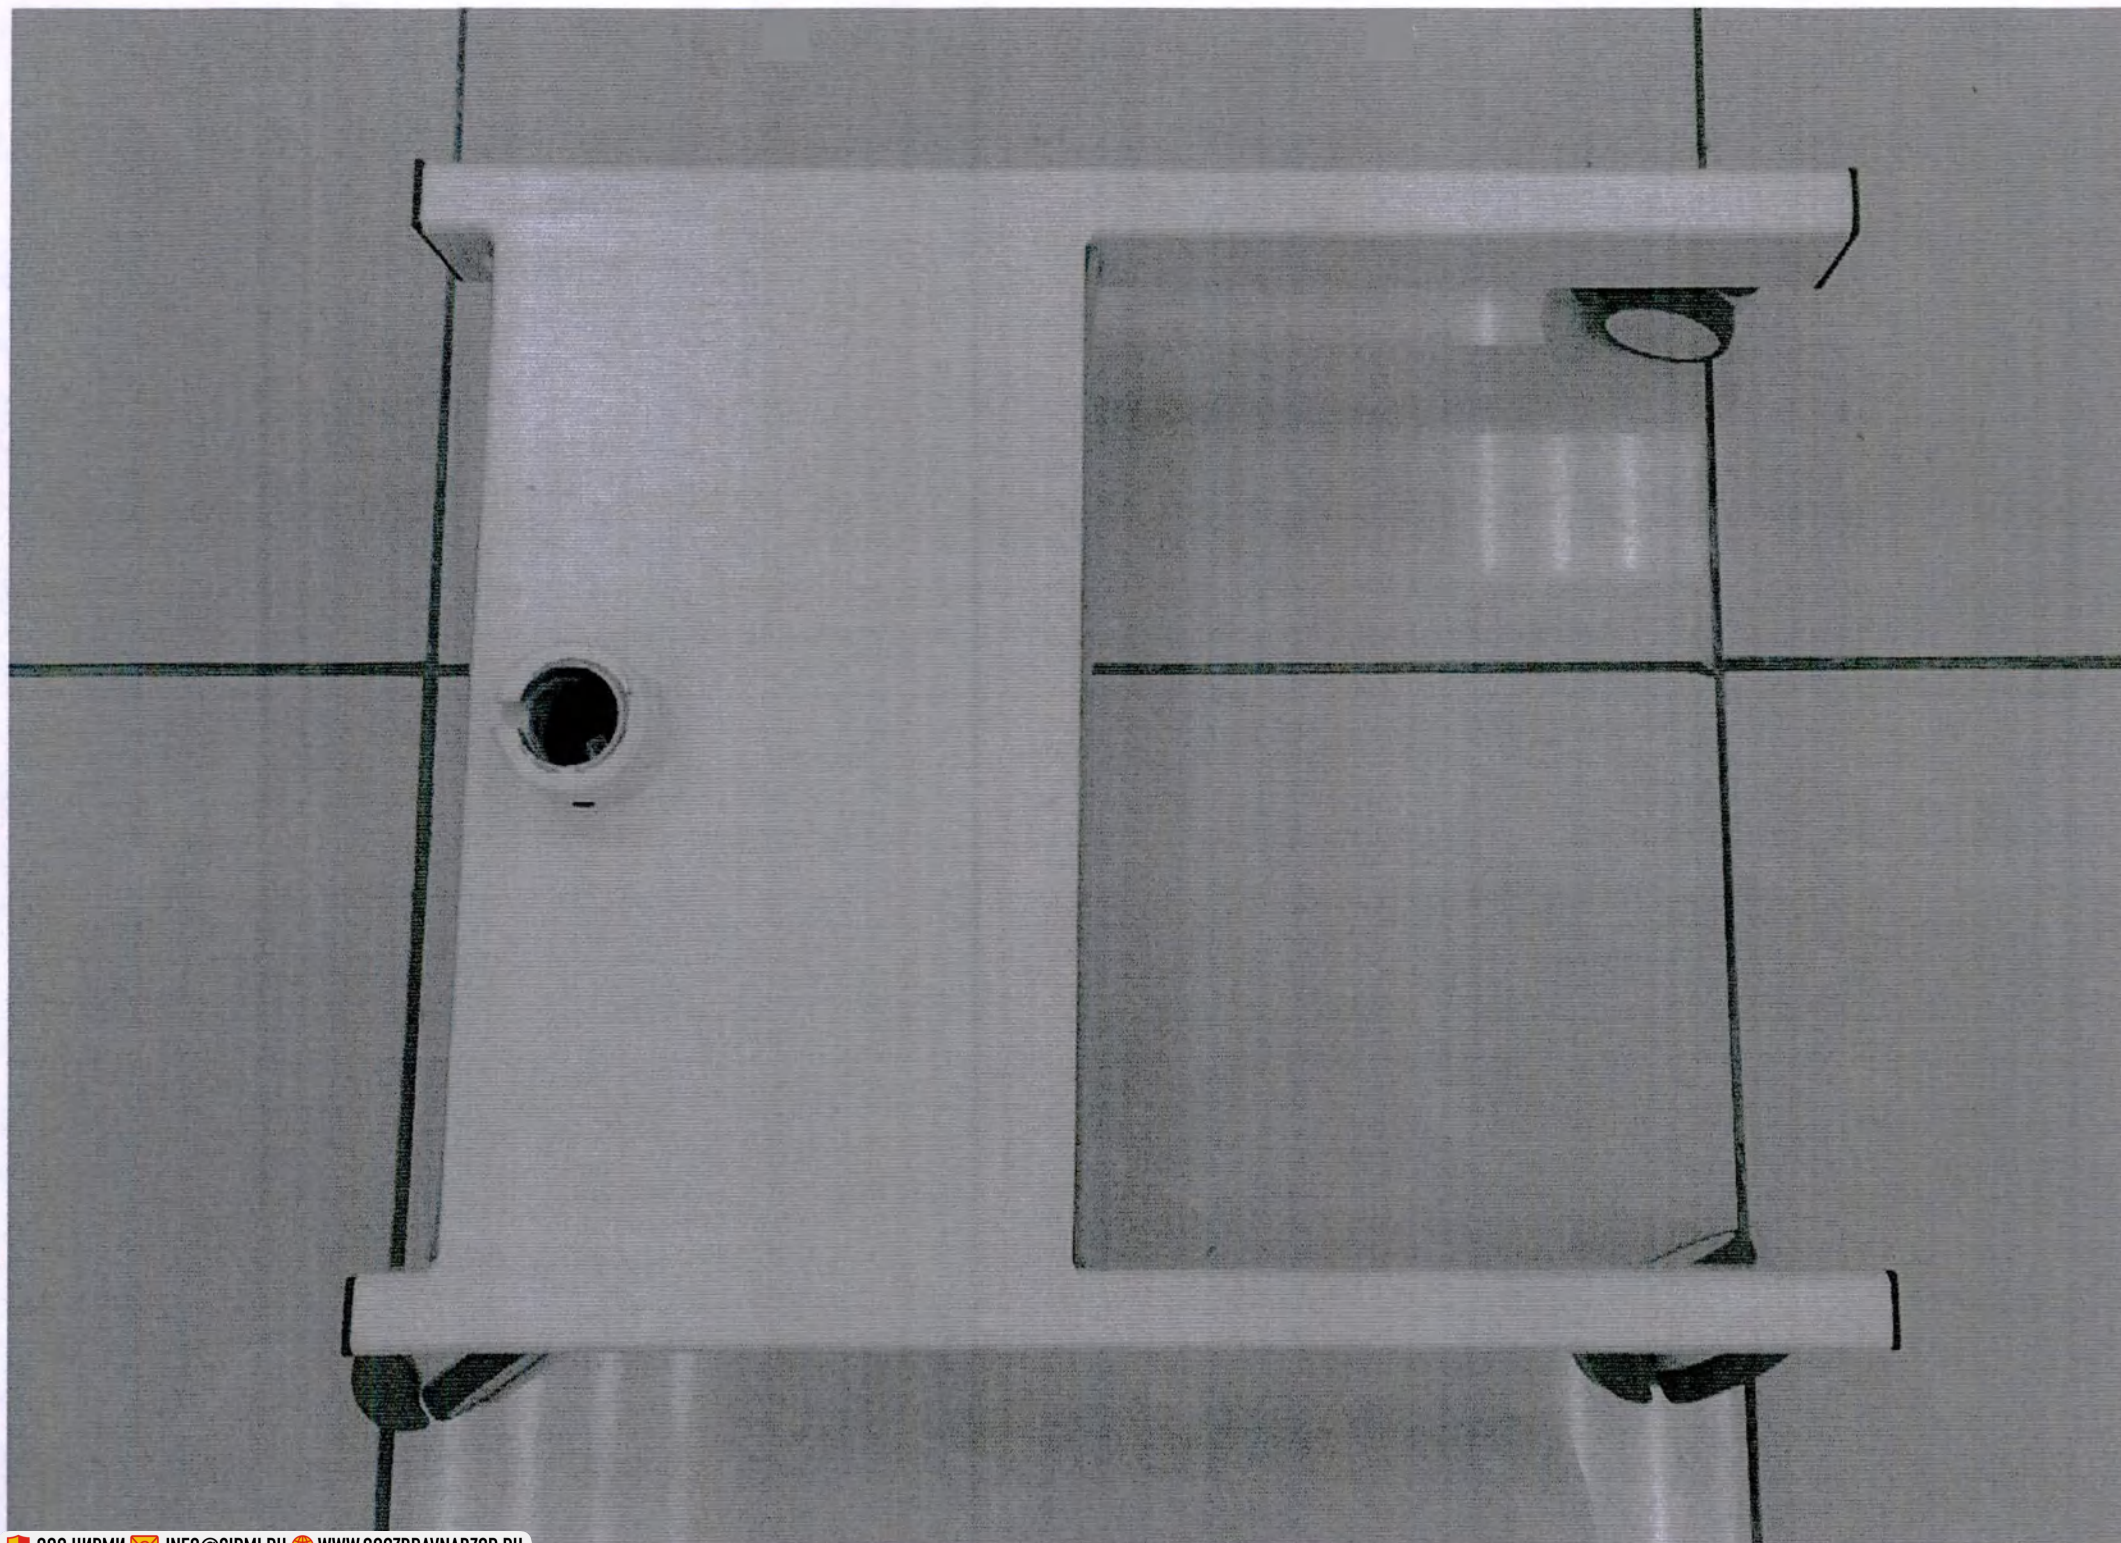


Рис. 6 – Основание с колесами



Рис. 7 – Ручка дугообразная

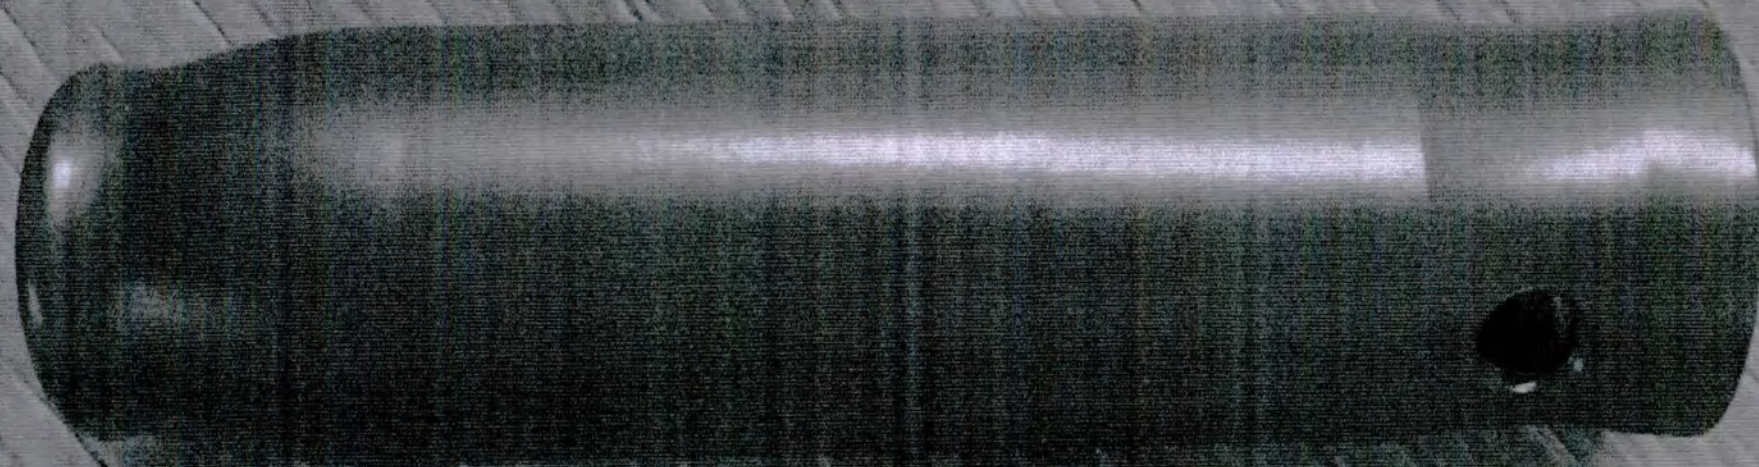


Рис. 8 – Ручка стерилизуемая

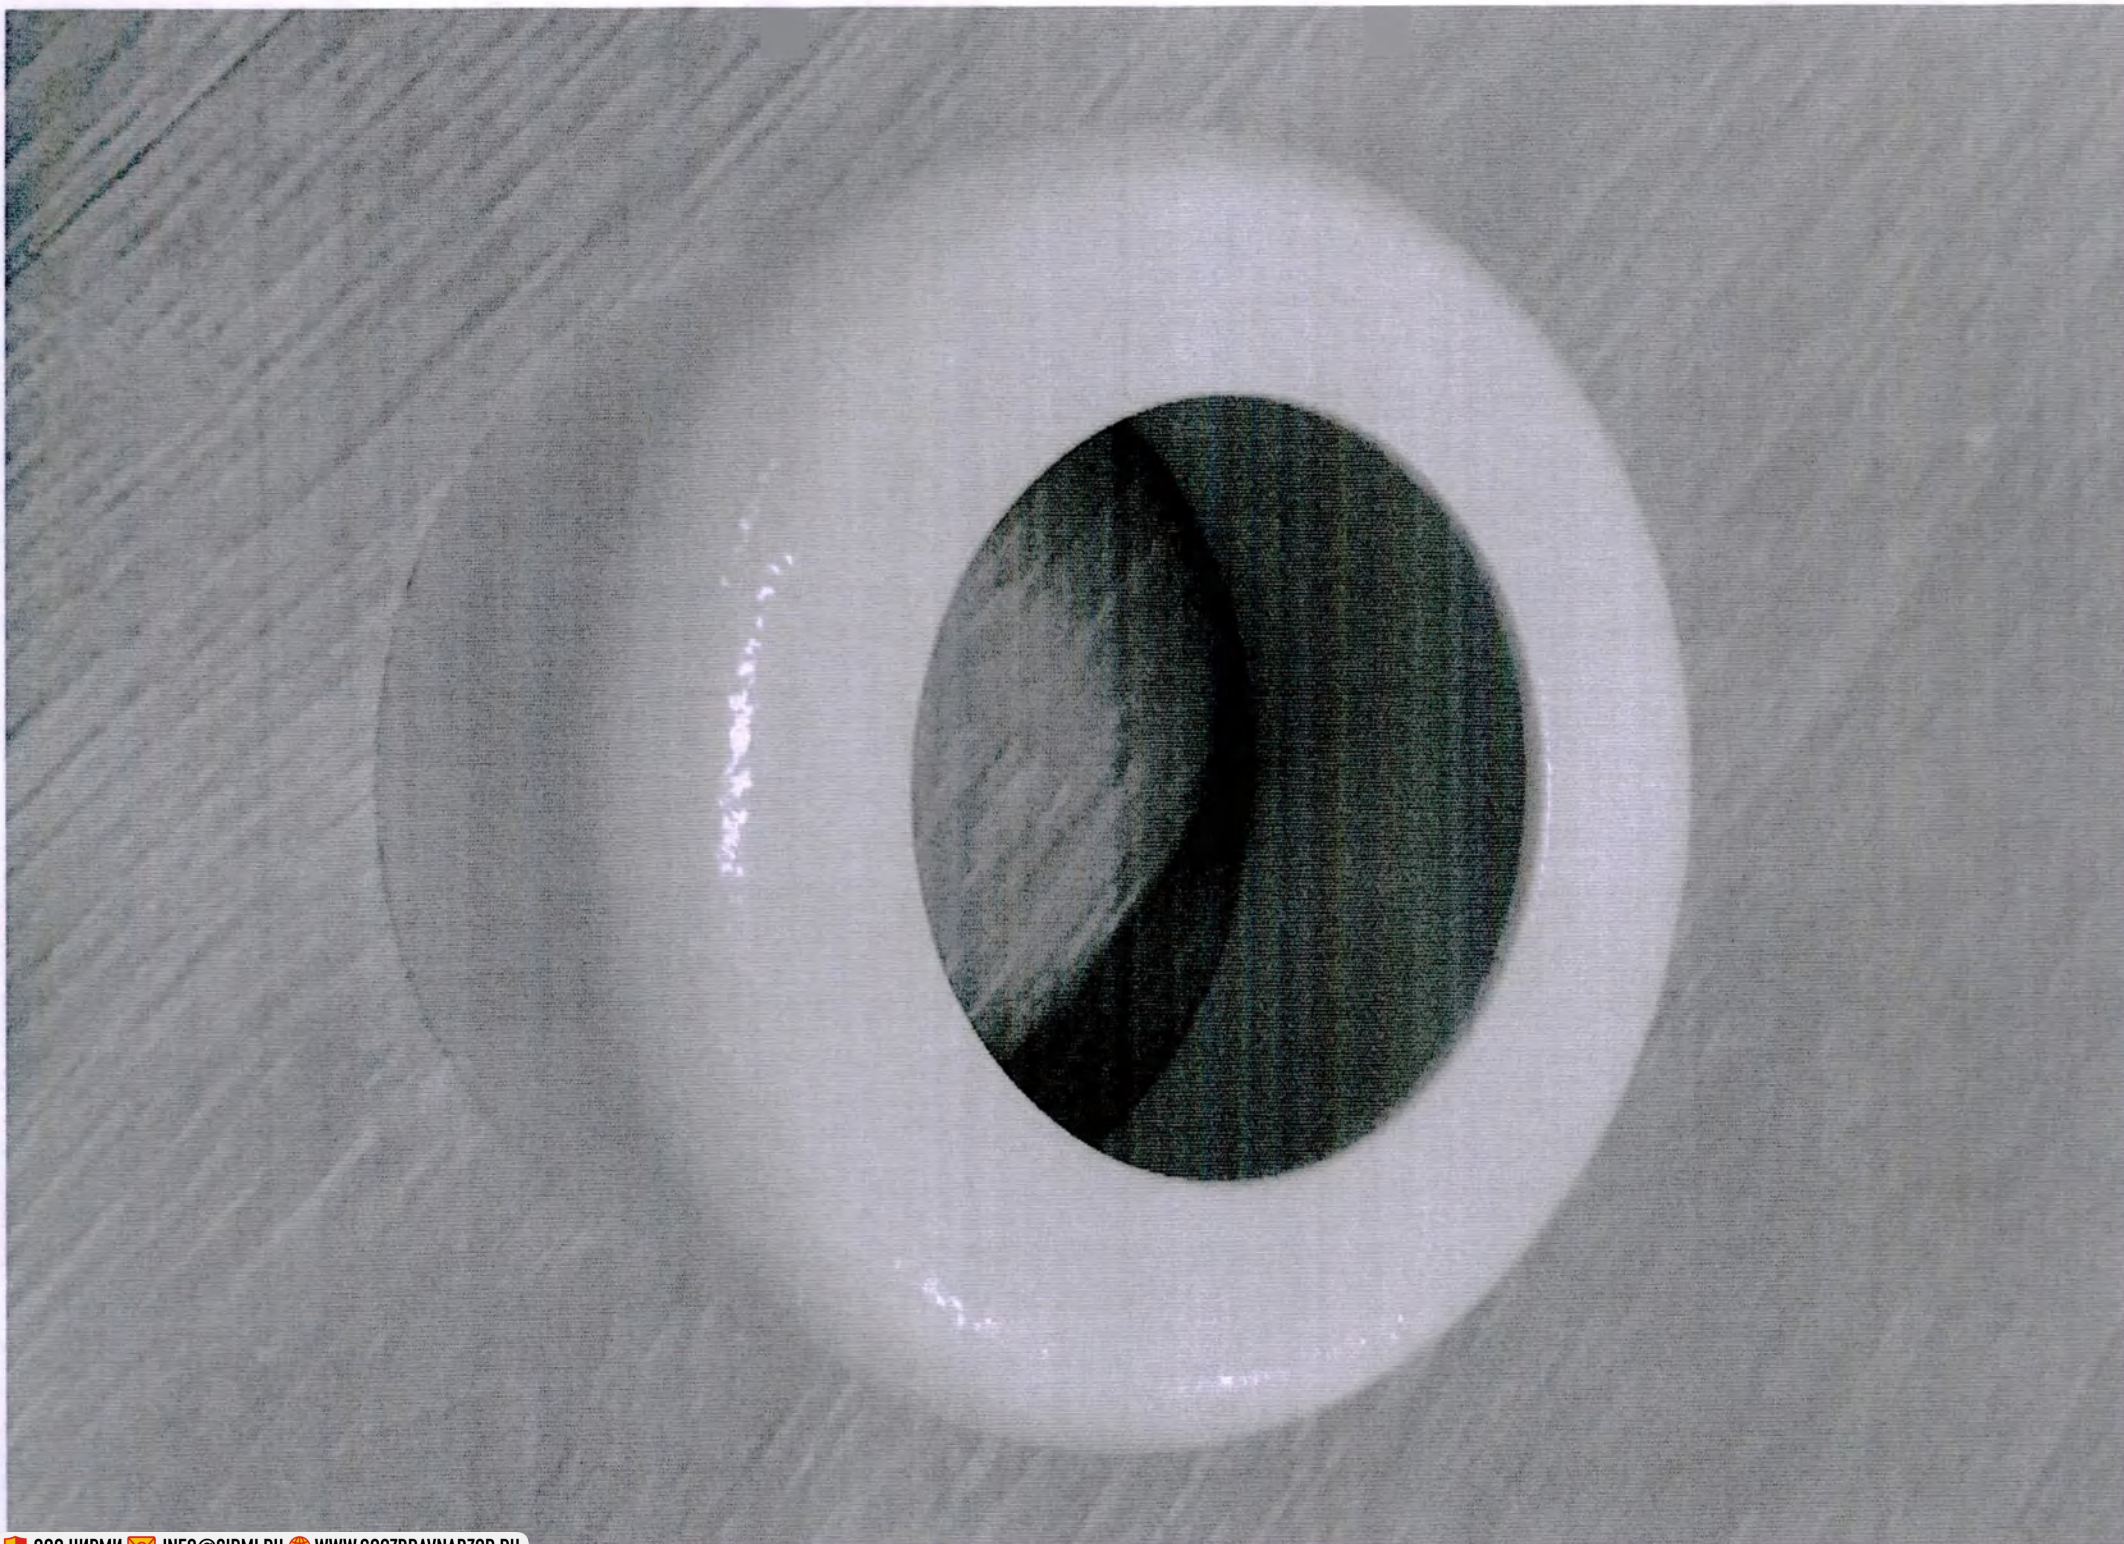


Рис. 9 – Муфта основания декоративная

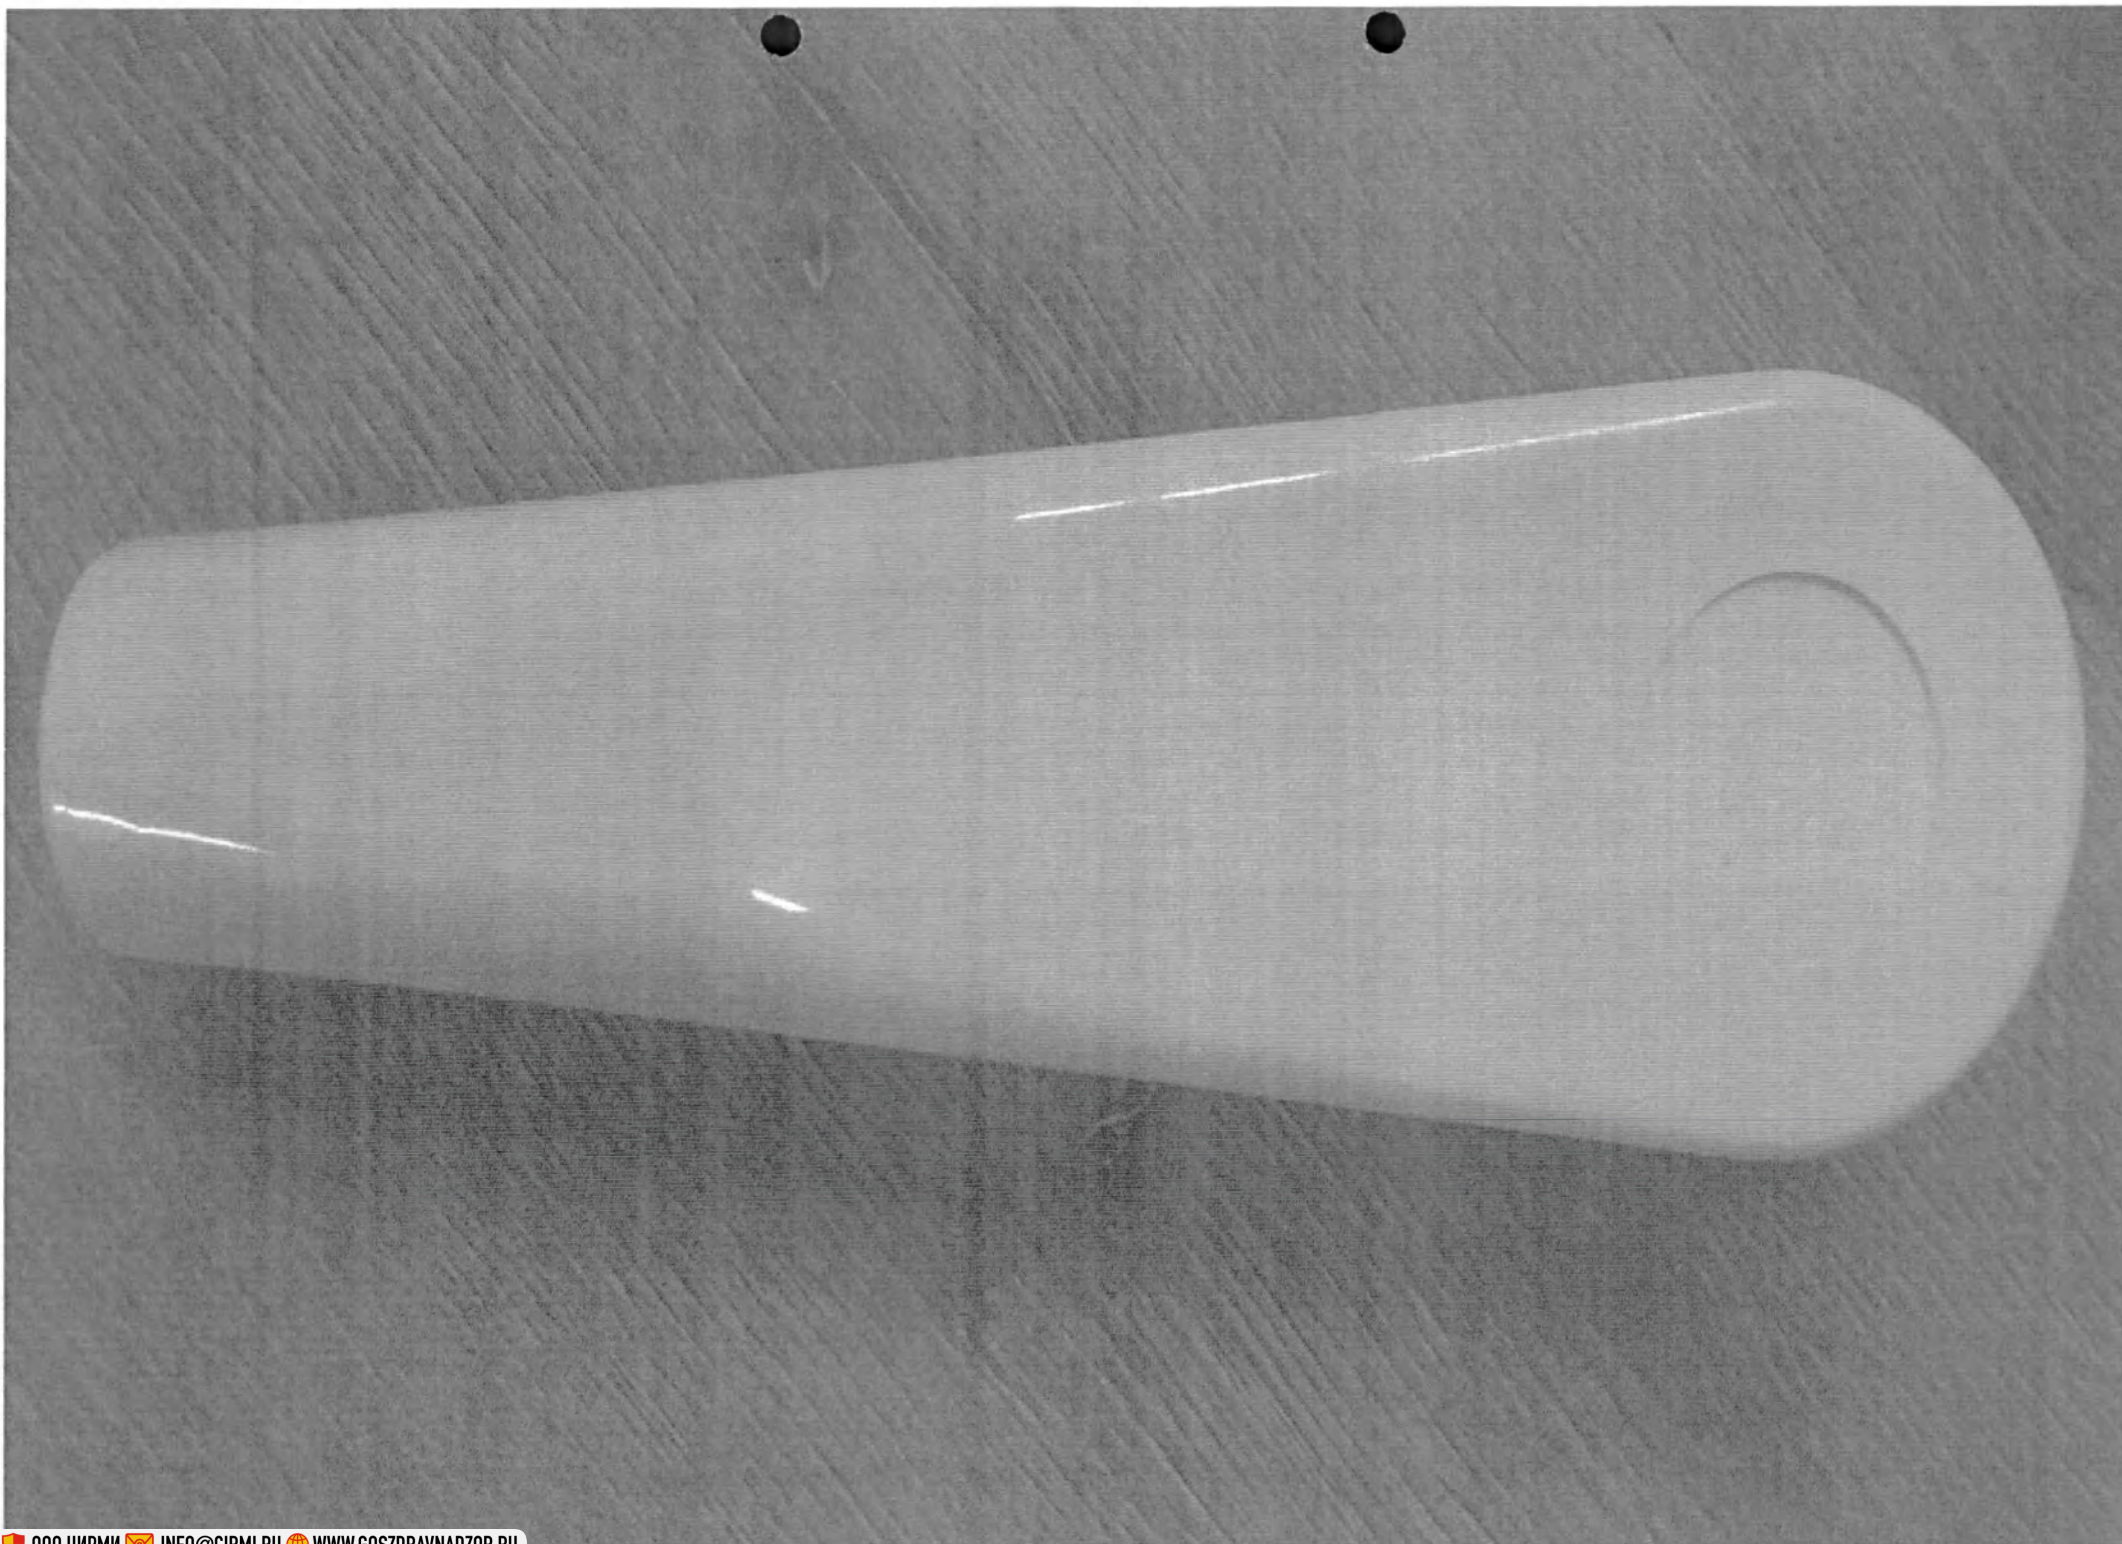


Рис. 10 – Кожух плеча декоративный





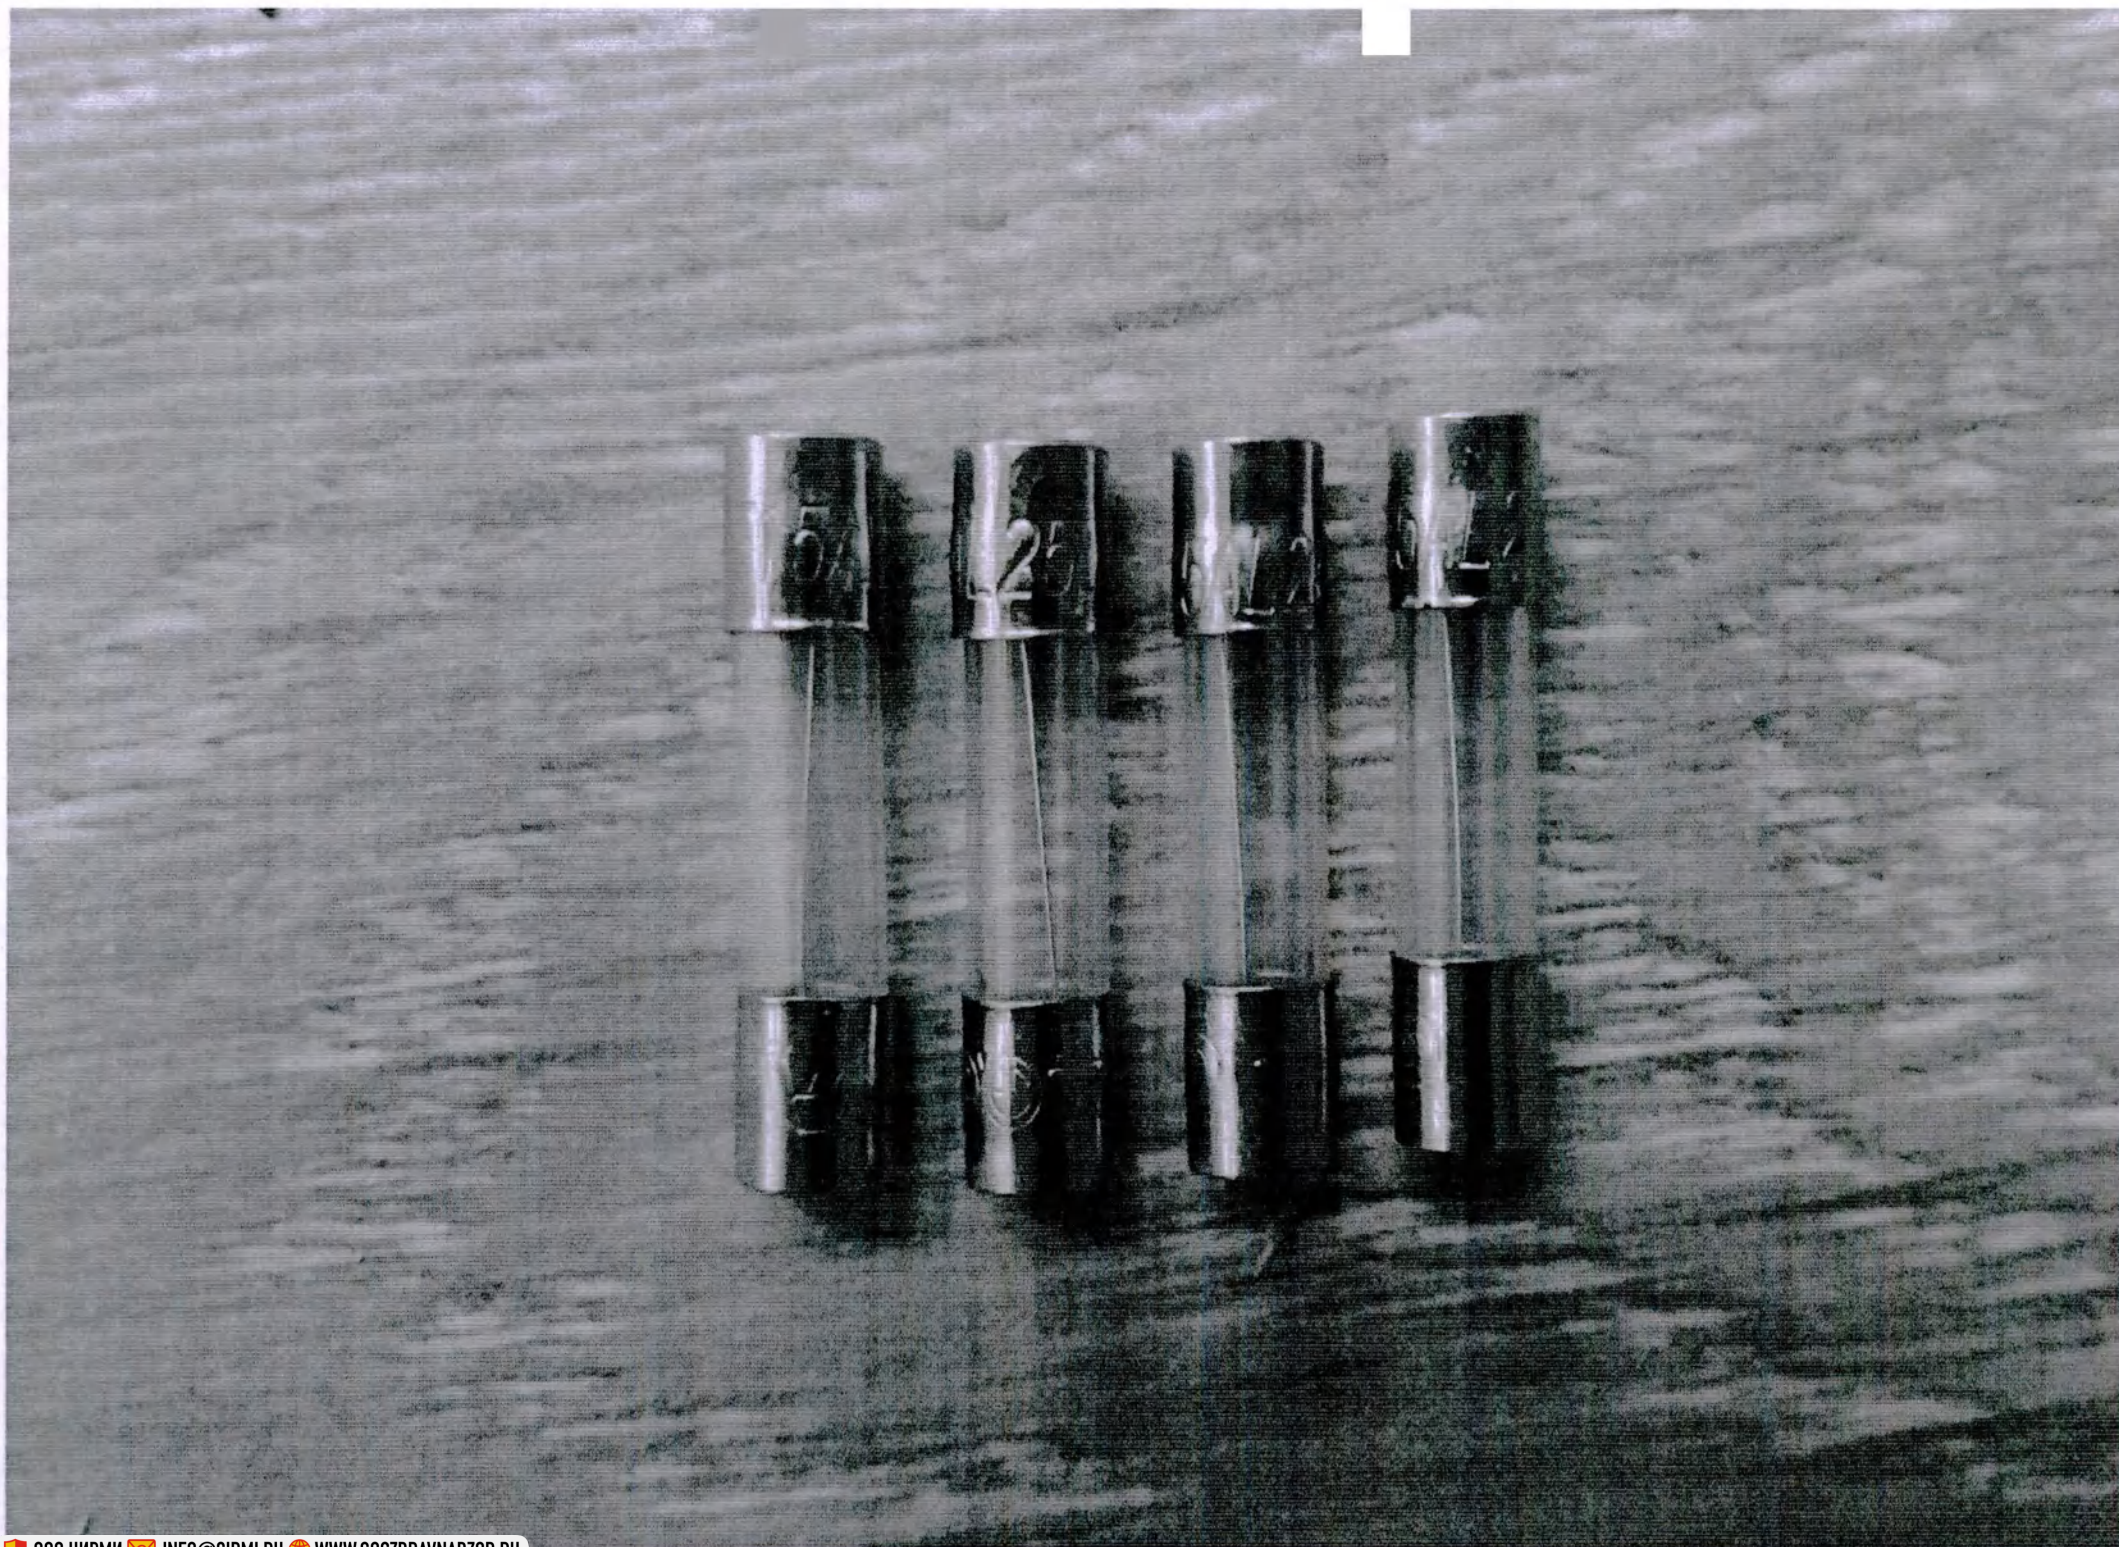


Рис. 13 – Предохранитель плавкий F1.5AL250V запасной (4 шт.)



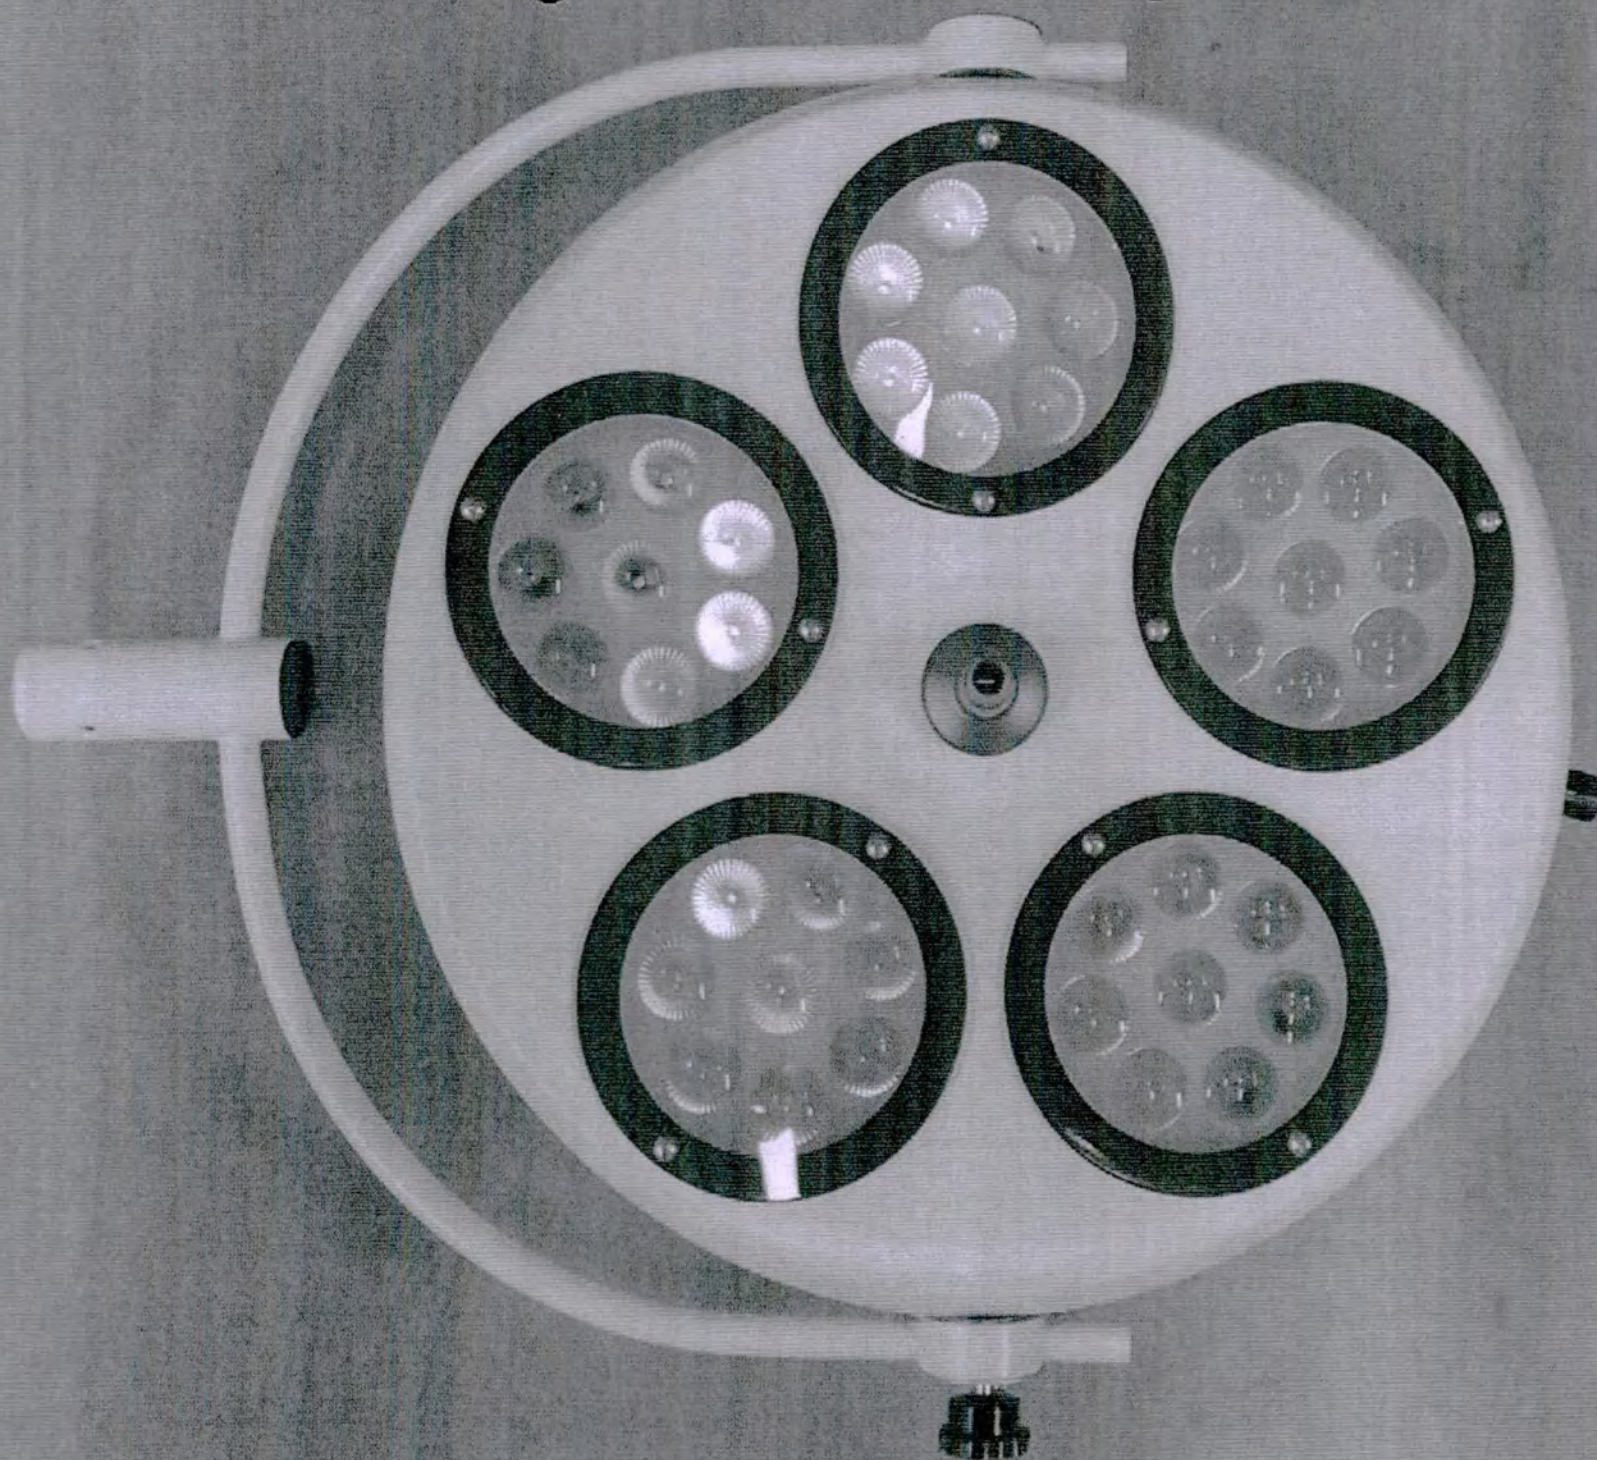
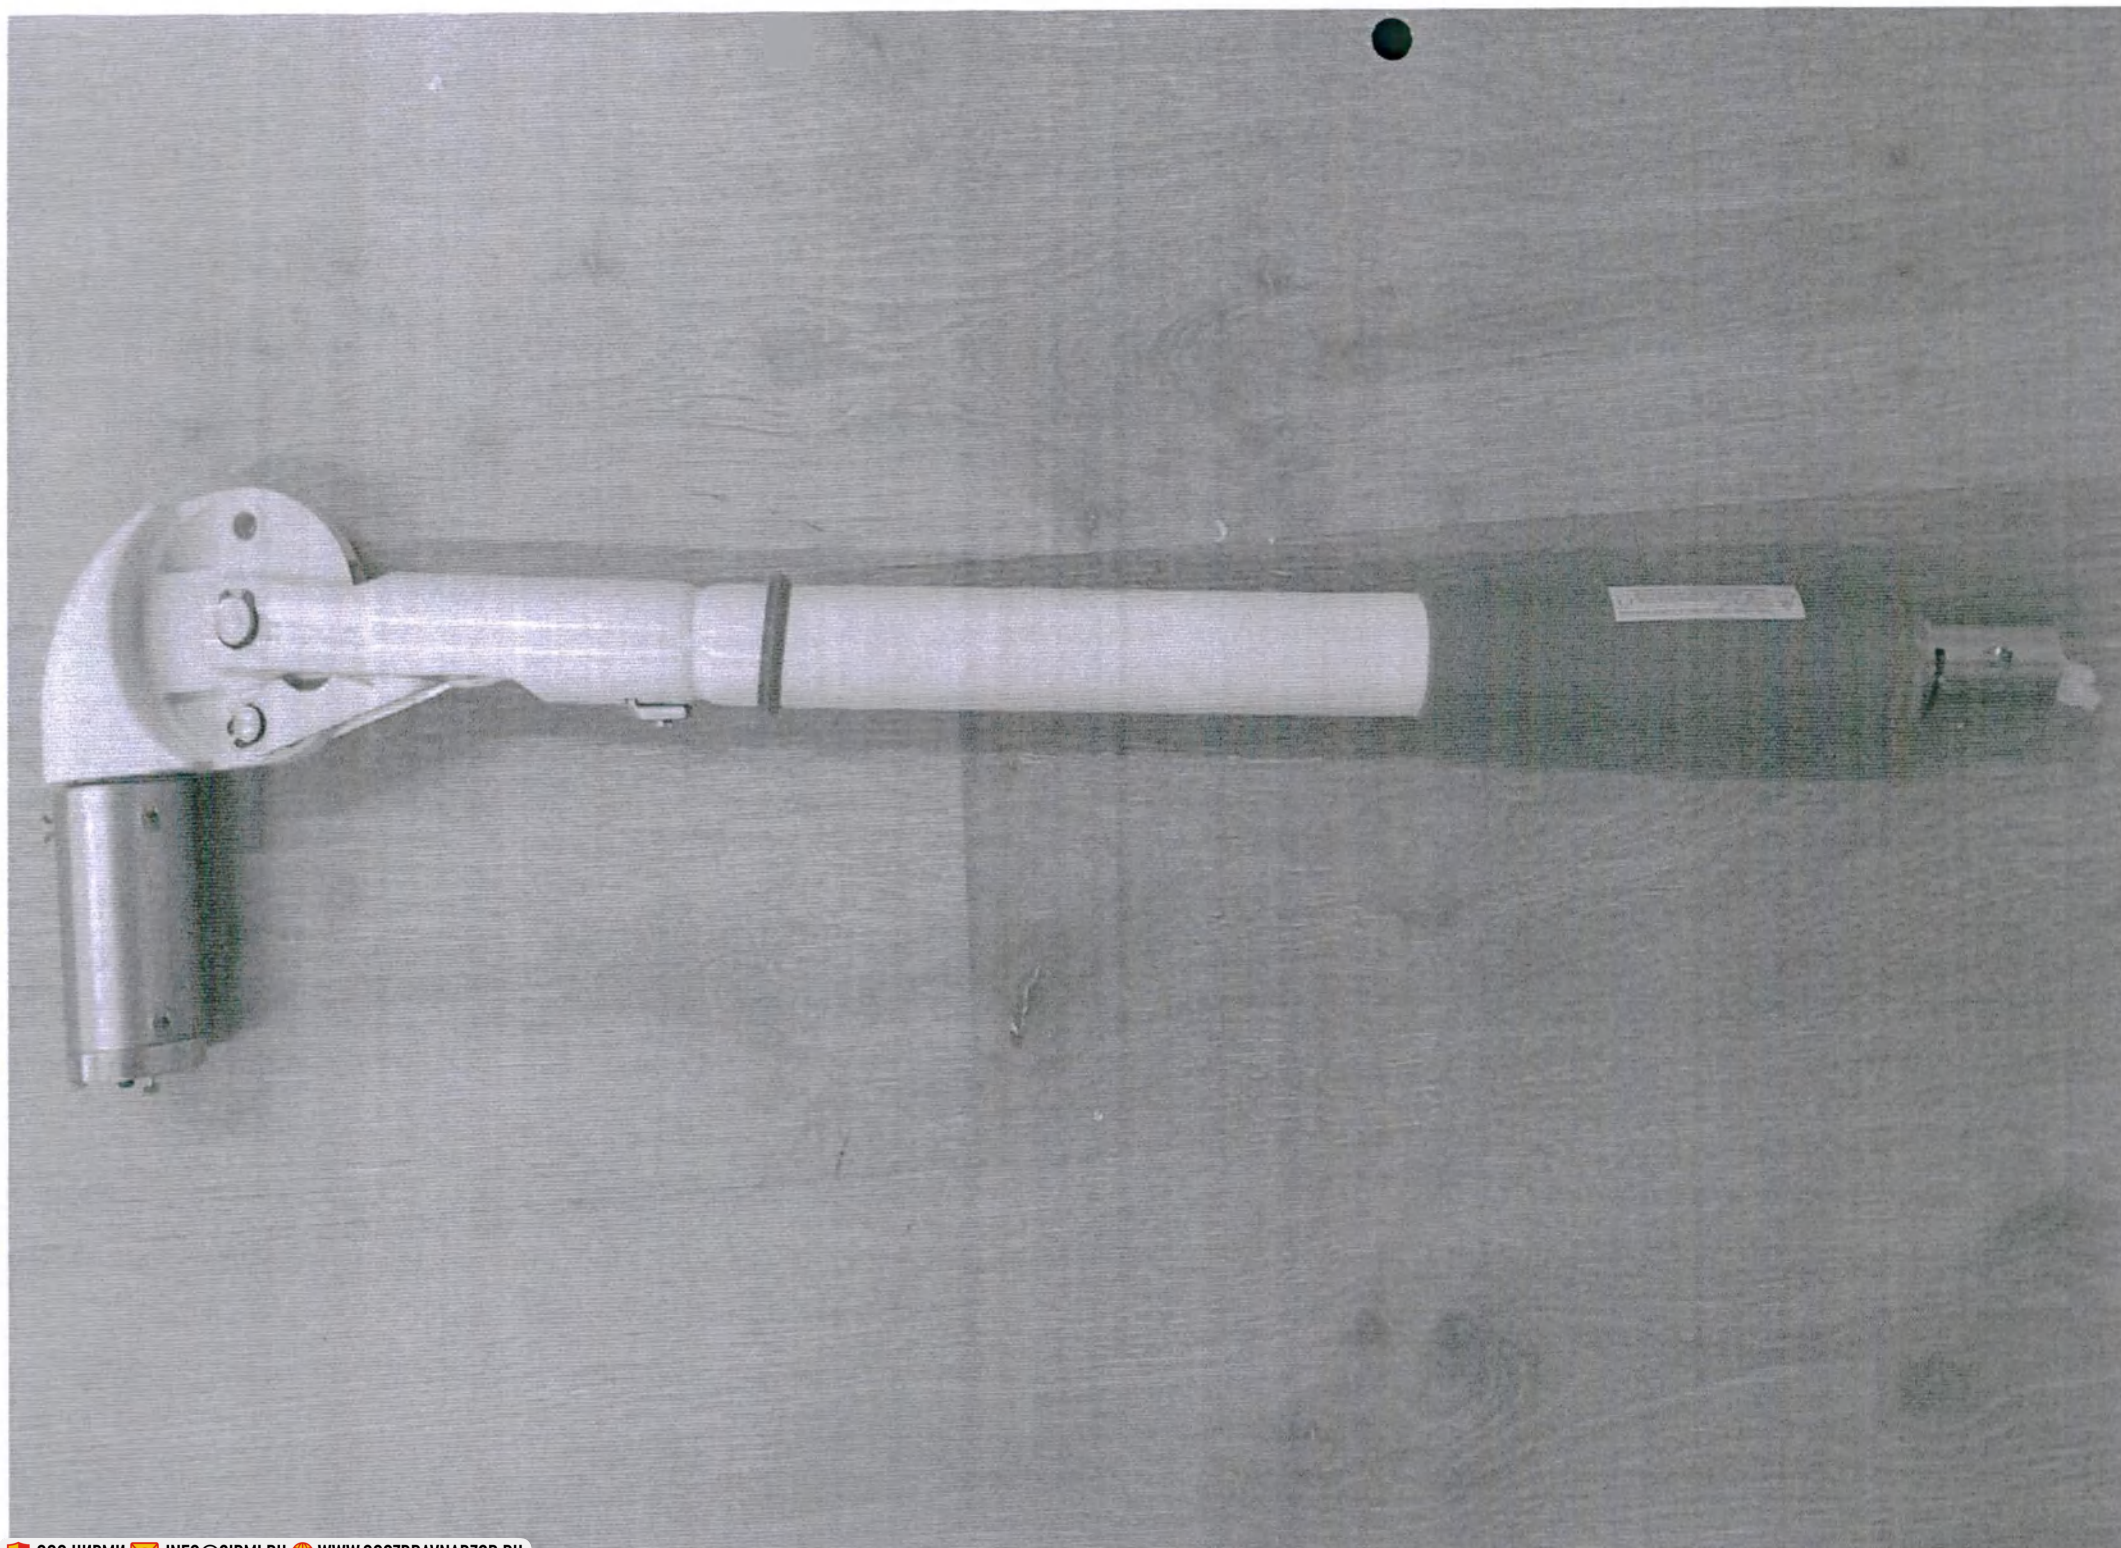


Рис. 15 – Блок освещения



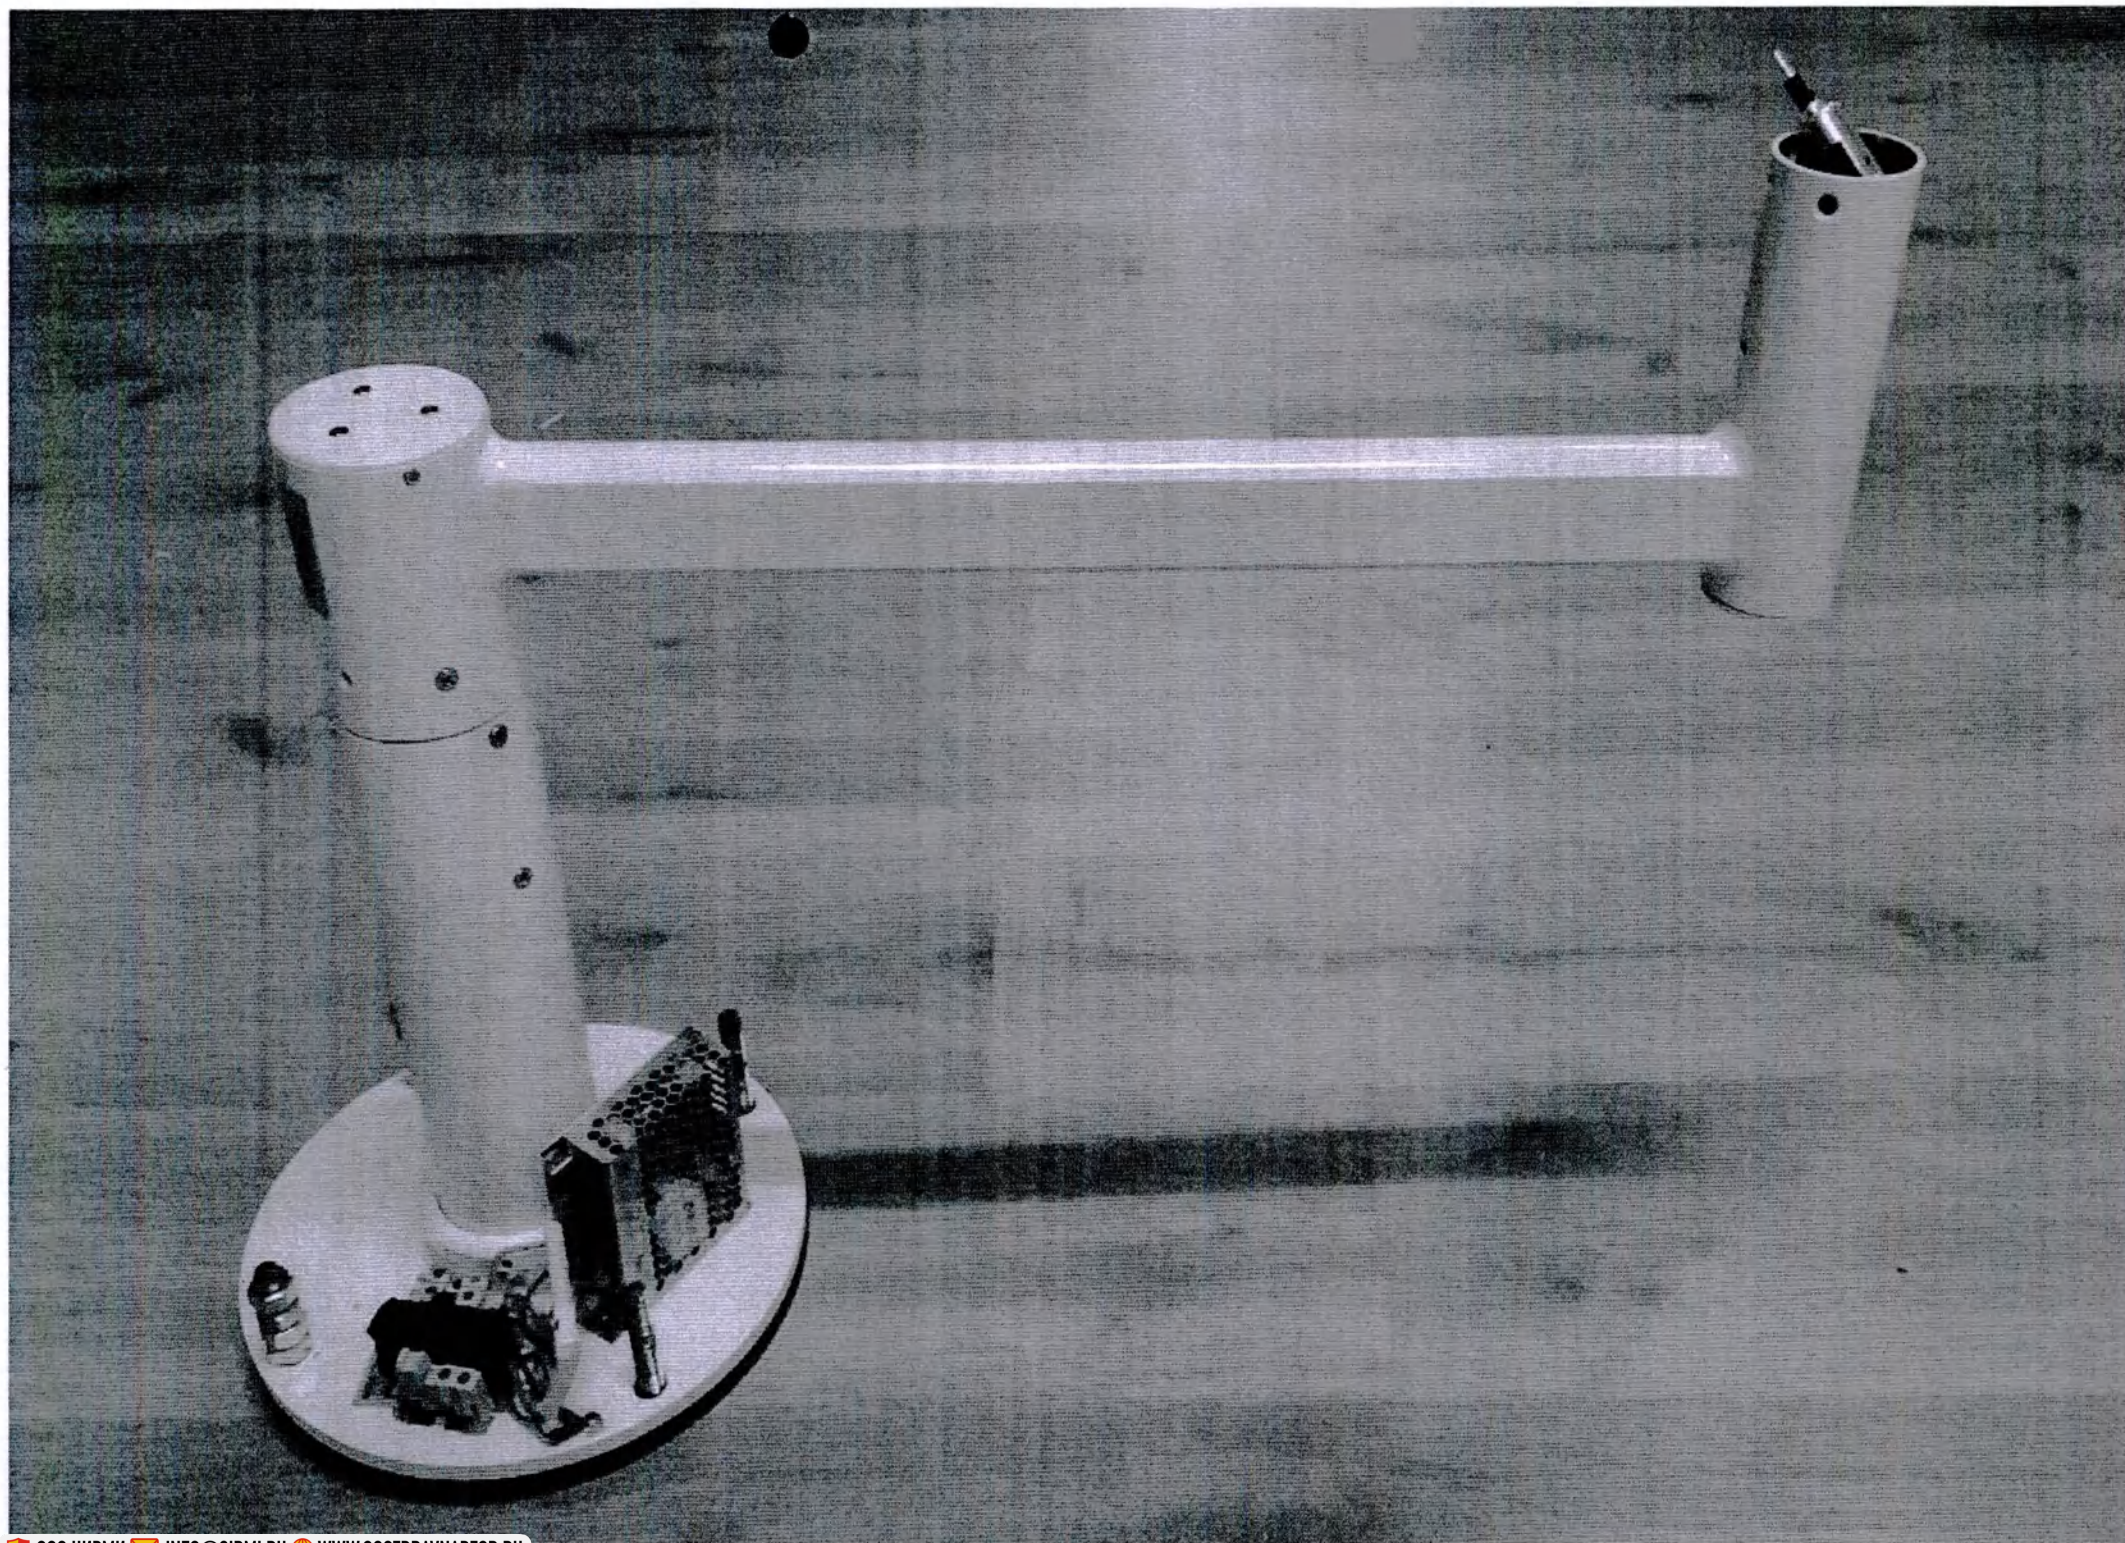


Рис. 17 – Блок установочный с одним горизонтальным плечом

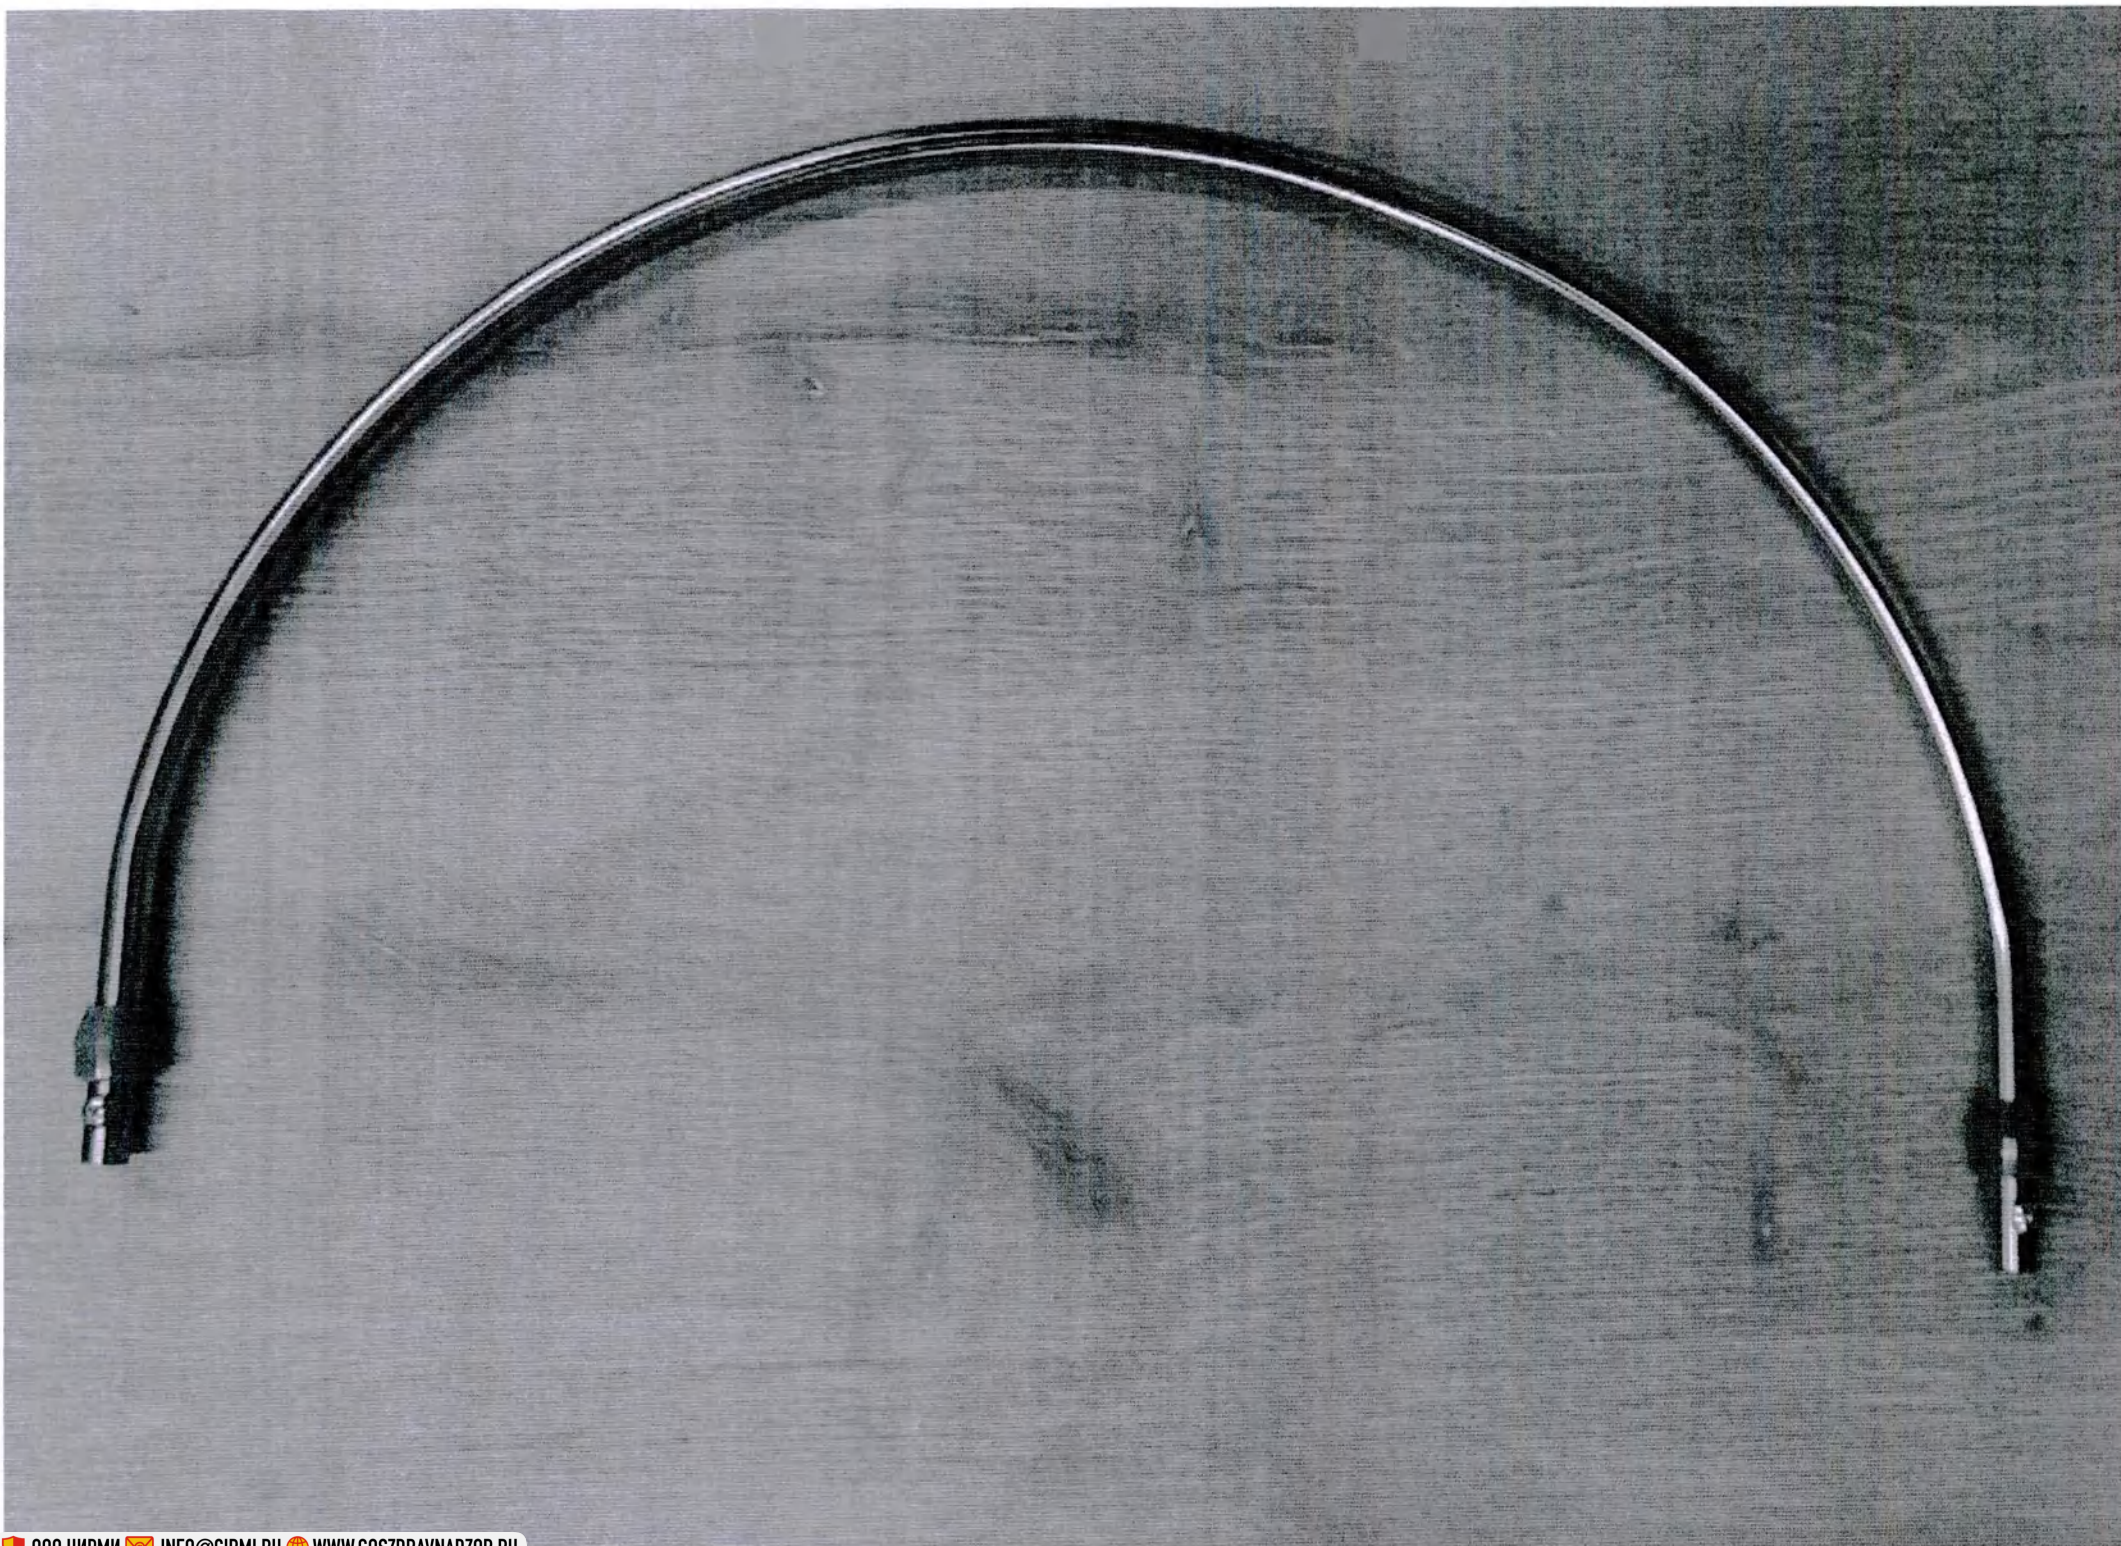


Рис. 18 – Ручка дугообразная

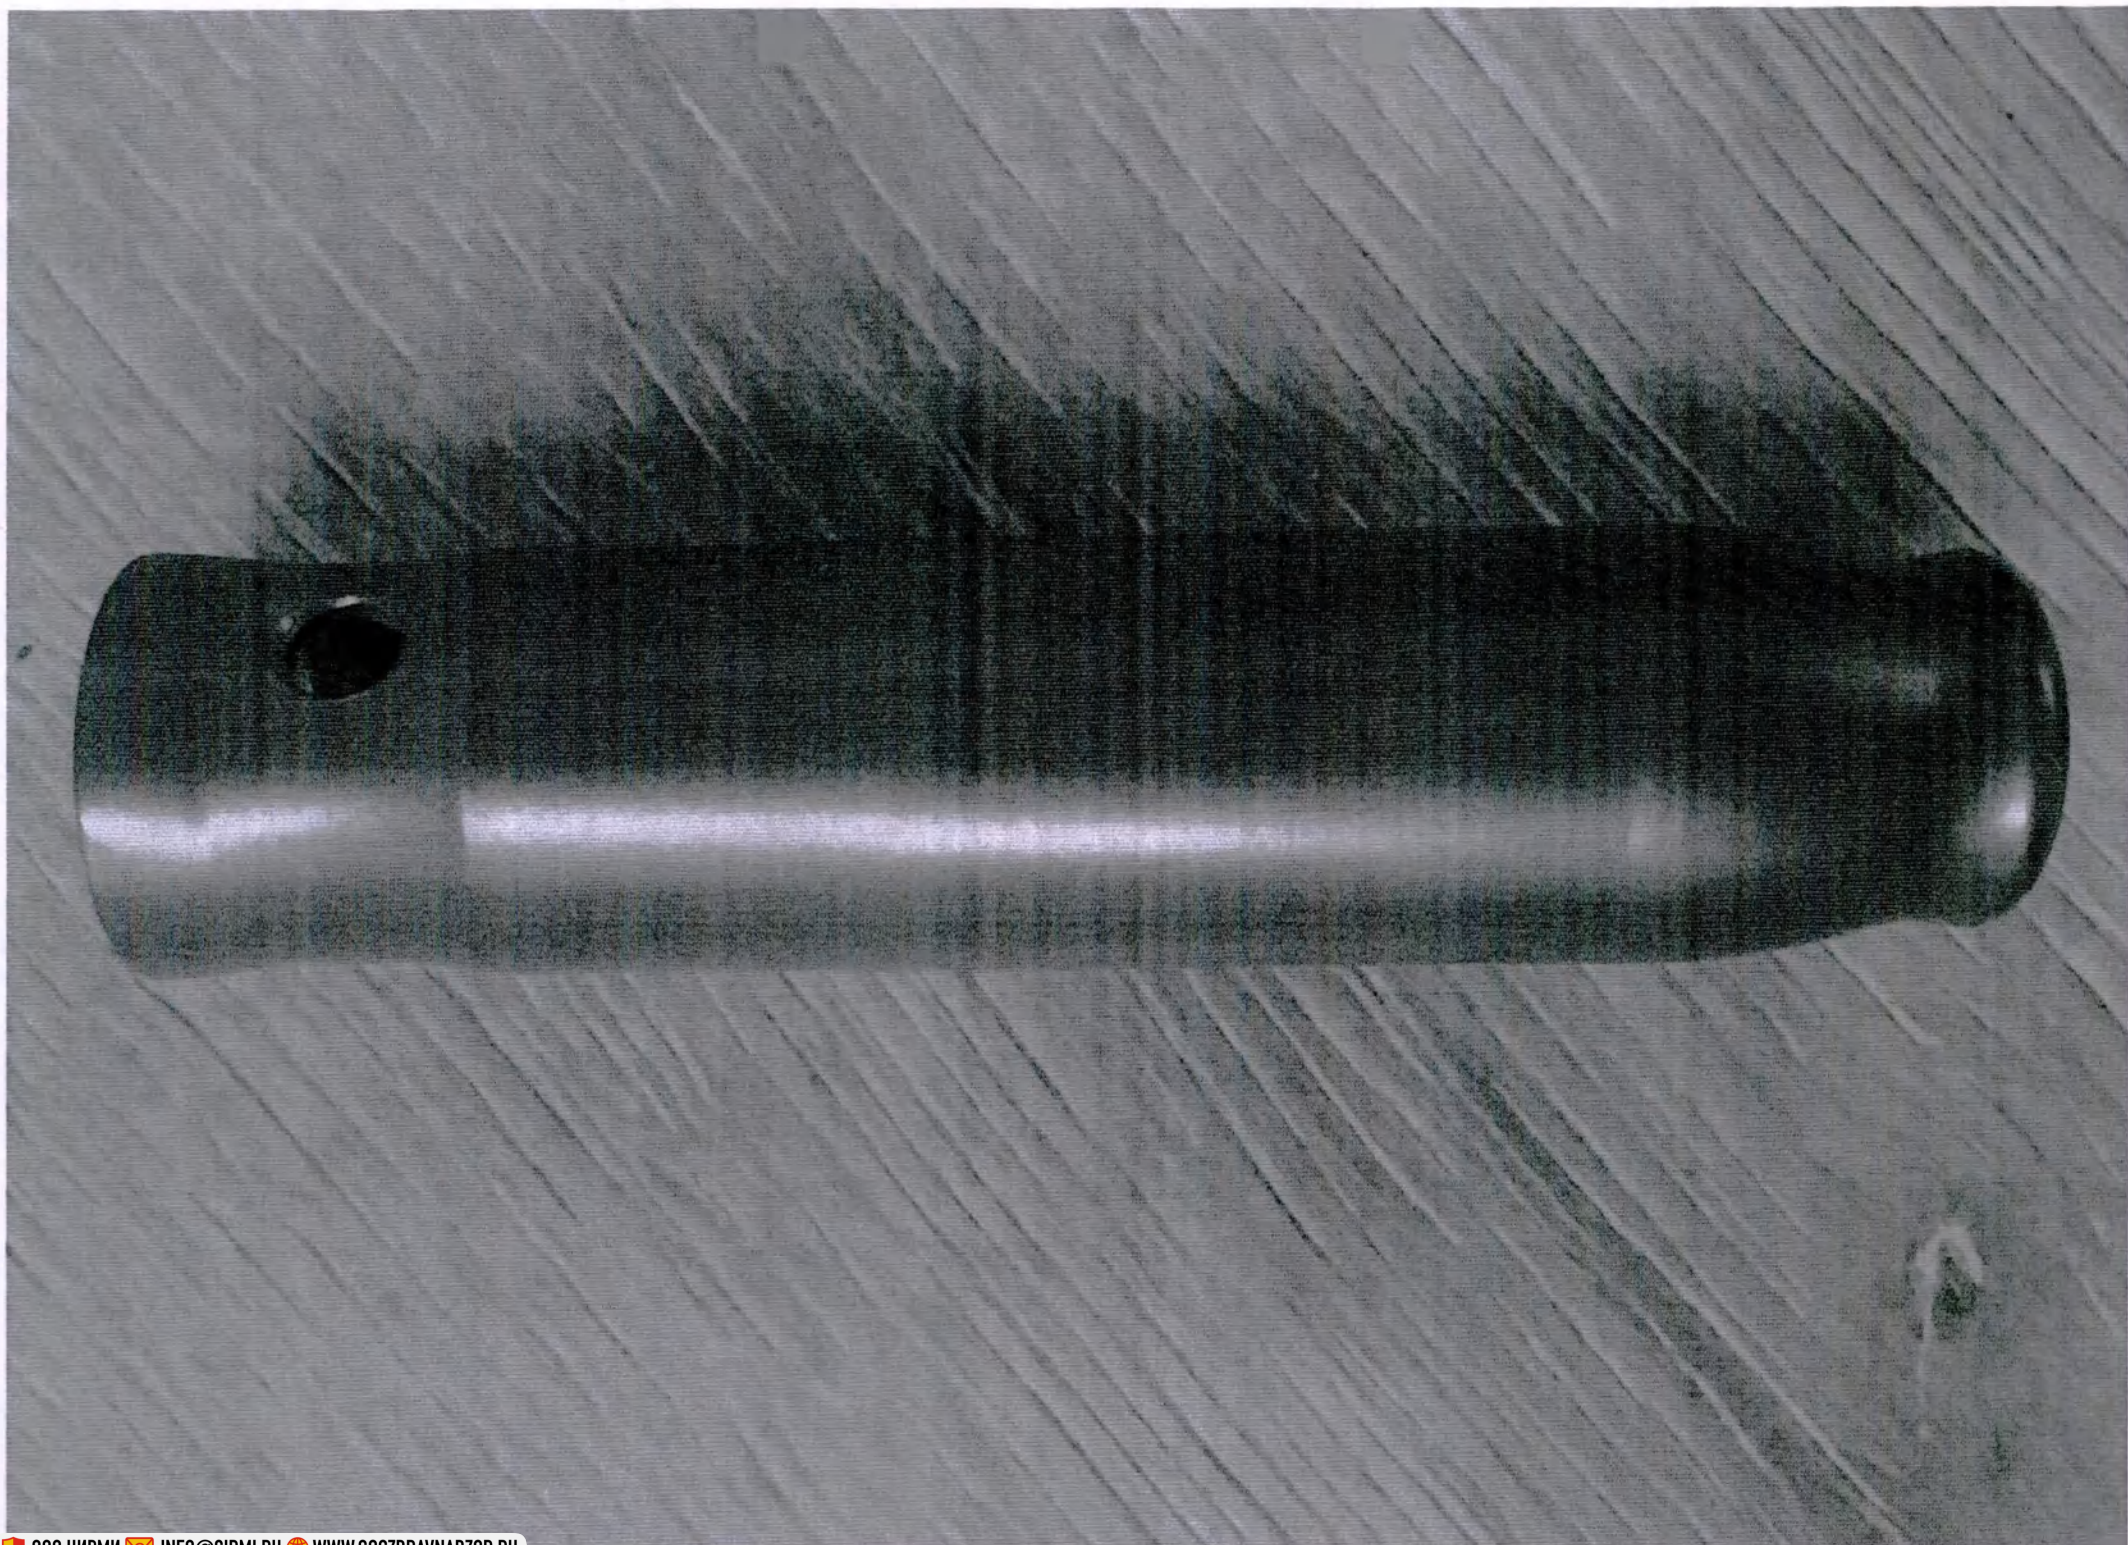
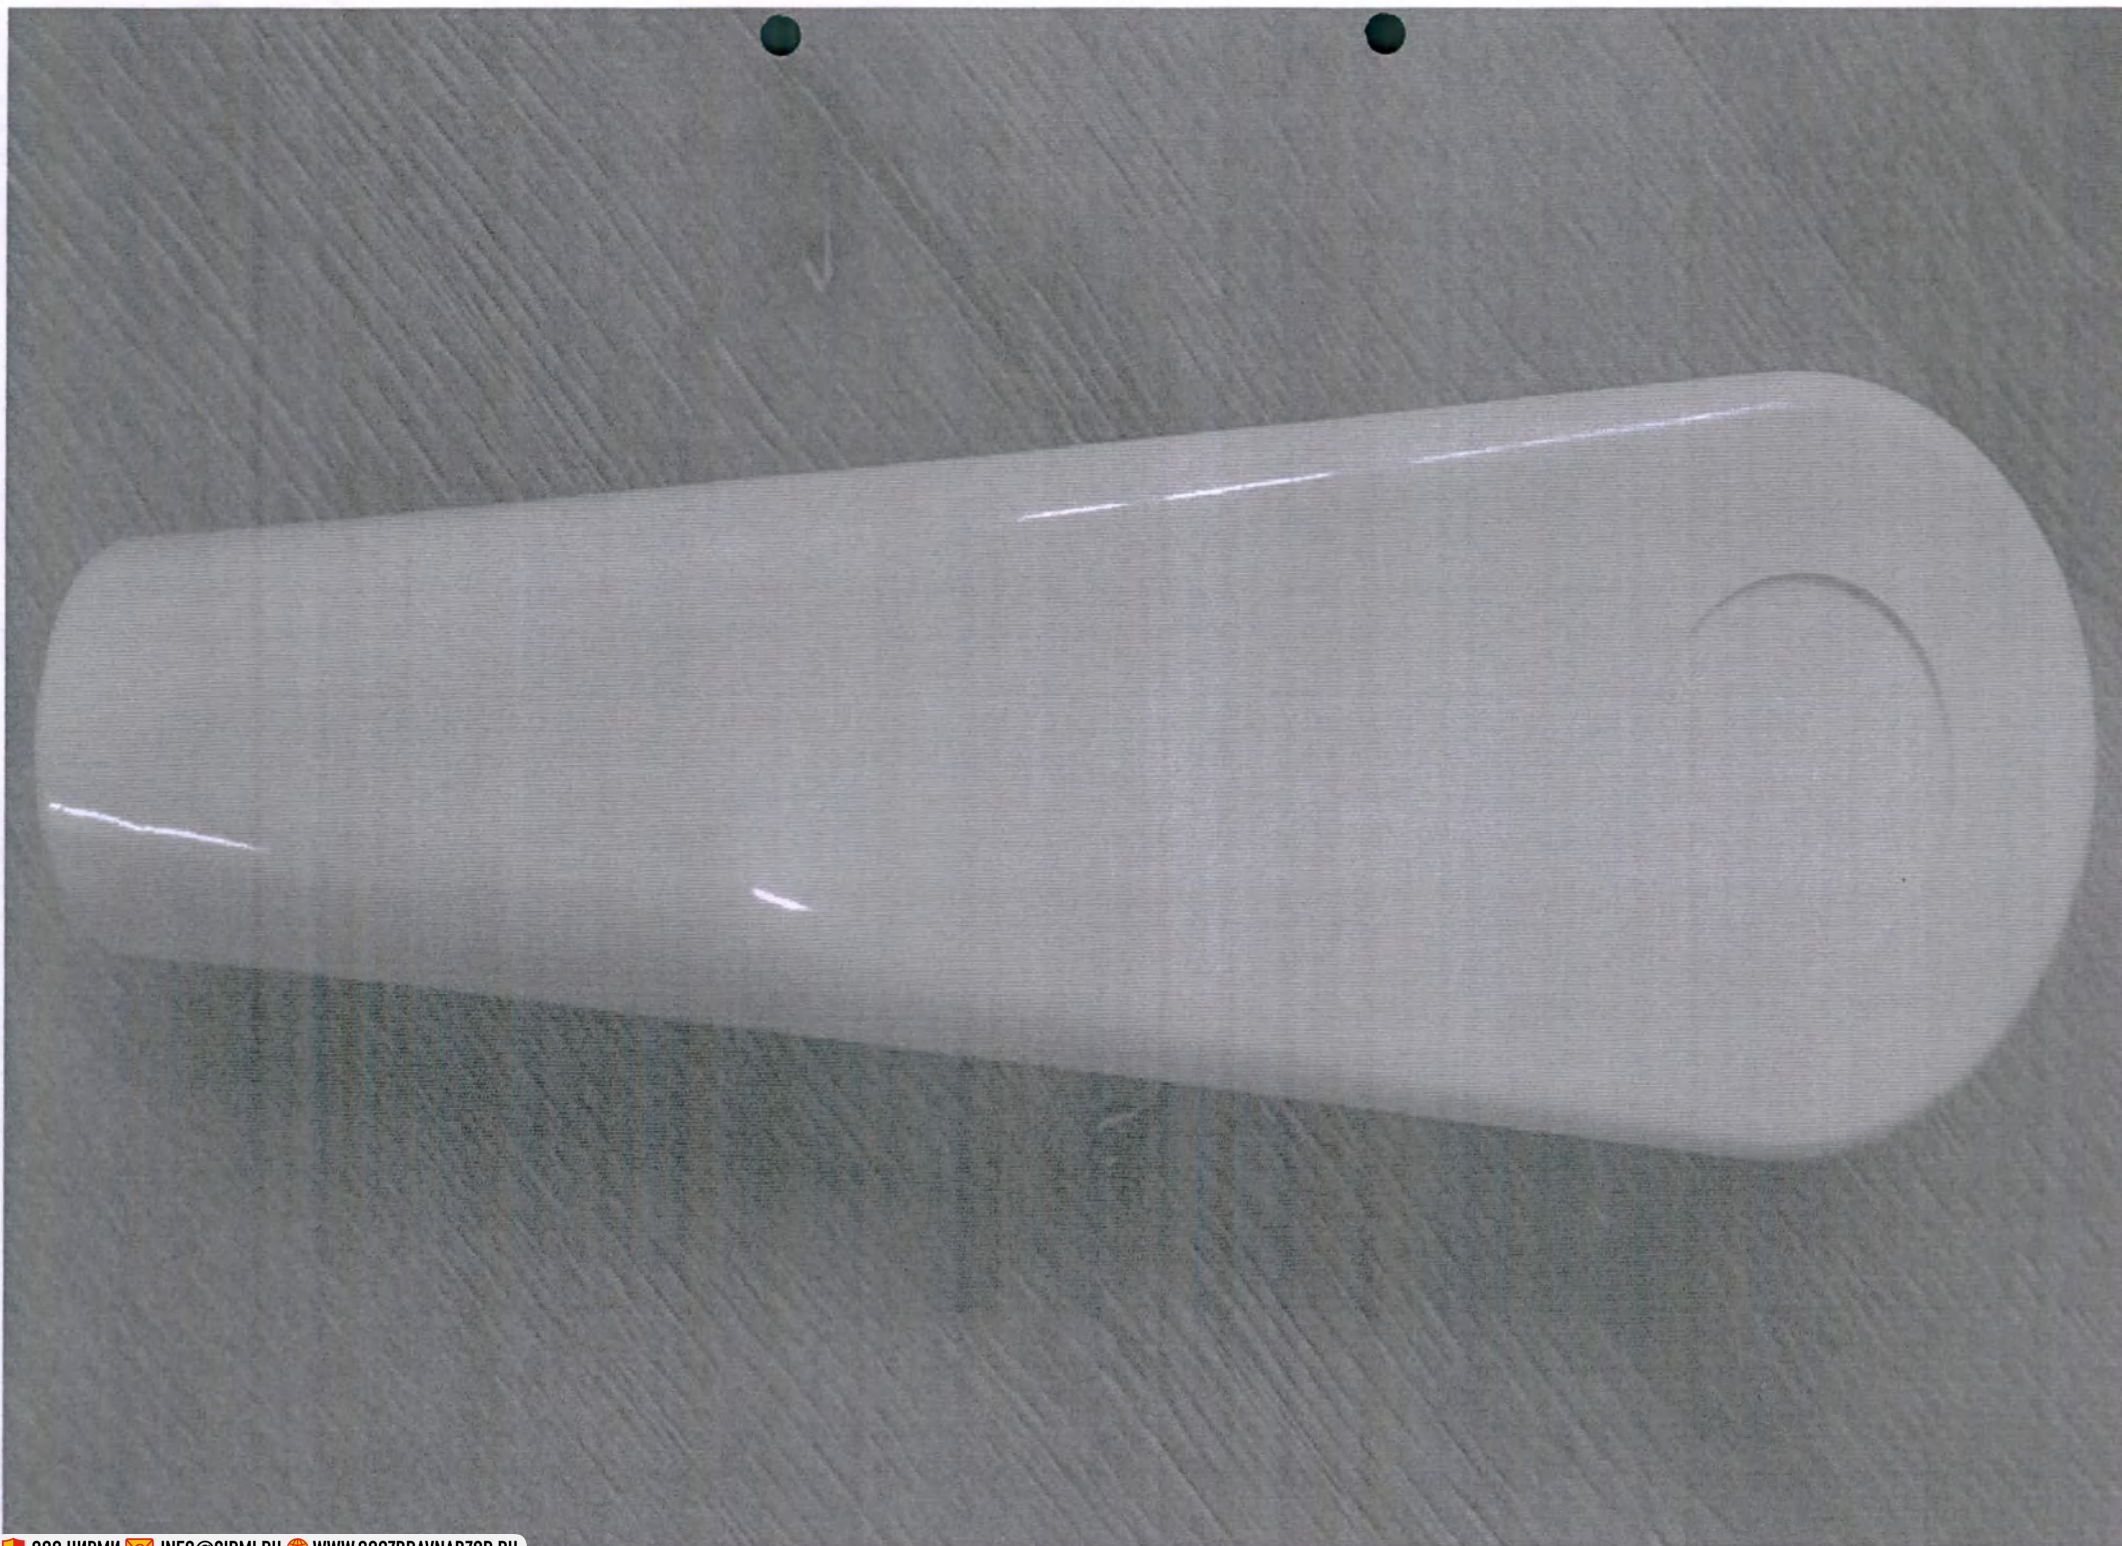


Рис. 19 – Ручка стерилизуемая



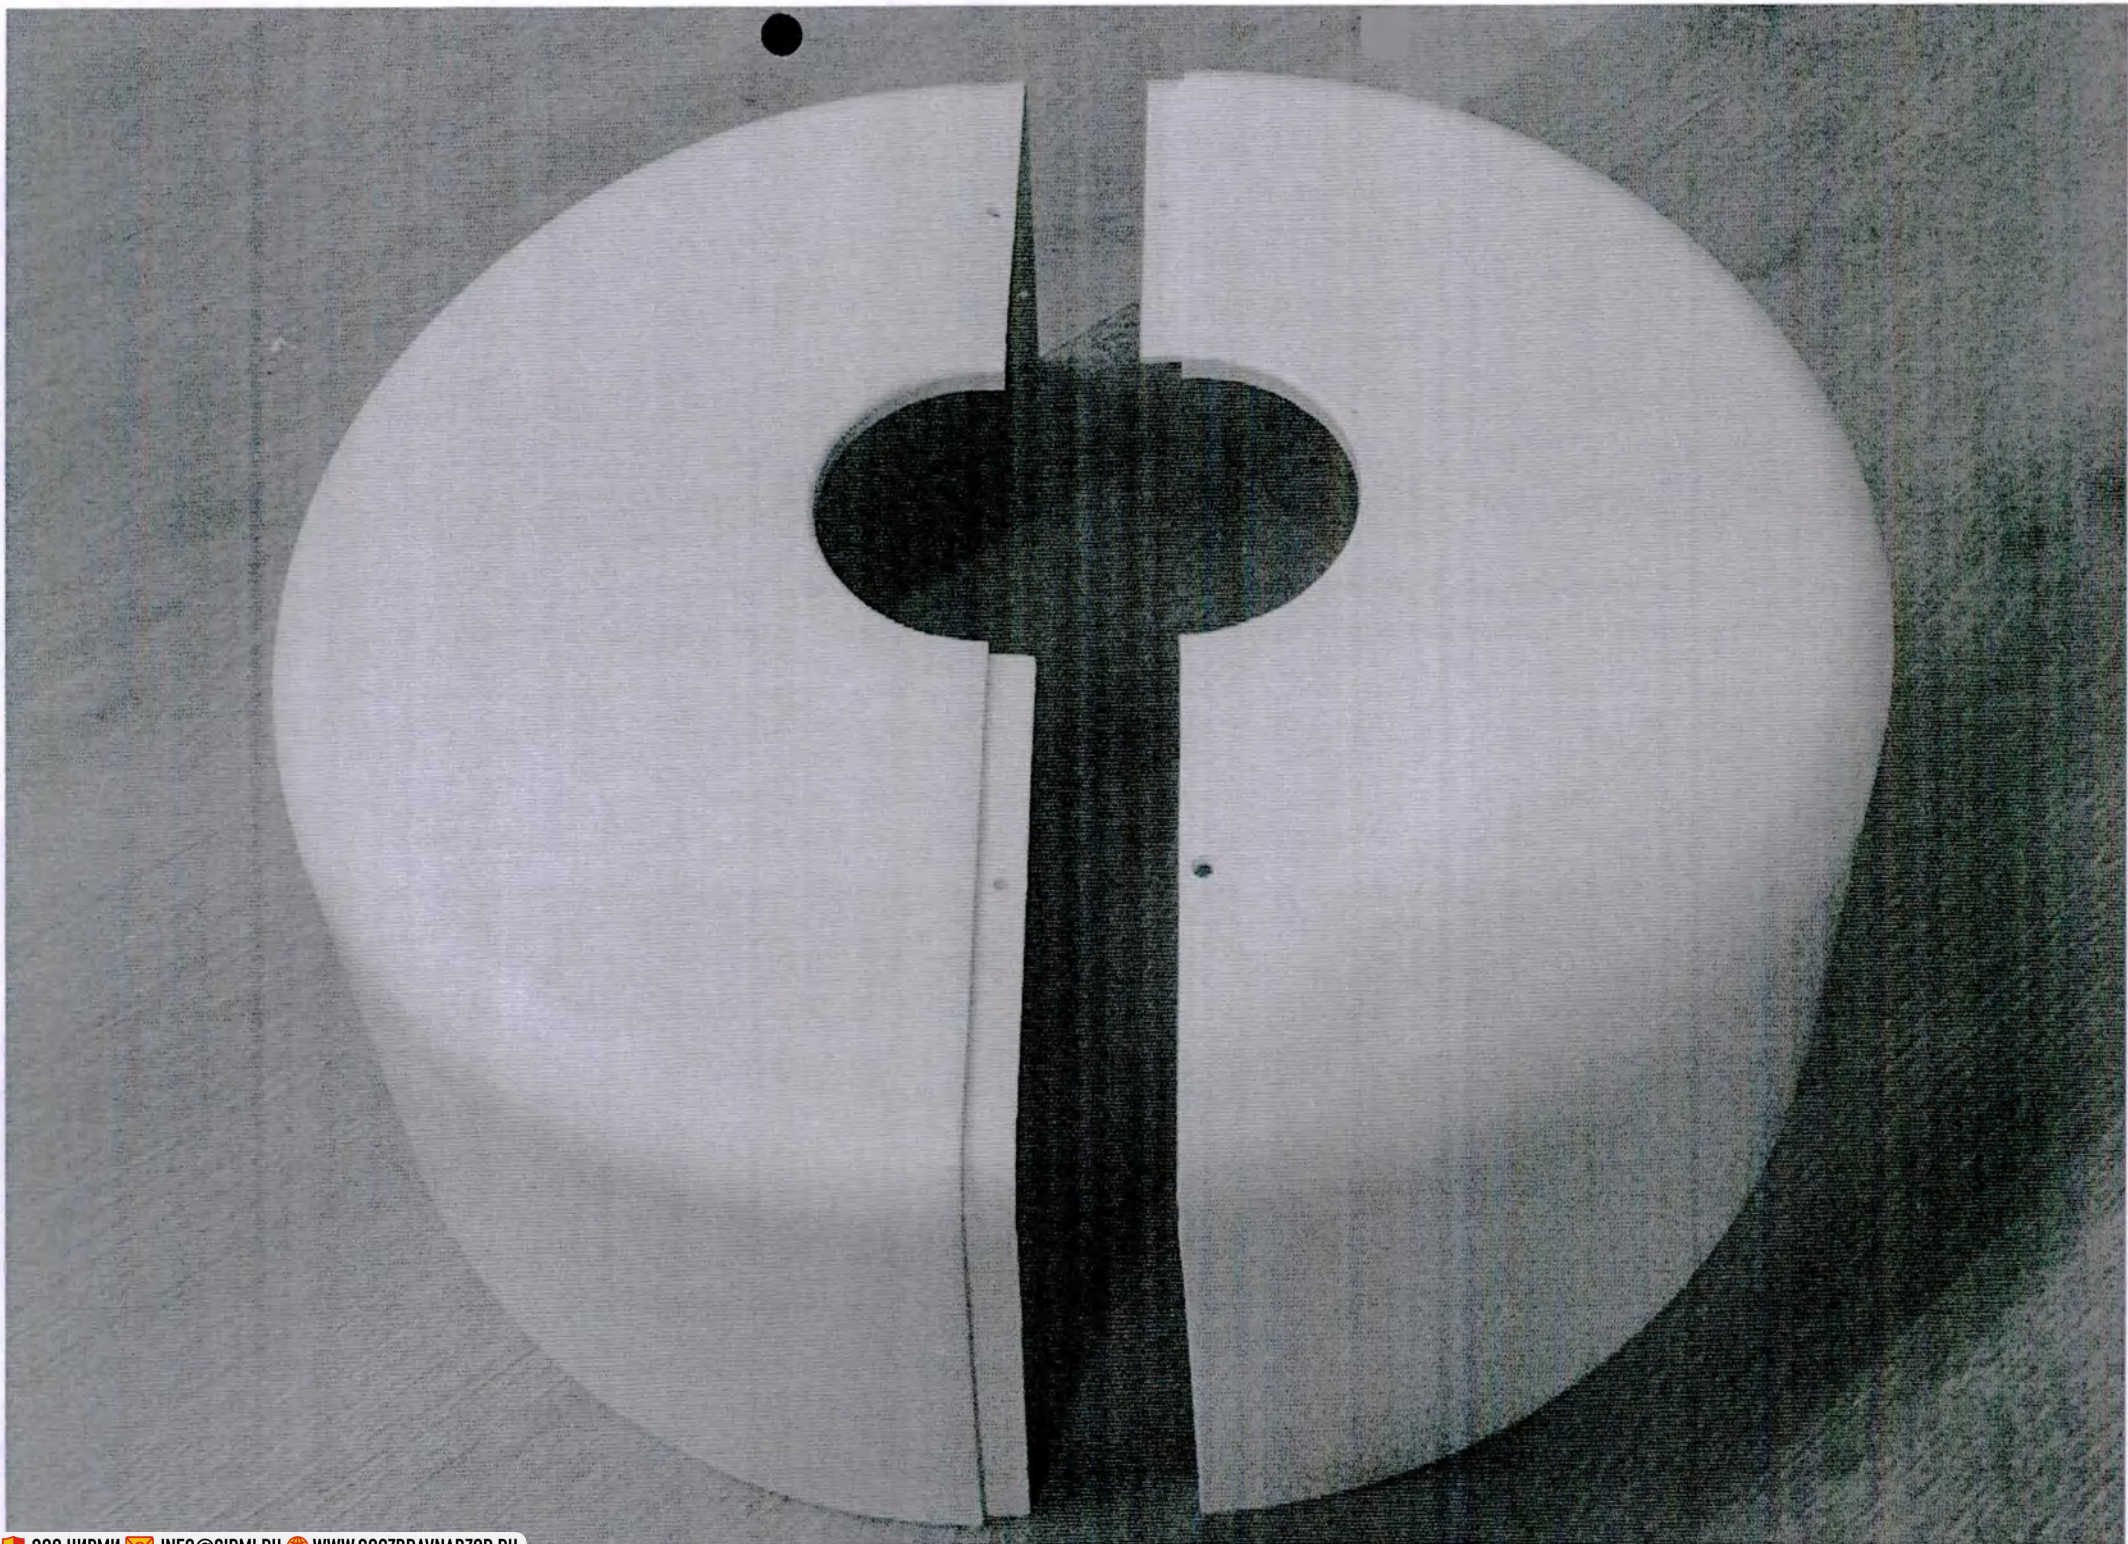


Рис. 21 – Кожух потолочный декоративный (2 шт.)

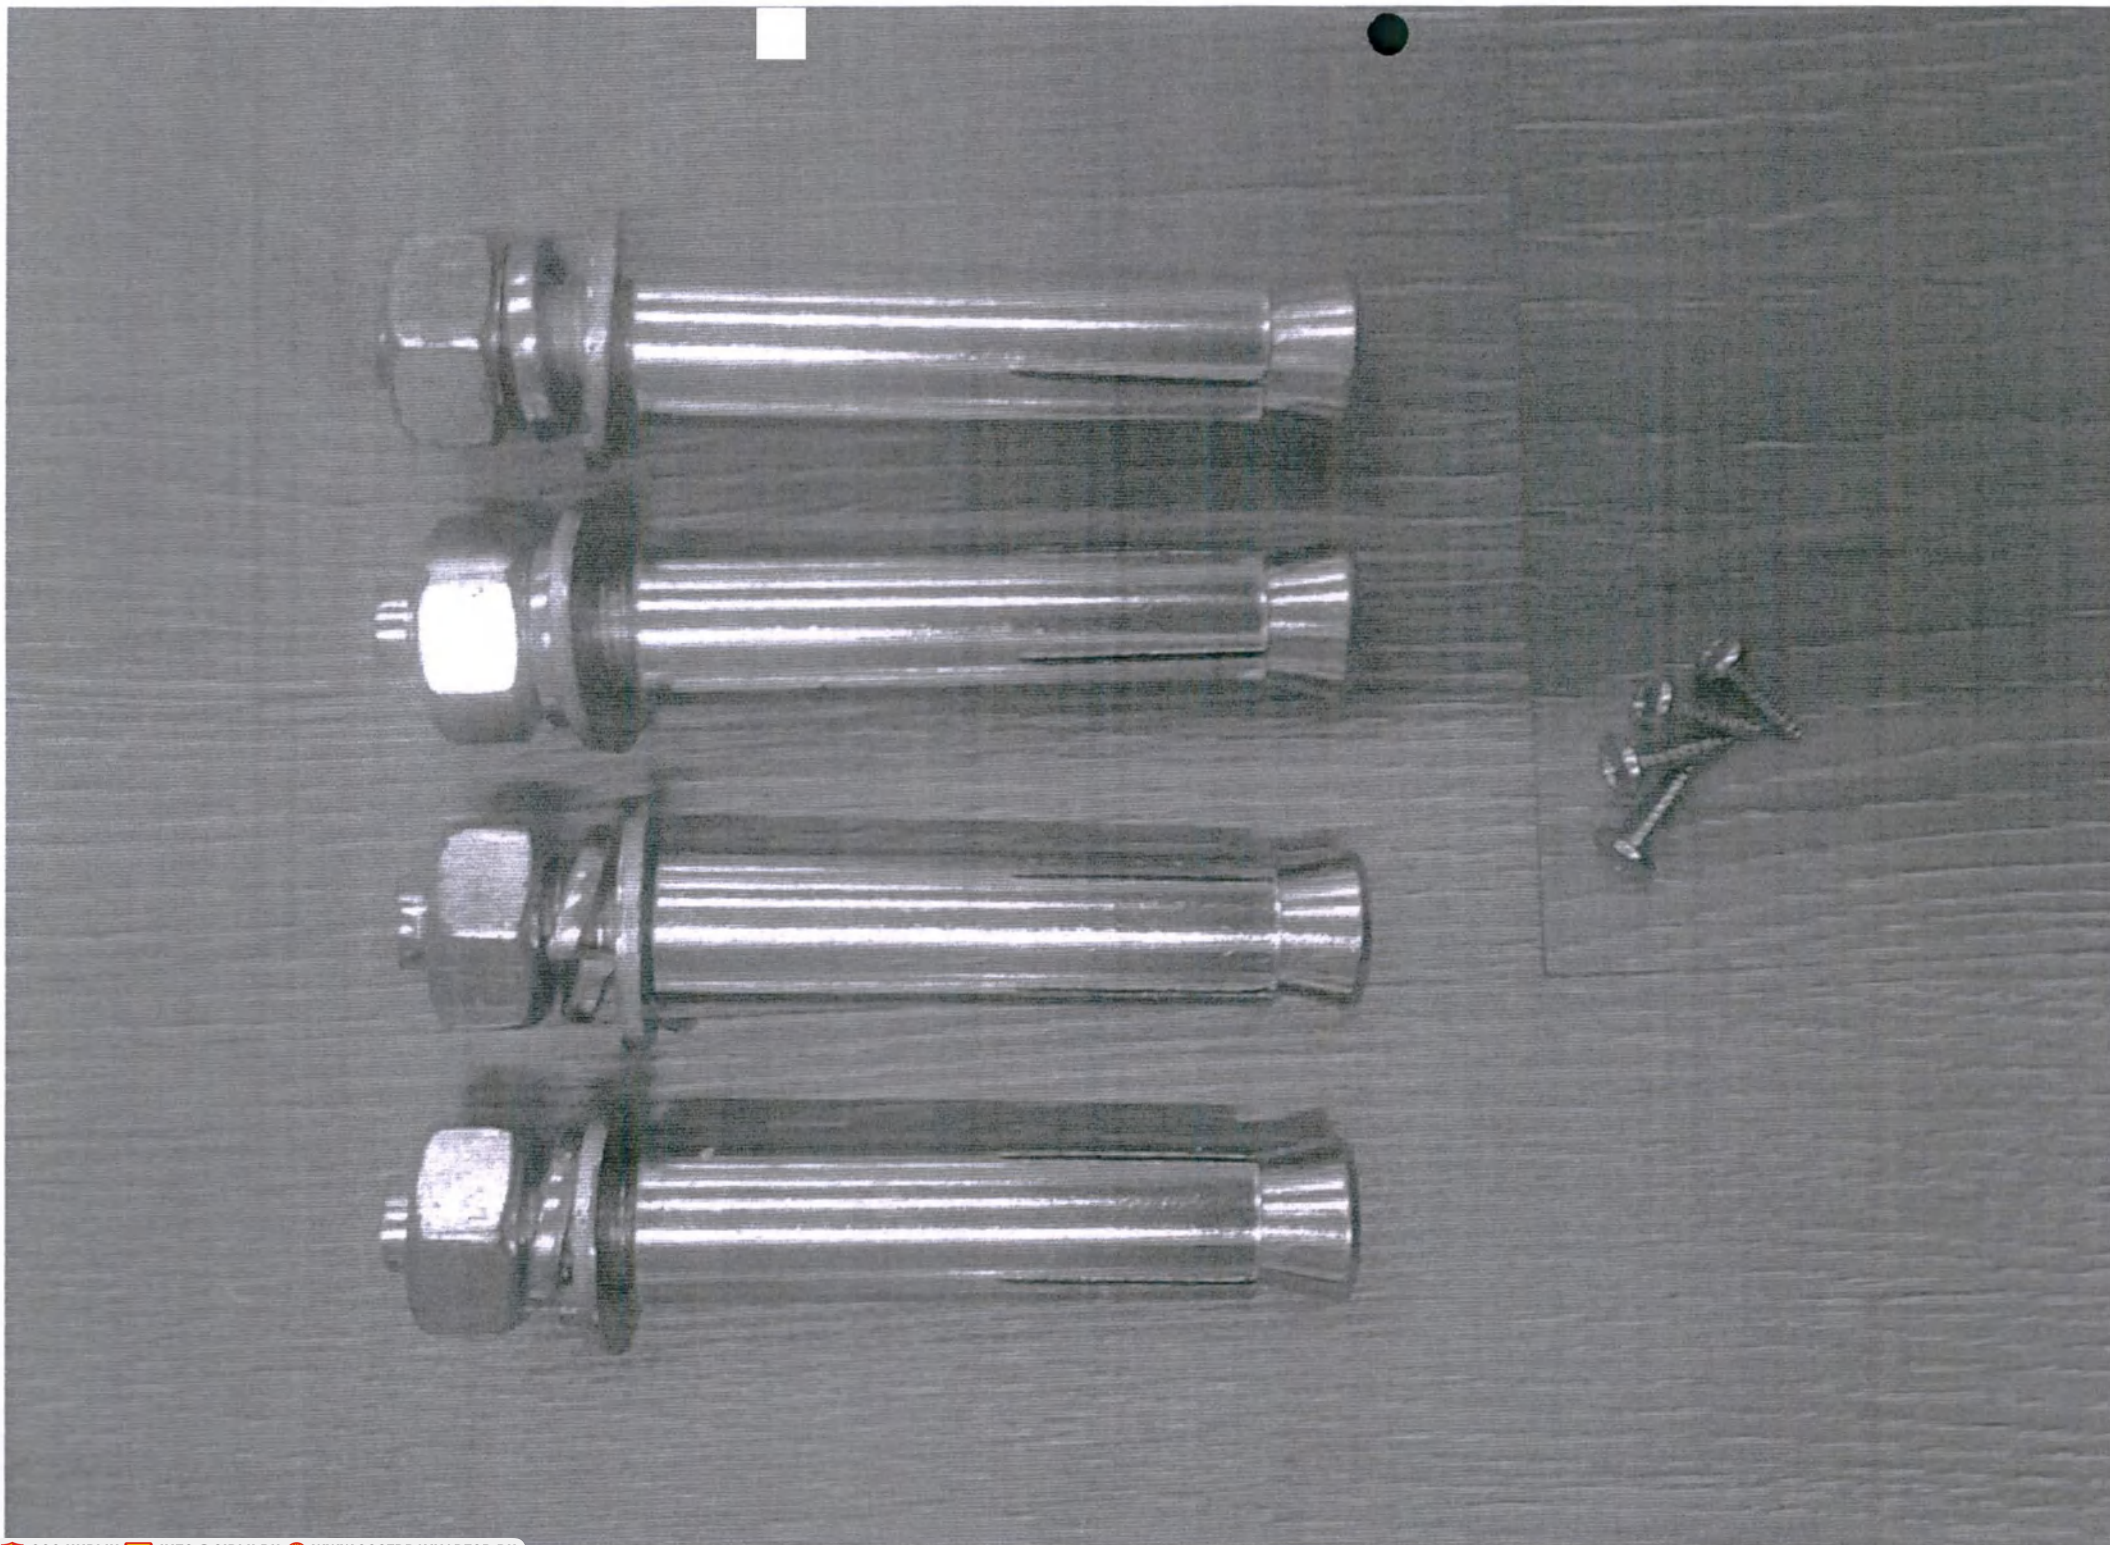


Рис. 22 – Комплект крепежа

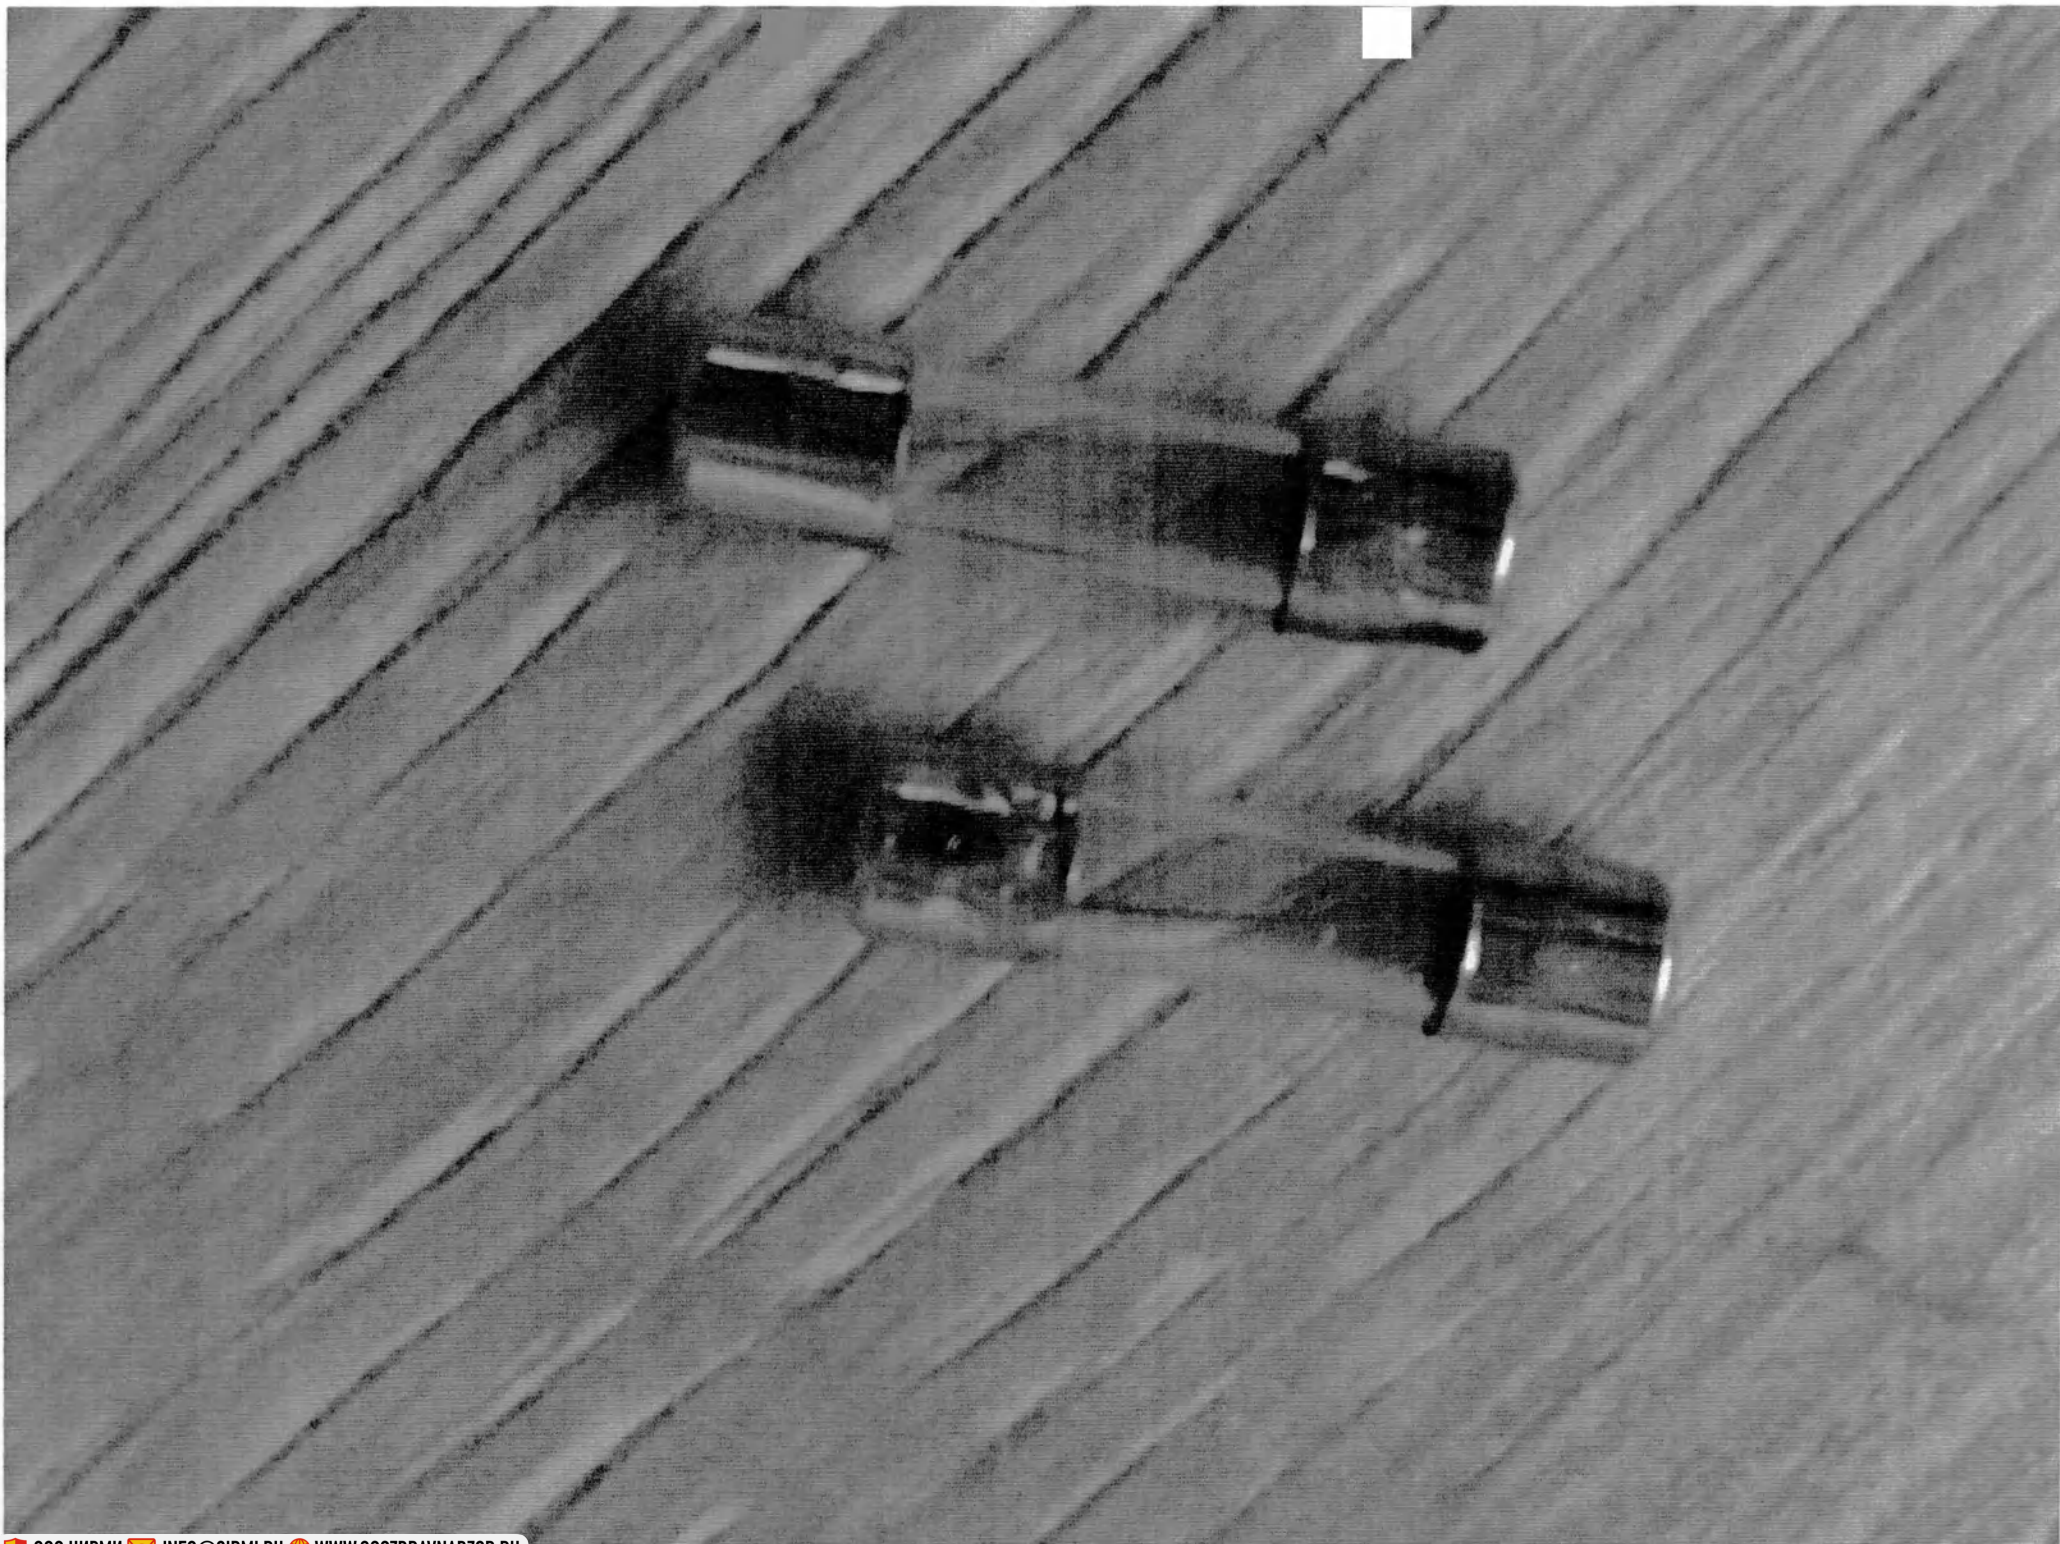
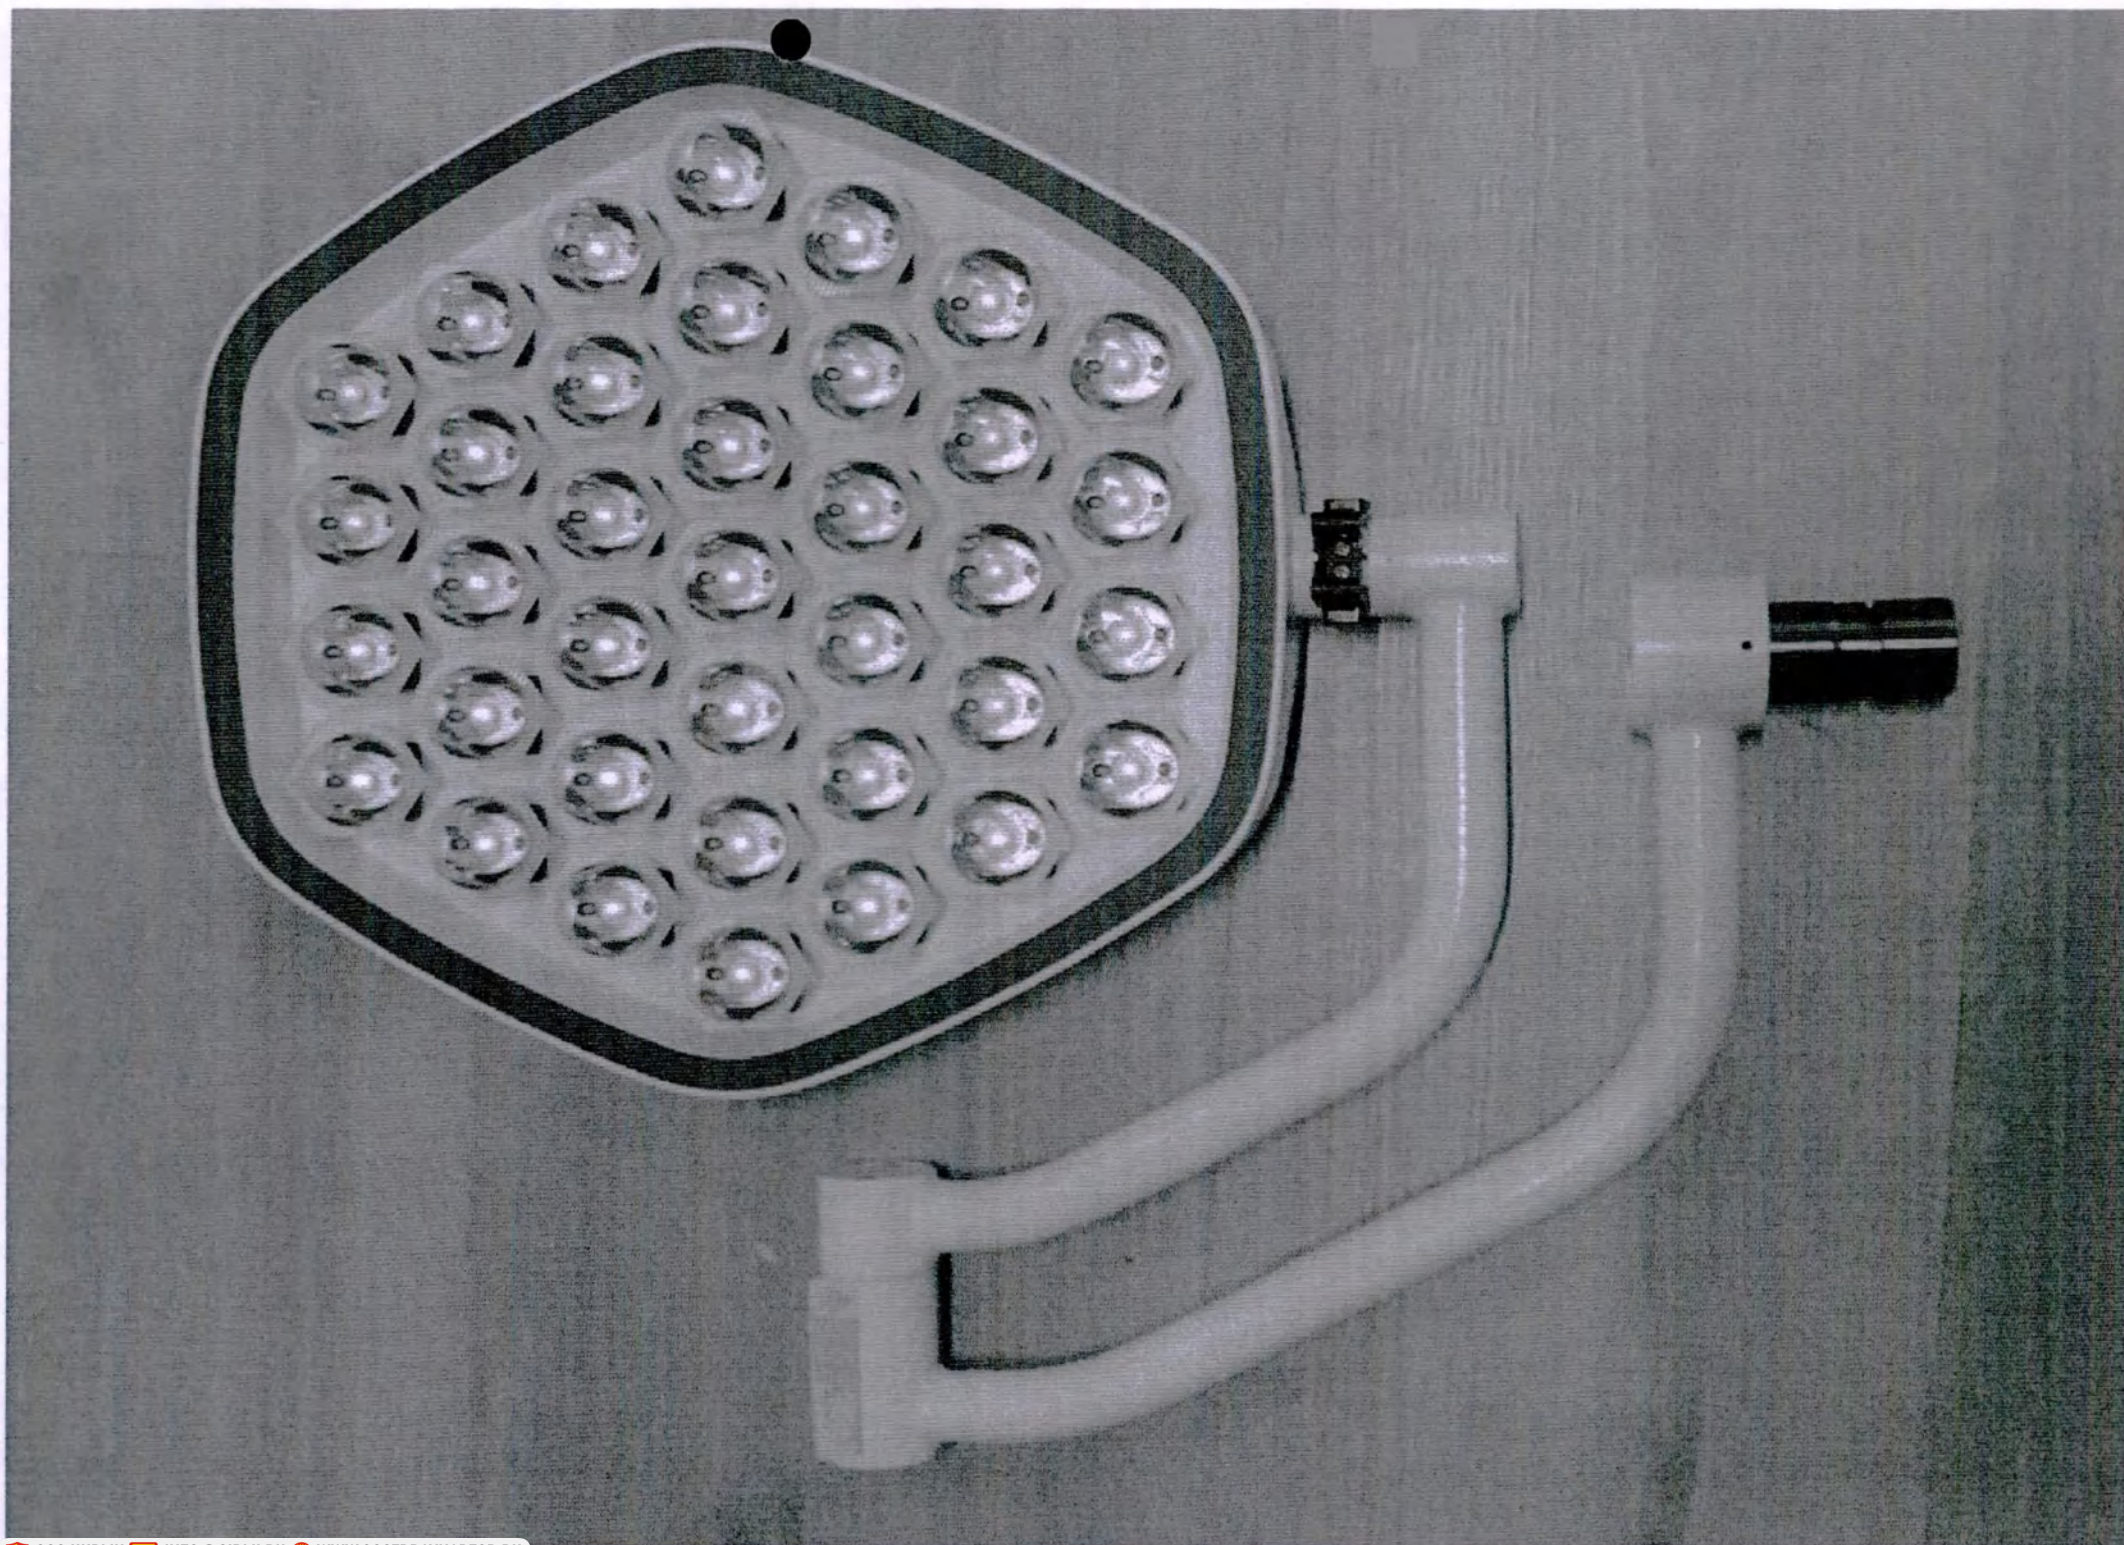


Рис. 23 – Предохранитель плавкий F2AL250V запасной (2 шт.)

III. Светильник медицинский хирургический «Armed», вариант исполнения AR-SY320C LED, в составе:





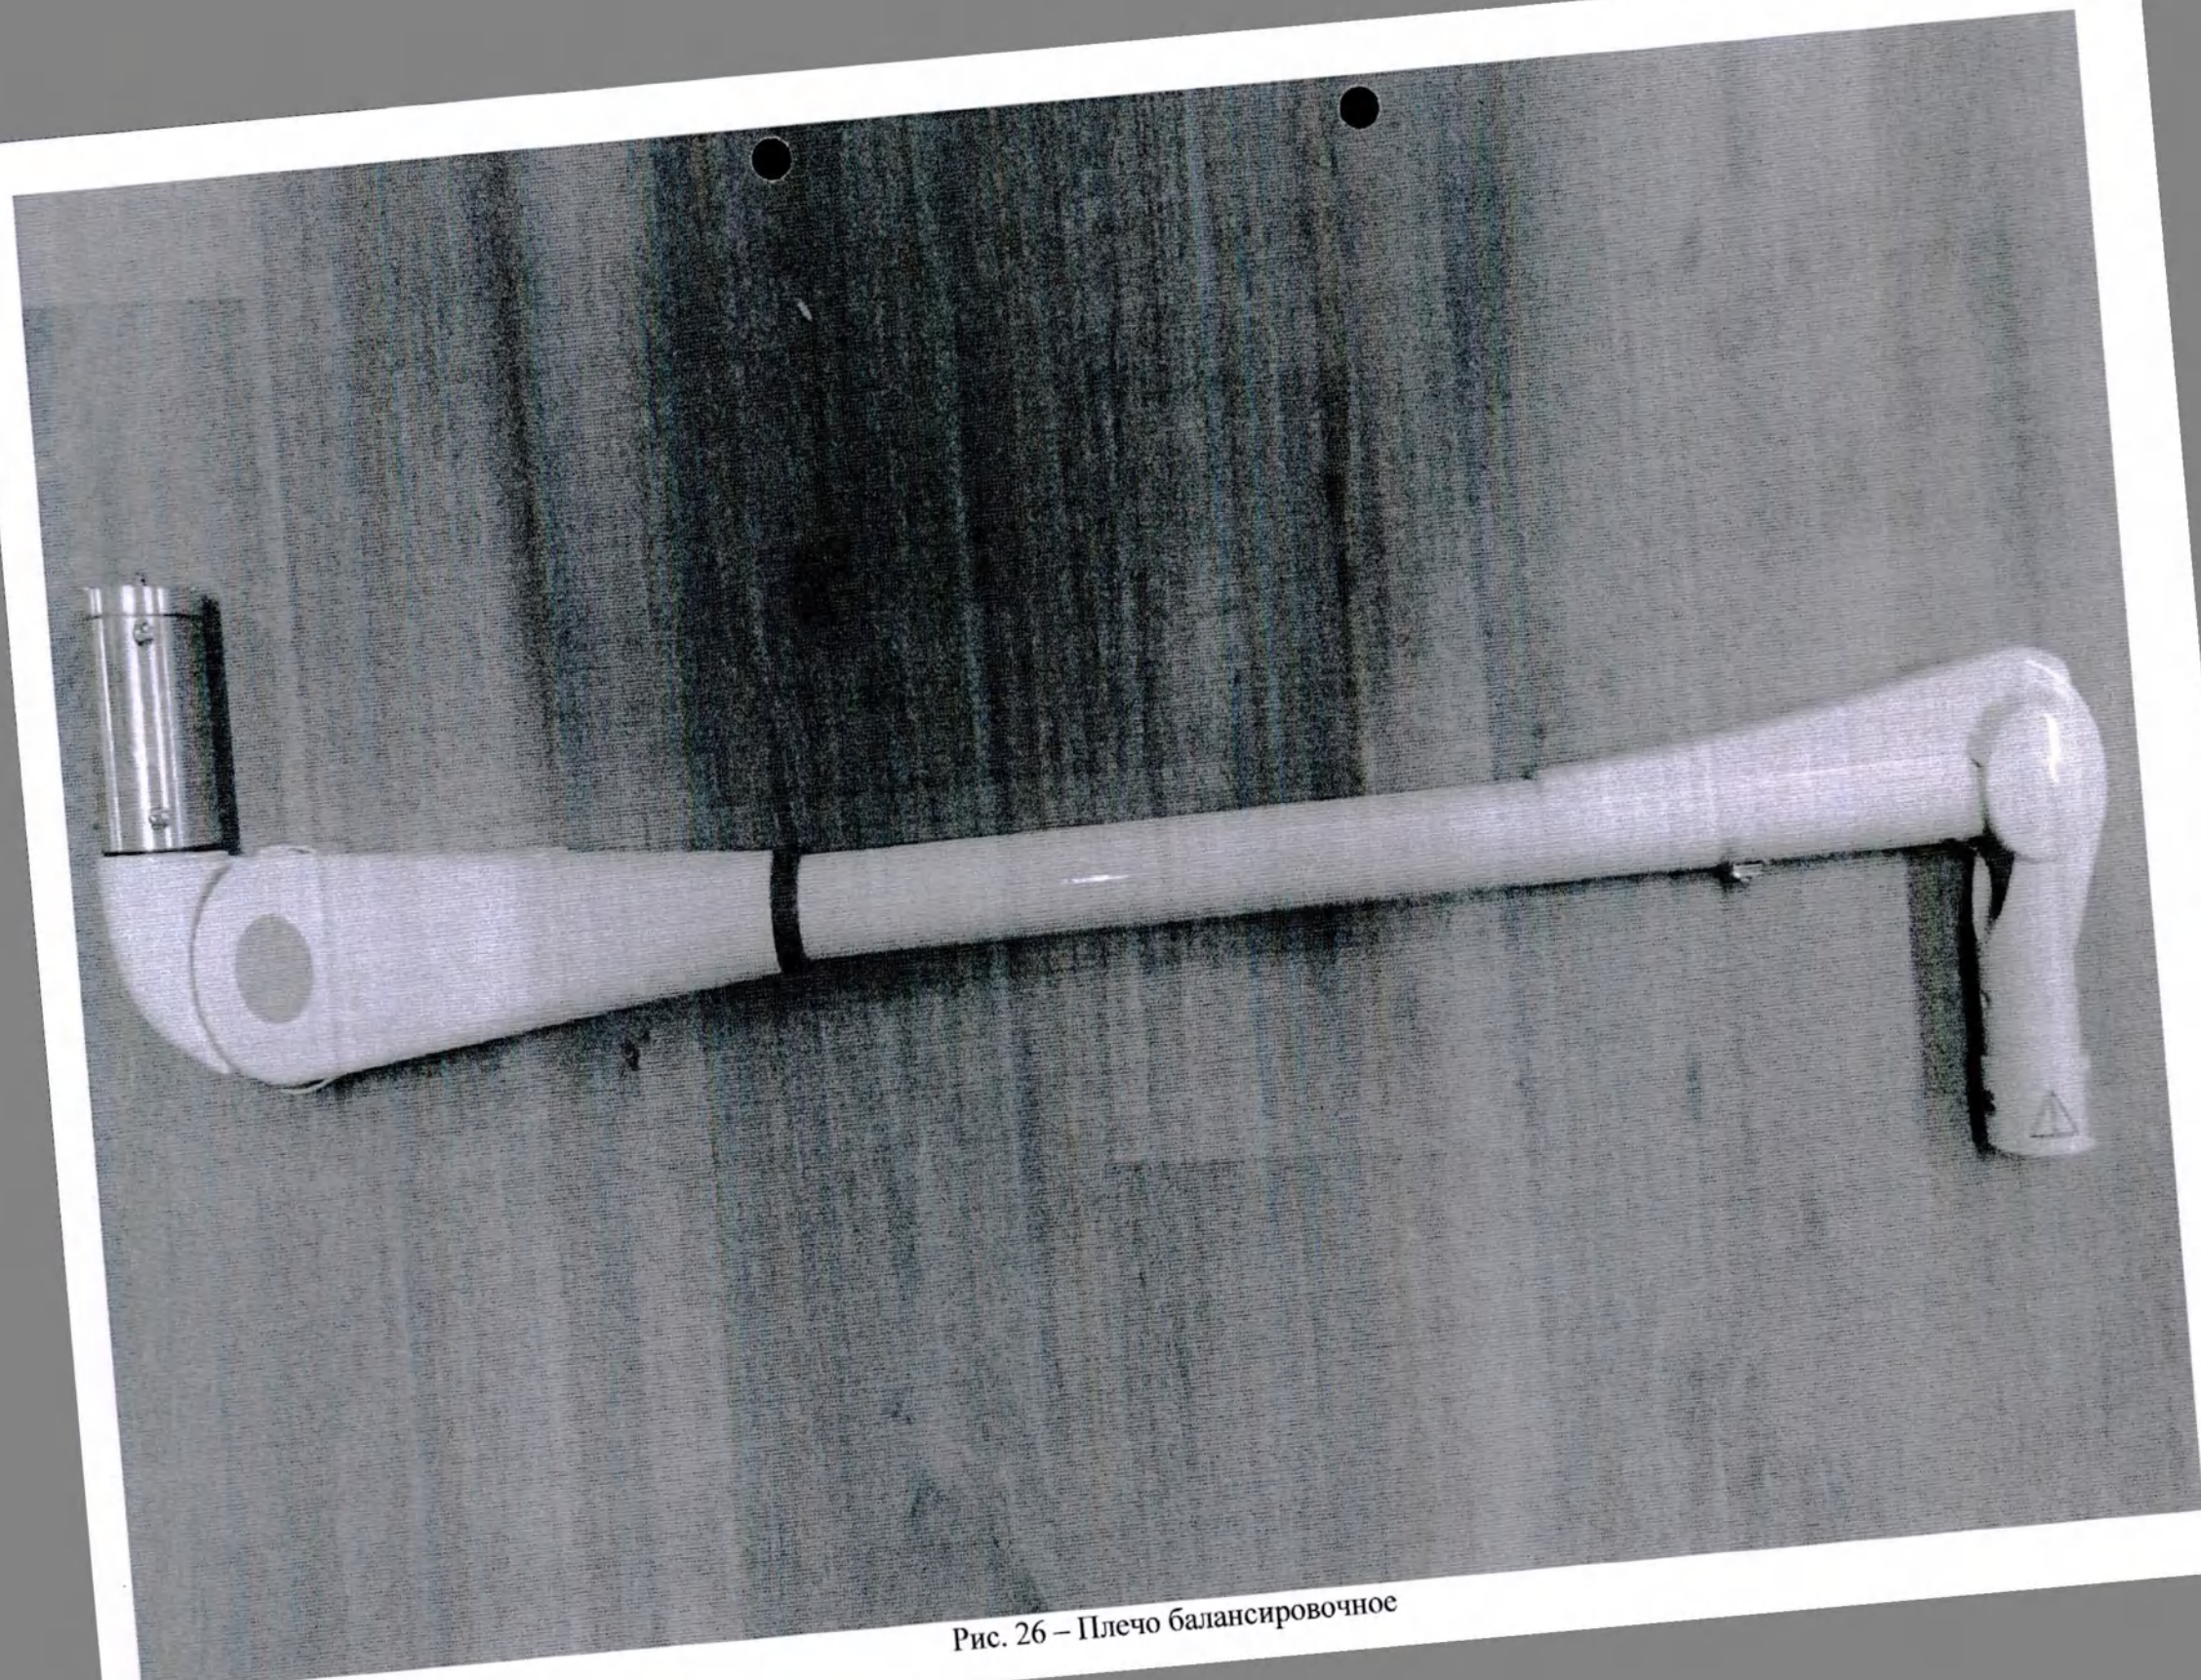


Рис. 26 – Плечо балансирующее

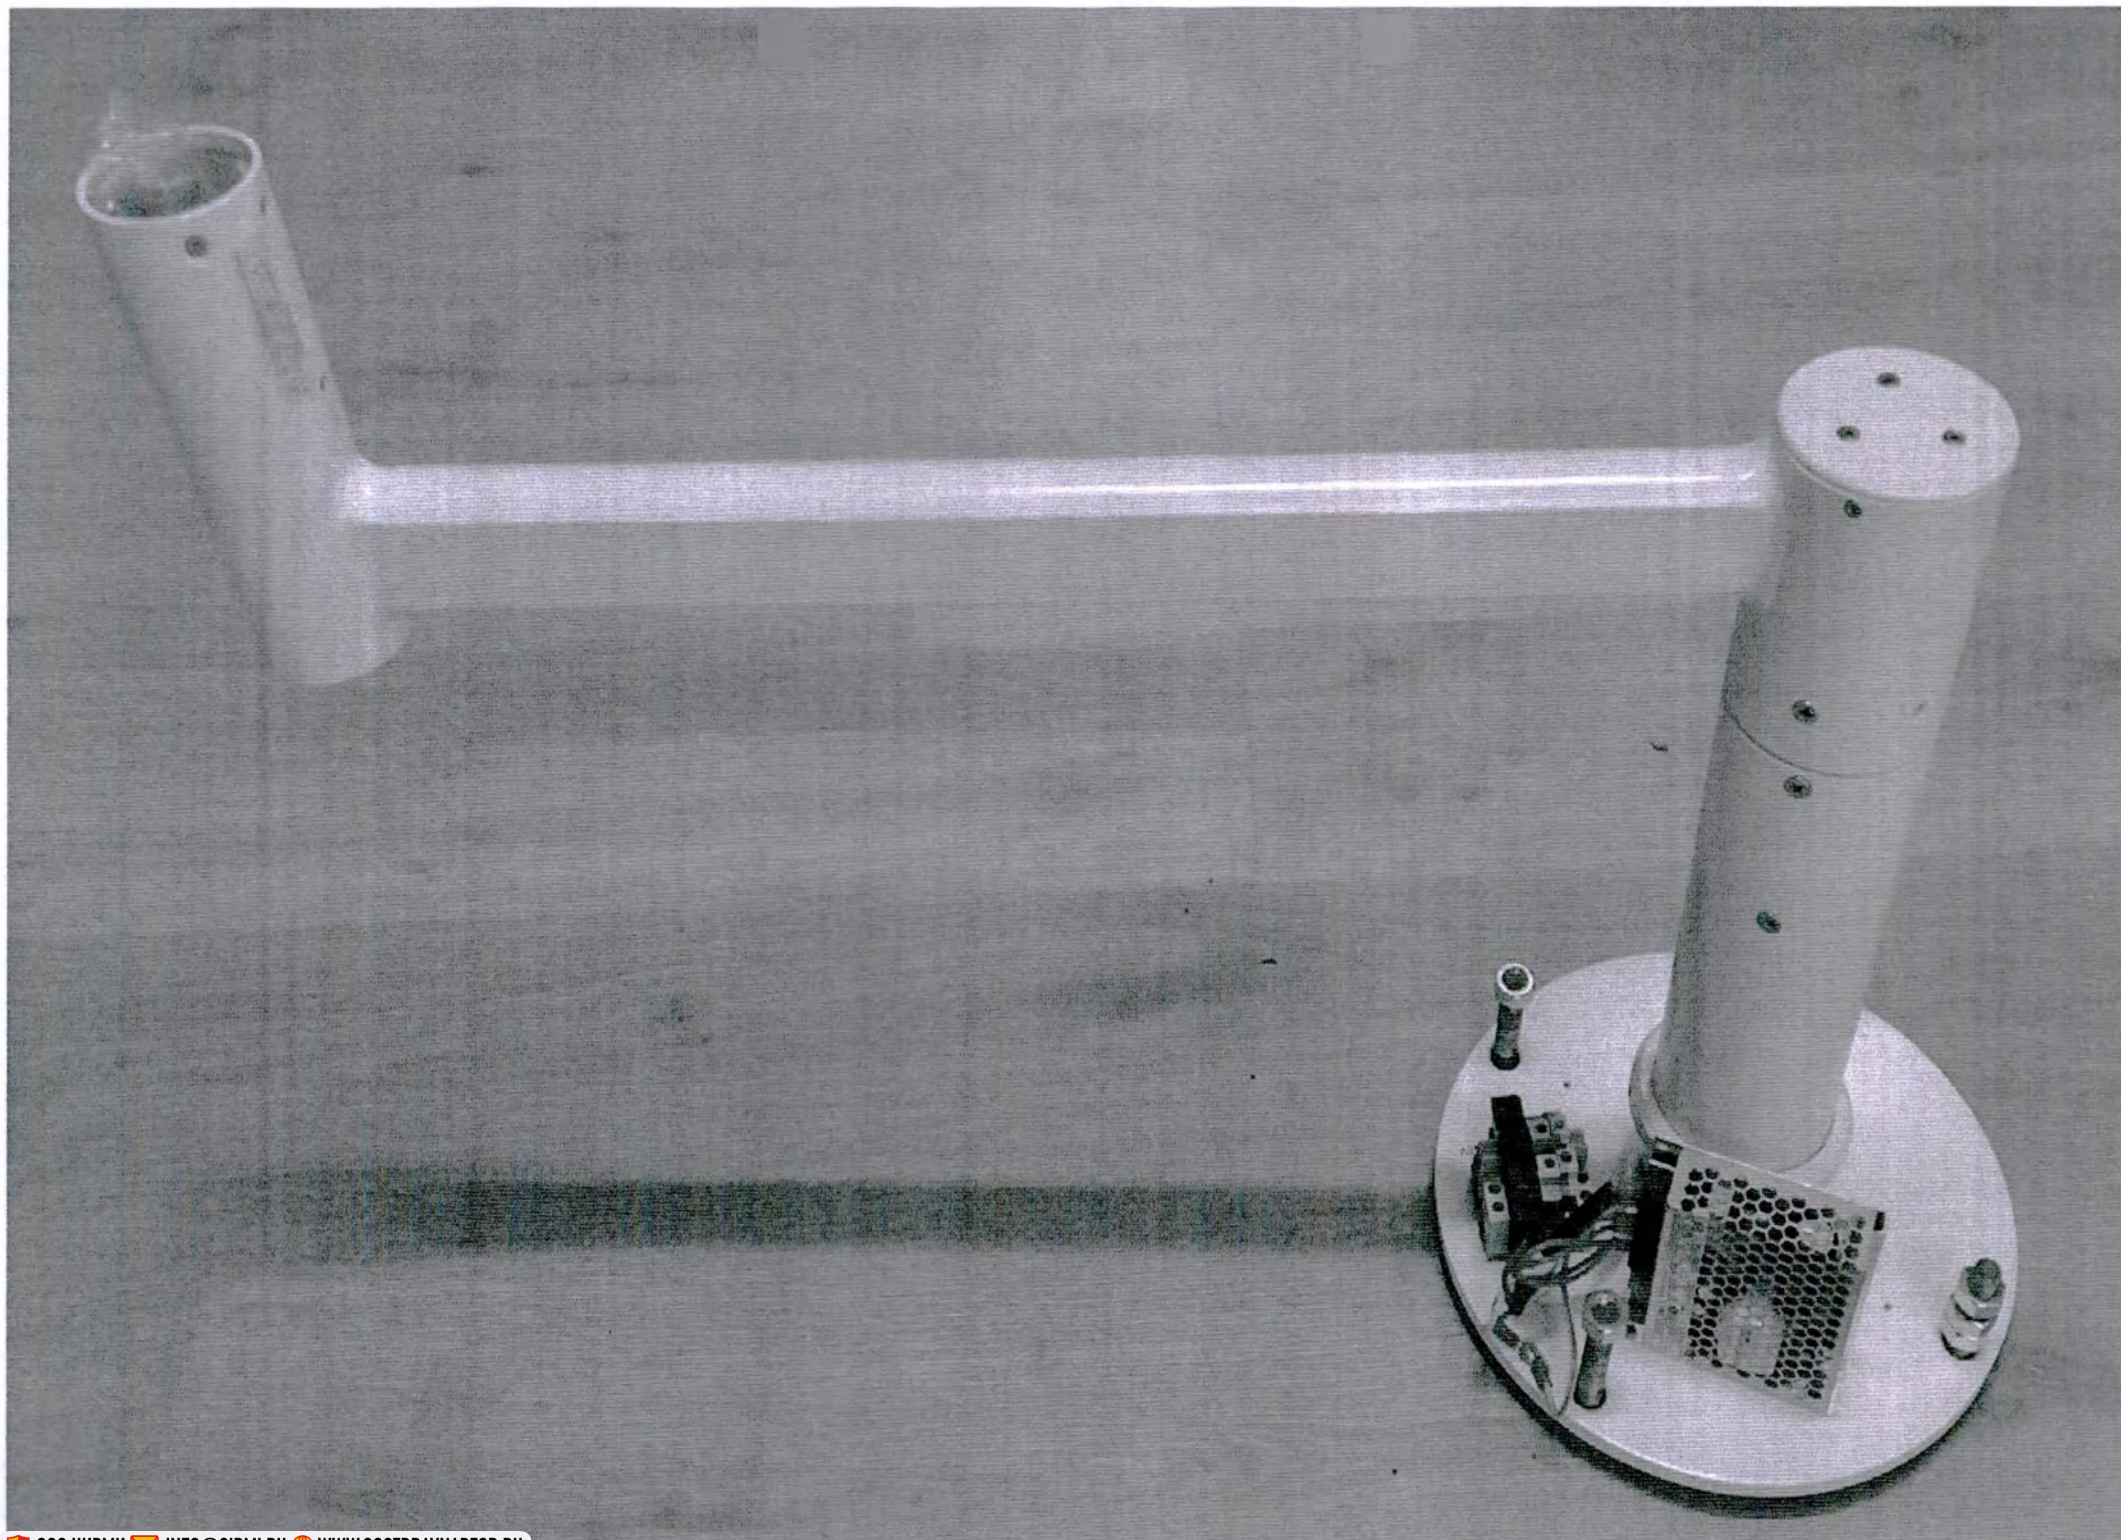
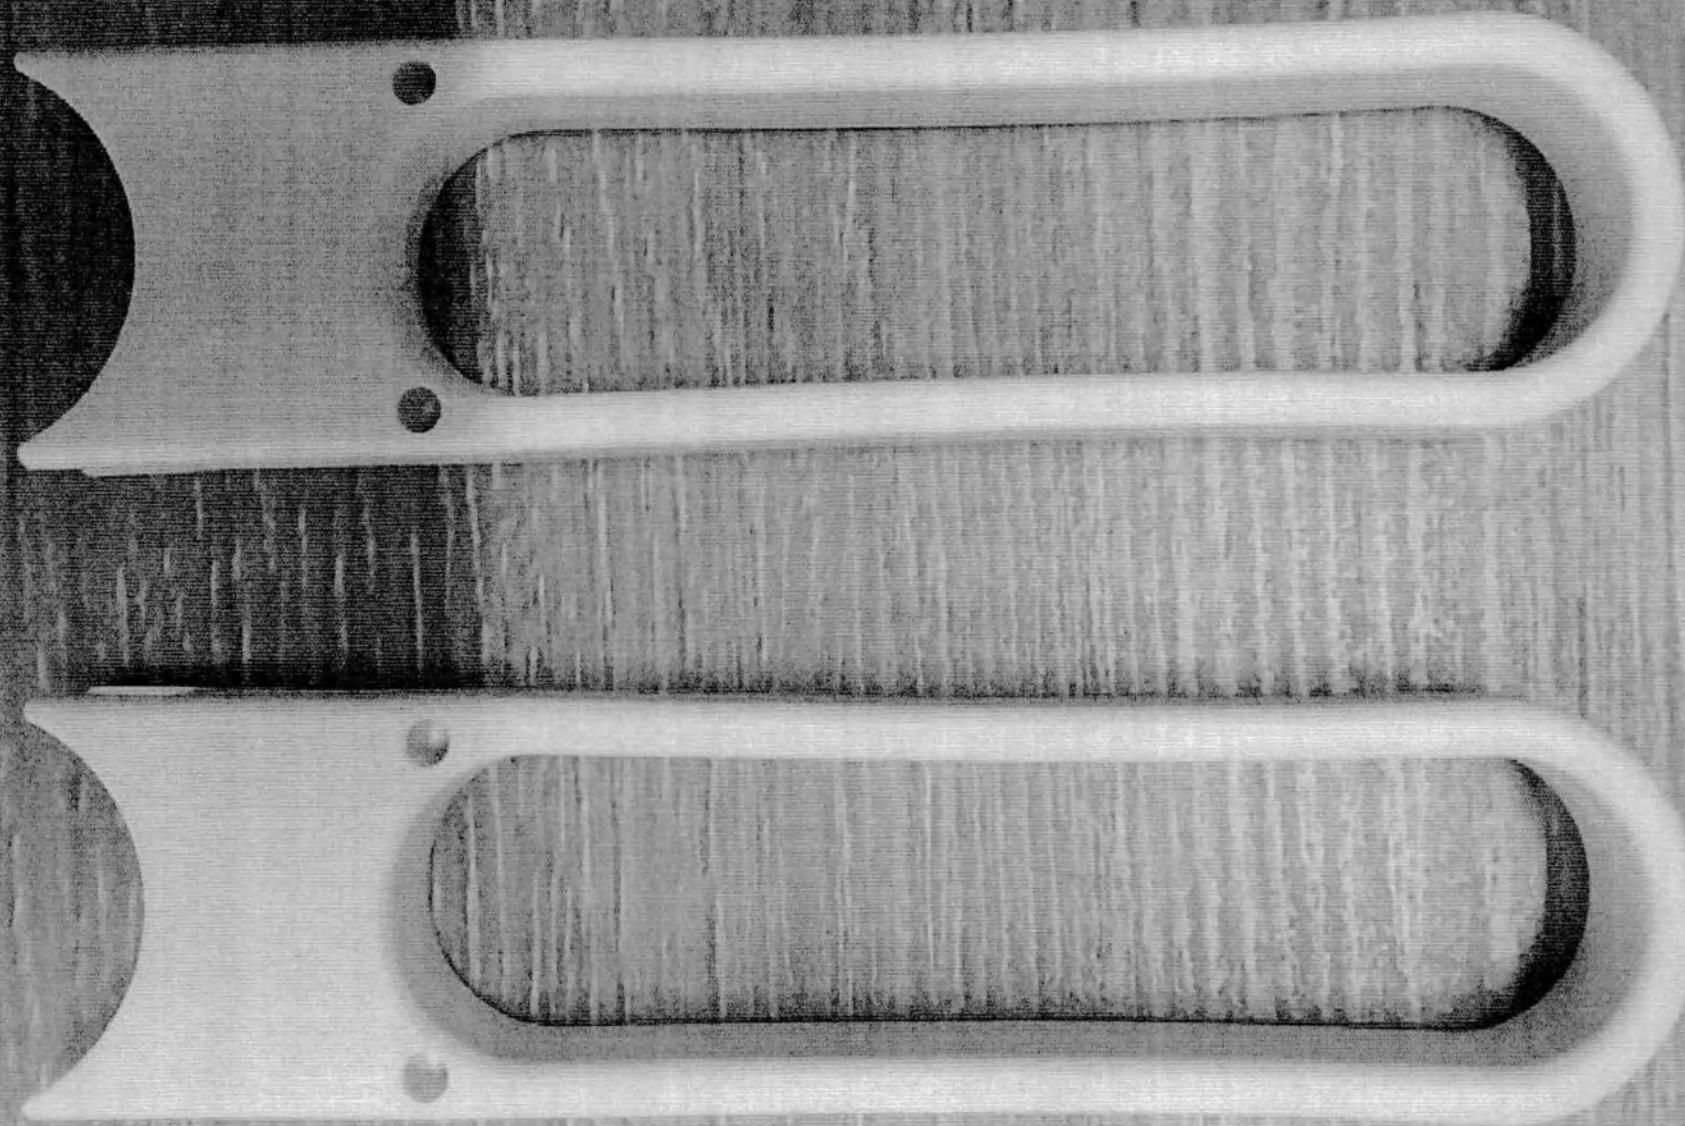
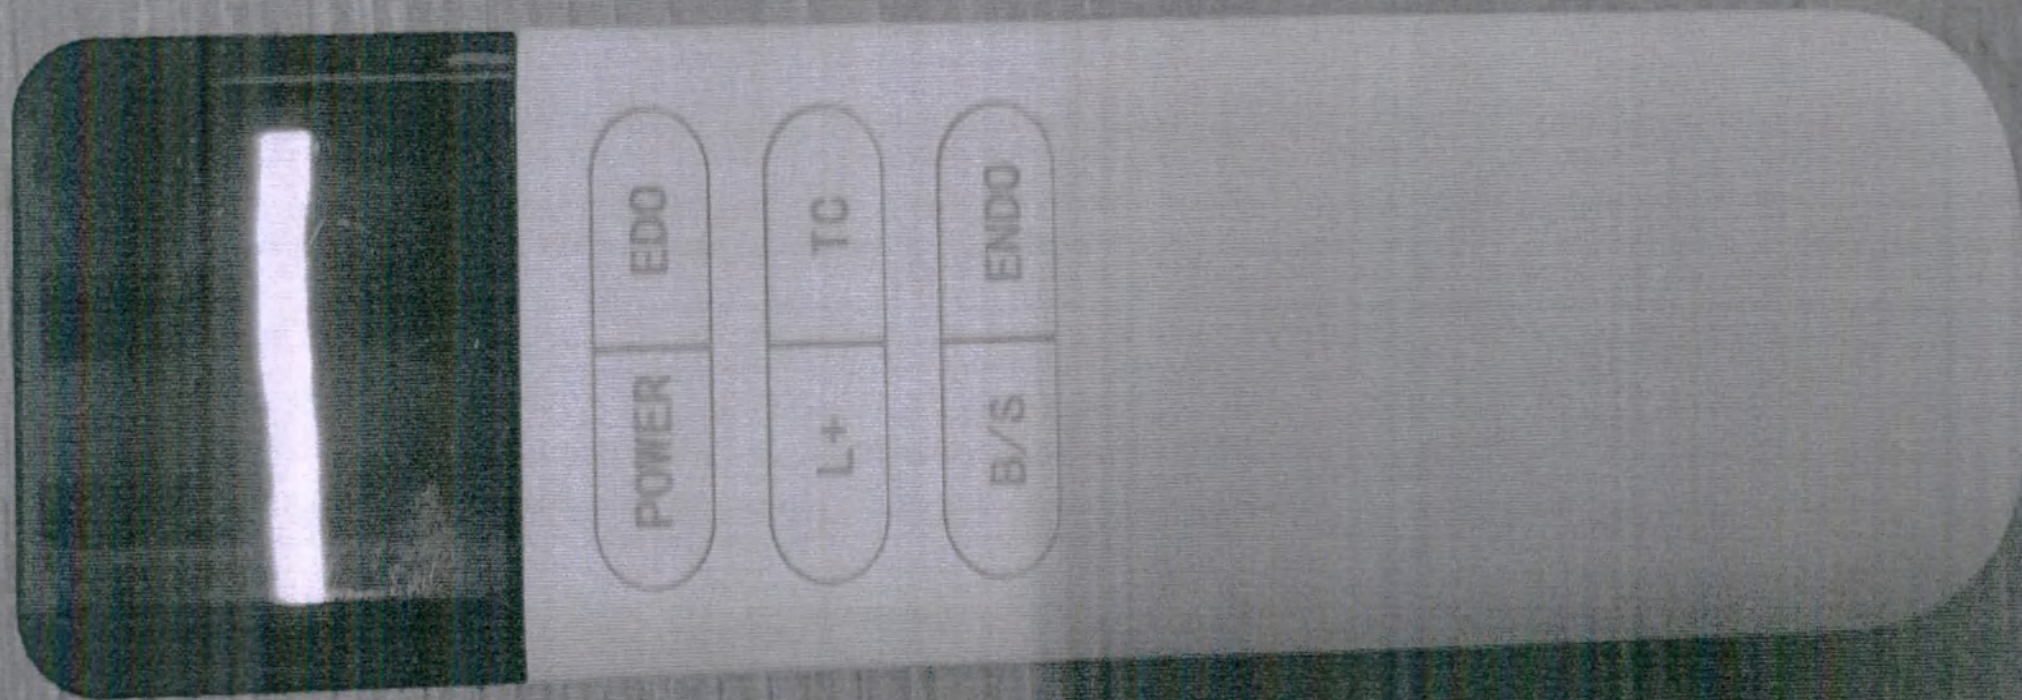


Рис. 27 – Блок установочный с одним горизонтальным плечом







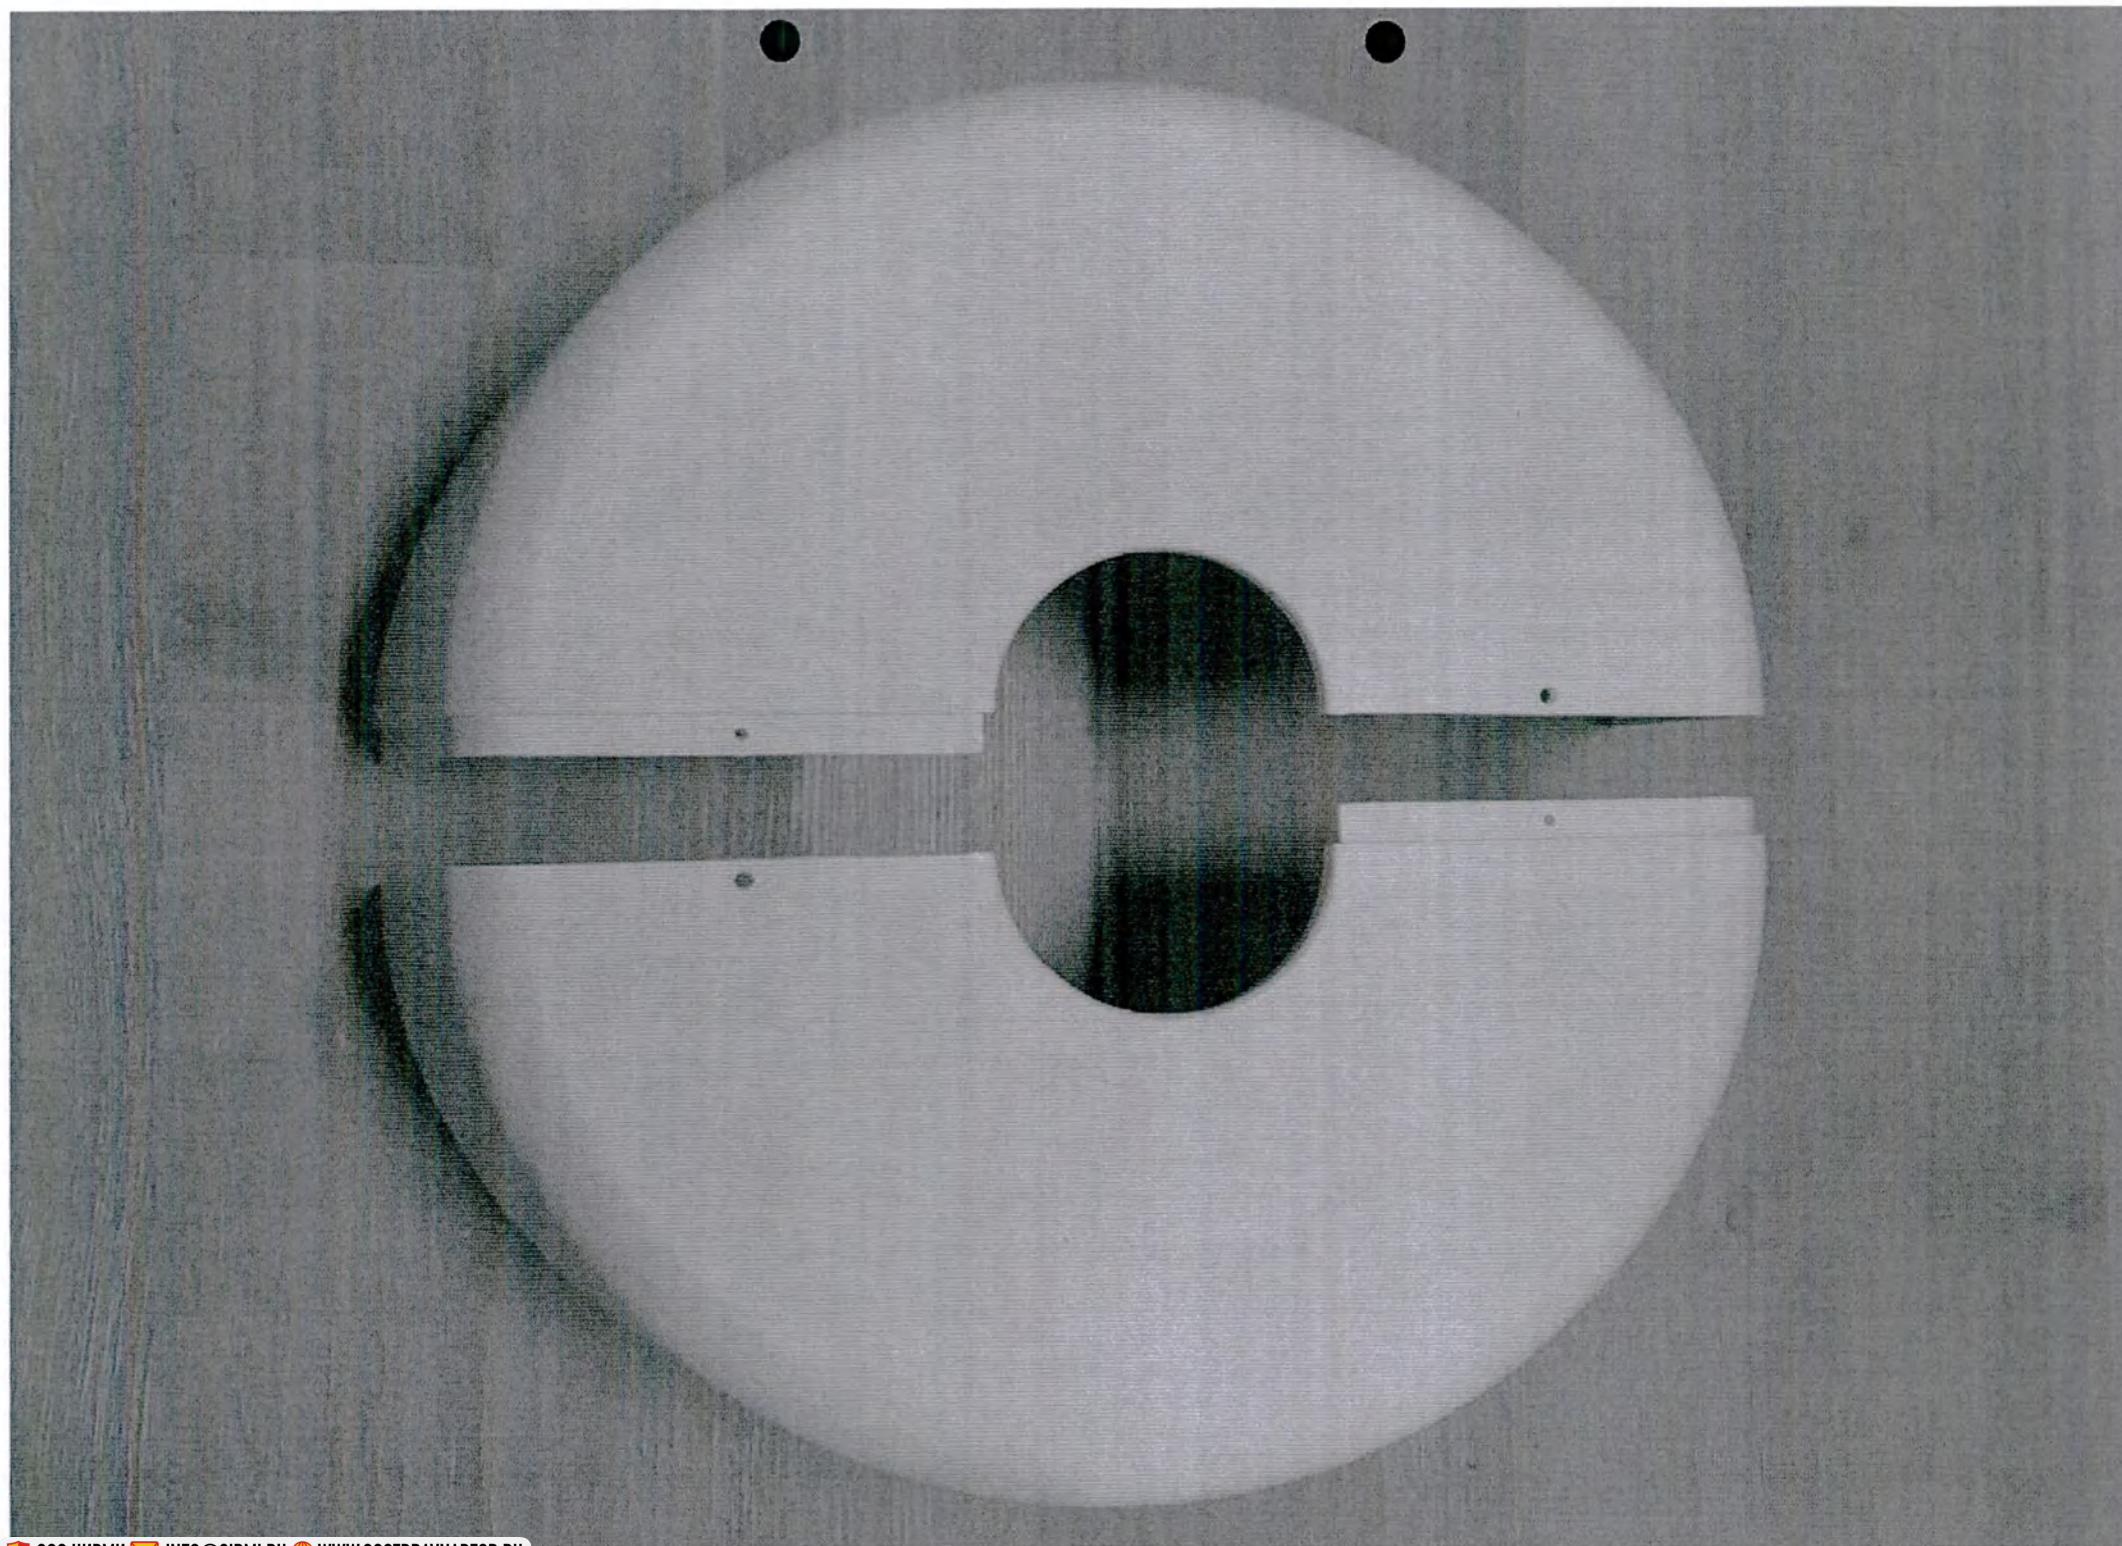


Рис. 31 – Кожух потолочный декоративный (2 шт.)

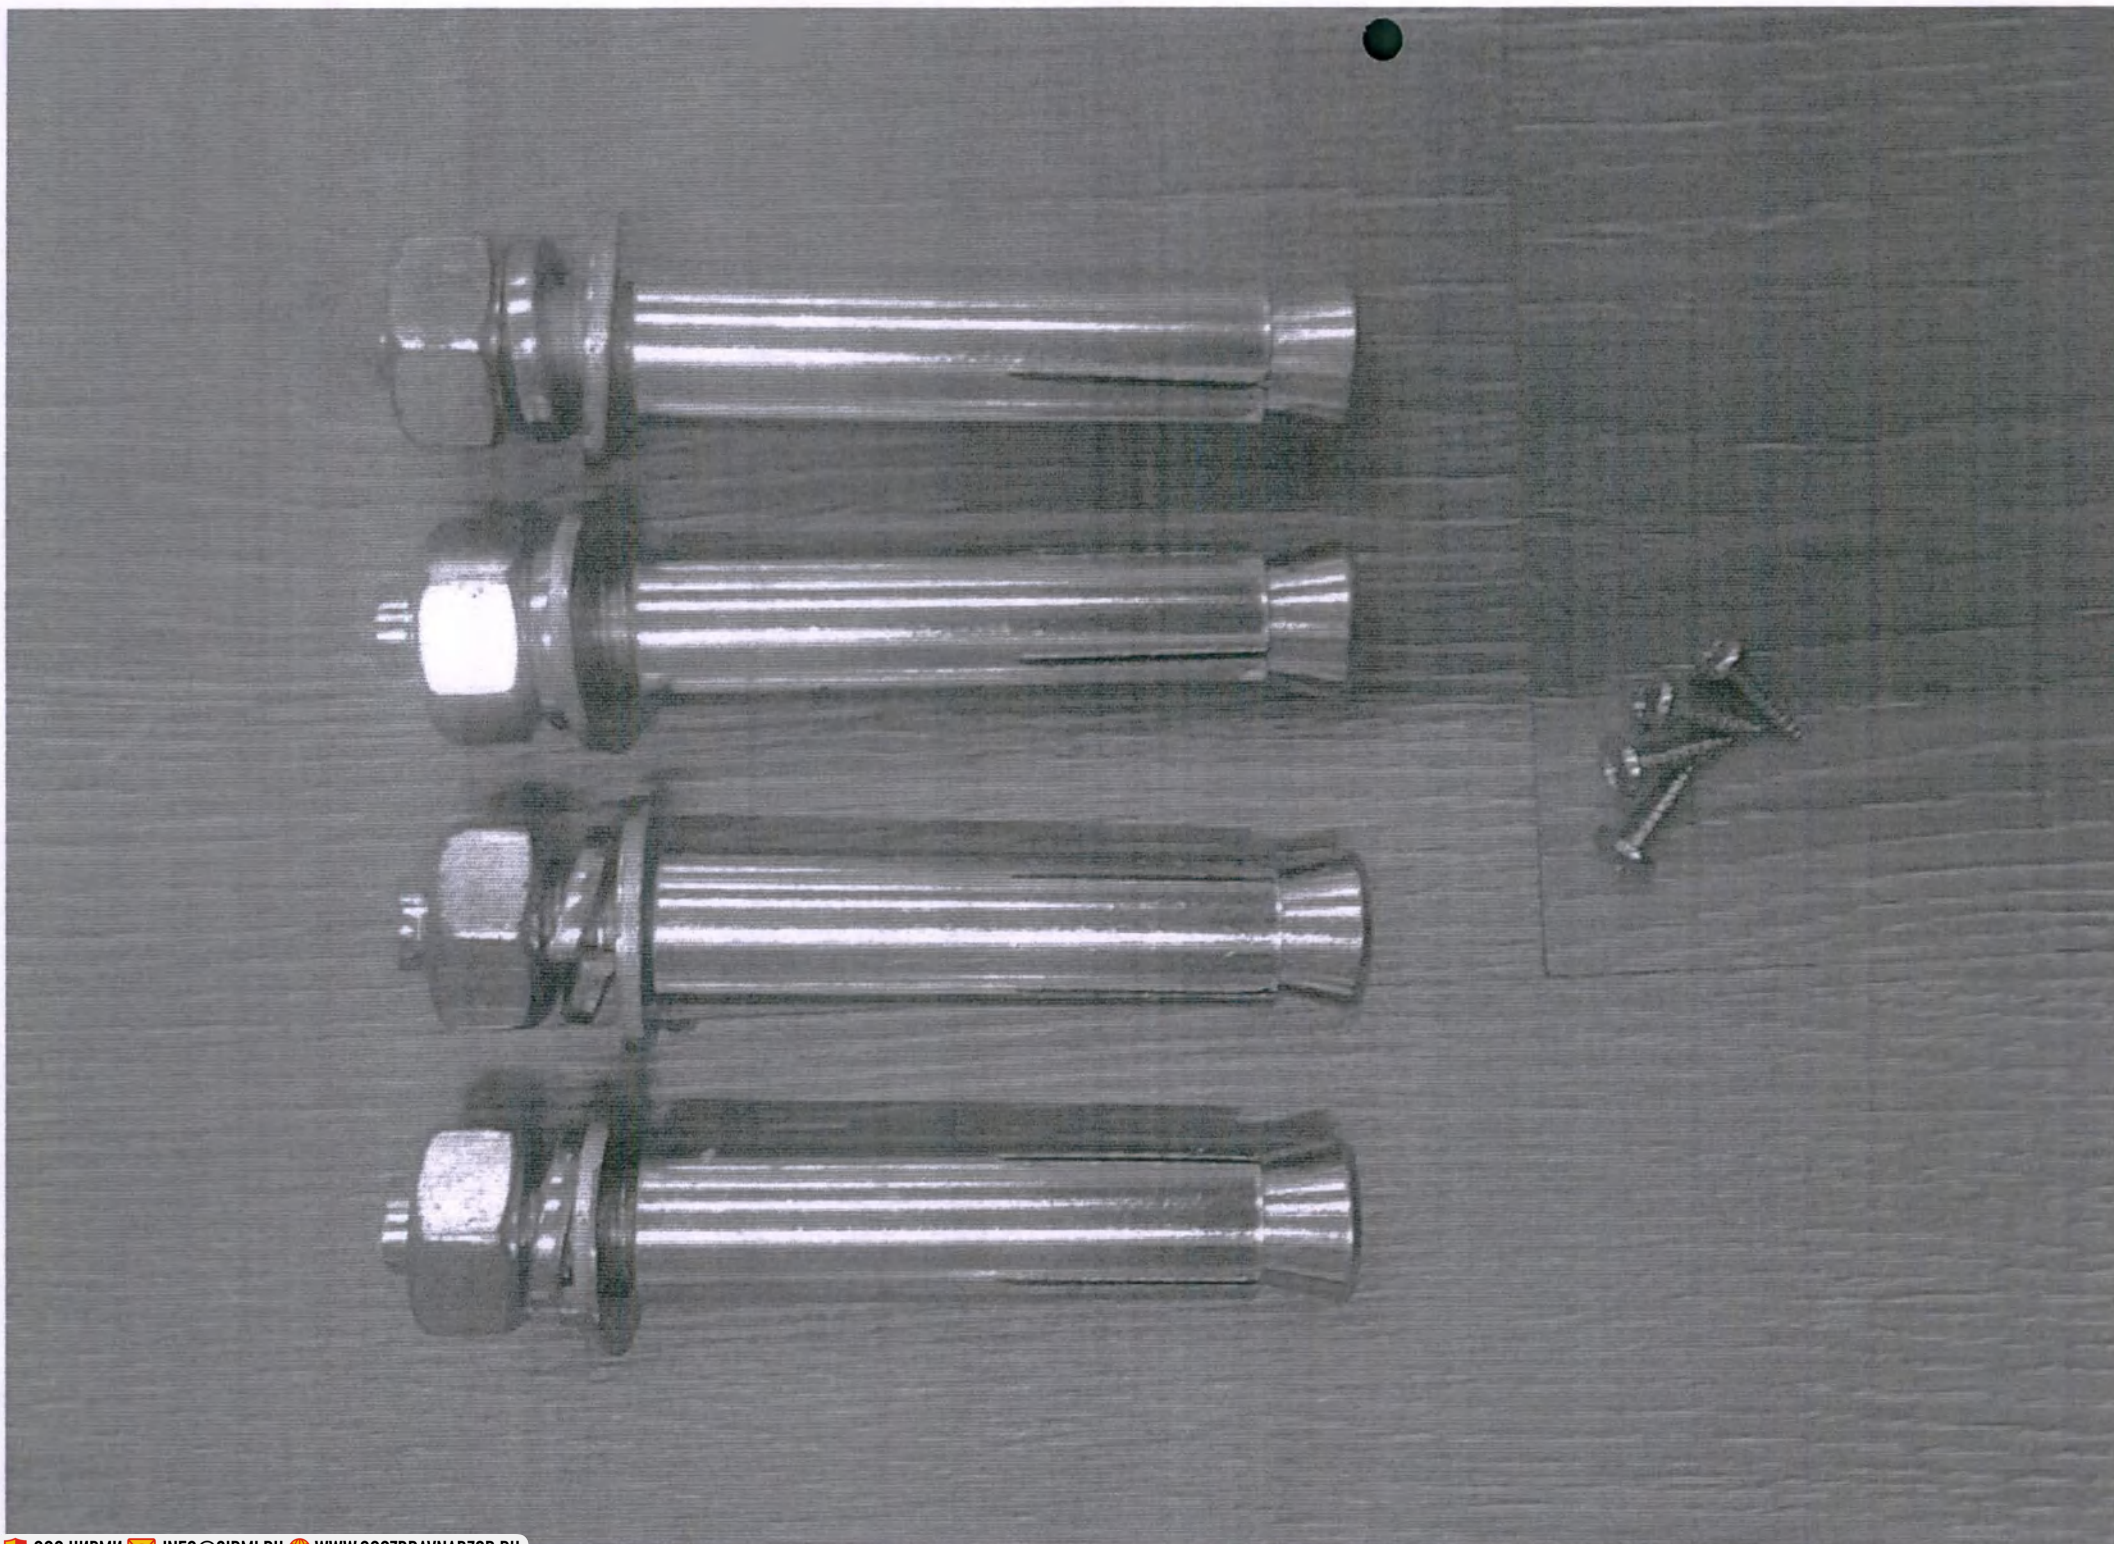


Рис. 32 – Комплект крепежа

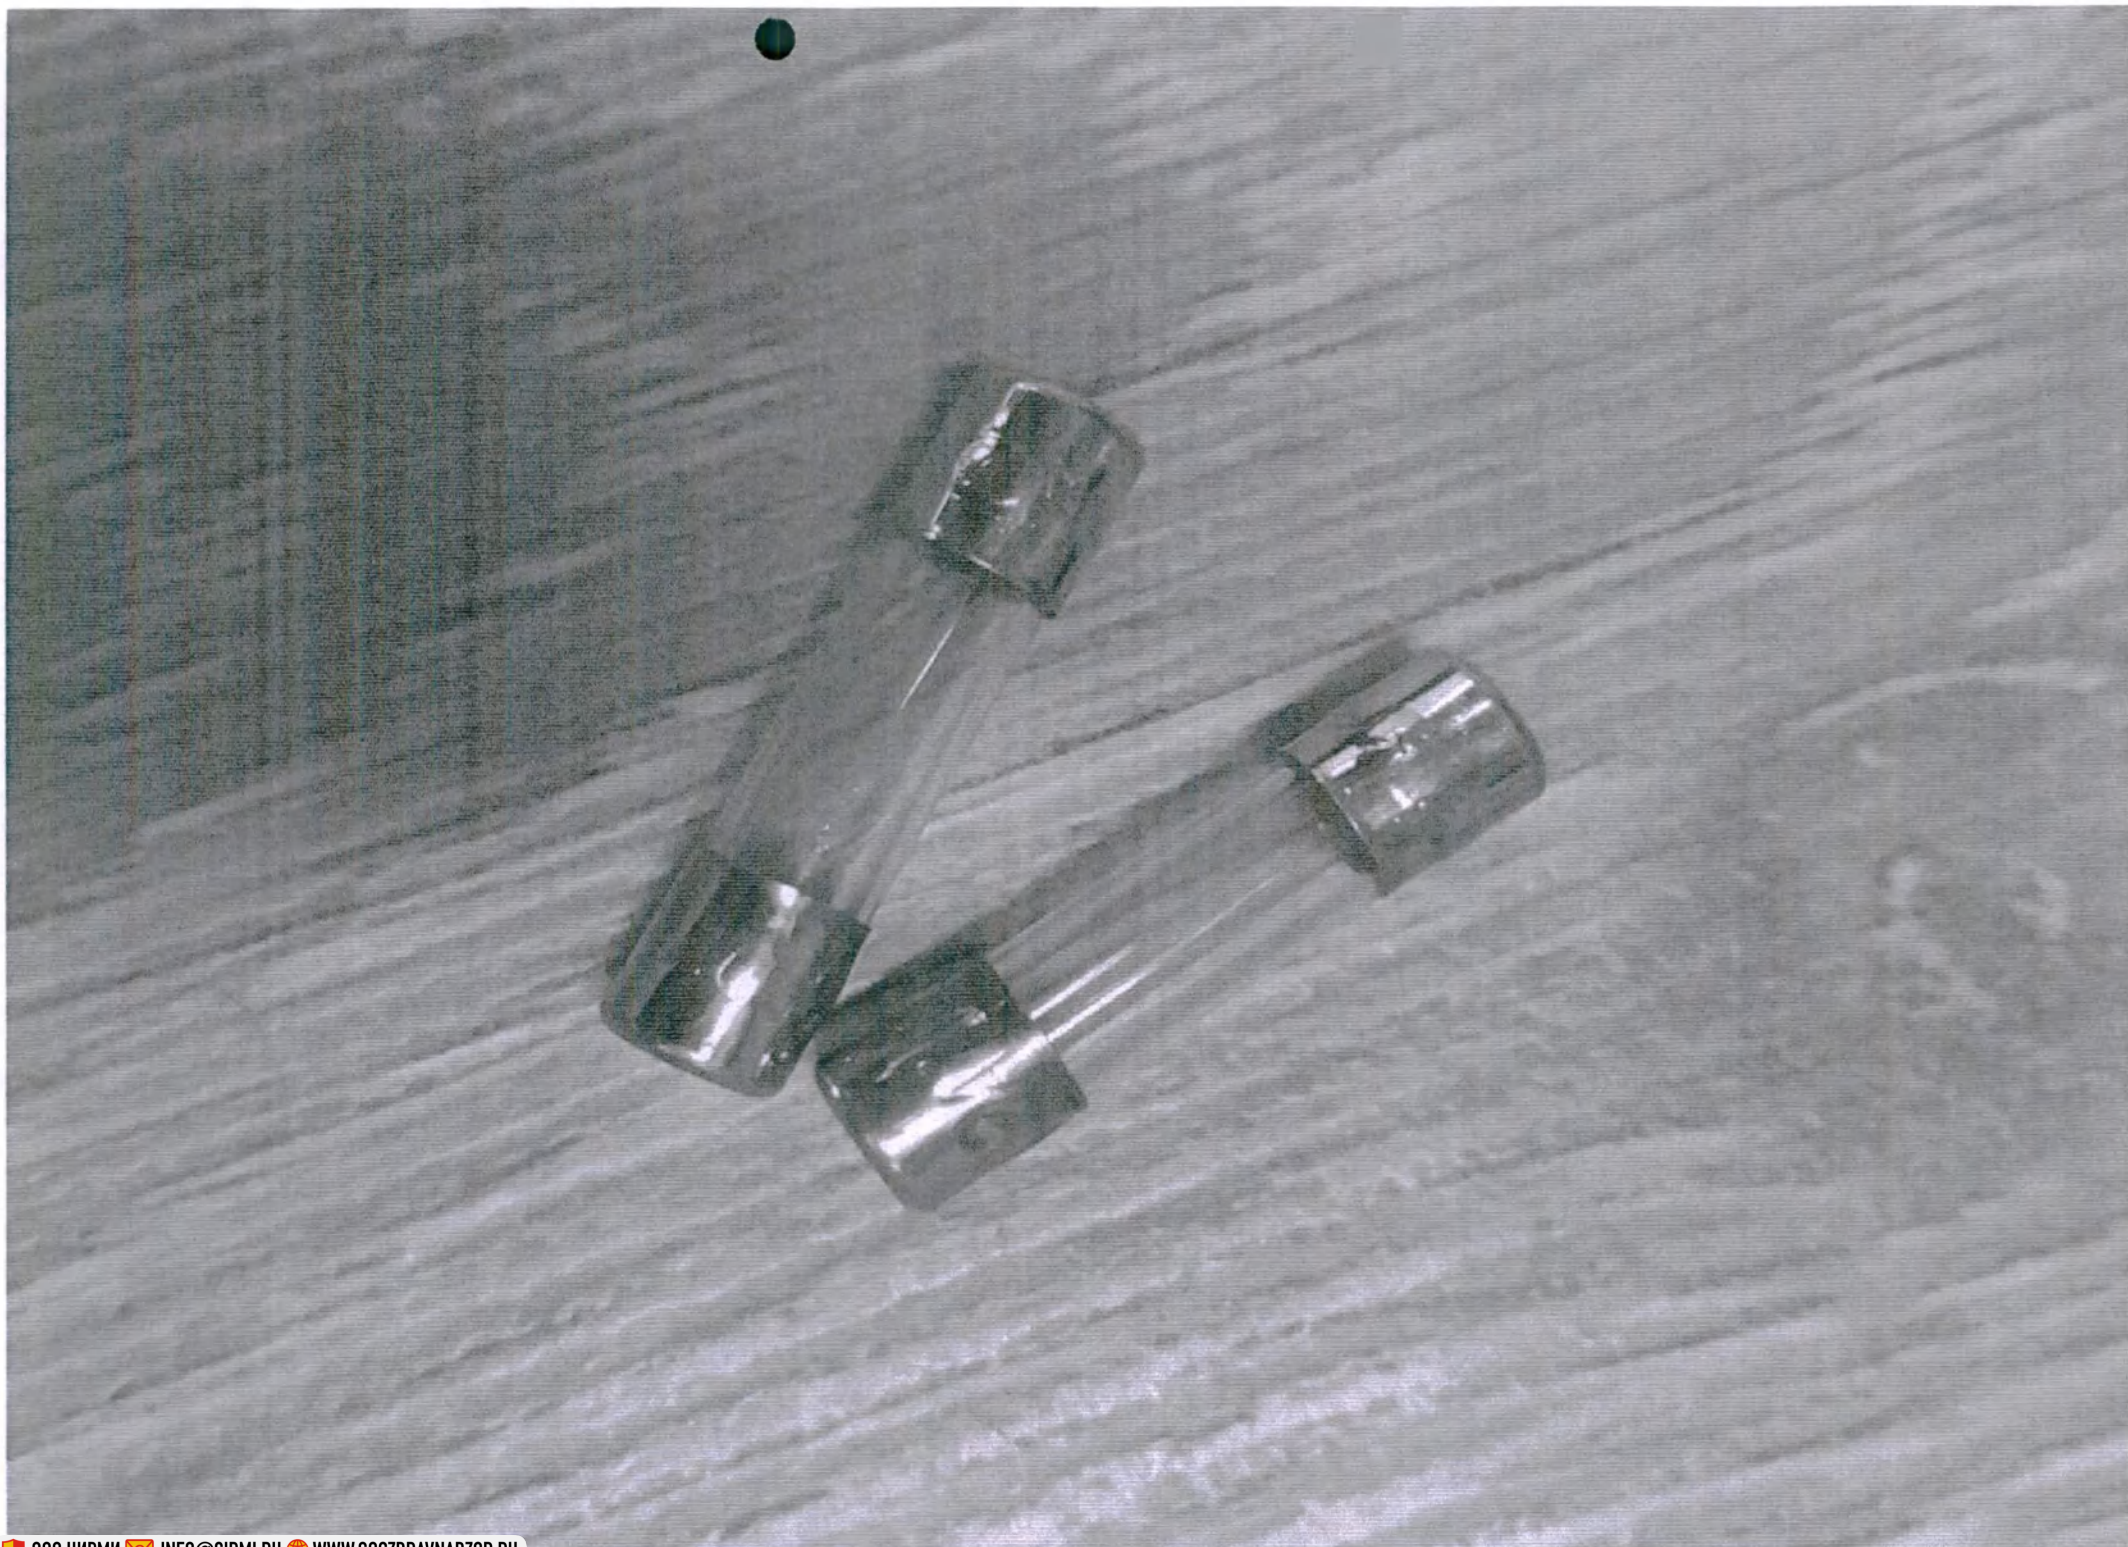
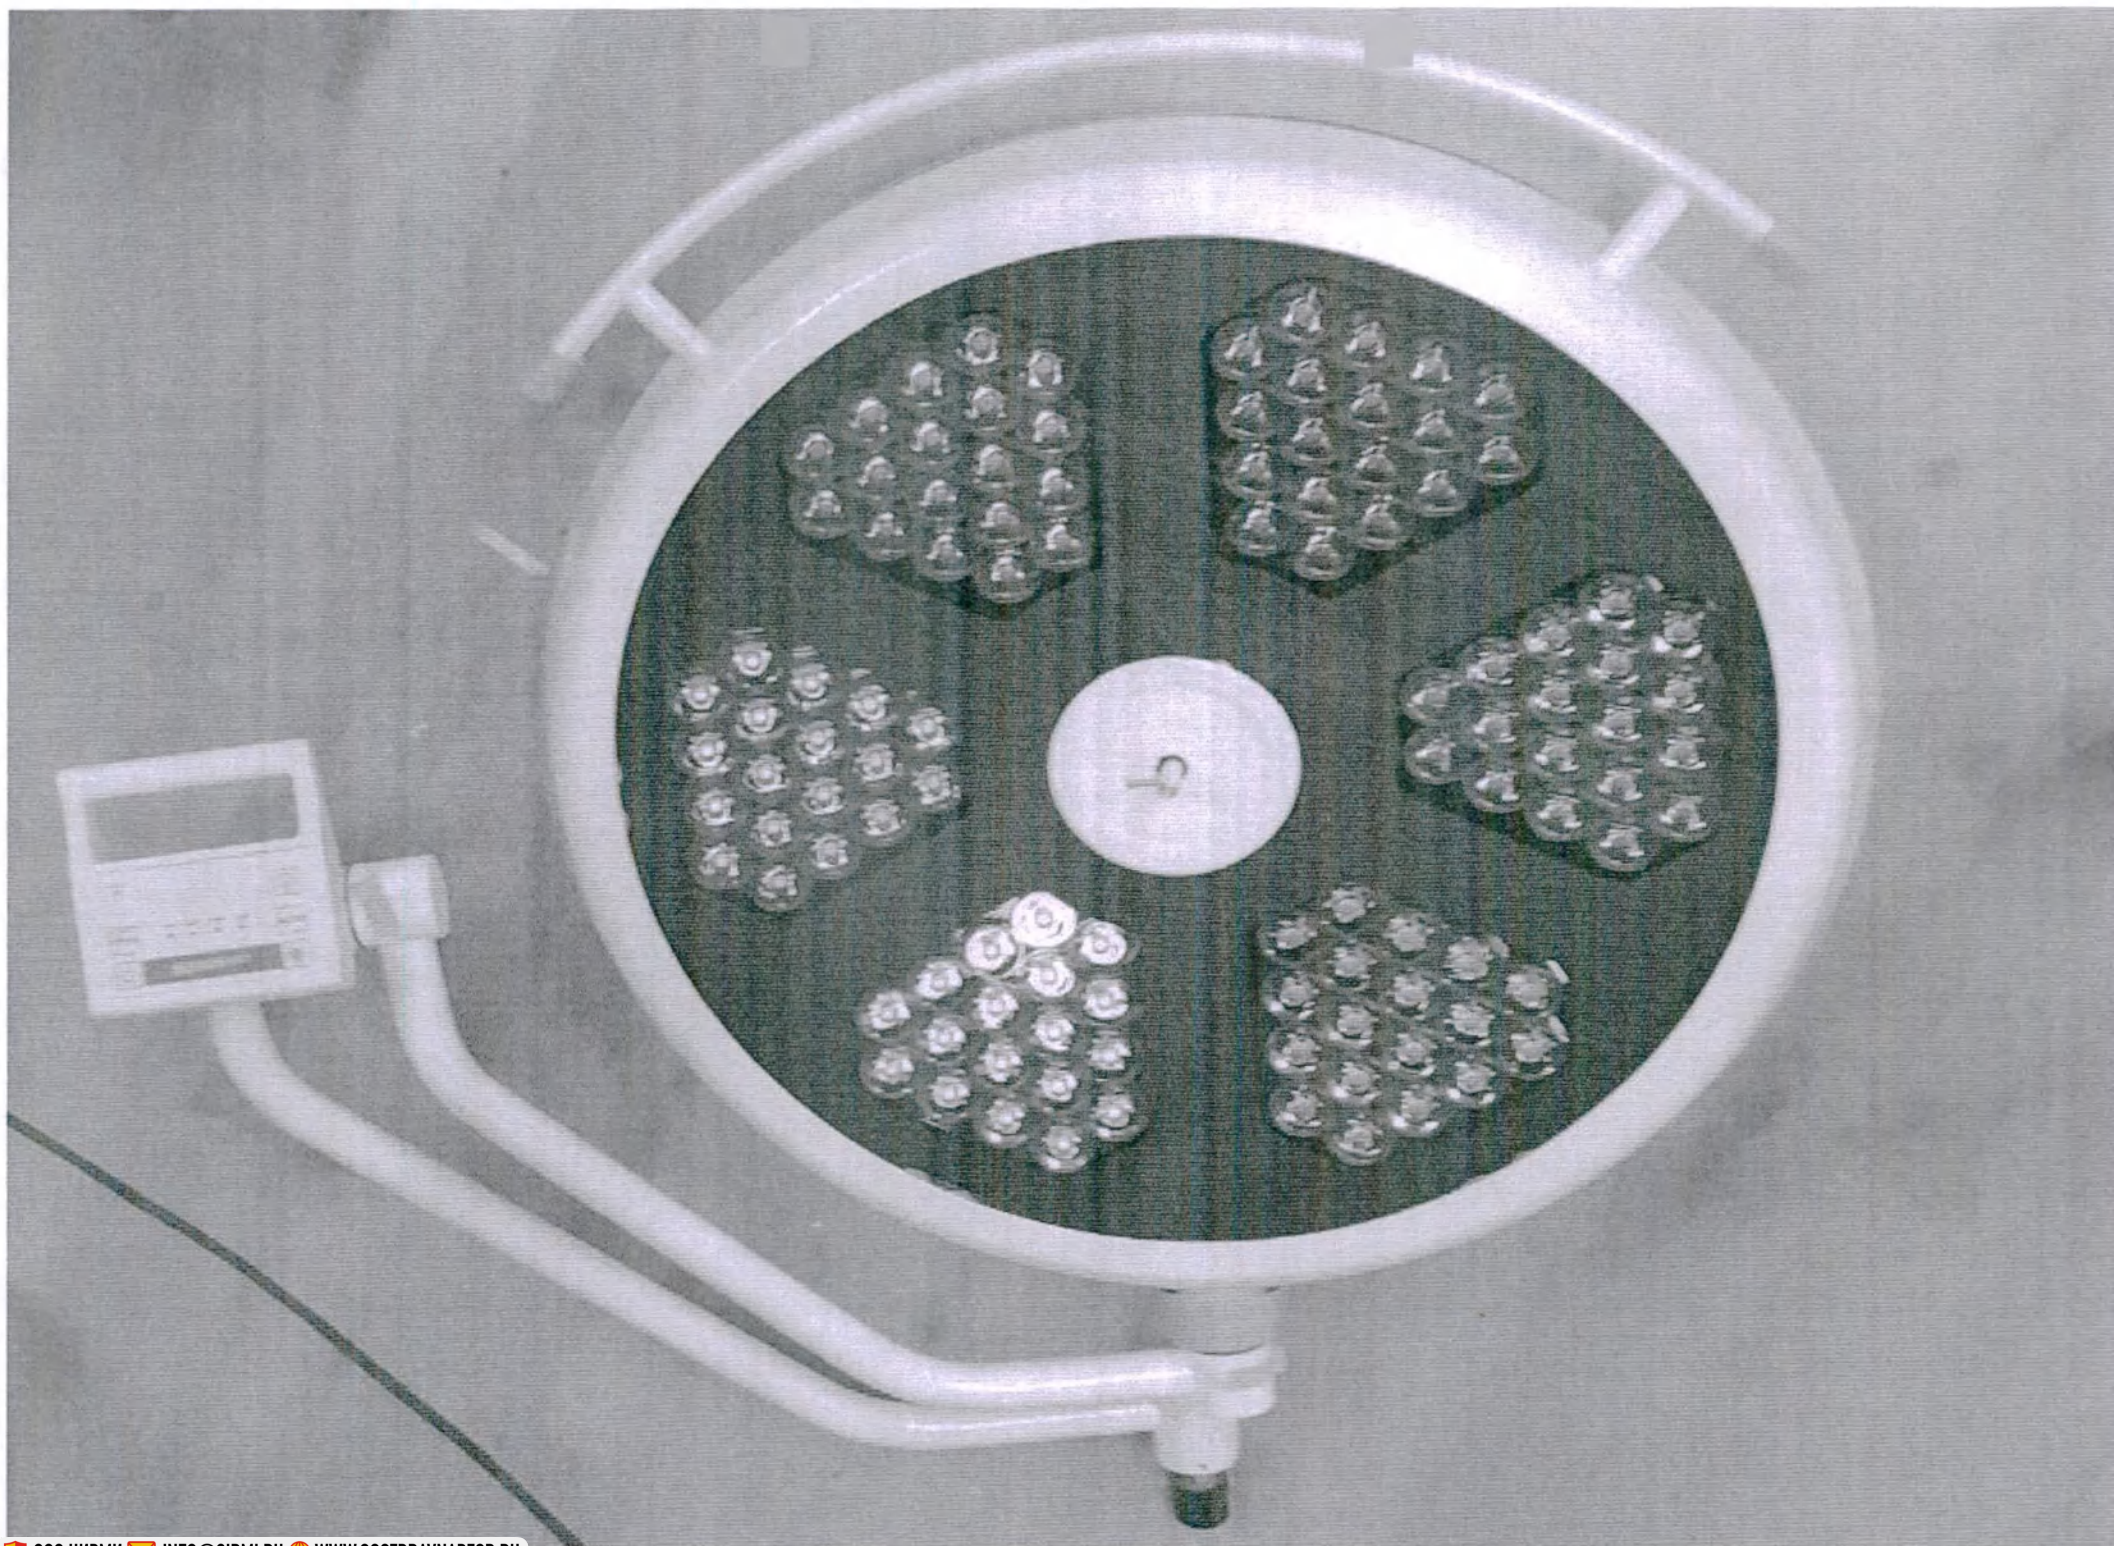


Рис. 33 – Предохранитель плавкий F2AL250V запасной (2 шт.)





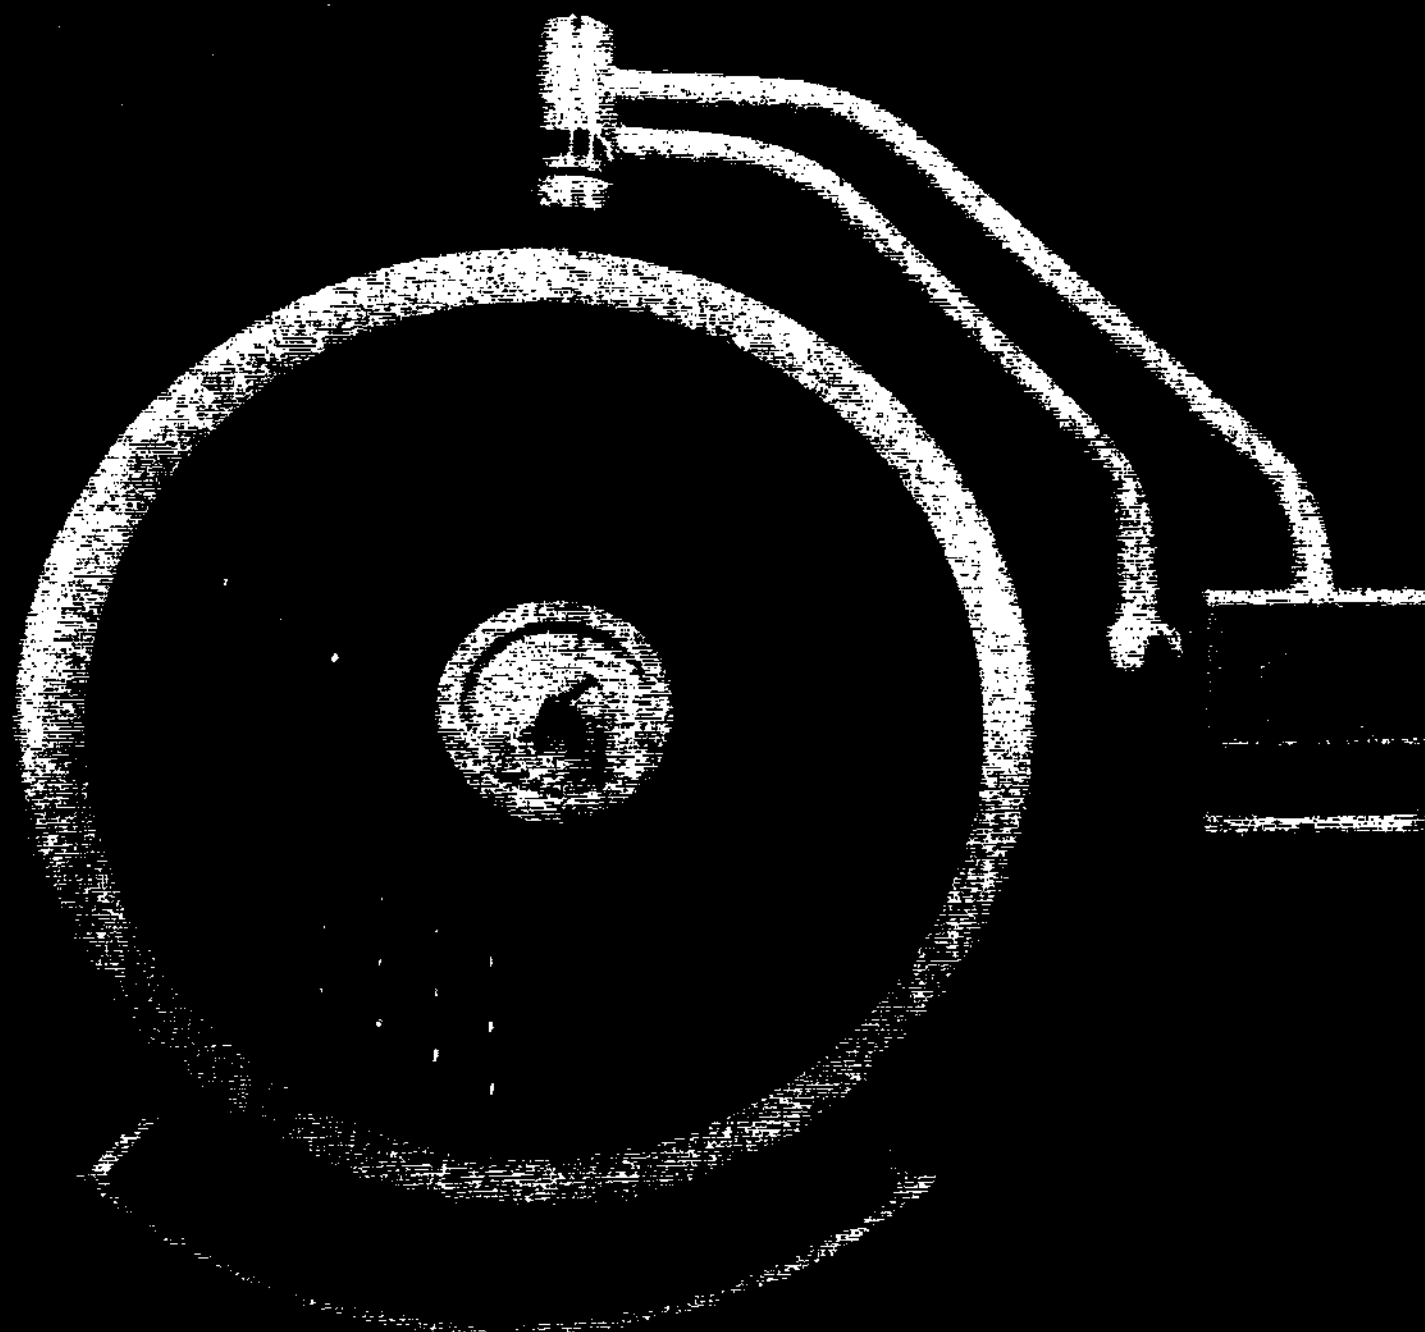
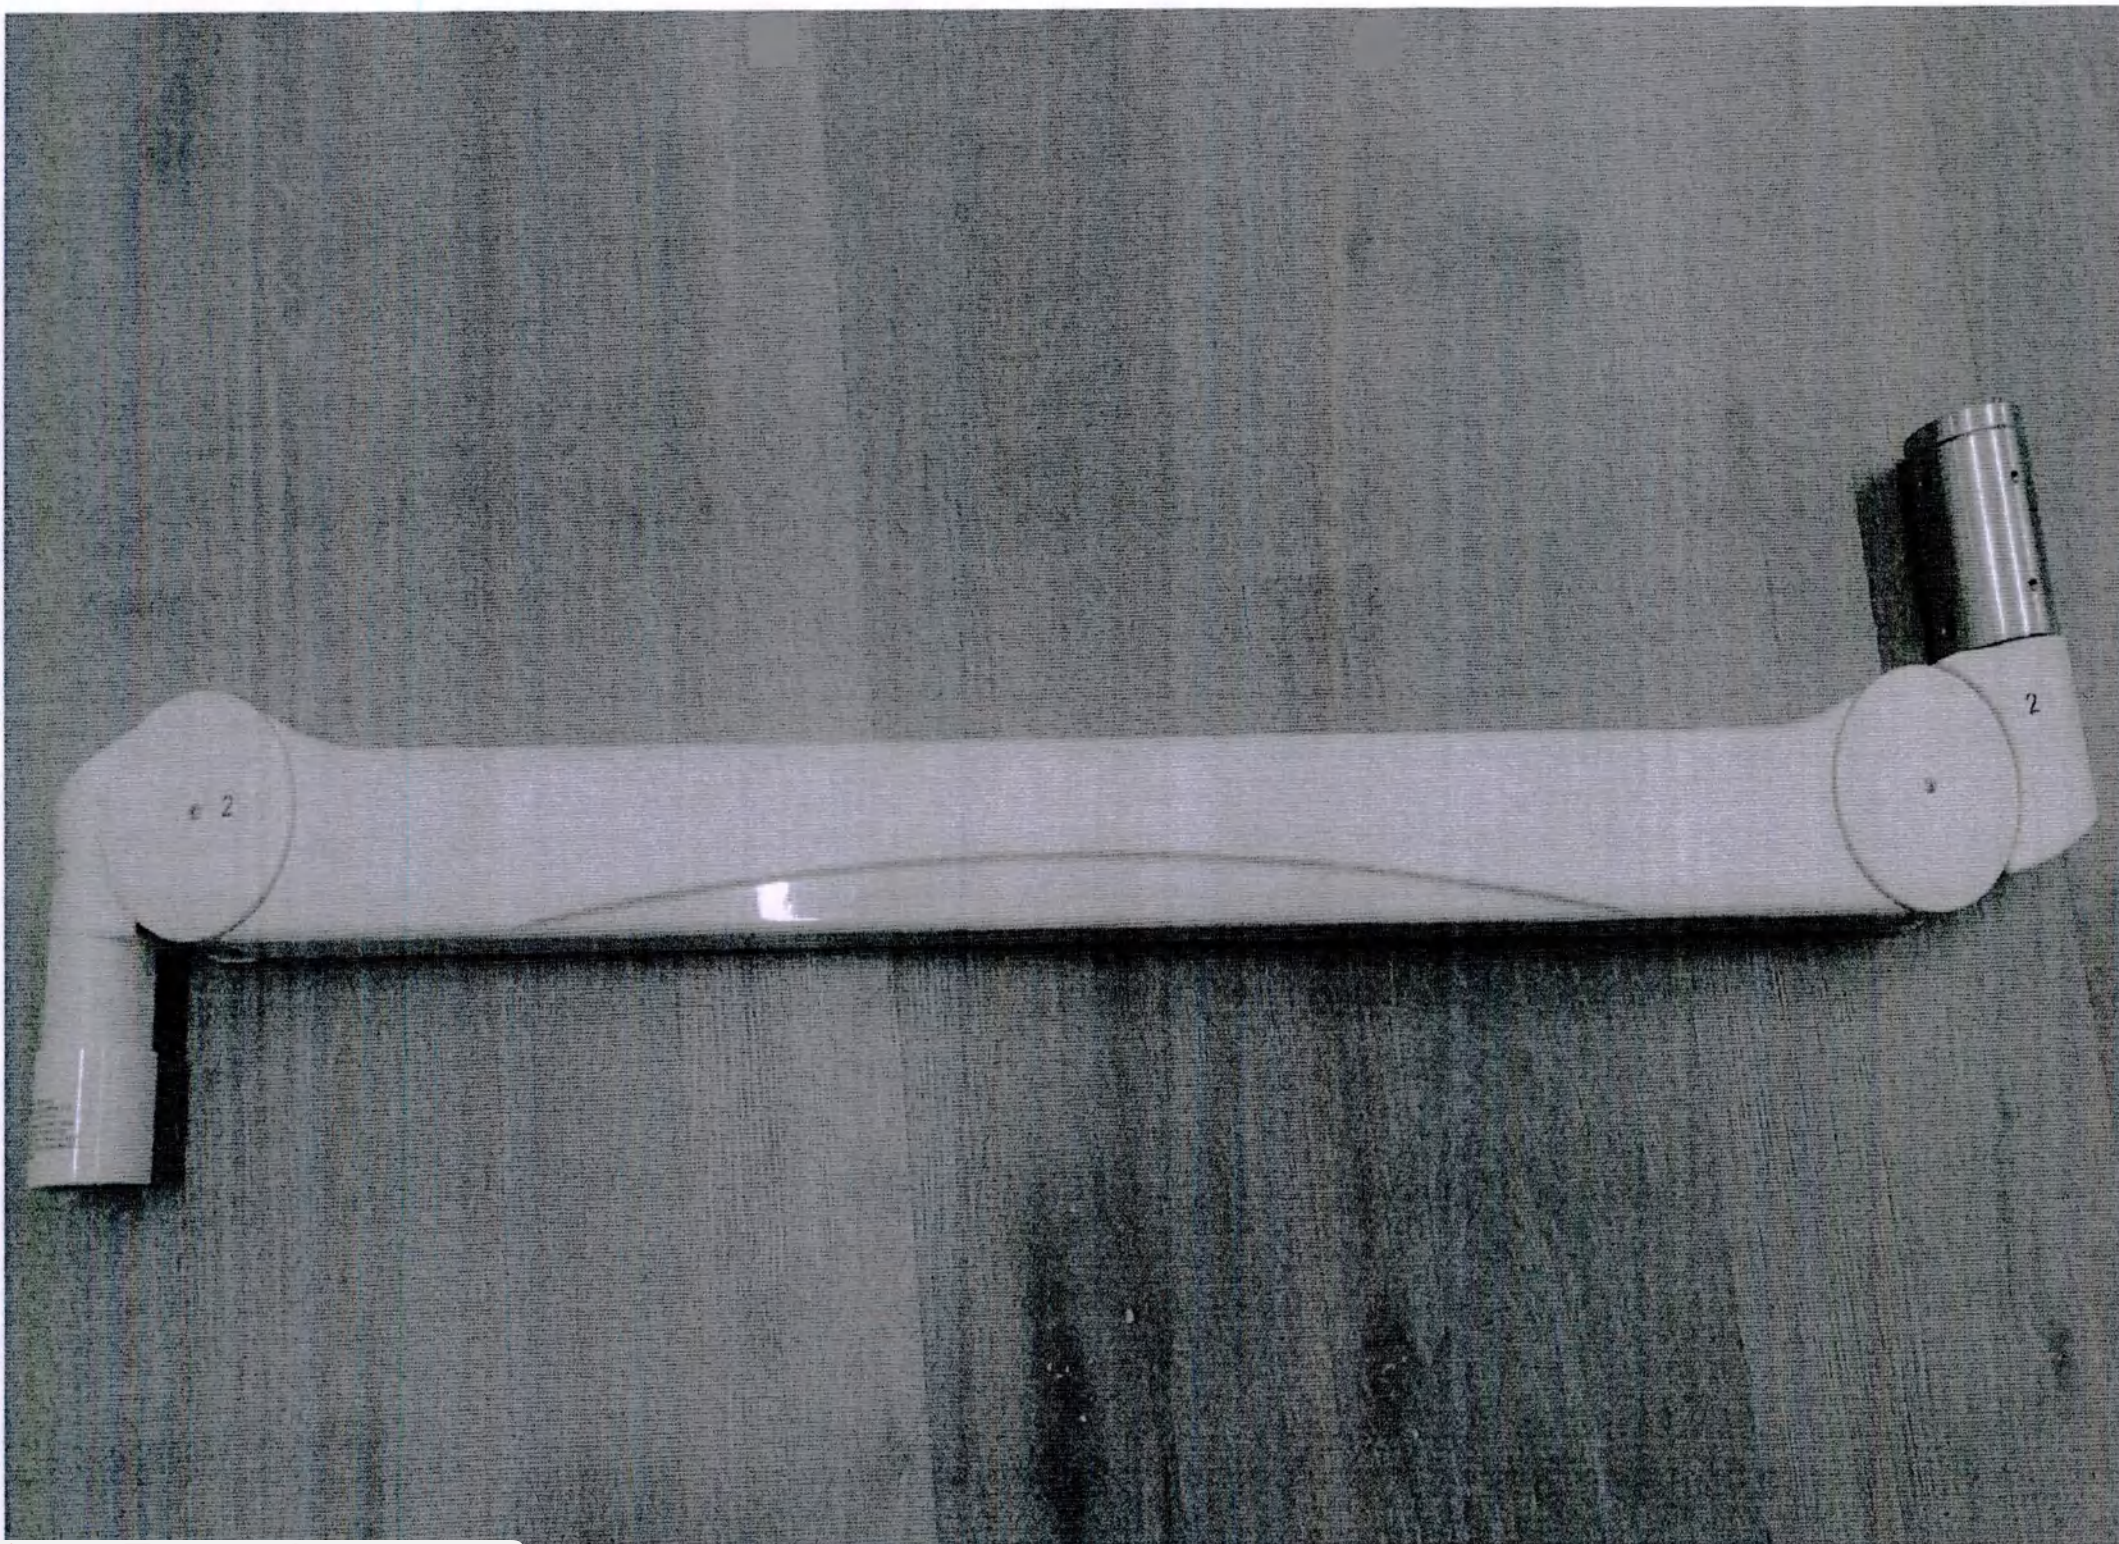




Рис. 37 – Плечо балансировочное 1



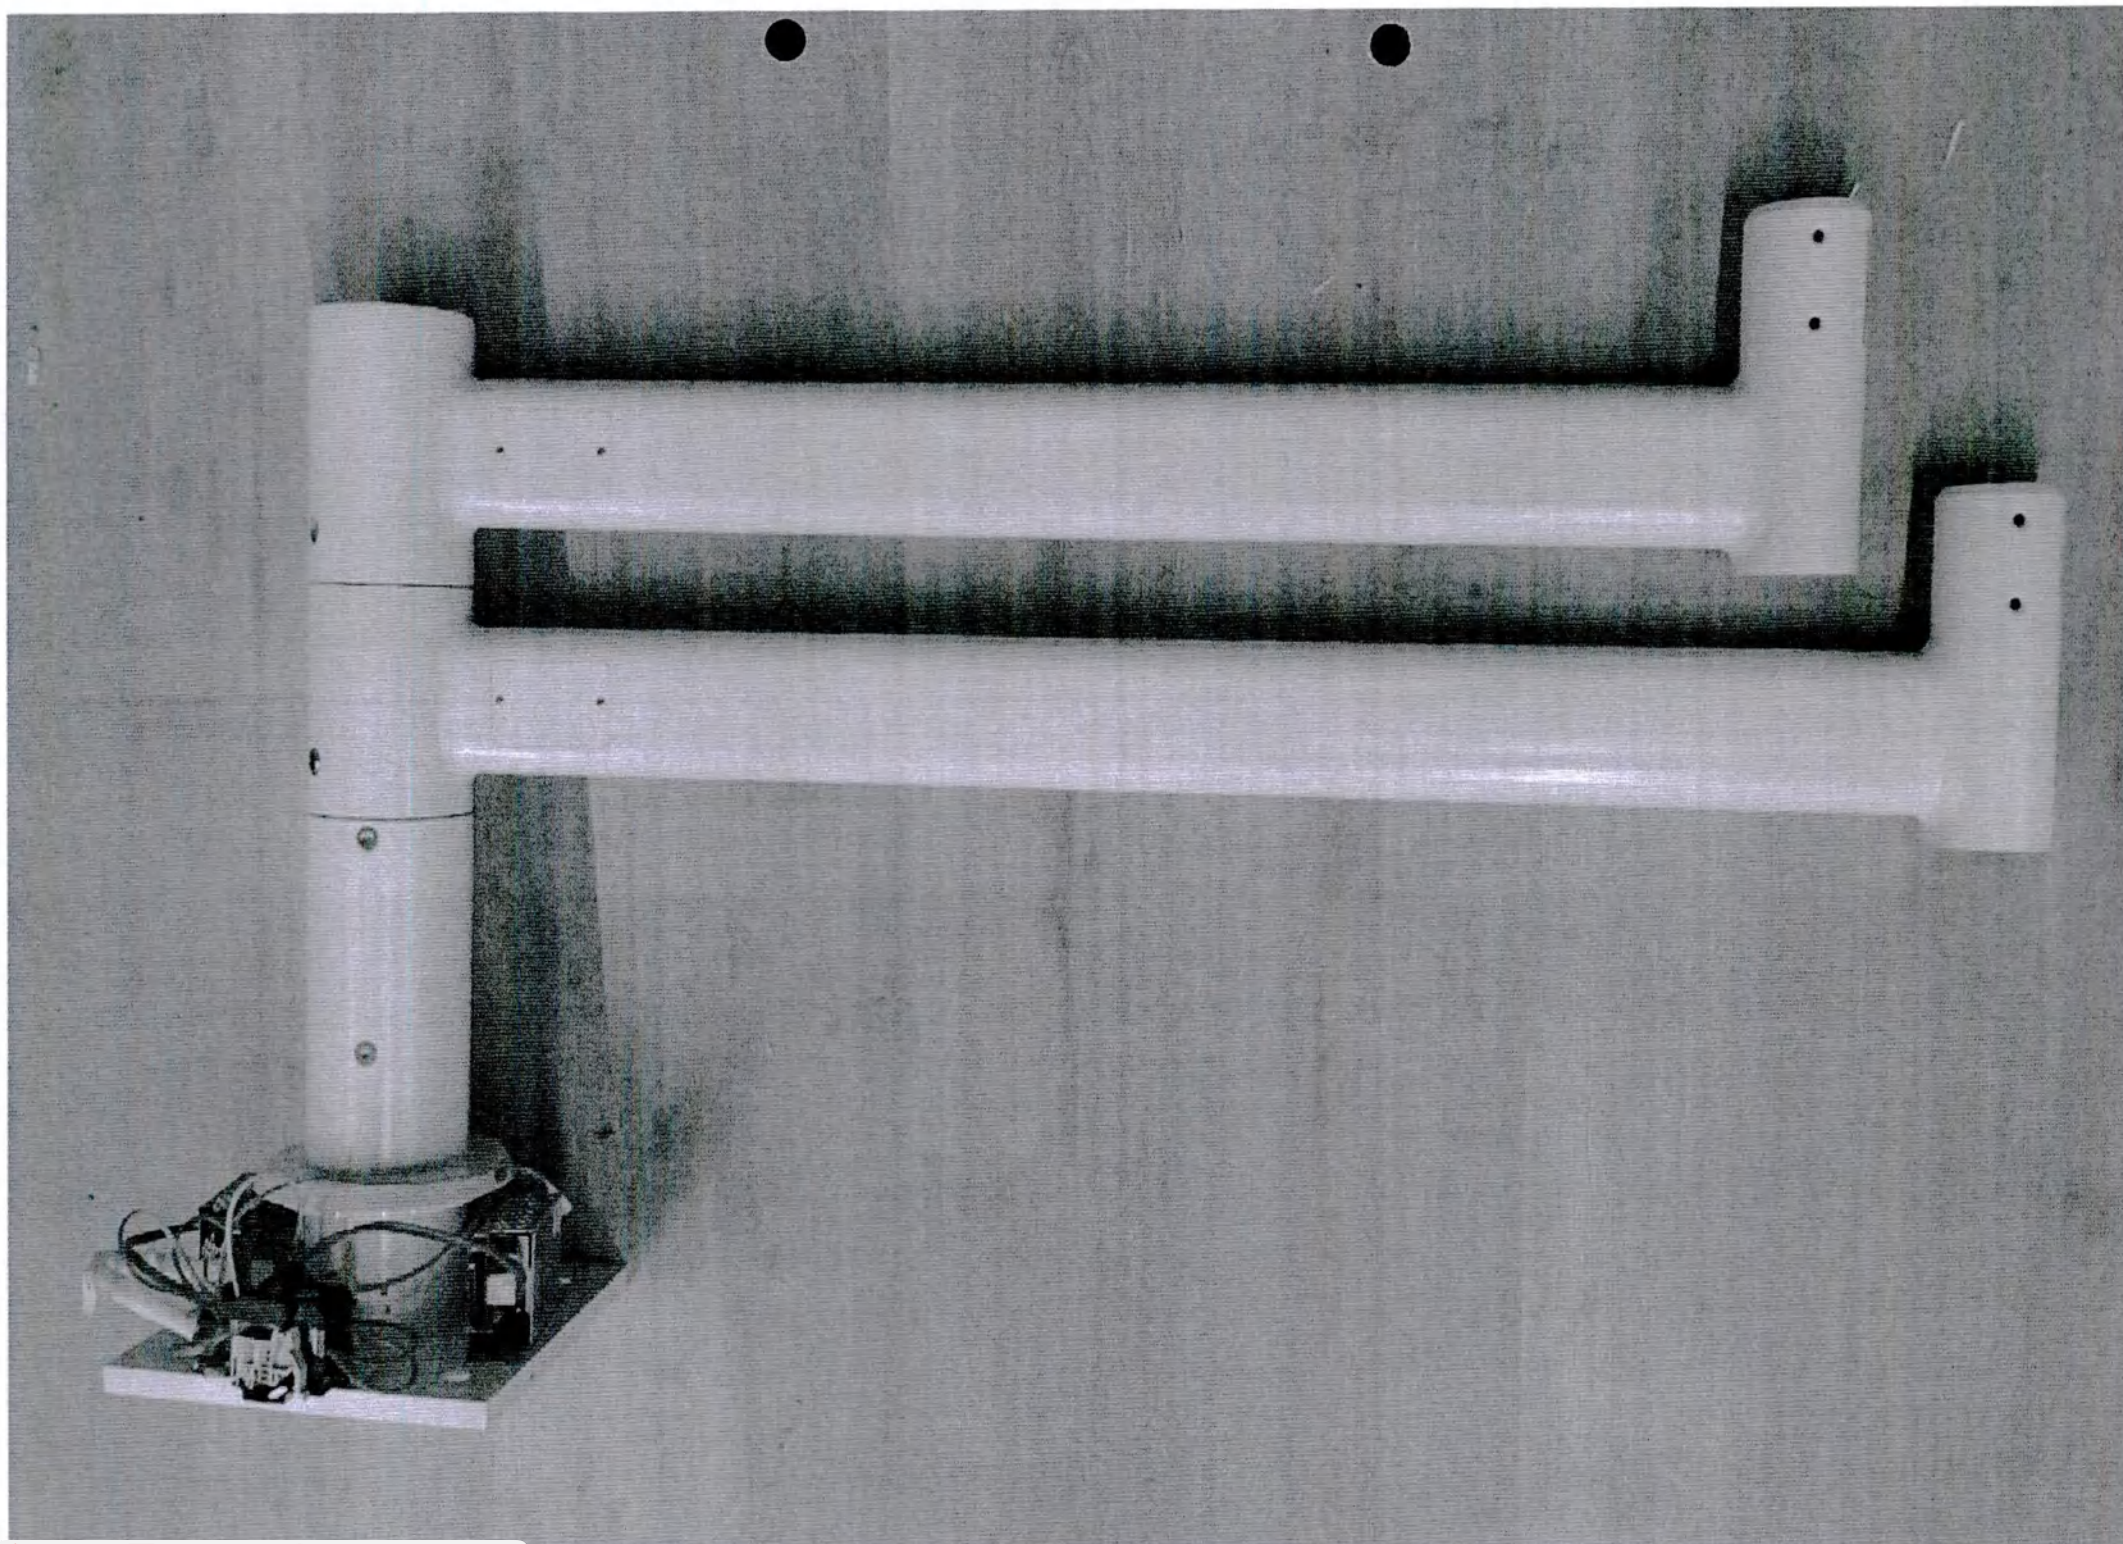


Рис. 39 – Блок установочный с двумя горизонтальными плечами

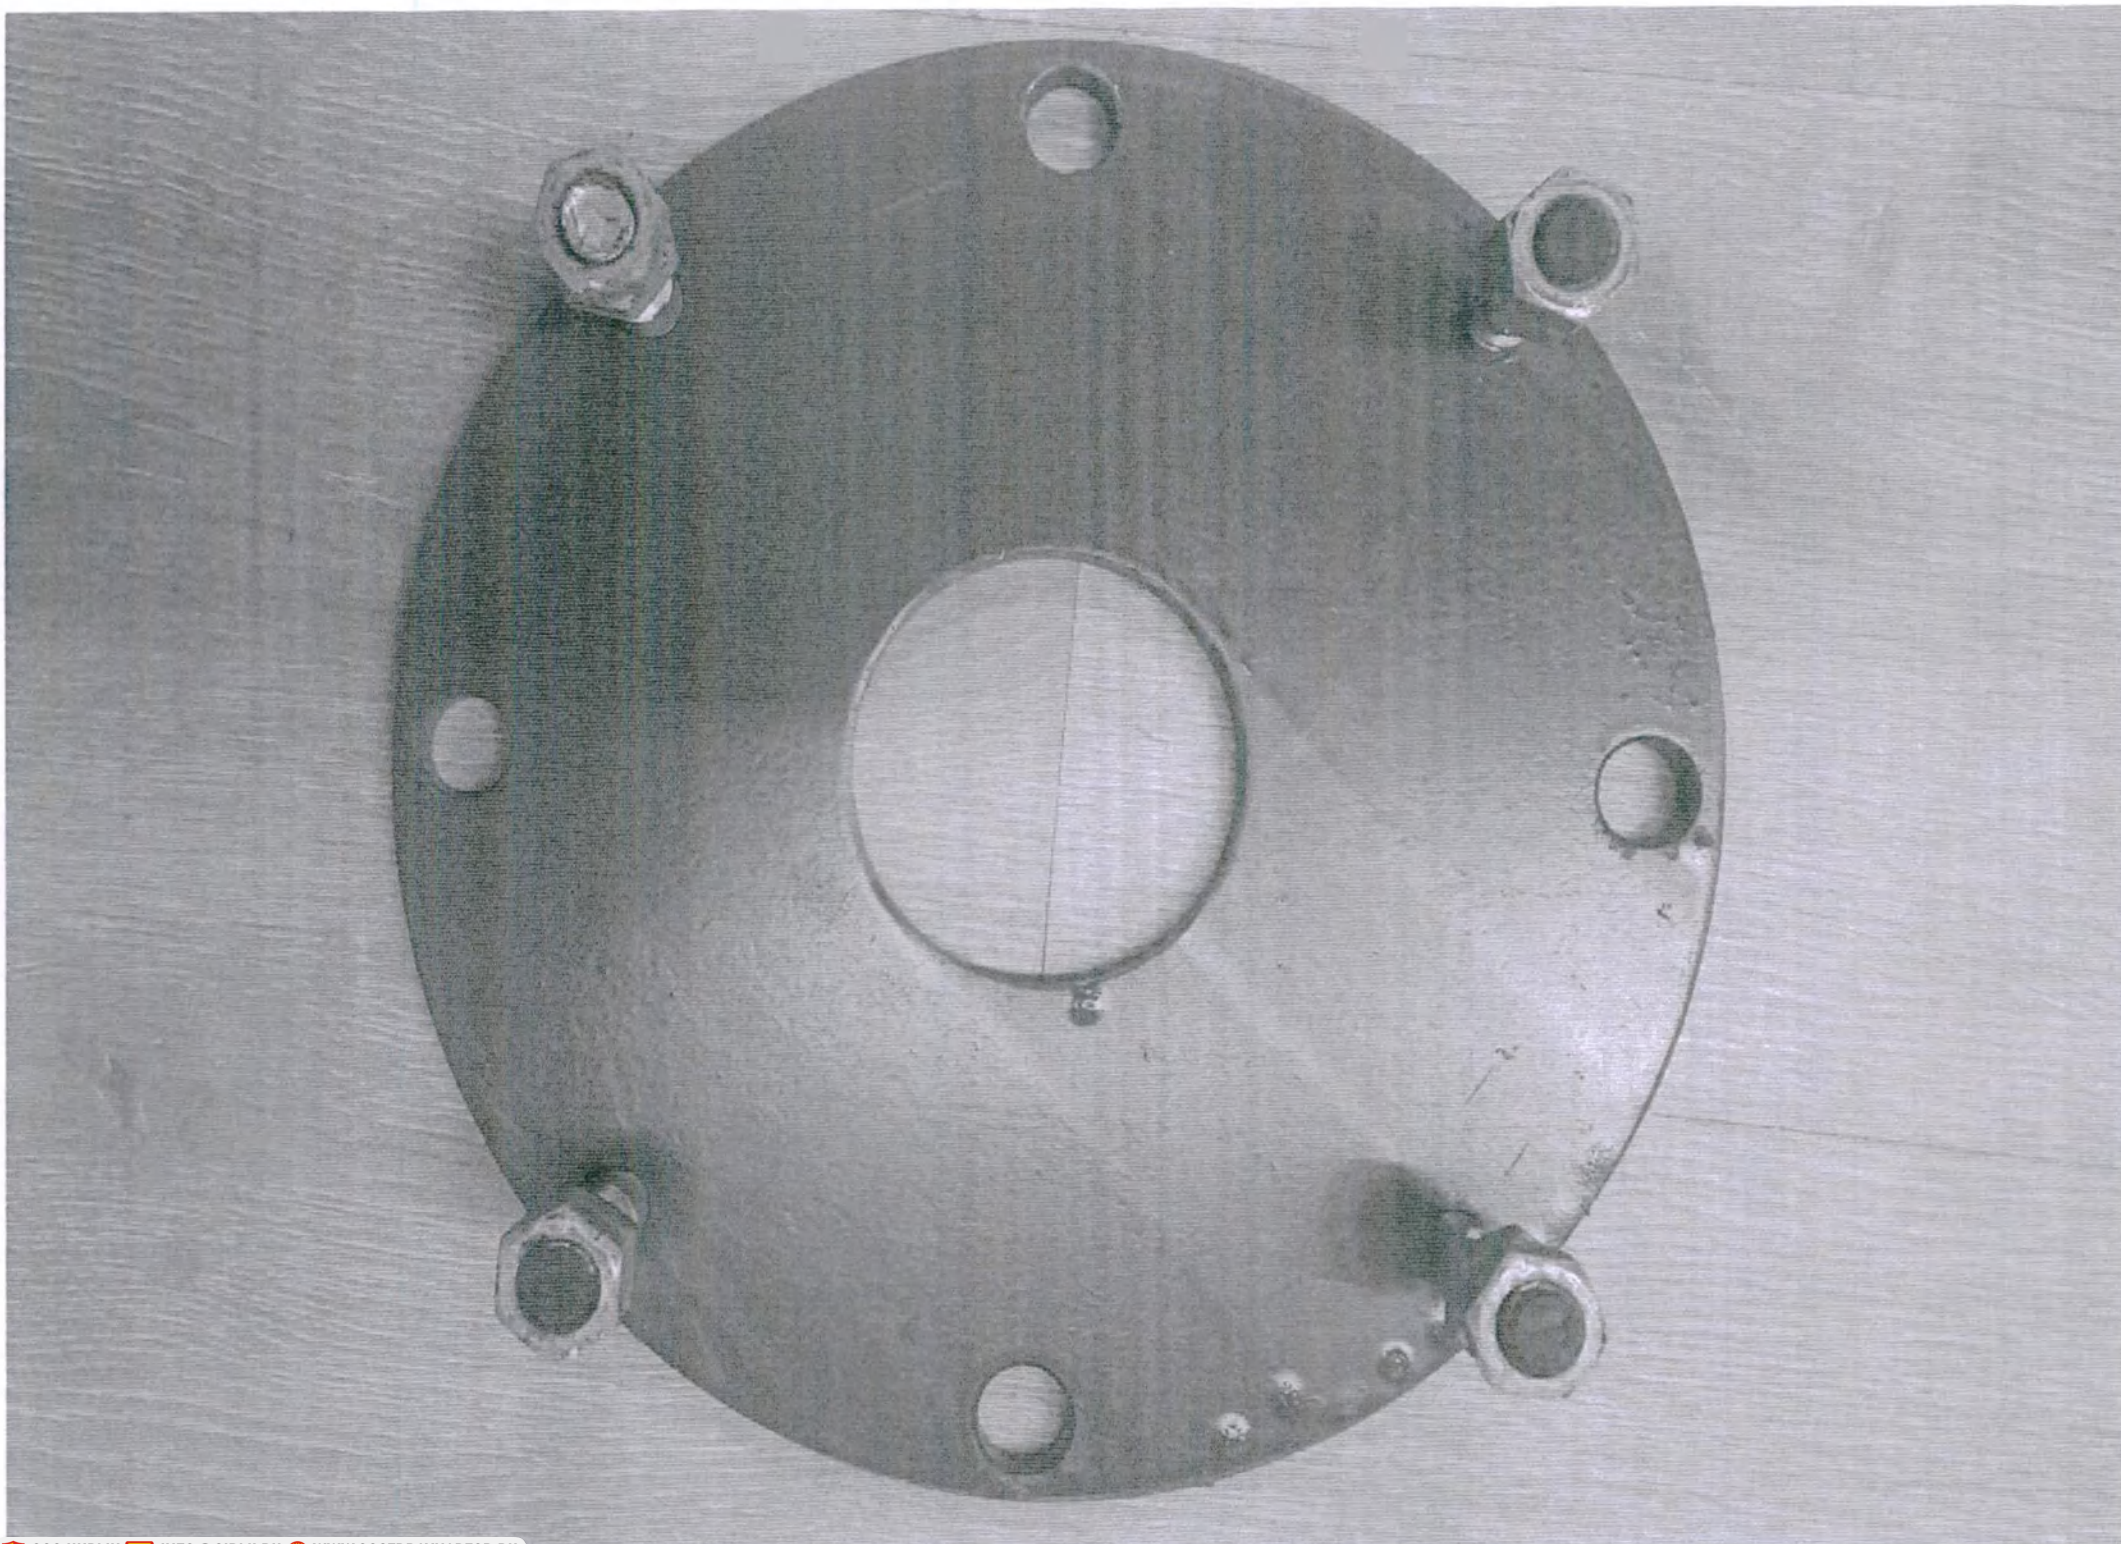
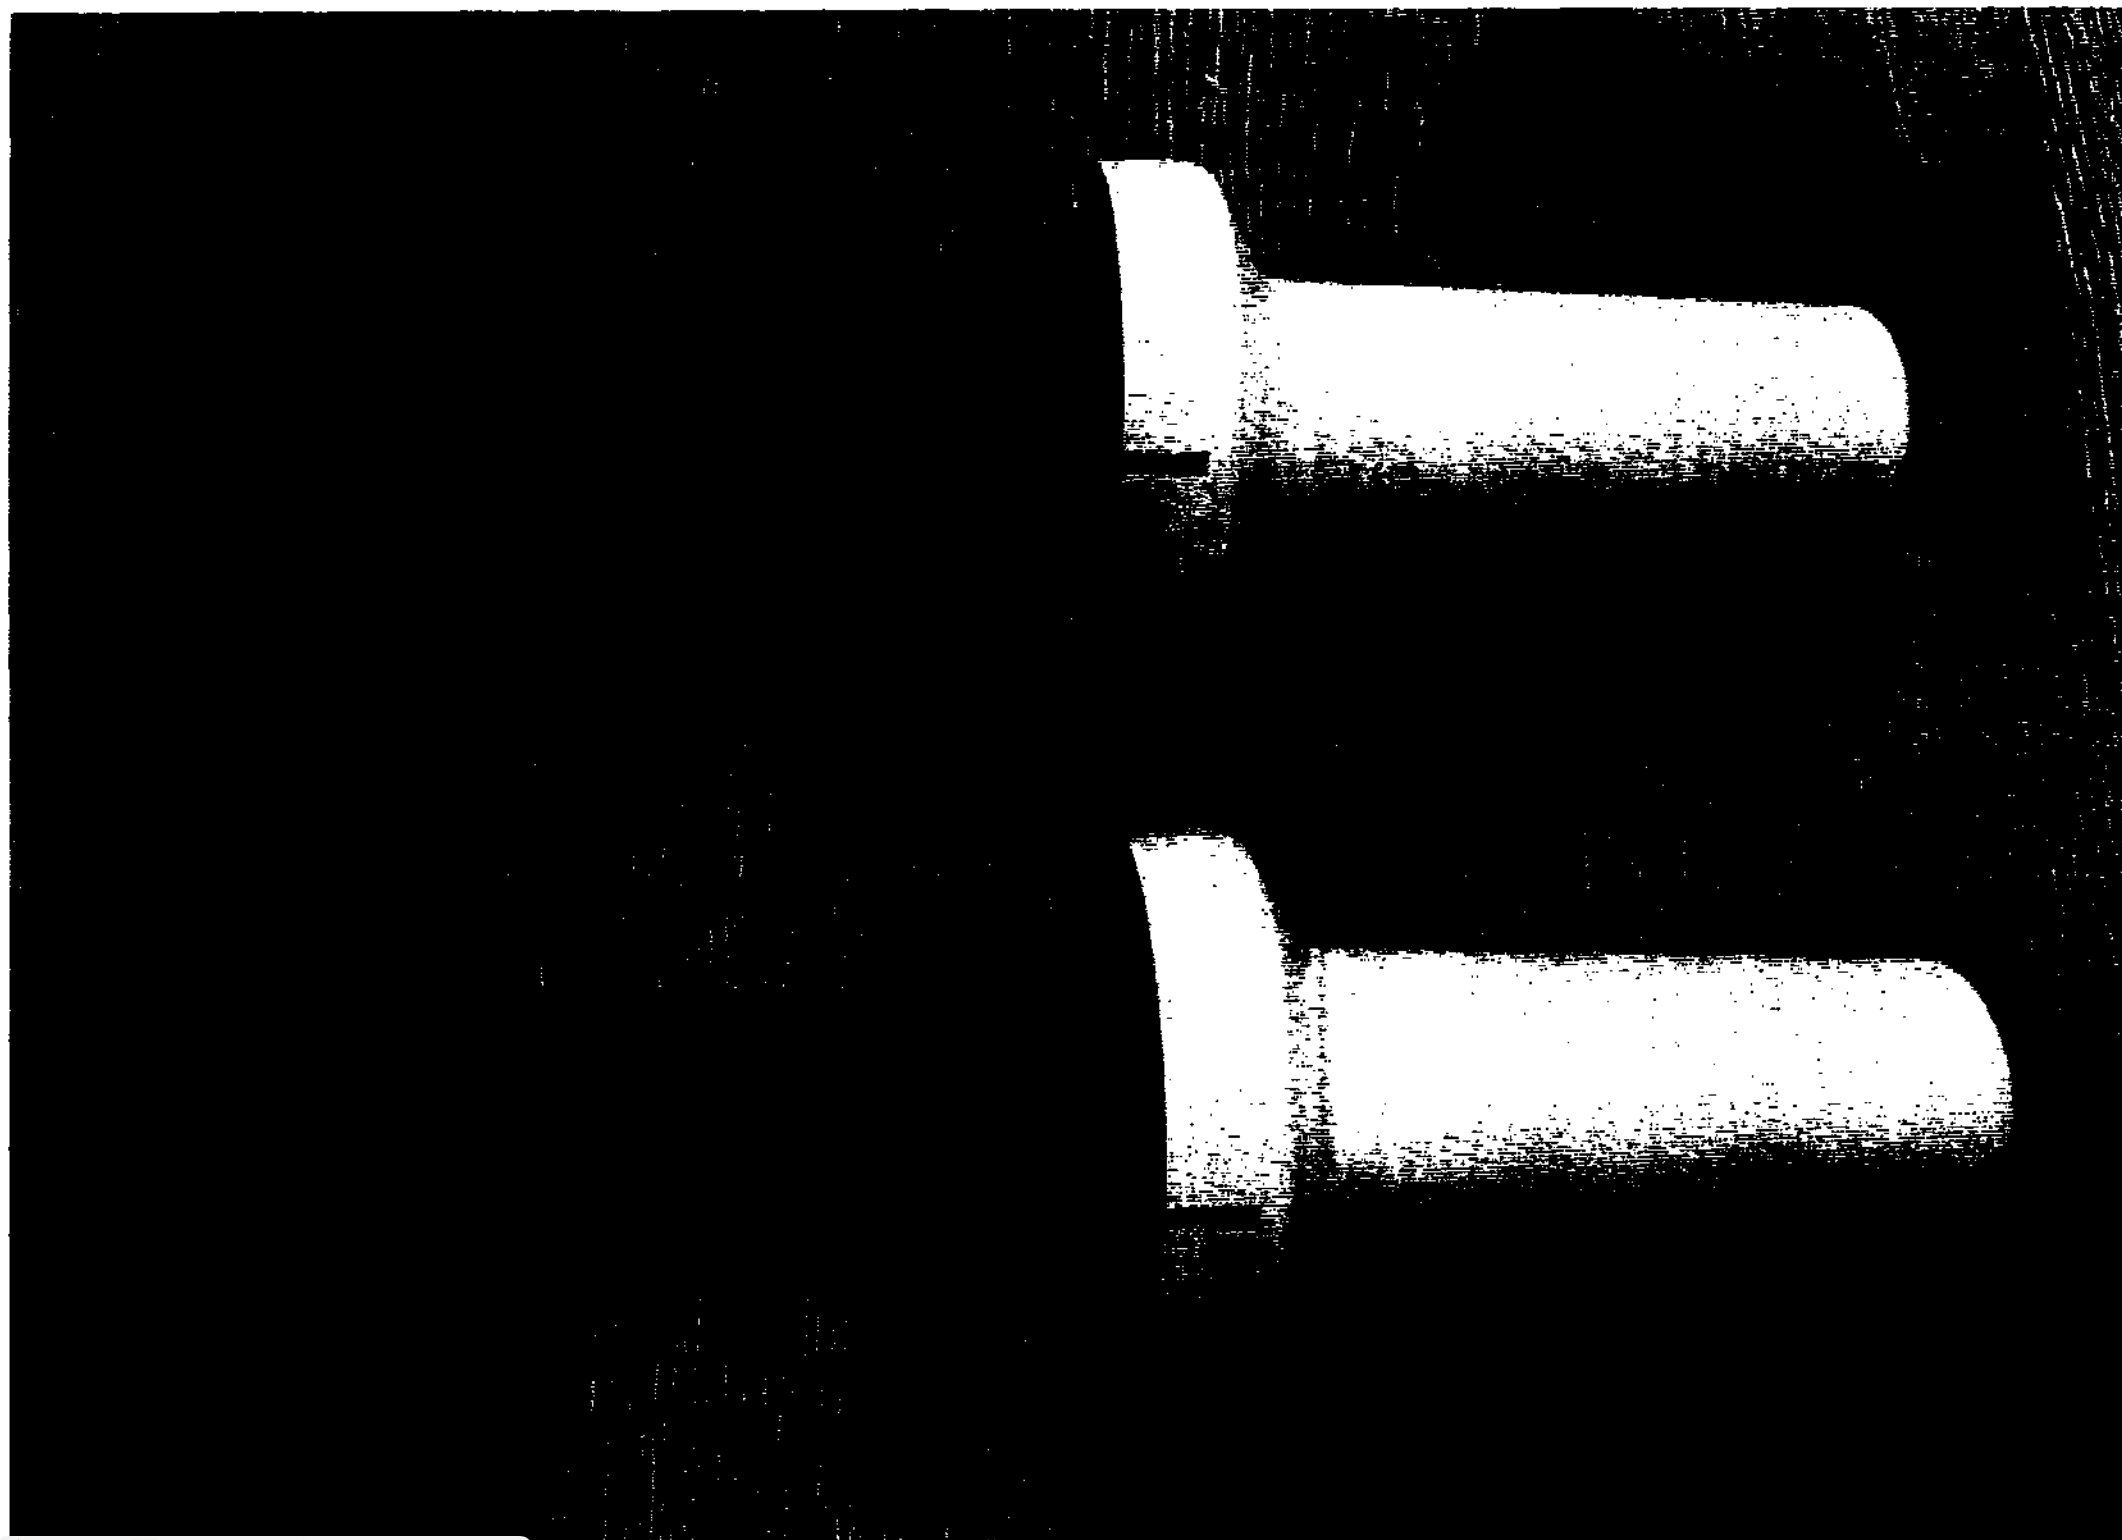
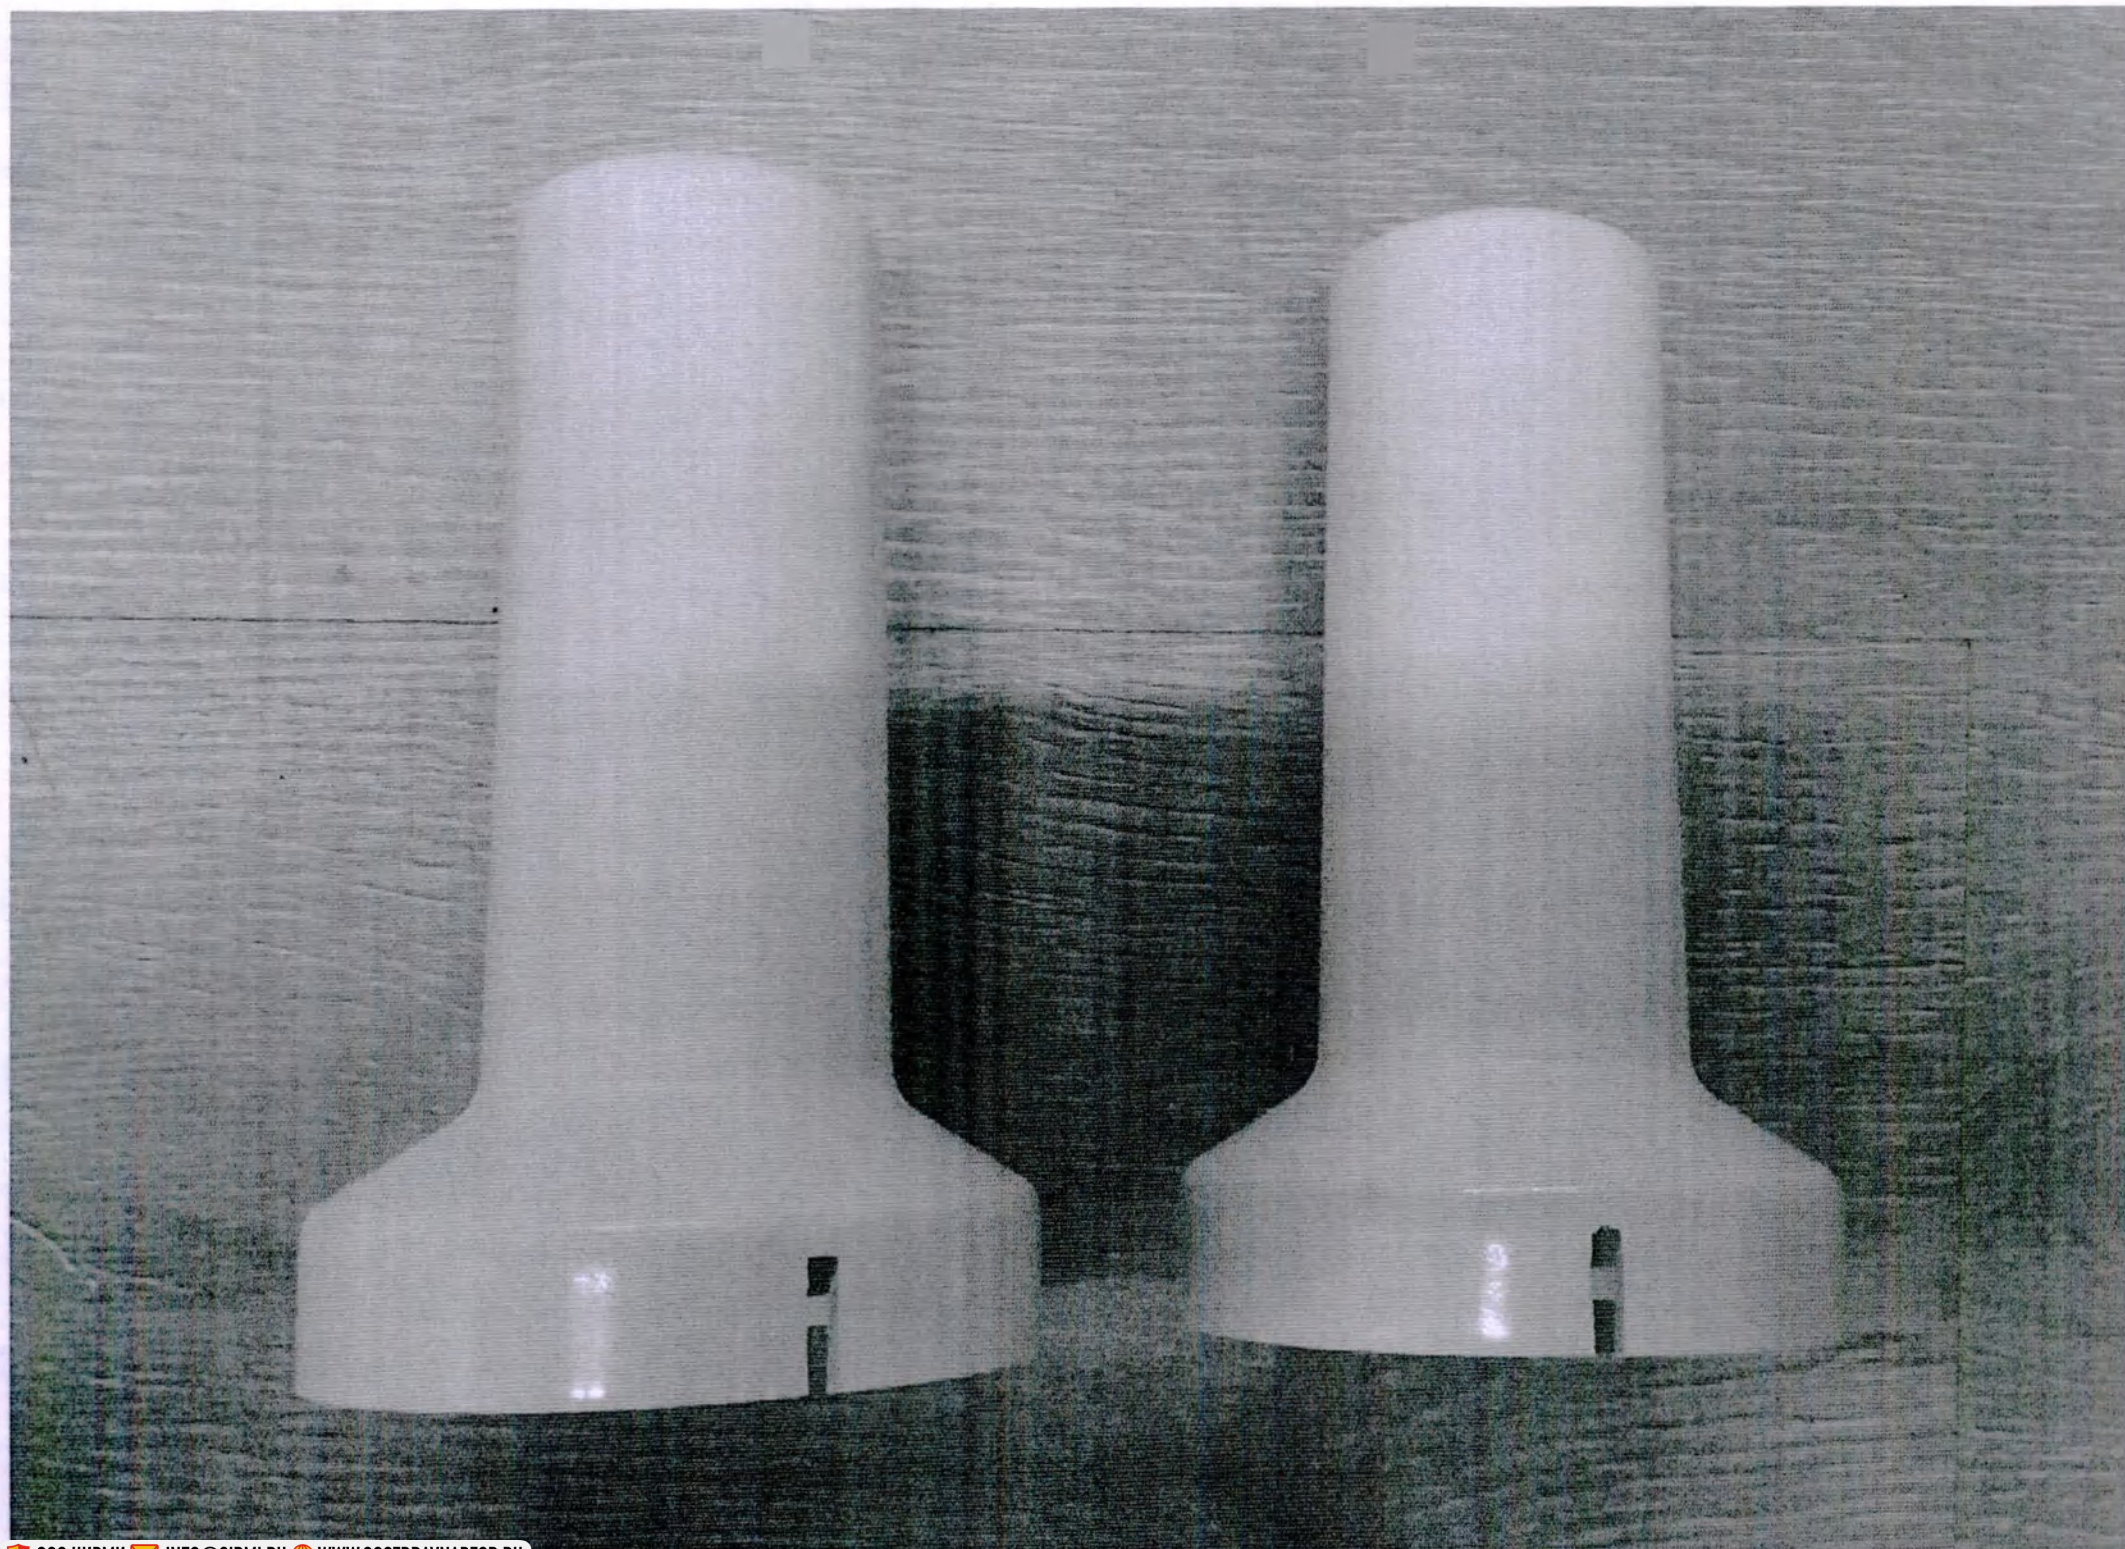
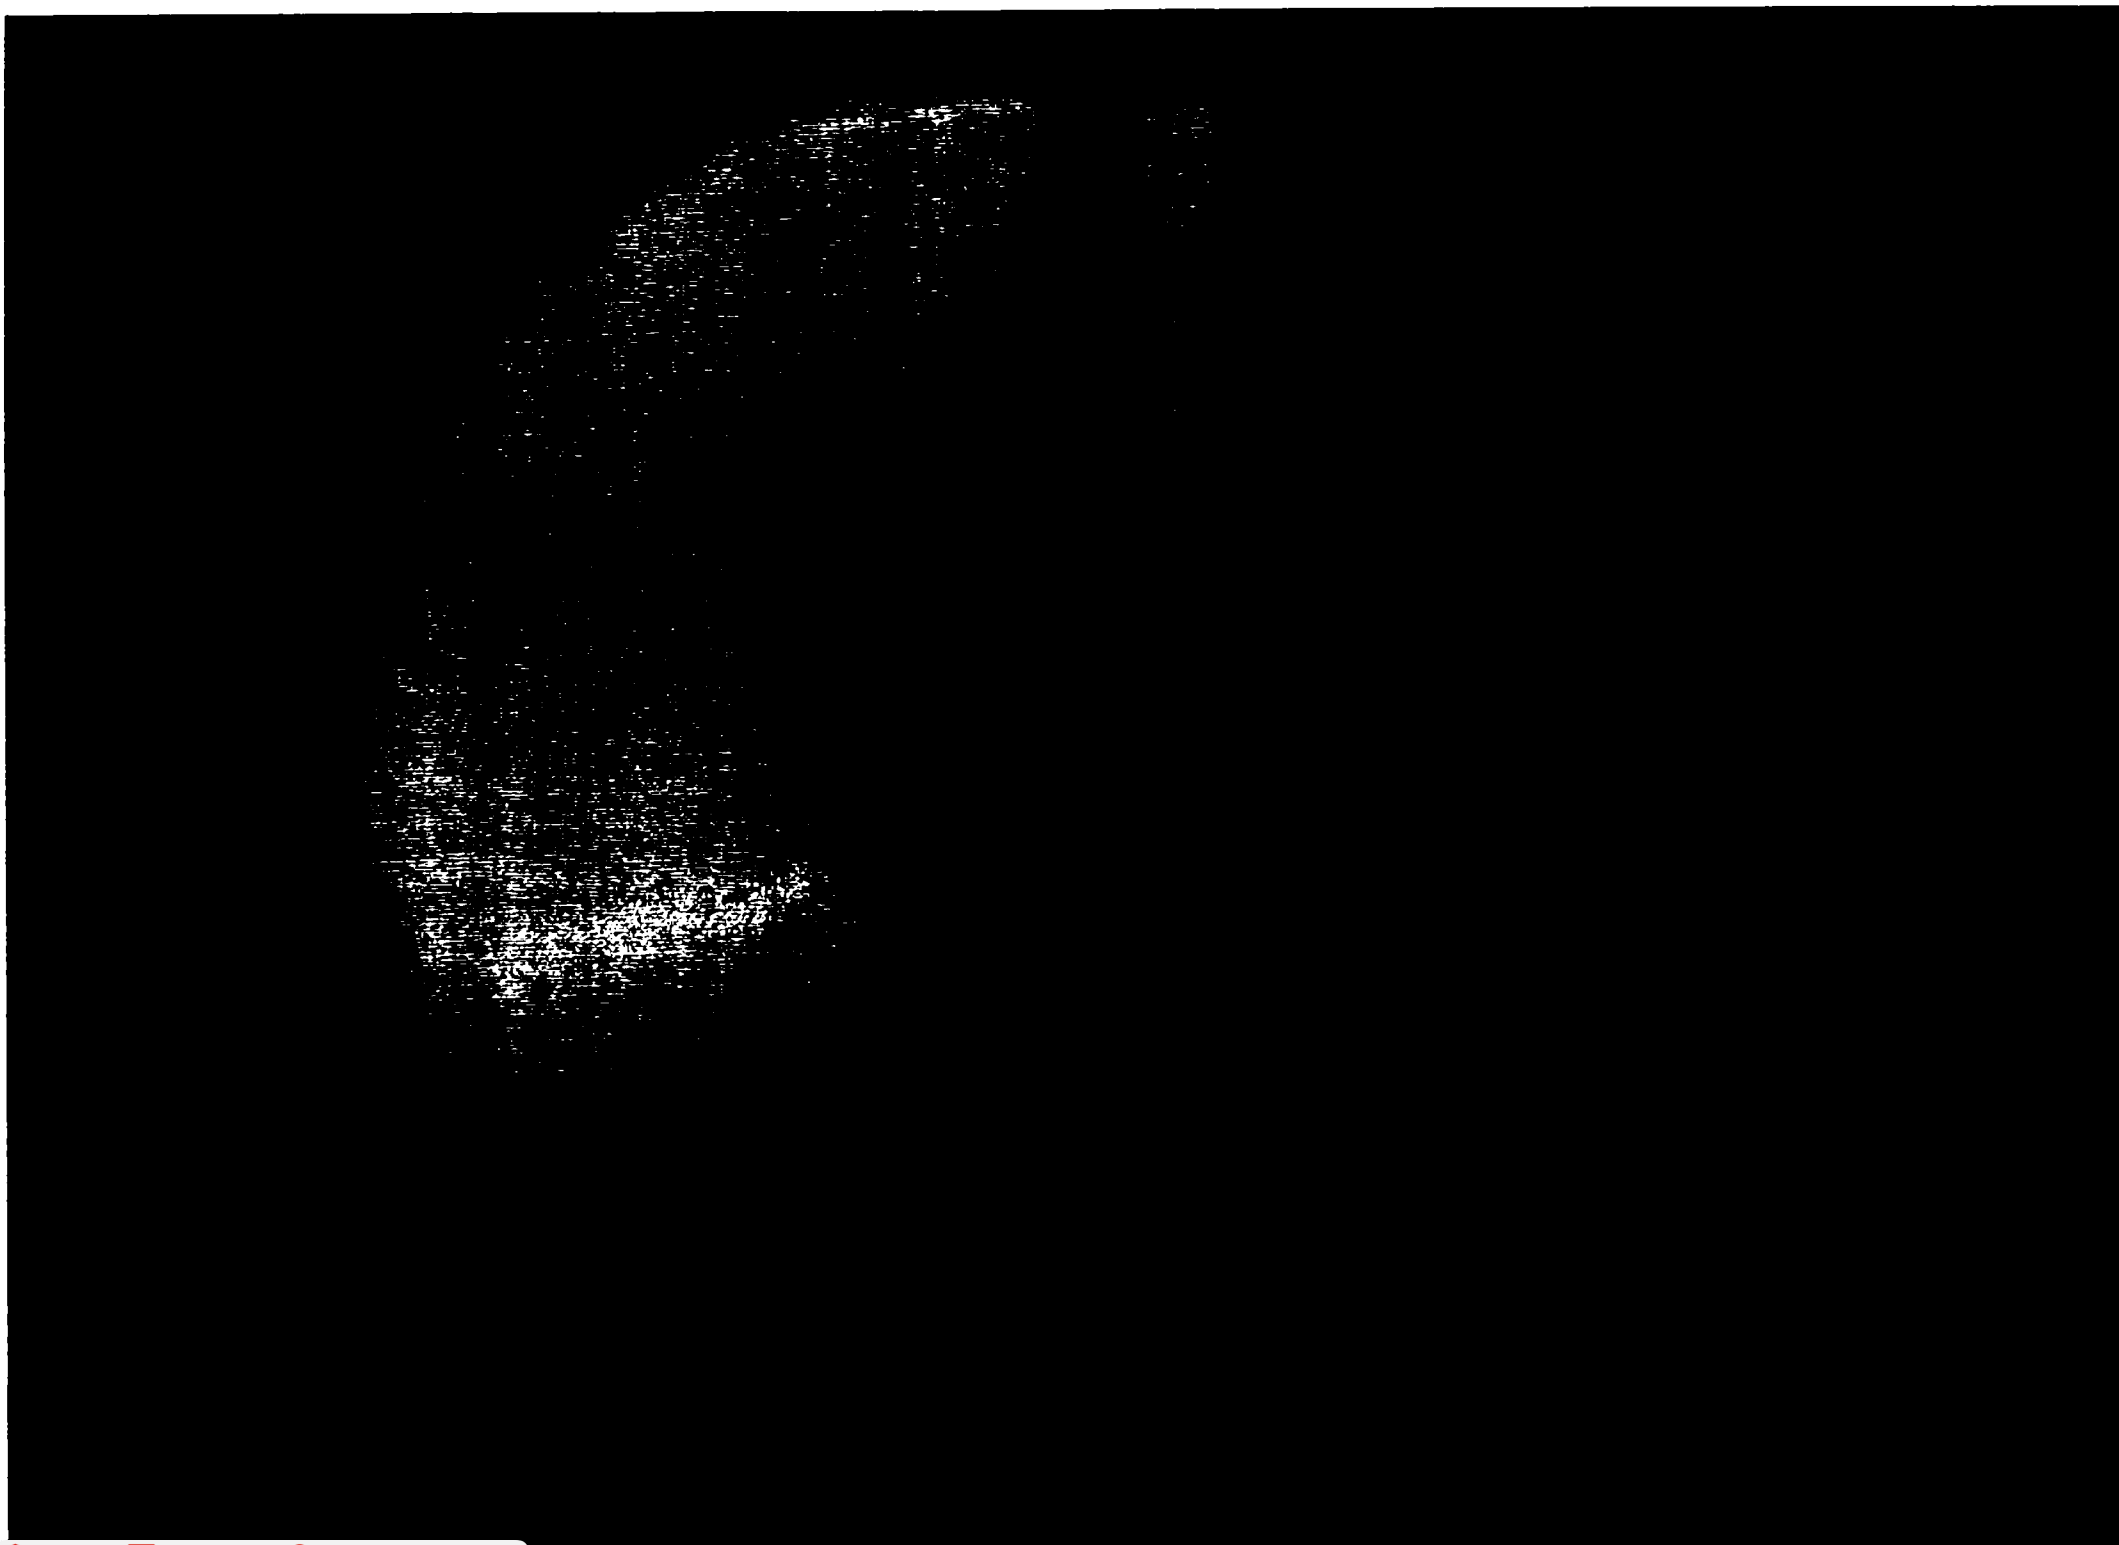


Рис. 40 – Фланец потолочный







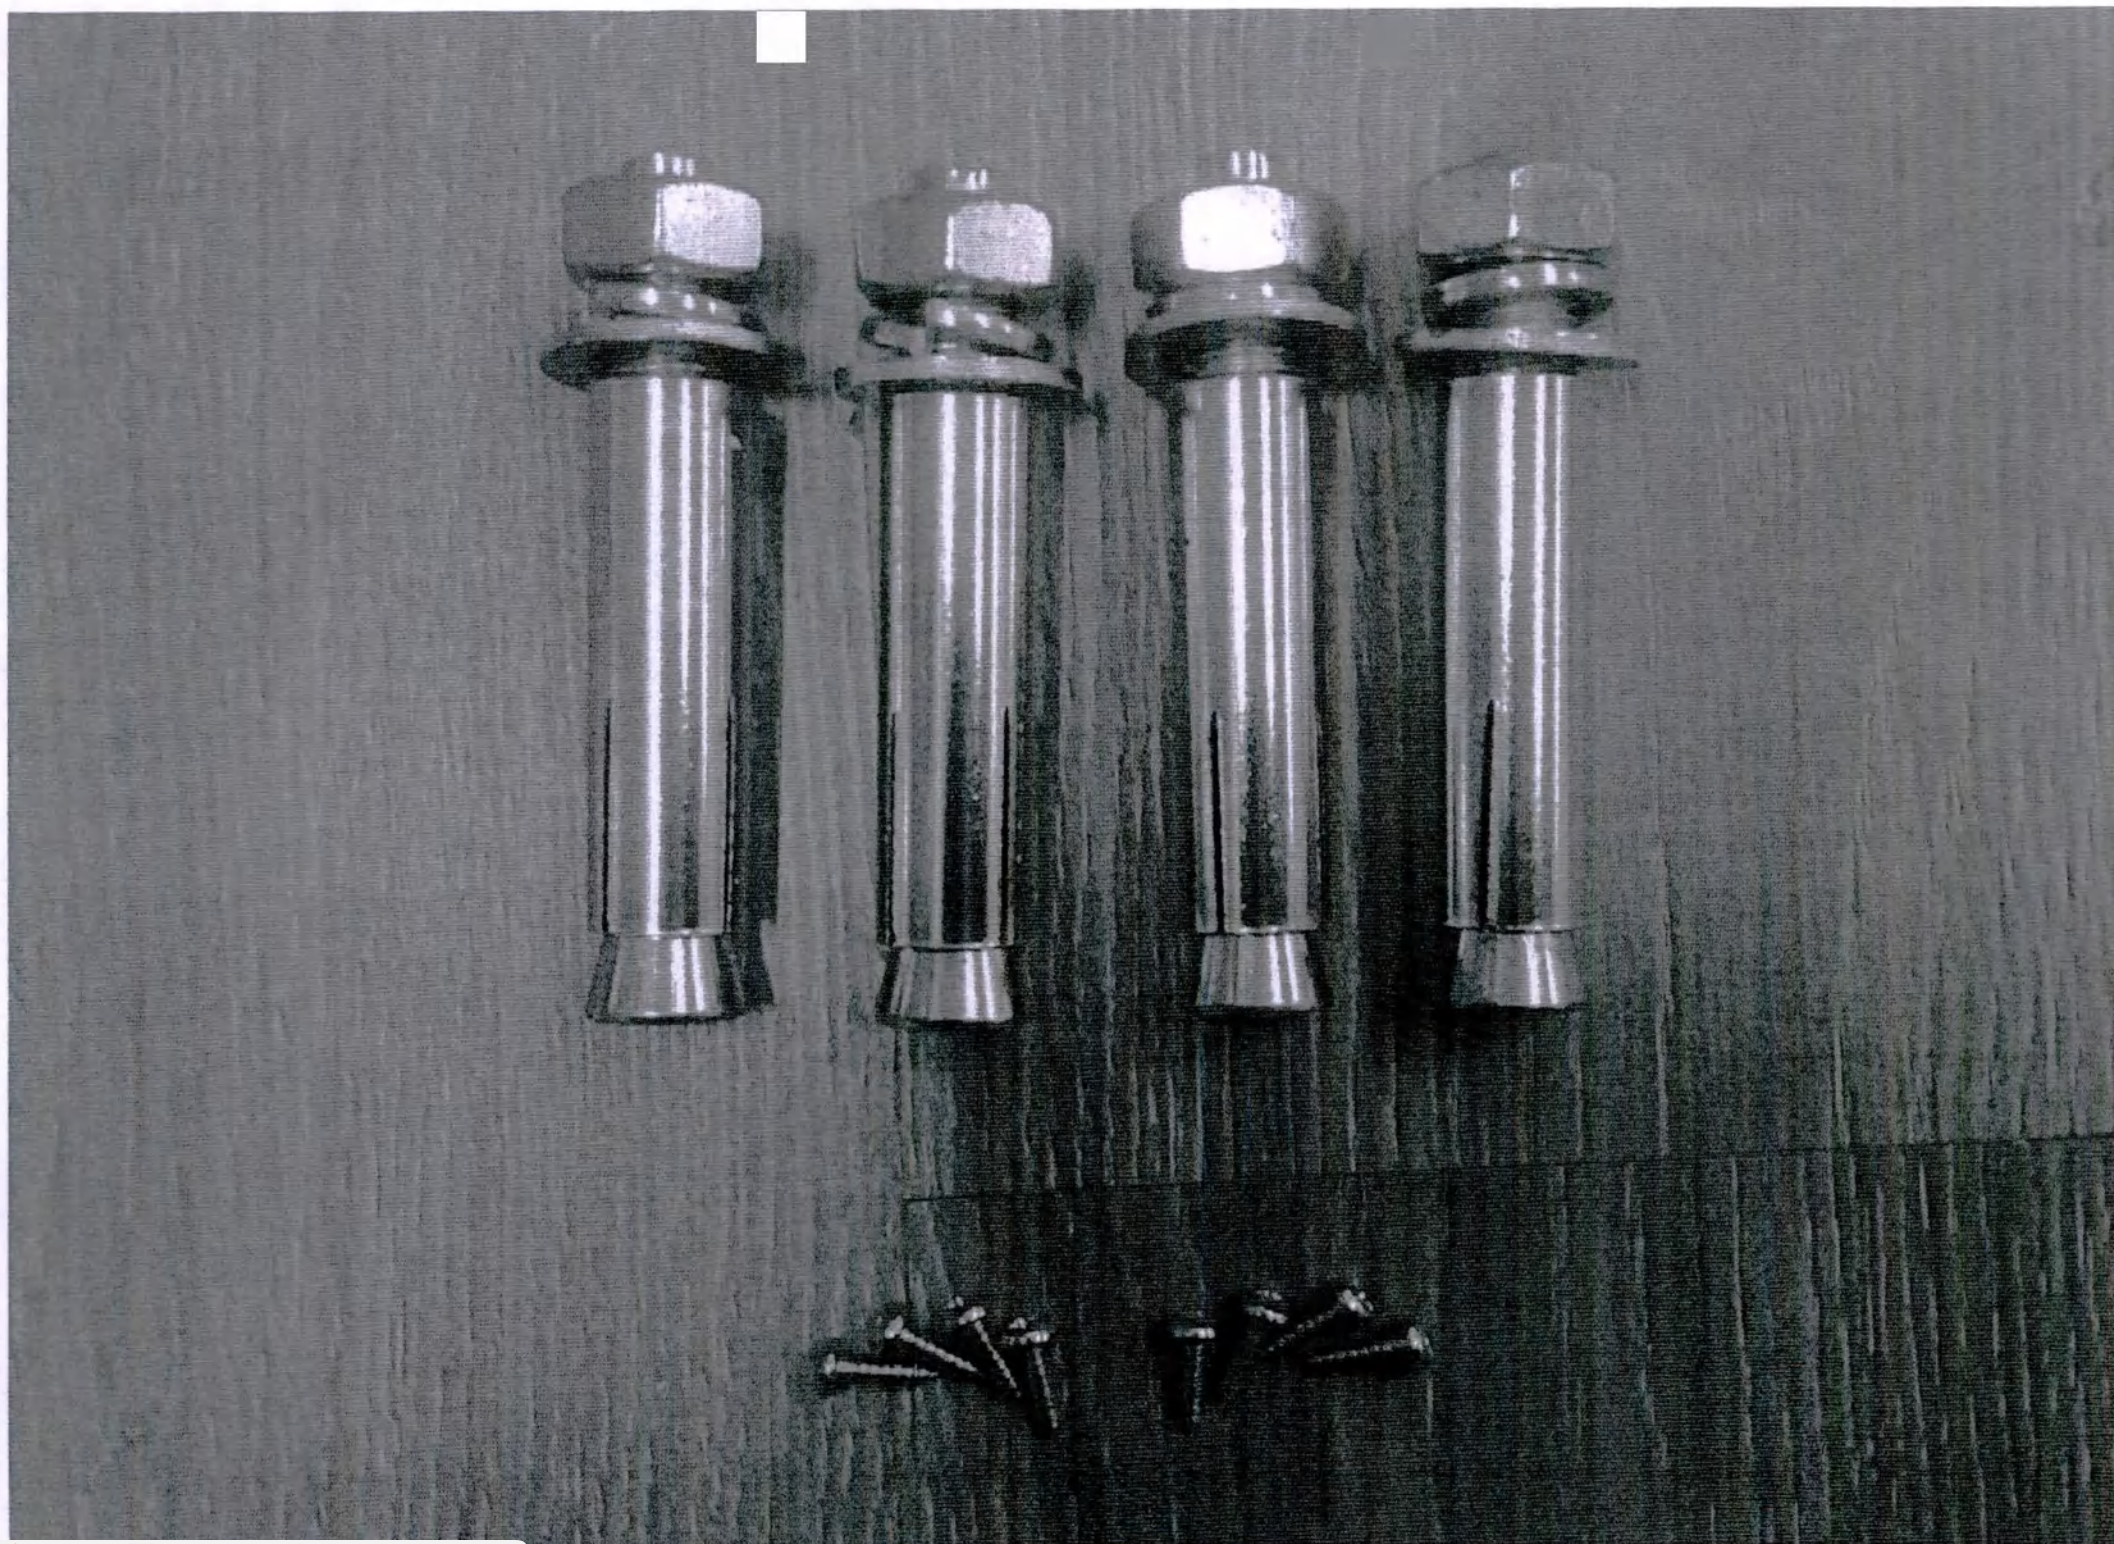


Рис. 44 – Комплект крепежа

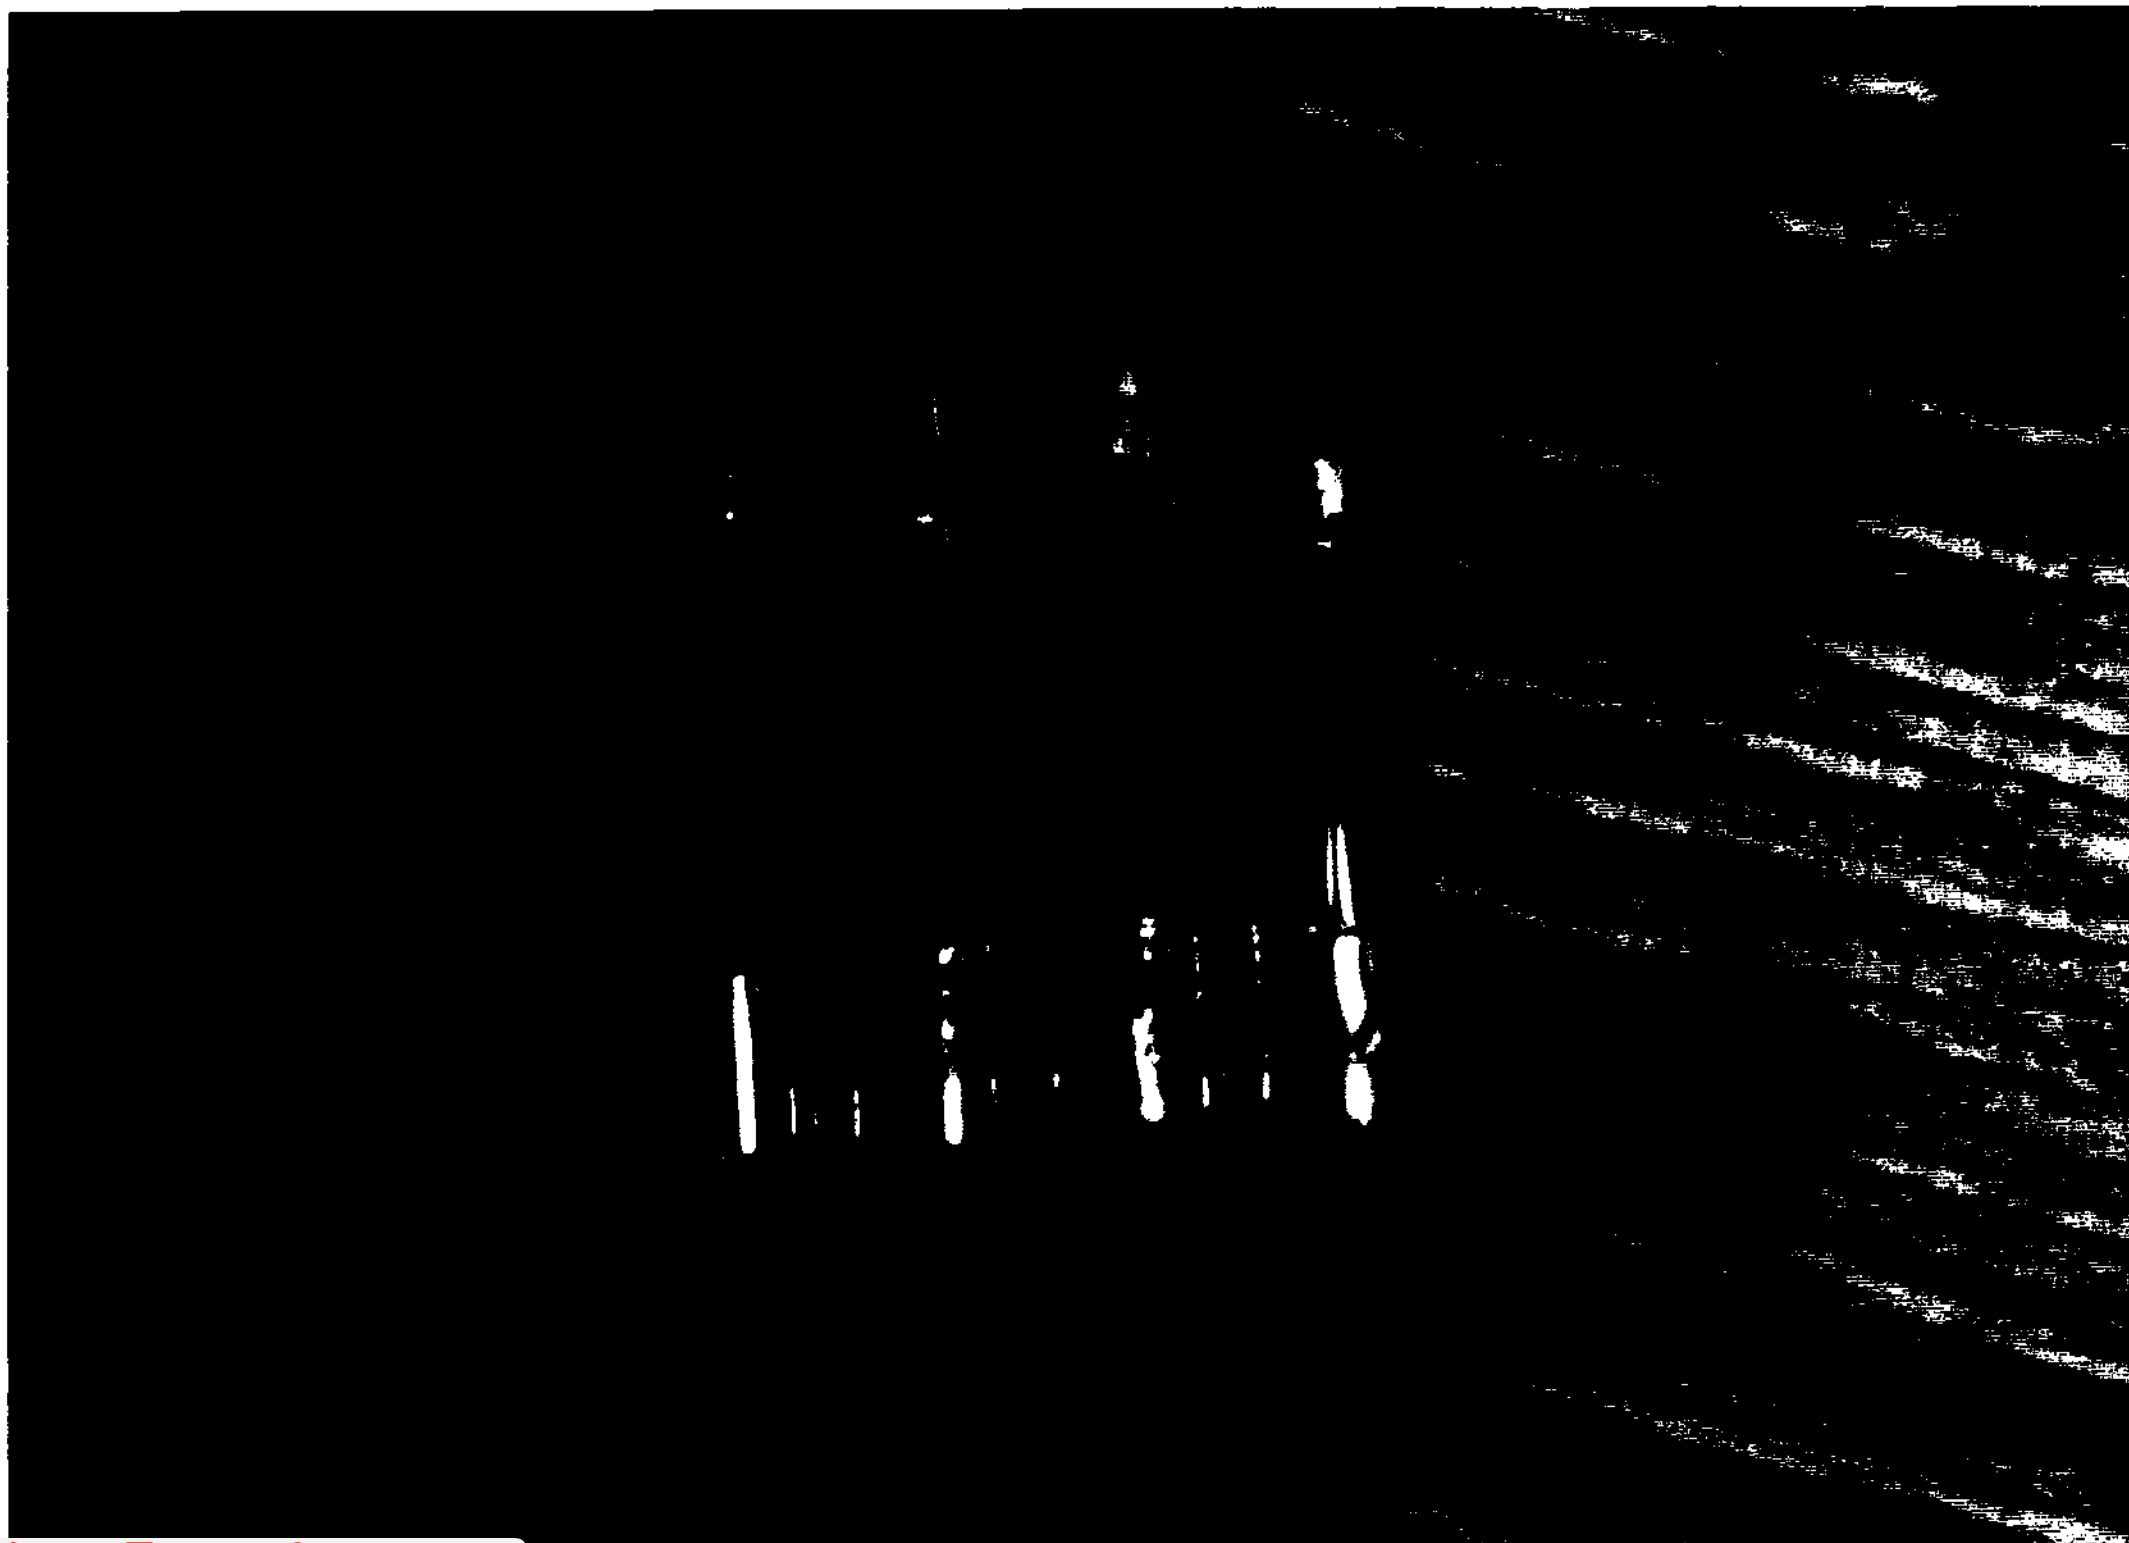


Рис. 45 – Предохранитель плавкий F2AL250V запасной (4 шт.)

V. Светильник медицинский хирургический «Armed», вариант исполнения AR 500 LED, в составе:





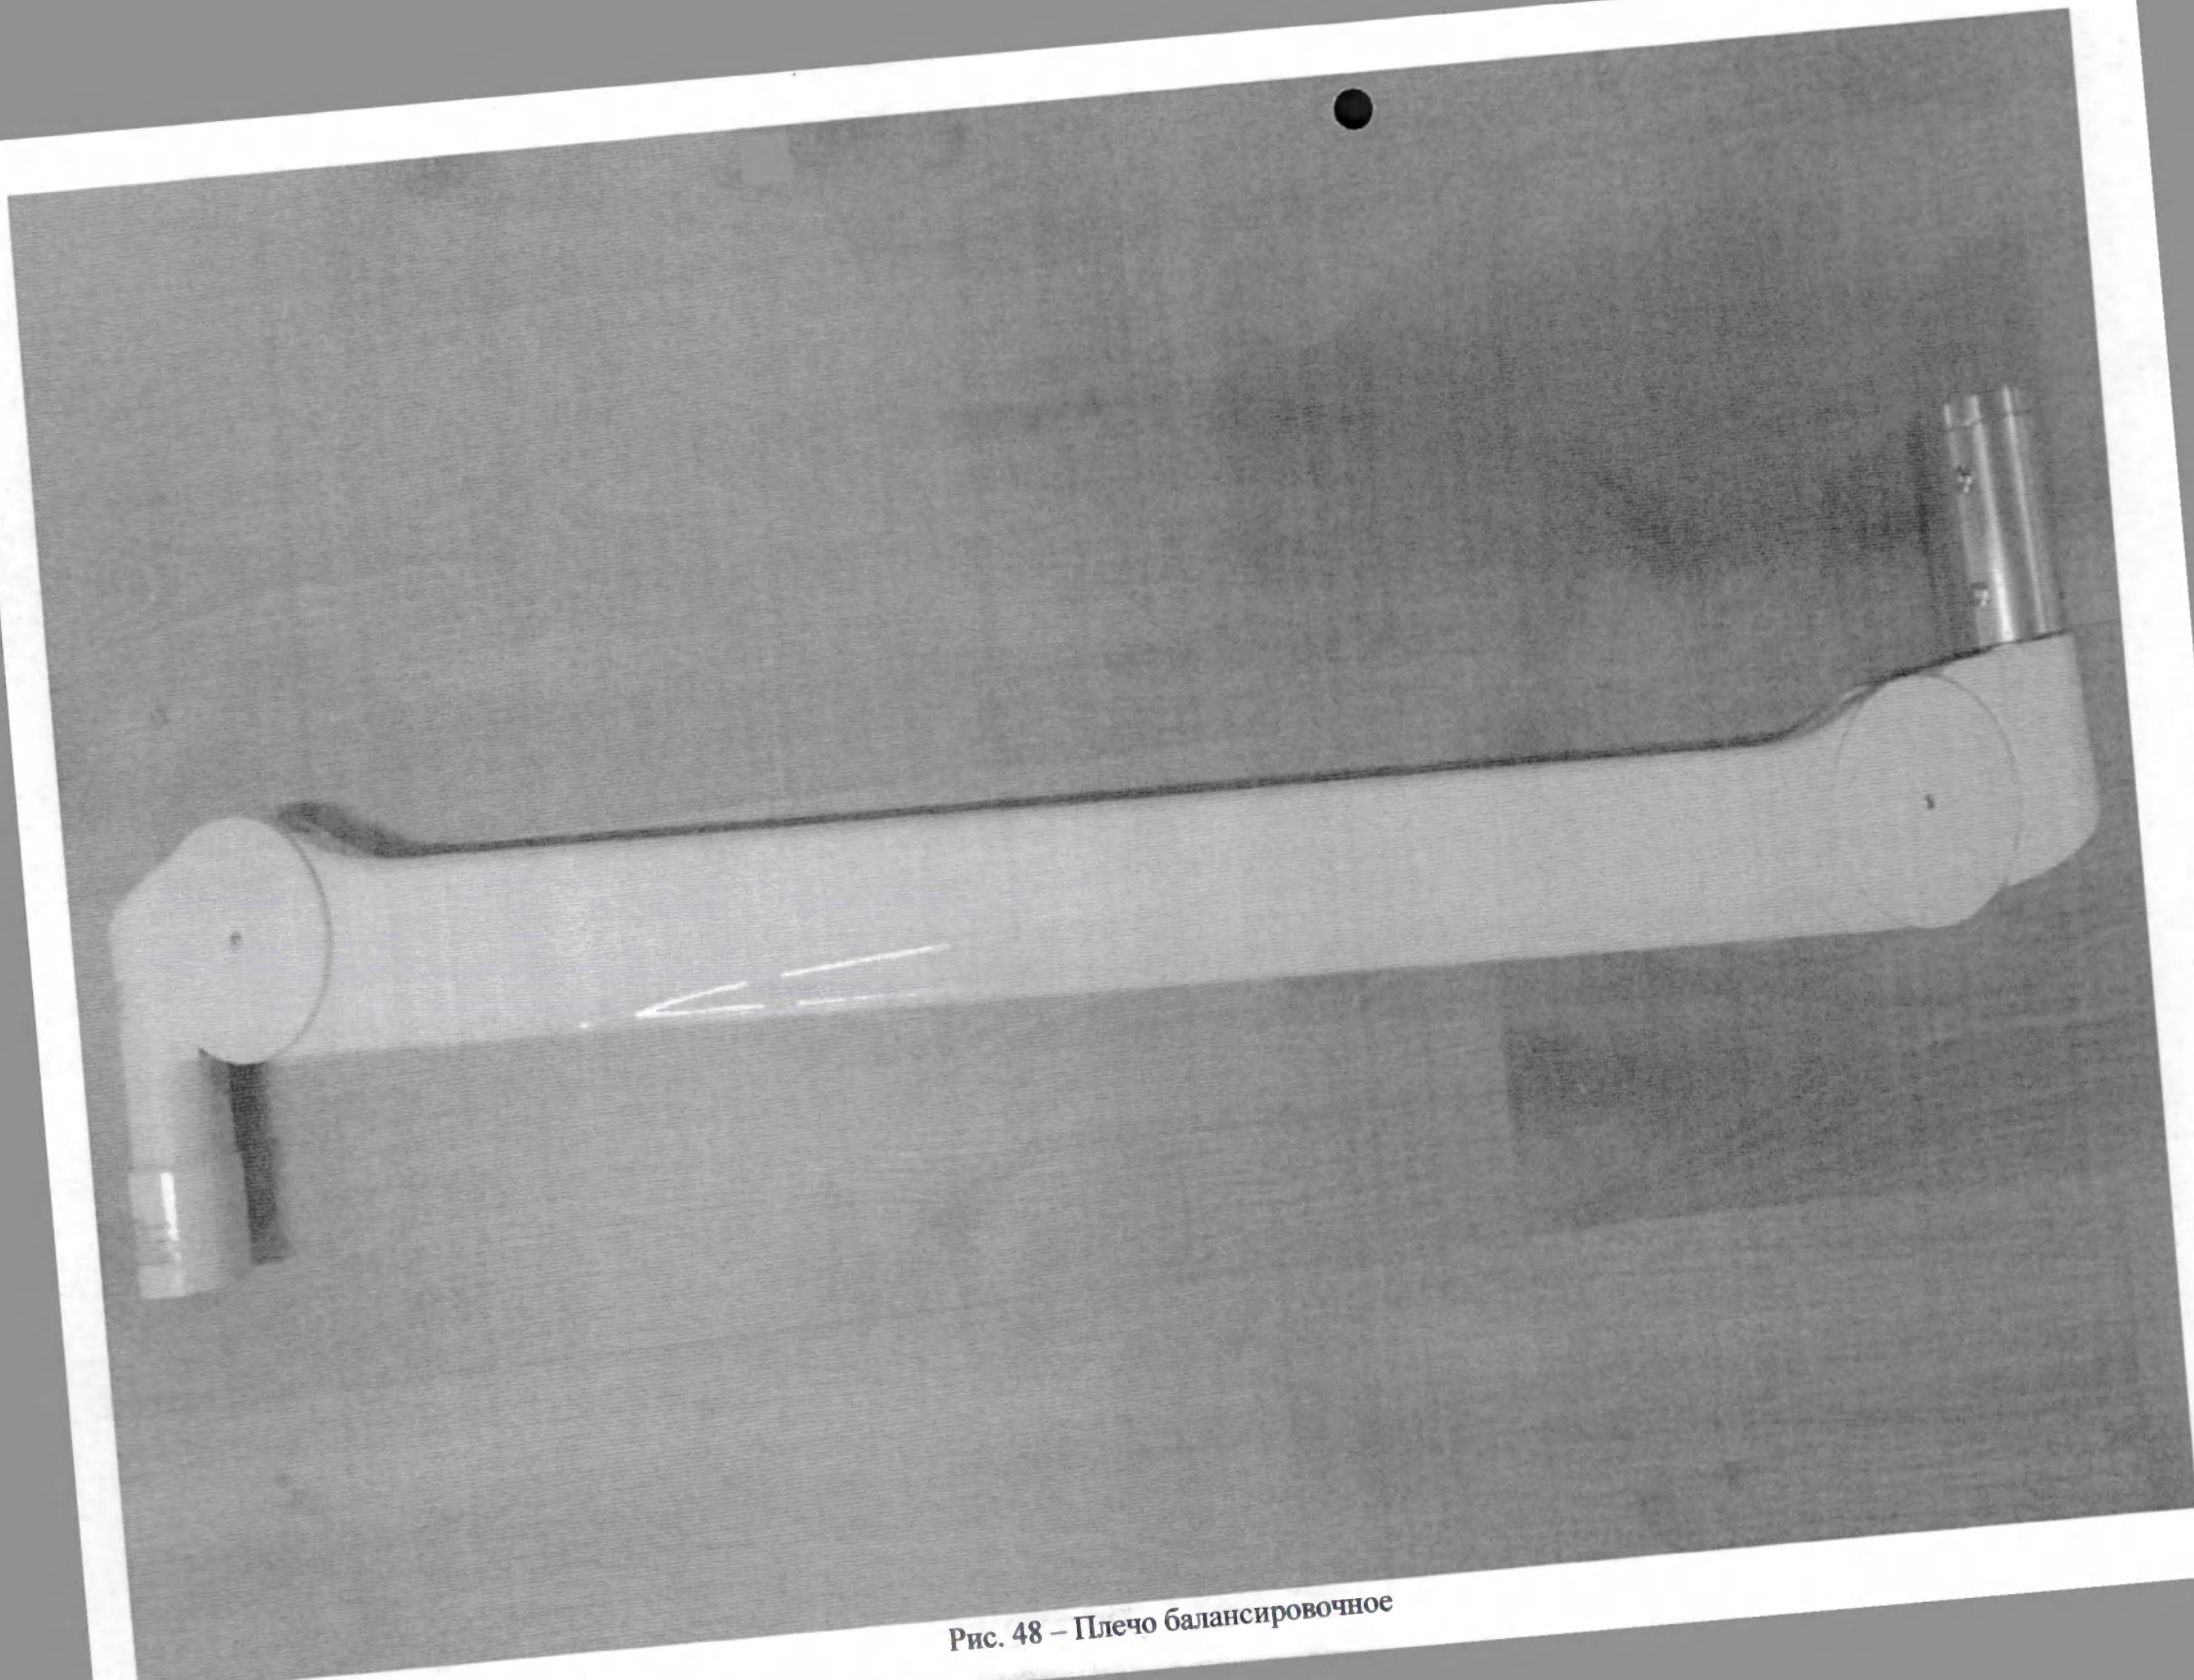


Рис. 48 – Плечо балансирующее

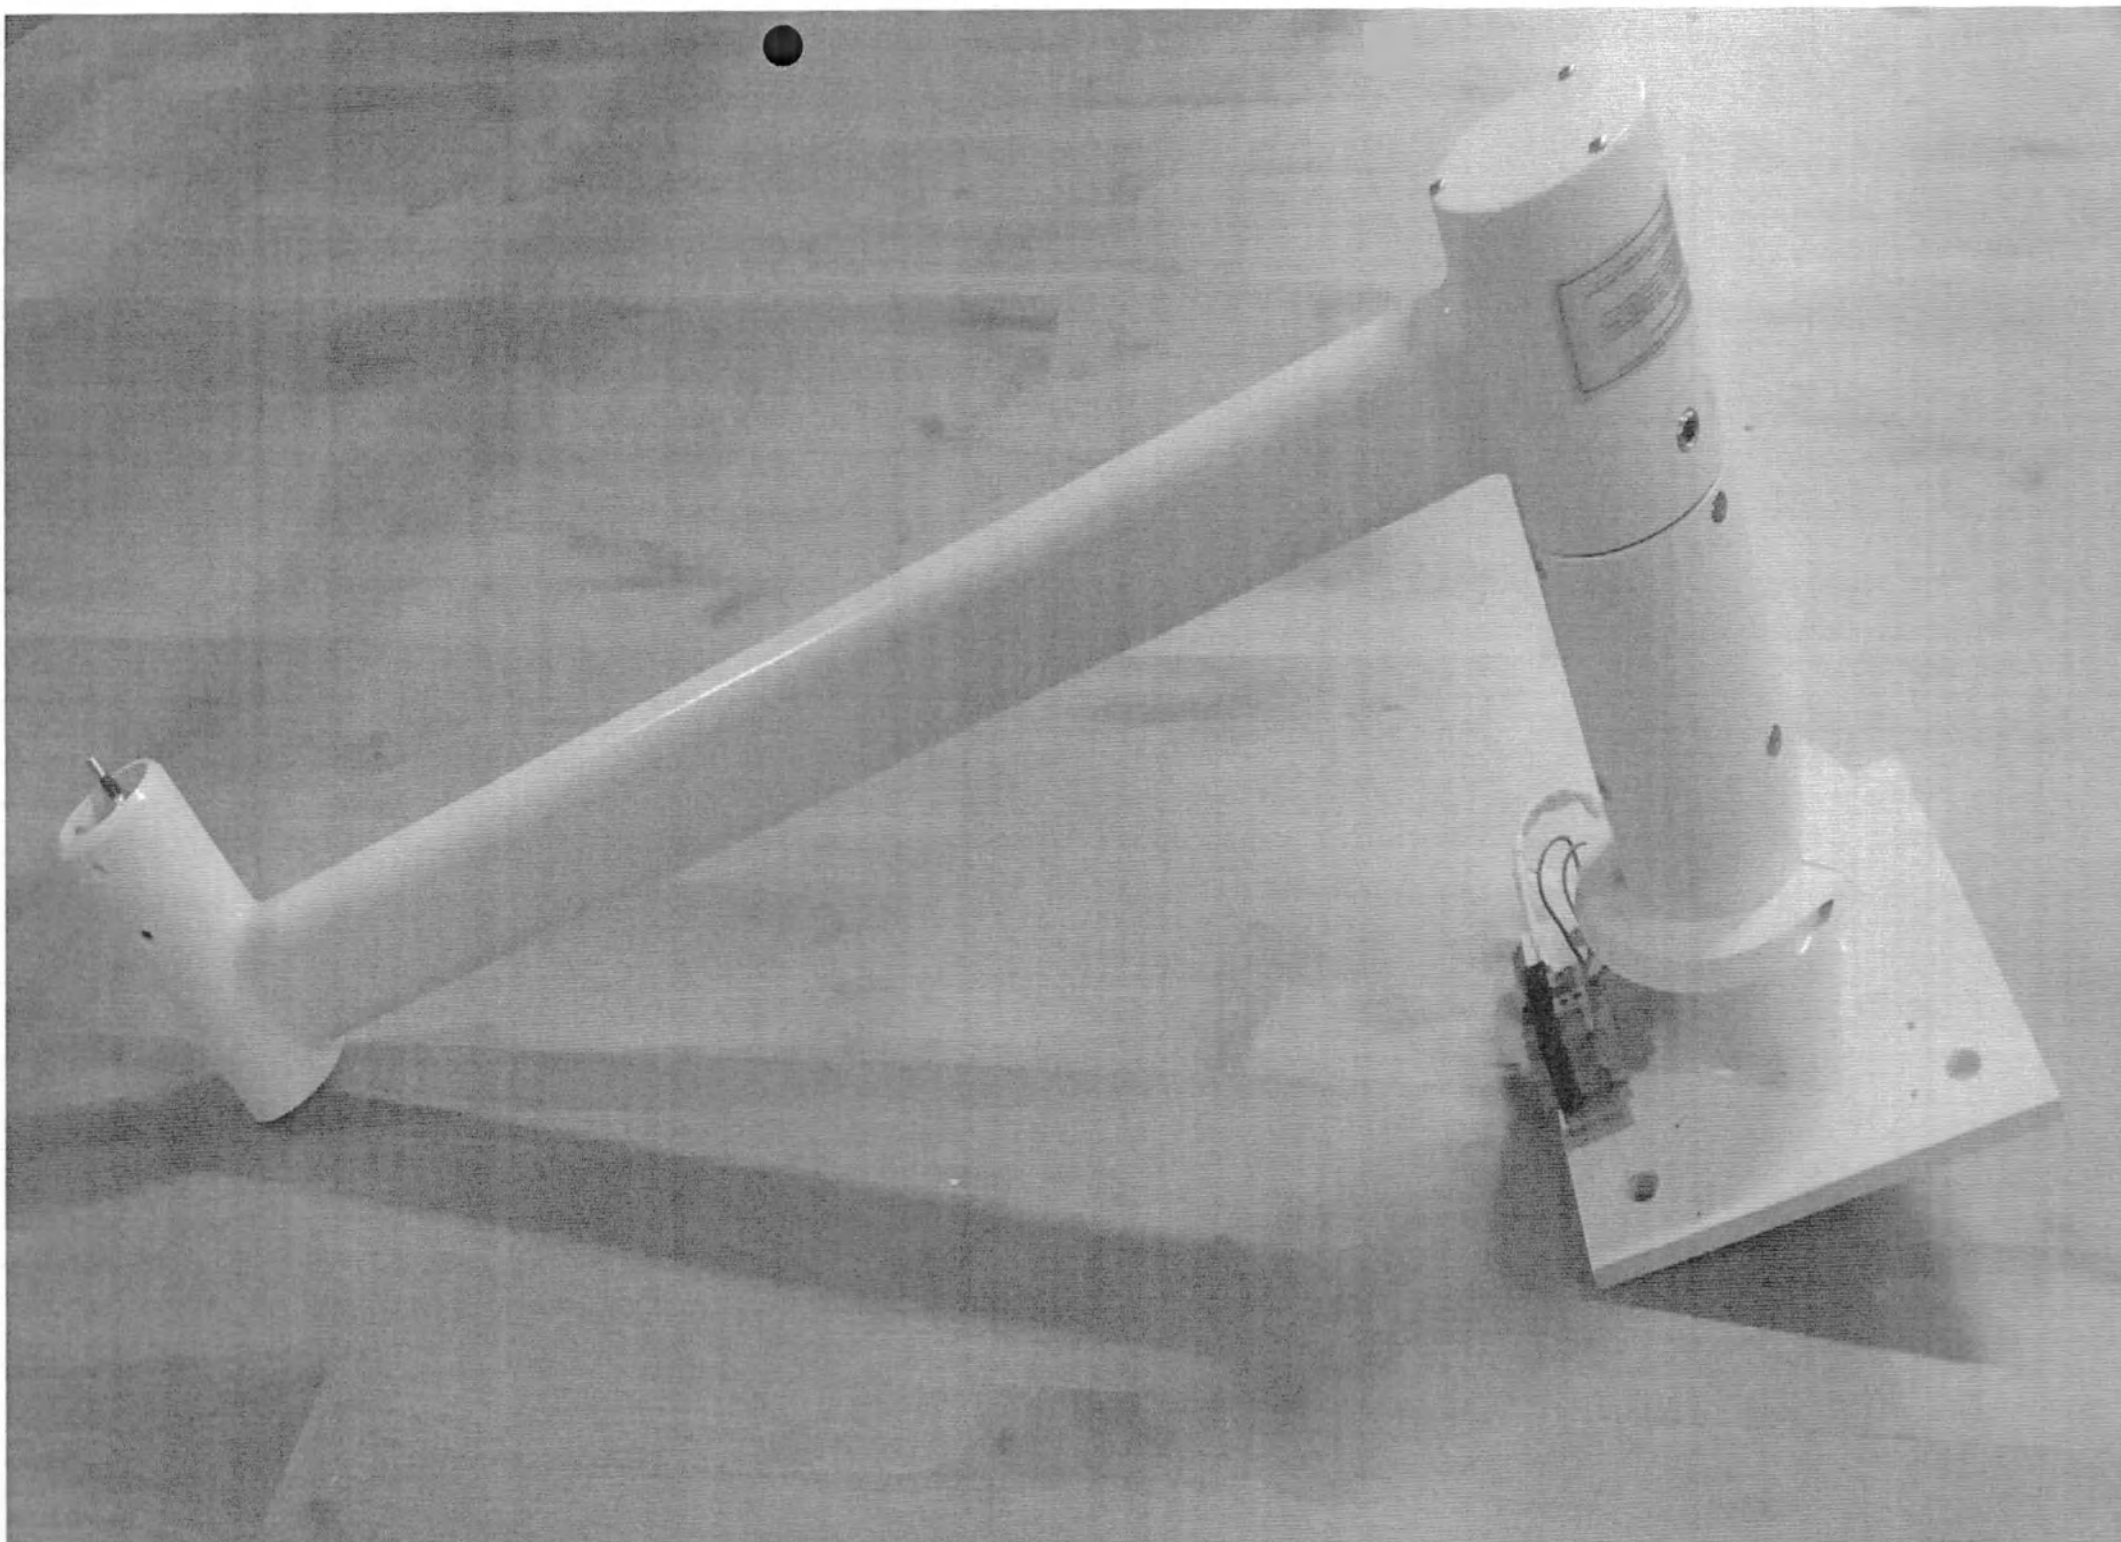


Рис. 49 – Блок установочный с одним горизонтальным плечом

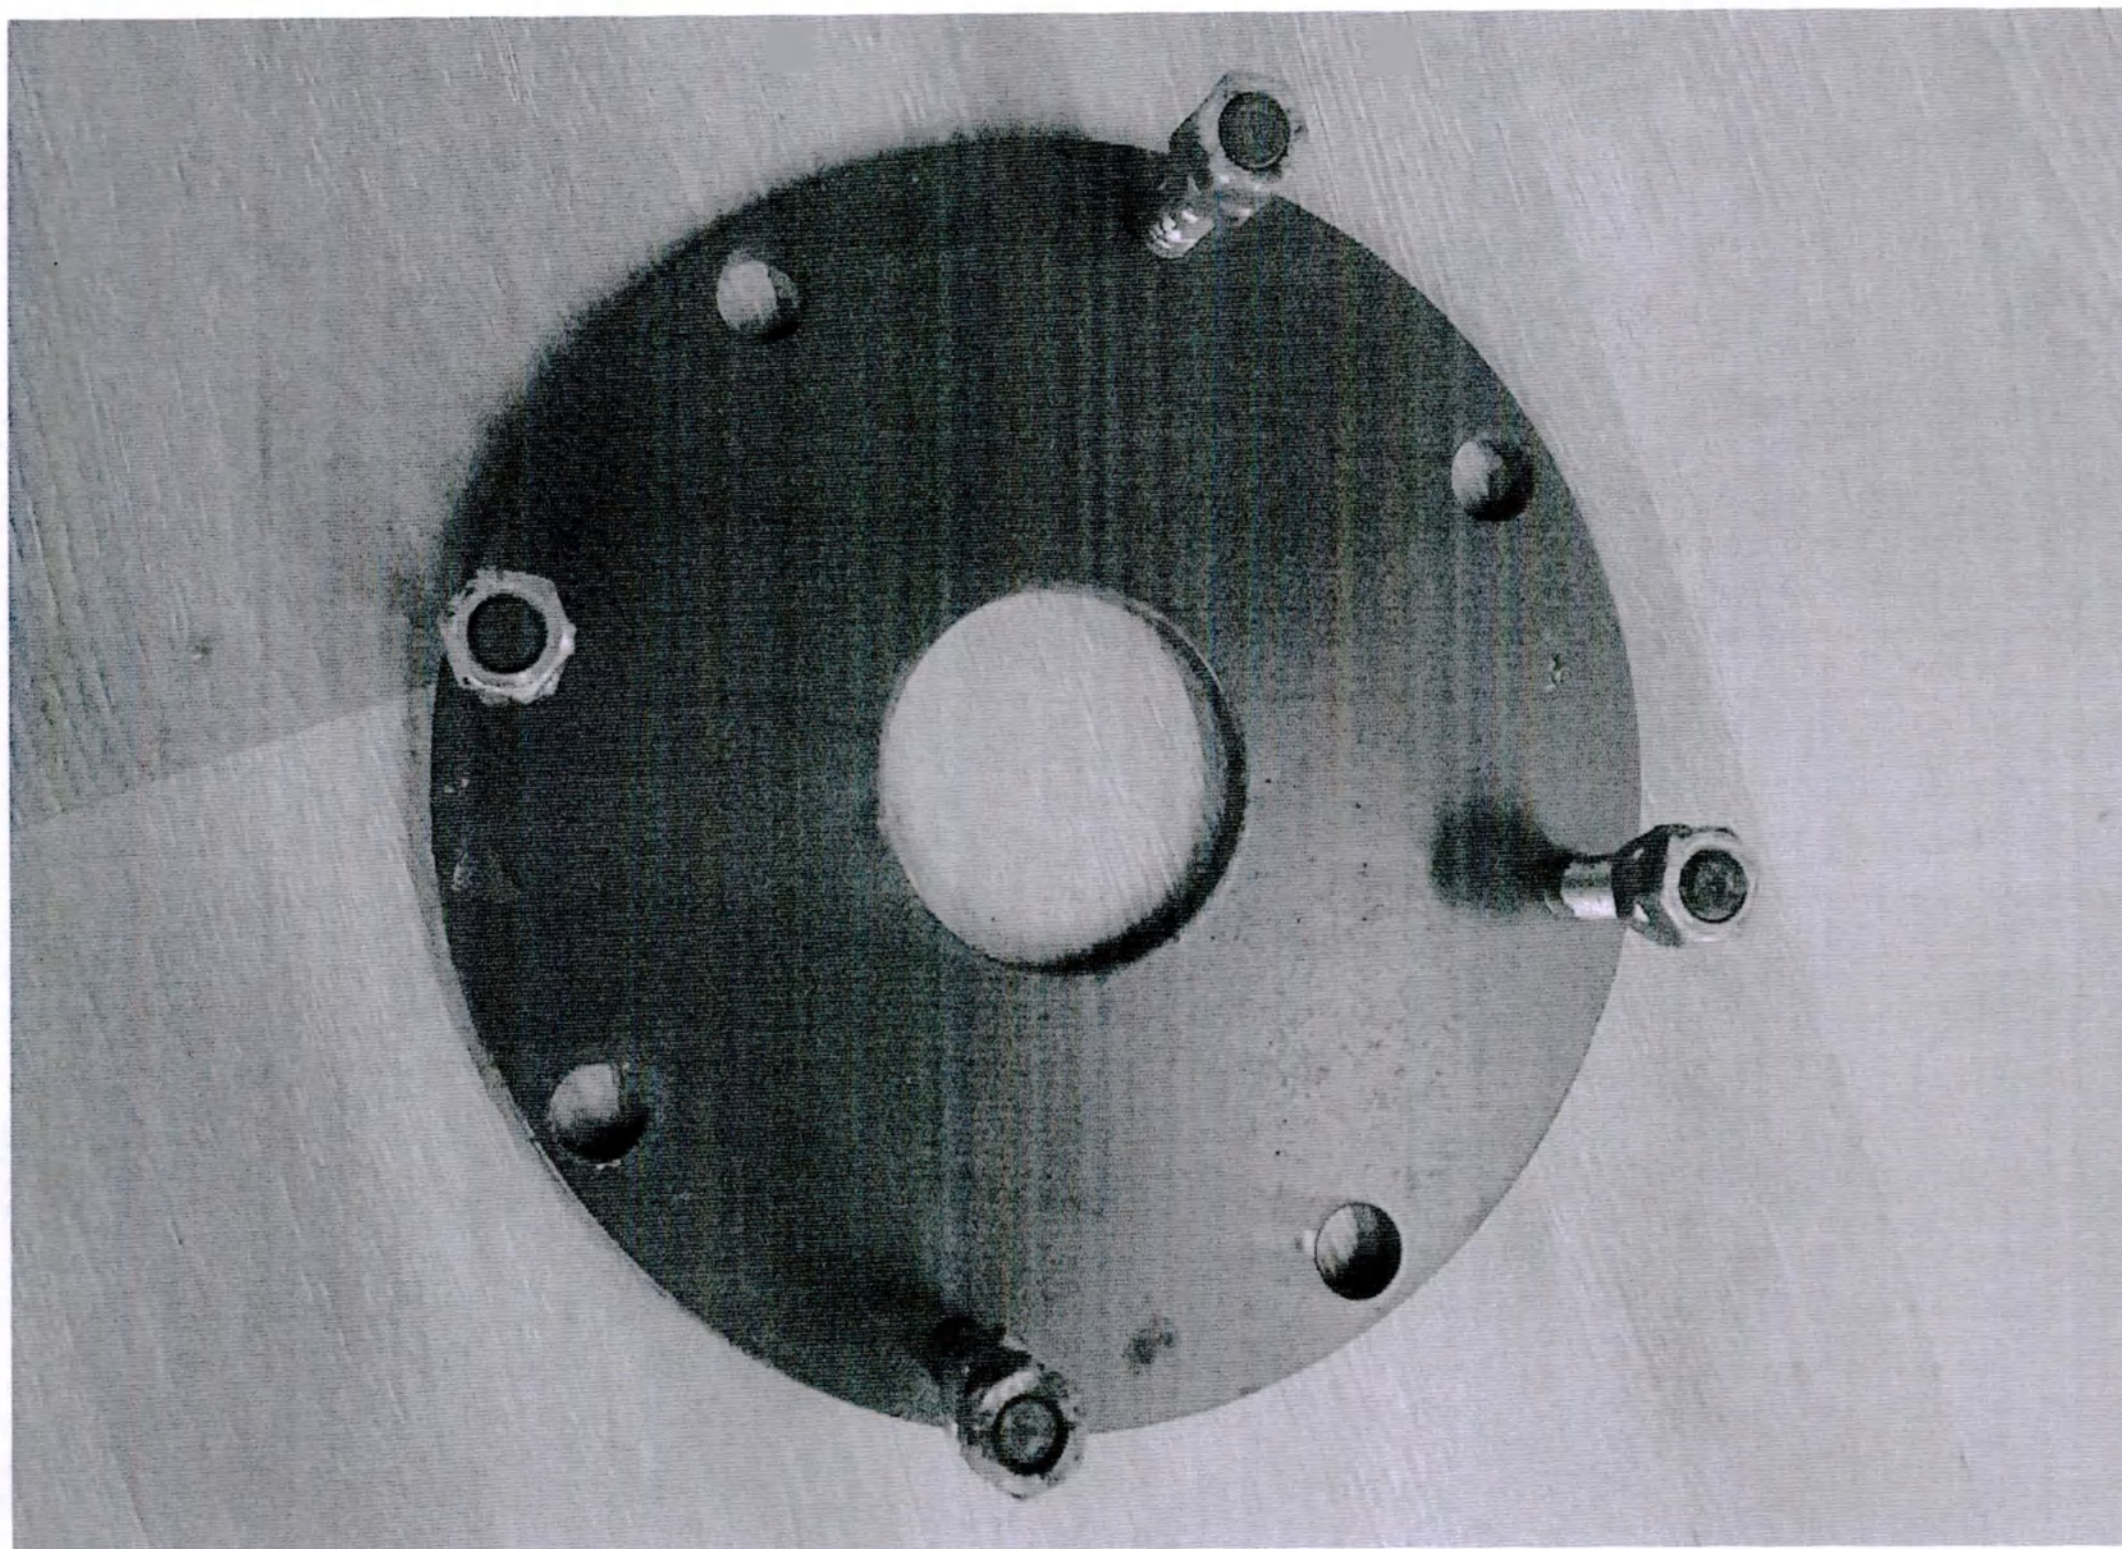


Рис. 50 – Фланец потолочный

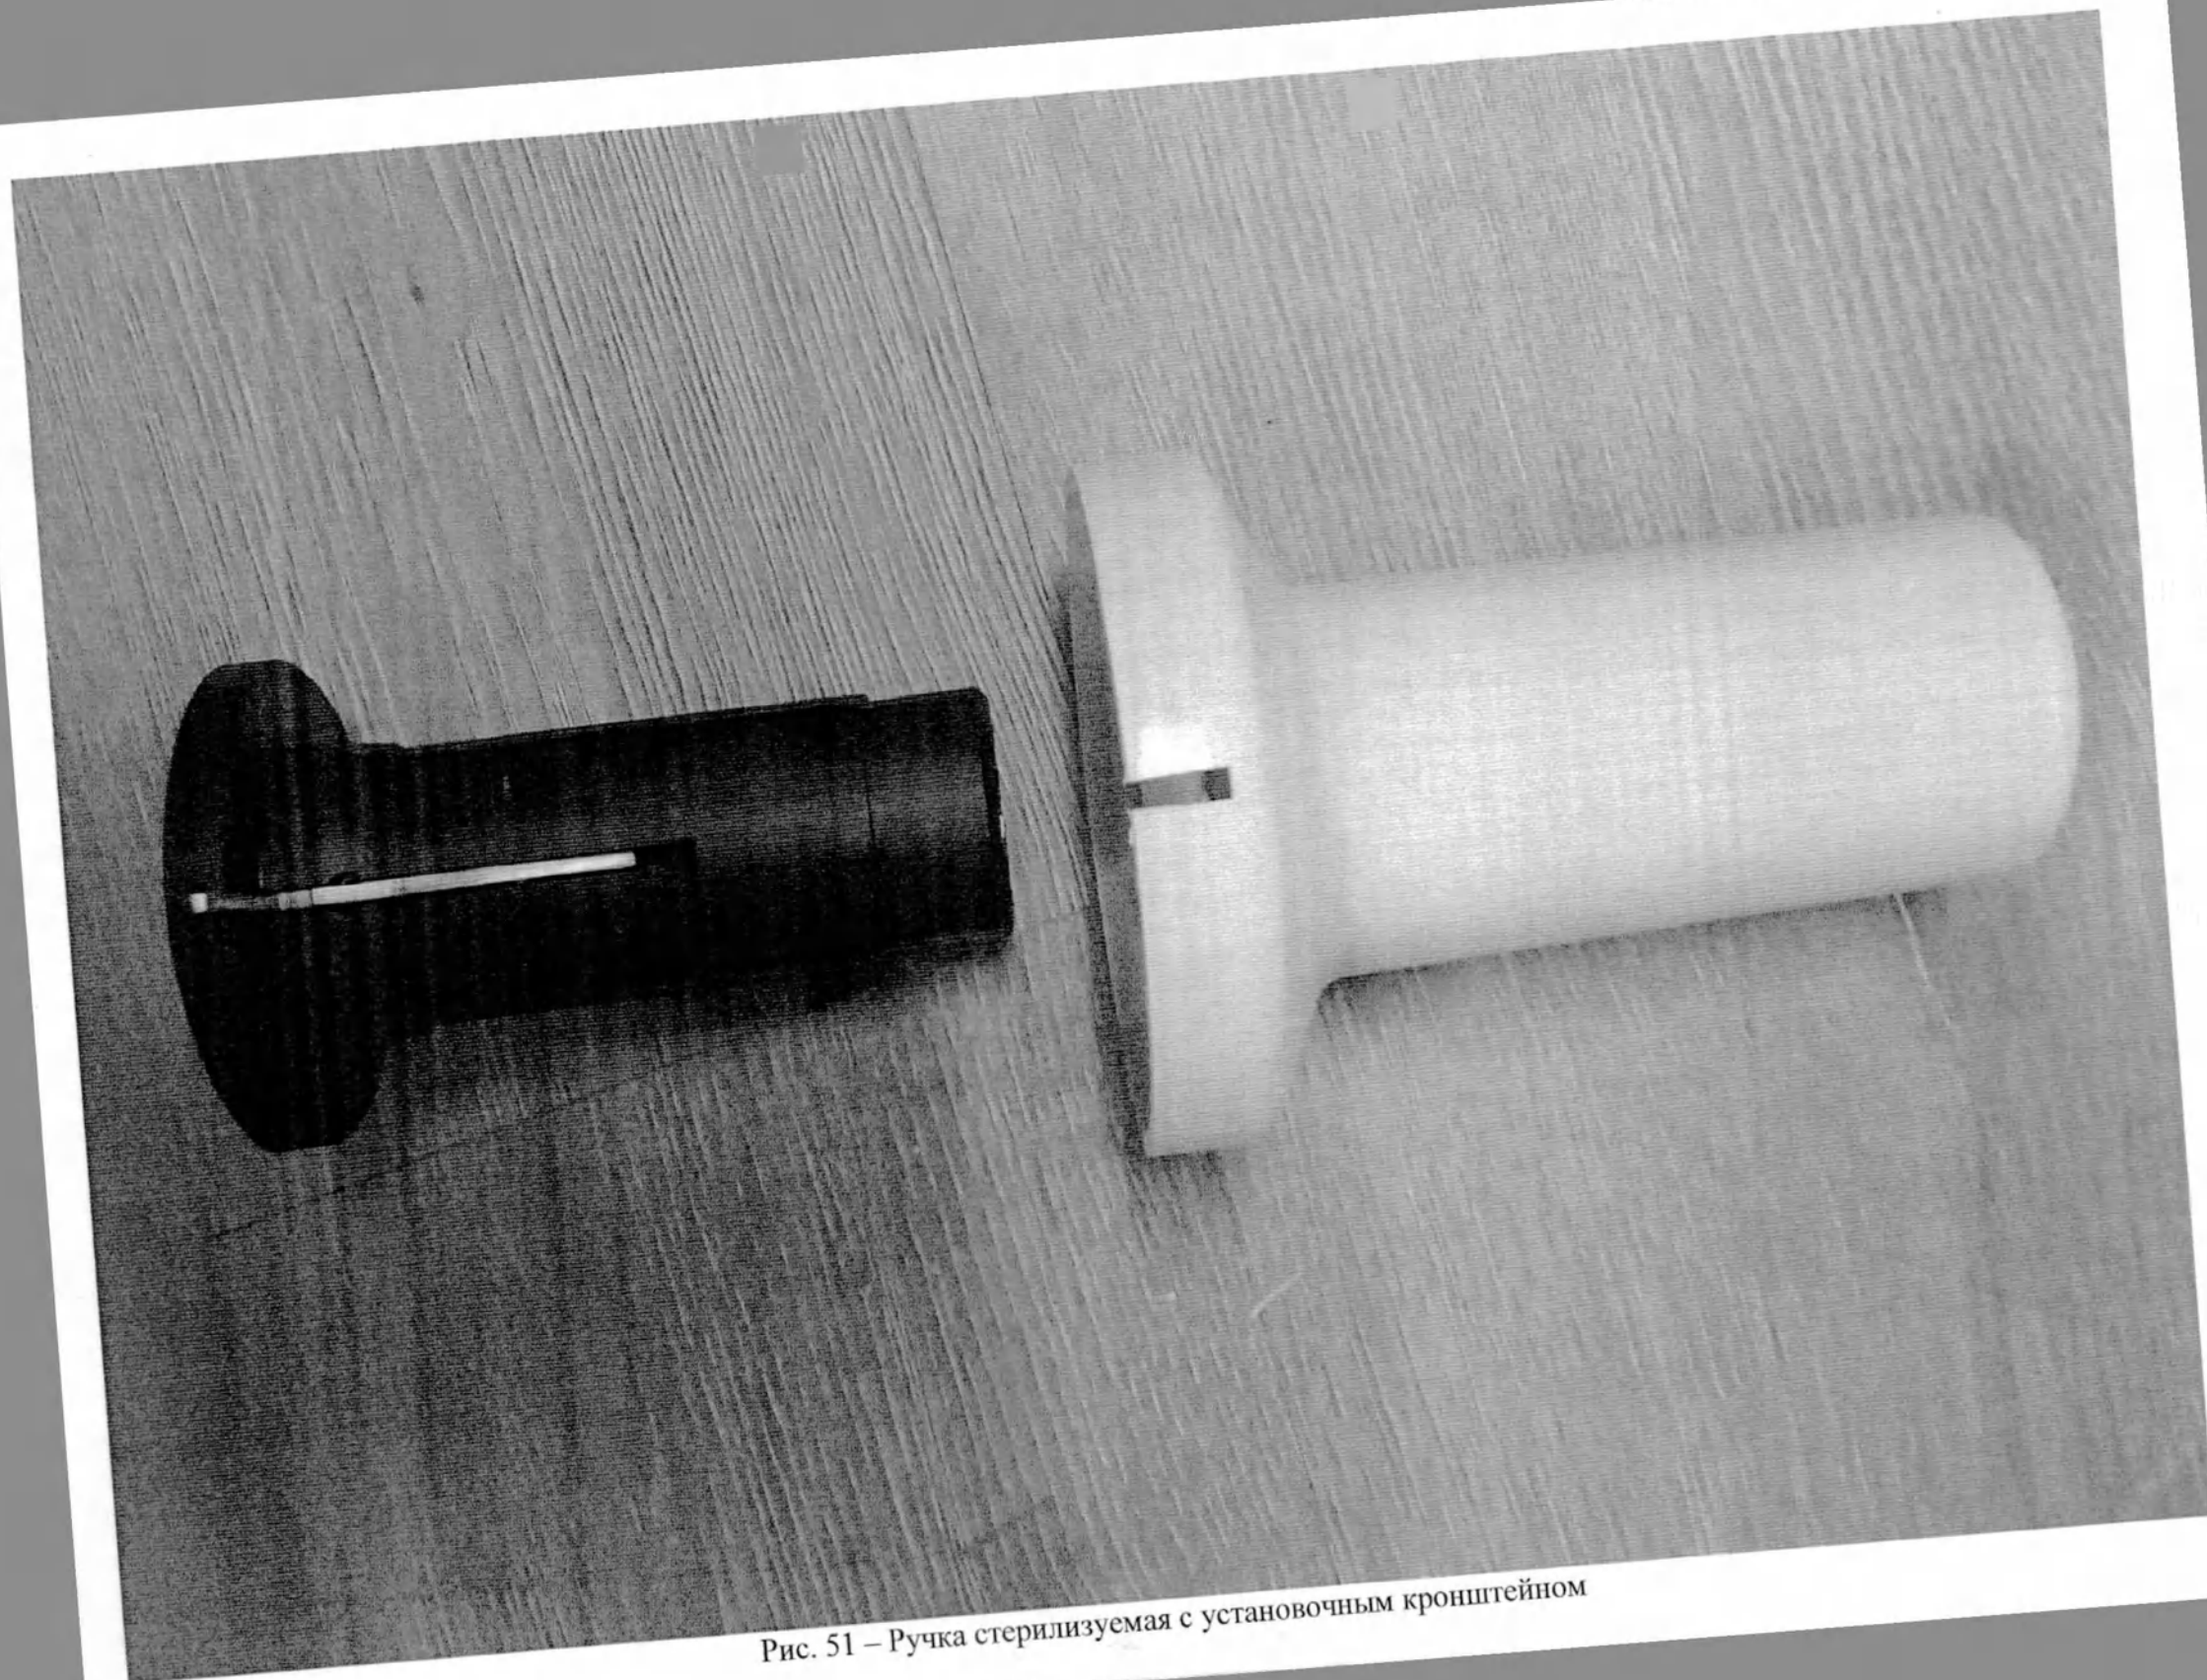
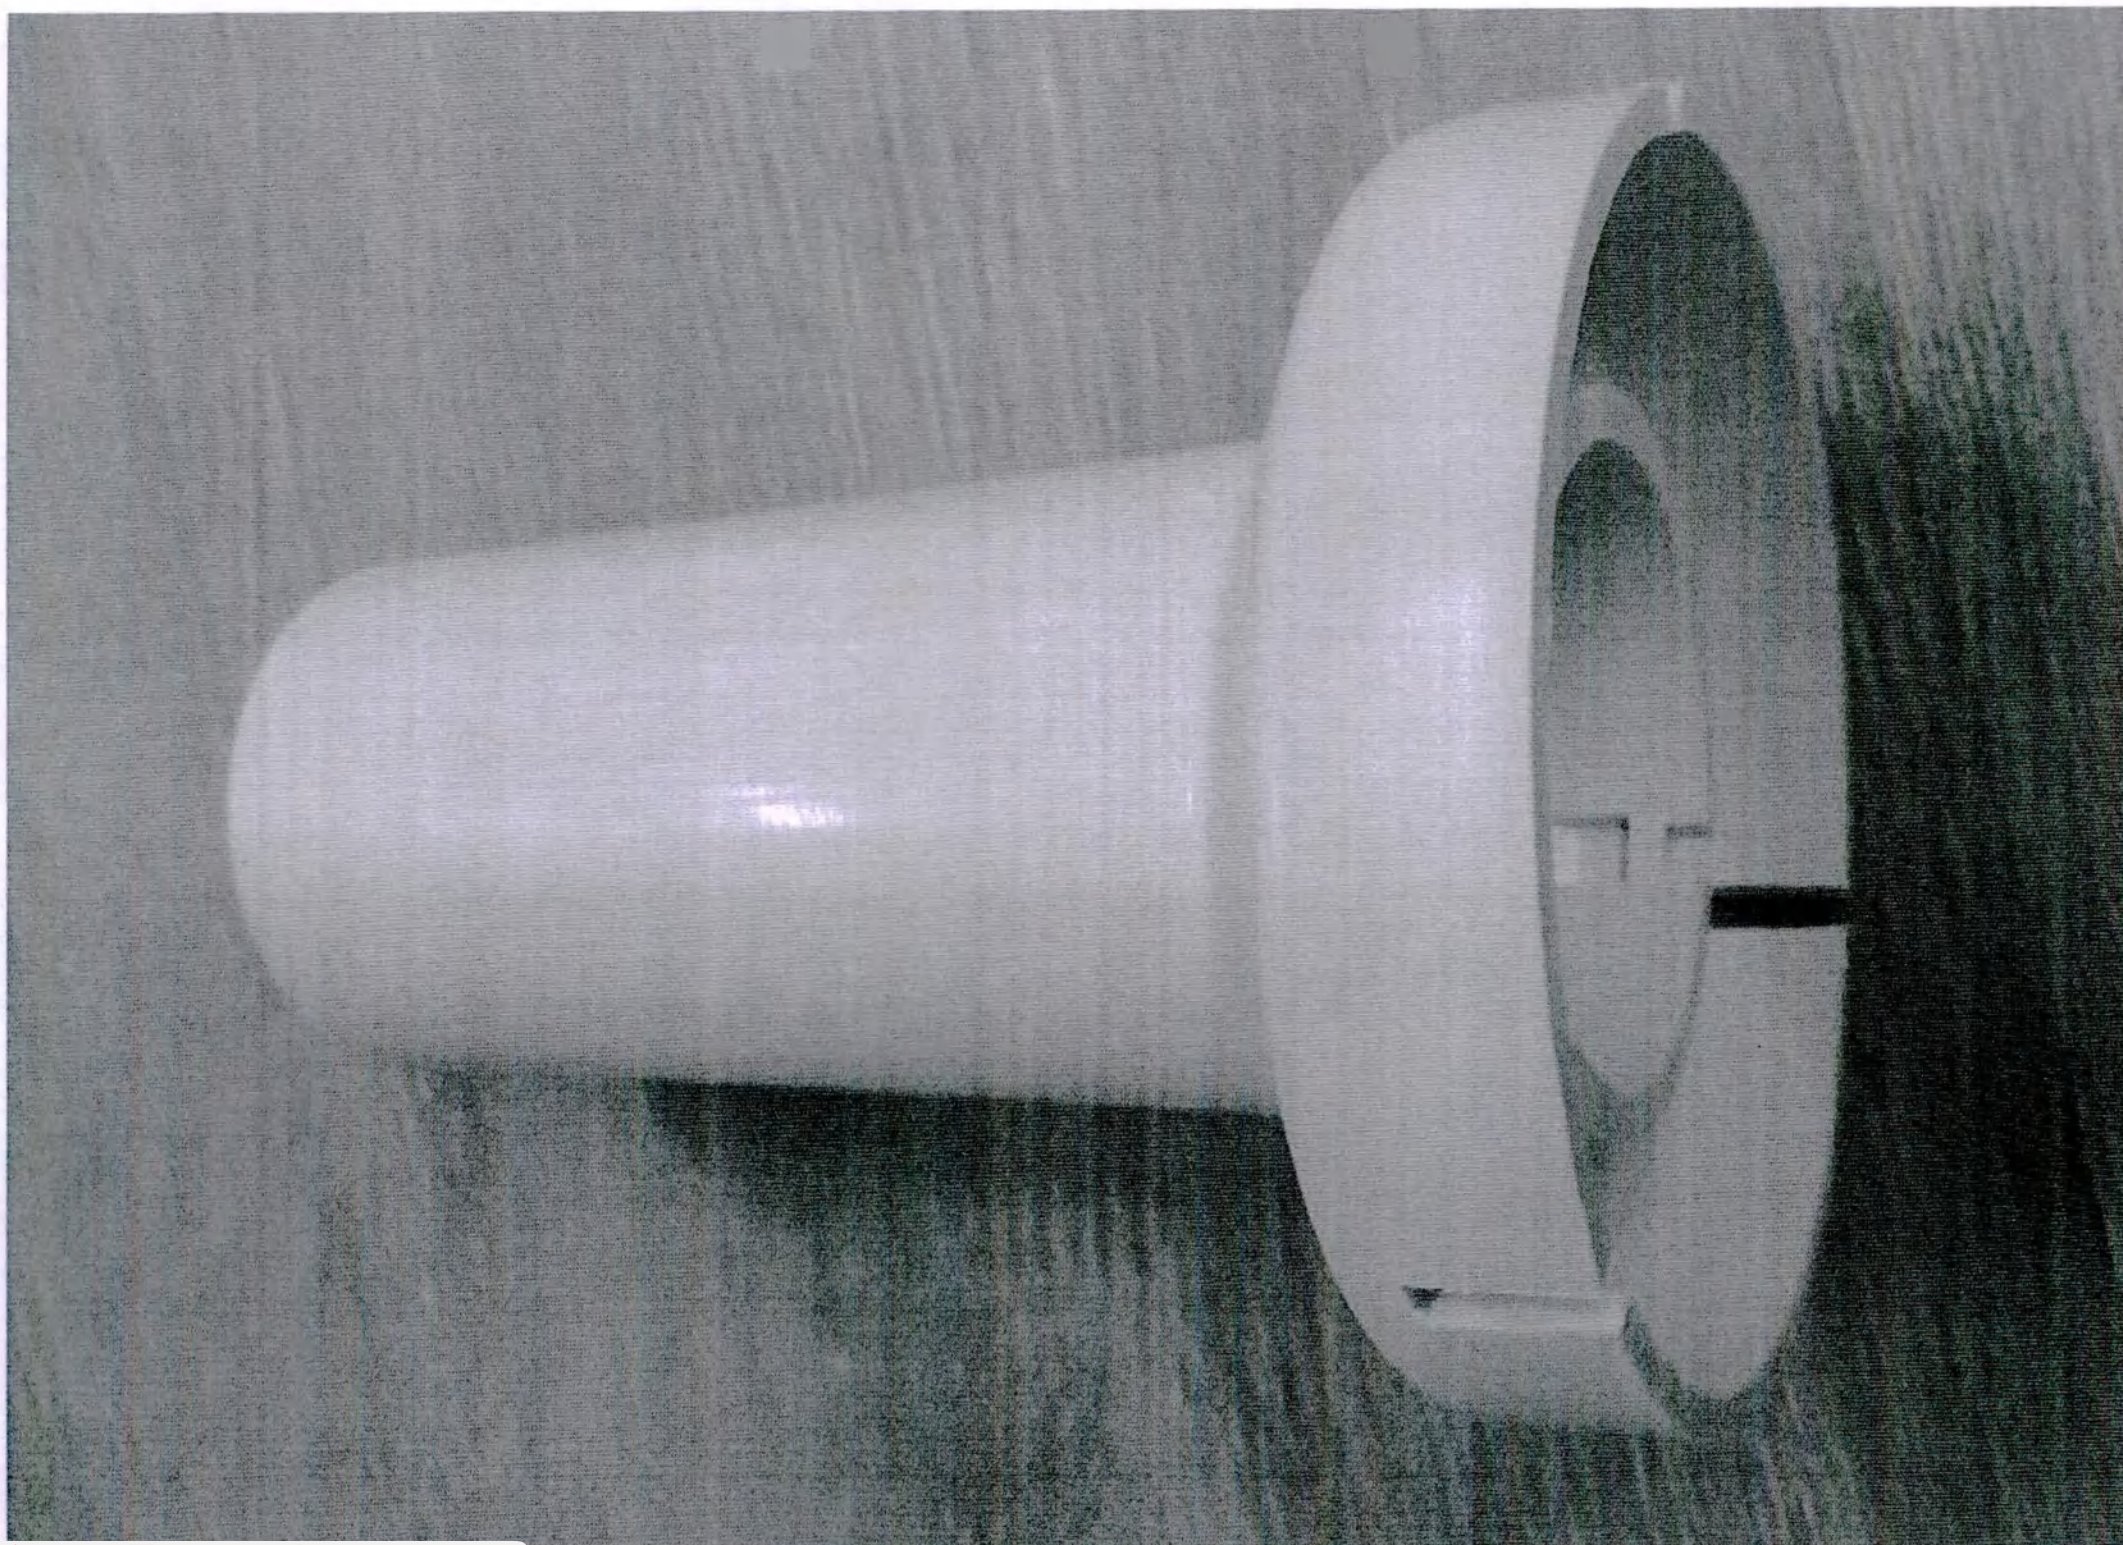
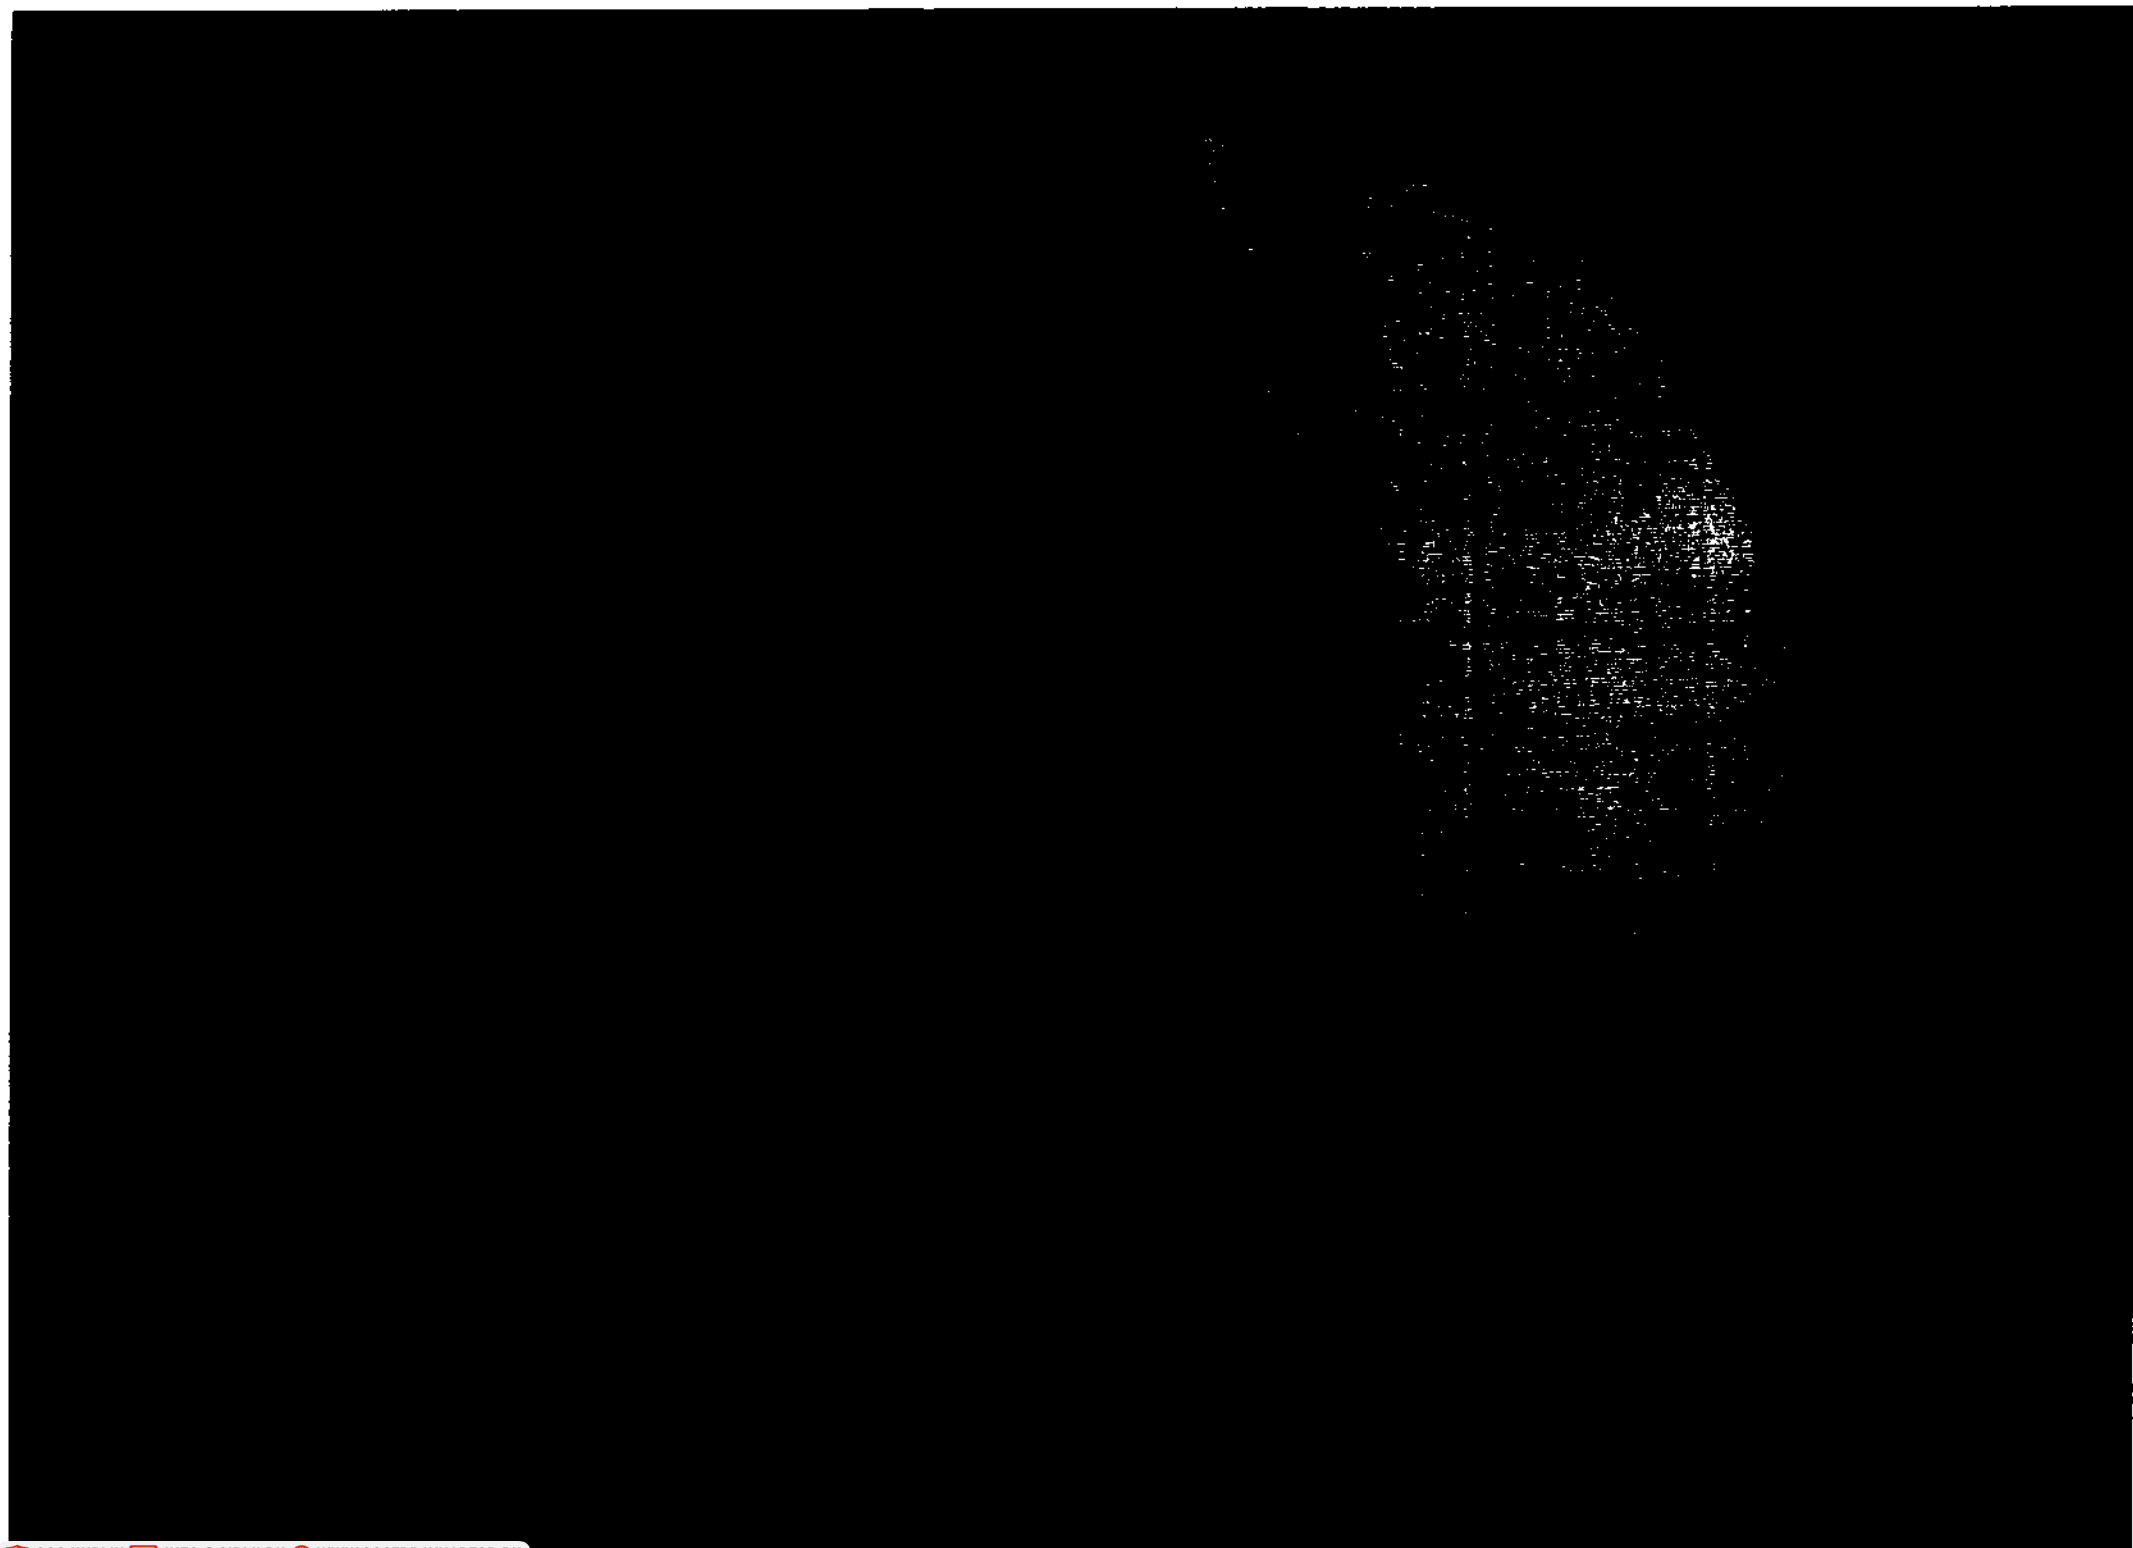


Рис. 51 – Ручка стерилизуемая с установочным кронштейном





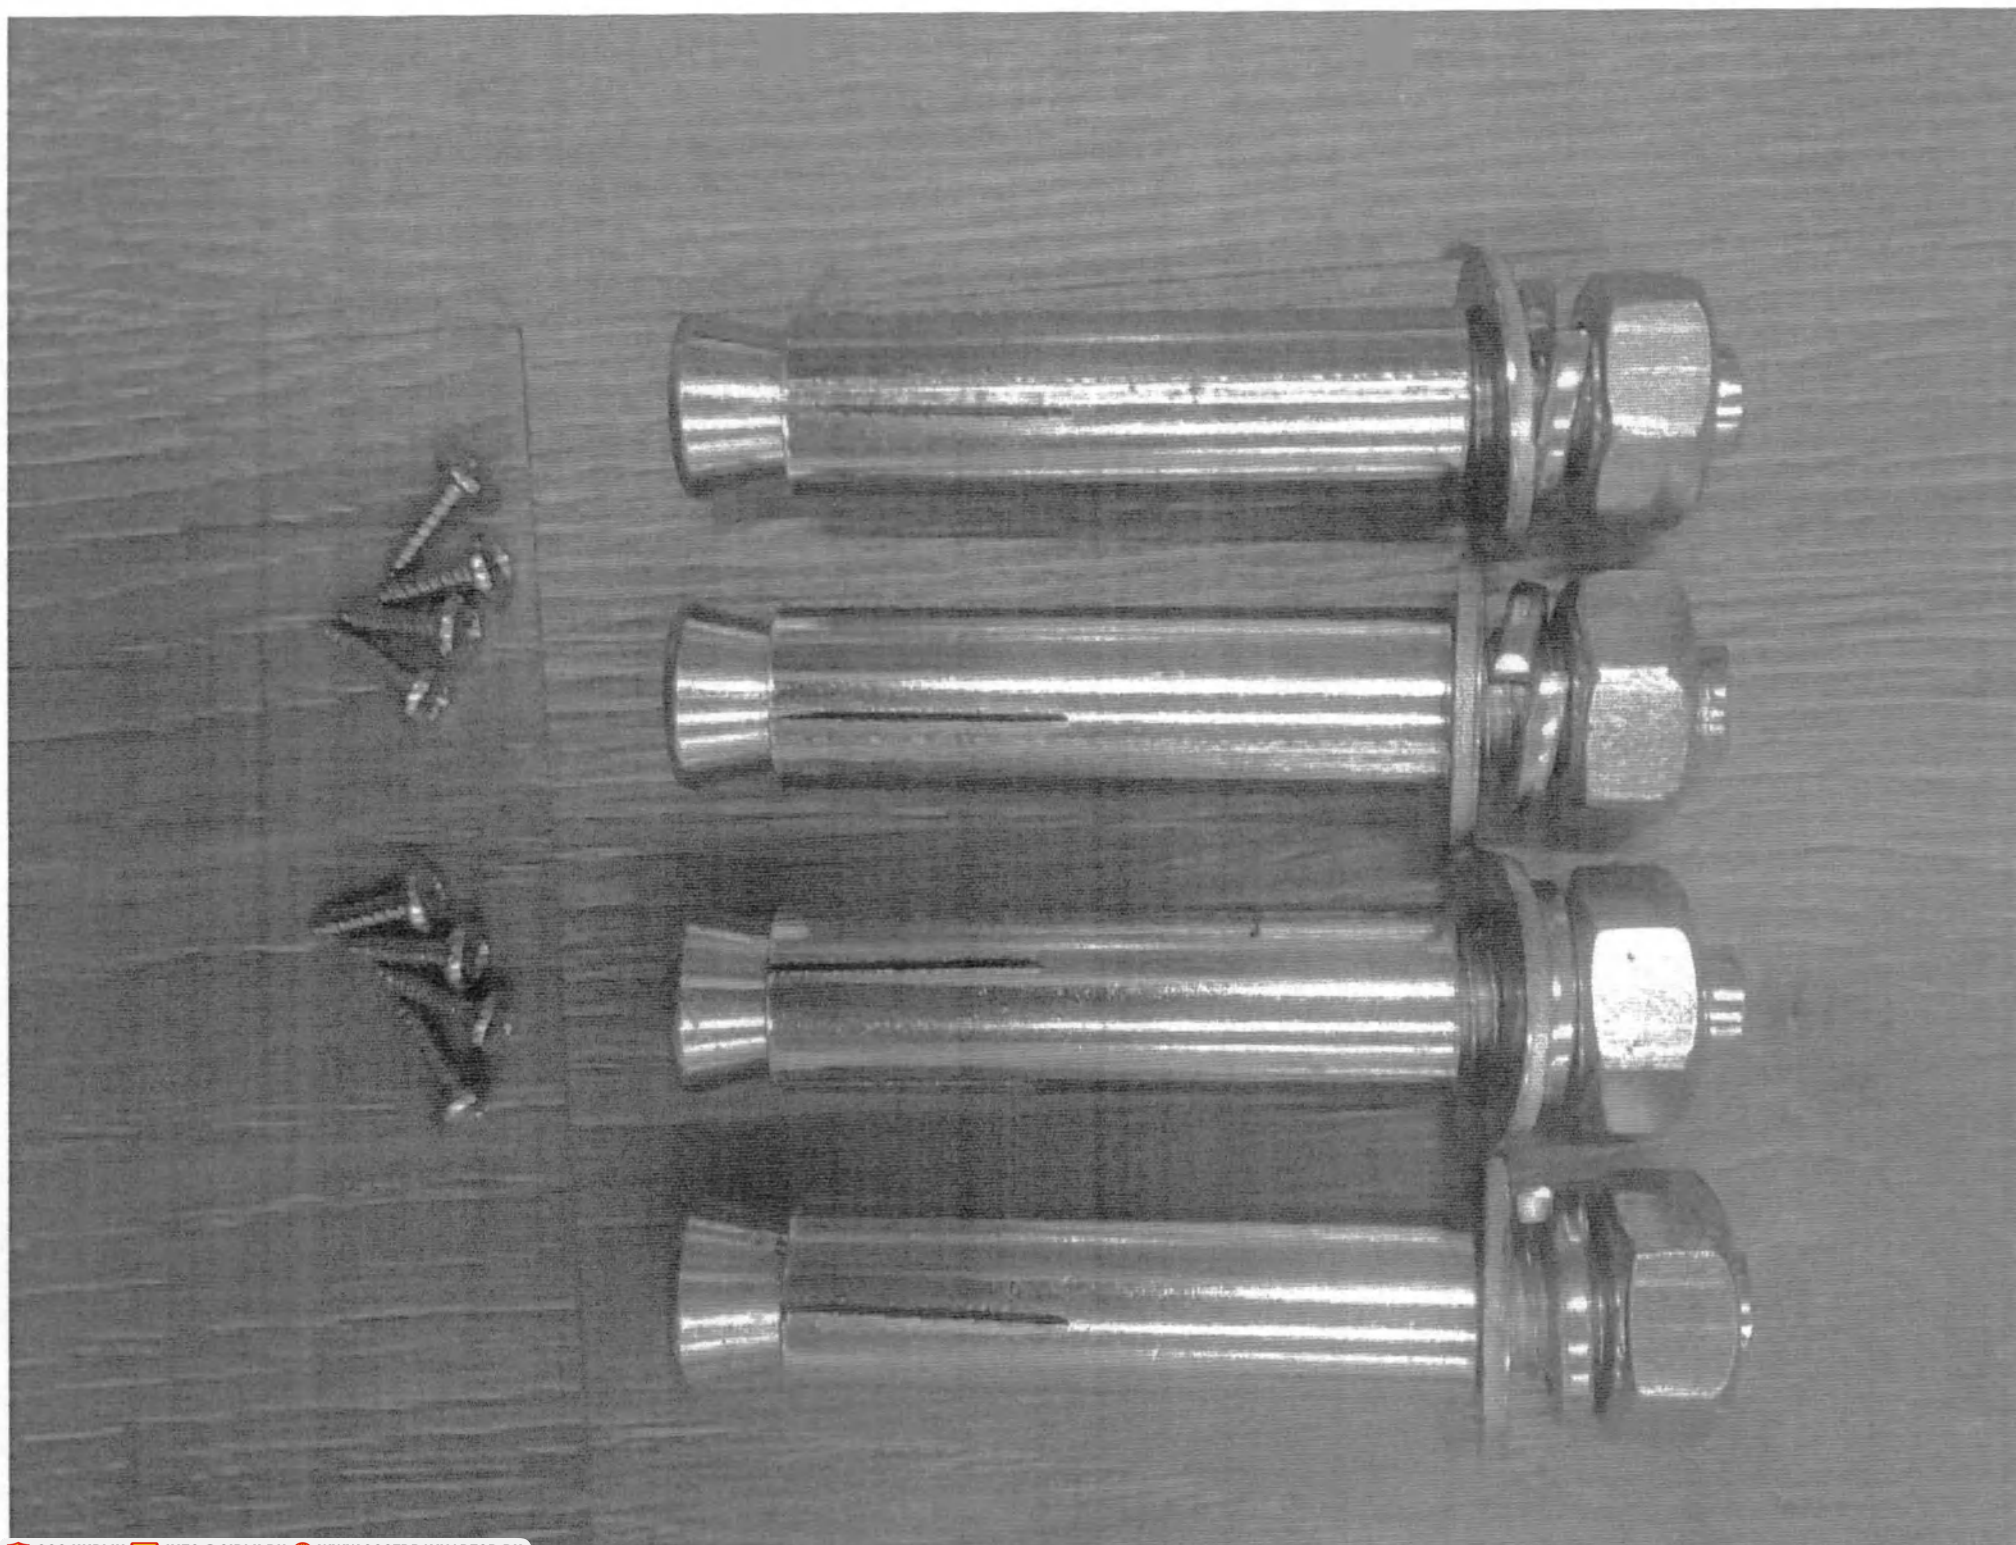


Рис. 54 – Комплект крепежа



Светильник медицинский хирургический «Armed», вариант исполнения AR 01-5 LED

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Производитель: Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building No.2, No.885, Qixing Road, Nicheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, China (Шанхай Хуэйфэн Медикал Инструмент Ко., Лтд., корпус №2, №885, ул. Цюсин, поселок Ничэн, новый район Пудун, 201306 Шанхай, Китай)

Импортер: ООО «ОПОРА», 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, зд. 5, пом. 1.

Потребляемая мощность: 55 ВА ($\pm 10\%$)

Напряжение сети: 220 В ($\pm 10\%$)

Частота сети: 50 Гц ($\pm 2\%$)

Масса: 49,5 кг ($\pm 5\%$)

Серийный номер:

Дата выпуска:



Светильник медицинский хирургический «Armed», вариант исполнения AR 02-5 LED

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Производитель: Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building No.2, No.885, Qiuxing Road, Nisheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, China (Шанхай Хуэйфэн Медикал Инструмент Ко., Лтд., корпус №2, №885, ул. Цюсин, поселок Ничэн, новый район Пудун, 201306 Шанхай, Китай)

Импортер: ООО «ОПОРА», 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, зд. 5, пом. 1.


Потребляемая мощность: 55 ВА ($\pm 10\%$)

Напряжение сети: 220 В ($\pm 10\%$)

Частота сети: 50 Гц ($\pm 2\%$)

Серийный номер:

Дата выпуска:

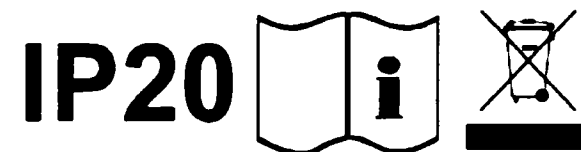

СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ «ARMED» AR 01-5 LED

Произведено: Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building No.2, No.885, Qiuxing Road, Nicheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, China (Шанхай Хуэйфэн Медикал Инструмент Ко., Лтд., корпус №2, №885, ул. Цюсин, поселок Ничэн, новый район Пудун, 201306 Шанхай, Китай)

Импортер: ООО «ОПОРА», 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, зд. 5, пом. 1

РУ № _____ от _____ г.

Перед применением внимательно изучите Руководство по эксплуатации!

Назначение: предназначен для освещения рабочего поля при проведении хирургических операций и при осмотре пациента.

Сфера применения: лечебно-профилактические учреждения.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.


Срок службы: 10 лет.

Дата упаковывания:



www.armed.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

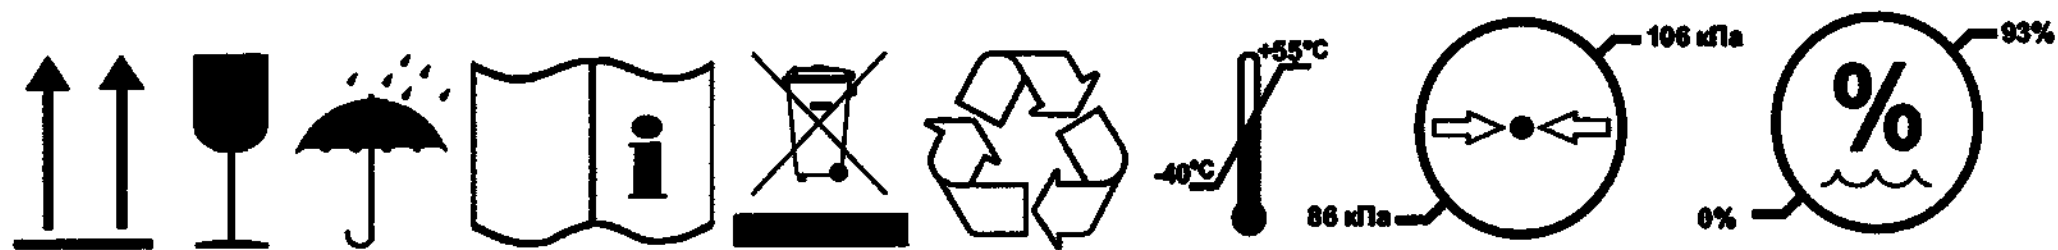

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью **60**
(*шестьдесят*) лист **06**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ОПОРА»
ЖУКОВ Р. С.

