

ООО «Левенштайн Медикал Рус» • Россия • г. Москва, ул. Гостиничная, д. 5

ИНН 7743309306 • ОГРН 1197746456489 • ОКПО 40773189

Утверждаю
Генеральный Директор
ООО «ЛЕВЕНШТАЙН МЕДИКАЛ РУС»
Бородина Н.Е.
« » 2024 г.




Фотографические изображения медицинского изделия

**Аппарат для диагностики нарушений сна и контроля
терапии Самоа, в вариантах исполнения**

2024 г.

I. Аппарат для диагностики нарушений сна и контроля терапии, в варианте исполнения Samoa

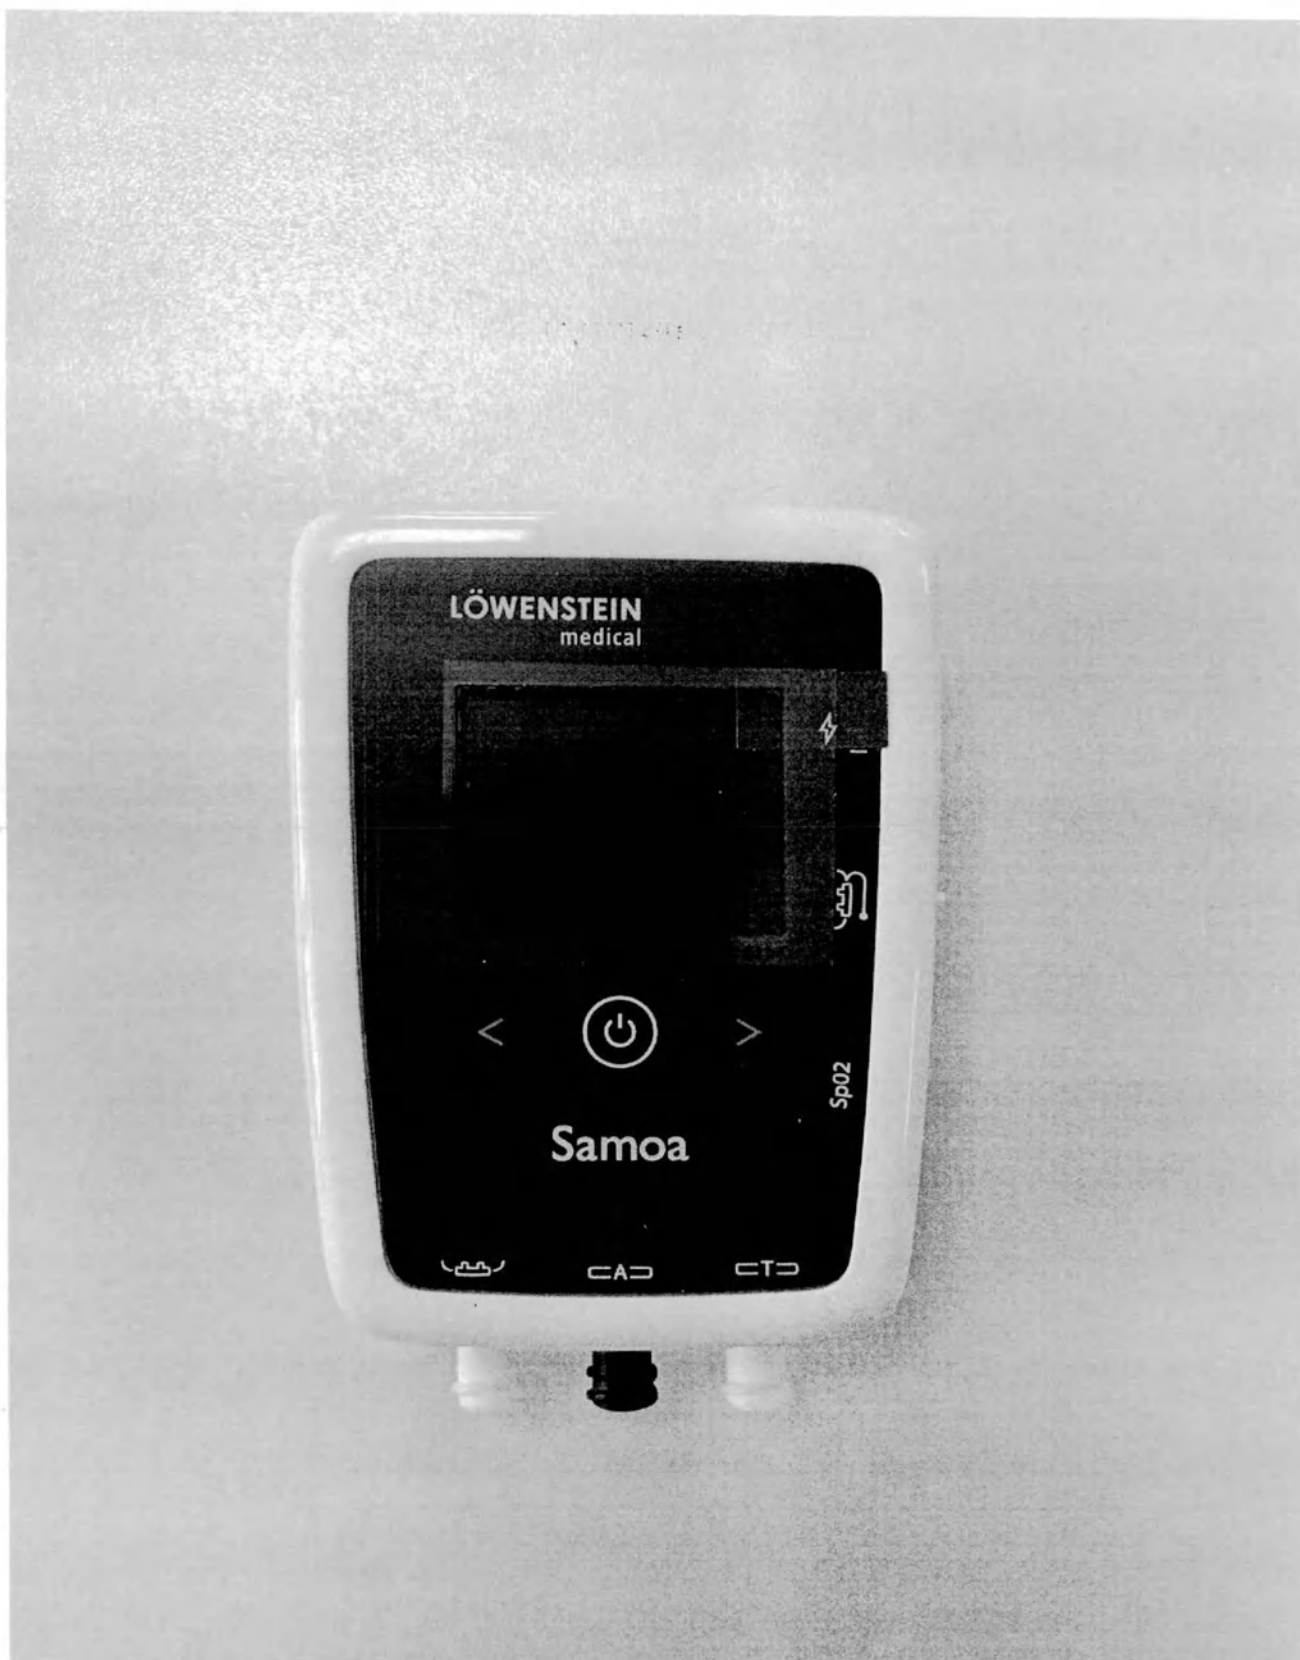

1. Рекордер пациента Samoa.

2. Аккумуляторная батарея для Самоа







3. Программное обеспечение MiniScreen Viewer.




4. Сумка для транспортировки для Samoa и аксессуаров

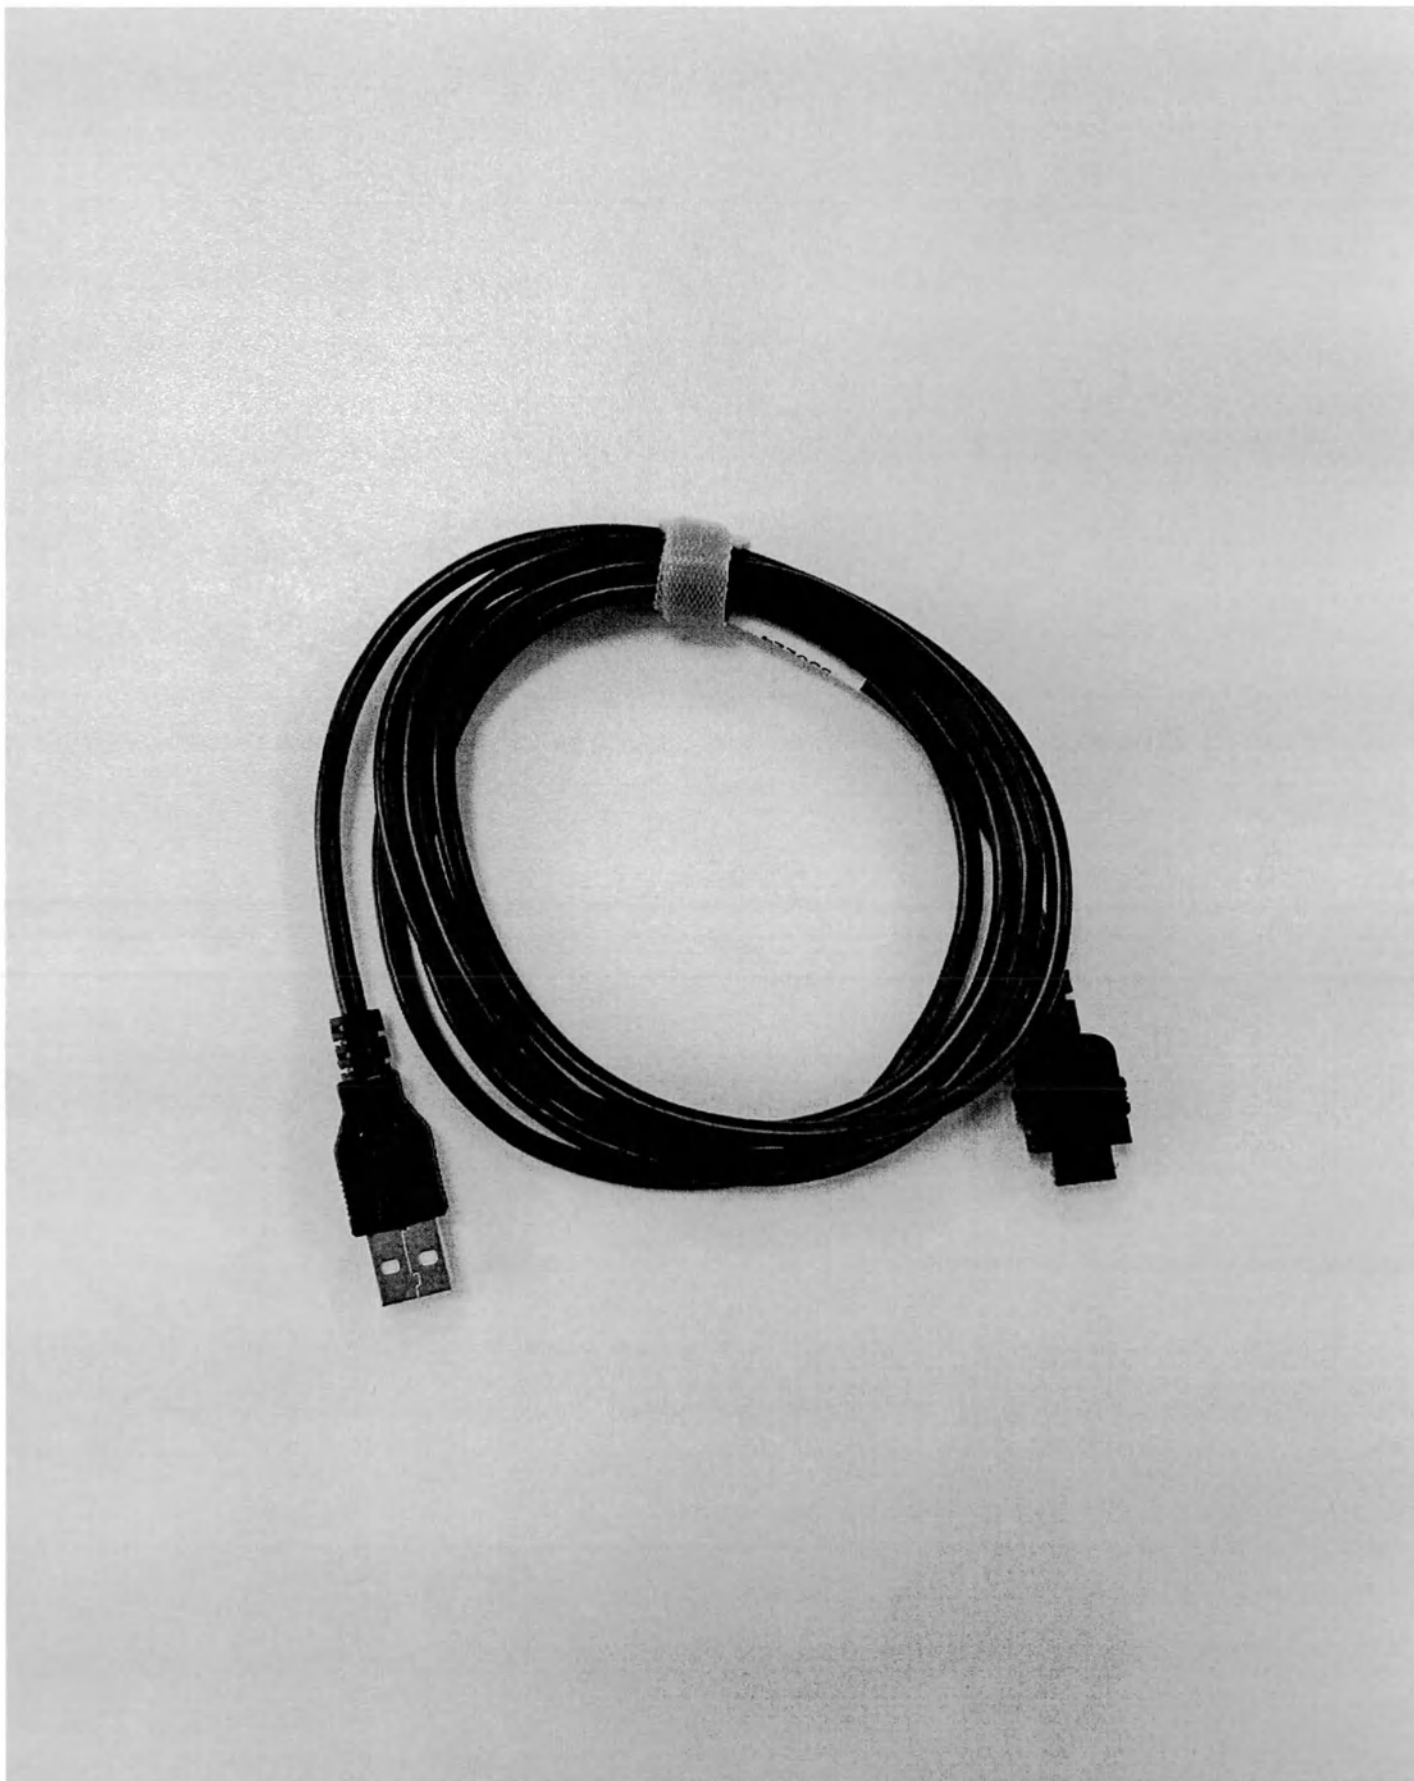


5. Кабель USB для передачи данных на ПК, 1.8 м

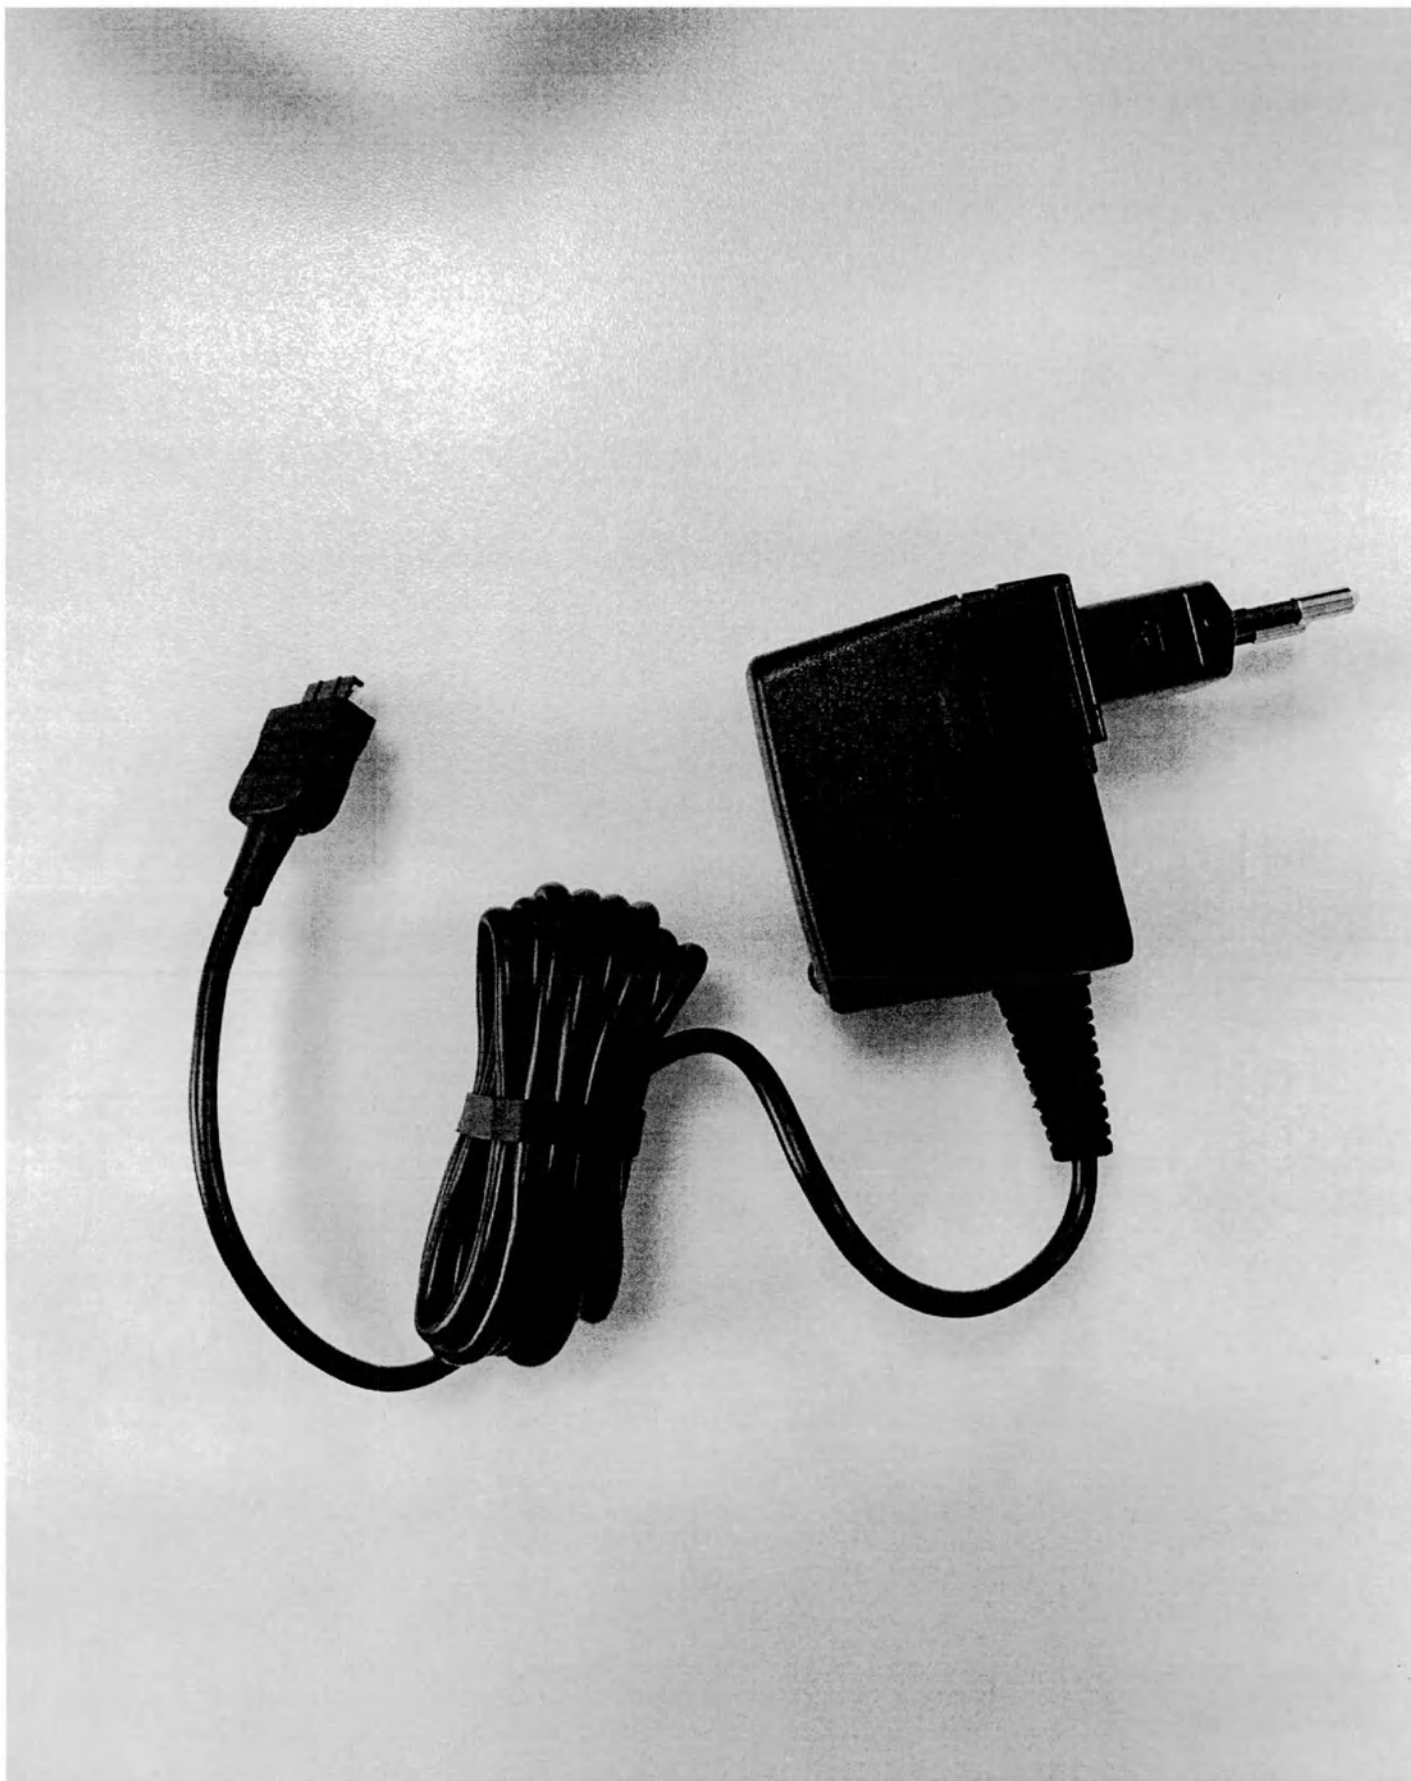


6. Адаптер питания с медицинским одобрением.

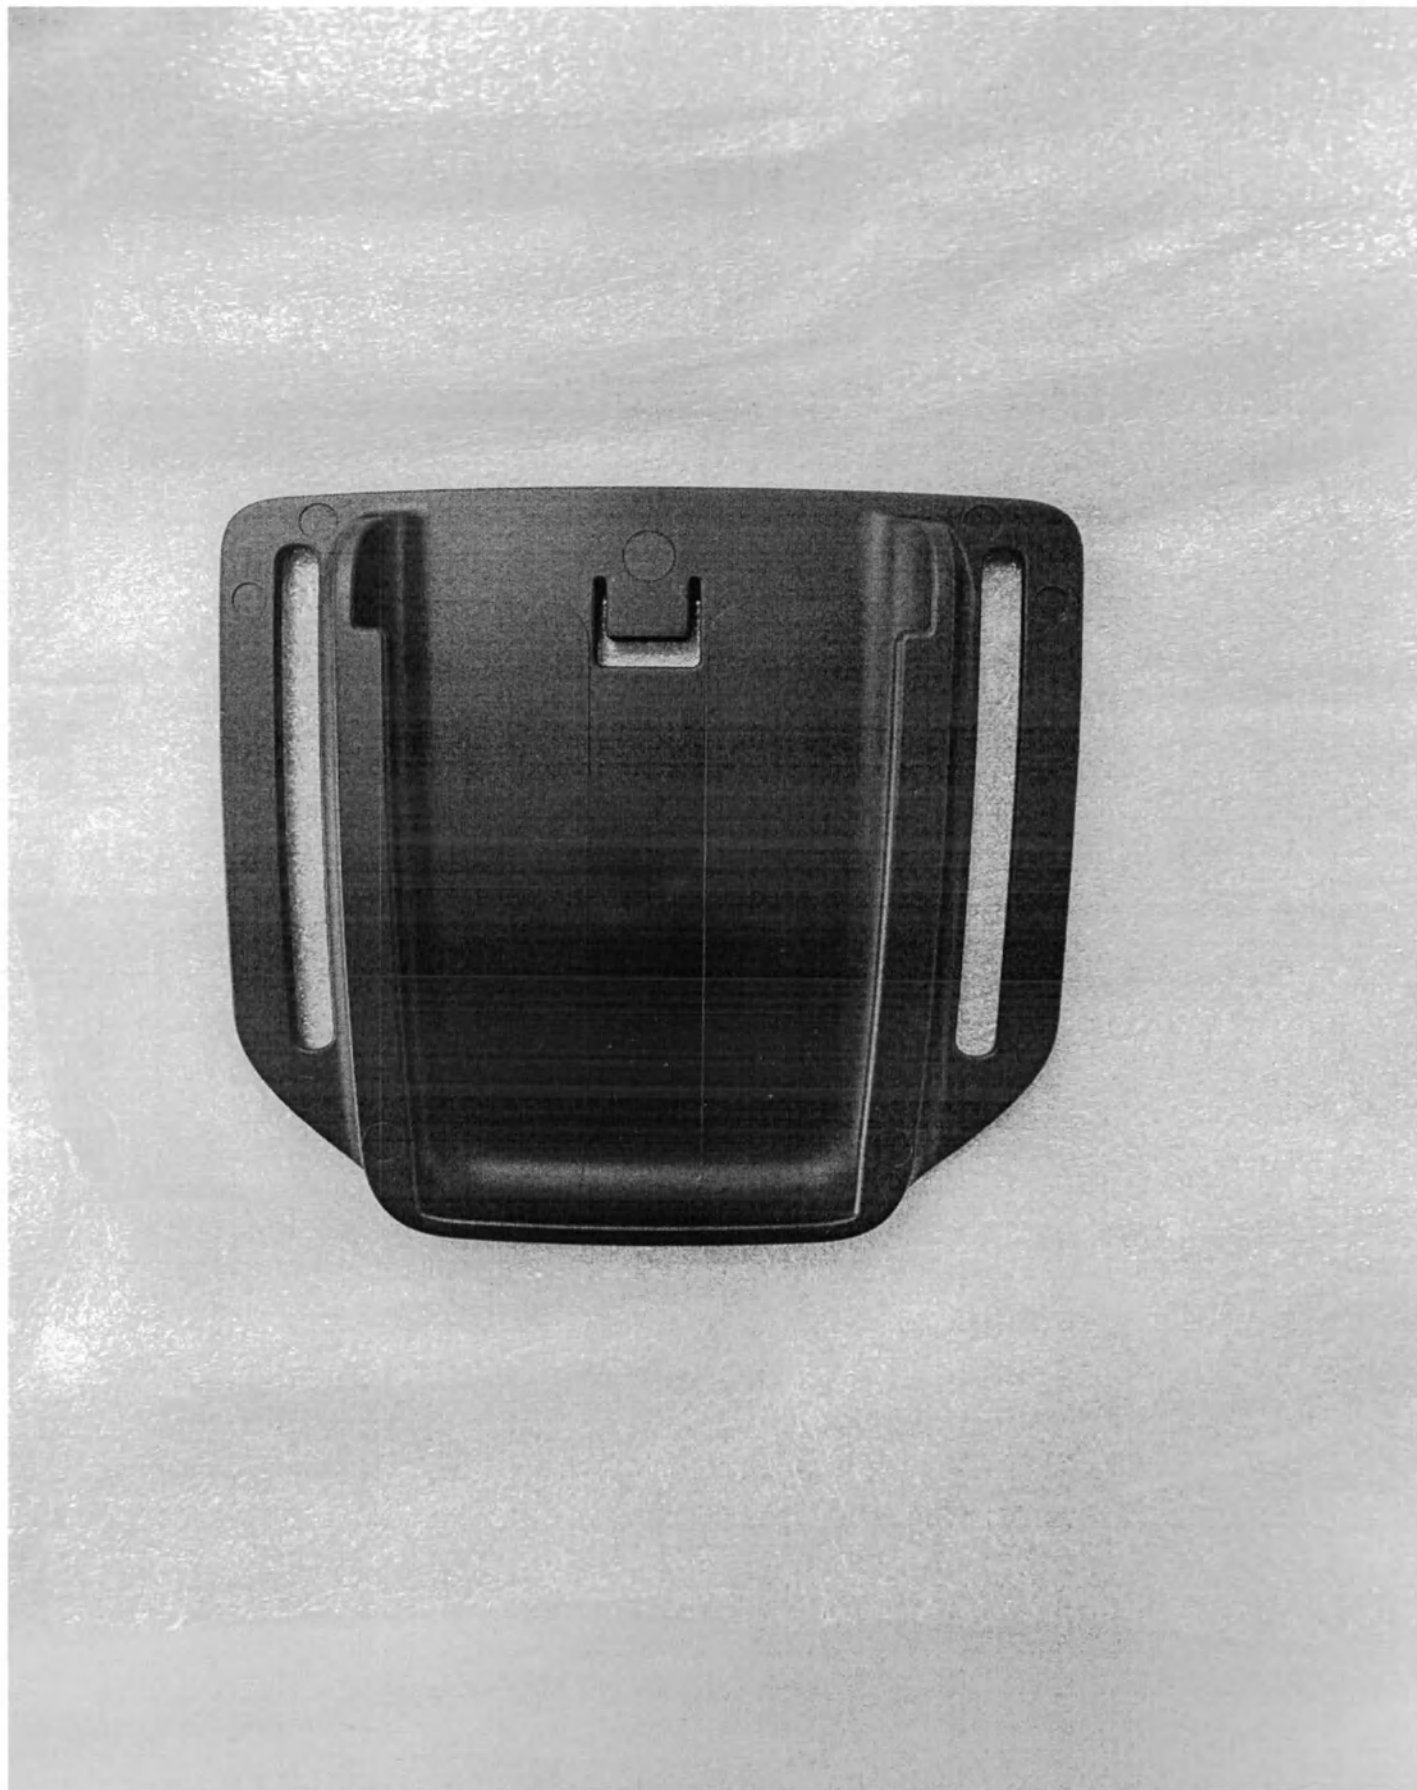


7. Консоль для переноски рекордера пациента Samoa.

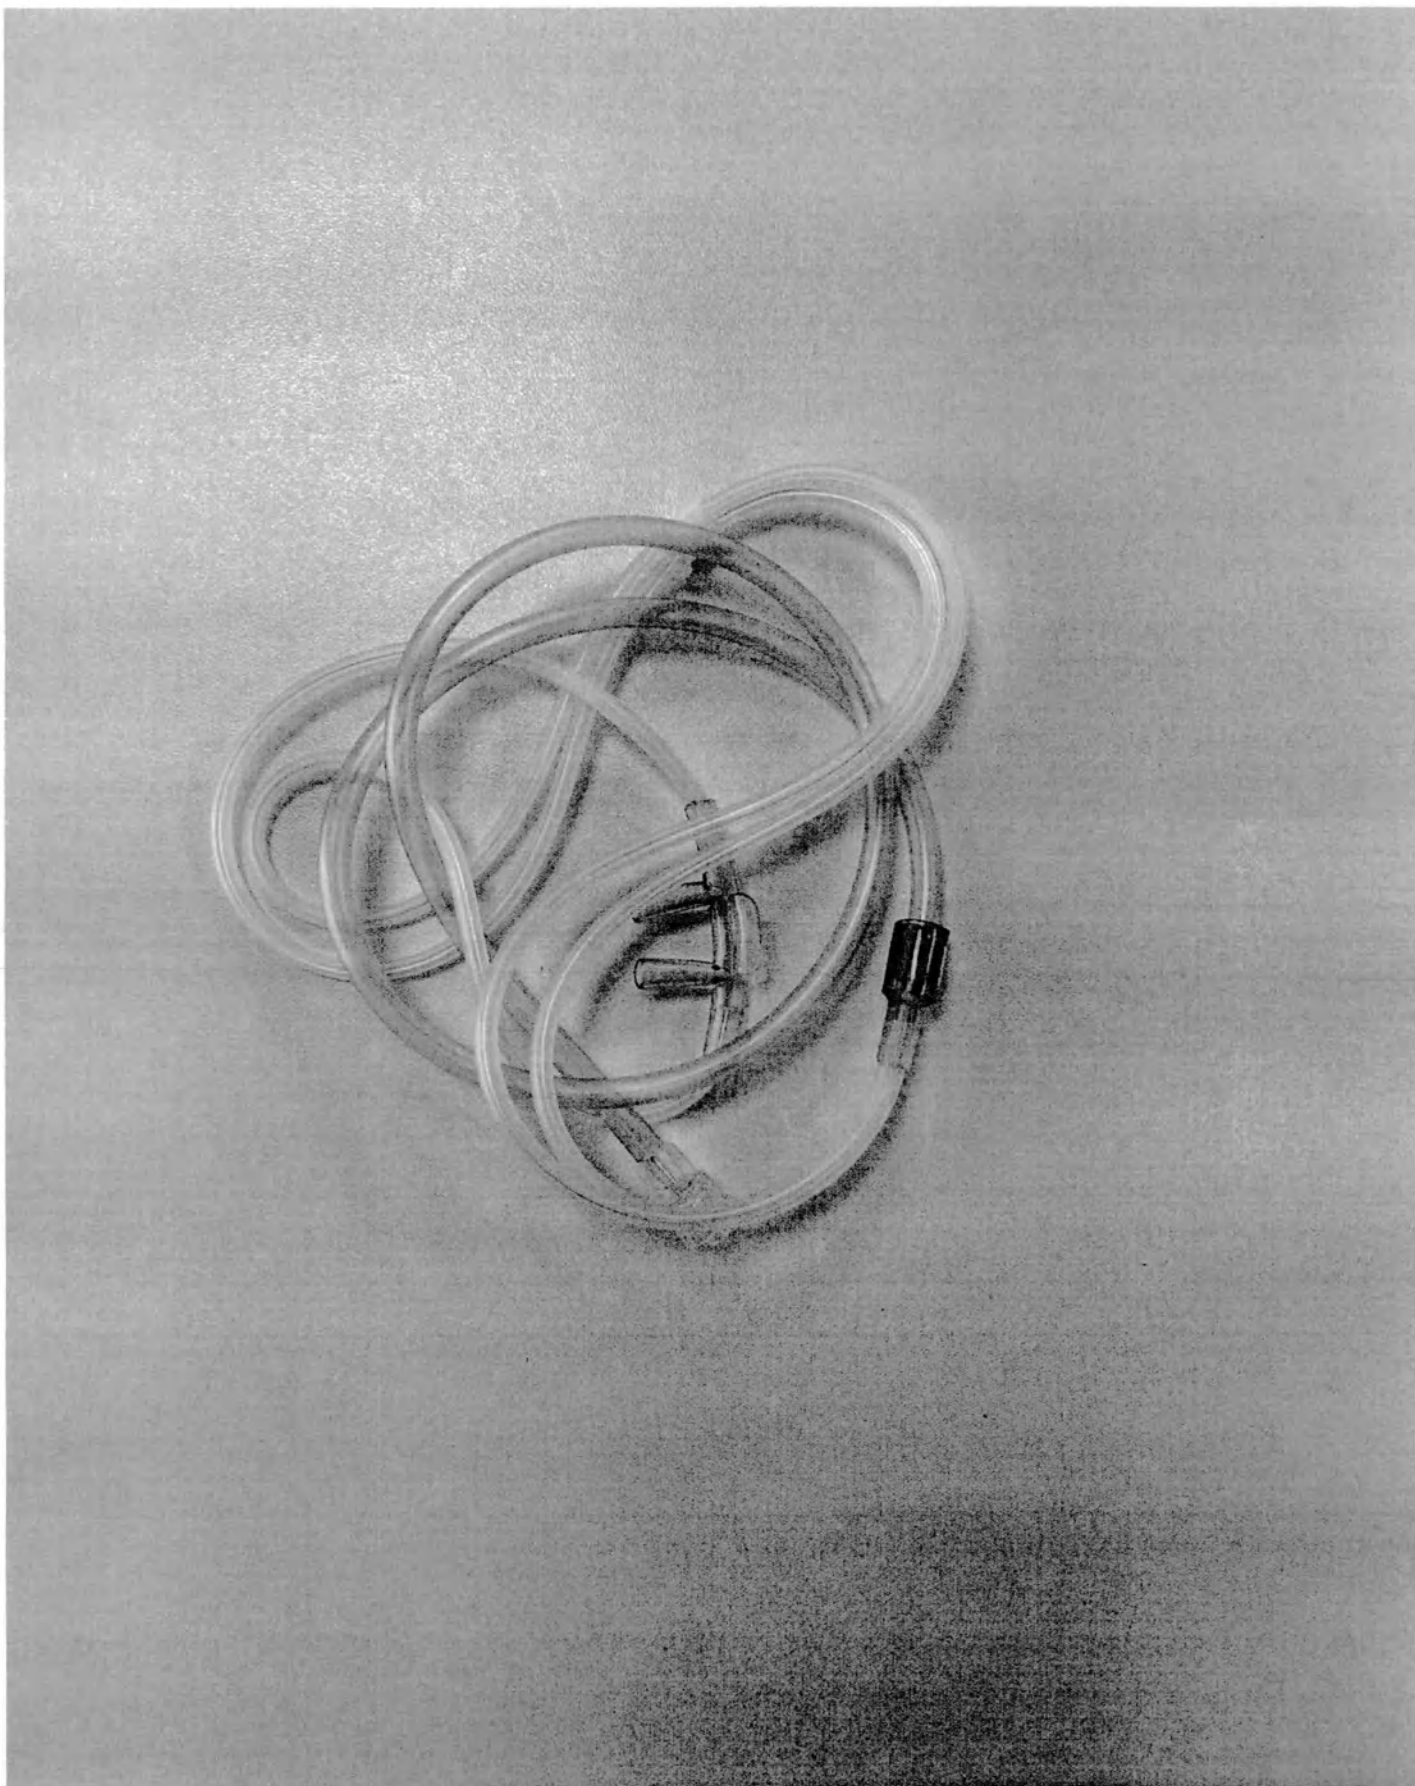


8. Назальная канюля, для взрослых, 50 см, LuerLock

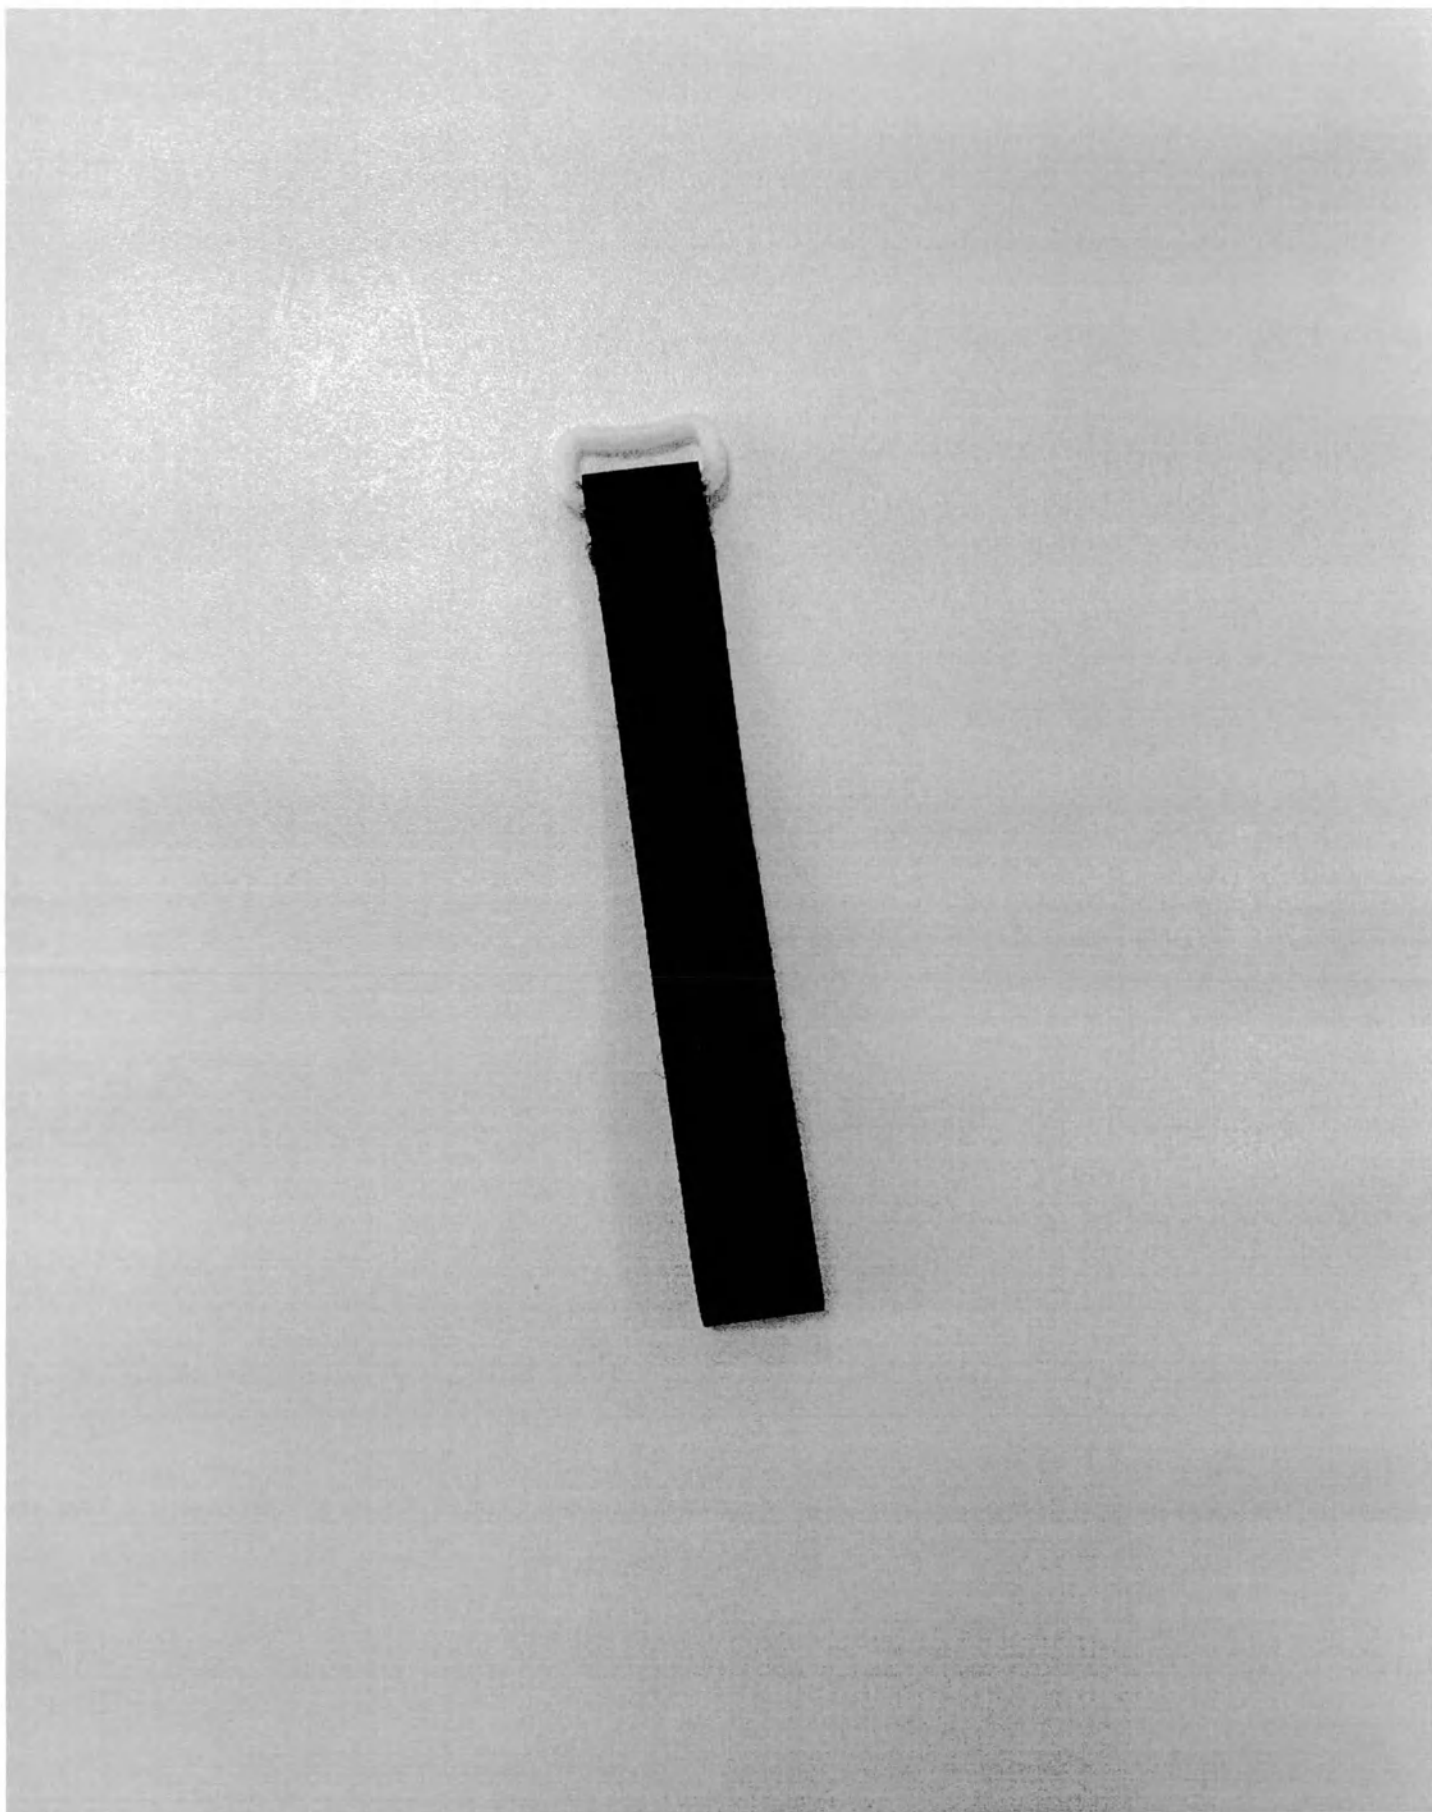

9. Застёжка на липучке на руку для SpO2 датчика

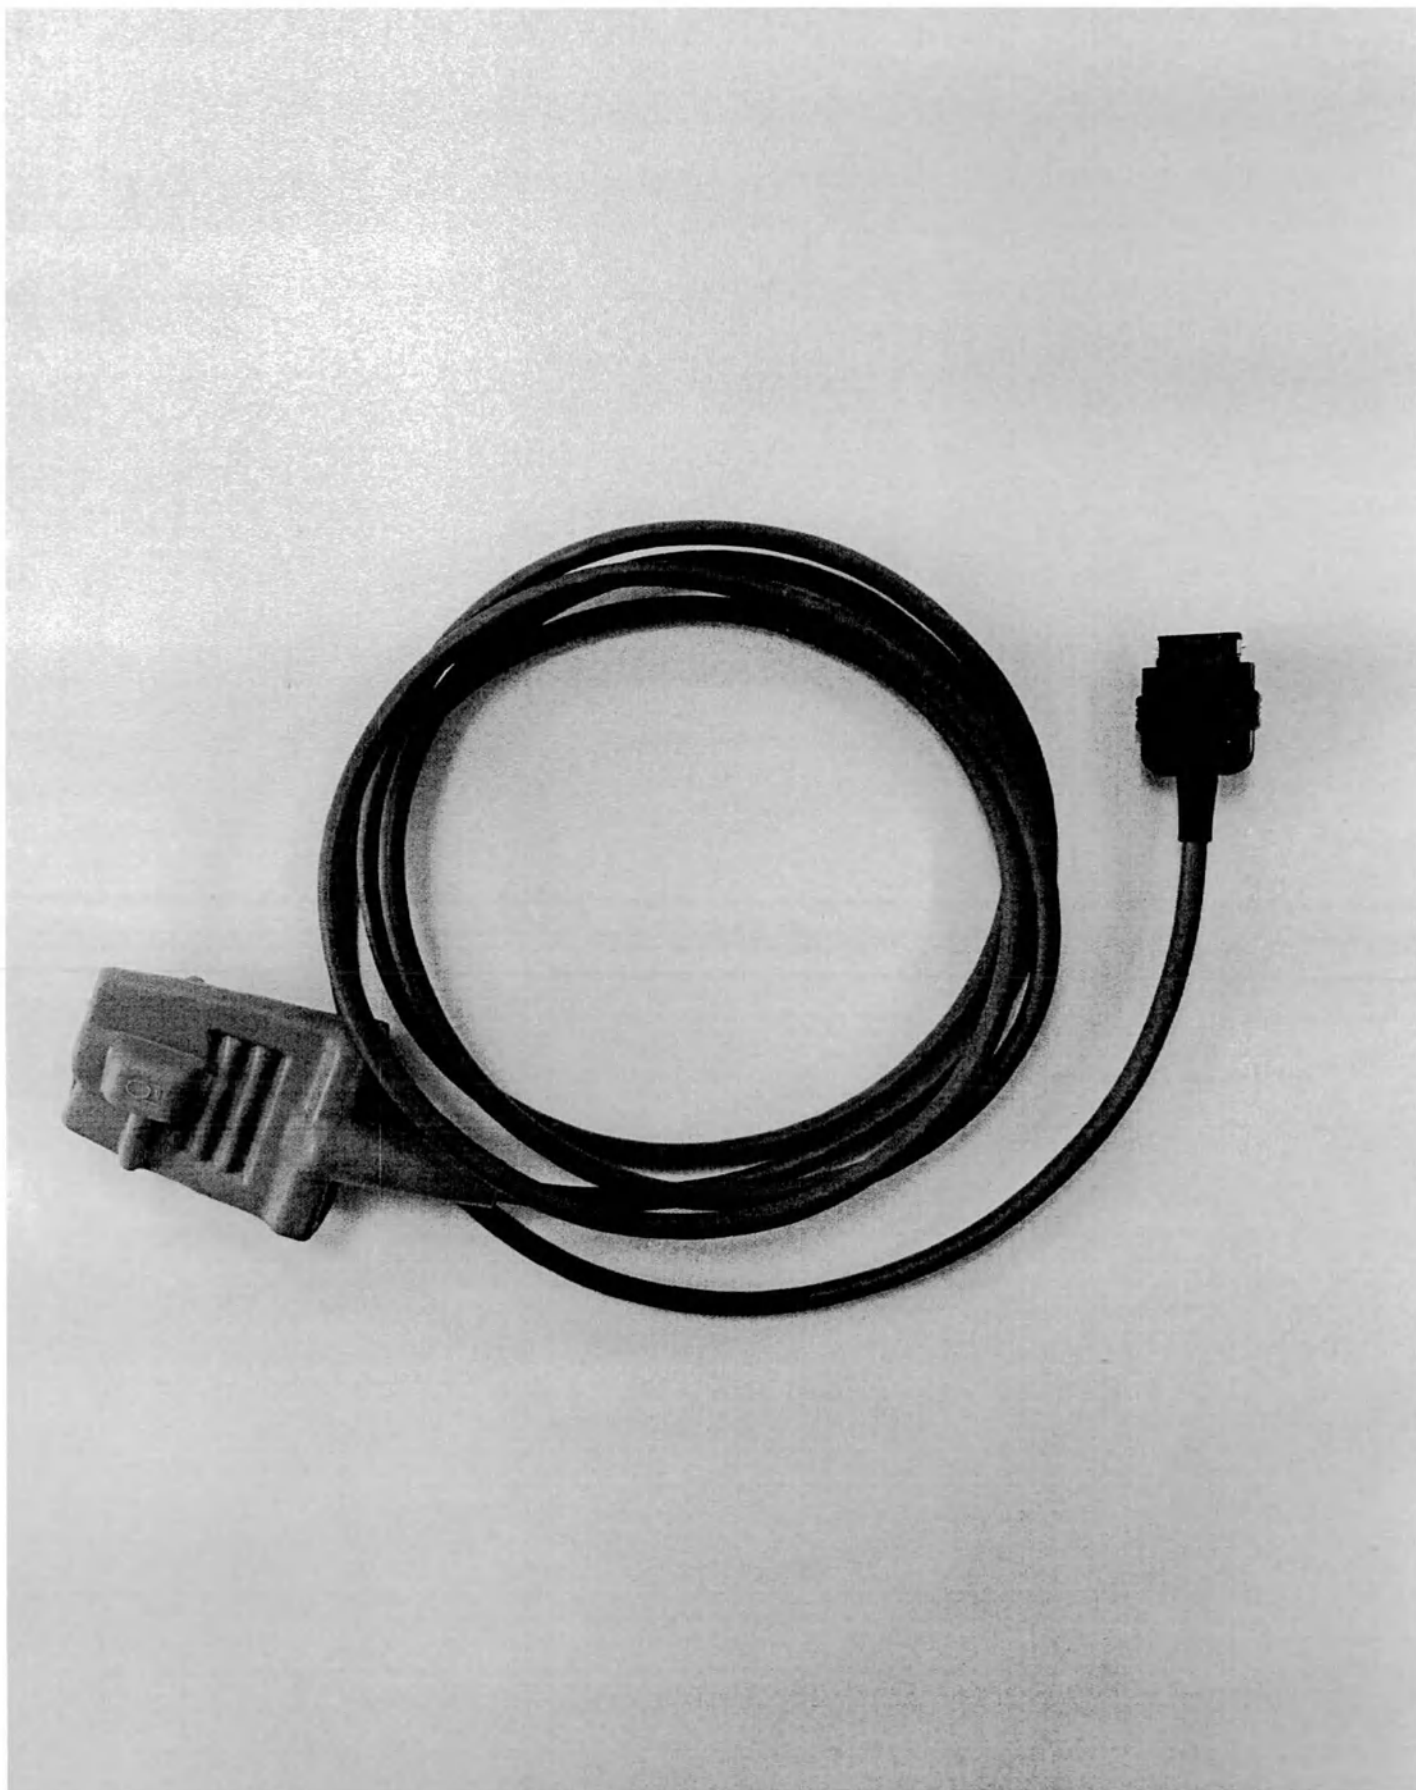


10. Пальцевой датчик SpO₂

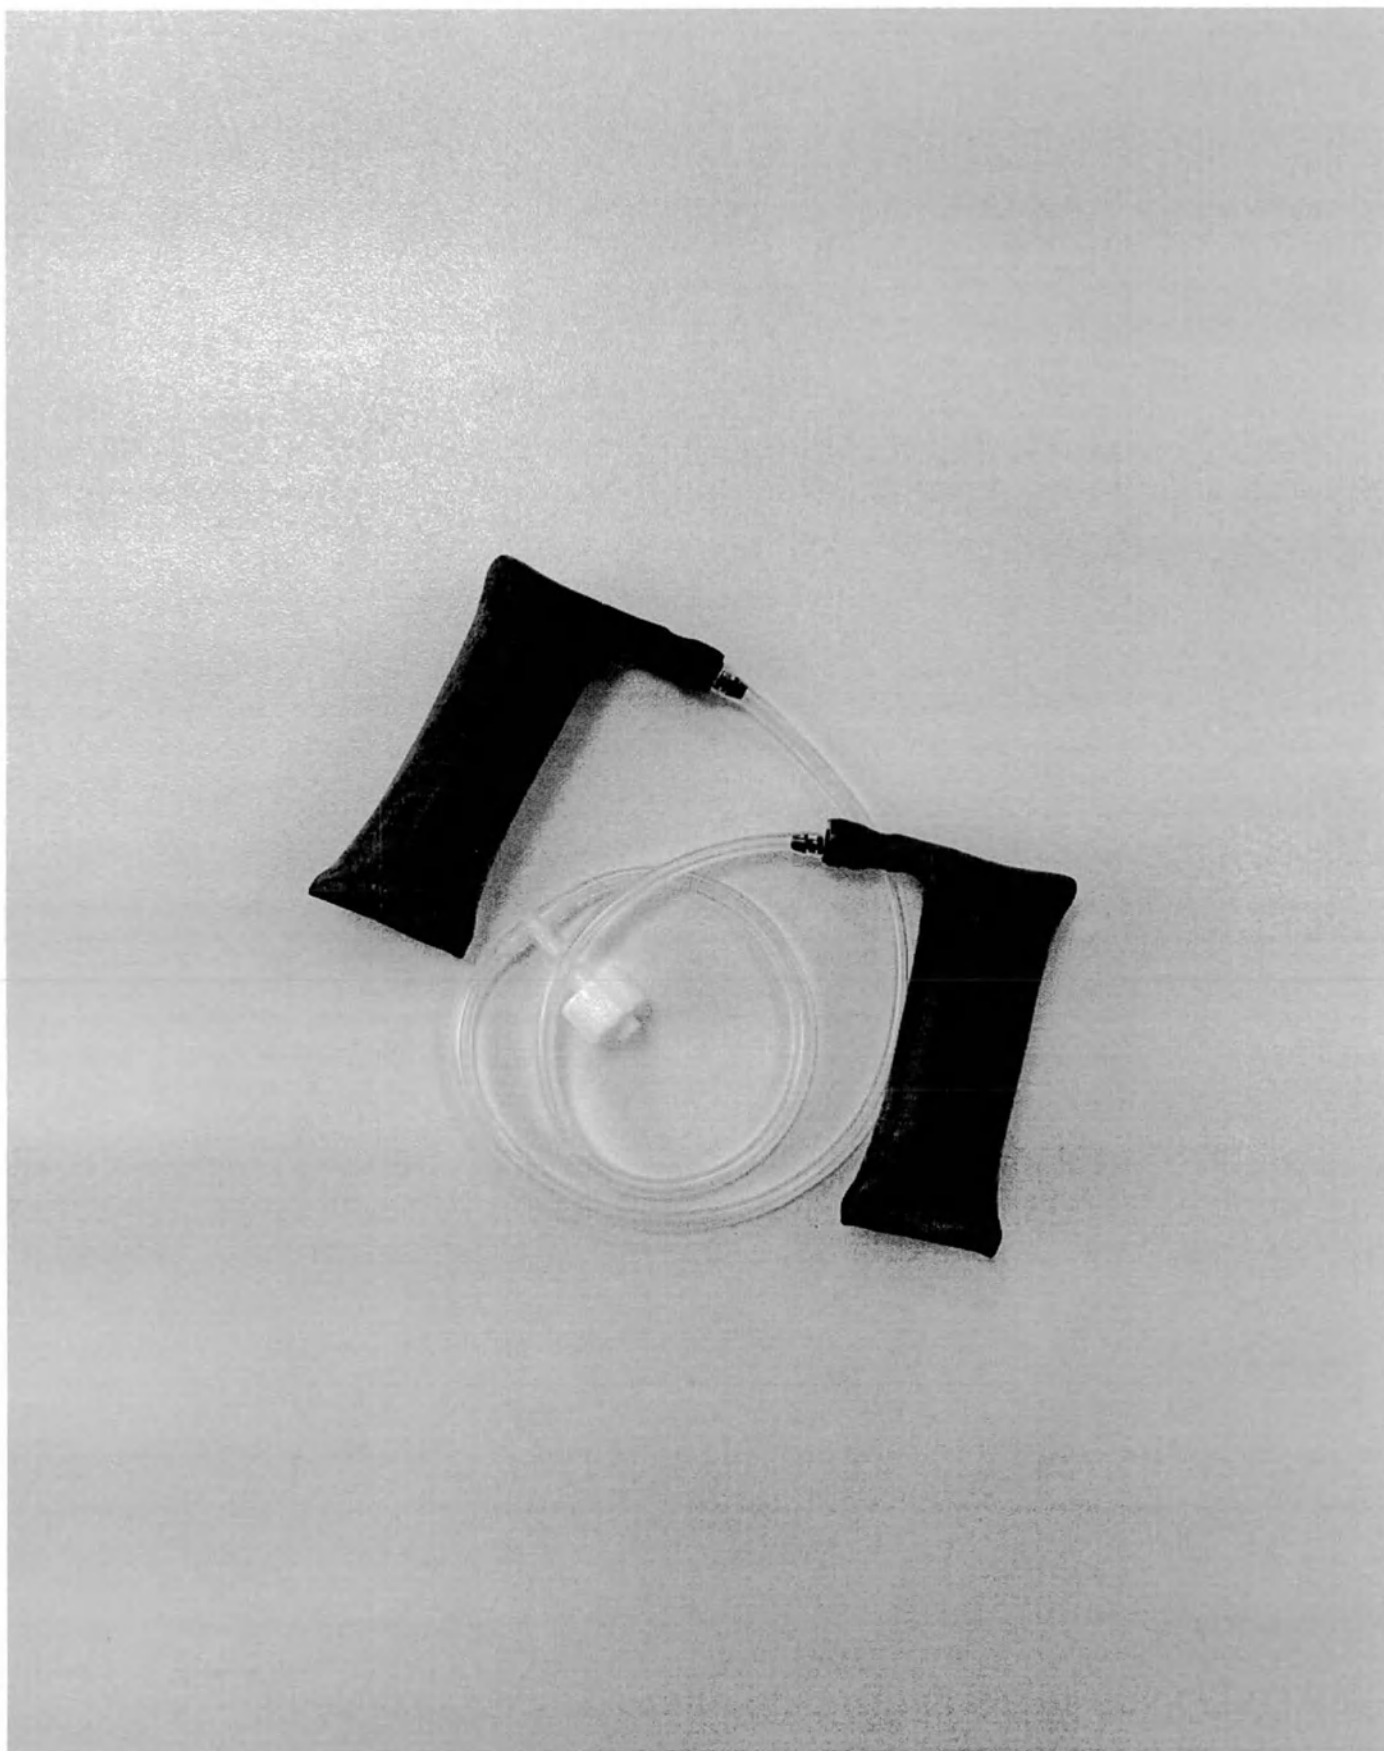


11. Торакальный датчик



12. Абдоминальный датчик

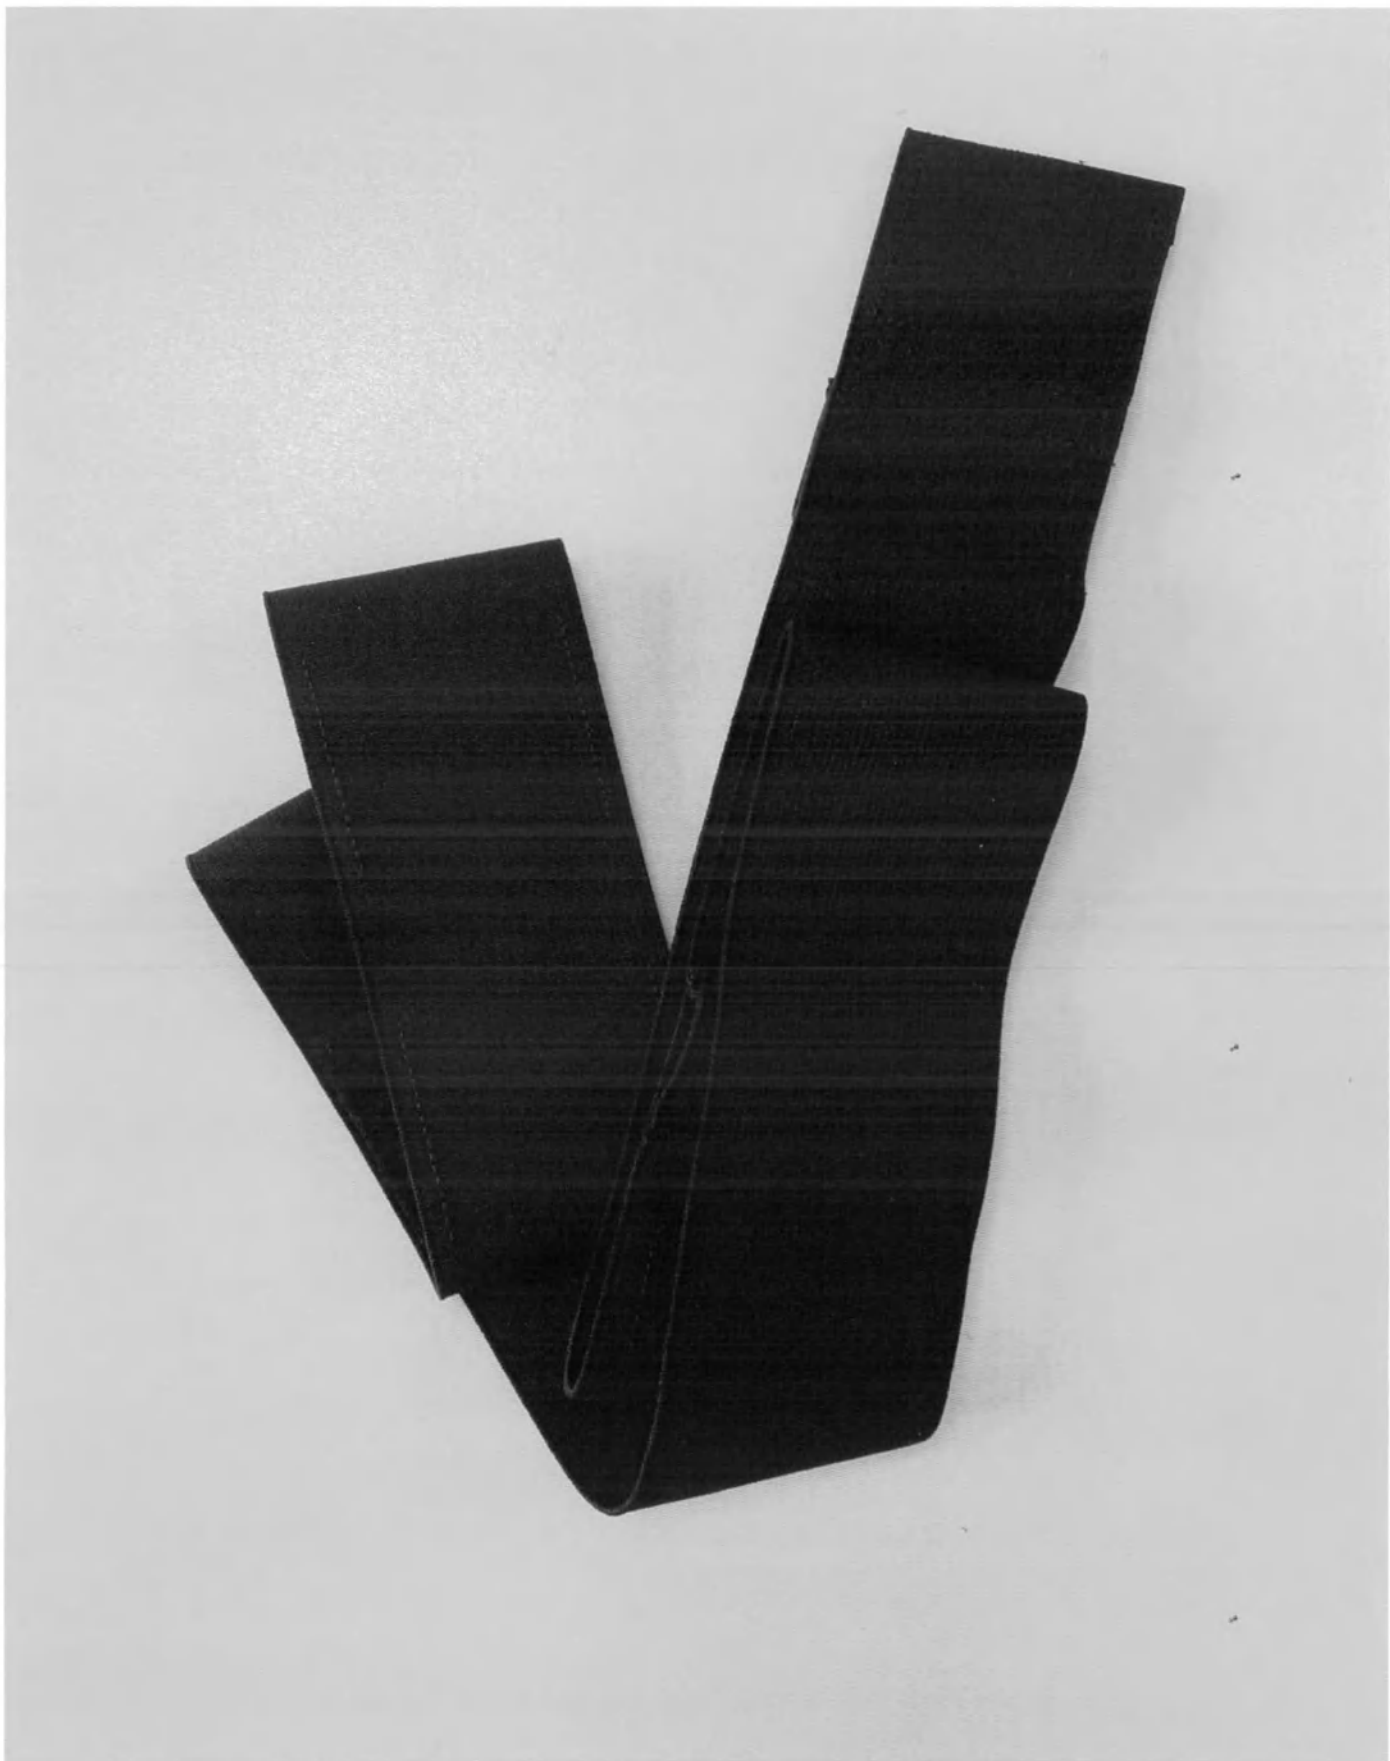


13. Ремень для переноски торакальный, гибкий, чёрный, Размер М

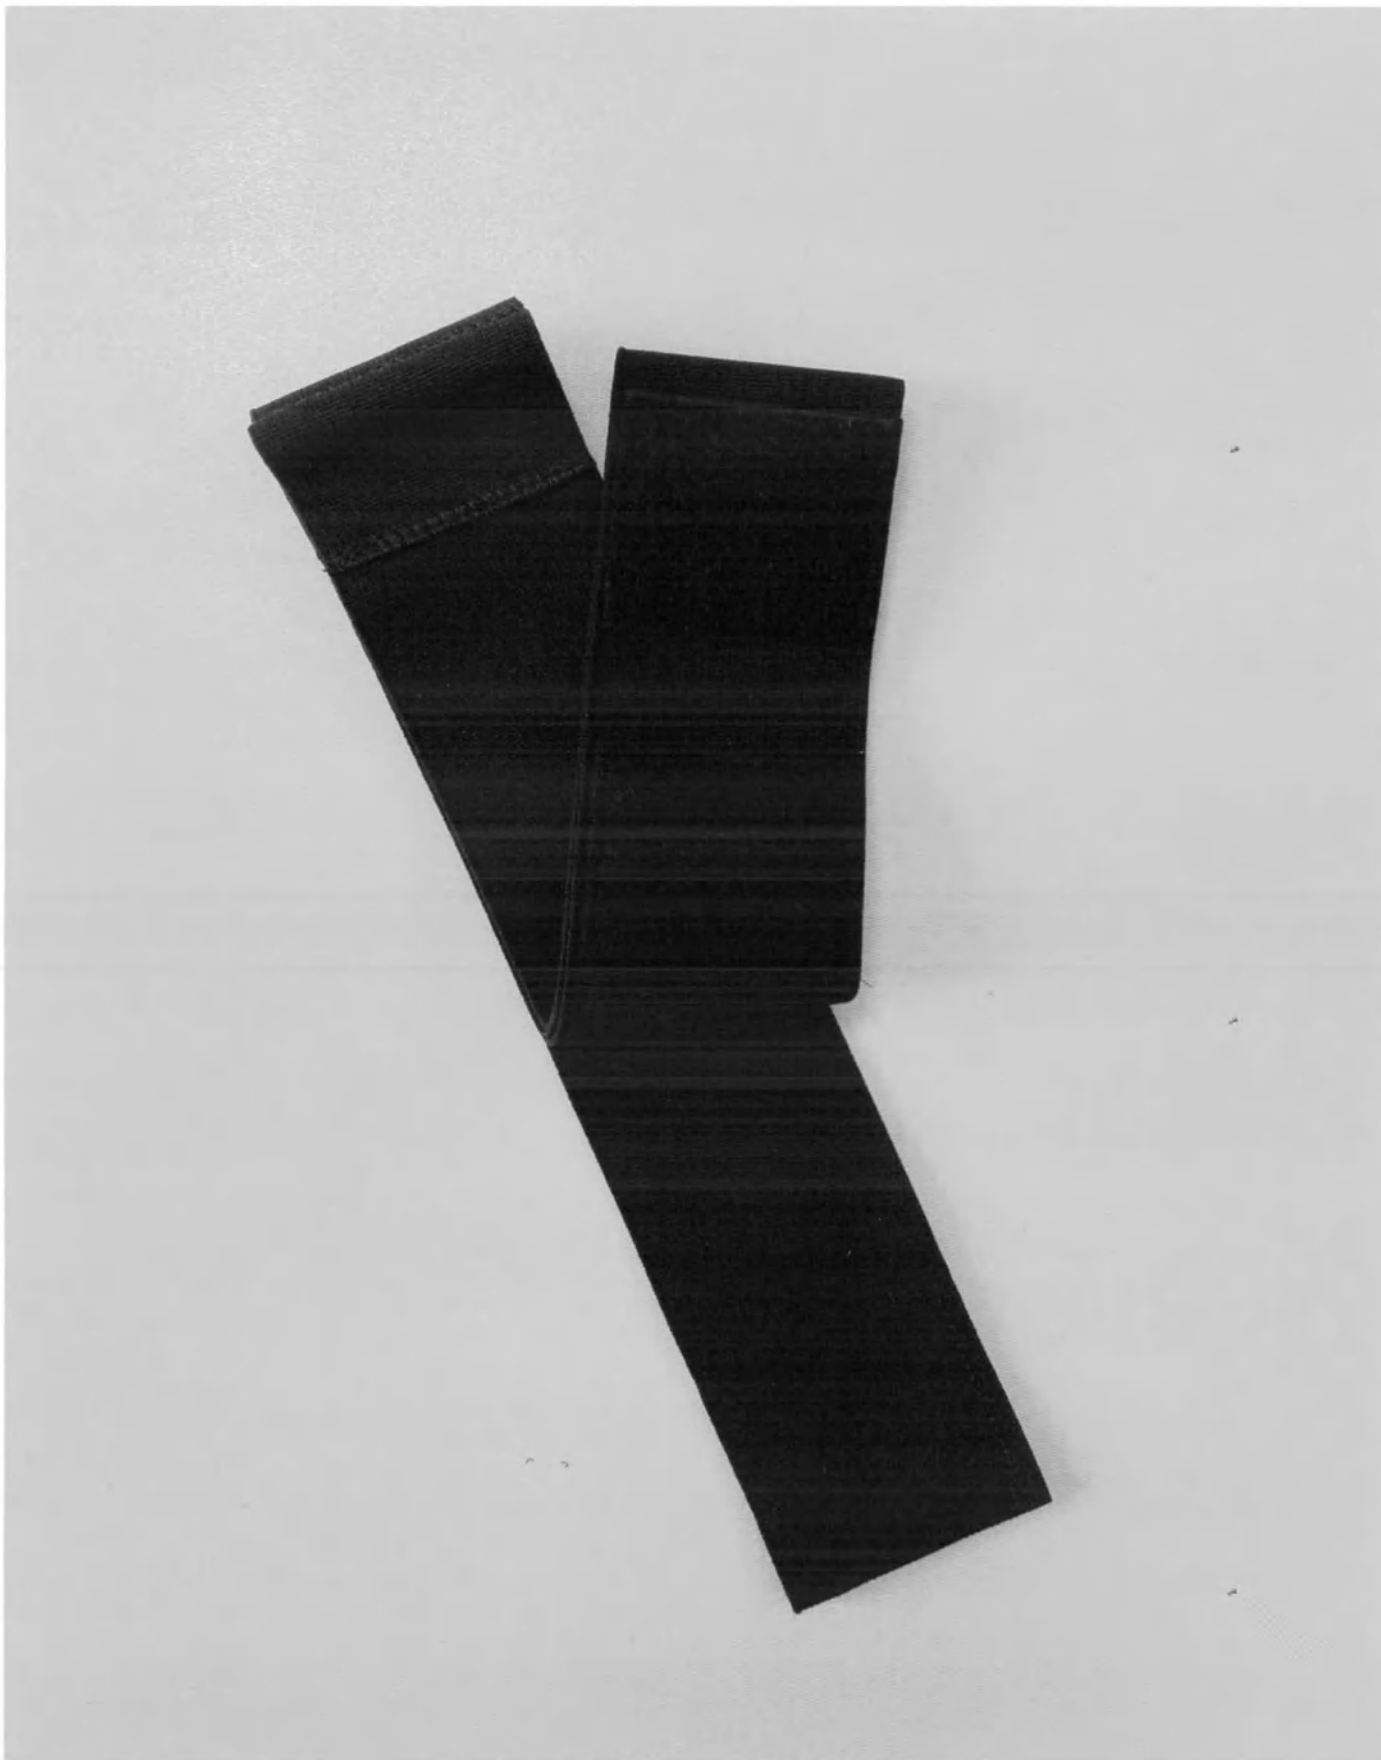


14. Ремень абдоминальный, гибкий, чёрный, Размер М




15. Набор для очистки Самоа, включая заглушку Key-Hole (1 шт.) и Luerlock уплотнительную заглушку (1 шт.)

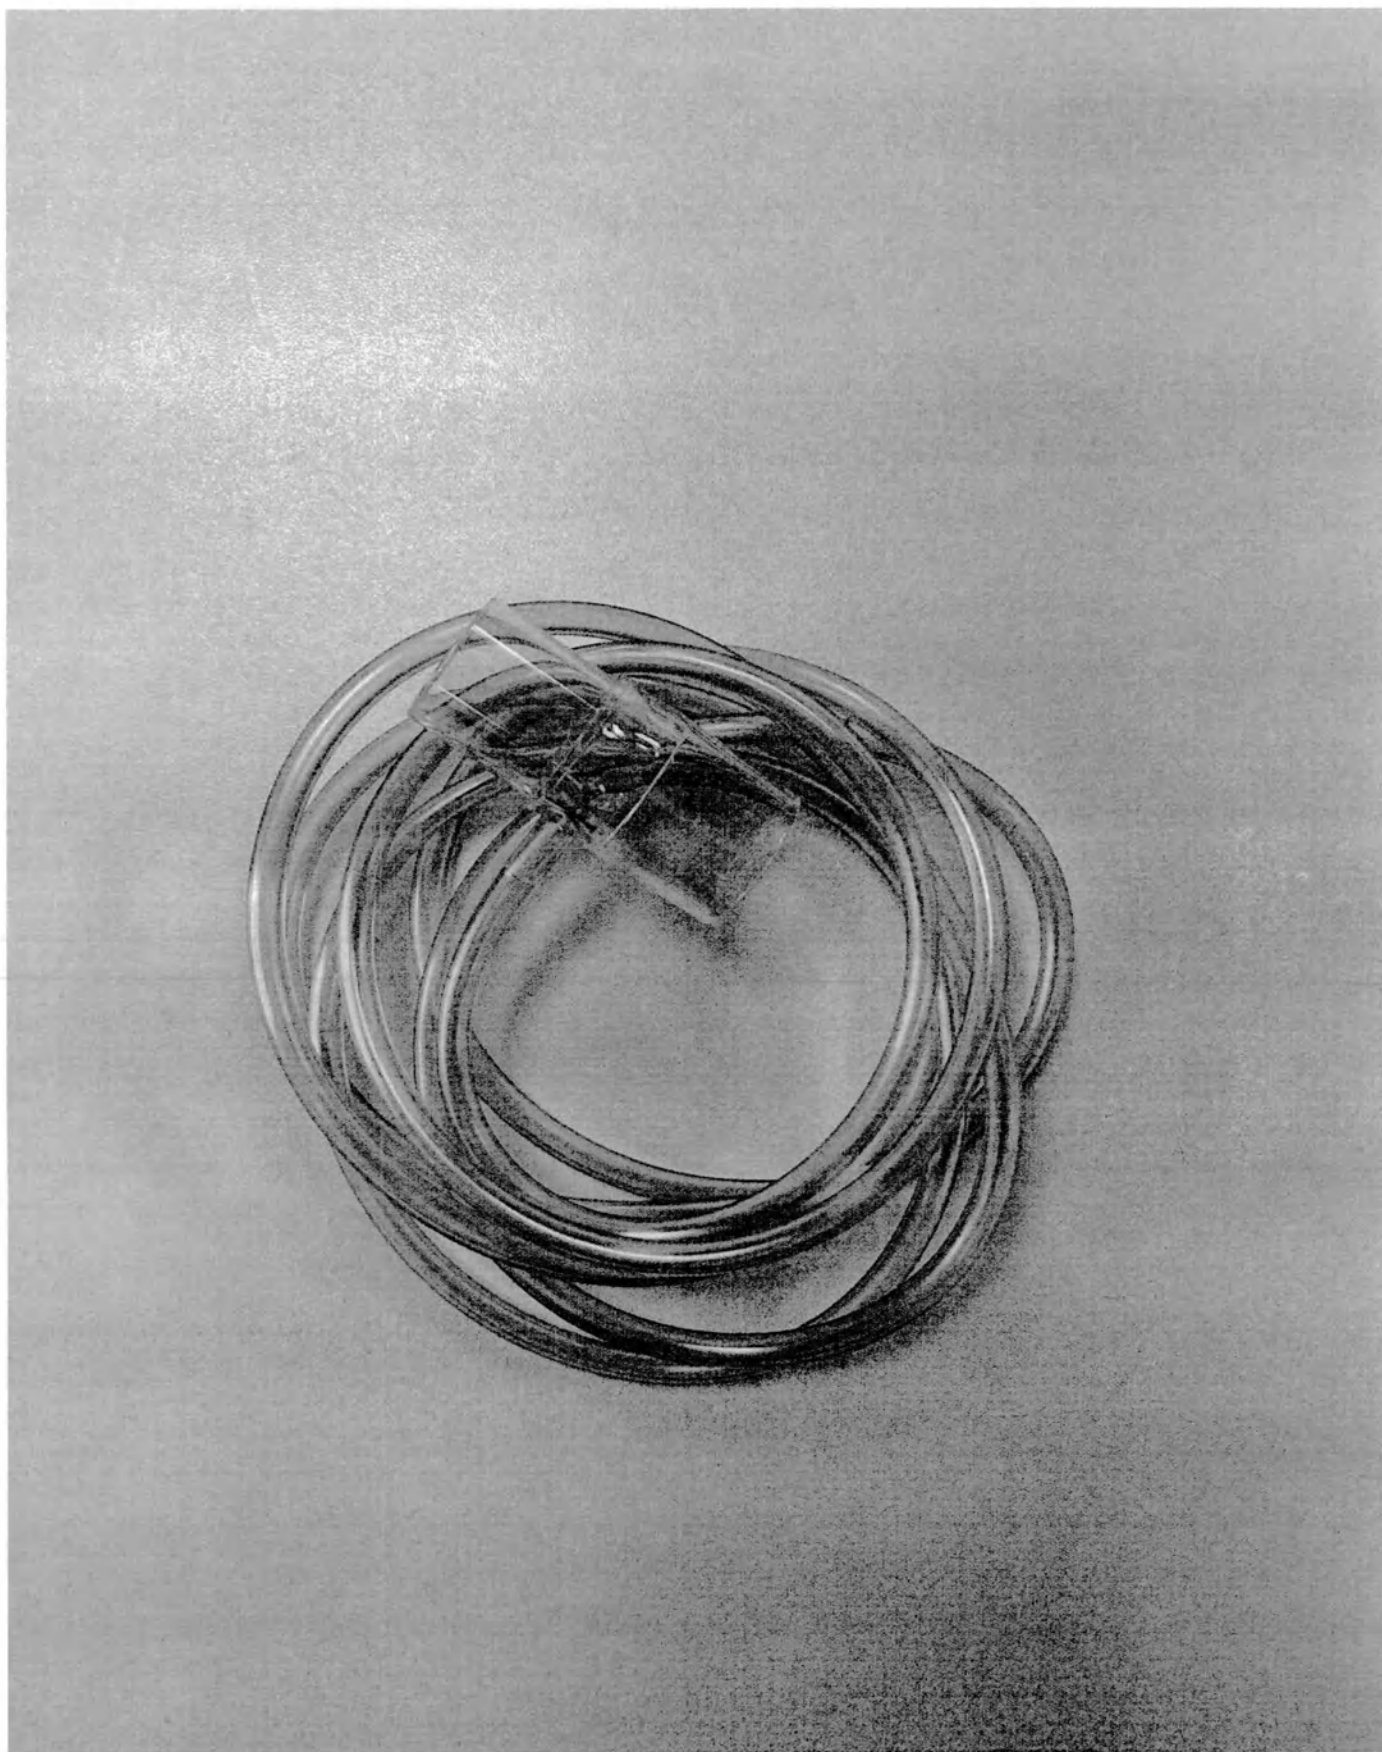


16. CPAP-адаптер, Luerlock, 200 см, одноразовый

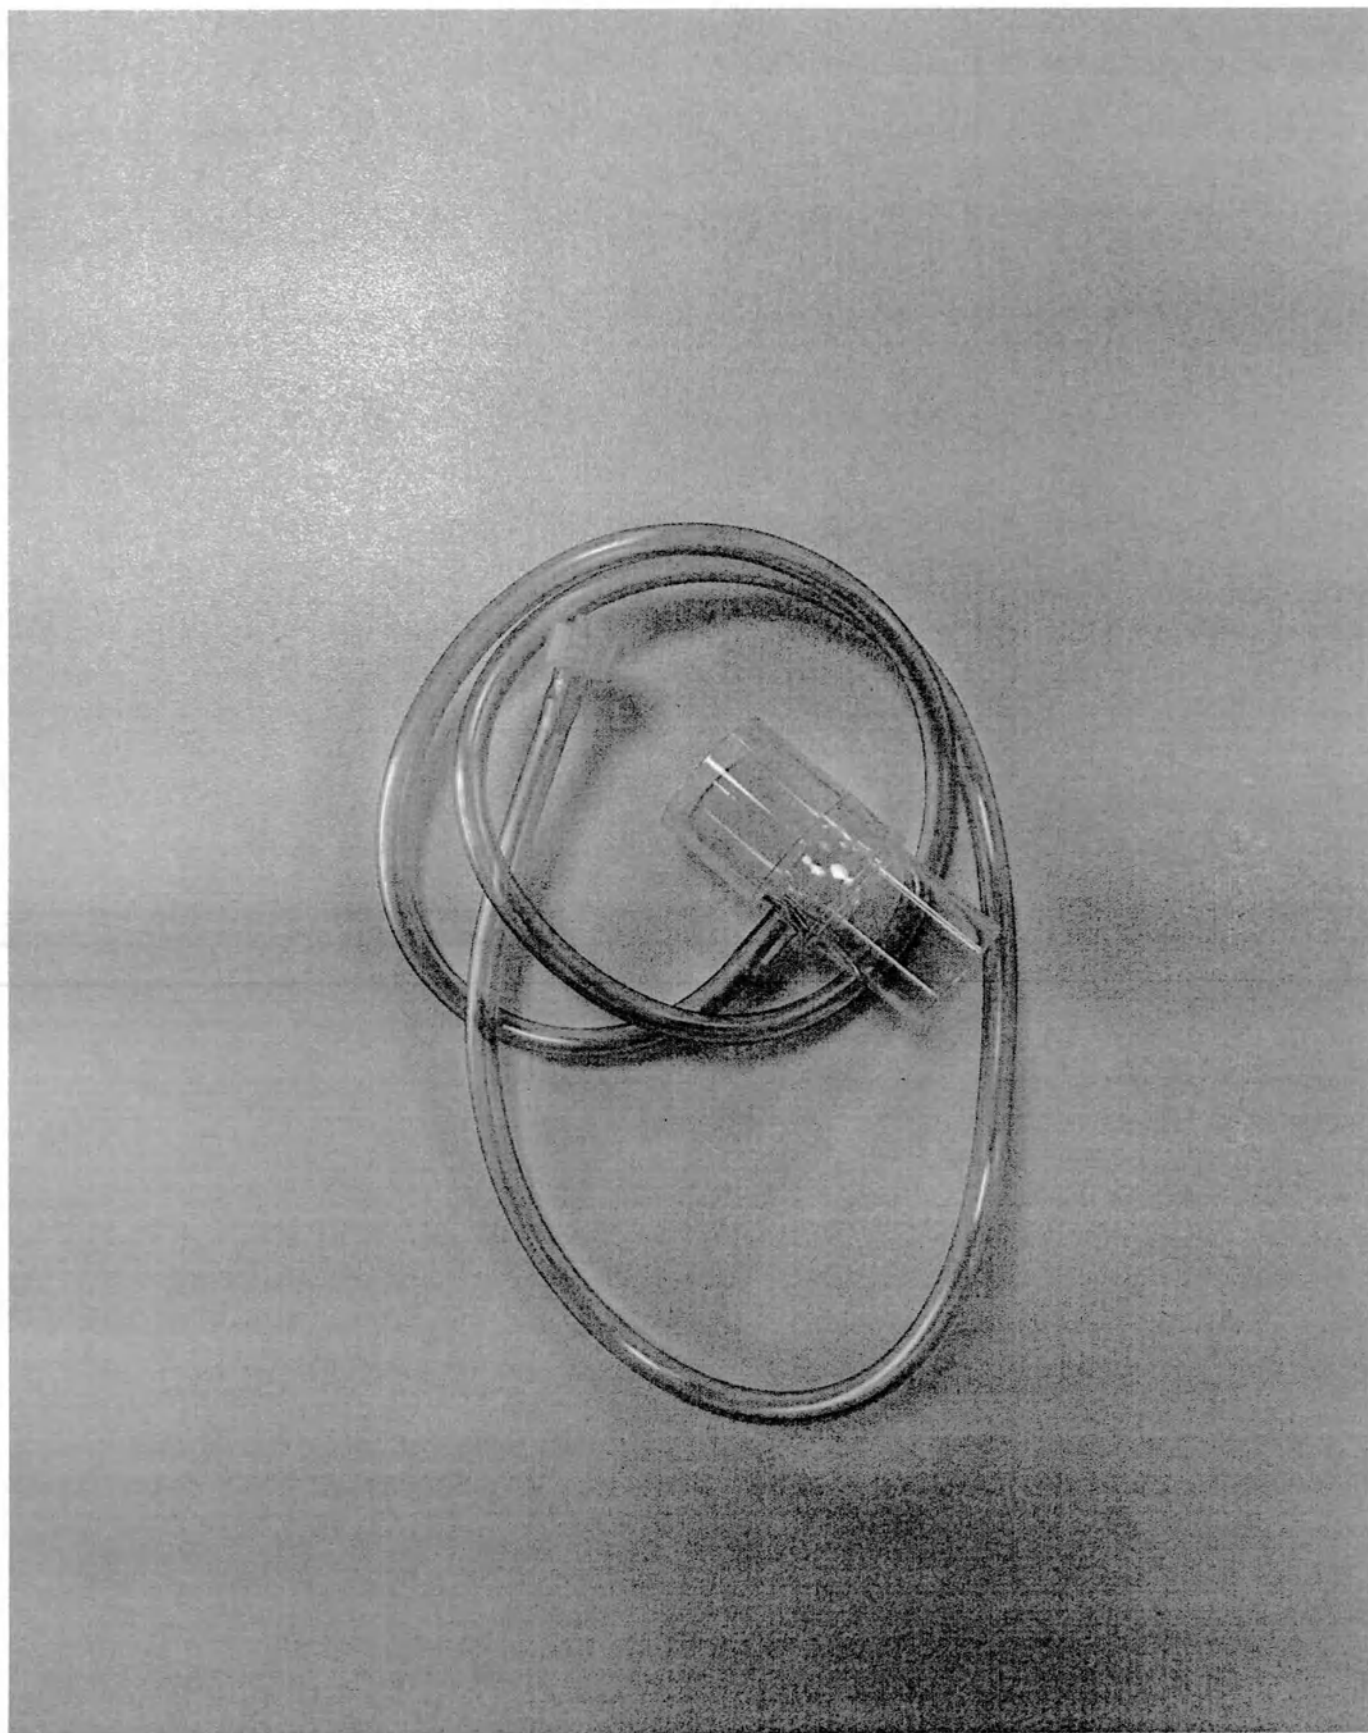


17. CPAP-адаптер, Luerlock, 80 см, одноразовый

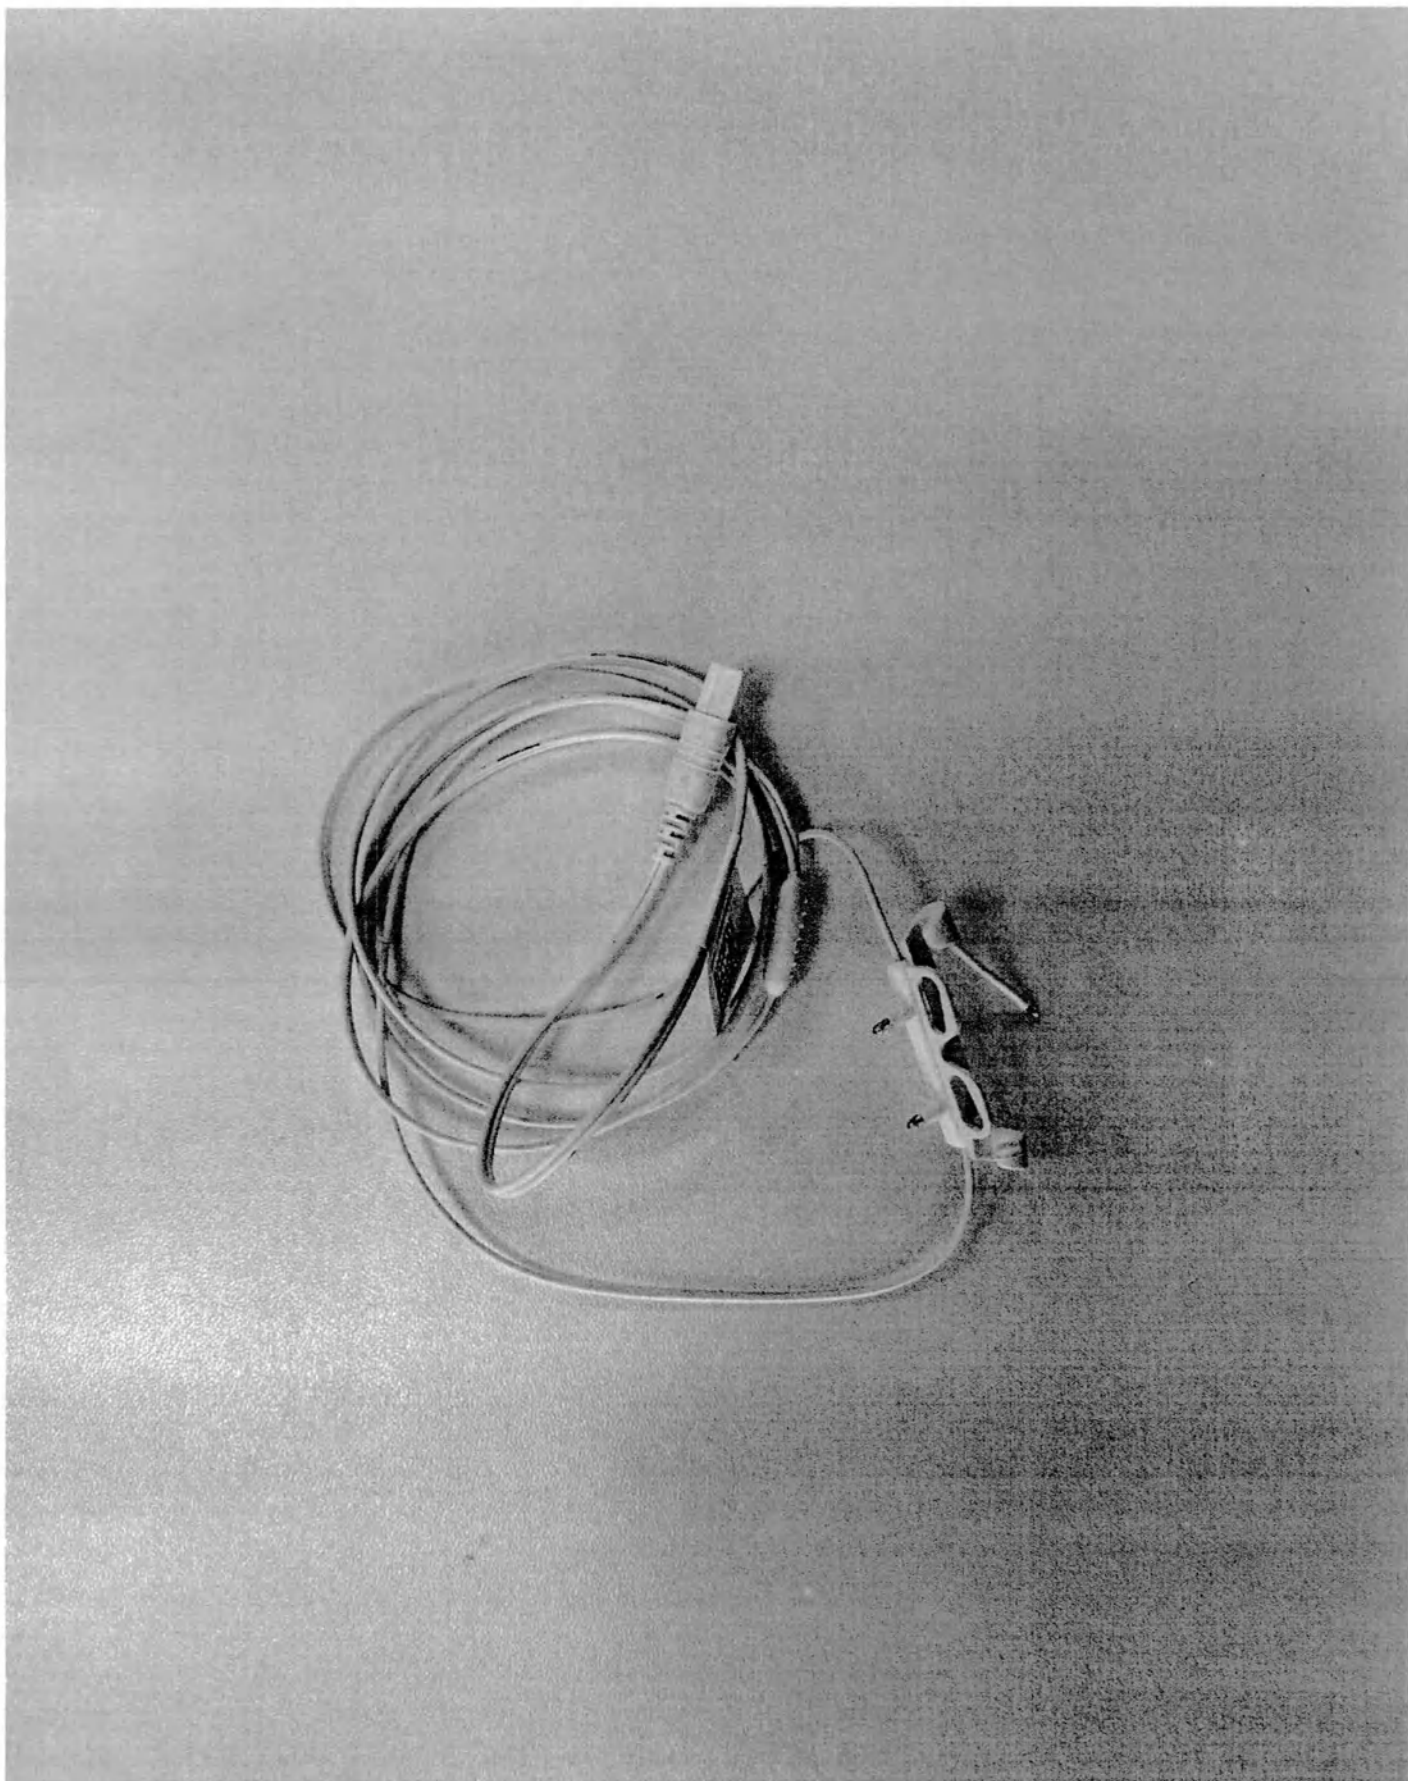


18. Термистор для Самоа

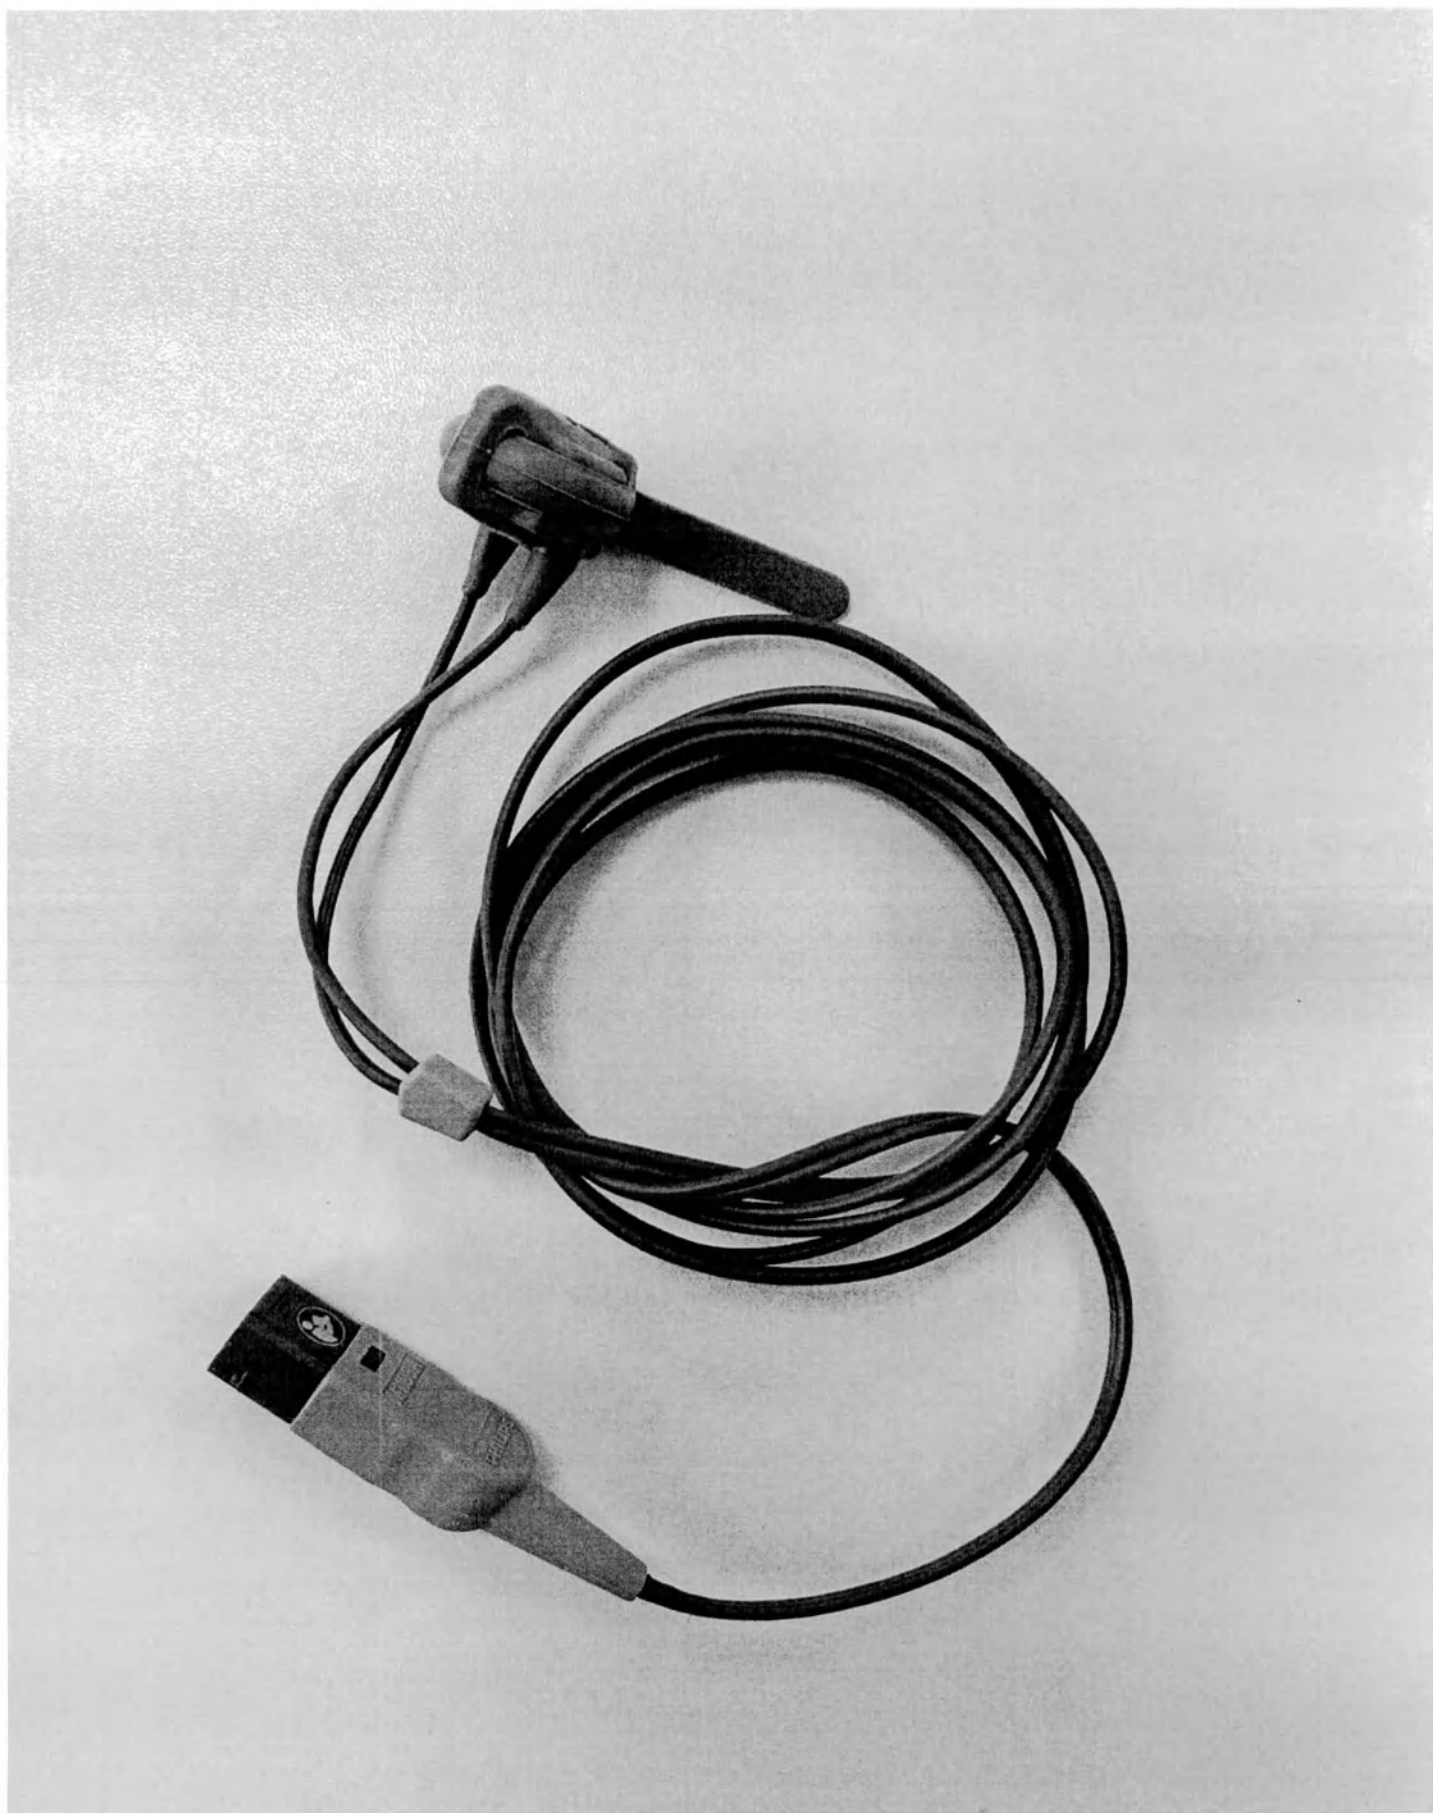


19. Детский датчик SpO₂ с Philips коннектором, дети 1 – 4 кг

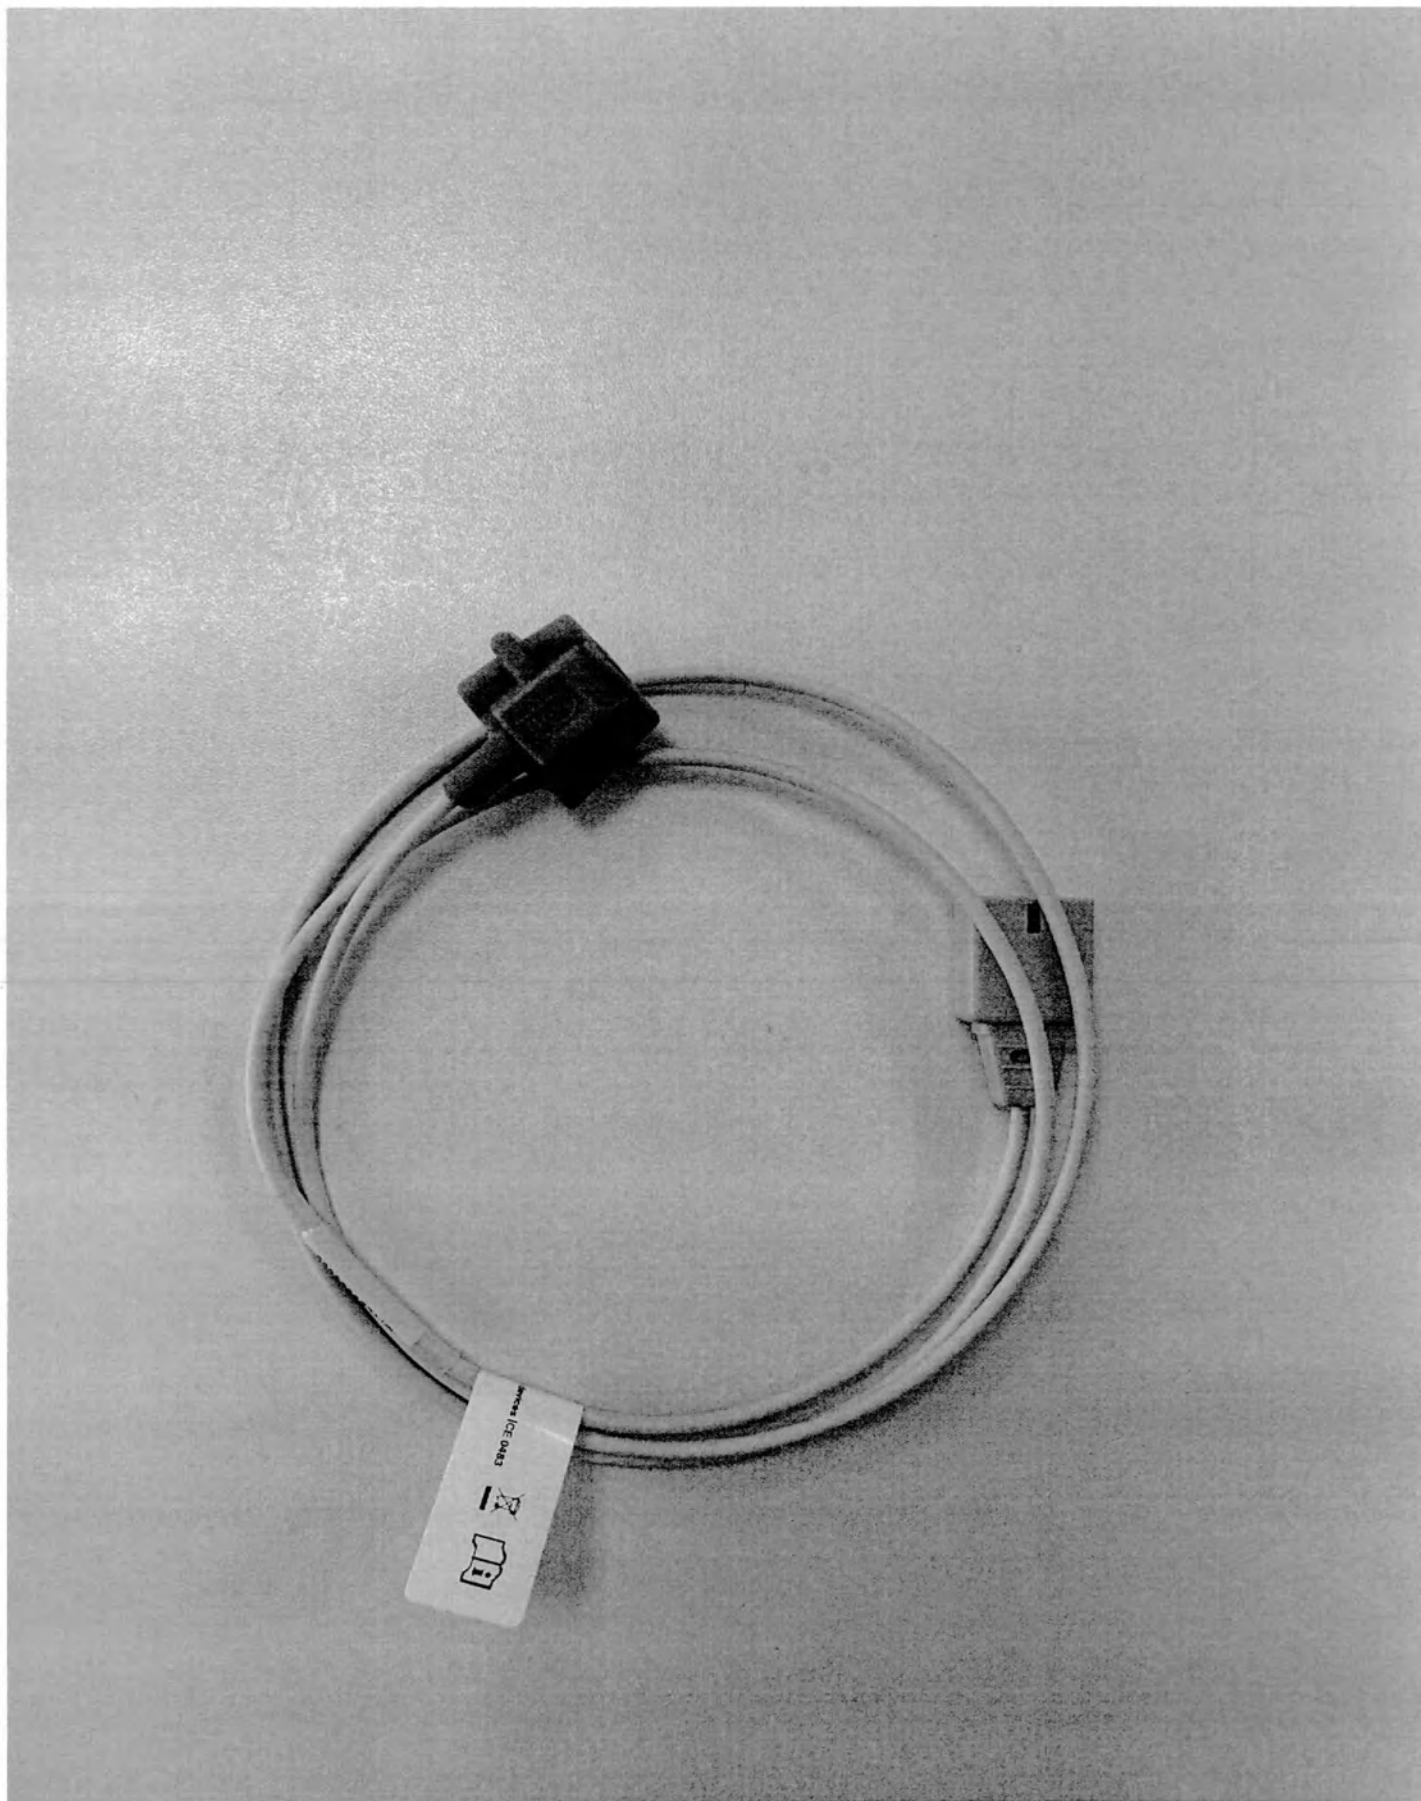

20. Детский датчик SpO₂, с DSUB коннектором, дети 4 – 40 кг

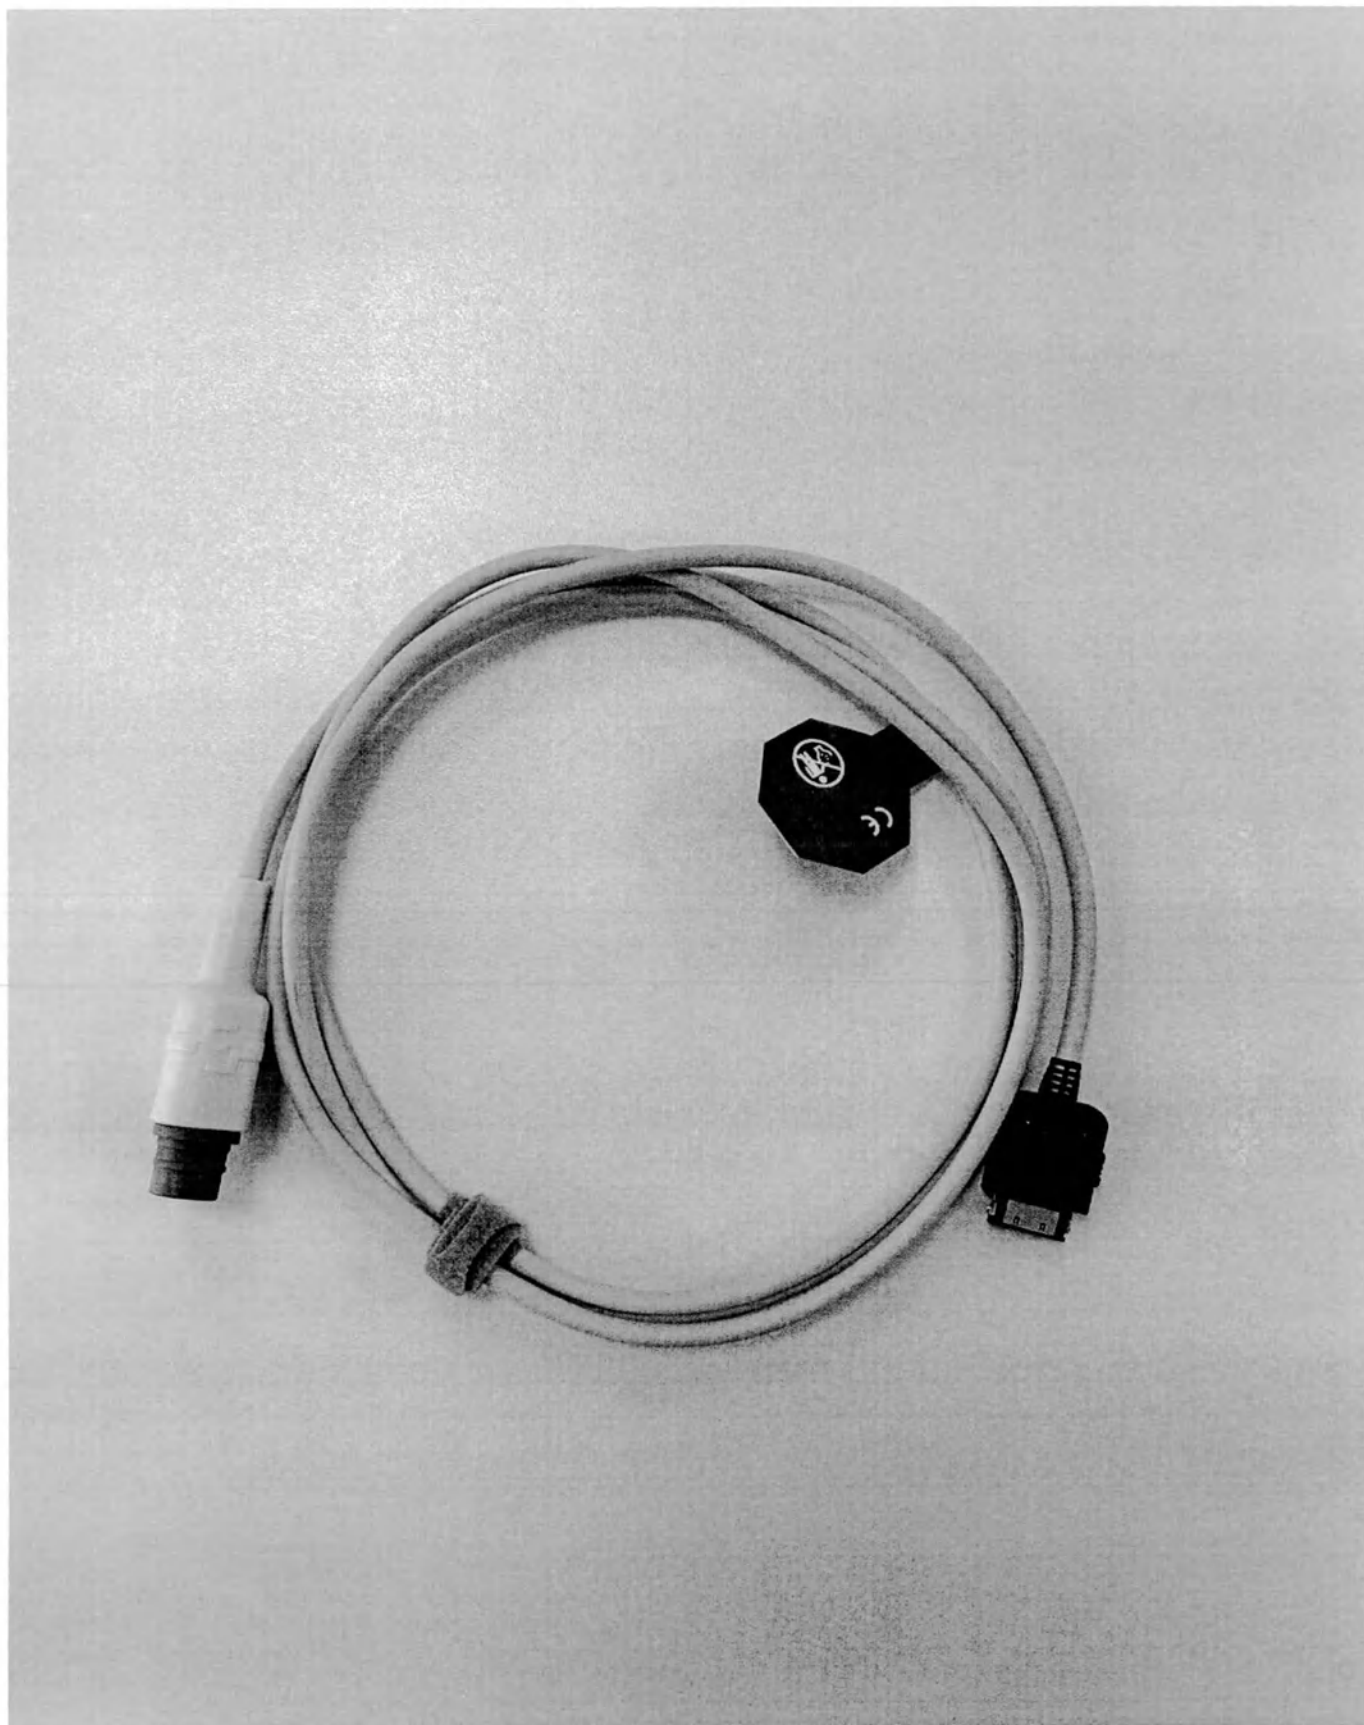


21. Удлинитель Hirose-Philips для аппарата и датчика SpO₂, для детей

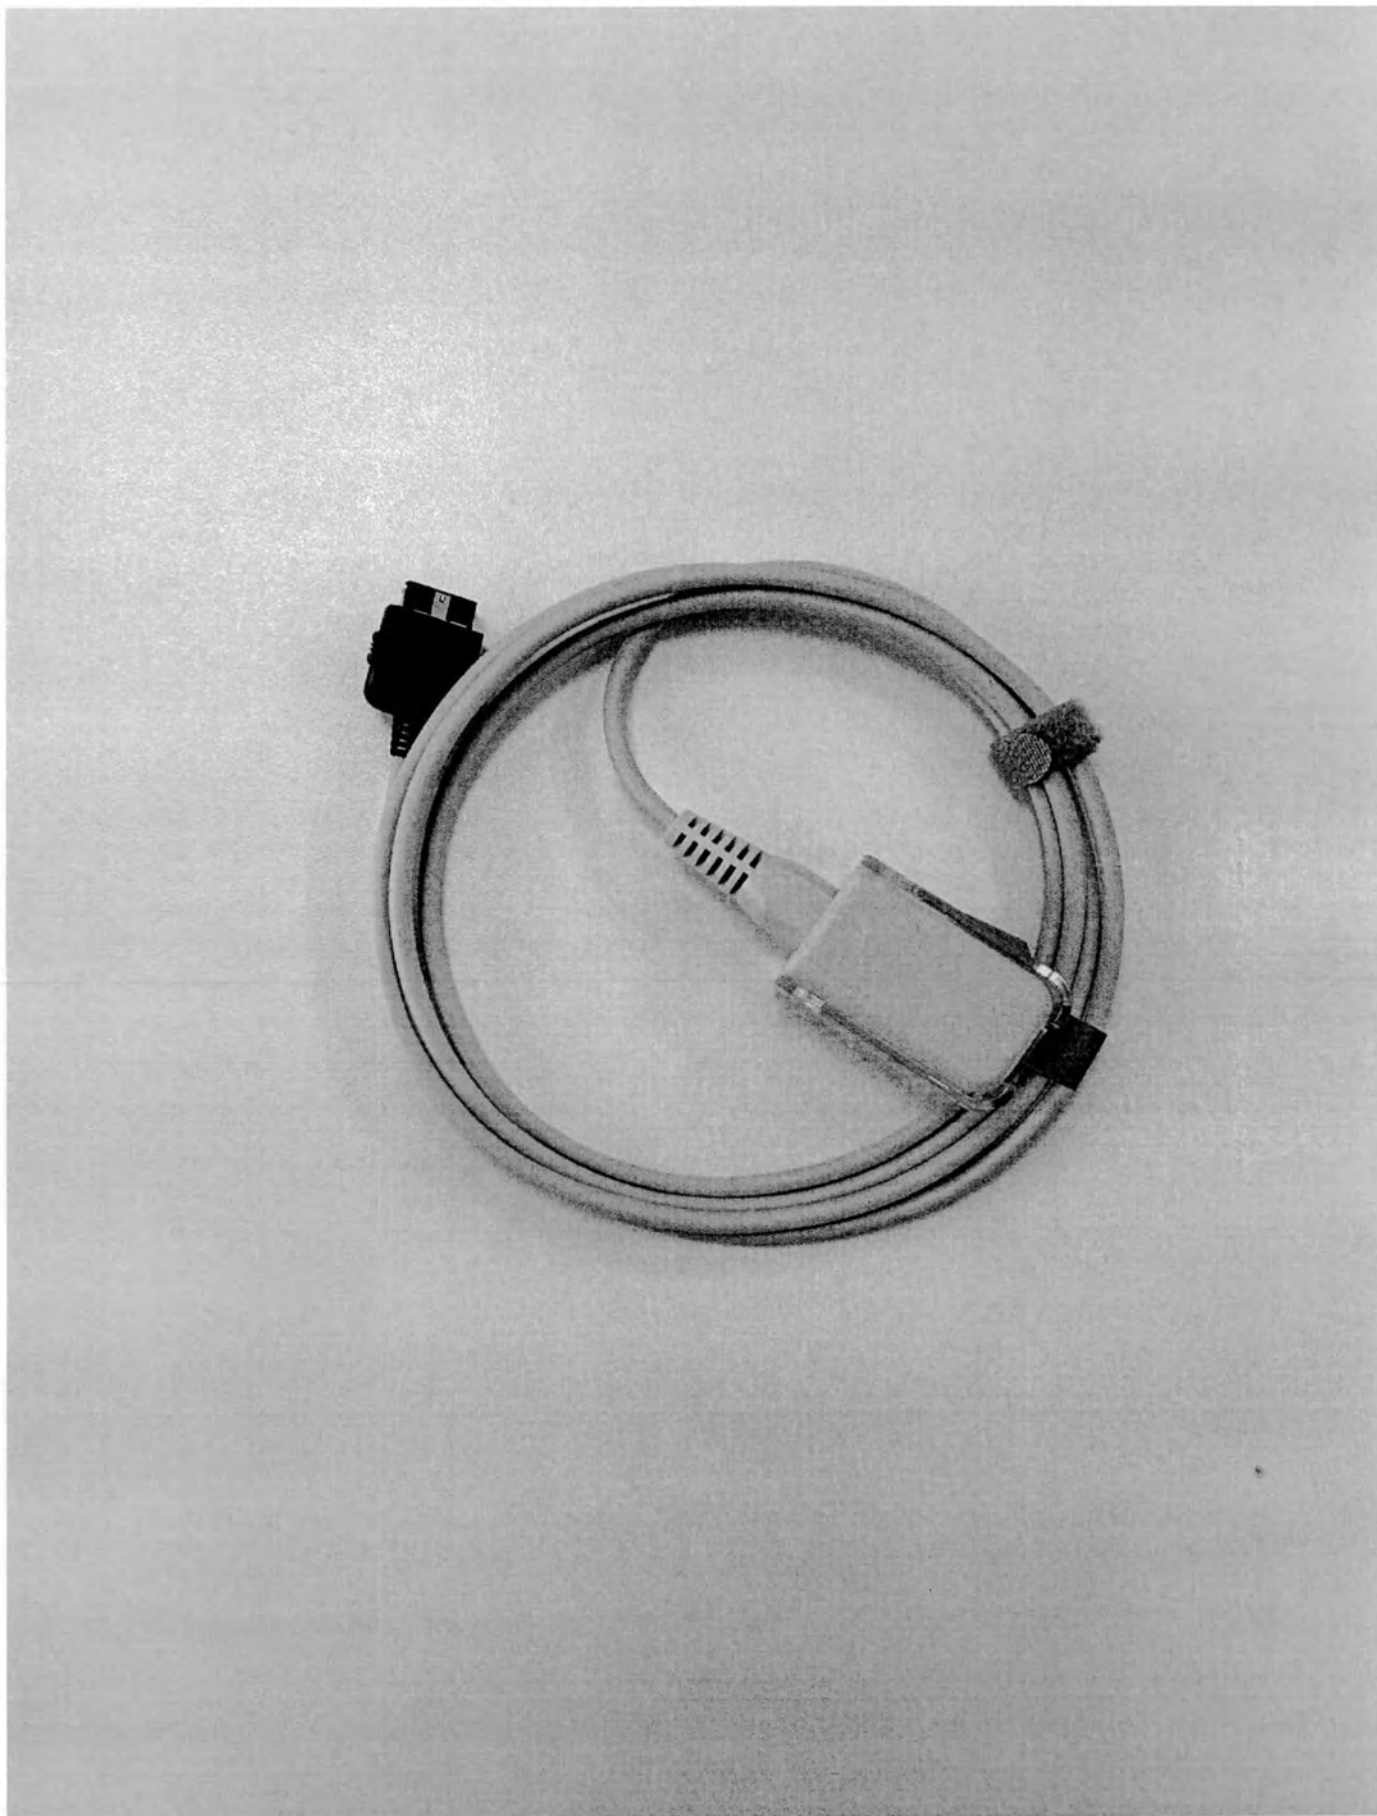


22. Удлинитель Hirose-DSUB, для аппарата и датчика SpO₂, для детей




23. Ремень для переноски торакальный, гибкий, синий, Размер S

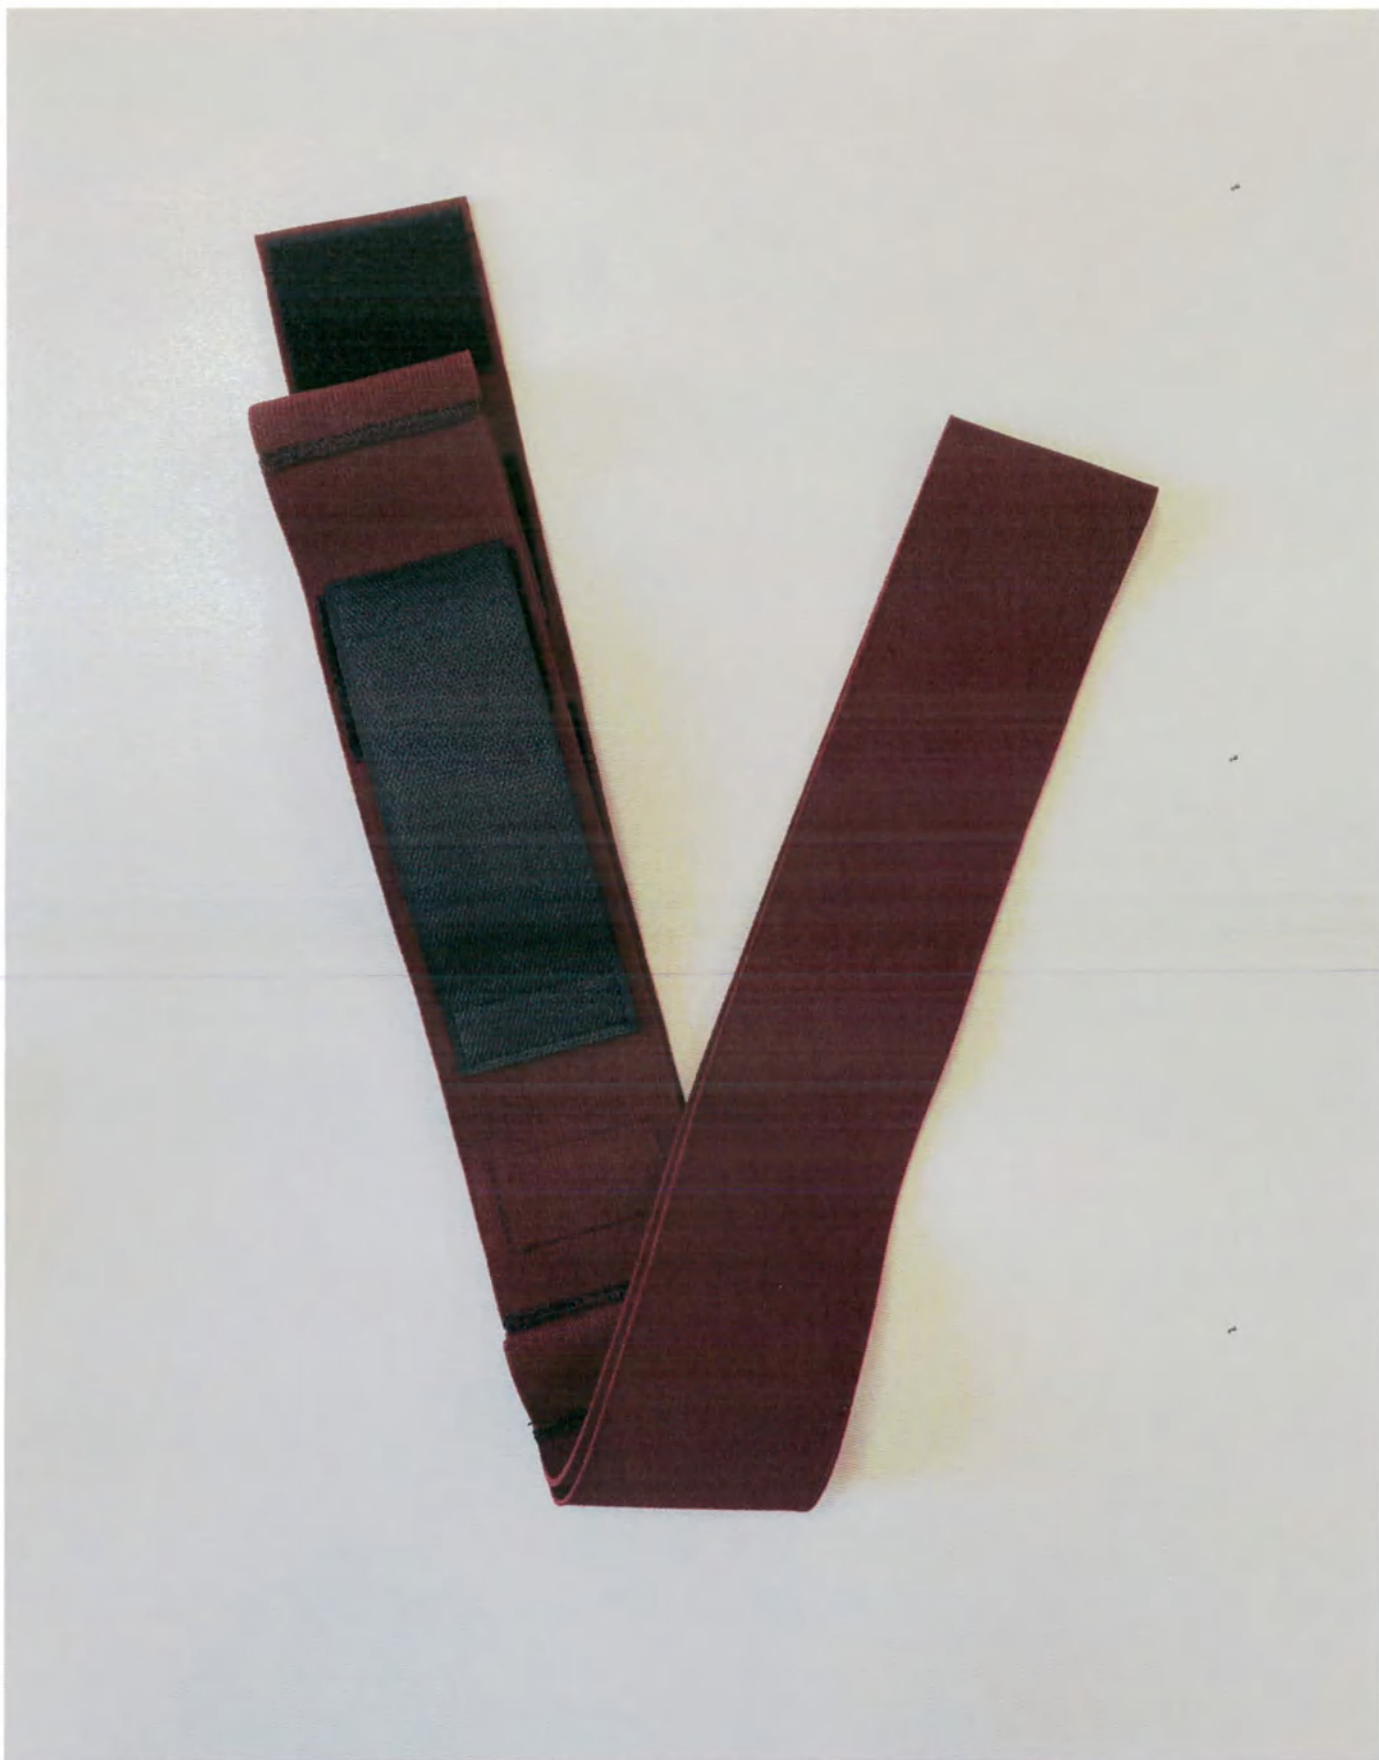


24. Ремень для переноски торакальный, гибкий, красный, Размер L

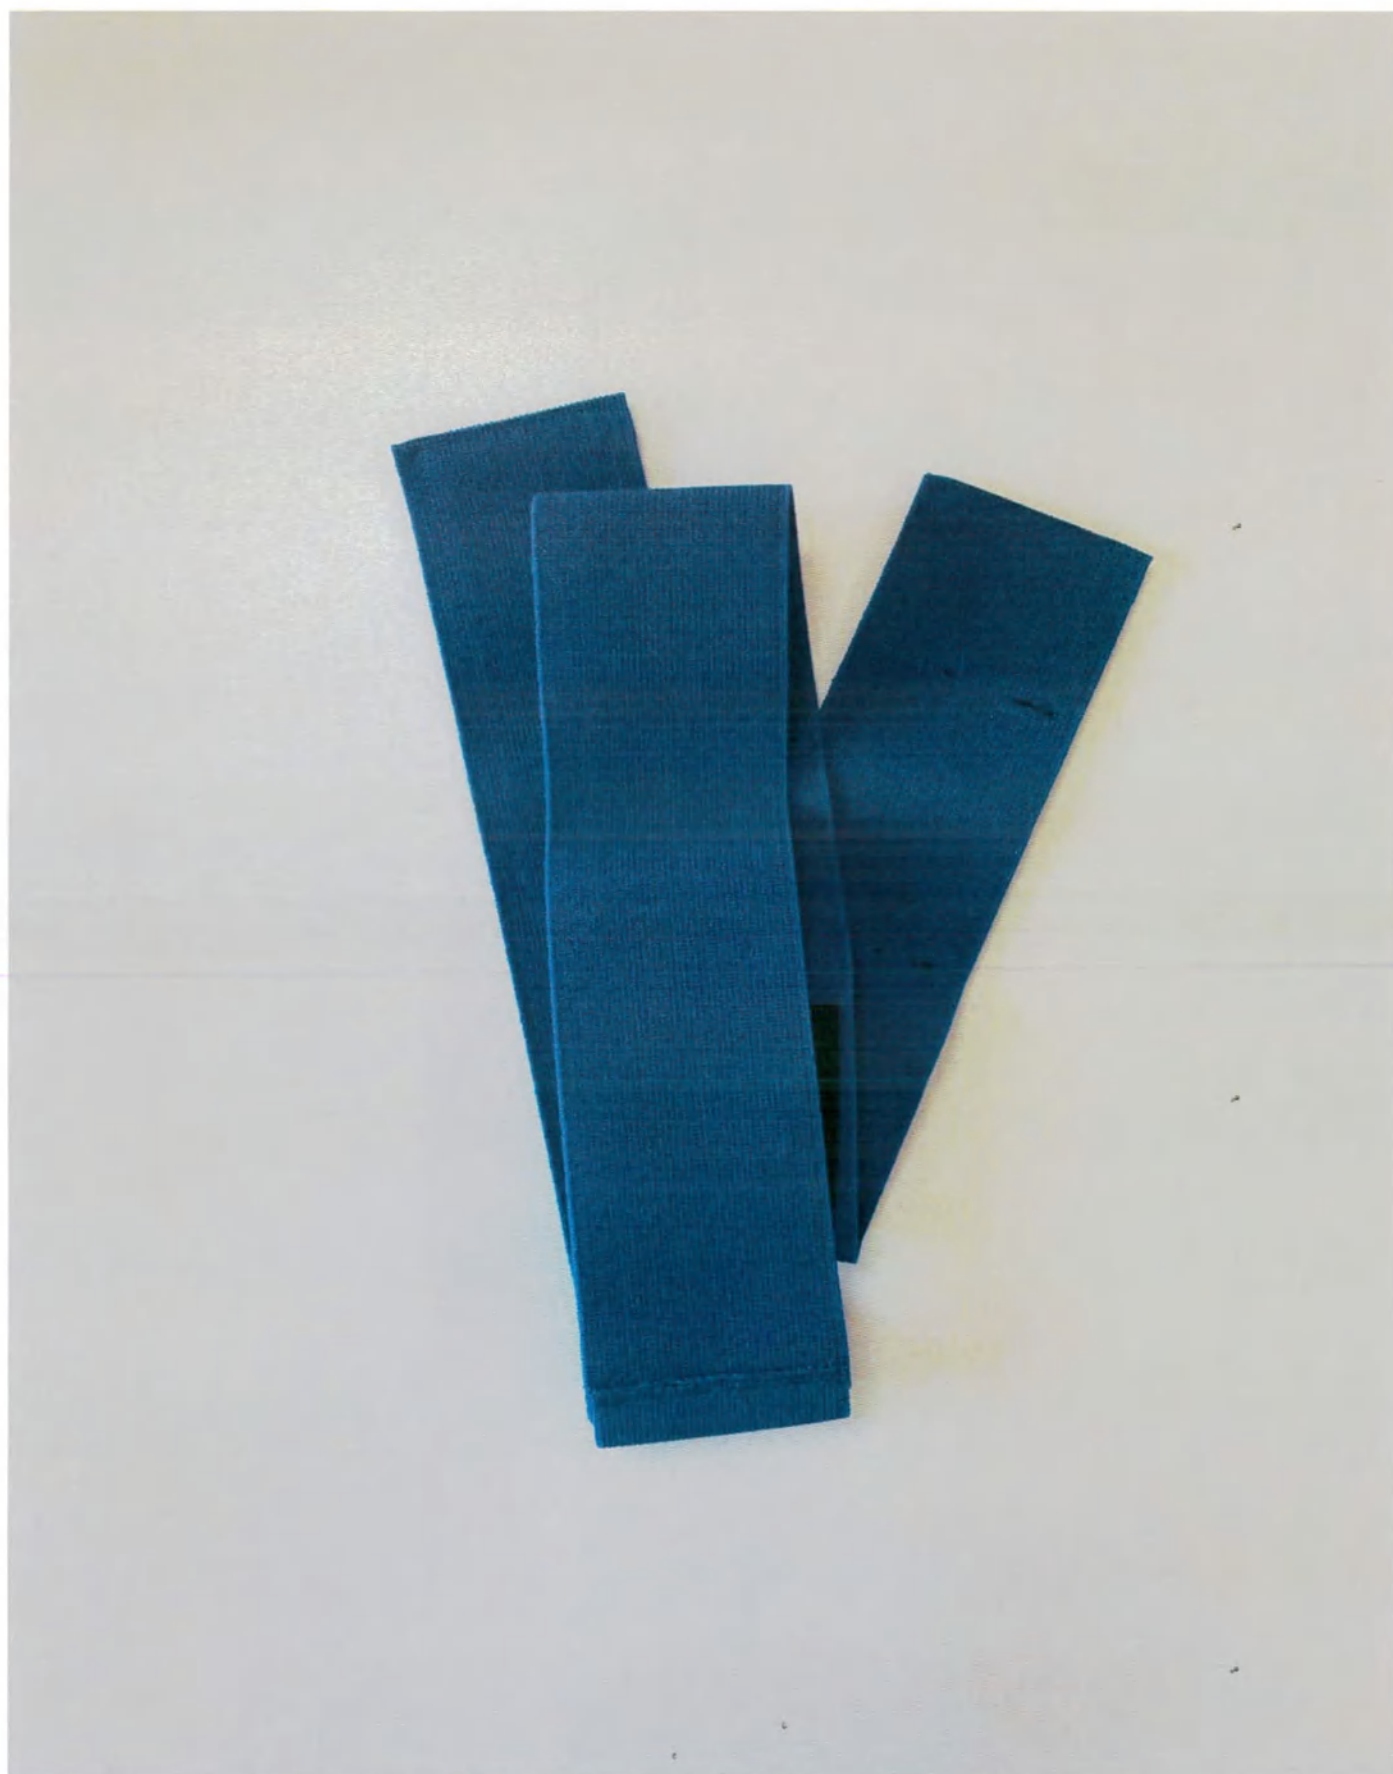

25. Ремень абдоминальный, гибкий, синий, Размер S

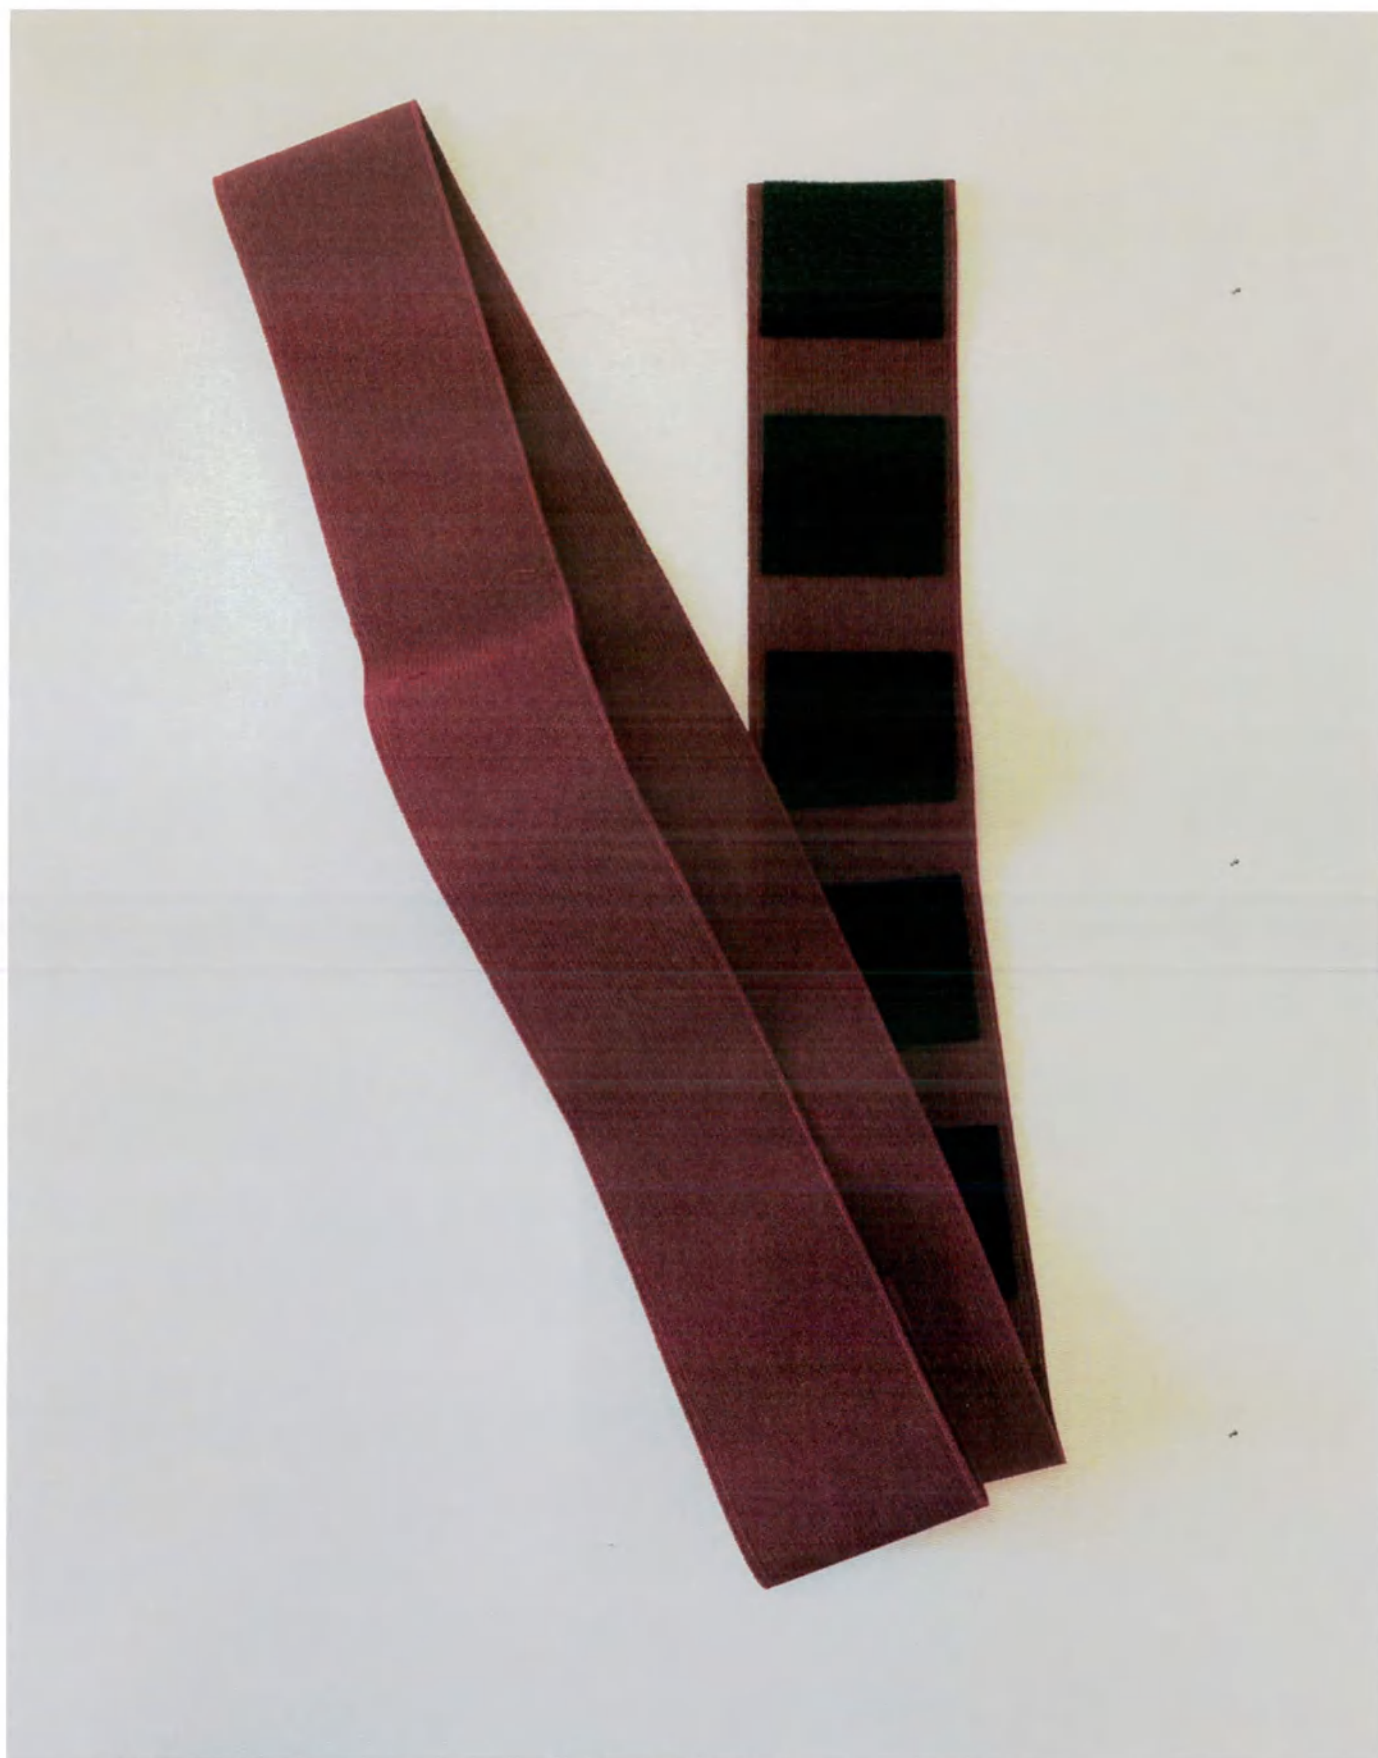

26. Ремень абдоминальный, гибкий, красный, Размер L

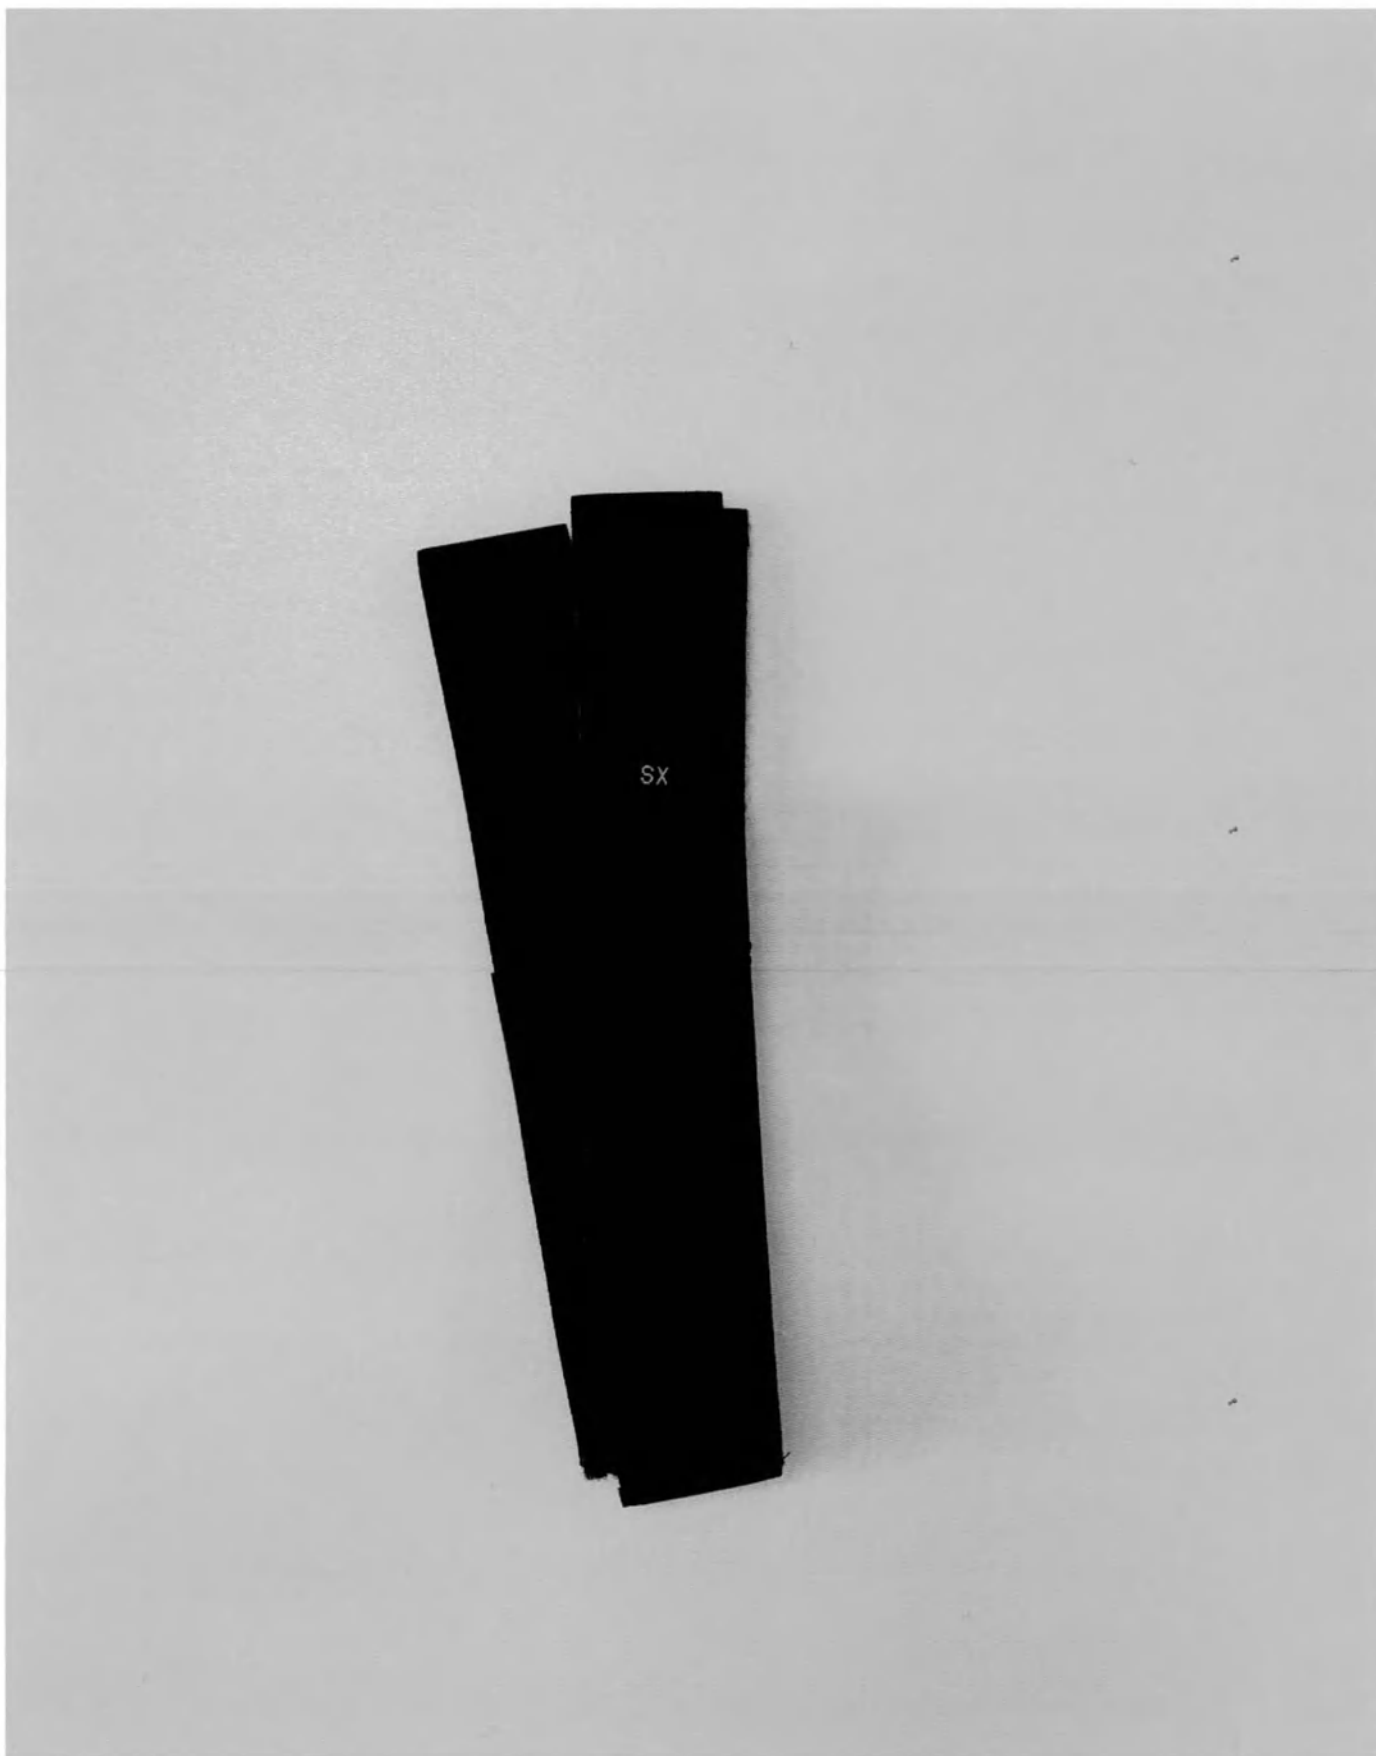

27. Торакальный ремень, размер XS



28. Торакальный ремень, размер XXS



29. Торакальный ремень, размер XXXS




30. Абдоминальный ремень, размер XS




31. Абдоминальный ремень, размер XXS




32. Абдоминальный ремень, размер XXXS

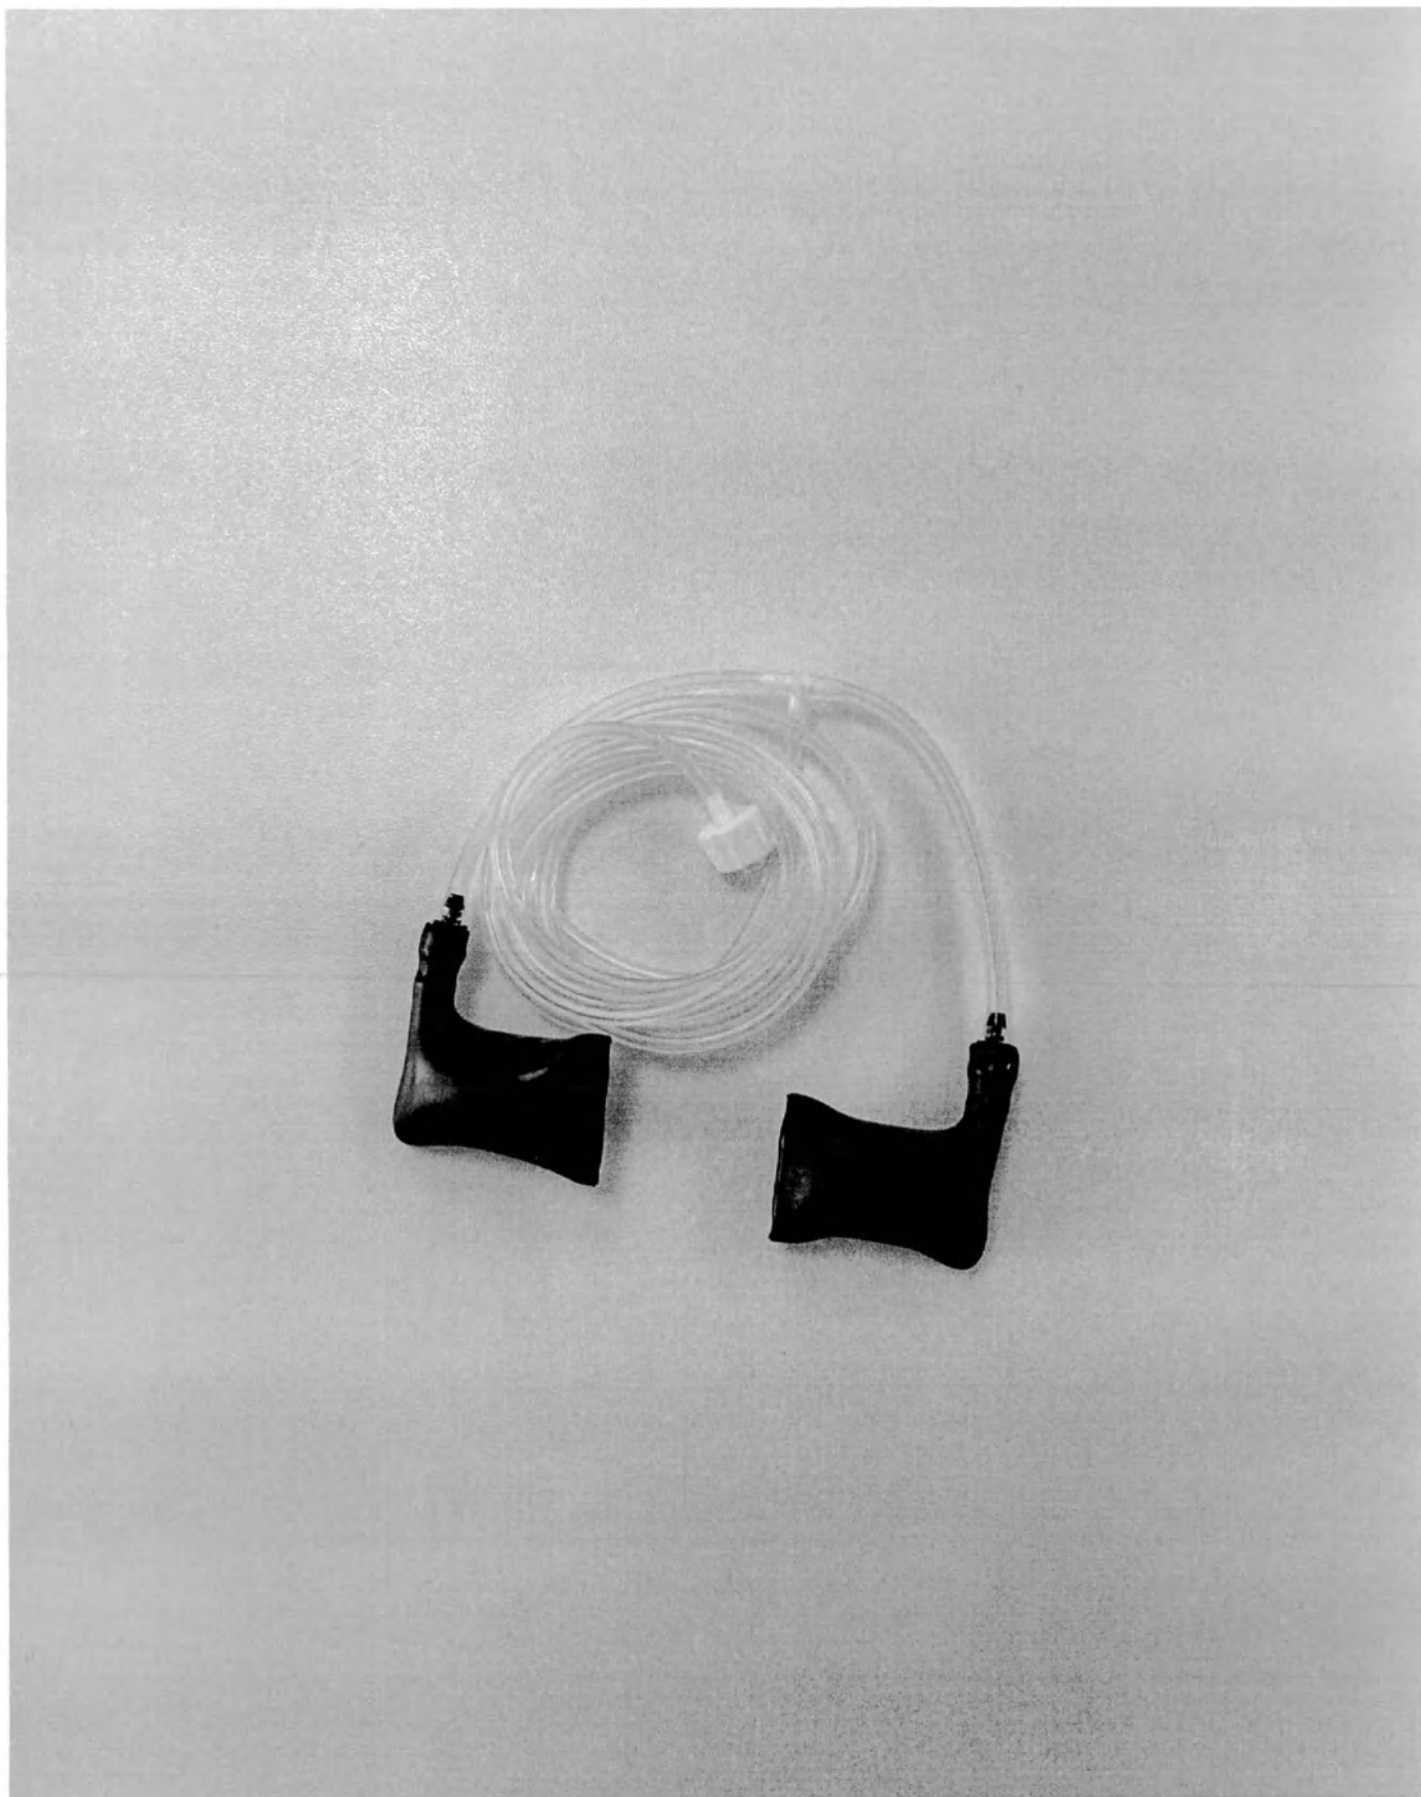

33. Торакальный датчик для детей

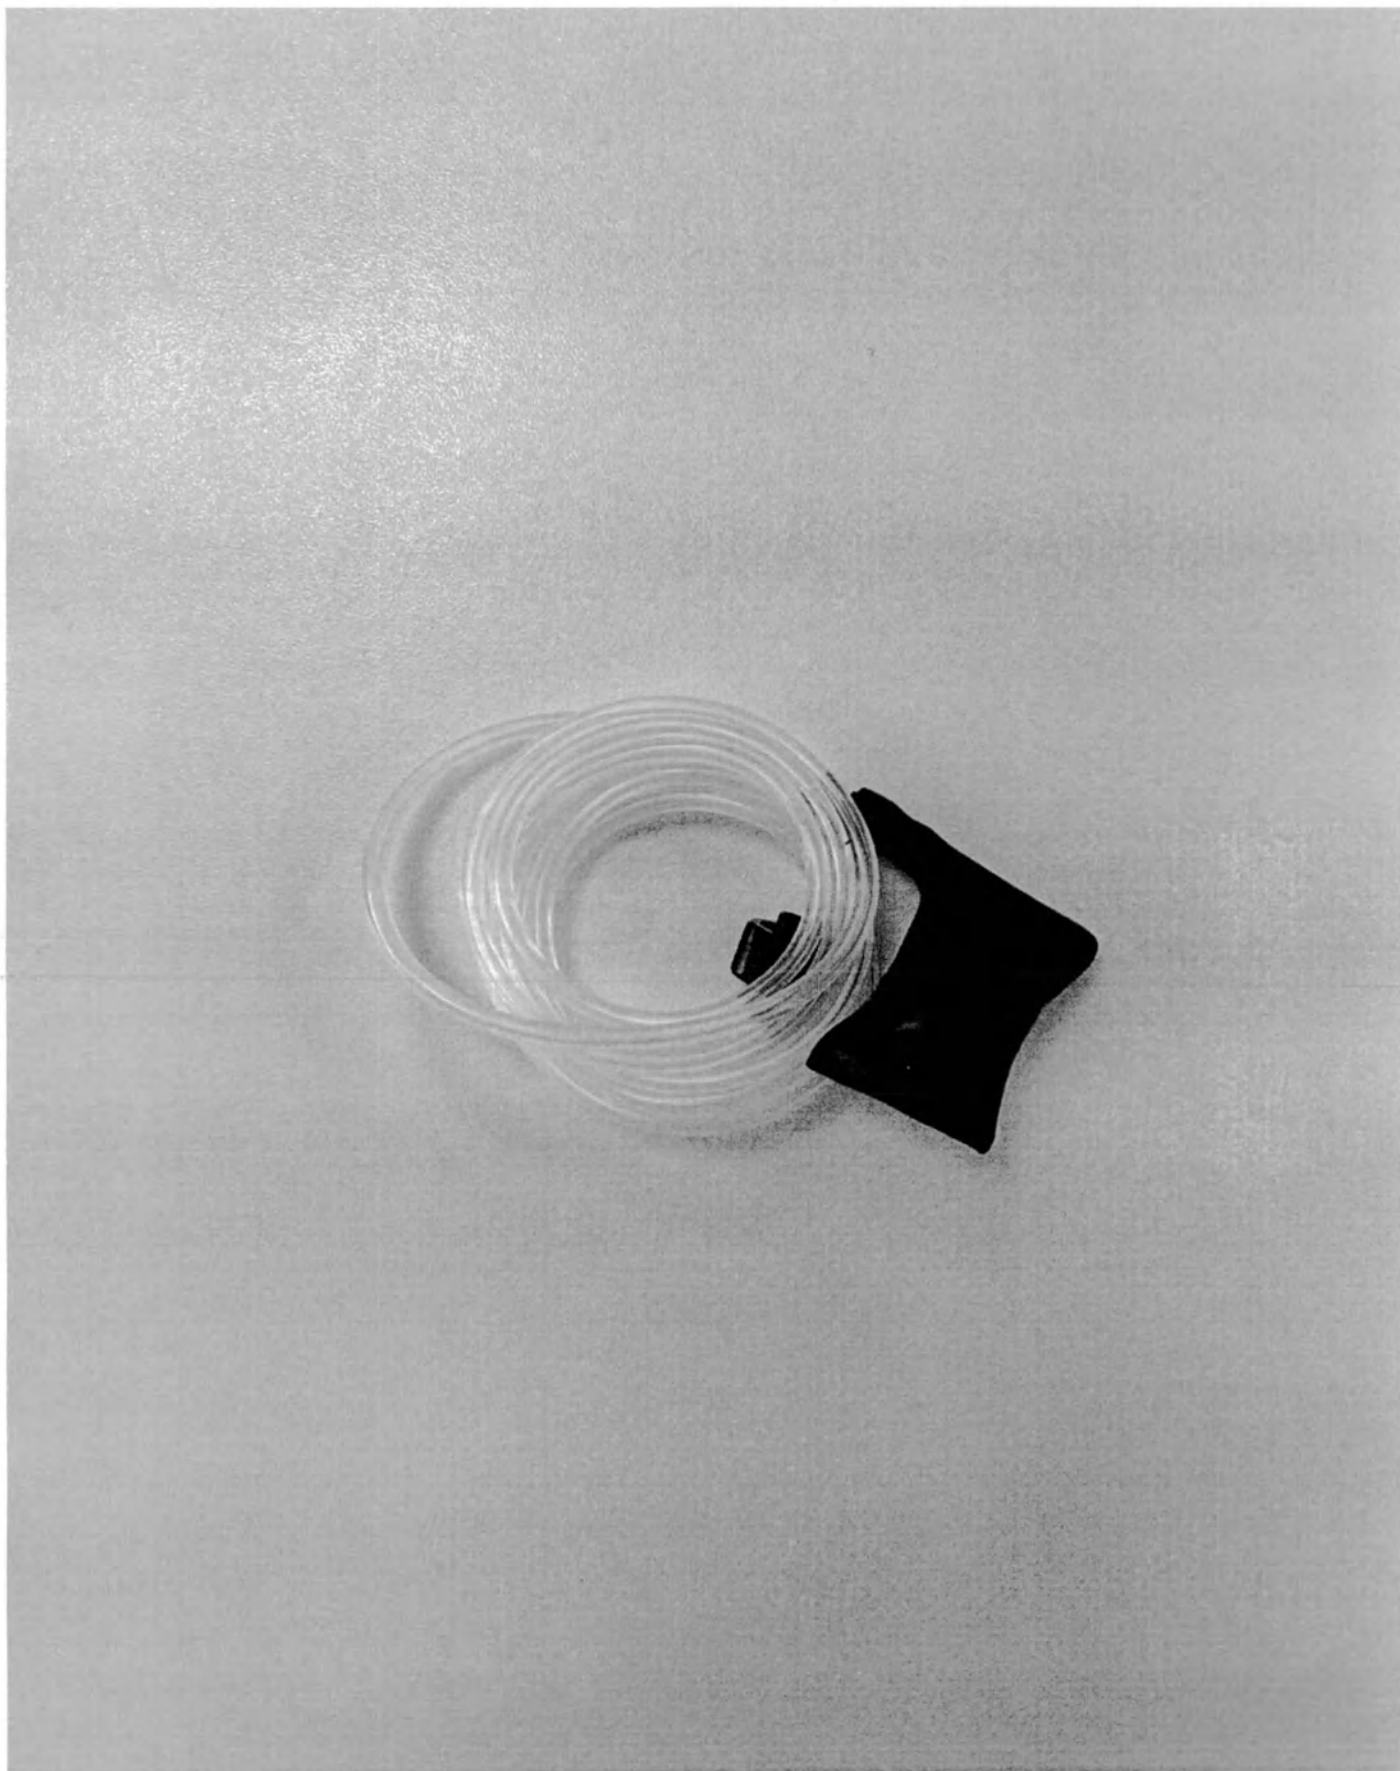

34. Абдоминальный датчик для детей

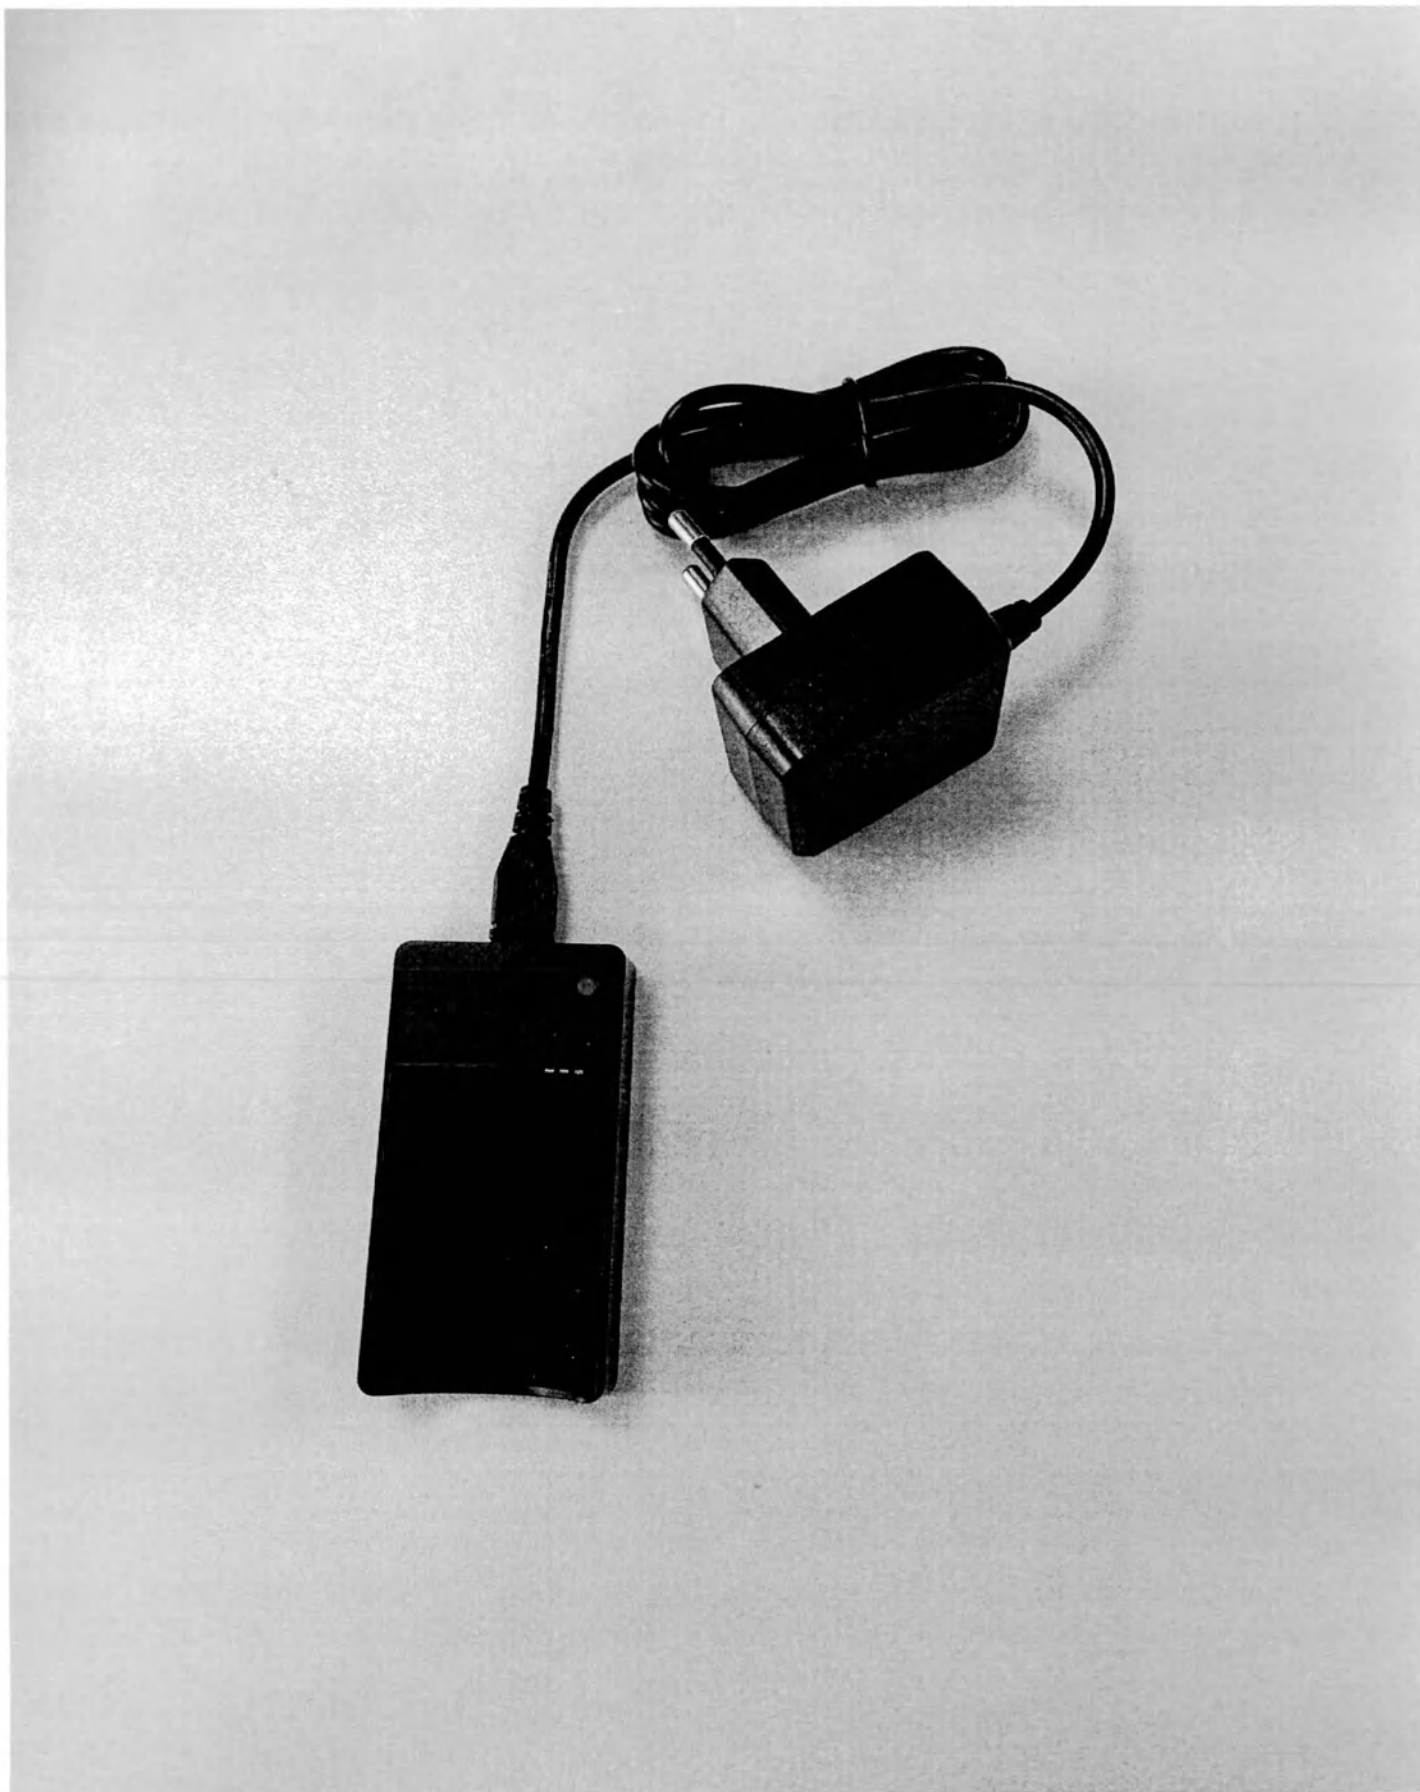

35. Зарядная станция для аккумулятора Samoa

II. Аппарат для диагностики нарушений сна и контроля терапии, в варианте исполнения Samoa lite



1. Рекордер пациента Samoa lite.




2. Аккумуляторная батарея для Samoa




3. Программное обеспечение MiniScreen Viewer.




4. Сумка для транспортировки для Самоа и аксессуаров

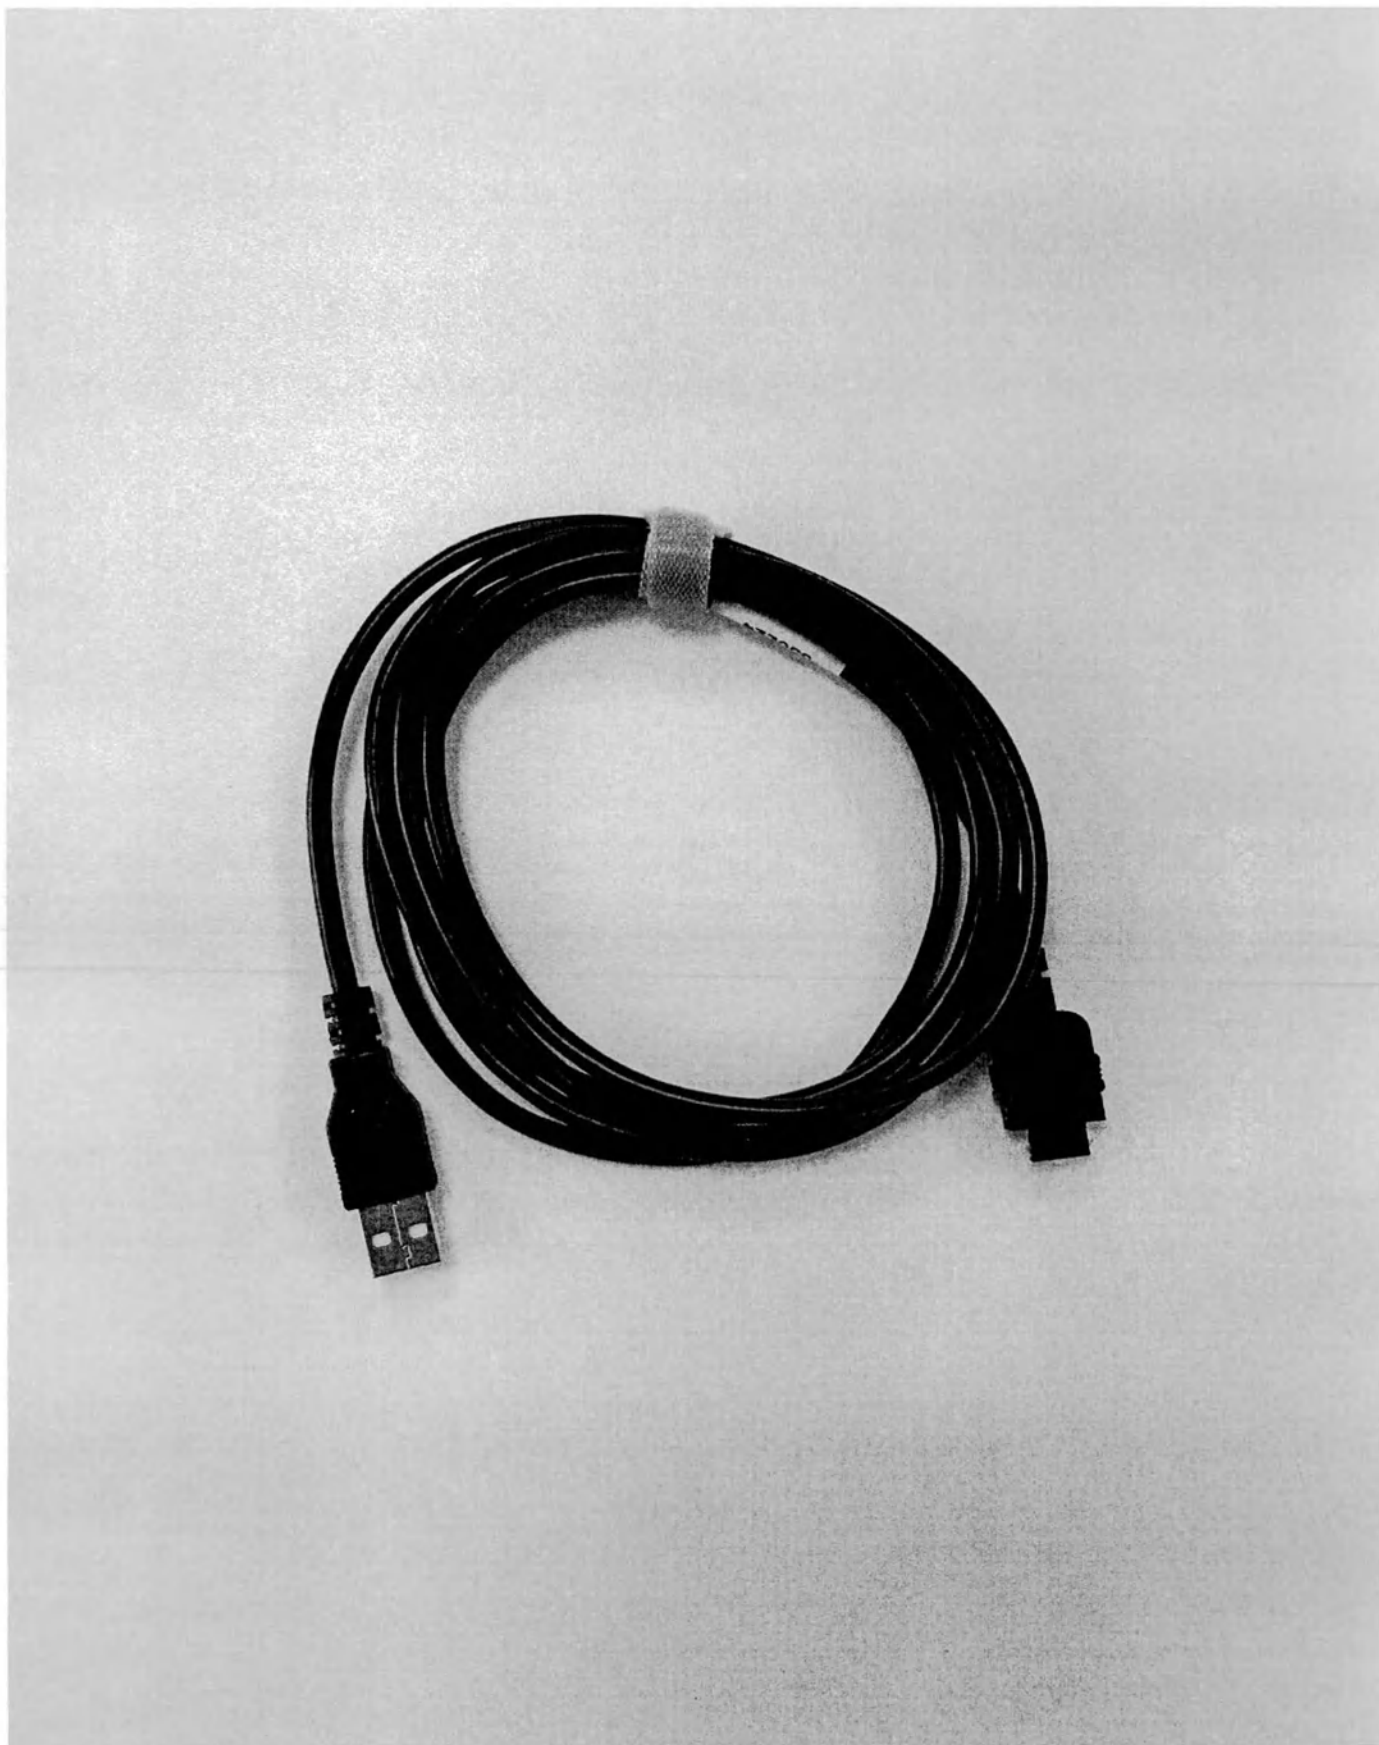


5. Кабель USB для передачи данных на ПК, 1.8 м

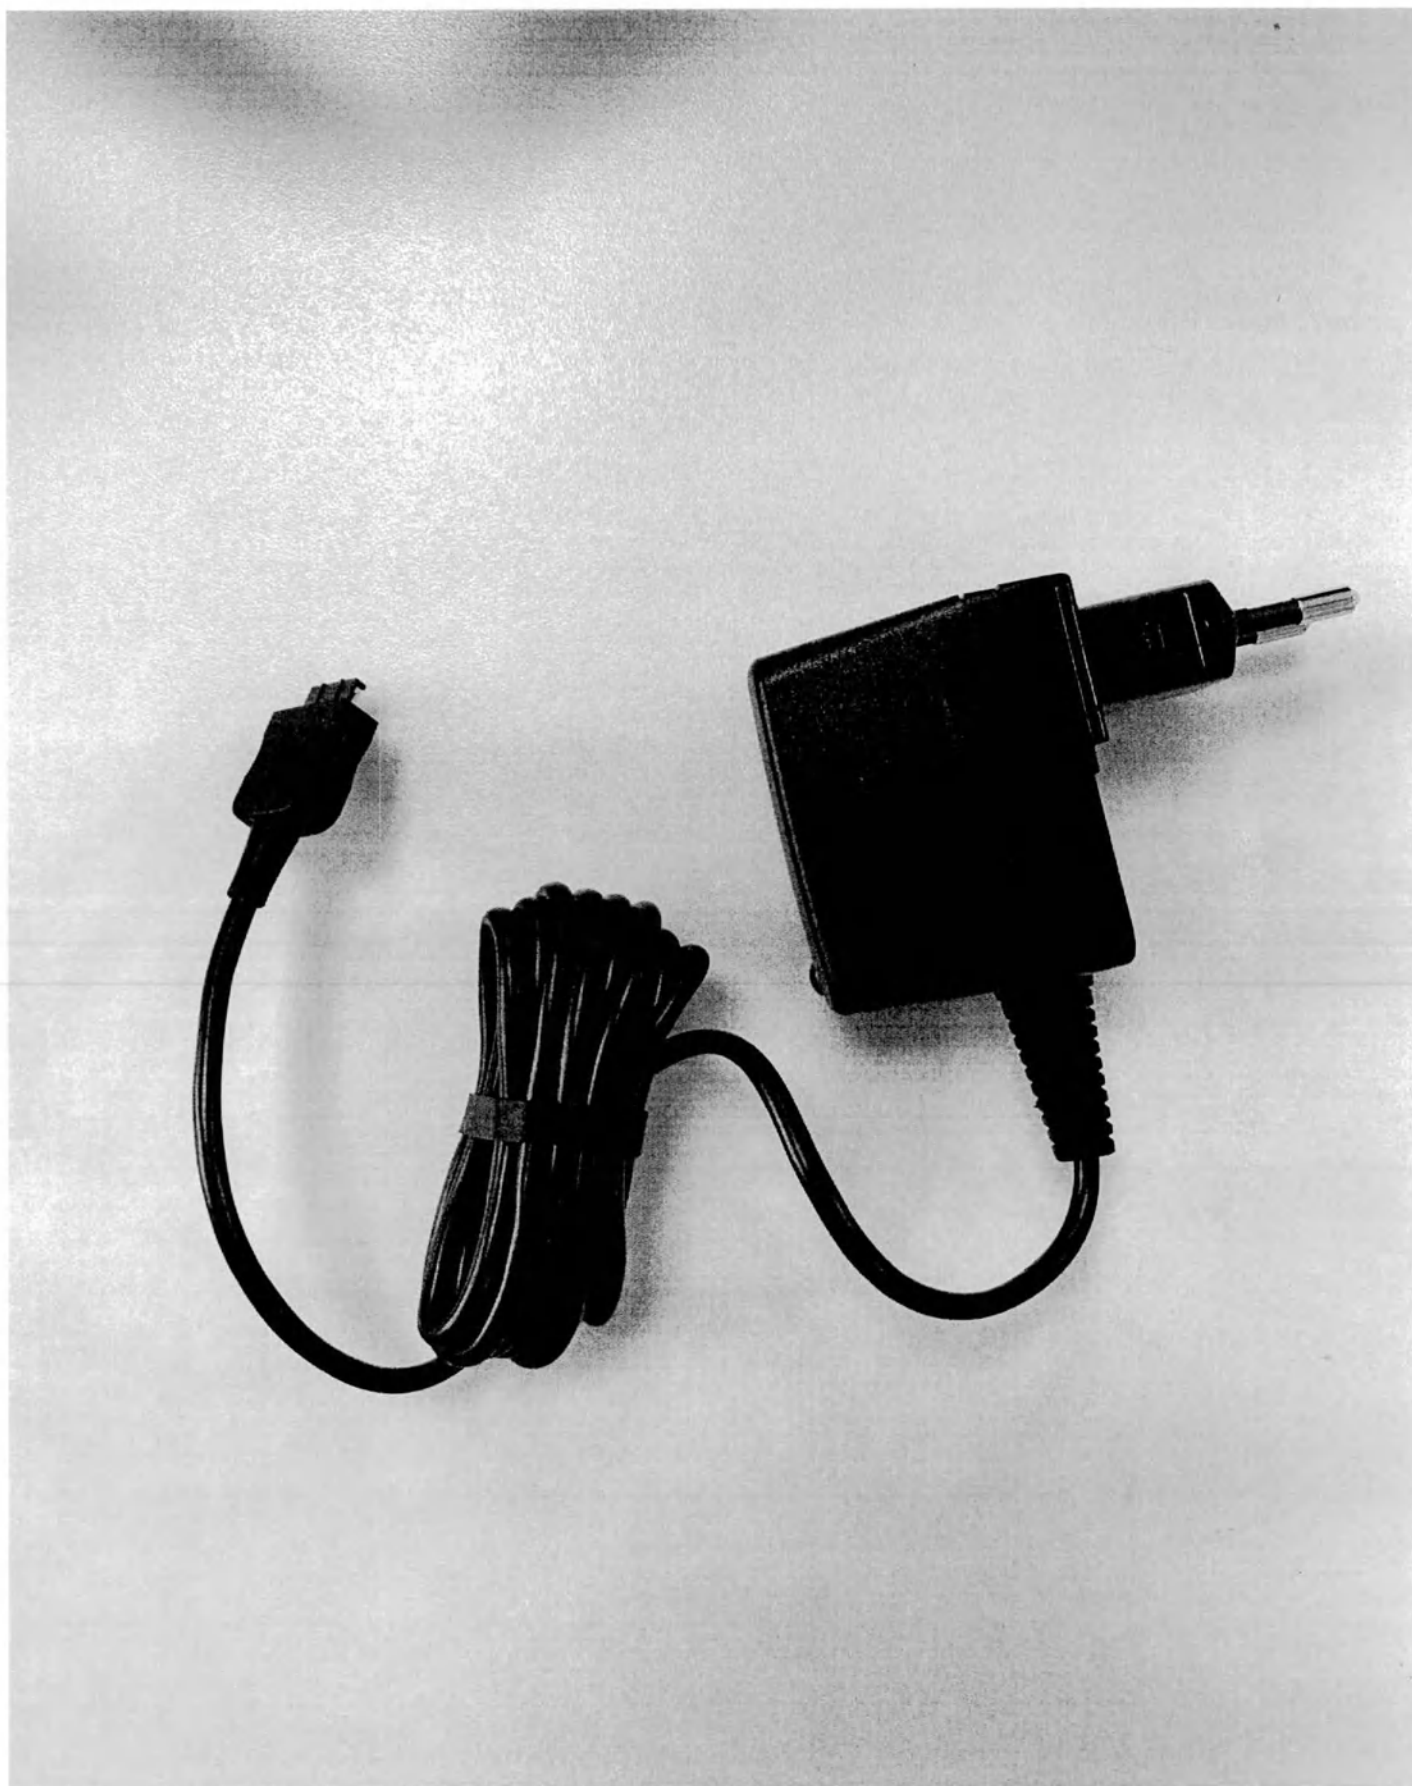


6. Адаптер питания с медицинским одобрением.

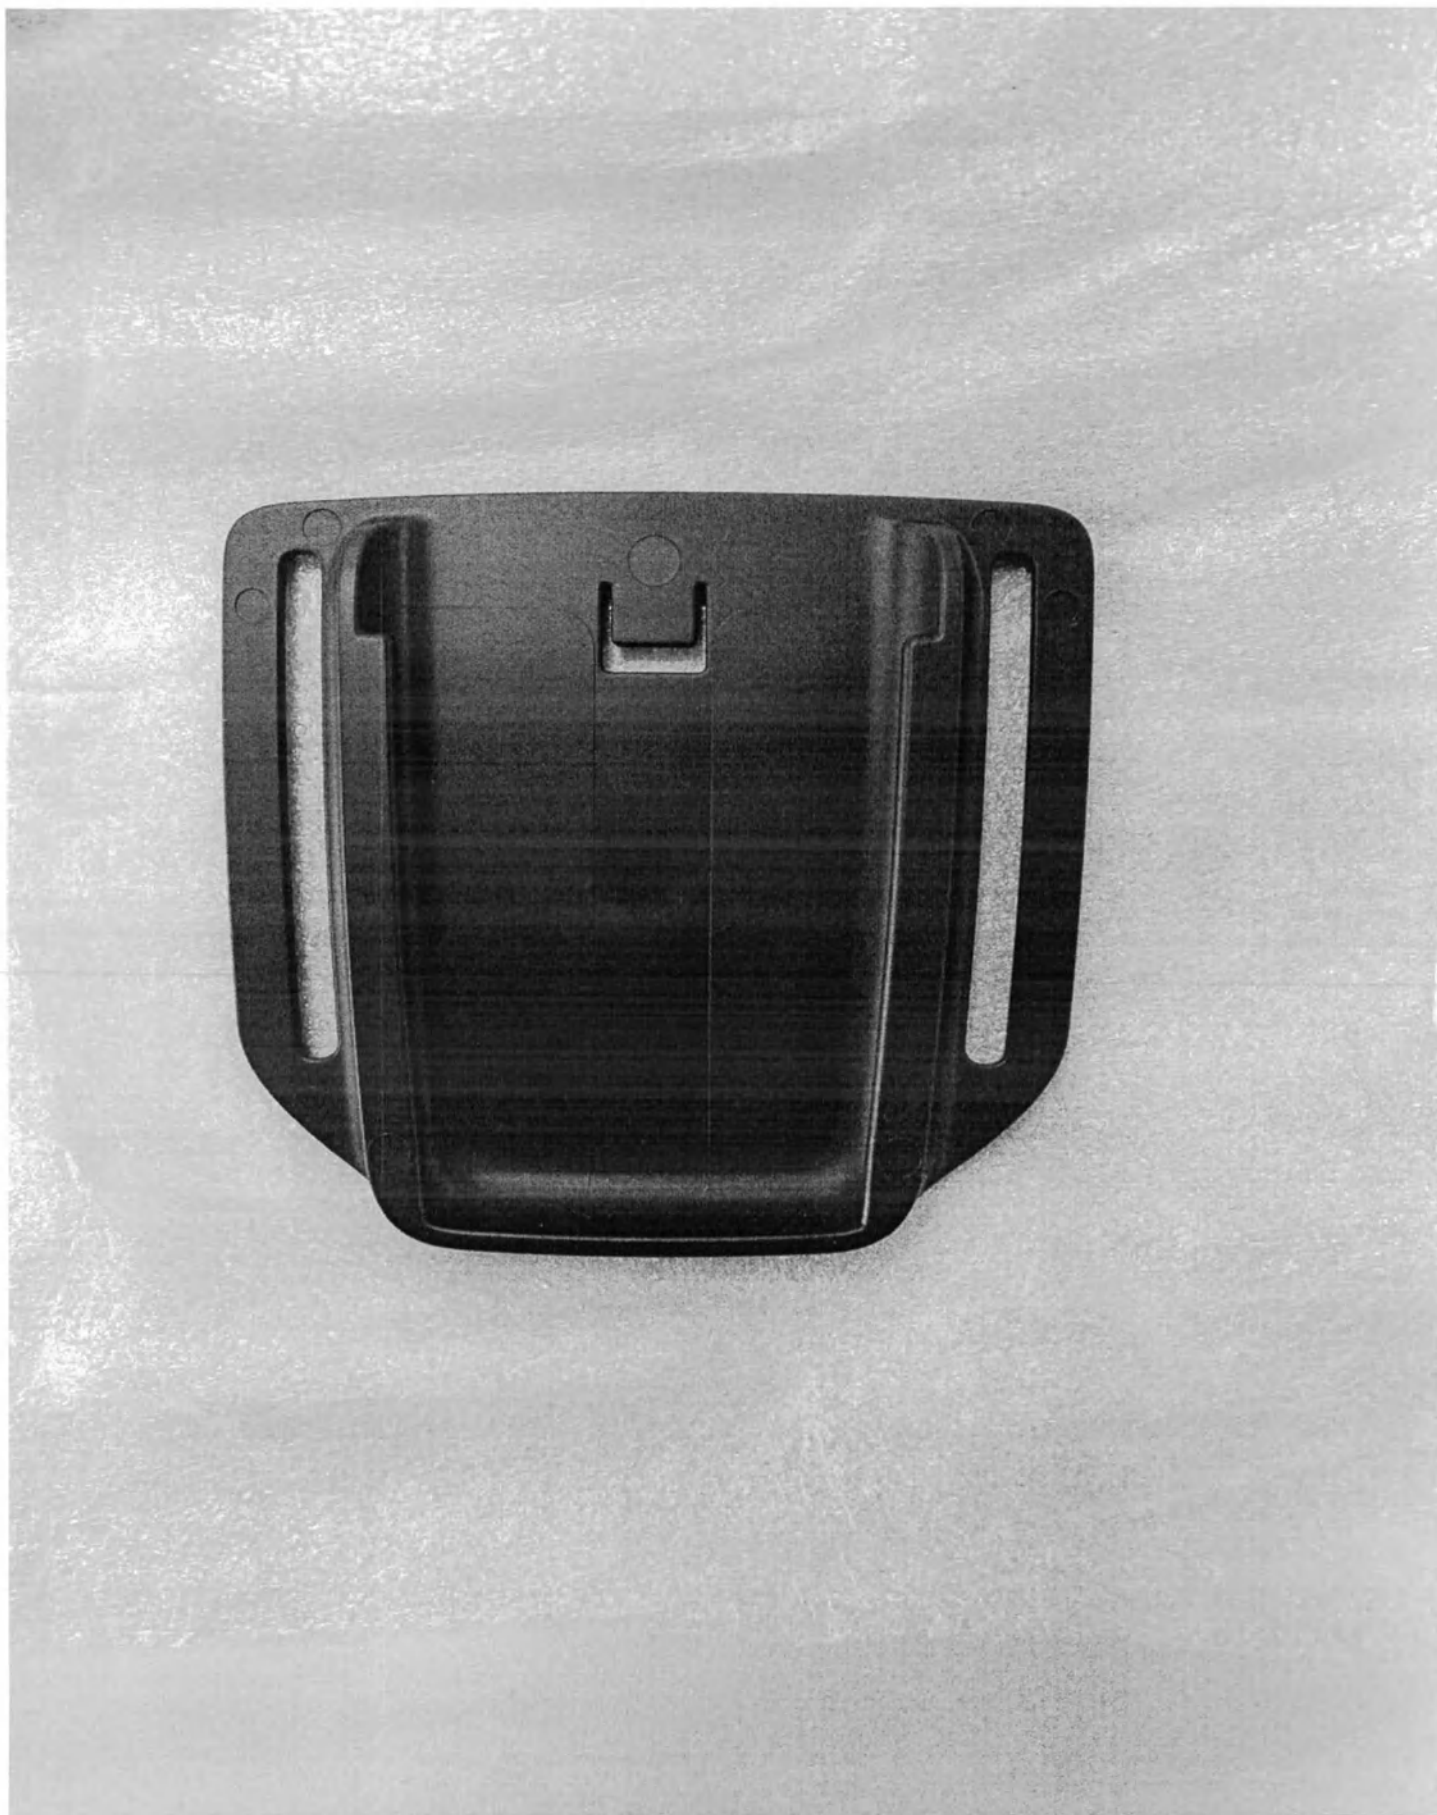


7. Консоль для переноски рекордера пациента Samoa.

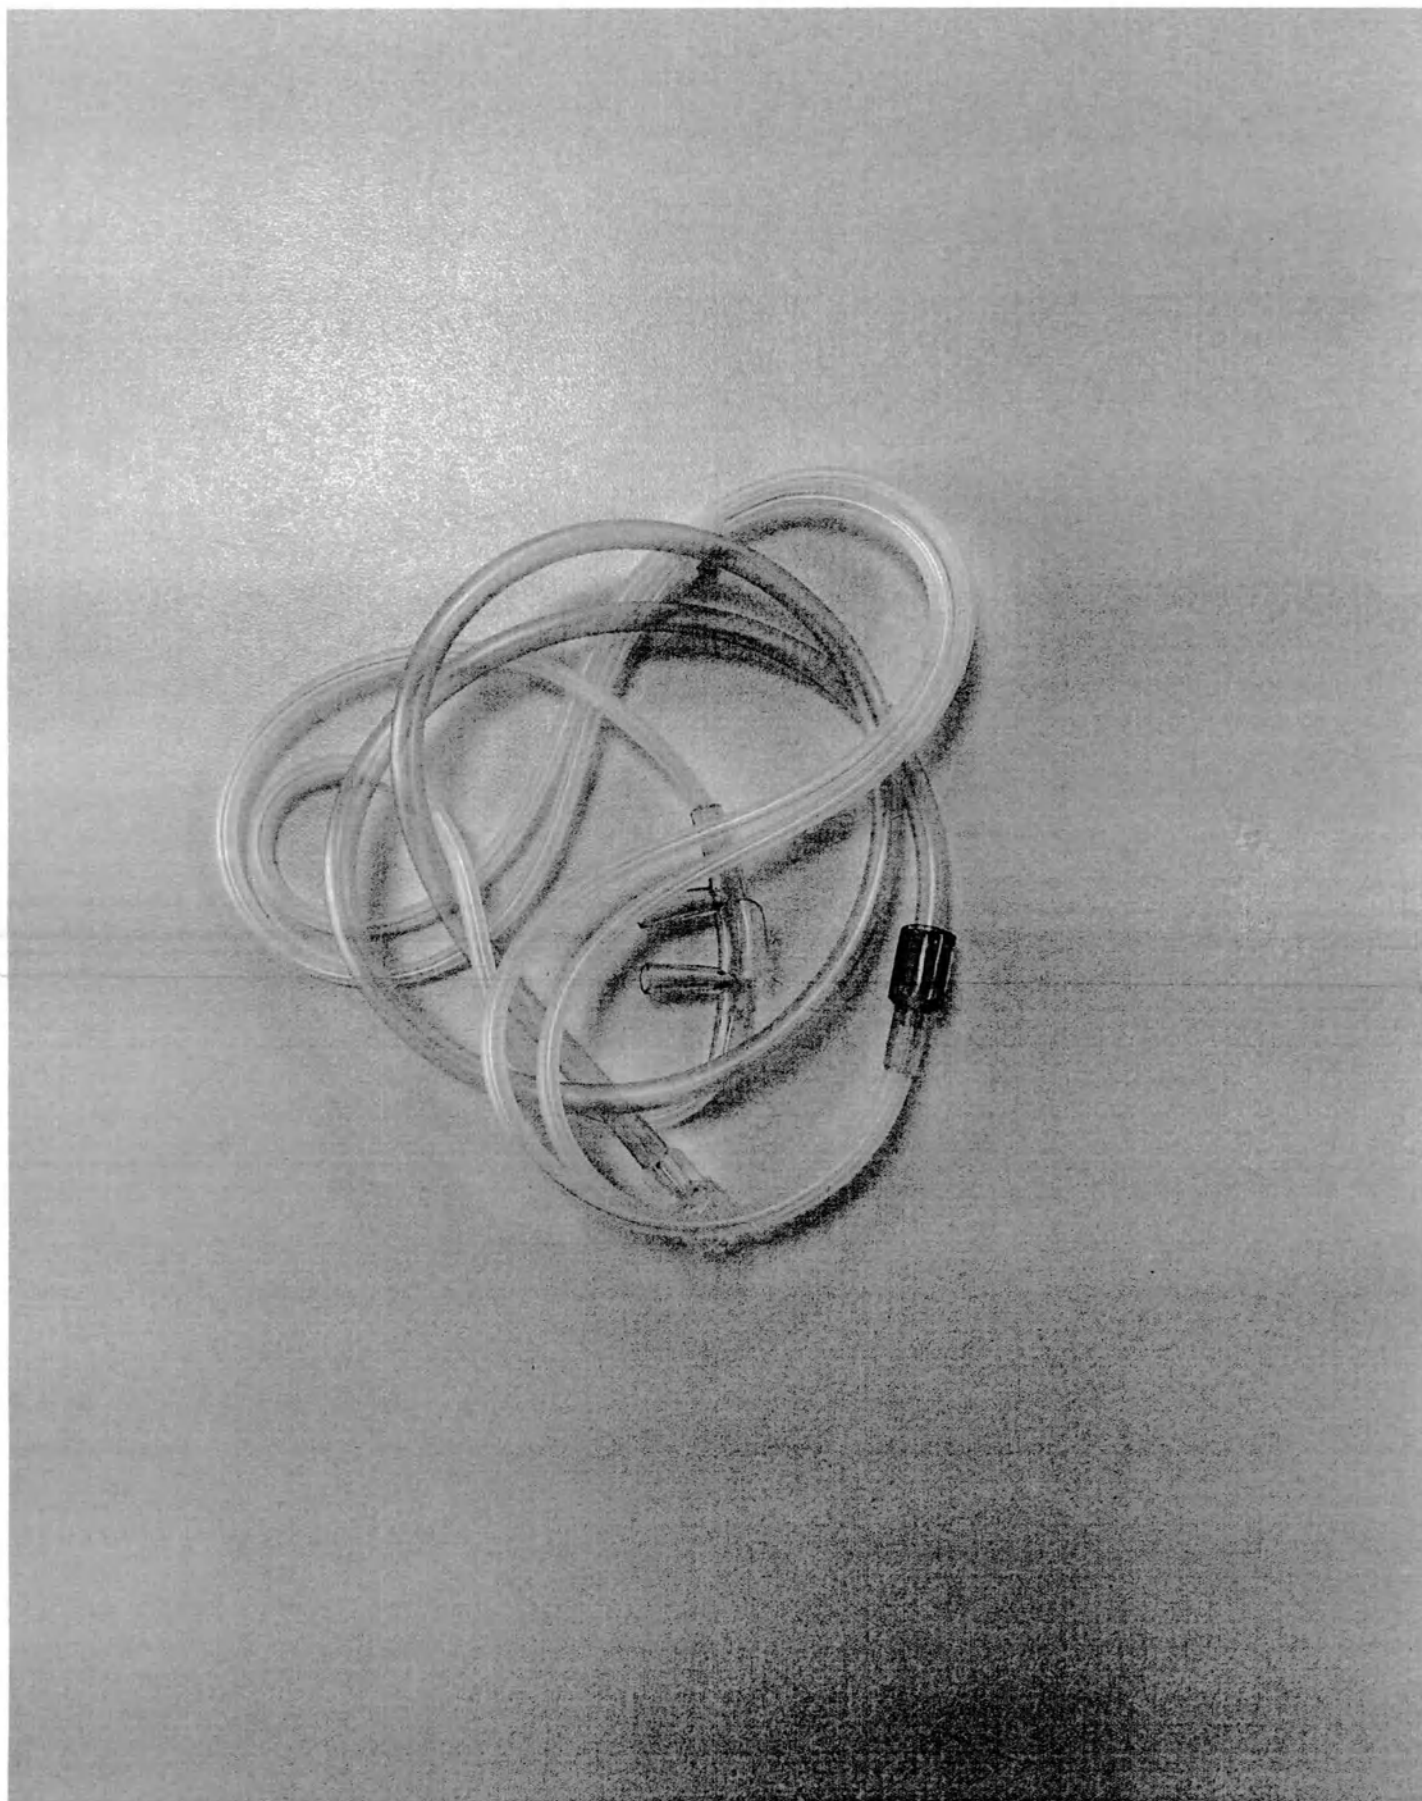


8. Назальная канюля, для взрослых, 50 см, LuerLock

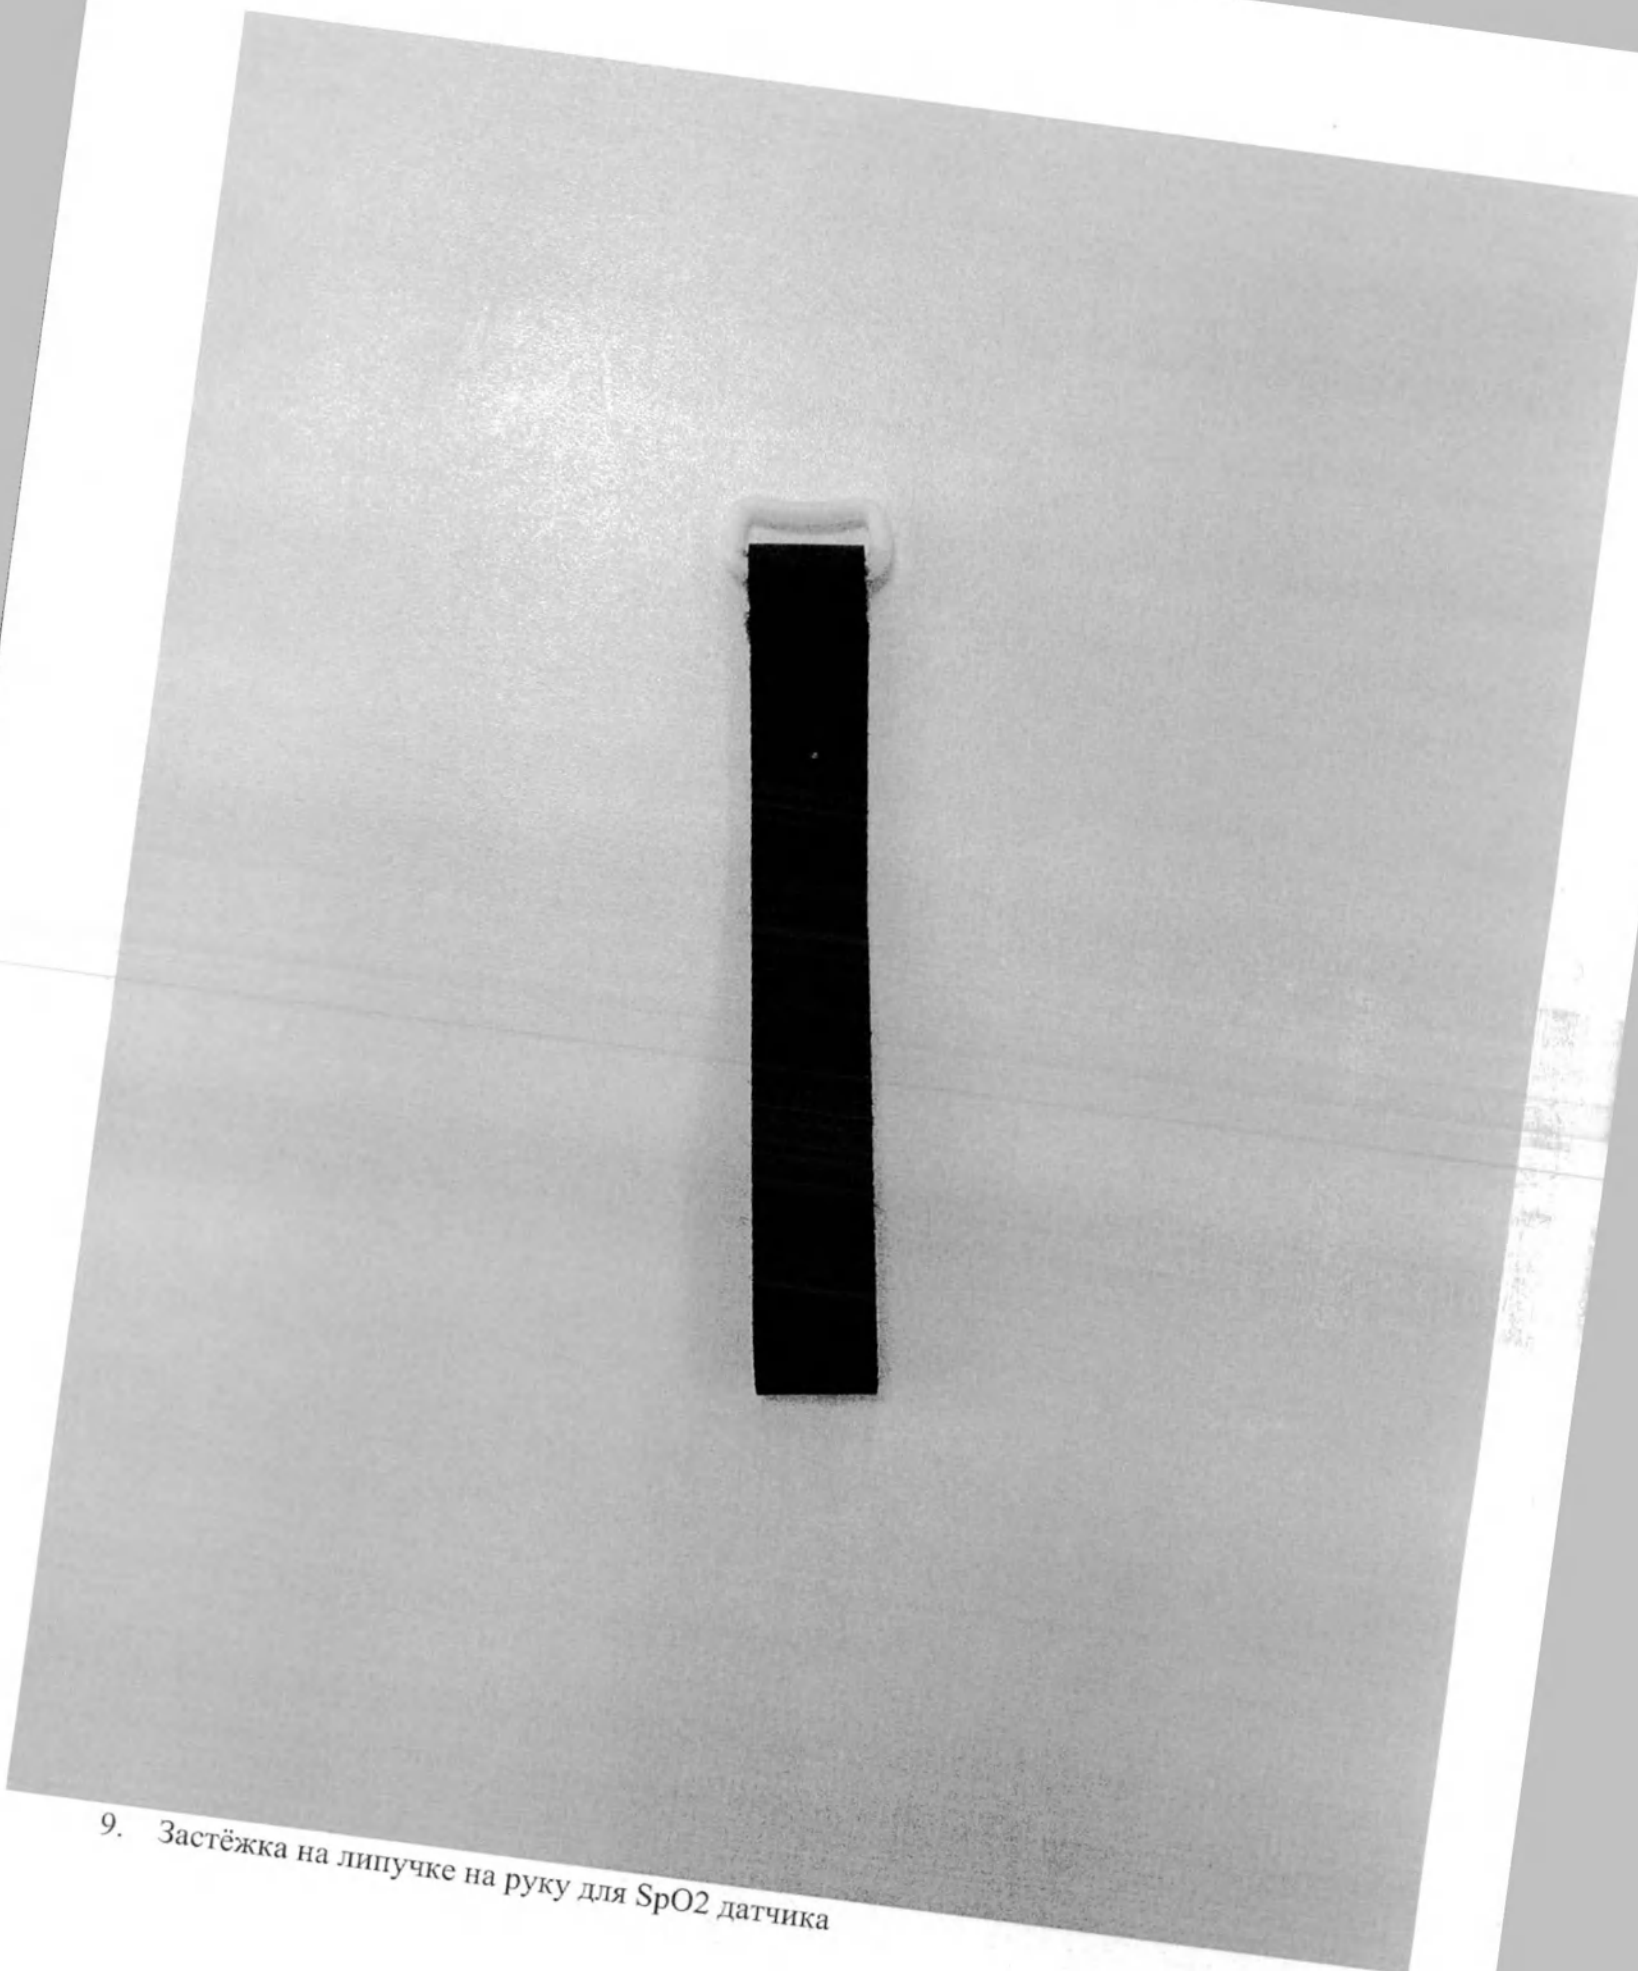


9. Застёжка на липучке на руку для SpO2 датчика

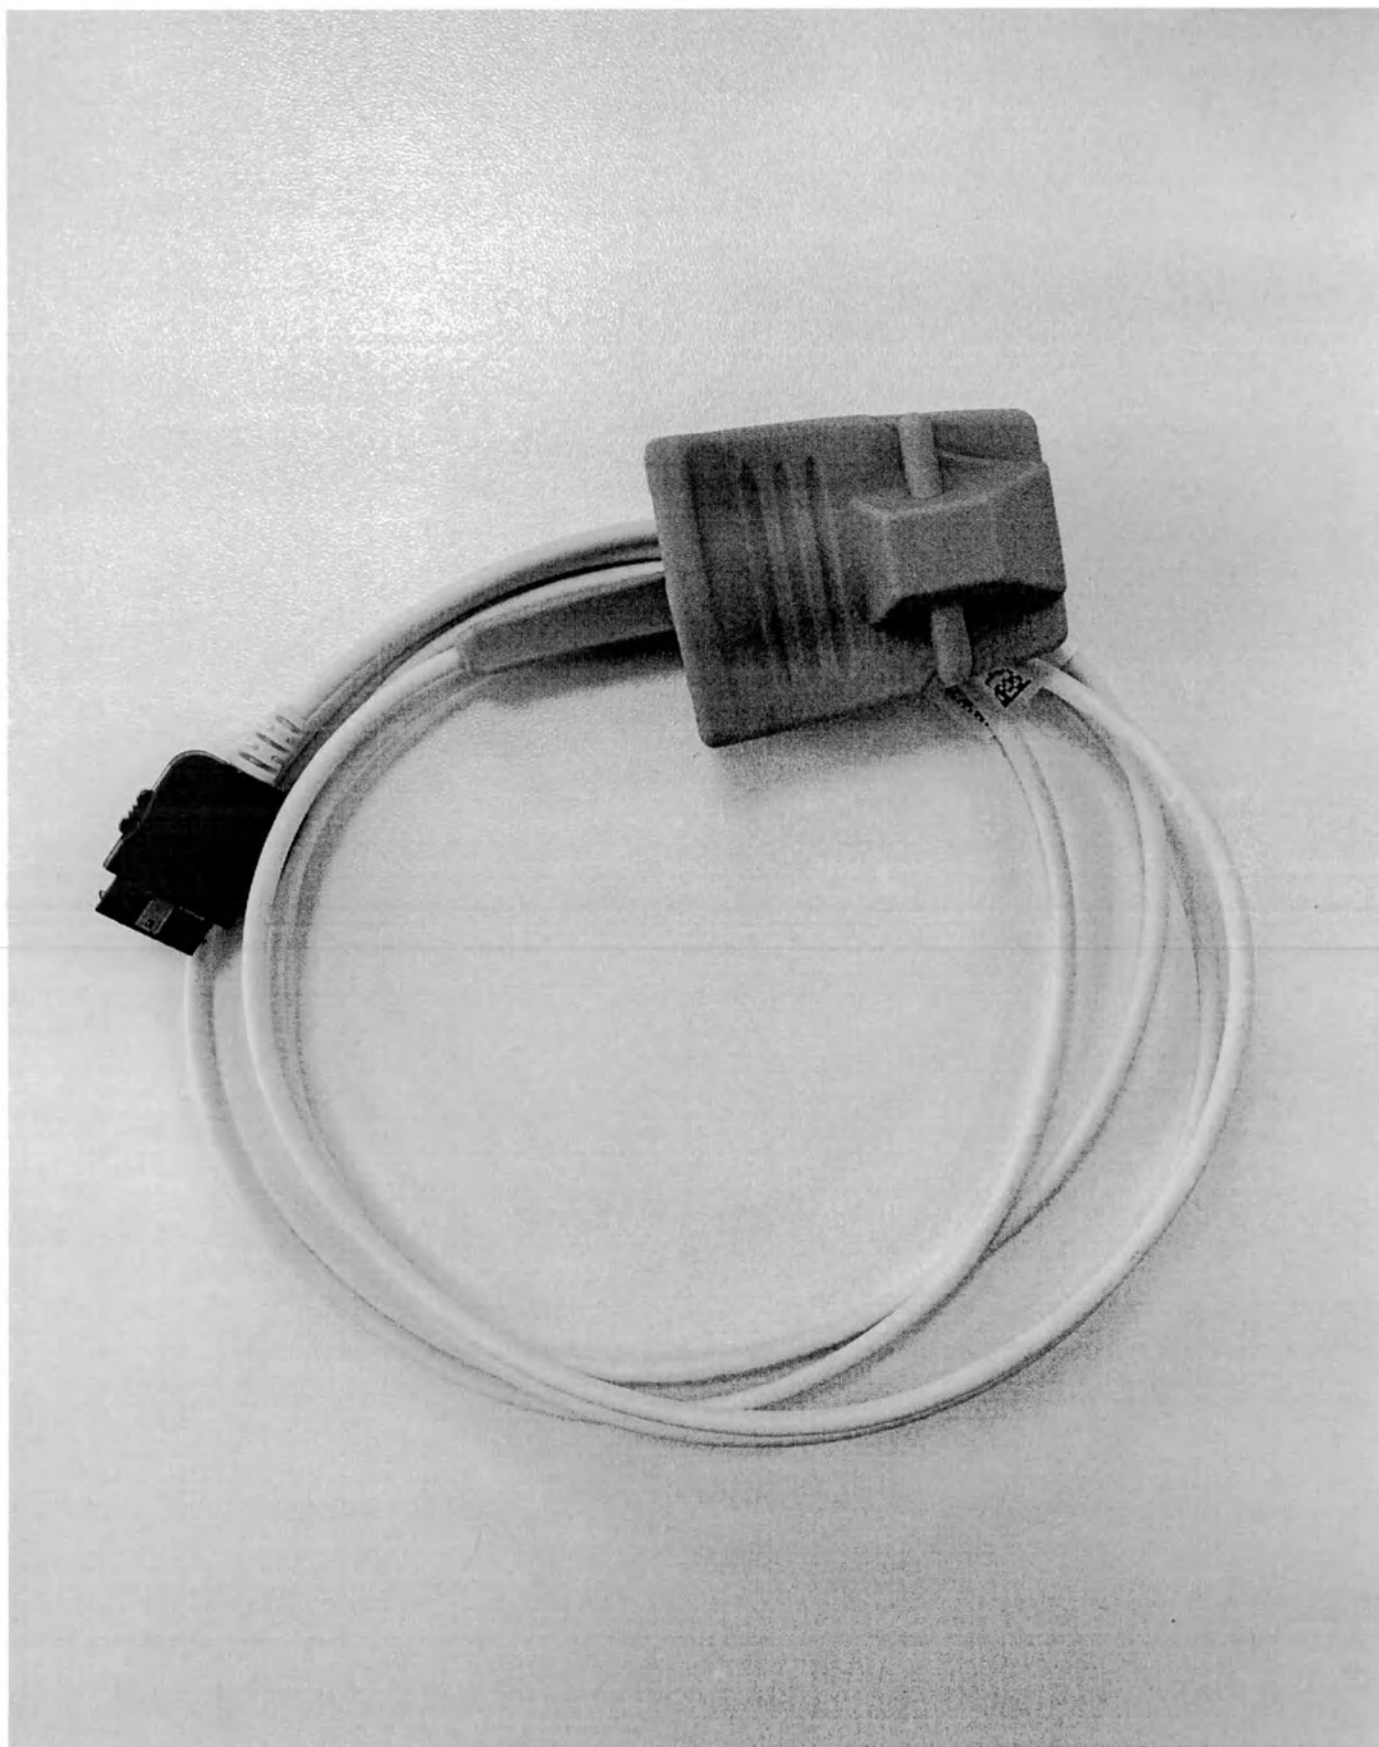


10. Датчик пульсоксиметрический SpO₂

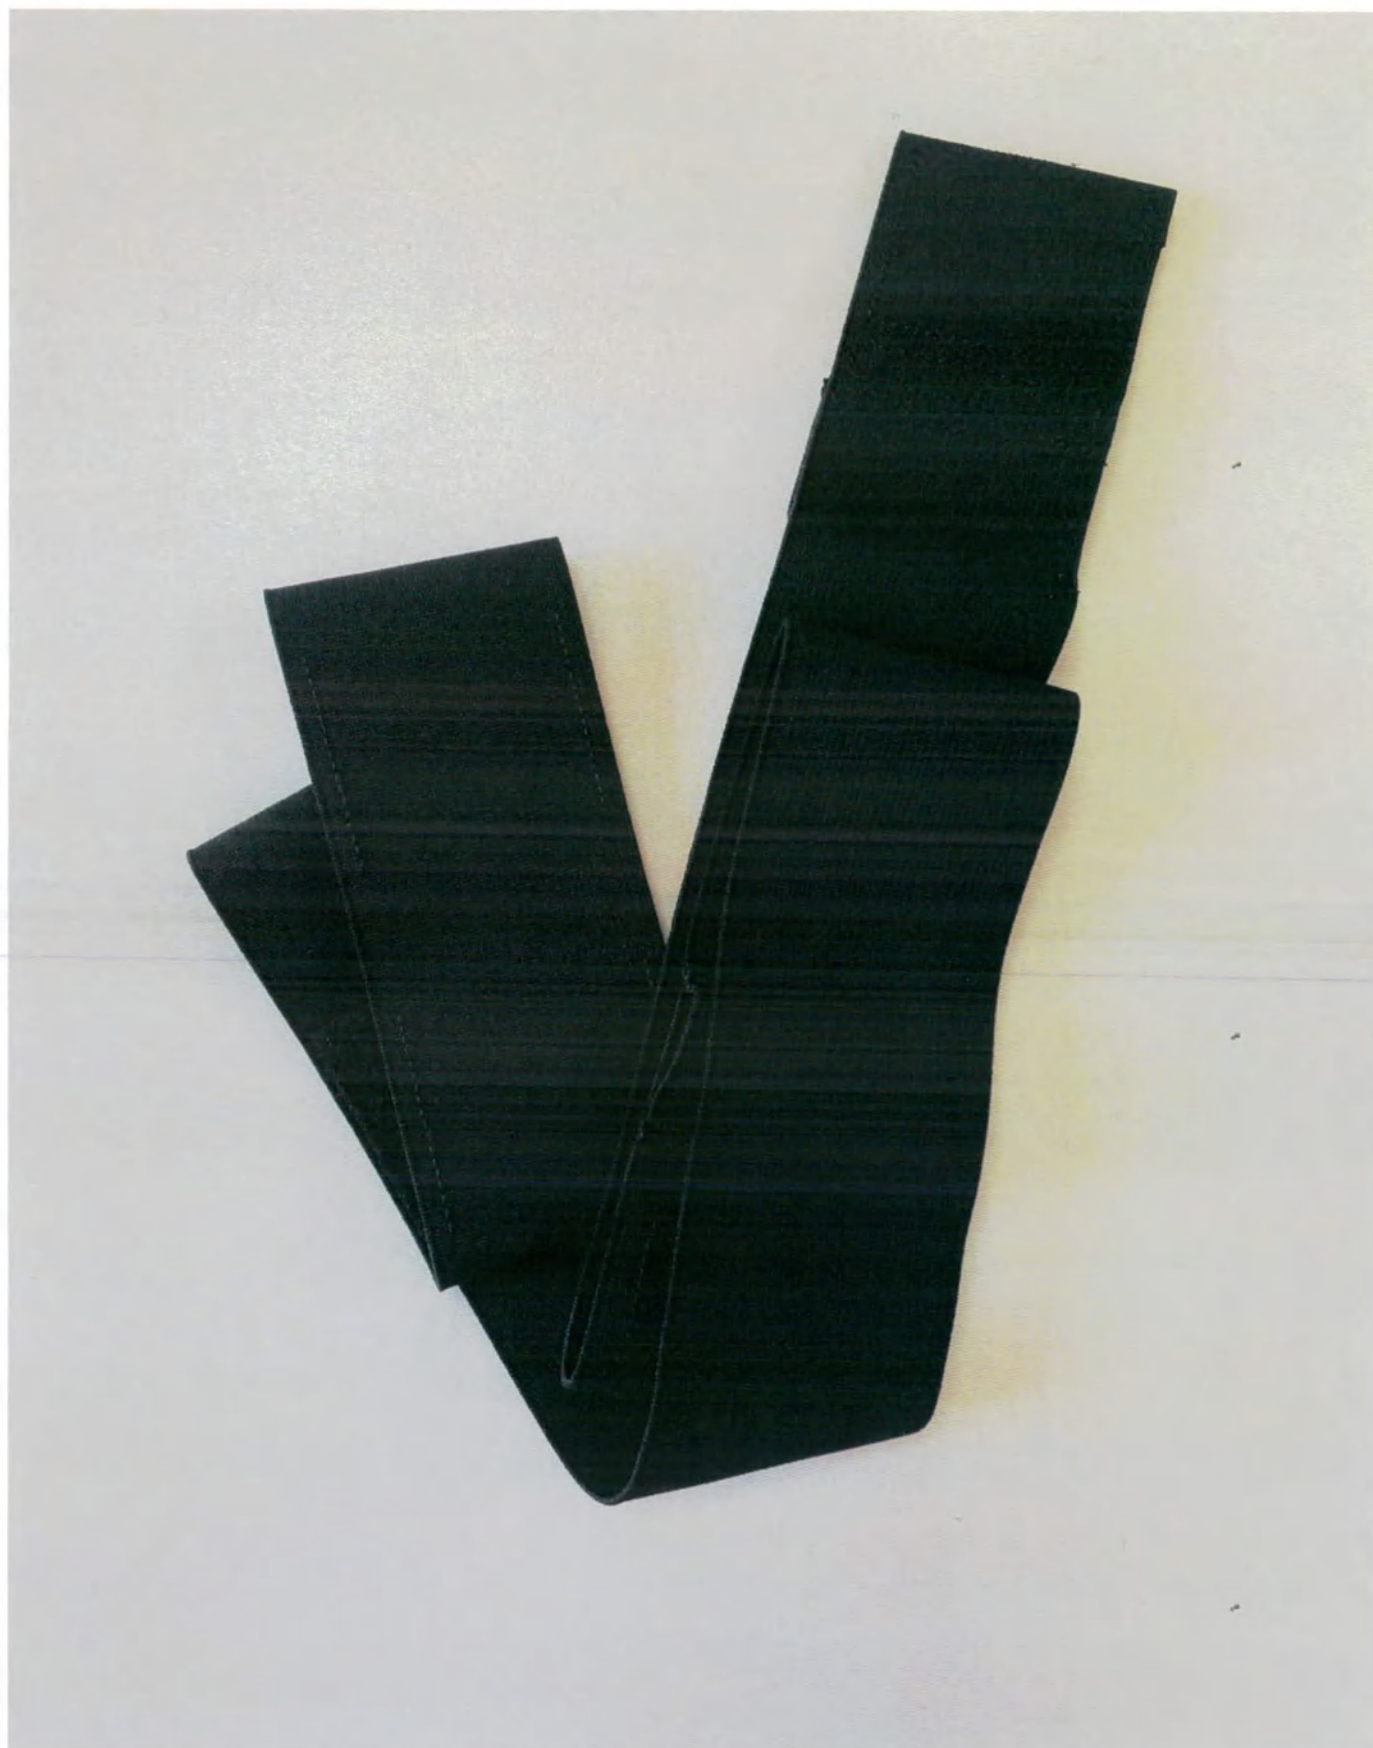


11. Ремень для переноски торакальный, гибкий, чёрный, Размер М

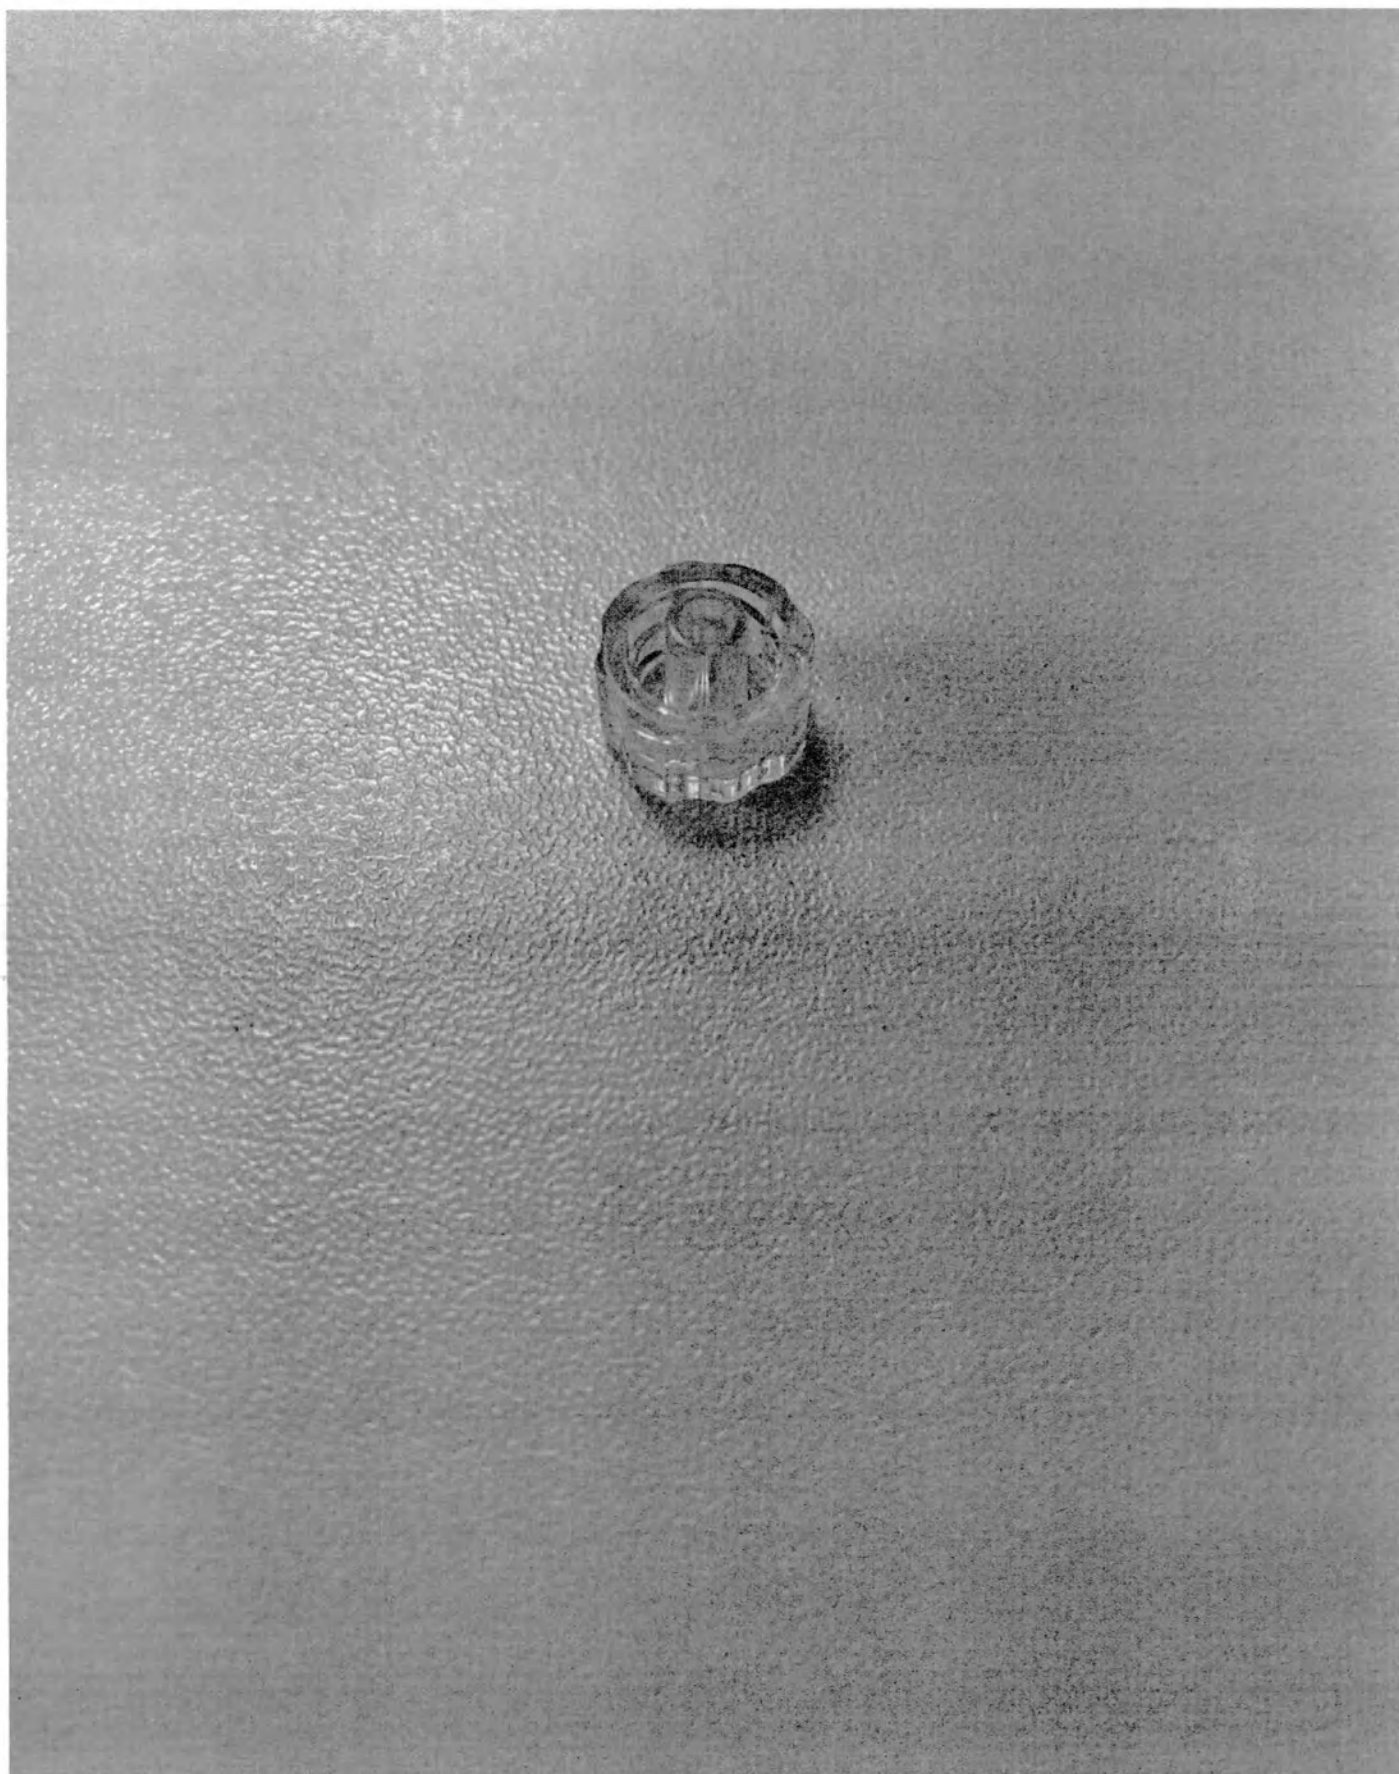


12. Luerlock уплотнительная заглушка.

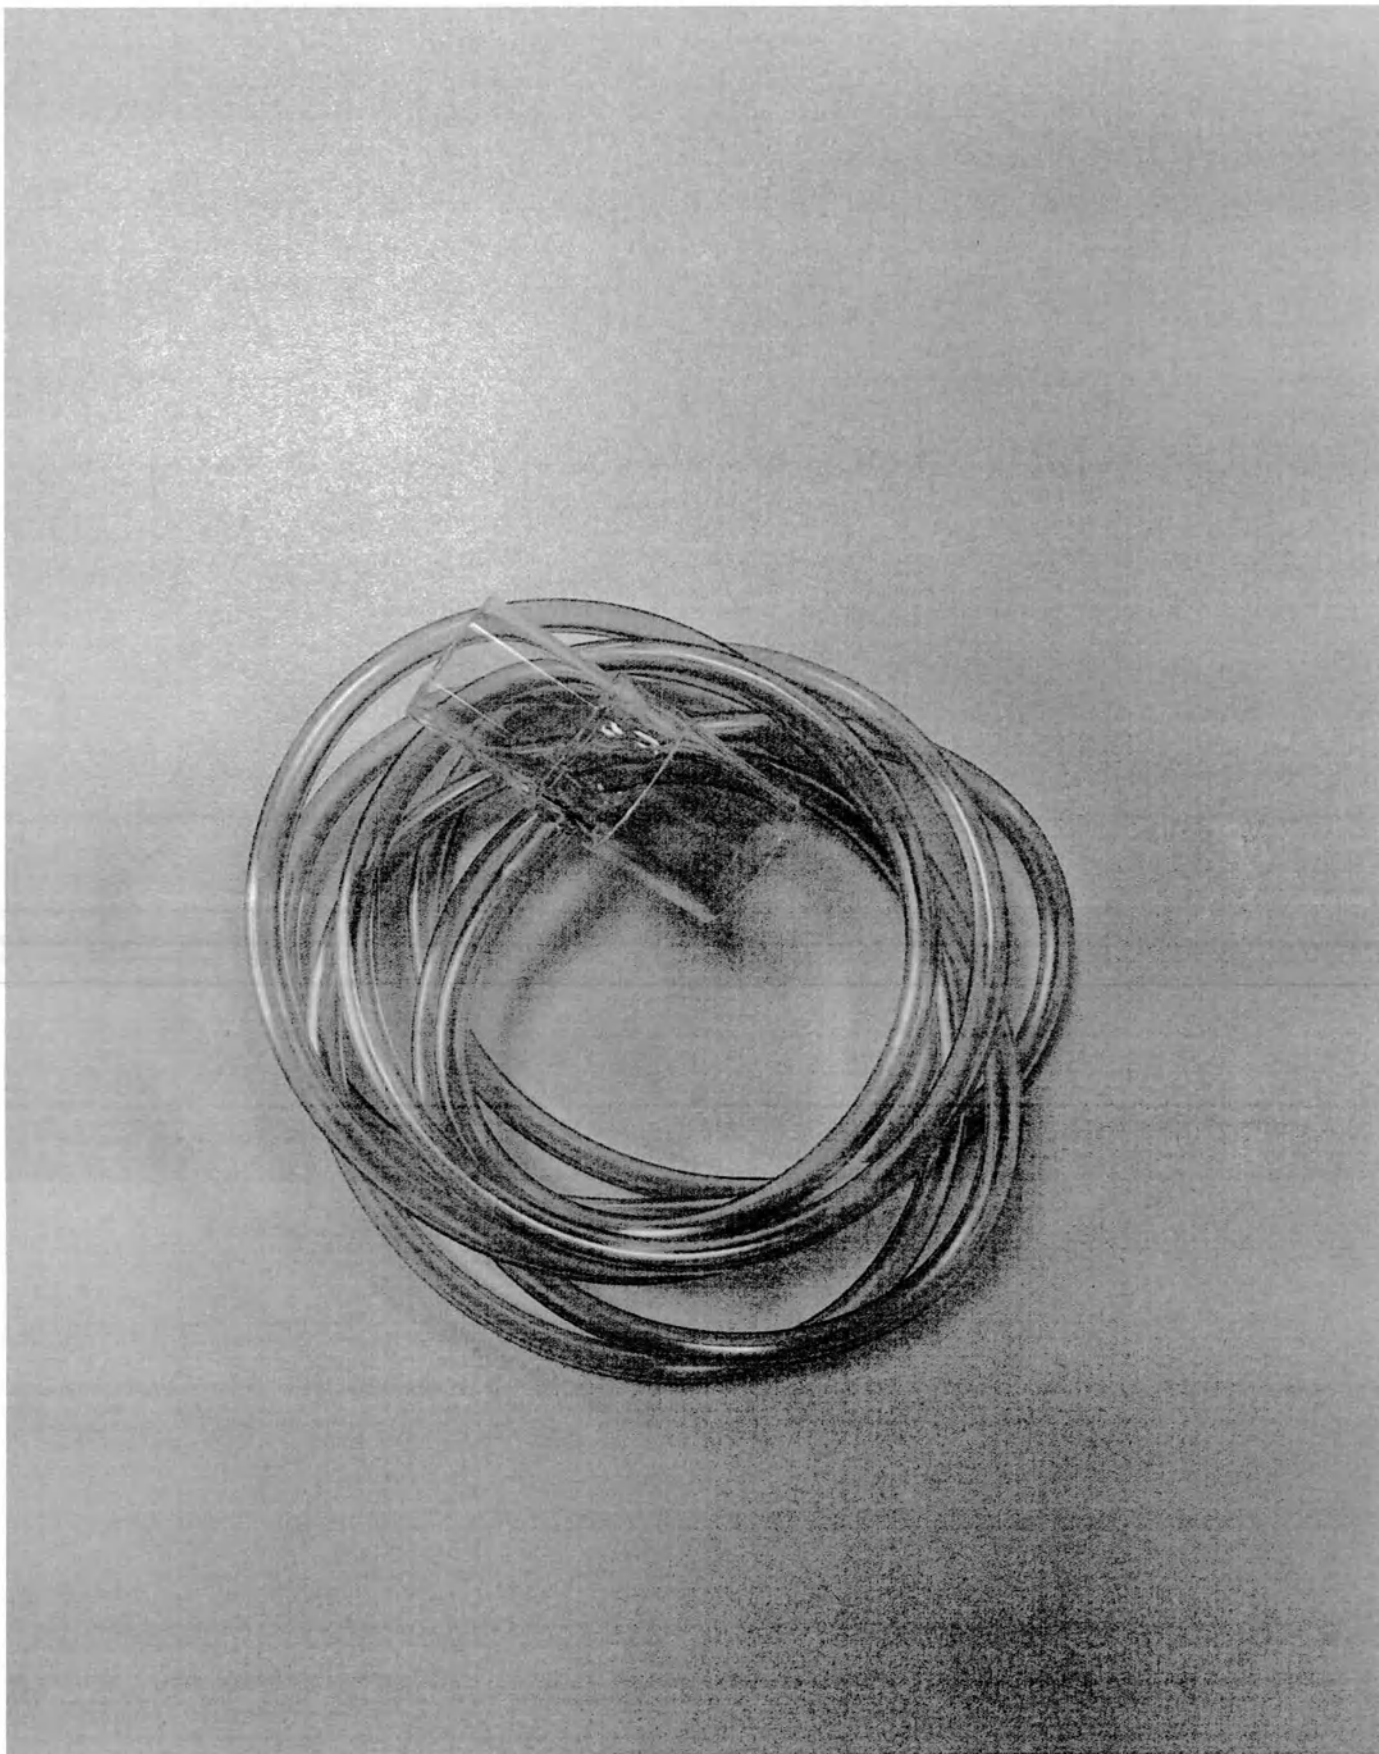


13. CPAP –адаптер, Luerlock, 200 см, одноразовый

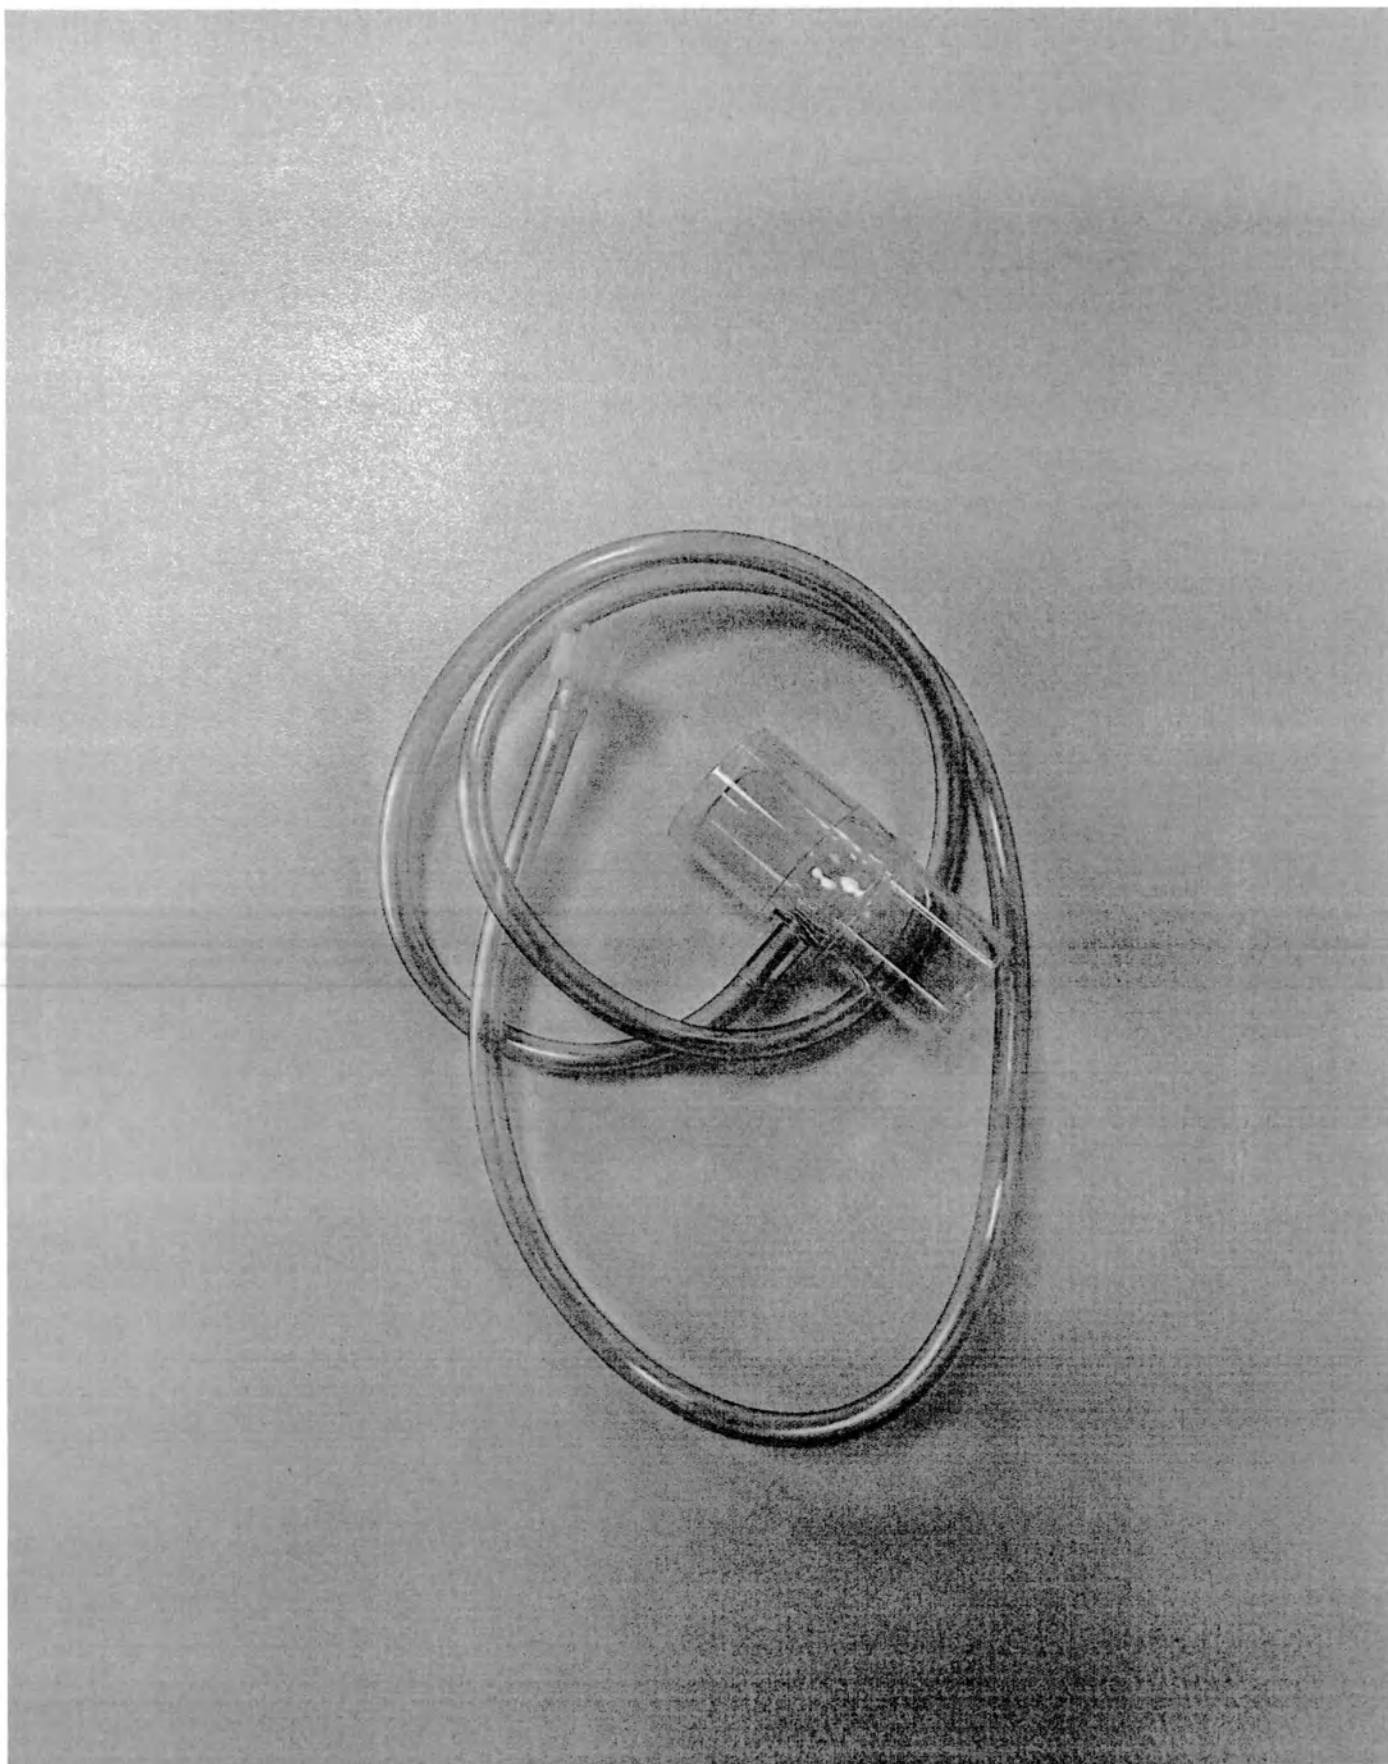


14. CPAP -адаптер, Luerlock, 80 см, одноразовый

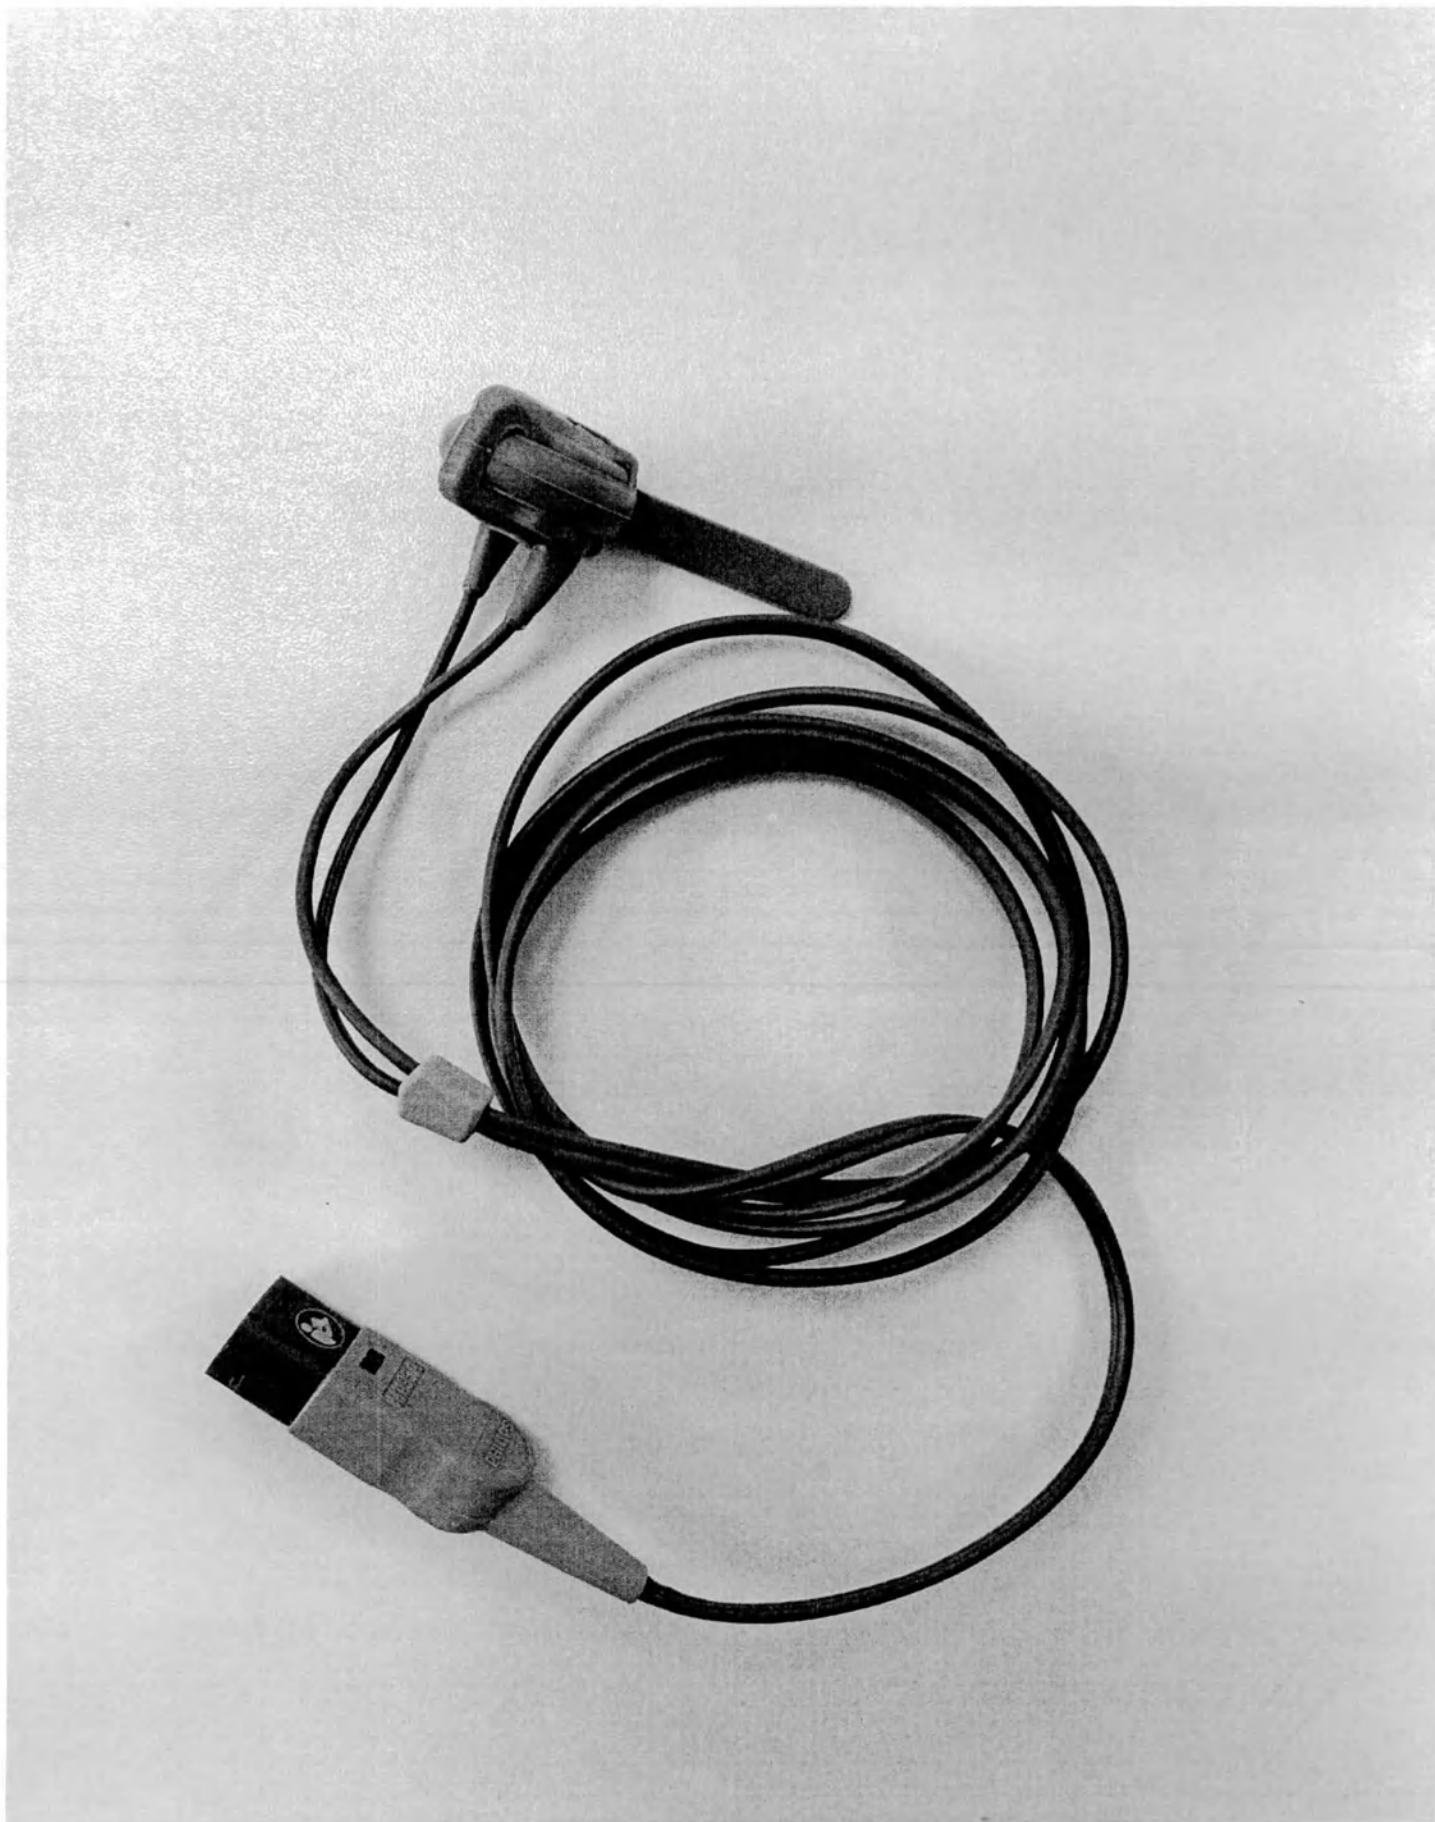


15. Детский датчик SpO₂ с Philips коннектором, дети 1 – 4 кг

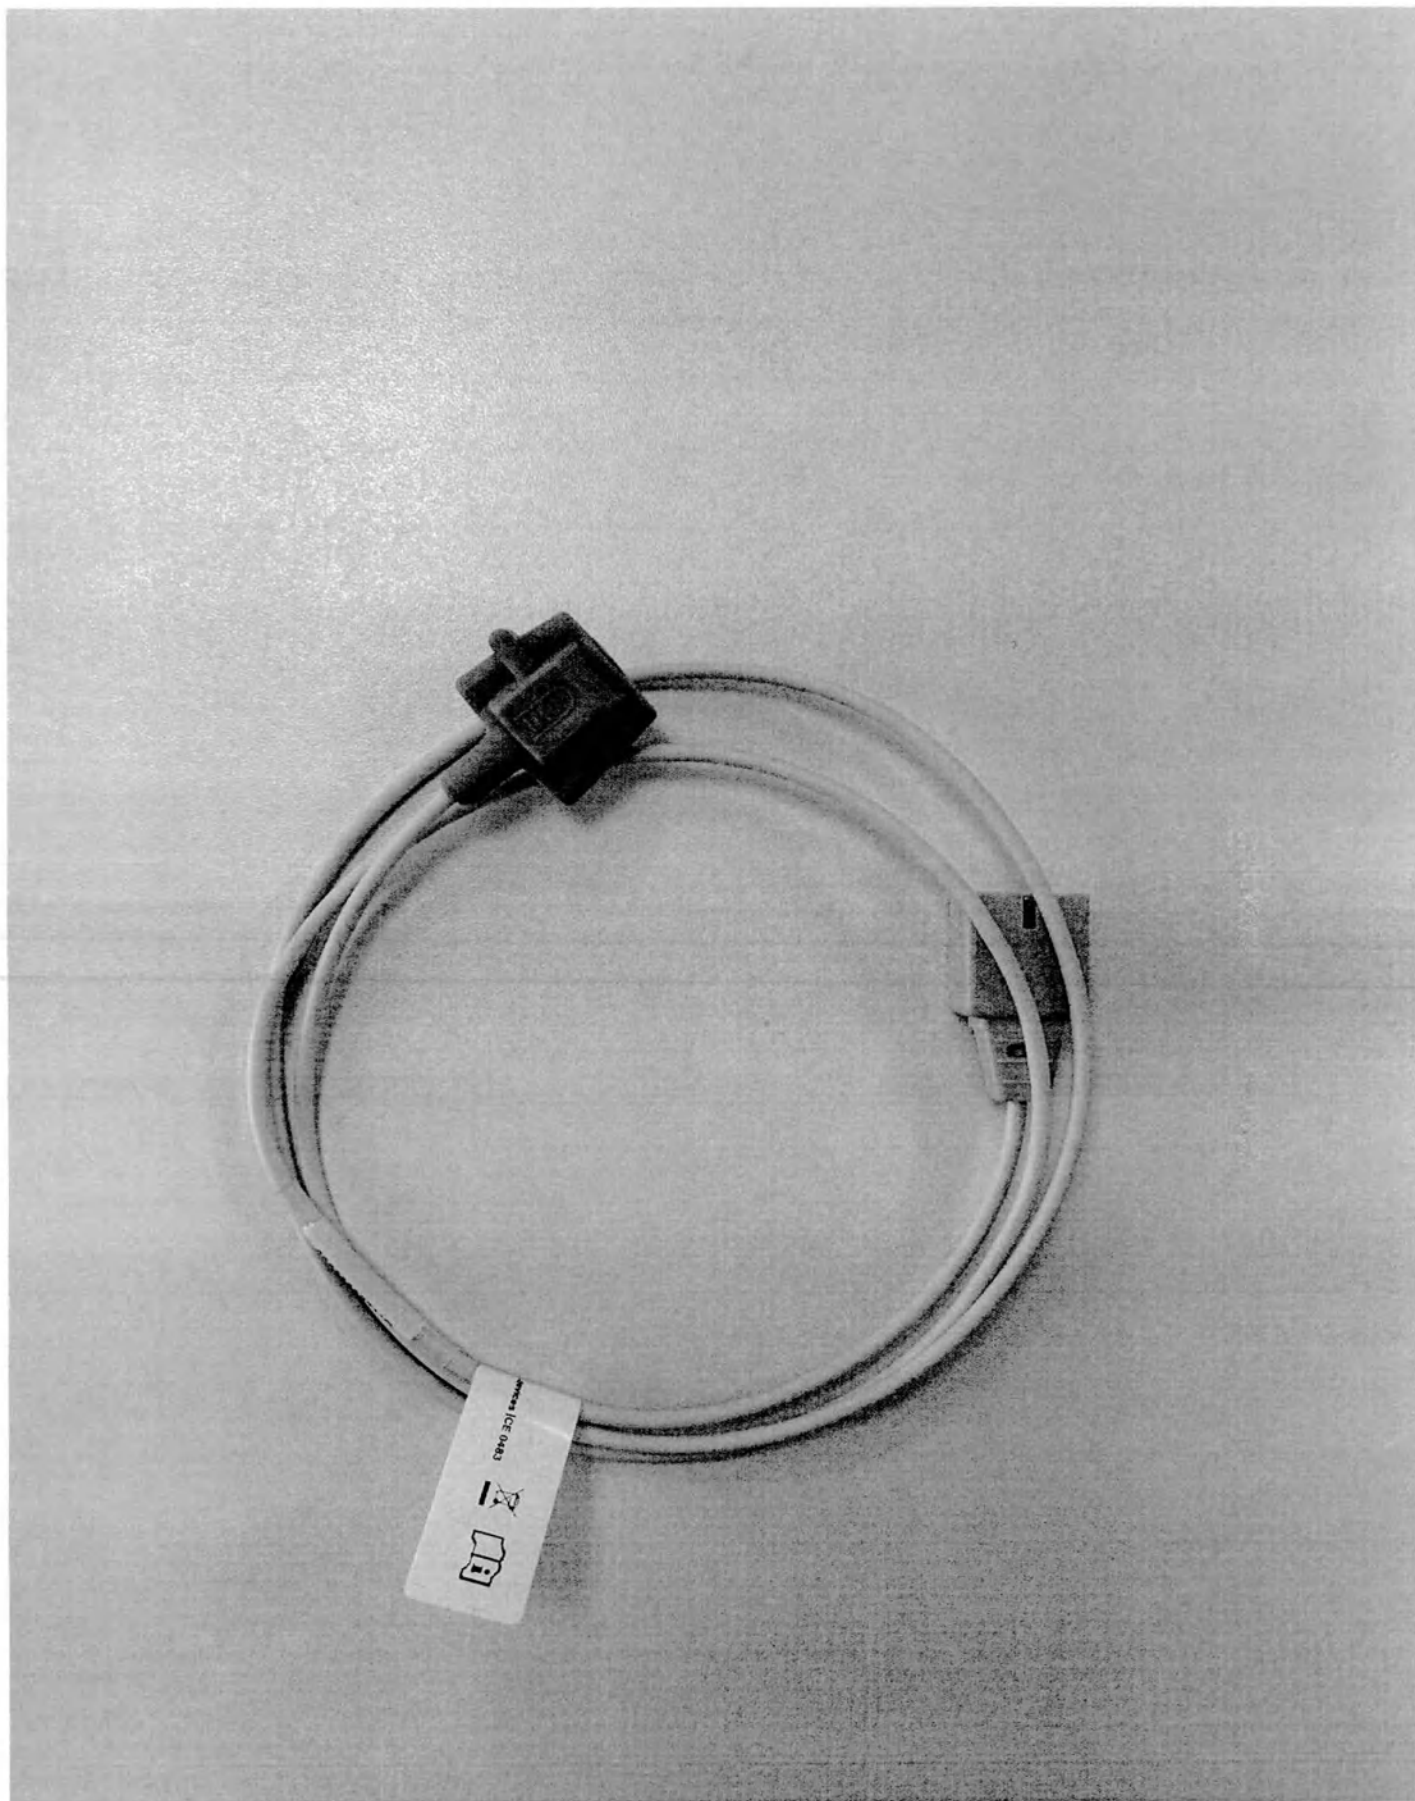


16. Детский датчик SpO₂, с DSUB коннектором, дети 4 – 40 кг

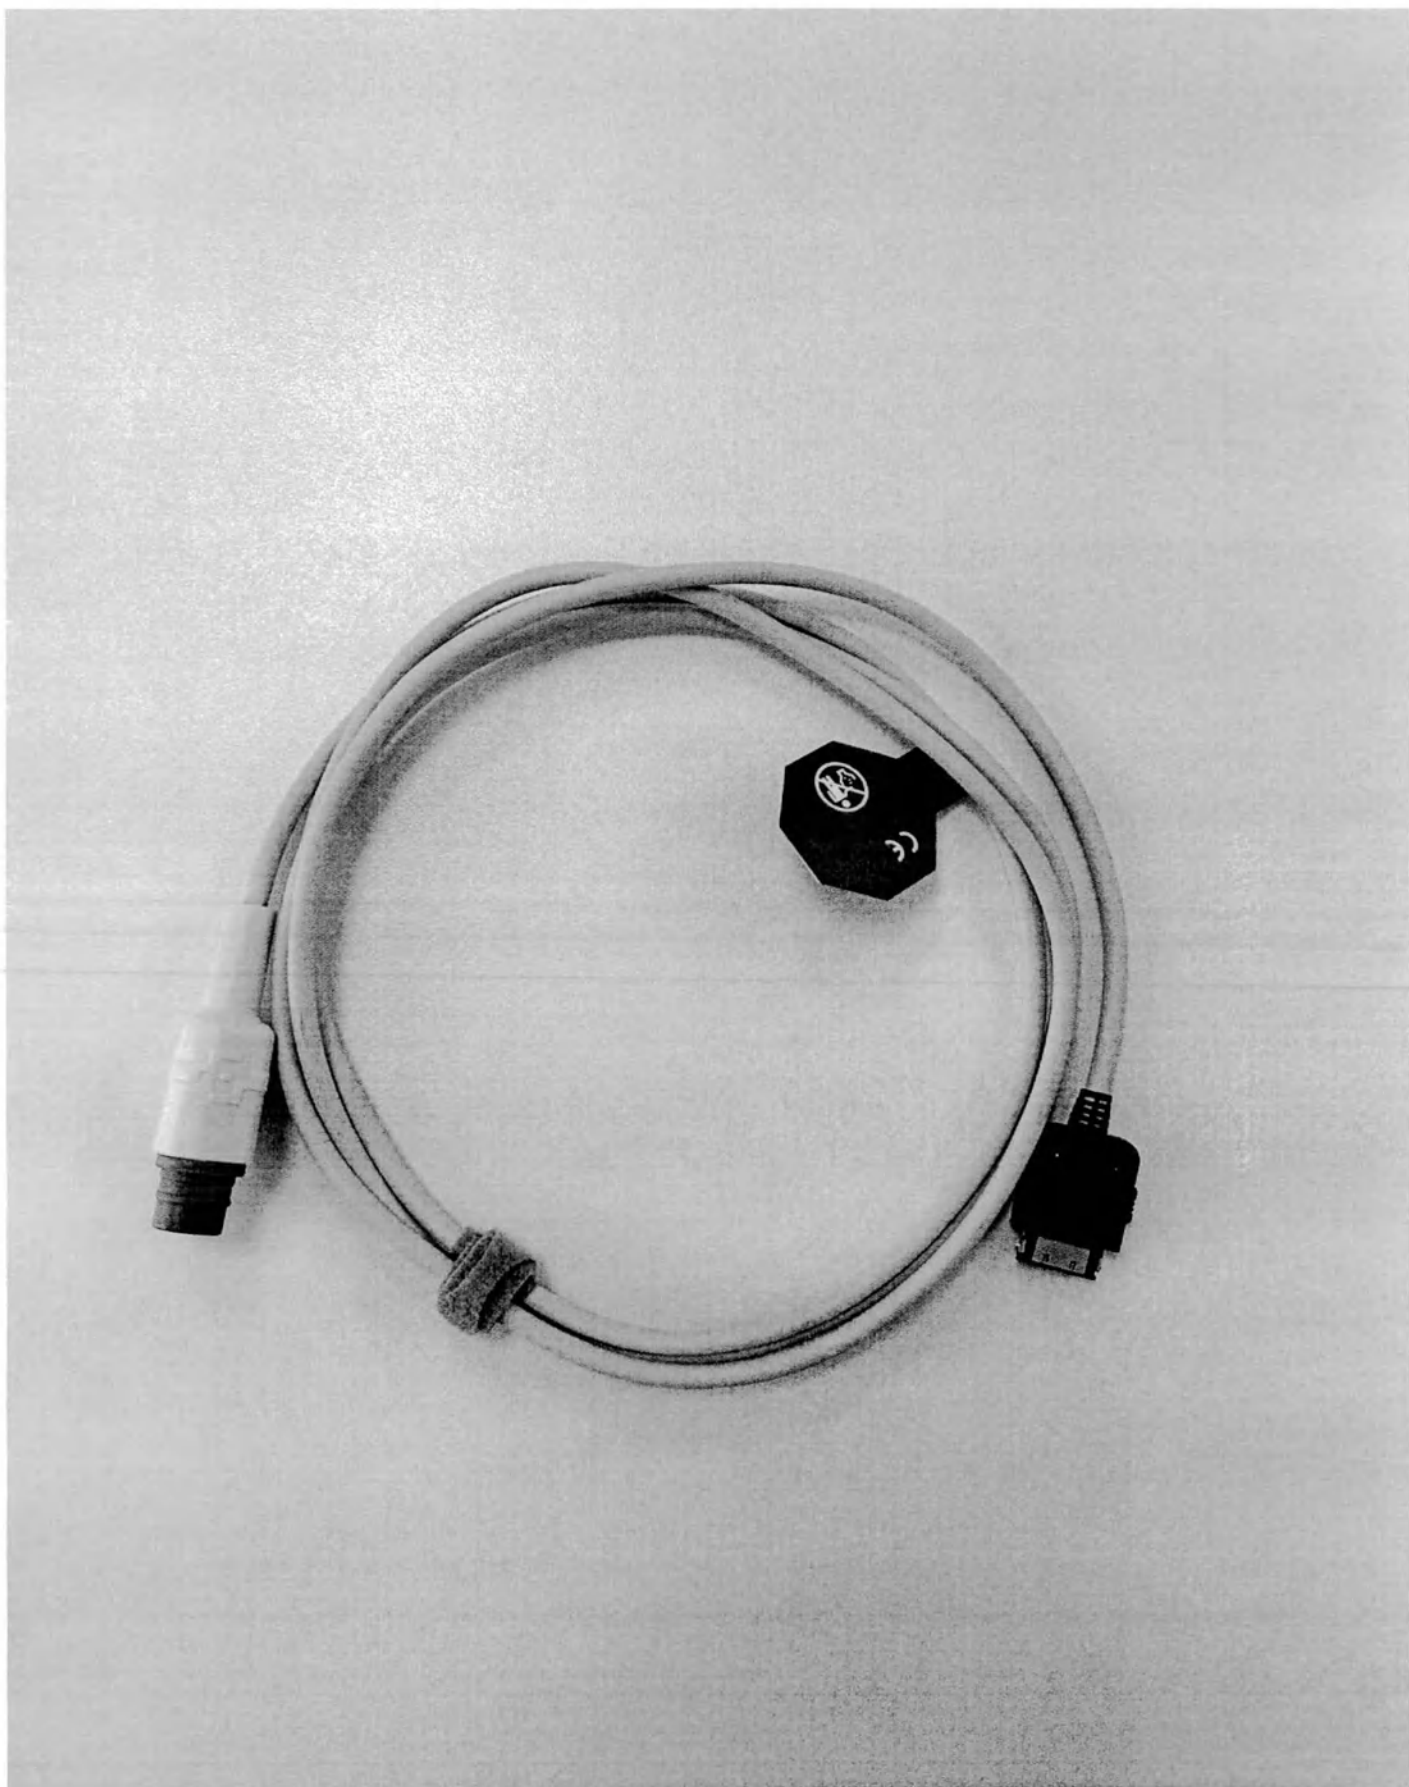


17. Удлинитель Hirose-Philips для аппарата и датчика SpO₂, для детей

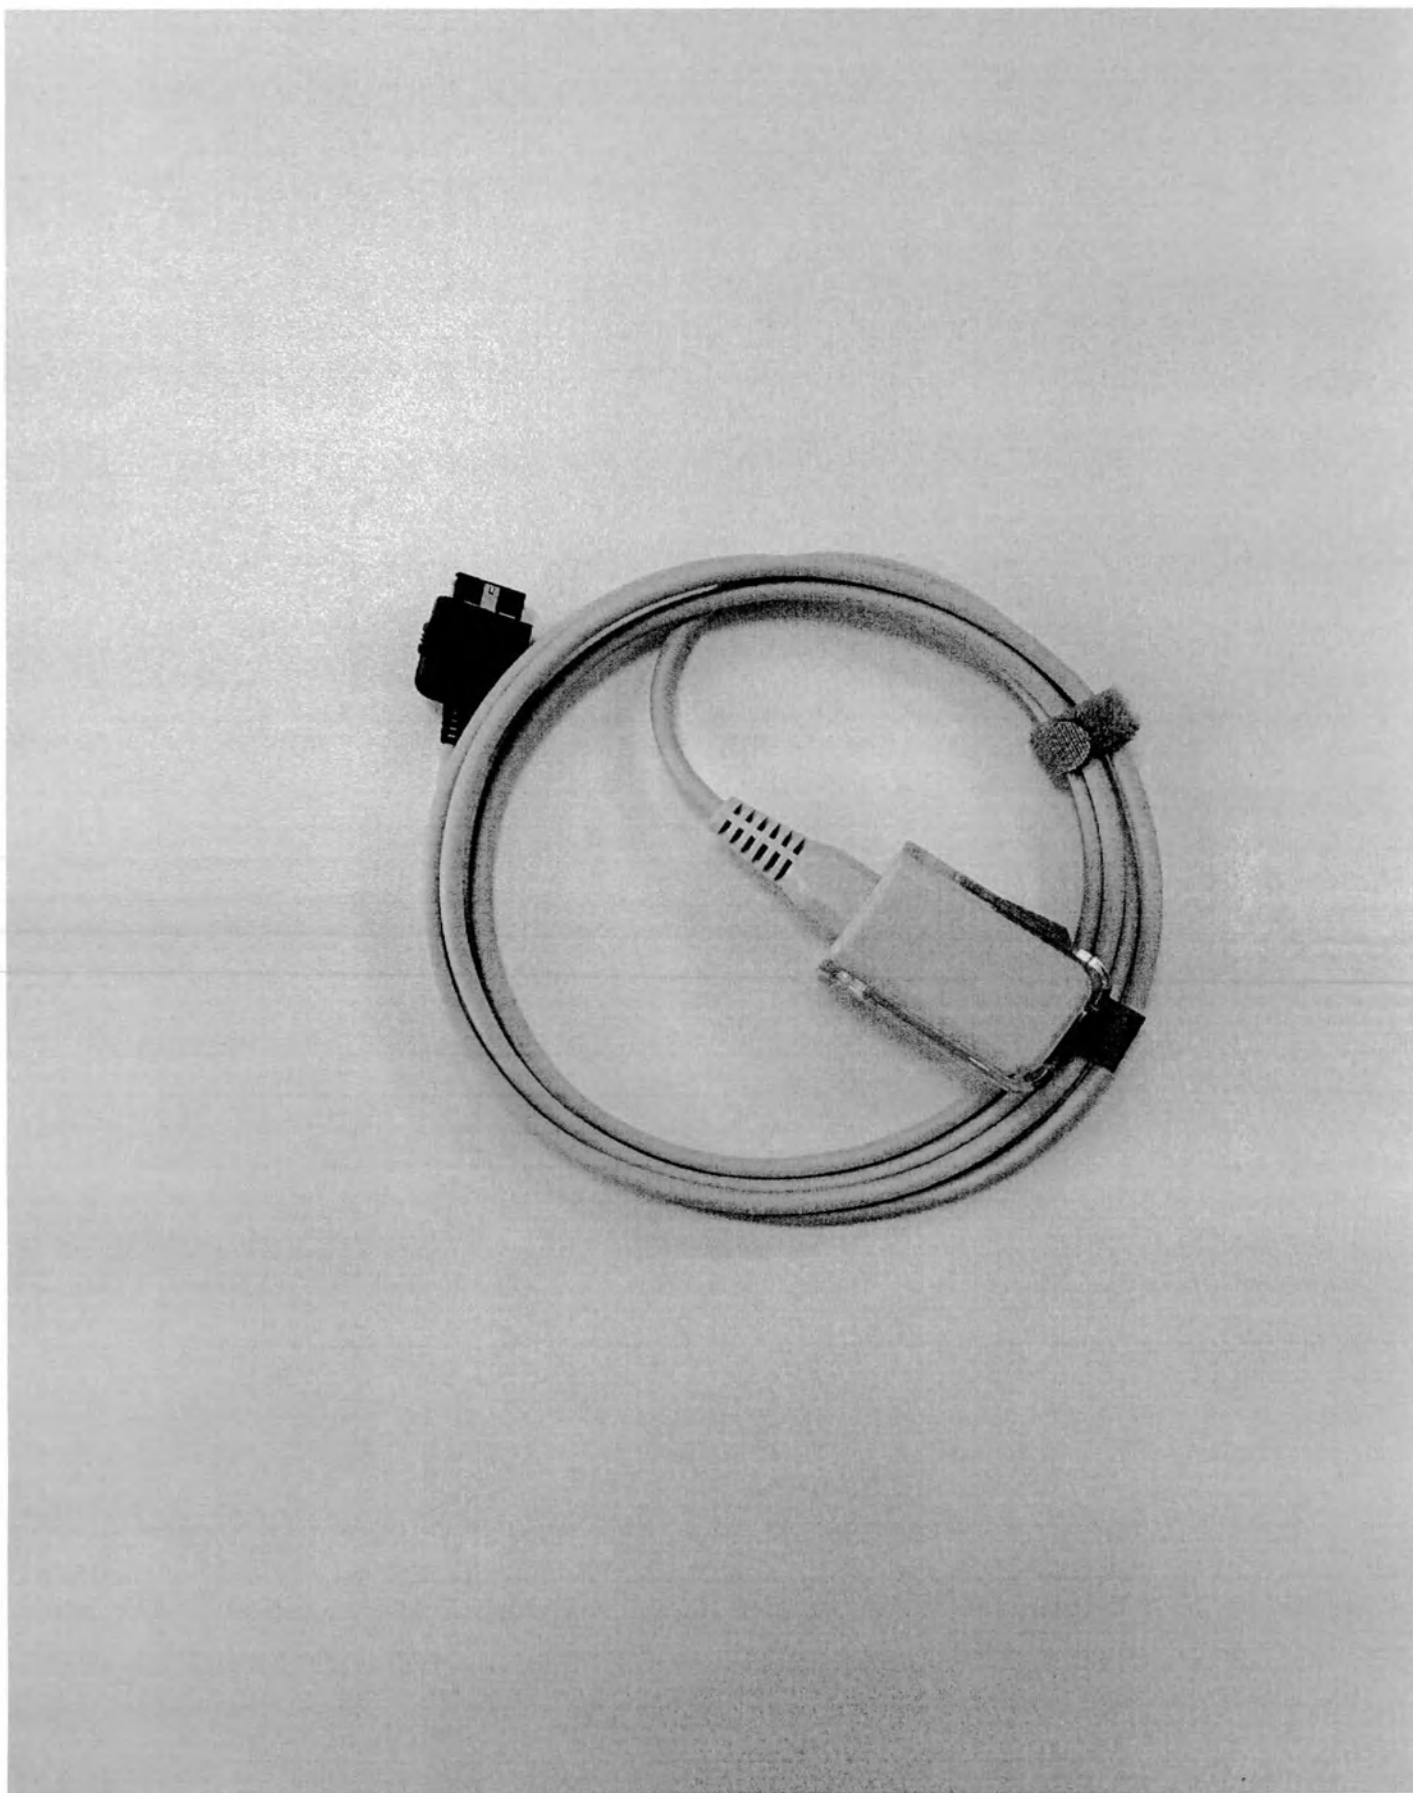

18. Удлинитель Hirose-DSUB, для аппарата и датчика SpO₂, для детей

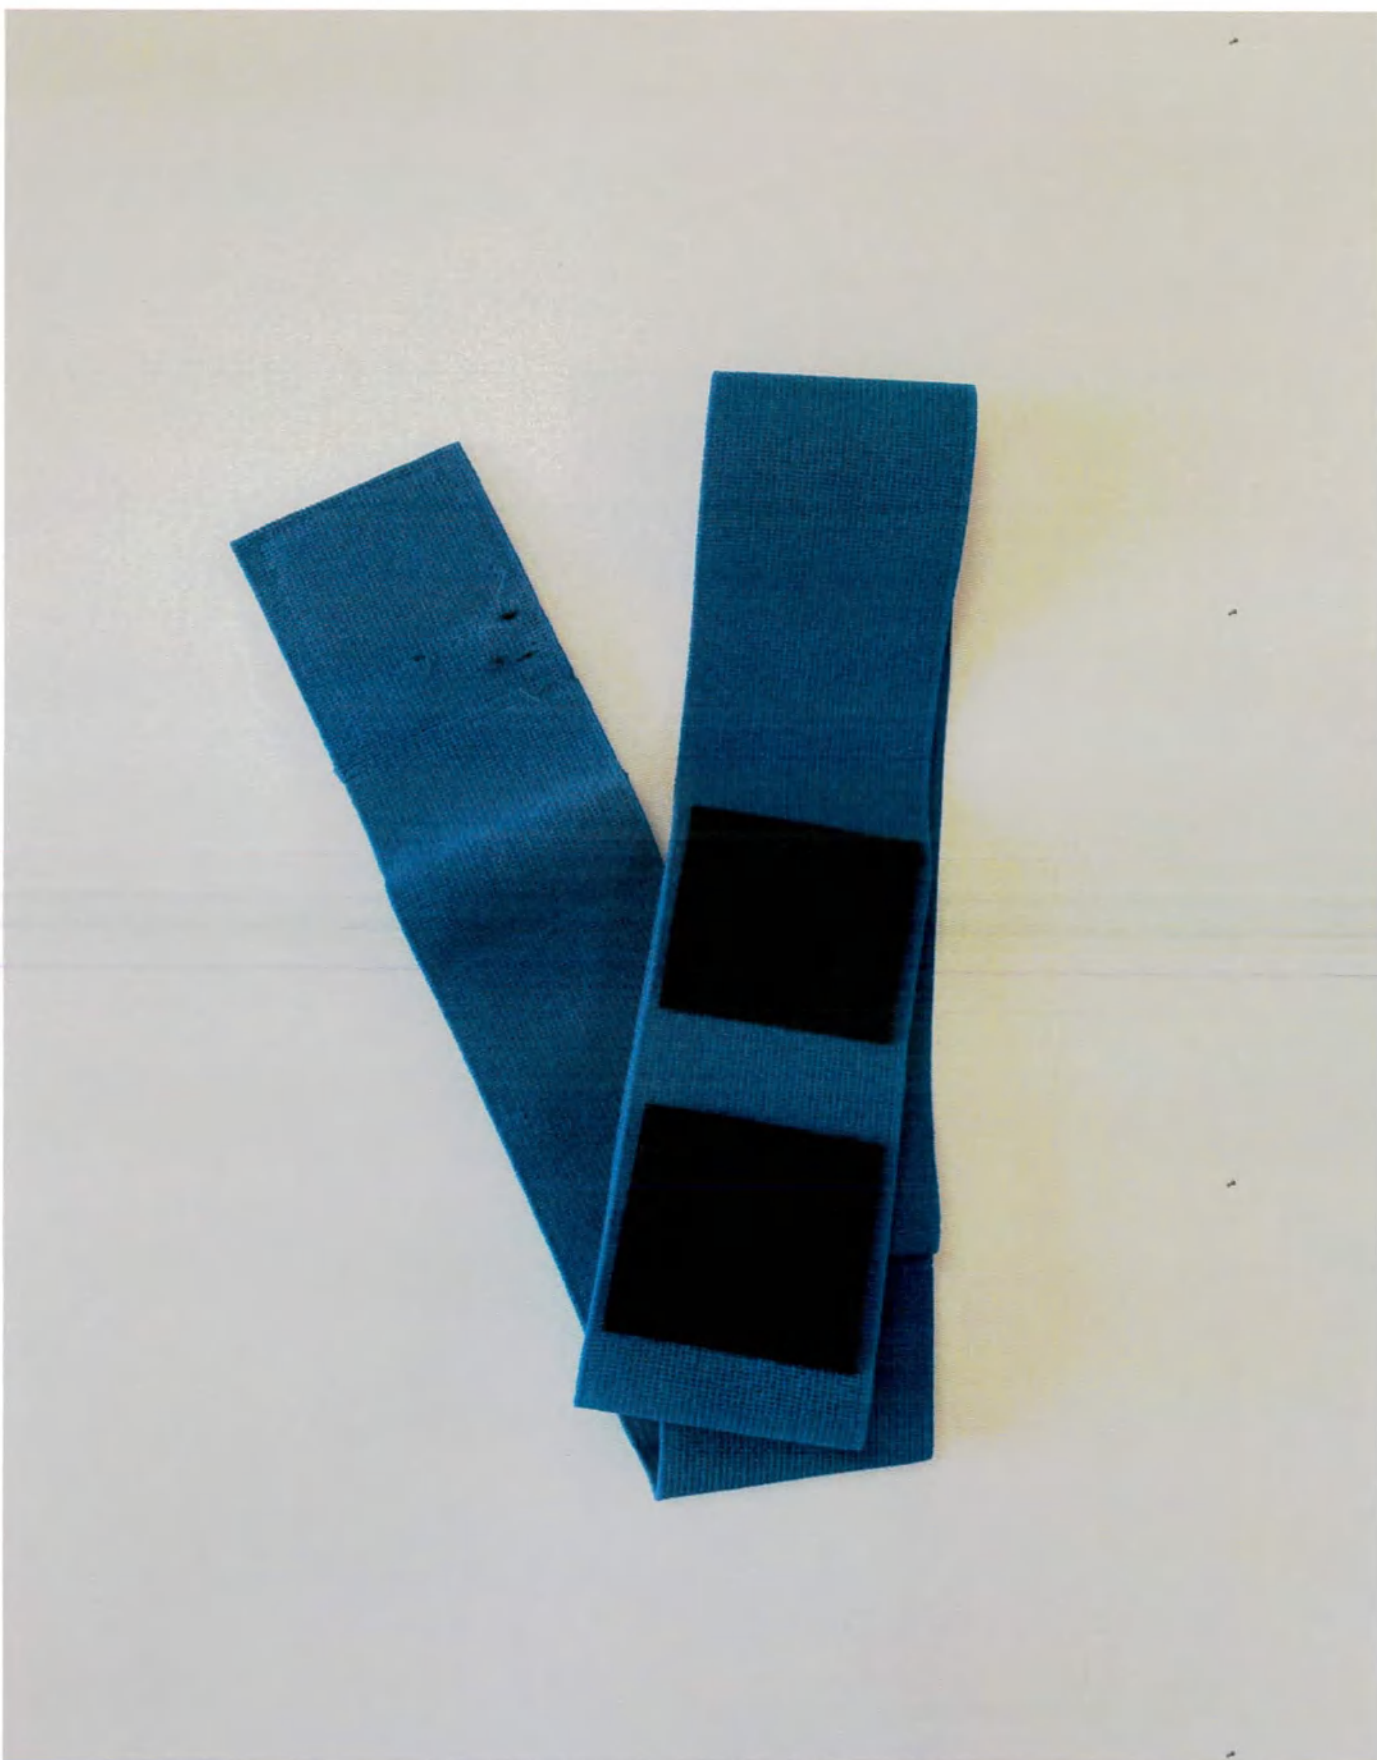

19. Ремень для переноски торакальный, гибкий, синий, Размер S

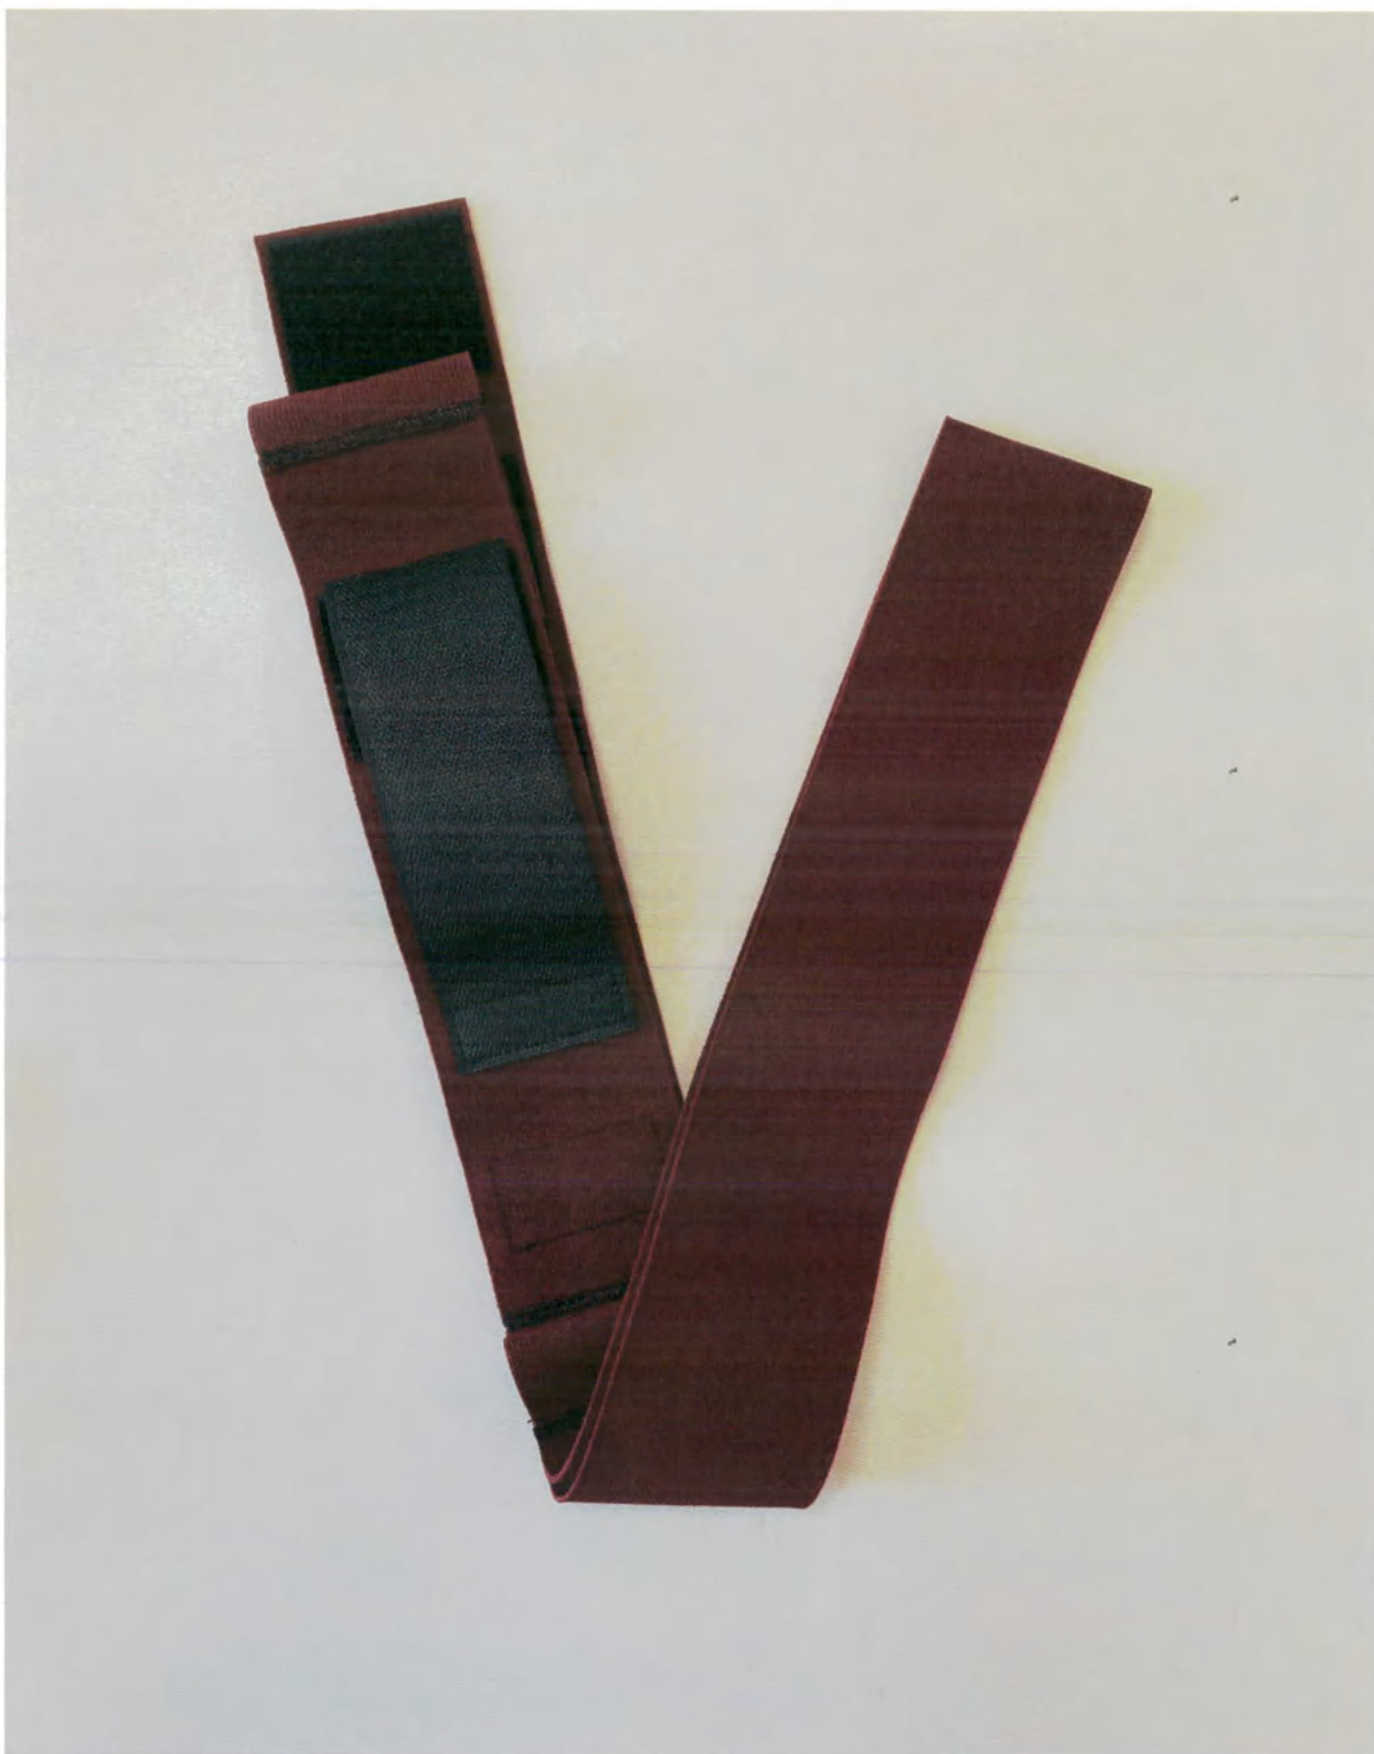

20. Ремень для переноски торакальный, гибкий, красный, Размер L




21. Торакальный ремень, размер XS



22. Торакальный ремень, размер XXS



23. Торакальный ремень, размер XXXS

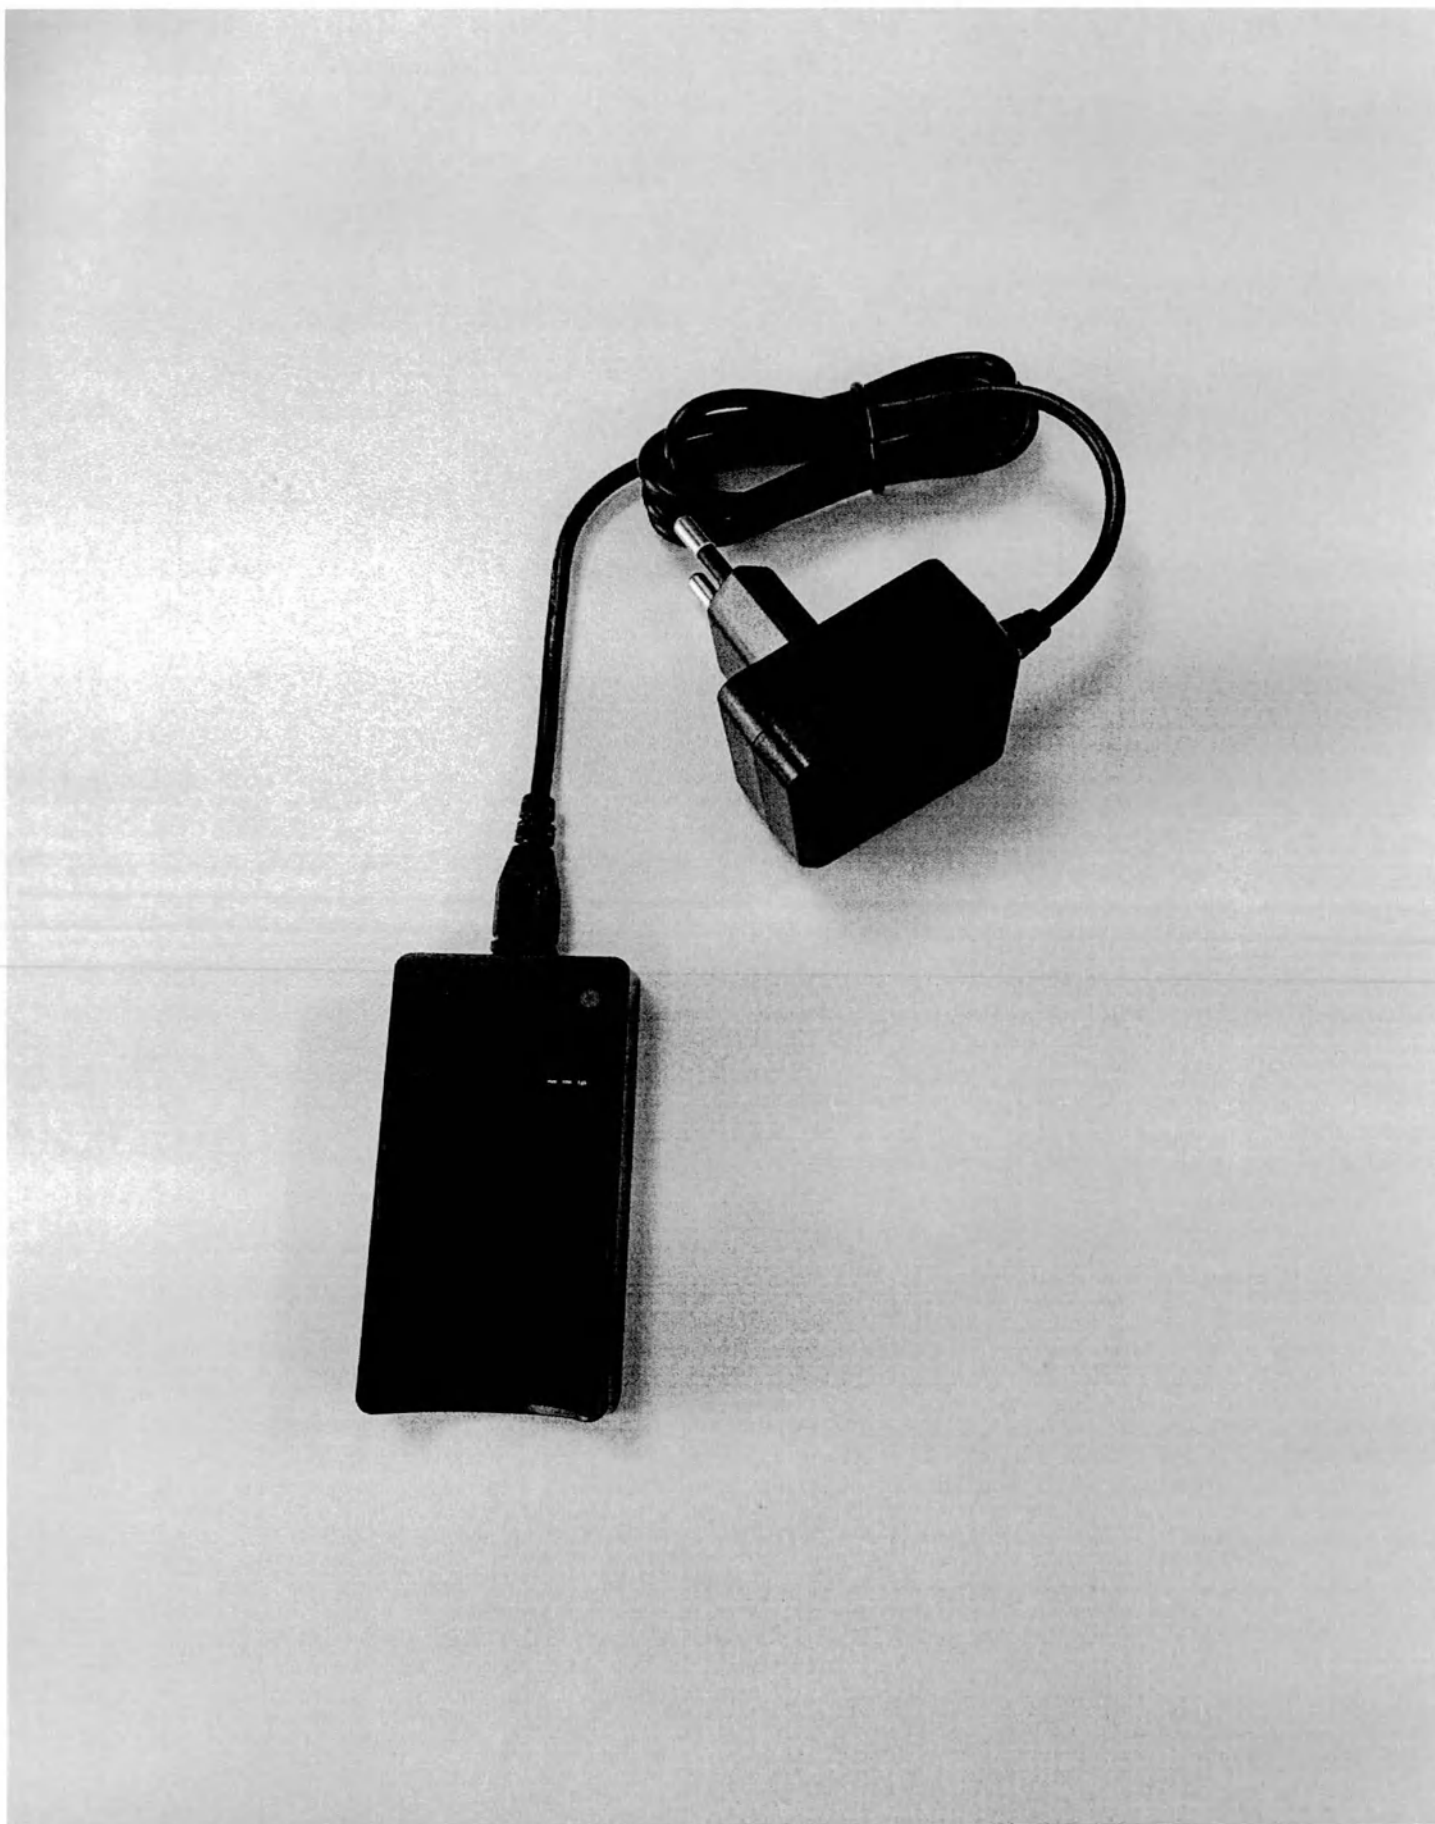

24. Зарядная станция для аккумулятора Samoa

В связи с маленьким размером аппаратов и невозможностью нанесения дополнительной маркировки в виде стикера на русском языке, вся необходимая информация будет представлена в инструкции по эксплуатации на медицинское изделие и на упаковке медицинского изделия и его комплектующих.



Рисунок 1 – Перевод макета маркировки медицинского изделия в варианте исполнения Samoa (основного блока)



Рисунок 2 - Перевод макета маркировки медицинского изделия в варианте исполнения Samoa lite (основного блока)

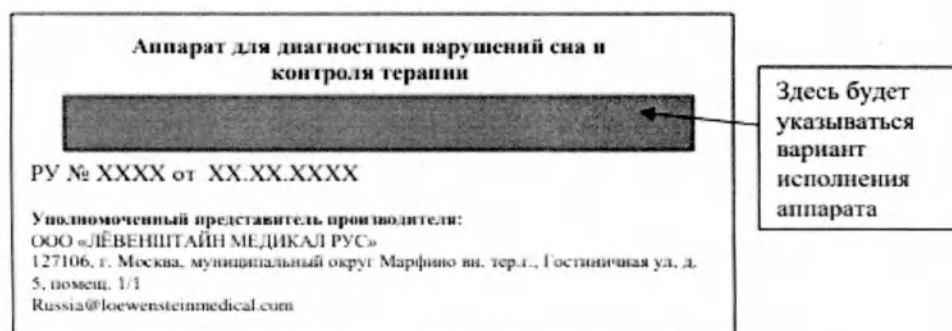


Рисунок 3 - Макет дополнительной маркировки транспортной упаковки аппарата на русском языке после прохождения процедуры государственной регистрации медицинского изделия

Аппарат для диагностики нарушений сна и контроля терапии РУ № XXXX от XX.XX.XXXX Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛЁВЕНШТАЙН МЕДИКАЛ РУС» 127106, г. Москва, муниципальный округ Марфино вн. тер.г., Гостиничная ул. д. 5, помещ. 1/1 Russia@loewensteinmedical.com	Здесь будет указываться вариант исполнения аппарата и наименование комплектующ их
--	--

Рисунок 4 - Макет дополнительной маркировки упаковки комплектующих аппарата после прохождения процедуры государственной регистрации медицинского изделия



Рисунок 5 – Фотоизображение транспортной упаковки аппарата



Рисунок 6 – Фотографическое изображение маркировки медицинского изделия в варианте исполнения Samoa (основного блока)

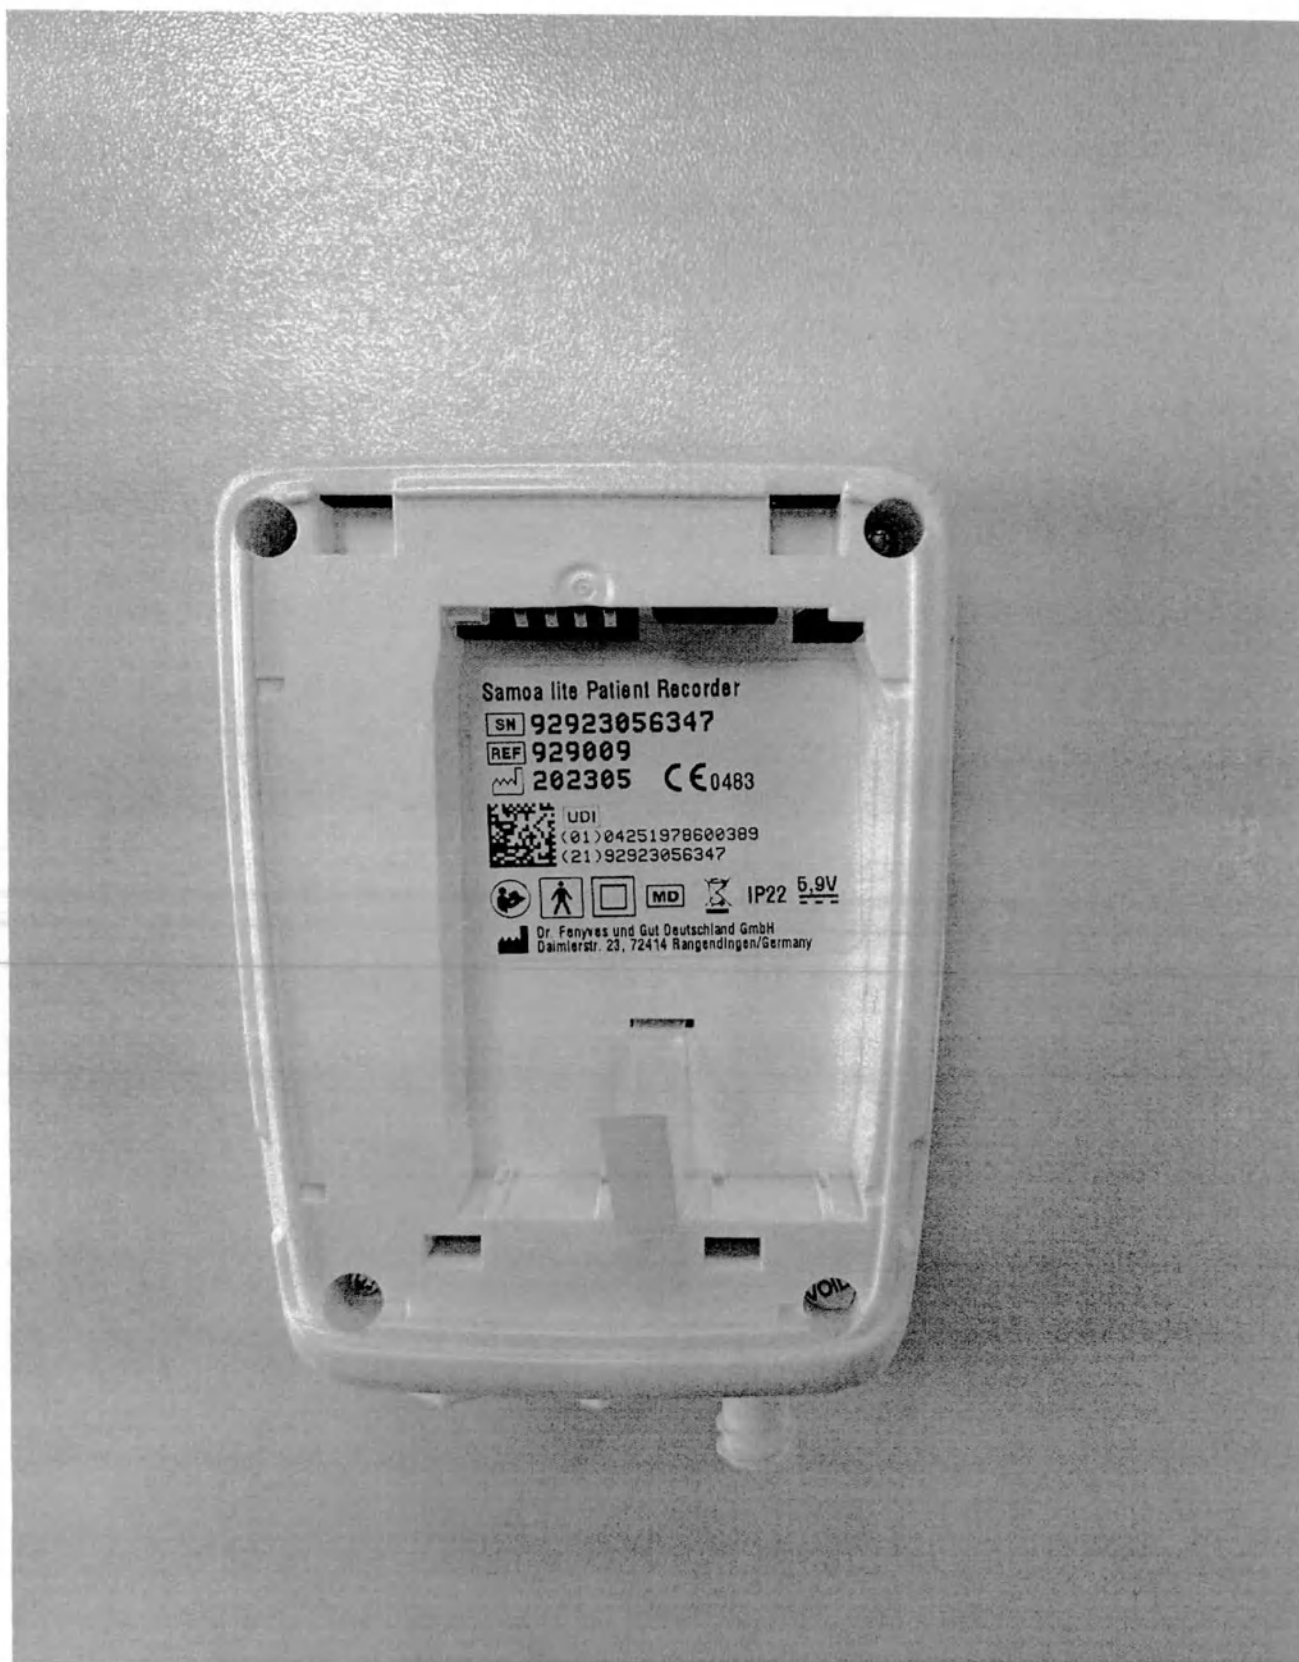


Рисунок 7 – Фотографическое изображение маркировки медицинского изделия в варианте исполнения Samoa lite (основного блока)

Всего пропущено и скреплено
печатью 65 листа (ов)

Бородина Н.Е.

