

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Пасифик Медикал Групп»

Ю.А. Кийко


2024 г.




Фотографические изображения изделия:

Жидкость обжимающая MCM Sheath I Medicside для диагностики in vitro

Changchun Medicside Medical Technology Co., Ltd.,
(Чанчунь Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

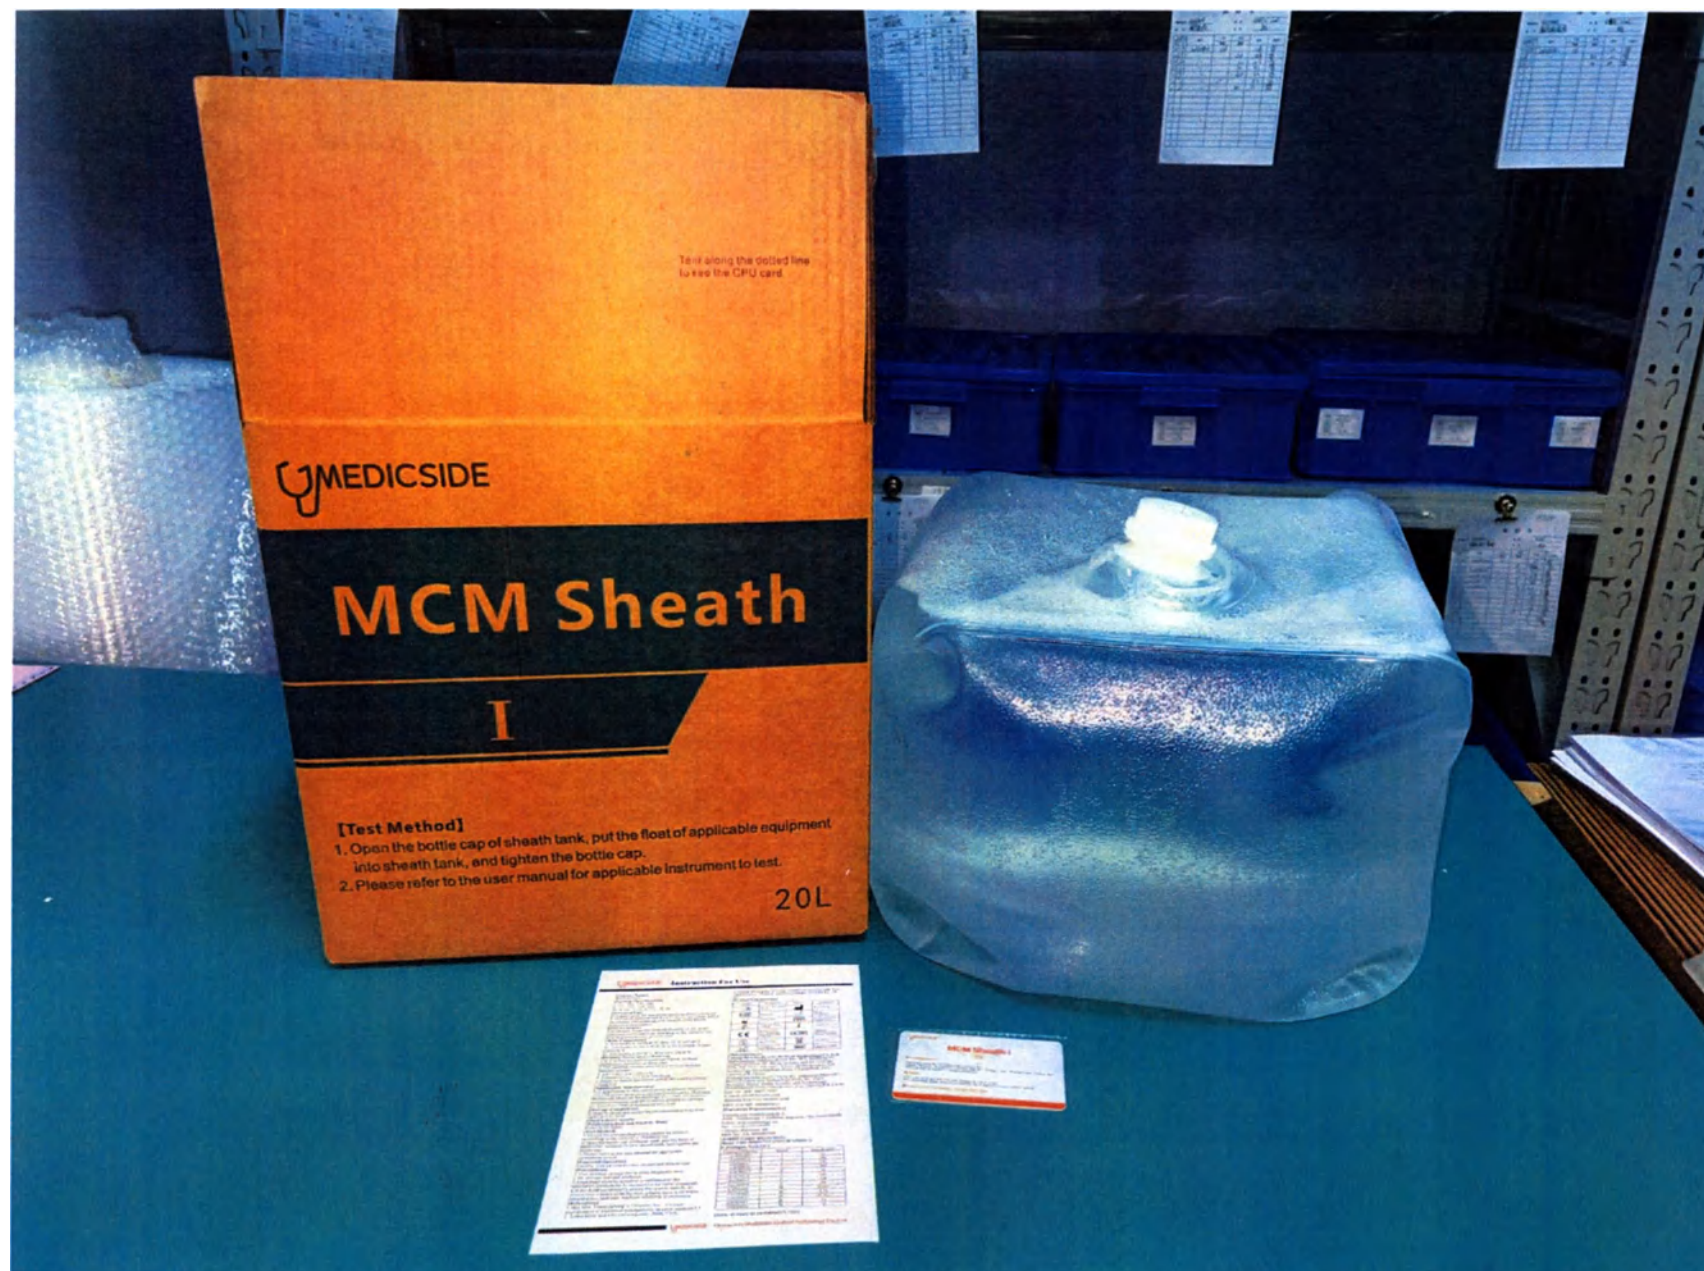


Общий вид МИ «Жидкость обжимающая MCM Sheath I Medicside для диагностики in vitro»

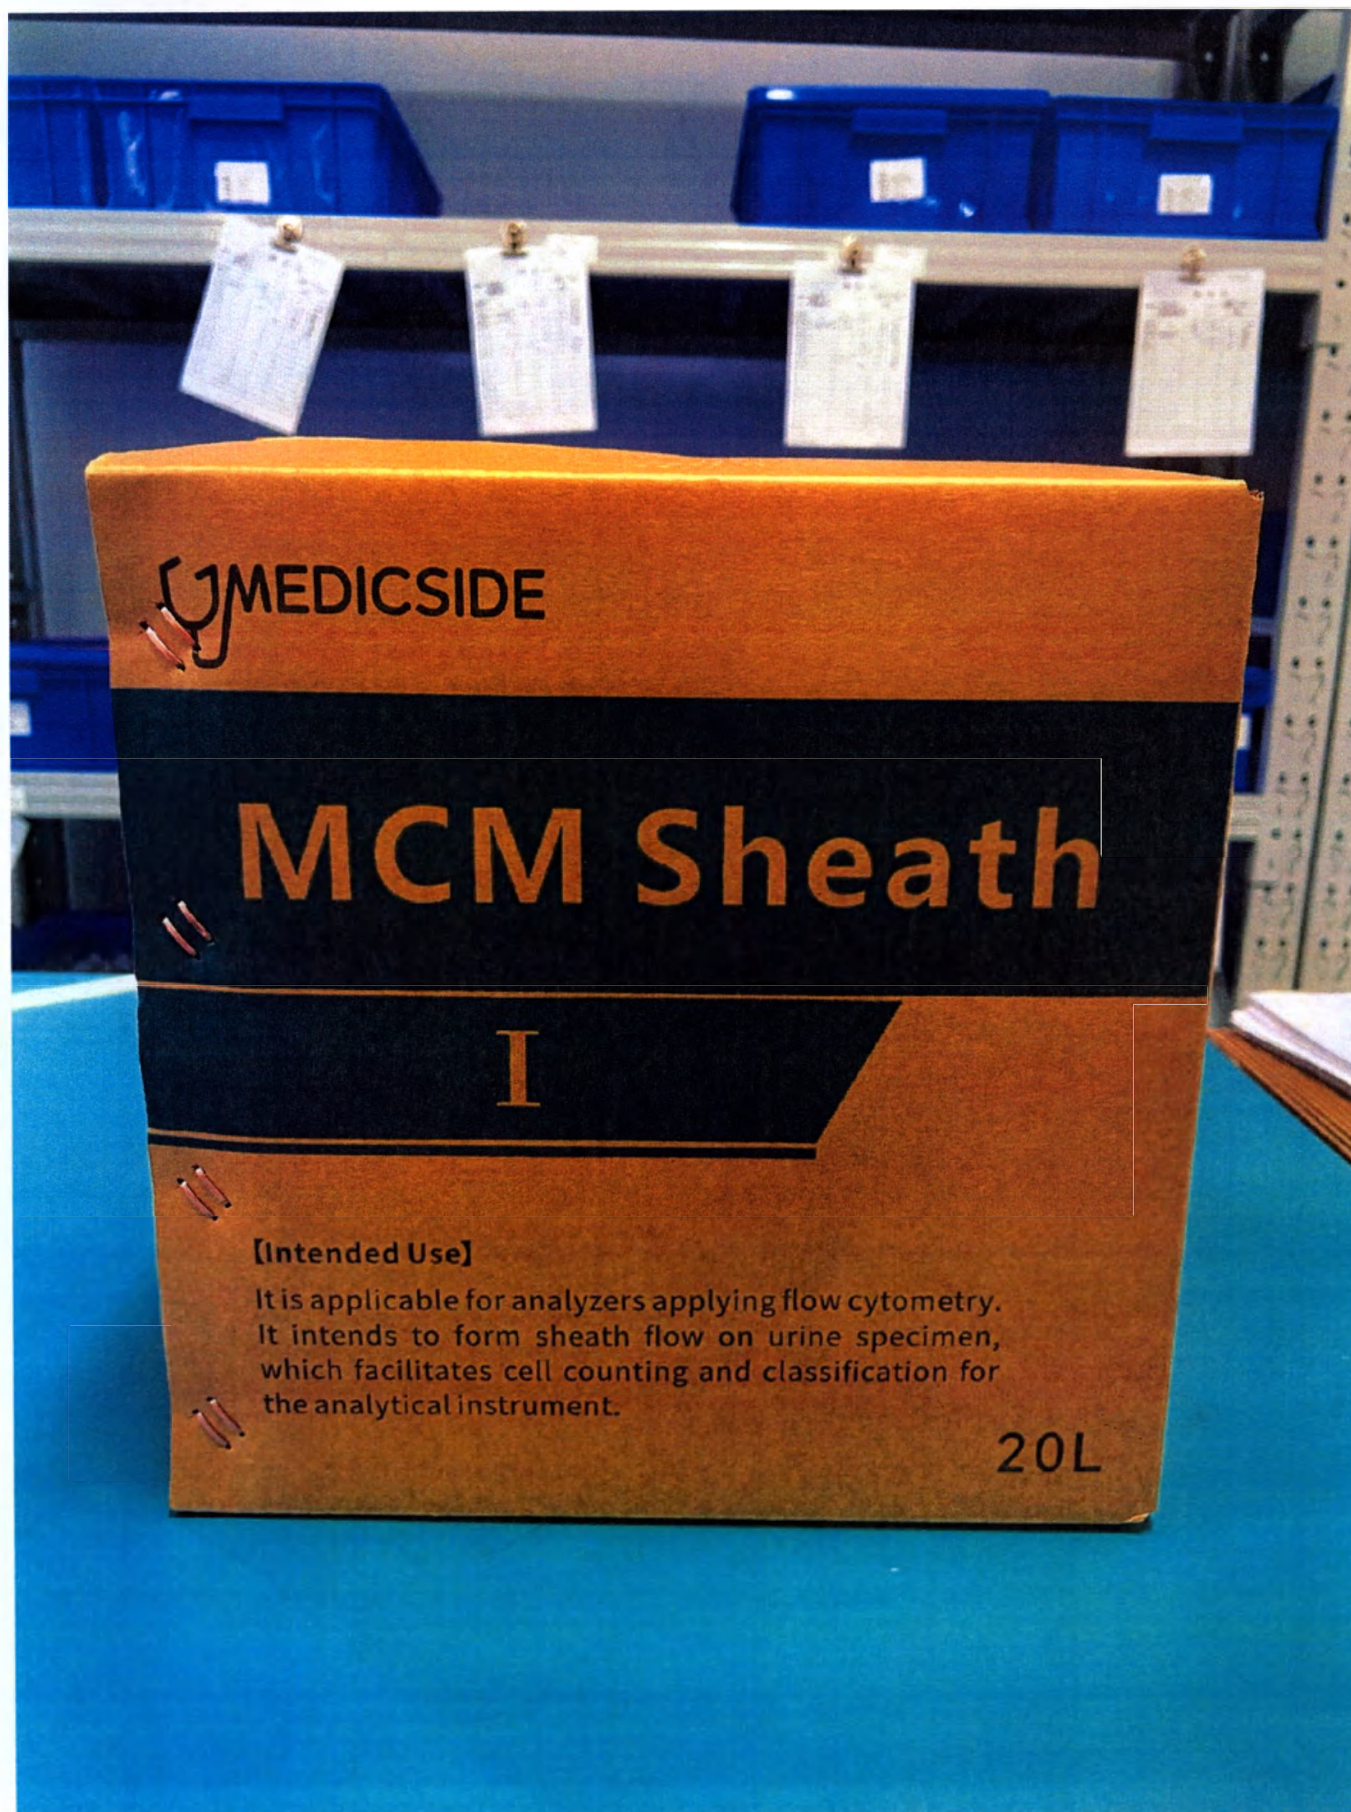


Оригинальная потребительская (транспортная) упаковка МИ «Жидкость обжимающая MCM Sheath I Medicside для диагностики in vitro»




Оригинальная потребительская (транспортная) упаковка МИ «Жидкость обжимающая MCM Sheath I Medicside для диагностики in vitro»

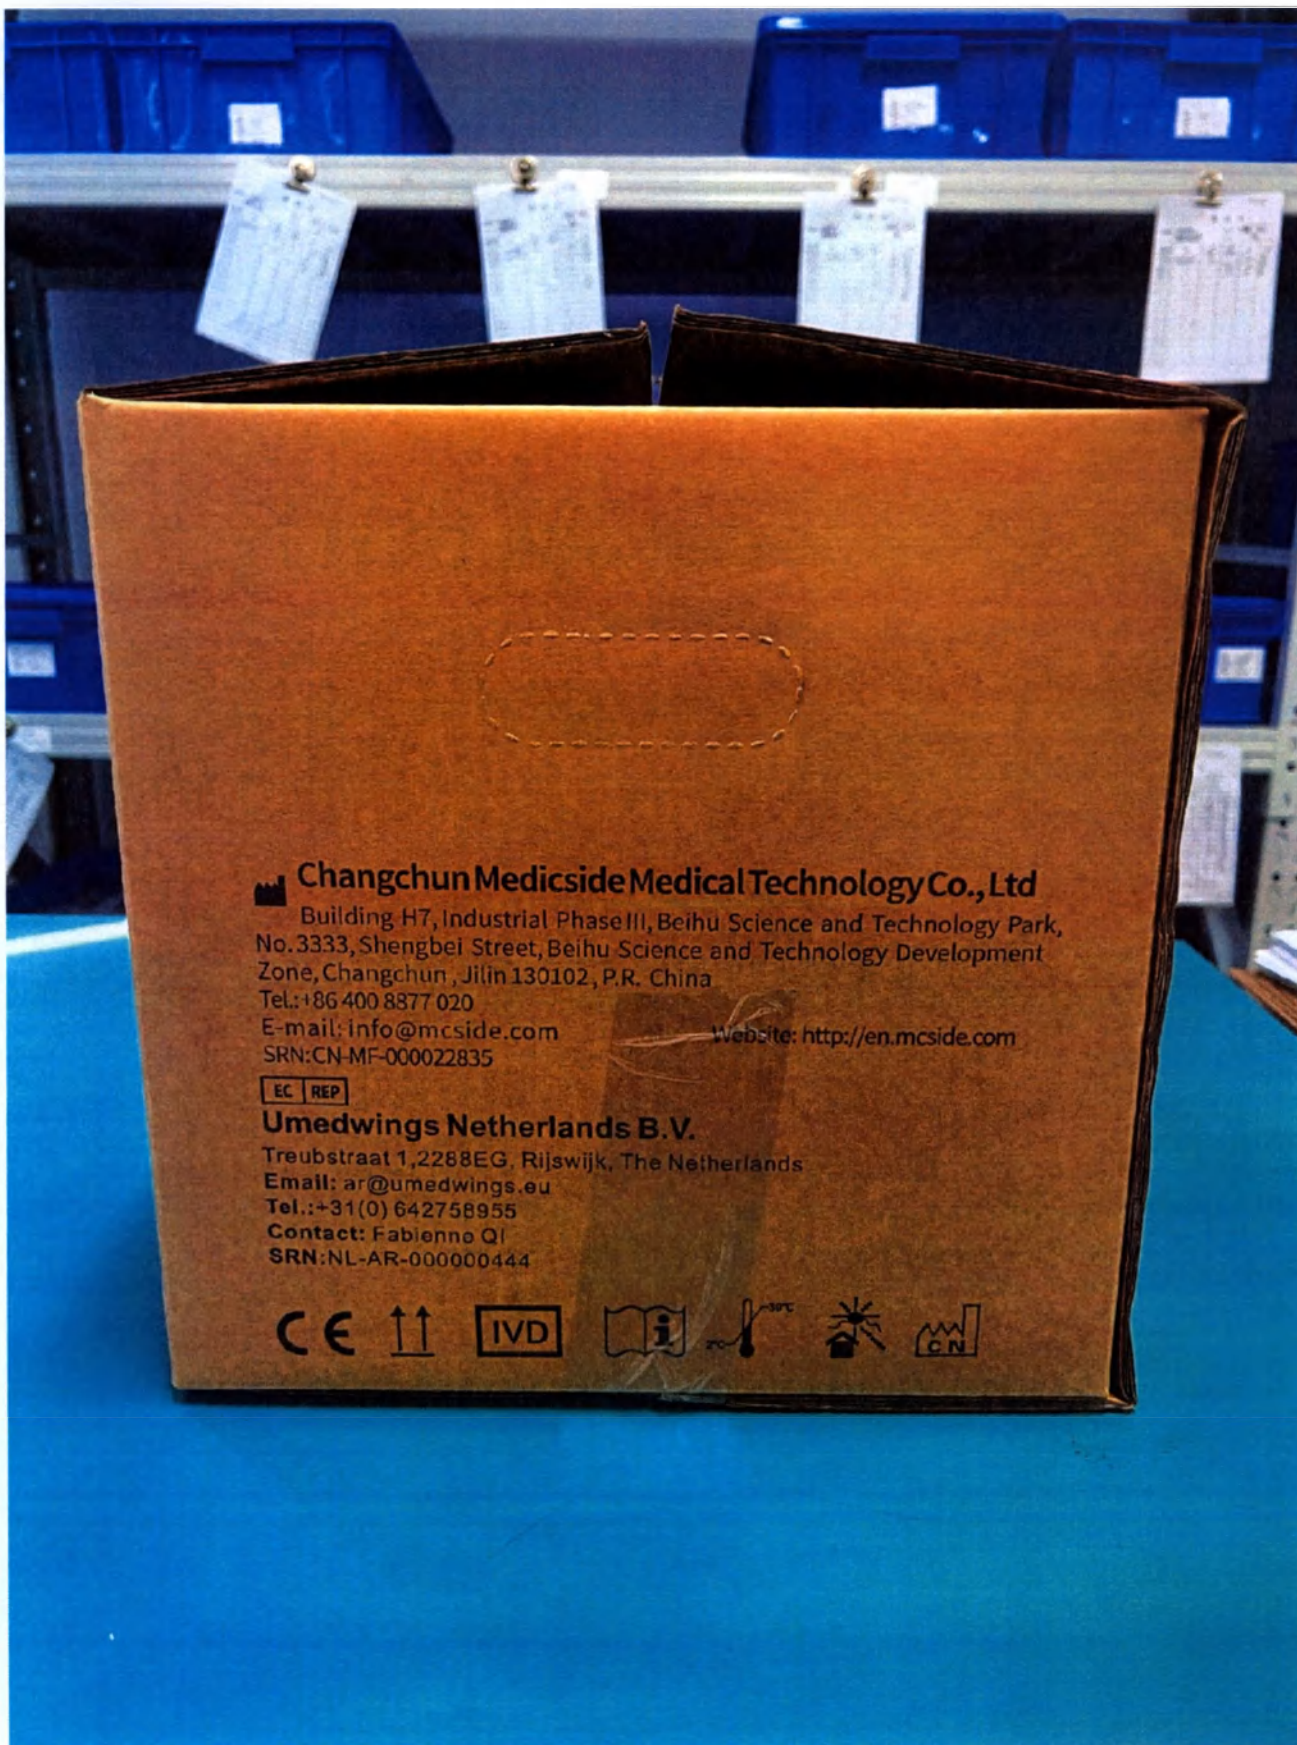

Оригинальная потребительская (транспортная) упаковка МИ «Жидкость обжимающая MCM Sheath I Medicside для диагностики in vitro»

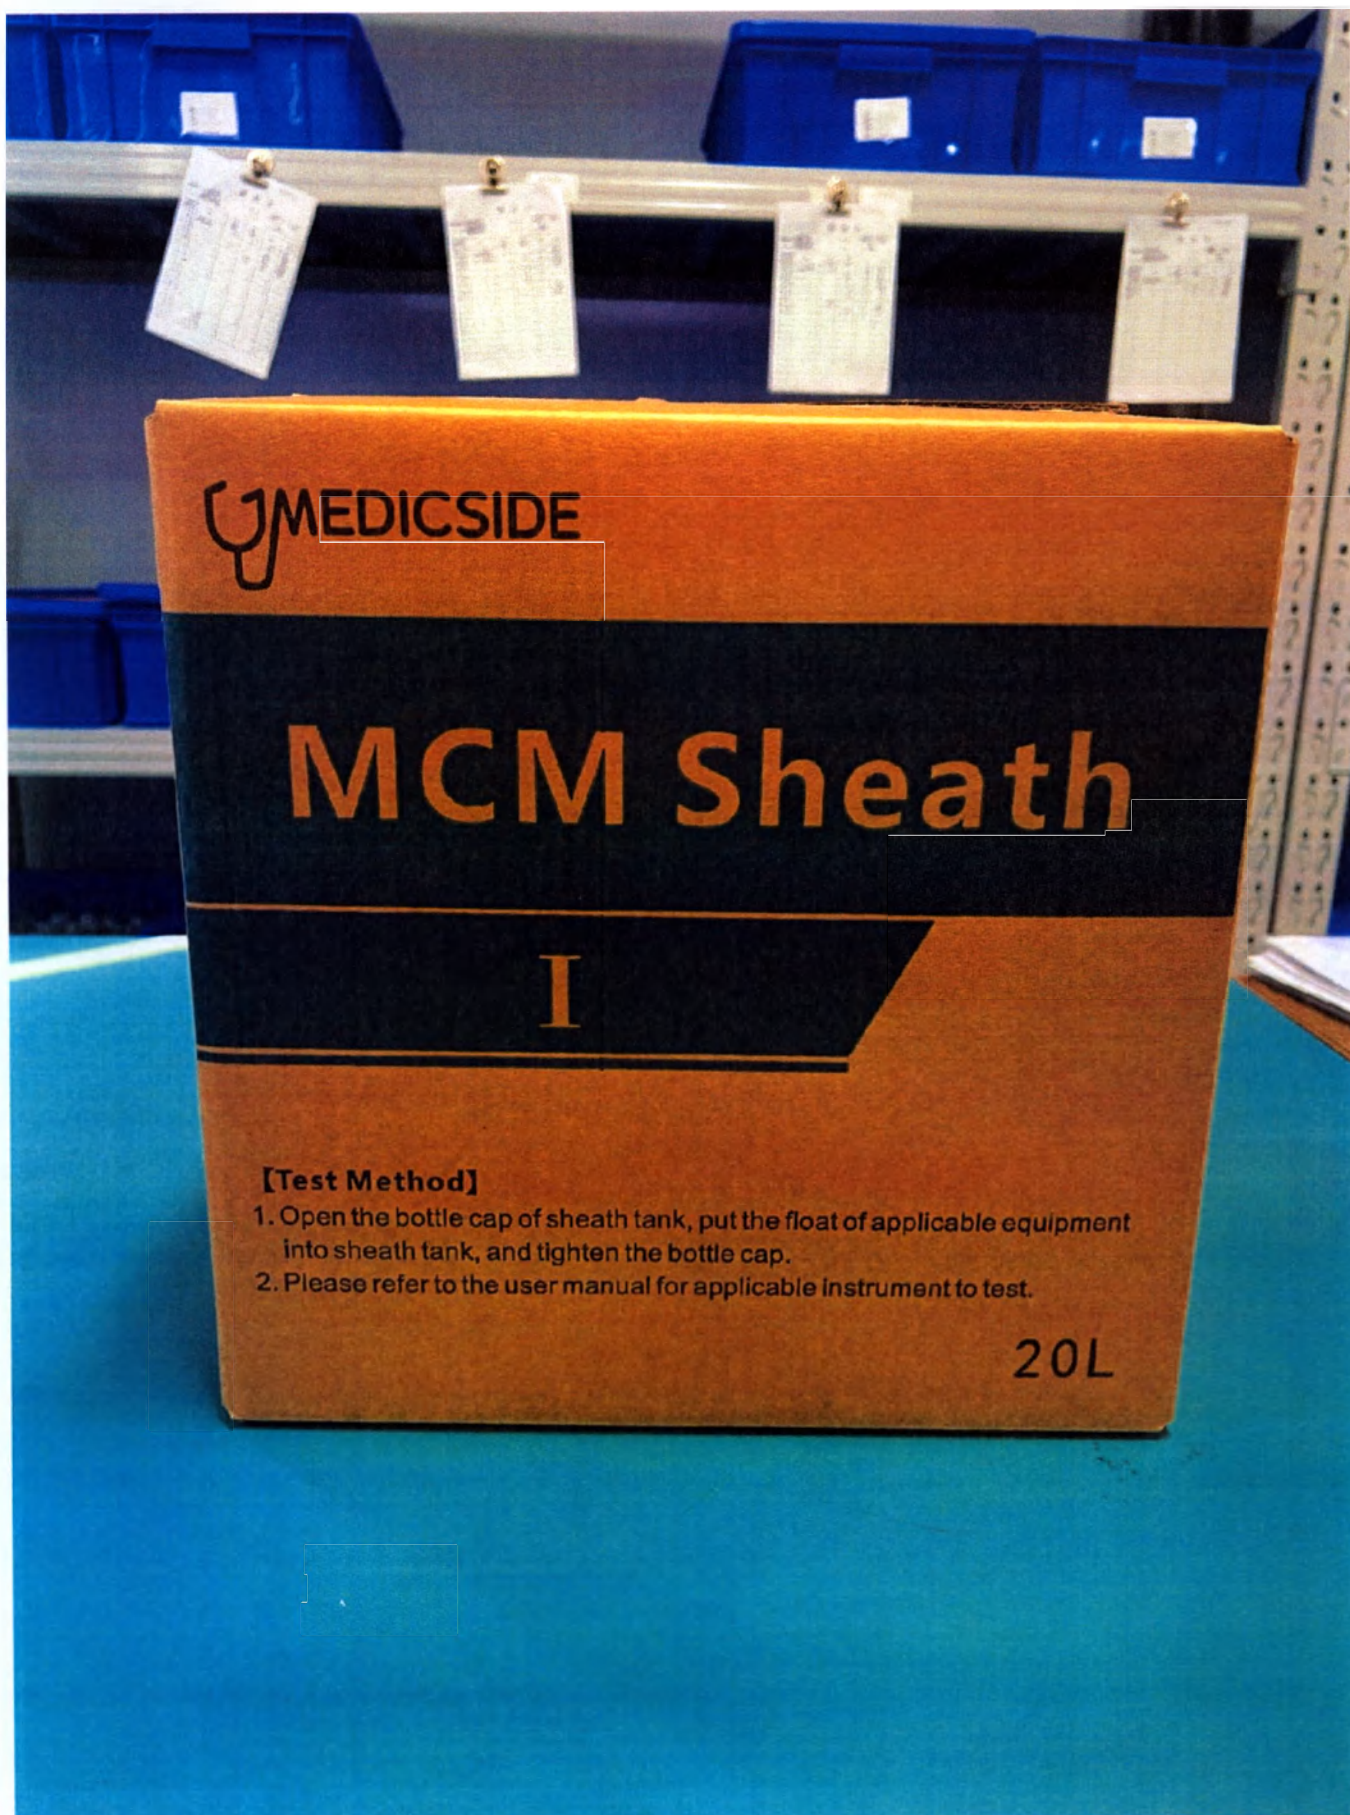

Оригинальная потребительская (транспортная) упаковка МИ «Жидкость обжимающая MCM Sheath I Medicside для диагностики in vitro»

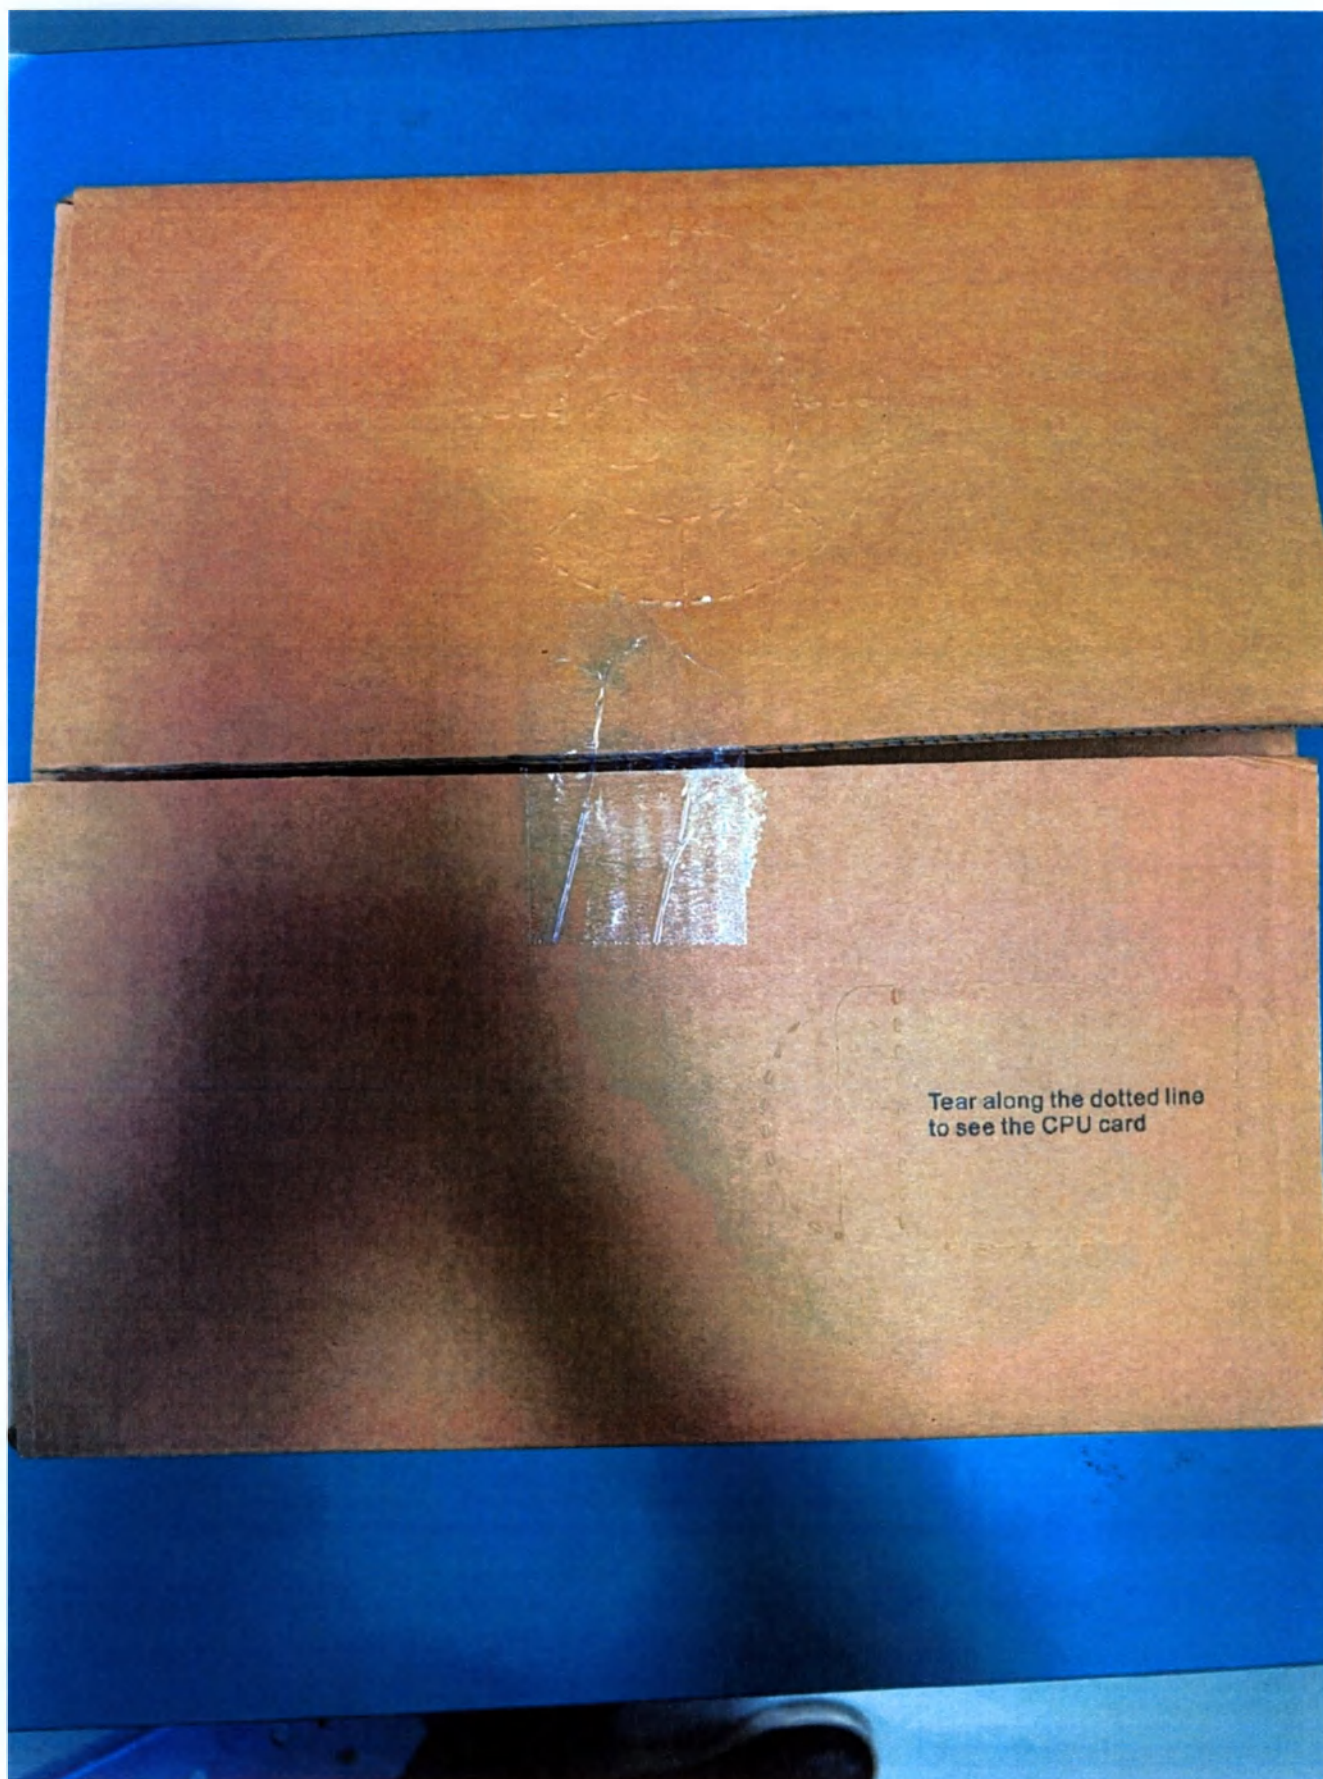

Оригинальная потребительская (транспортная) упаковка МИ «Жидкость обжимающая MCM Sheath I Medicside для диагностики in vitro»

 MEDICSIDE®

MCM Sheath I

20L

● **Charging process:**

1. Insert the card to the card reader at the computer end ;
2. Enter "Reagents Management" interface, click the "Charge" and "Read IC Card" button, then follow the pop-up interface to complete the process.

● **Notice:**

1. The card can be used only once, after charging, the card is invalid.
2. To avoid charge failure, please do not bend the card or expose it to strong magnetic material.

● **Customer Service Hotline: +86 400-8877-020**

Changchun Medicside Medical Technology Co., Ltd

Kapra MCM Sheath I

Артикул (REF): 410204012

Жидкость обжимающая MCM Sheath I Medicside для диагностики in vitro

Состав:

- Жидкость обжимающая MCM Sheath I – 20 л. х 1 шт.;
- Карта MCM Sheath I – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Информацию на этикетке считать приоритетной



масса нетто _____

масса брутто _____

габаритные размеры (ДхШхВ): _____

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Changchun Medicside Medical Technology Co., Ltd. (Чанчунь Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд), Китай

Room 701-707, Building 7, Changxinchuanggu, West of Beiyuanda Street and south of Longhu Road, Beihu Science and Technology Development Zone, Changchun, Jilin 130052, P.R.China.



Назначение и последовательность этапов проведения анализа смотри в инструкции по применению

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Макет этикетки на потребительской (транспортной) упаковке

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 9 листа (-ов)

Генеральный директор *Кишир* Ю.А. Кийко
М.П.

