


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Пасифик Медикал Групп»



Ю.А. Кийко

«25» ноября 2024 г.



Фотографические изображения изделия:

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.
(Чжэцзян Мединксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай




Общий вид изделия в полной комплектации



Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи СА-500

Urine Analyzer

 MEDICSIDE

Model: CA-500

Specification: 603mm×757mm×762mm

Input: ~100-240V 50-60Hz Power: 200VA


S/N: NCA500202307030006

 : 05.12.2023

 : Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

2nd Floor, No.66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan County,
Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China.


Tel: +86 400 8877 020 E-mail: info@meside.com <http://en.meside.com>

 Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, the Netherlands

SRN: NL-AR-000000444

EMDN: W05030580



Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи CA-500 (оригинальная маркировка)

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи CA-500

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Род источника питания: переменный ток

100-240В, 50Гц/60Гц, 200 ВА

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4

Информацию на этикетке считать приоритетной




Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiasha


Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China



Информацию о дате производства анализатора, серийном номере анализатора и остальные графические символы см. на оригинальной маркировке

Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи CA-500 (макет этикетки на русском языке)

ЛАЗЕРНАЯ
АППАРАТУРА
КЛАССА 1

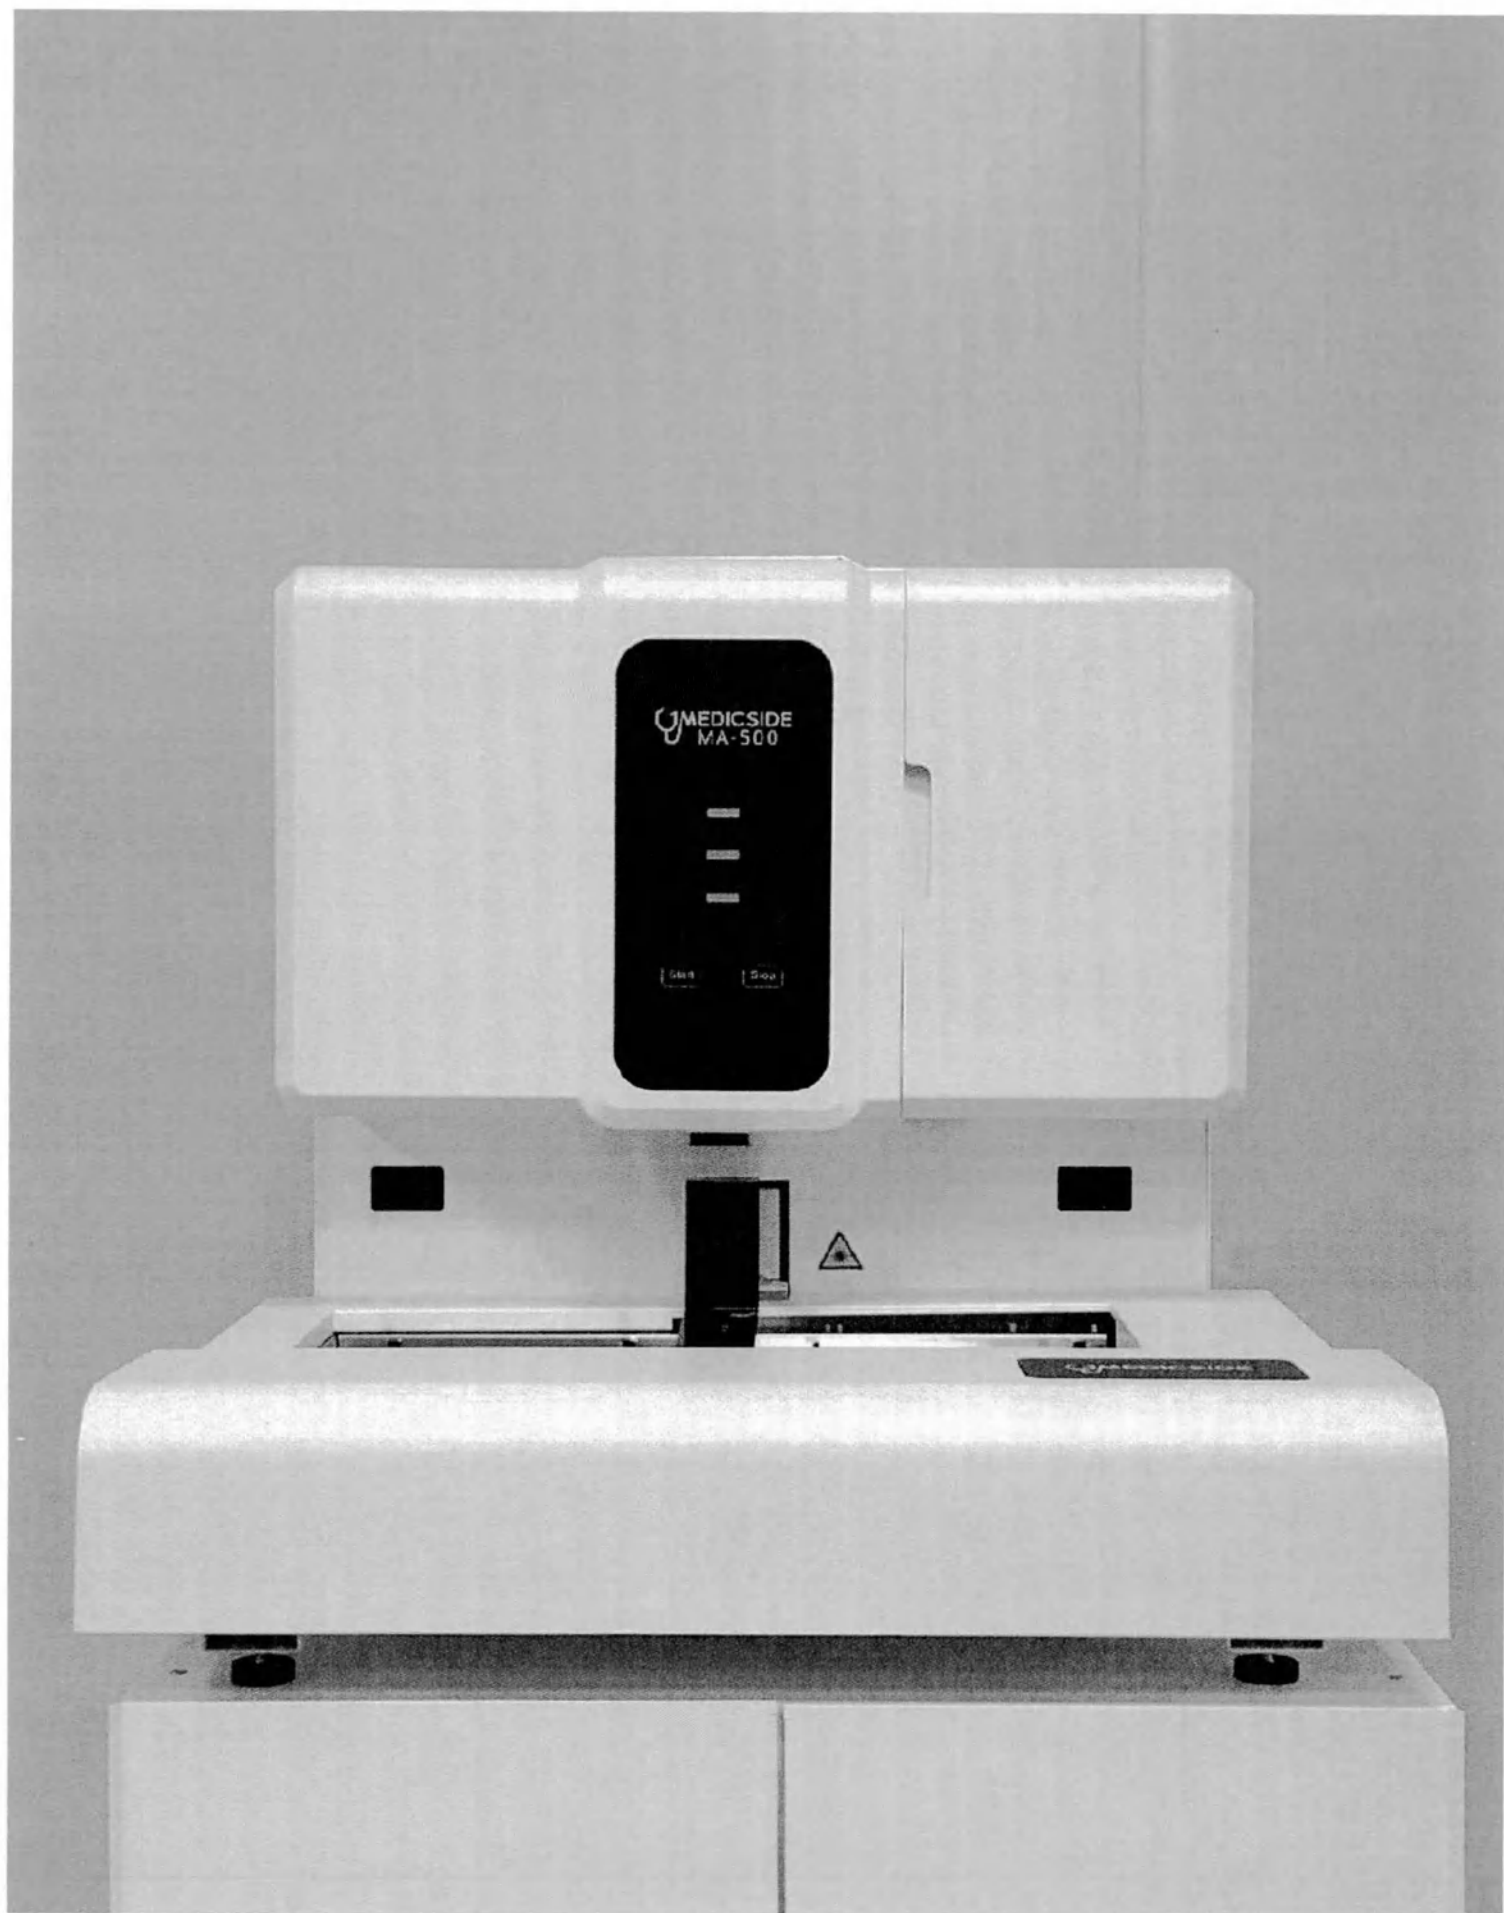

Анализатор автоматический клеточного состава мочи МА-500

Urine Sediment Analyzer

 MEDICSIDE

Model: MA-500

Specification: 603mm×757mm×581mm

Input: ~100-240V 50-60Hz Power: 200VA


S/N: NMA500202304010007

: 21.11.2023

: Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

2nd Floor, No.66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan County,
Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China.


Tel: +86 400 8877 020 E-mail: info@meside.com <http://en.meside.com>

 Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, the Netherlands

SRN: NL-AR-000000444

EMDN: W05030580



Анализатор автоматический клеточного состава мочи МА-500 (оригинальная маркировка)

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Анализатор автоматический клеточного состава мочи MA-500

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Род источника питания: переменный ток

100-240В, 50Гц/60Гц, 200 ВА

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4

Информацию на этикетке считать приоритетной


ЛАЗЕРНАЯ
АППАРАТУРА
КЛАССА 1



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.


(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiasha
Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China




Информацию о дате производства анализатора, серийном номере анализатора и остальные графические символы см. на оригинальной маркировке

Анализатор автоматический клеточного состава мочи MA-500 (макет этикетки на русском языке)

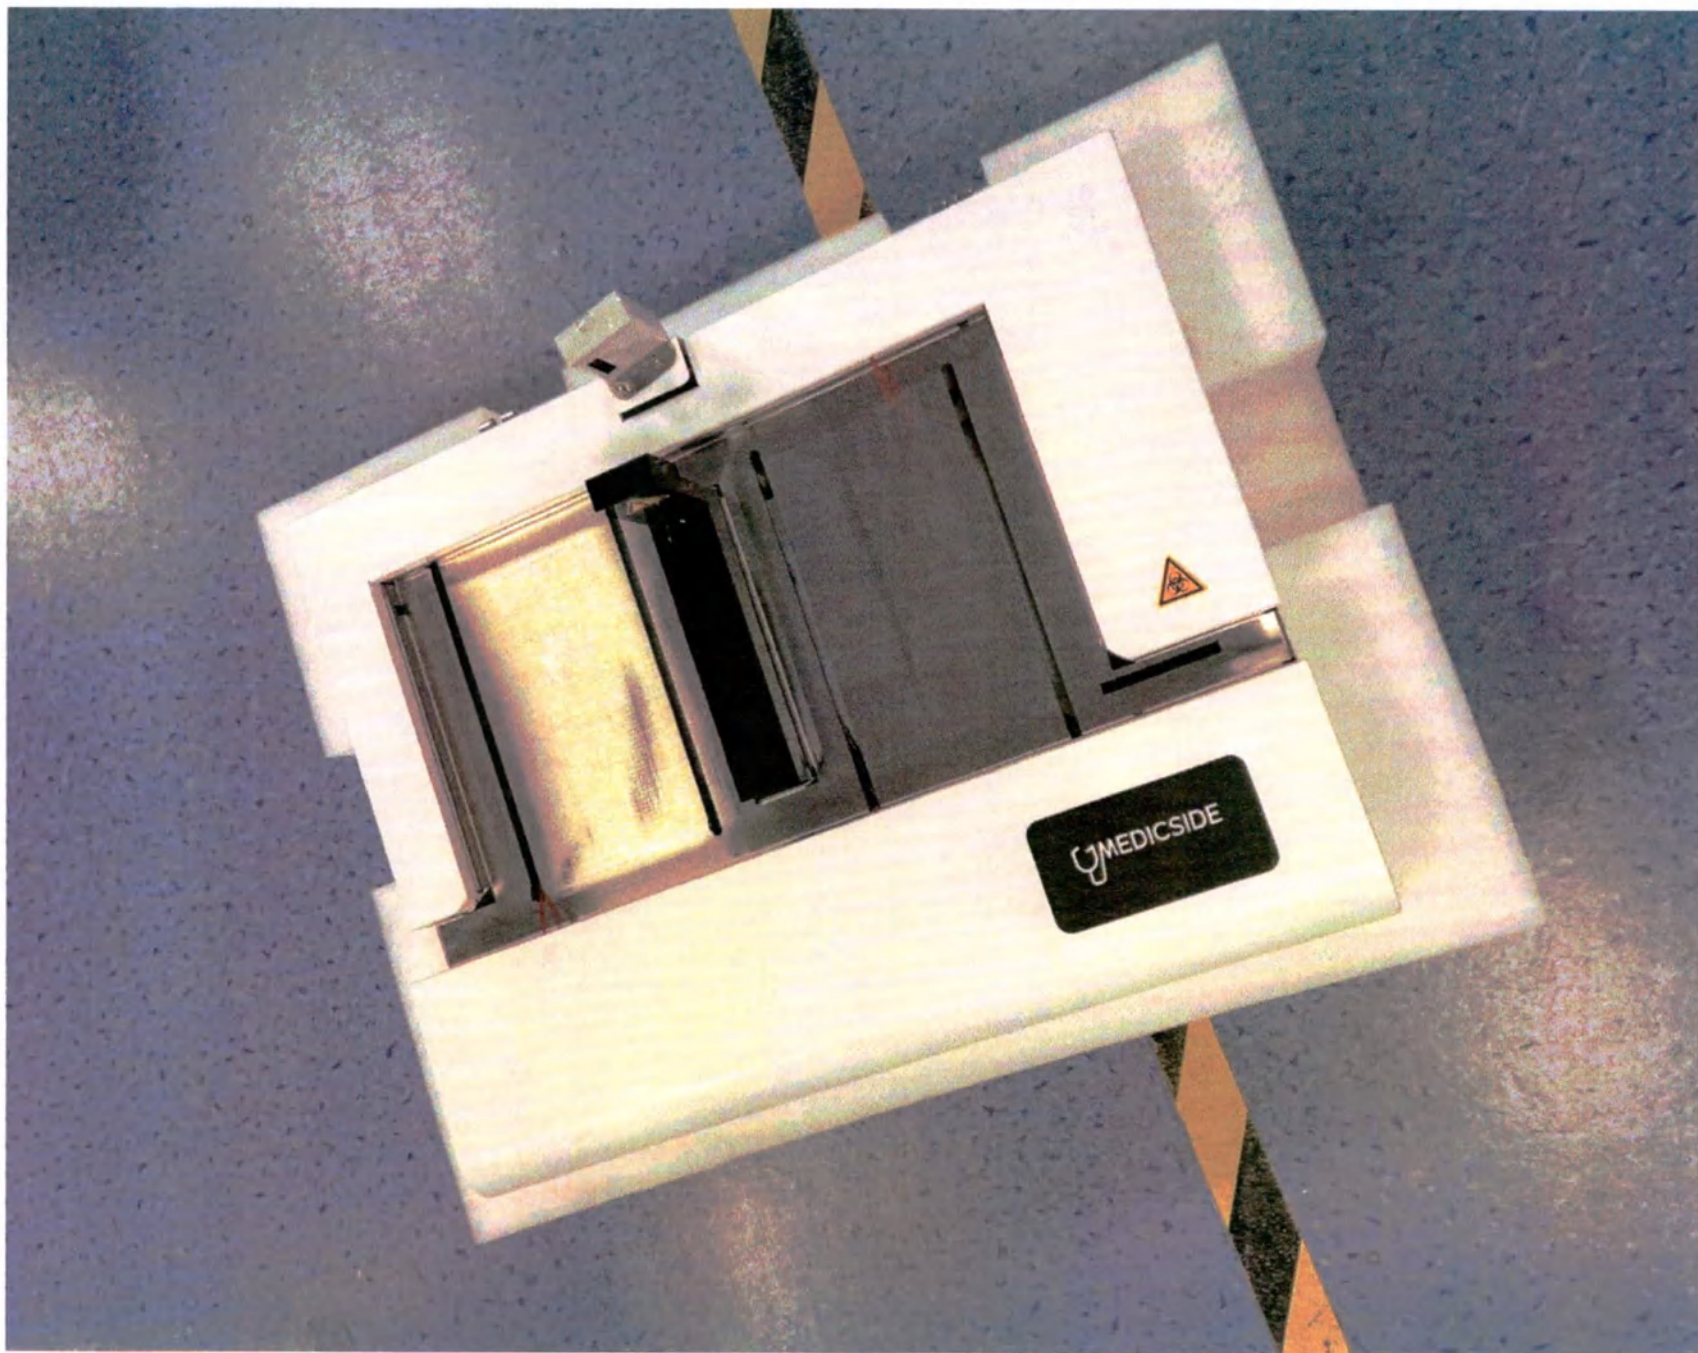

Автоподатчик образцов анализатора мочи



**Руководство по эксплуатации на медицинское изделие:
«Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 +
MA500 с принадлежностями»**

Производства: Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd. (Чжэцзян
Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай


Руководство по эксплуатации




Кабель электропитания




Кабель RS232

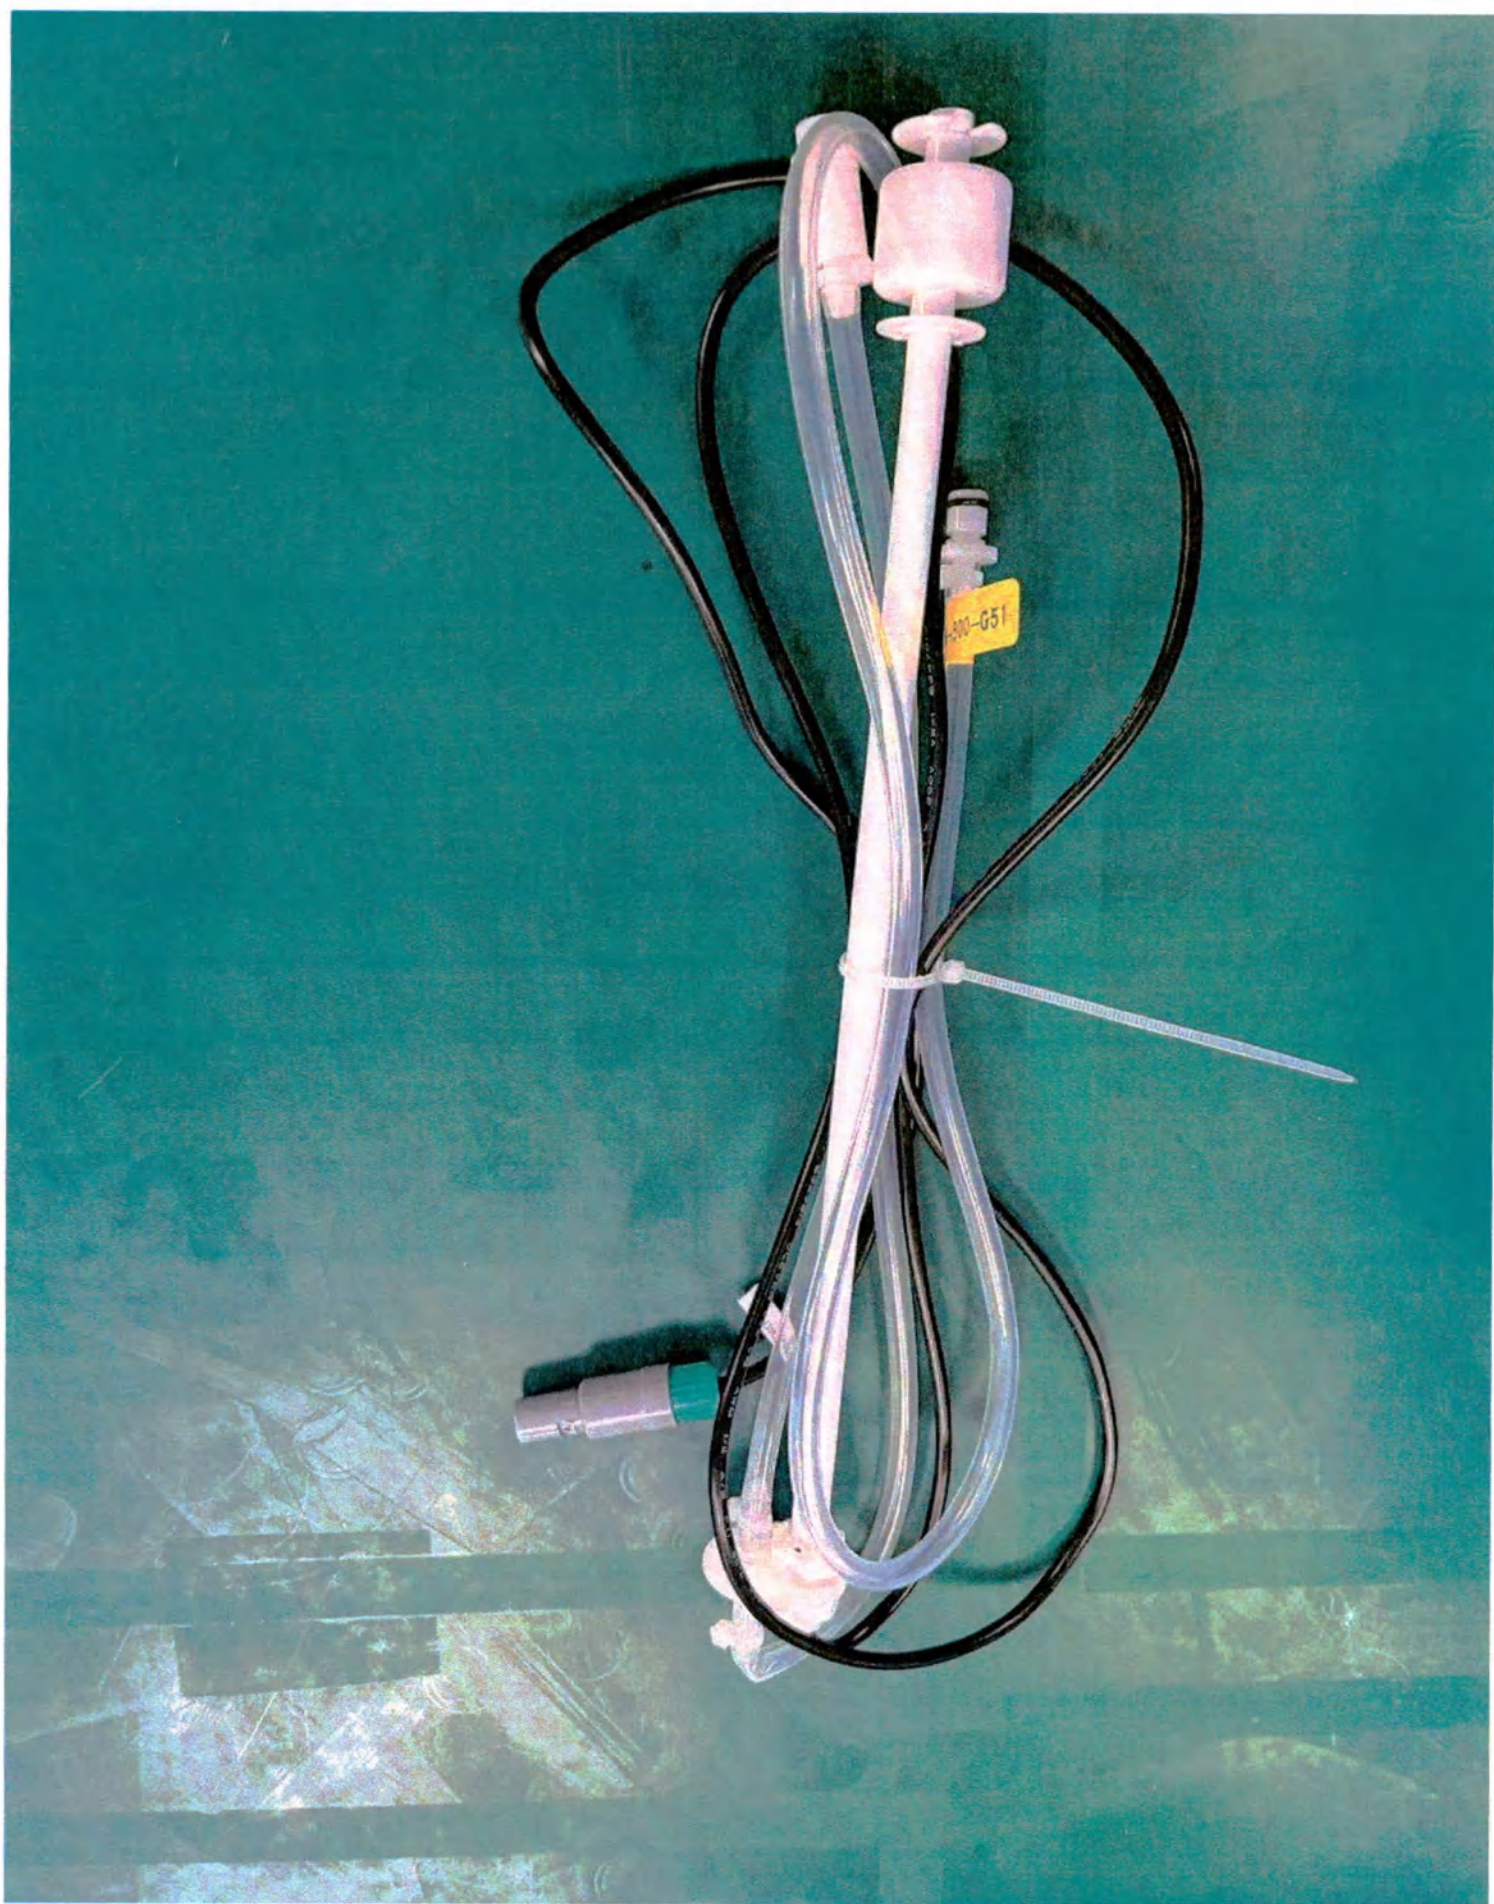

Трубка для забора жидкости с датчиком

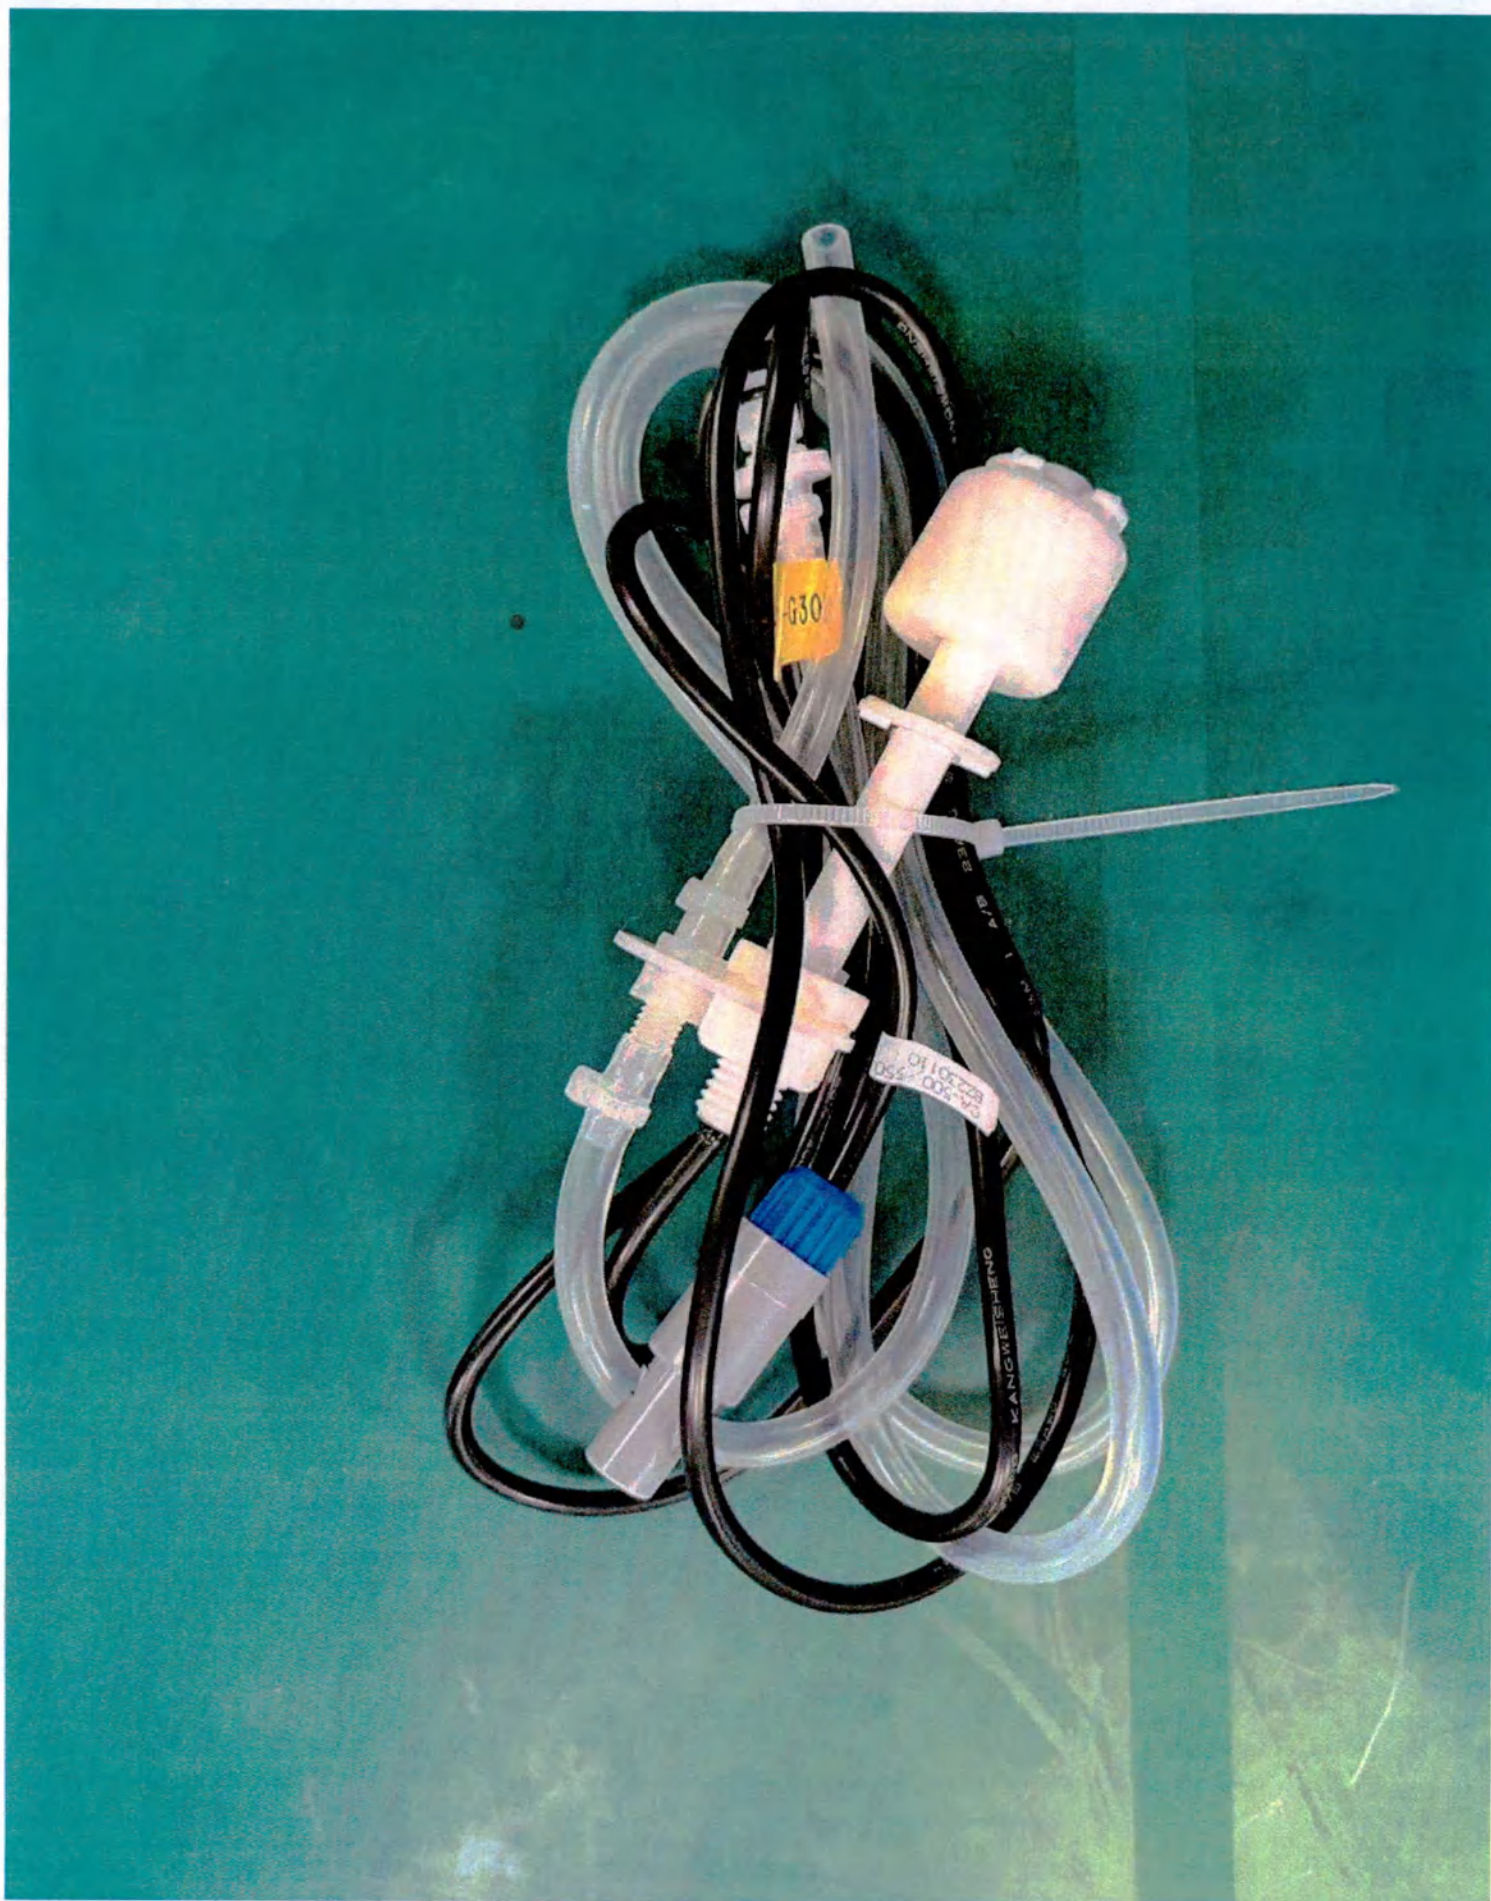

Трубка для слива отработанной жидкости с датчиком

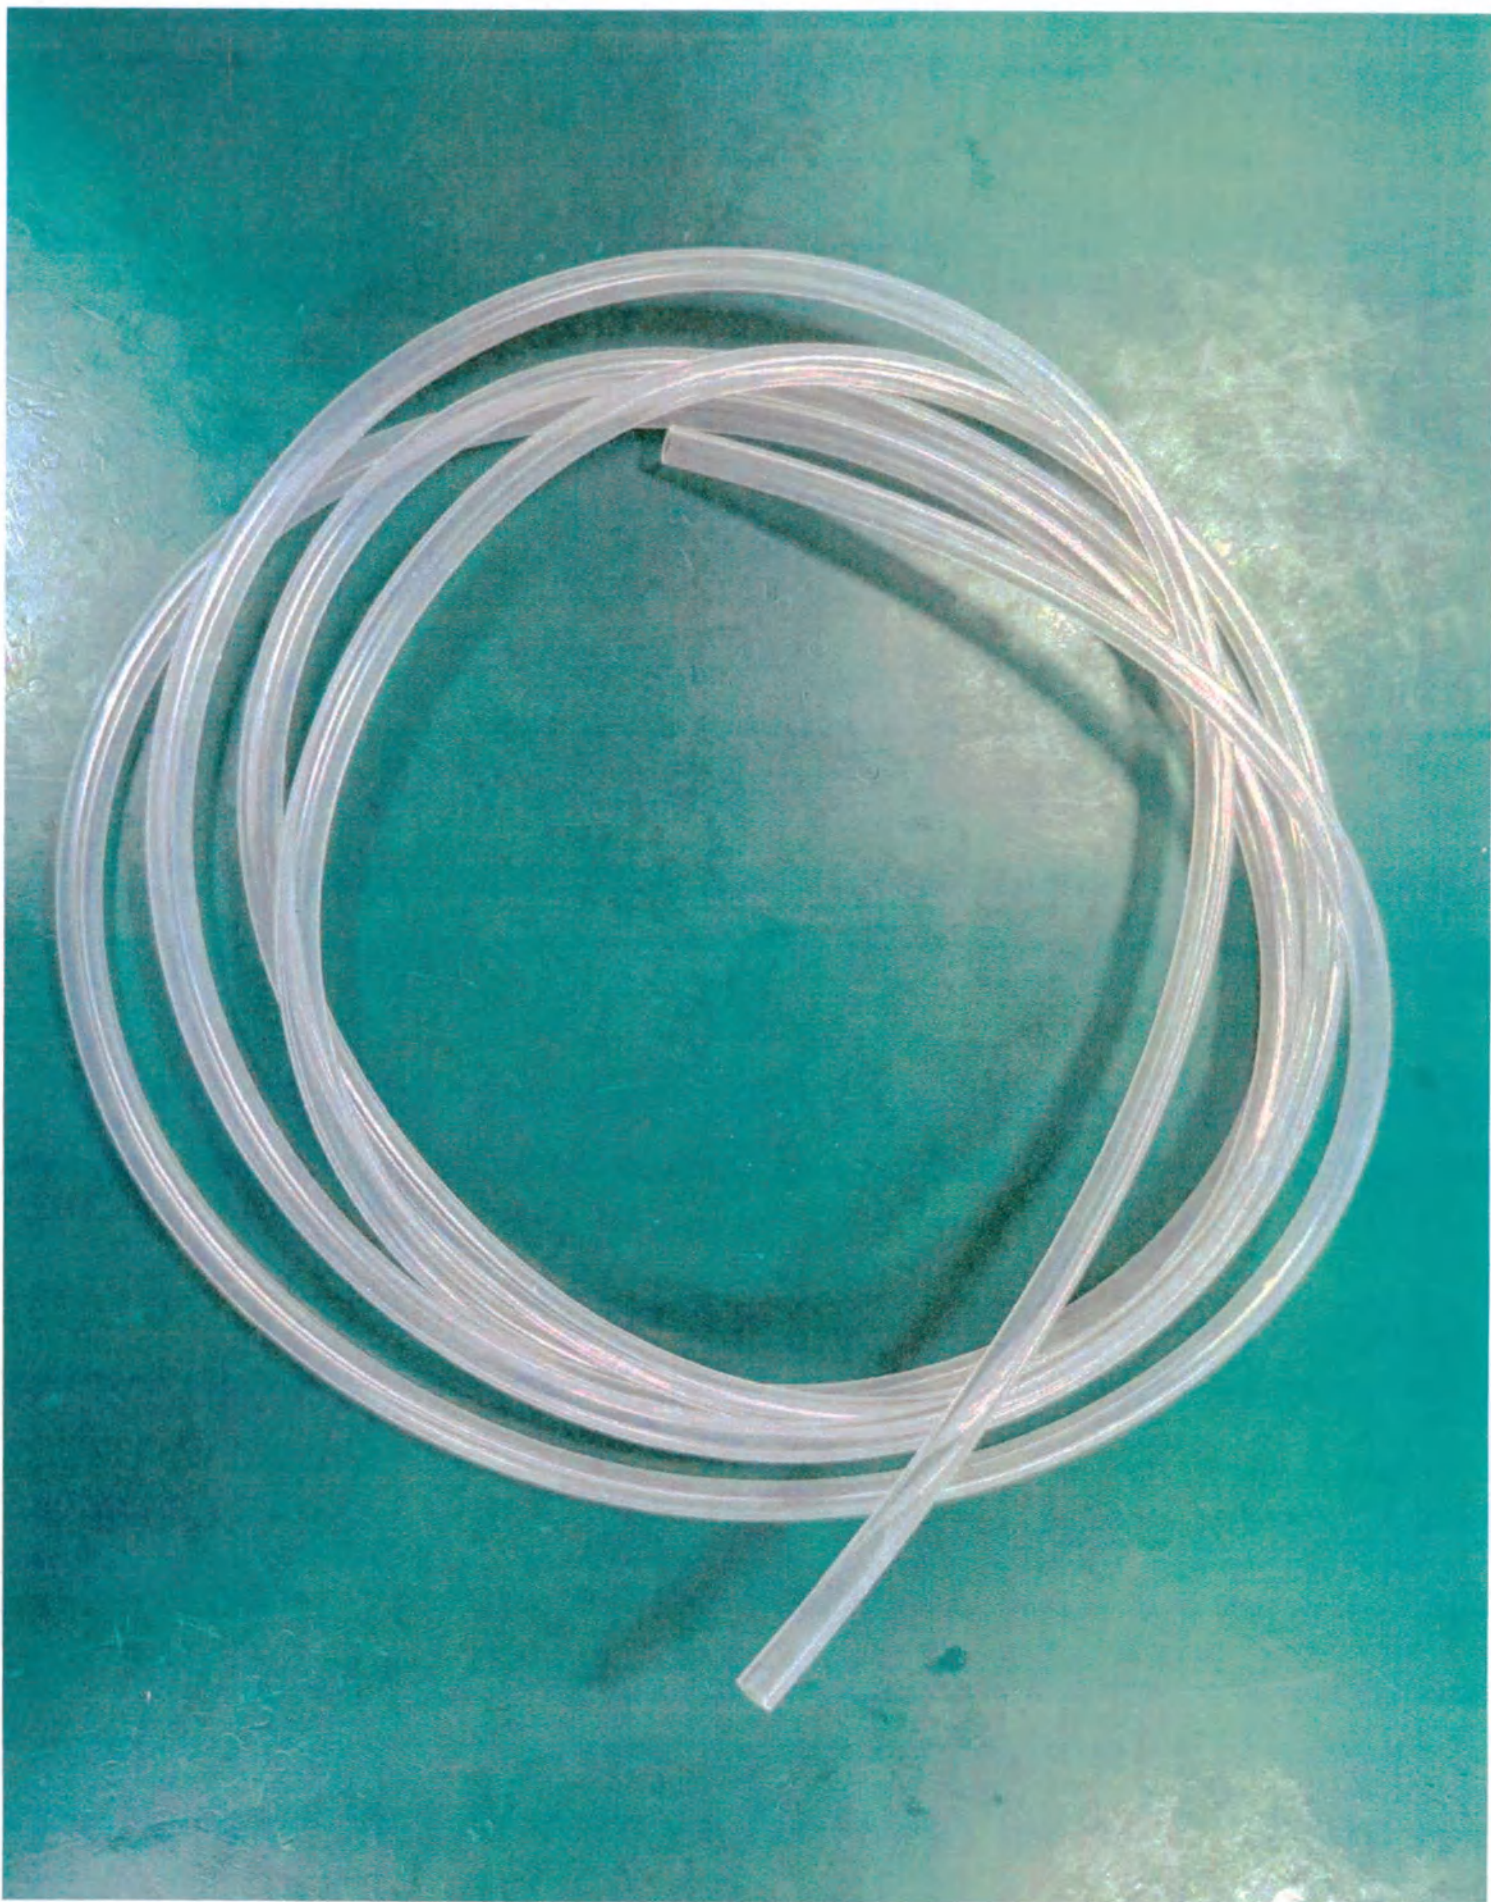

Трубка для отработанной жидкости




Контейнер




Крышка для контейнера под обжимающую жидкость



Крышка для контейнера

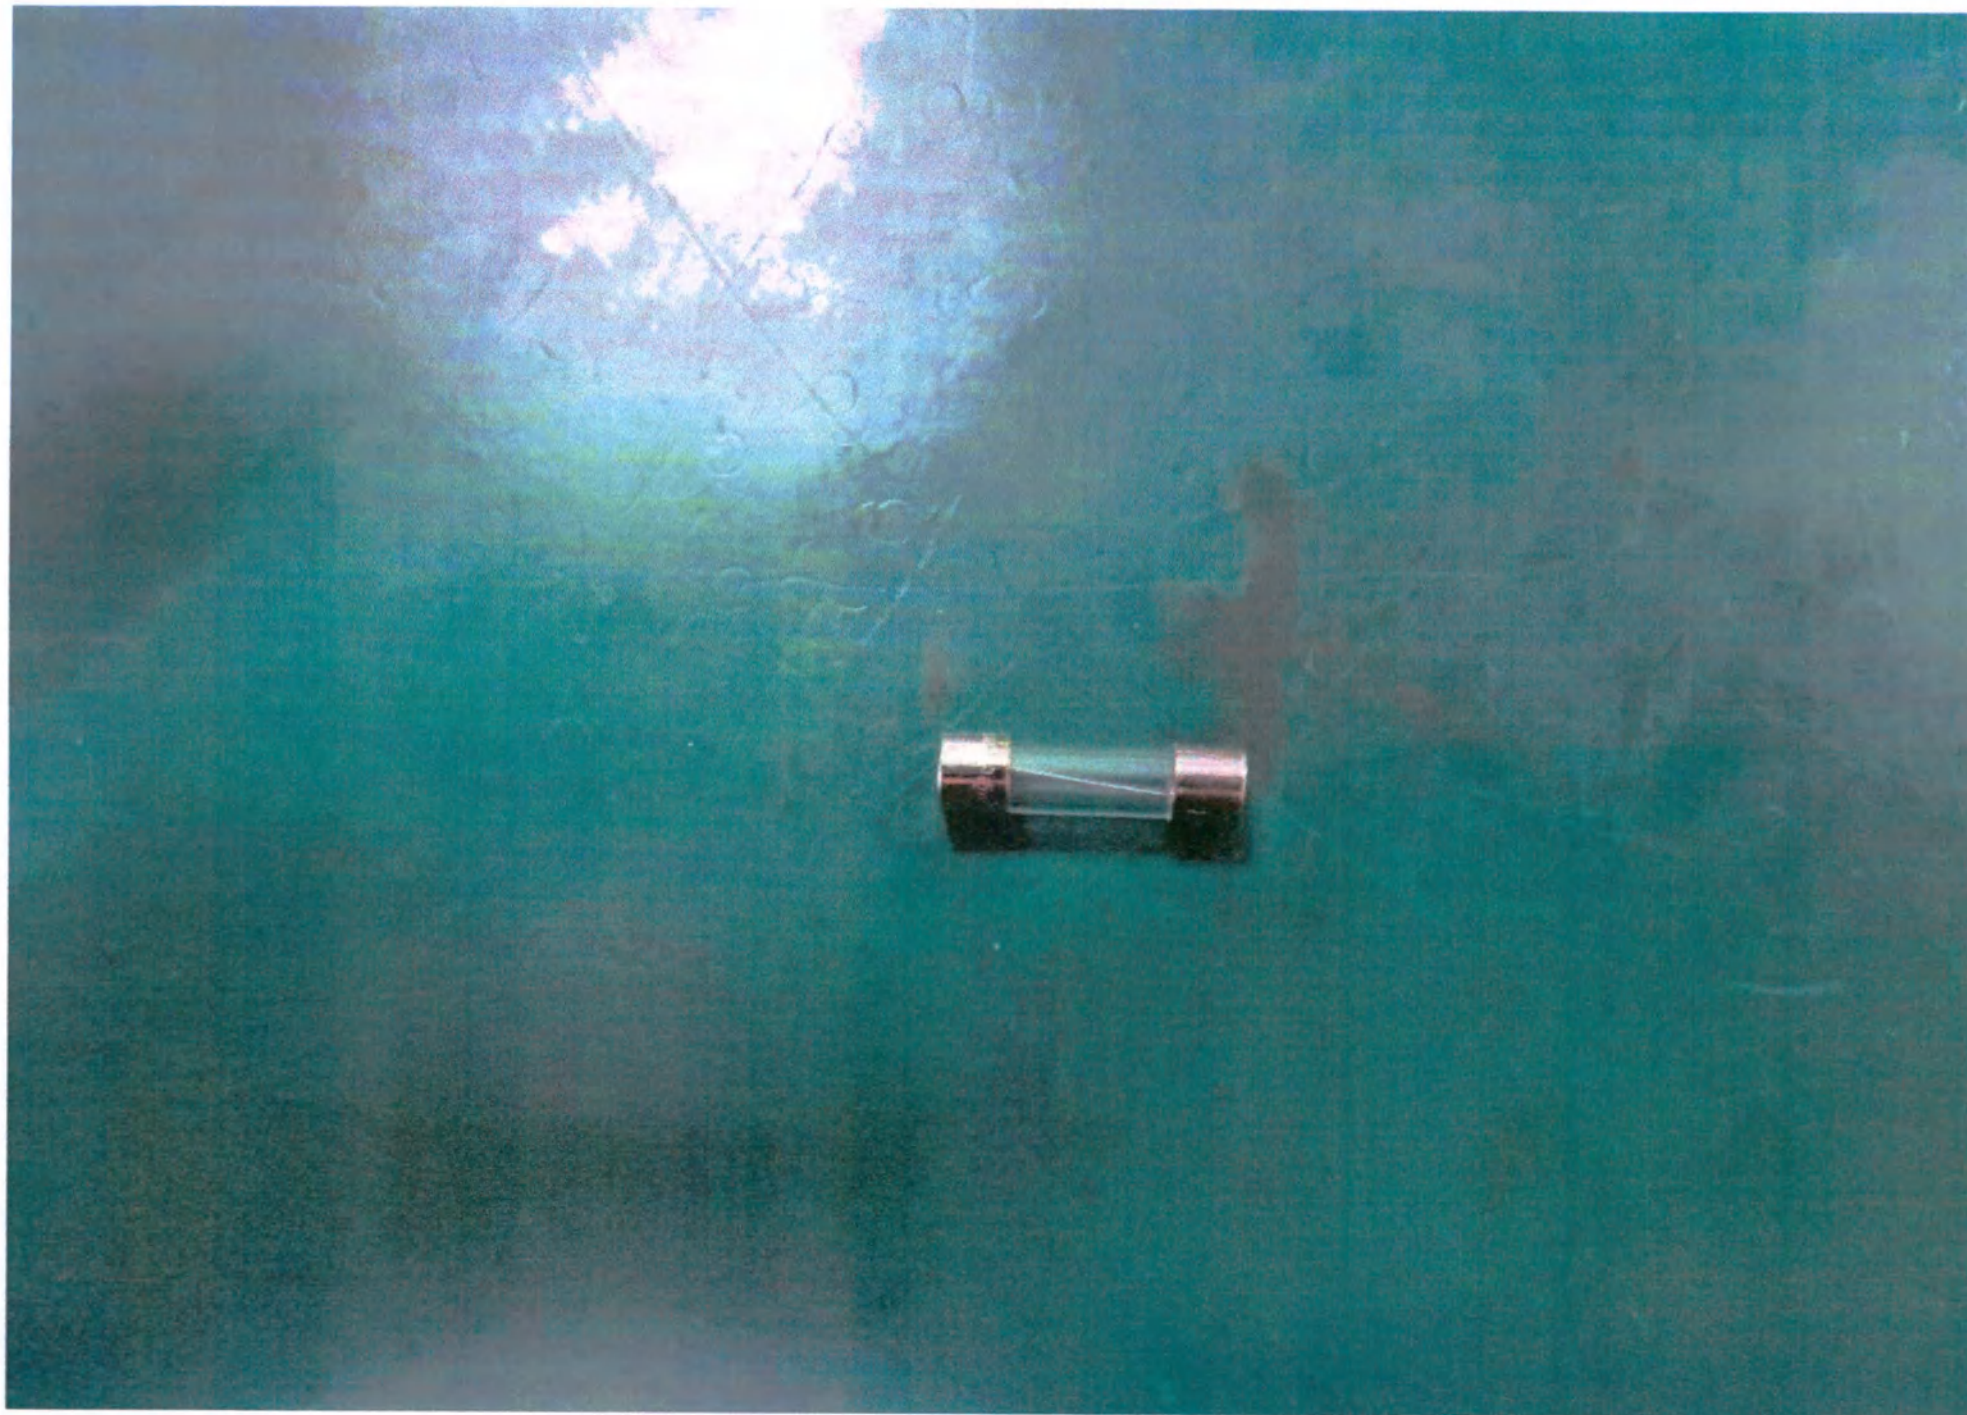


Предохранитель (2А)

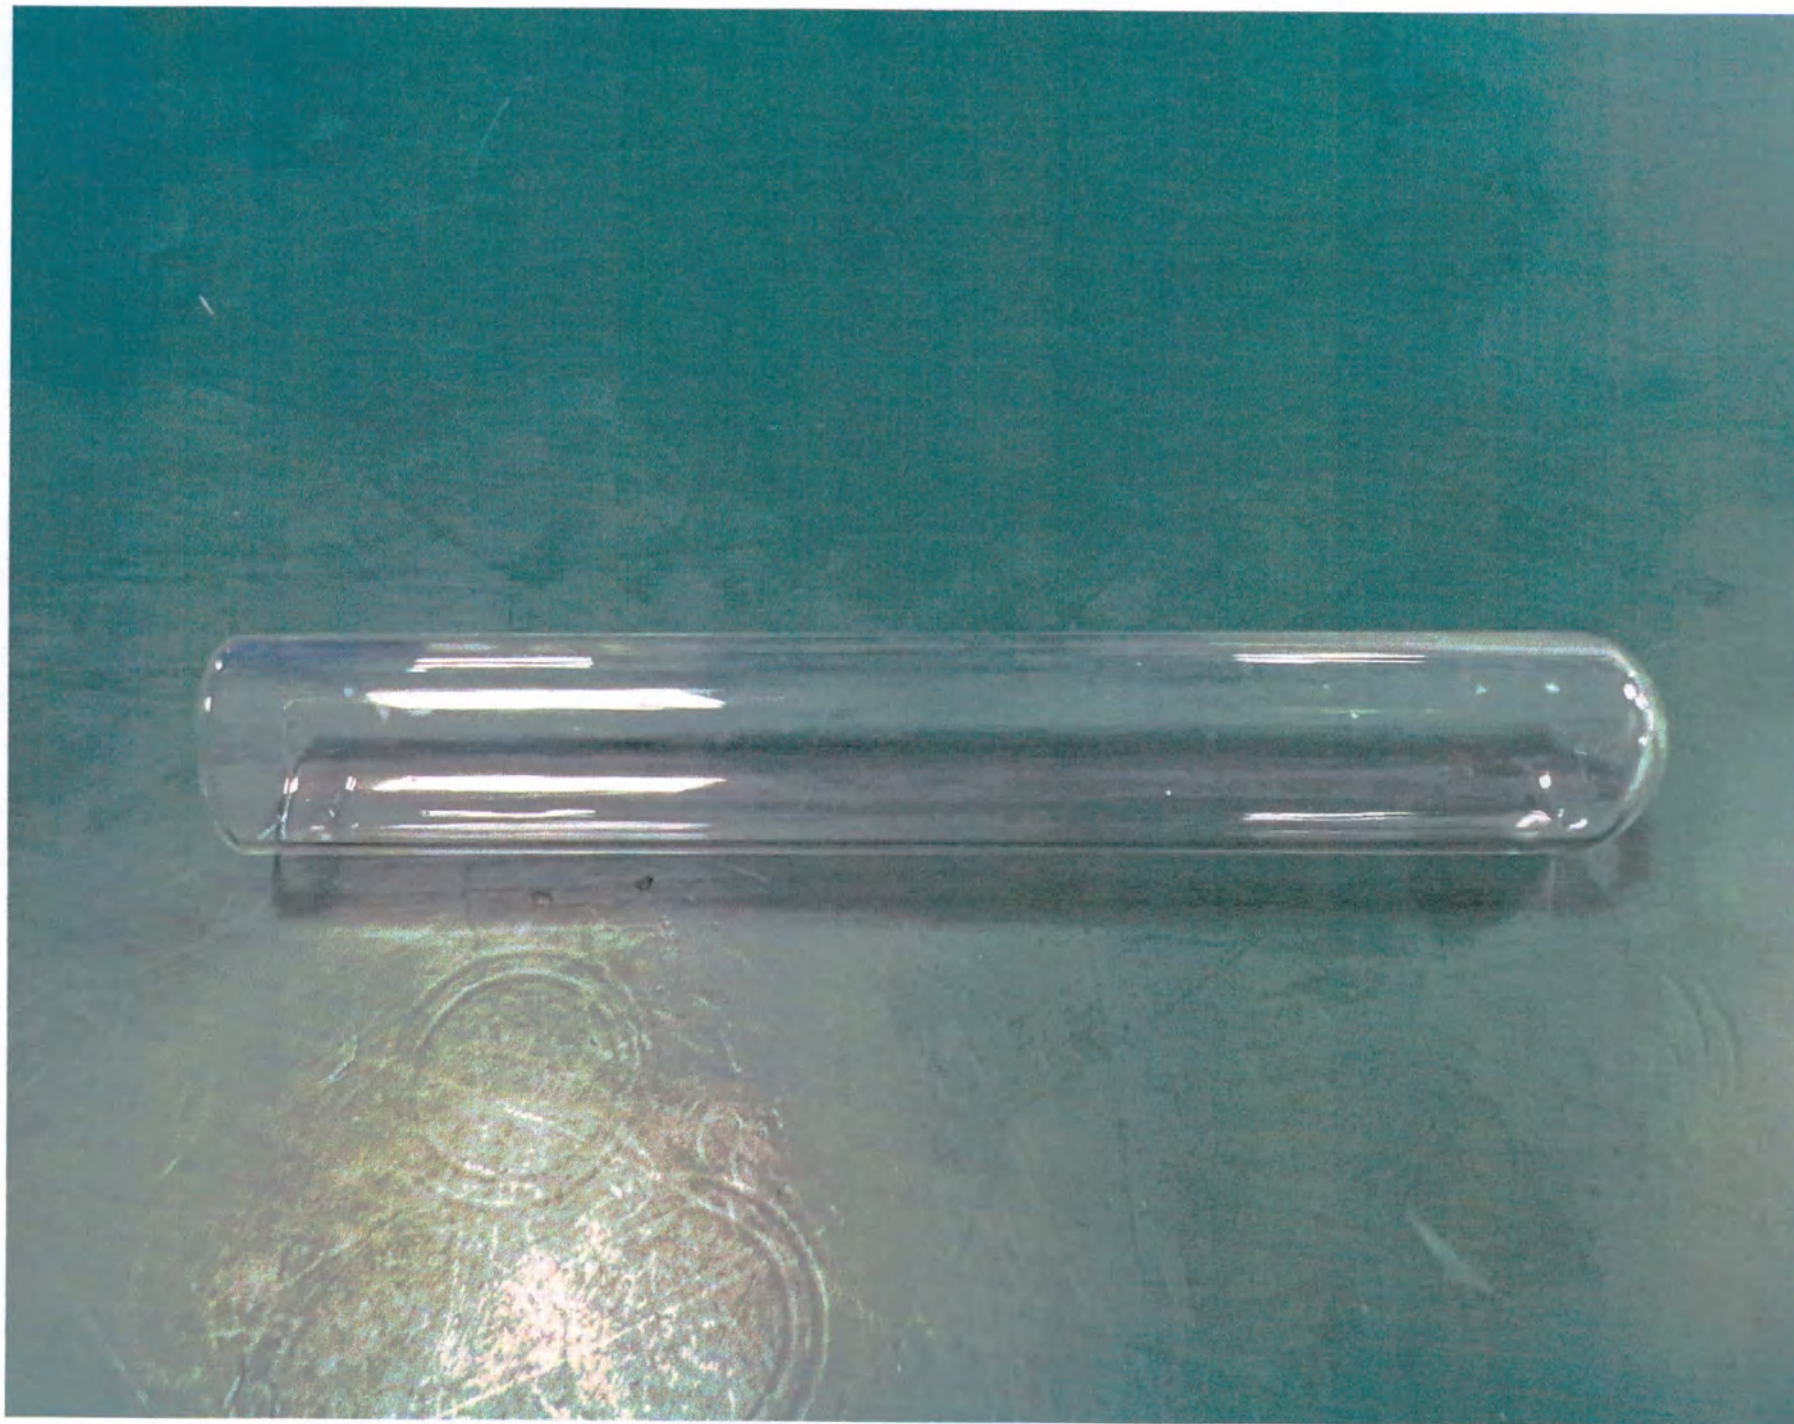


Пробирка стеклянная




Пробирка стеклянная мерная

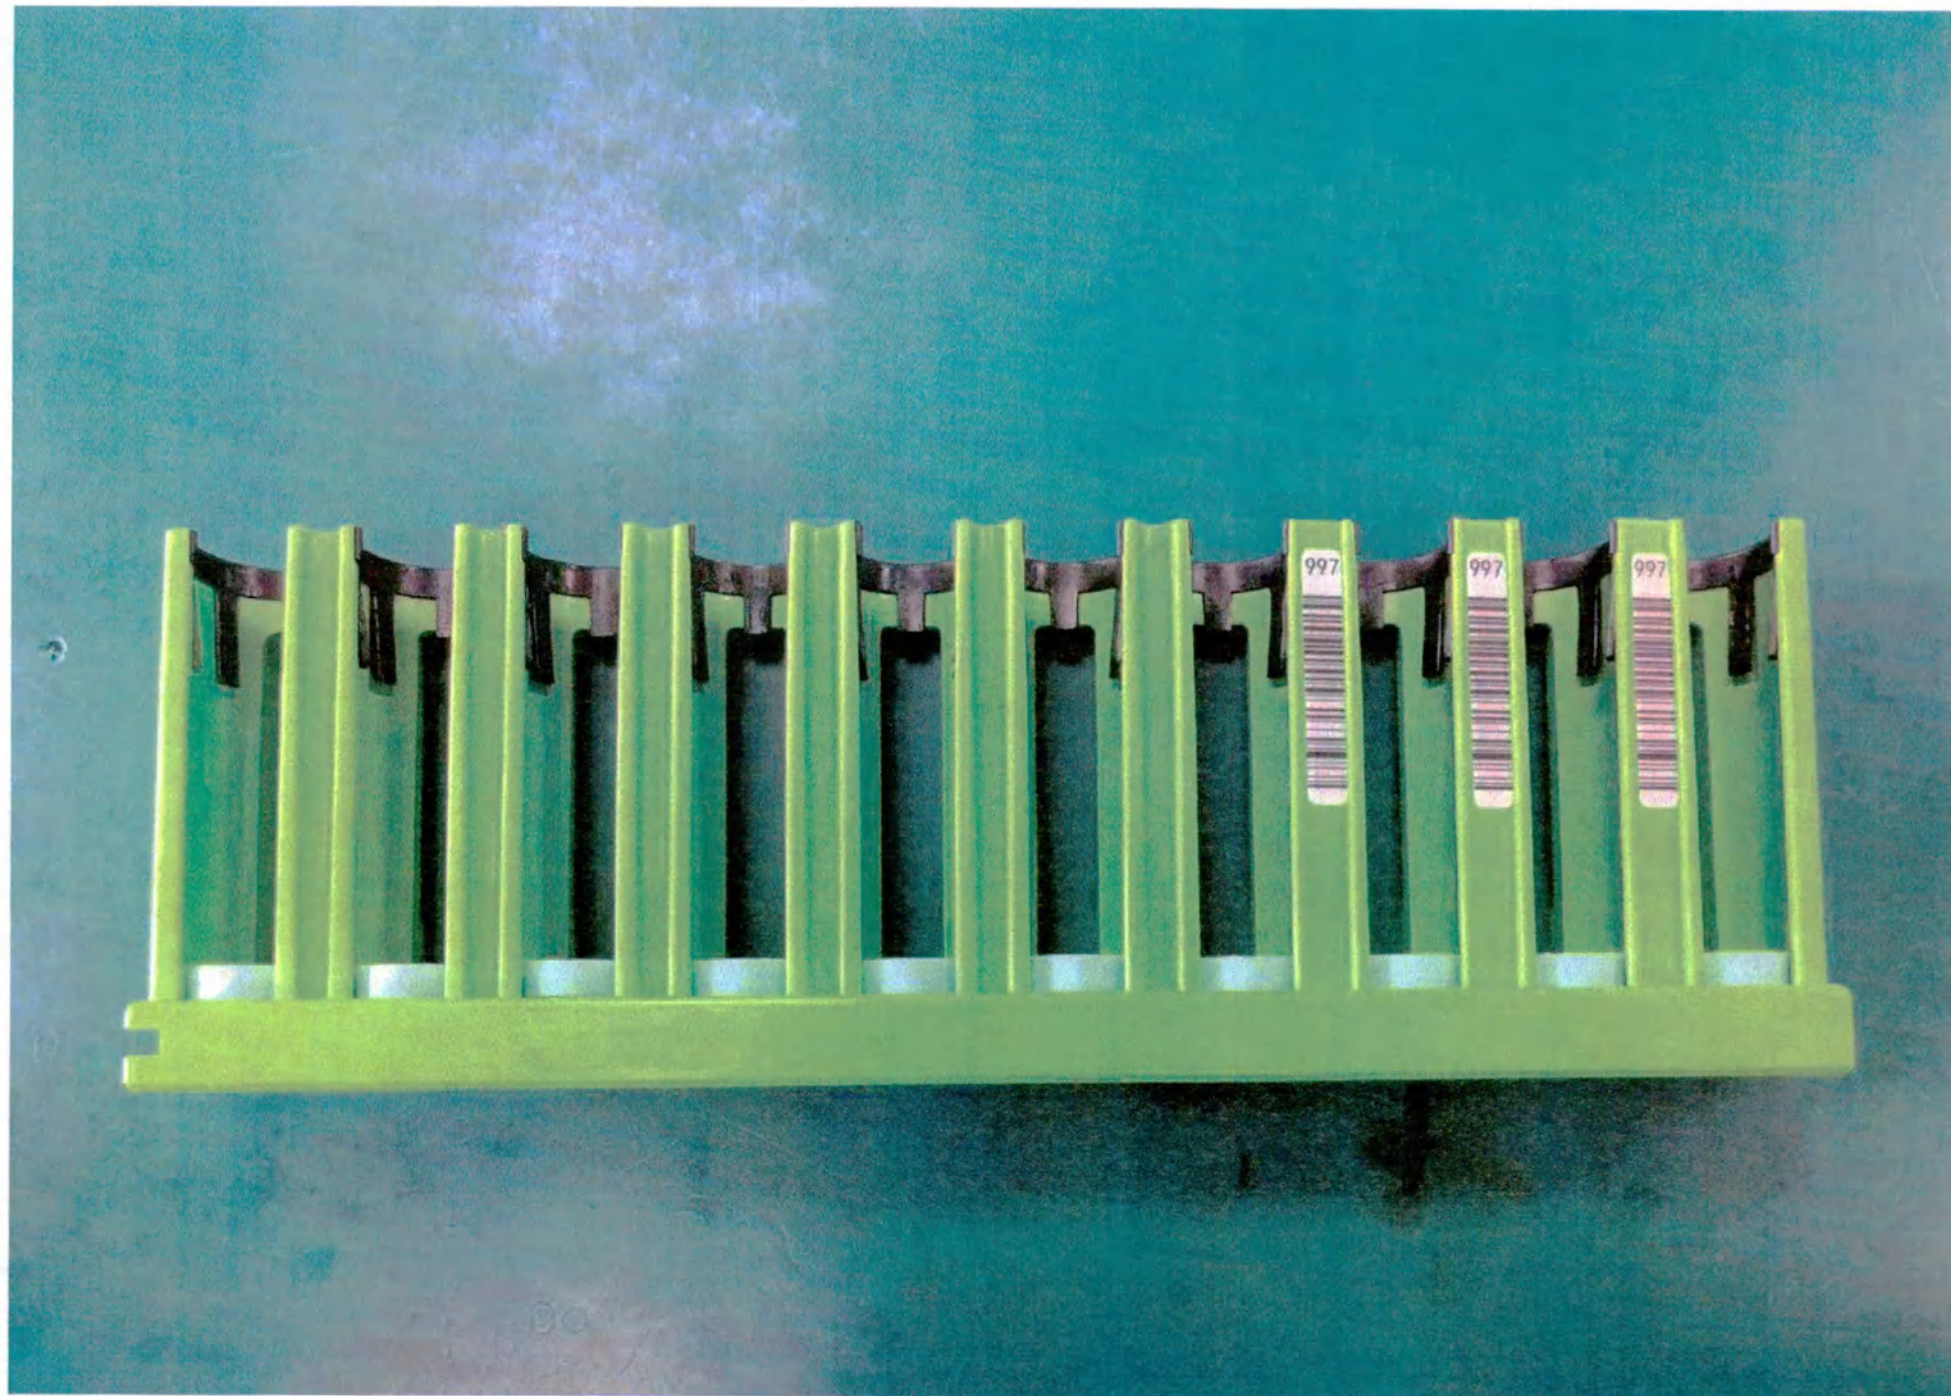


Штатив для контроля и калибровки СА-500, зеленый

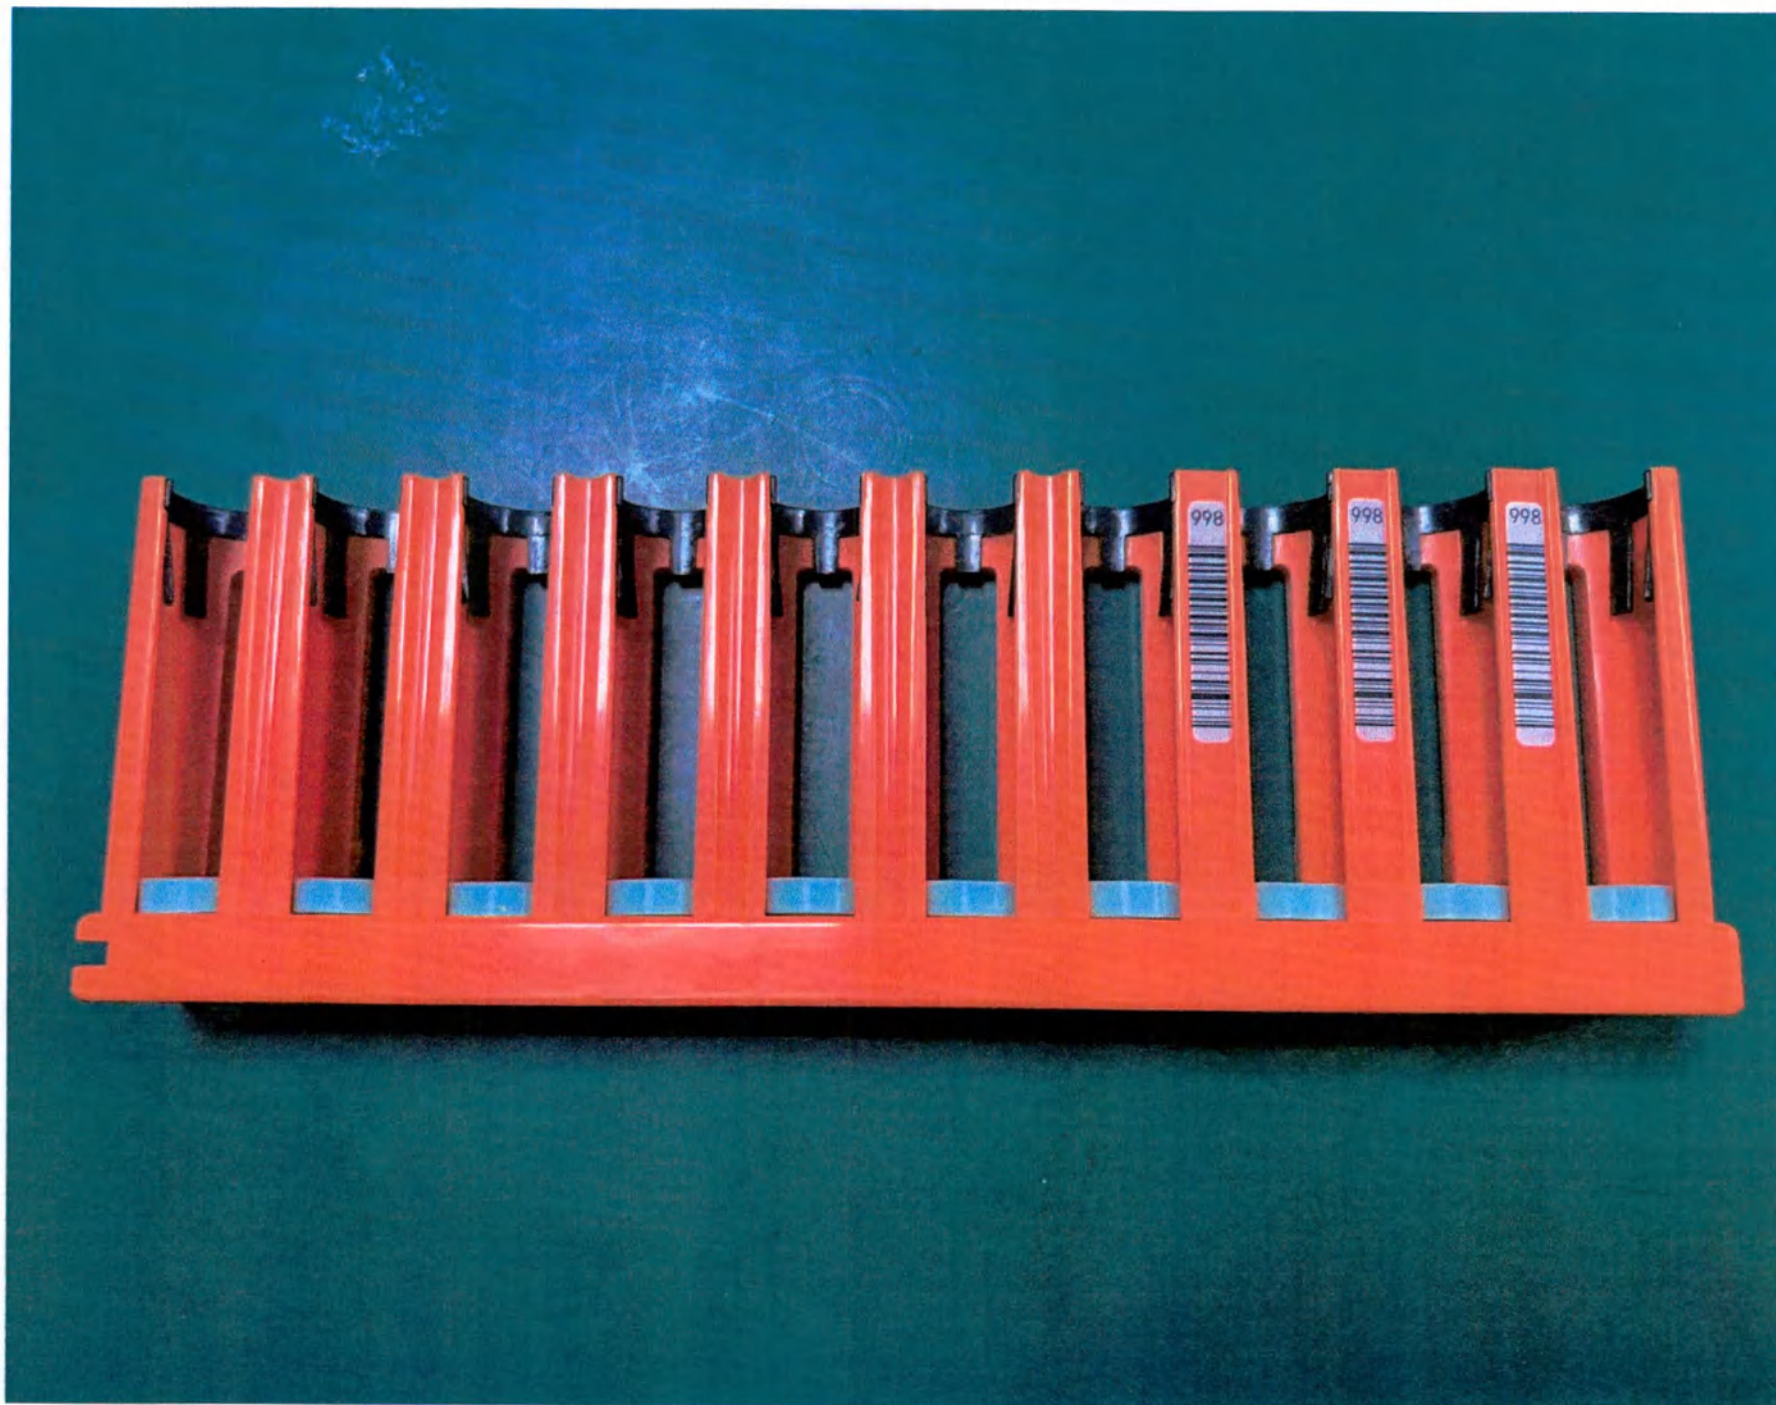


Штатив для контроля и калибровки МА-500, оранжевый

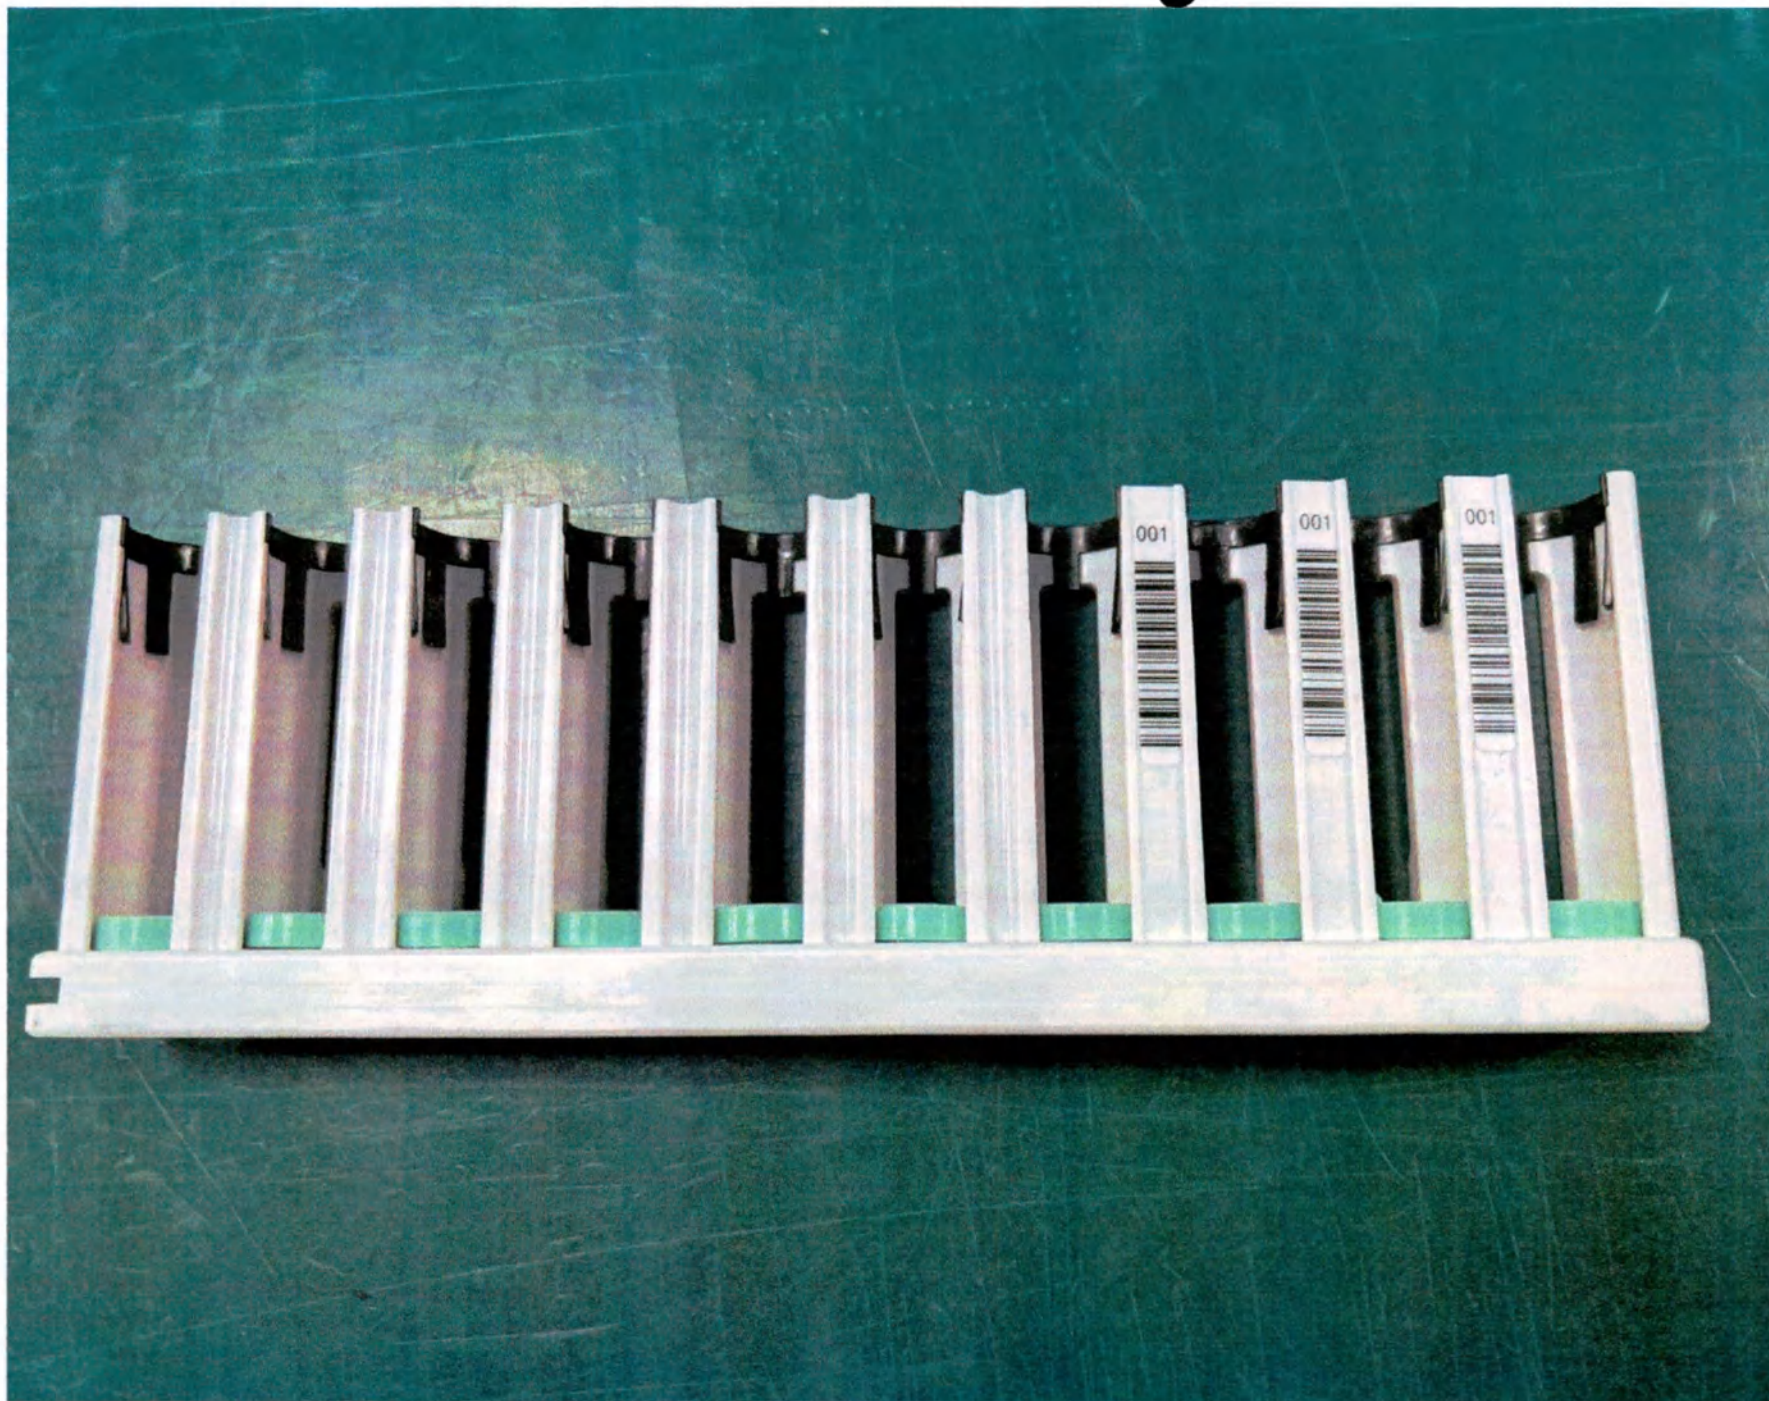


Штатив для образцов, белый

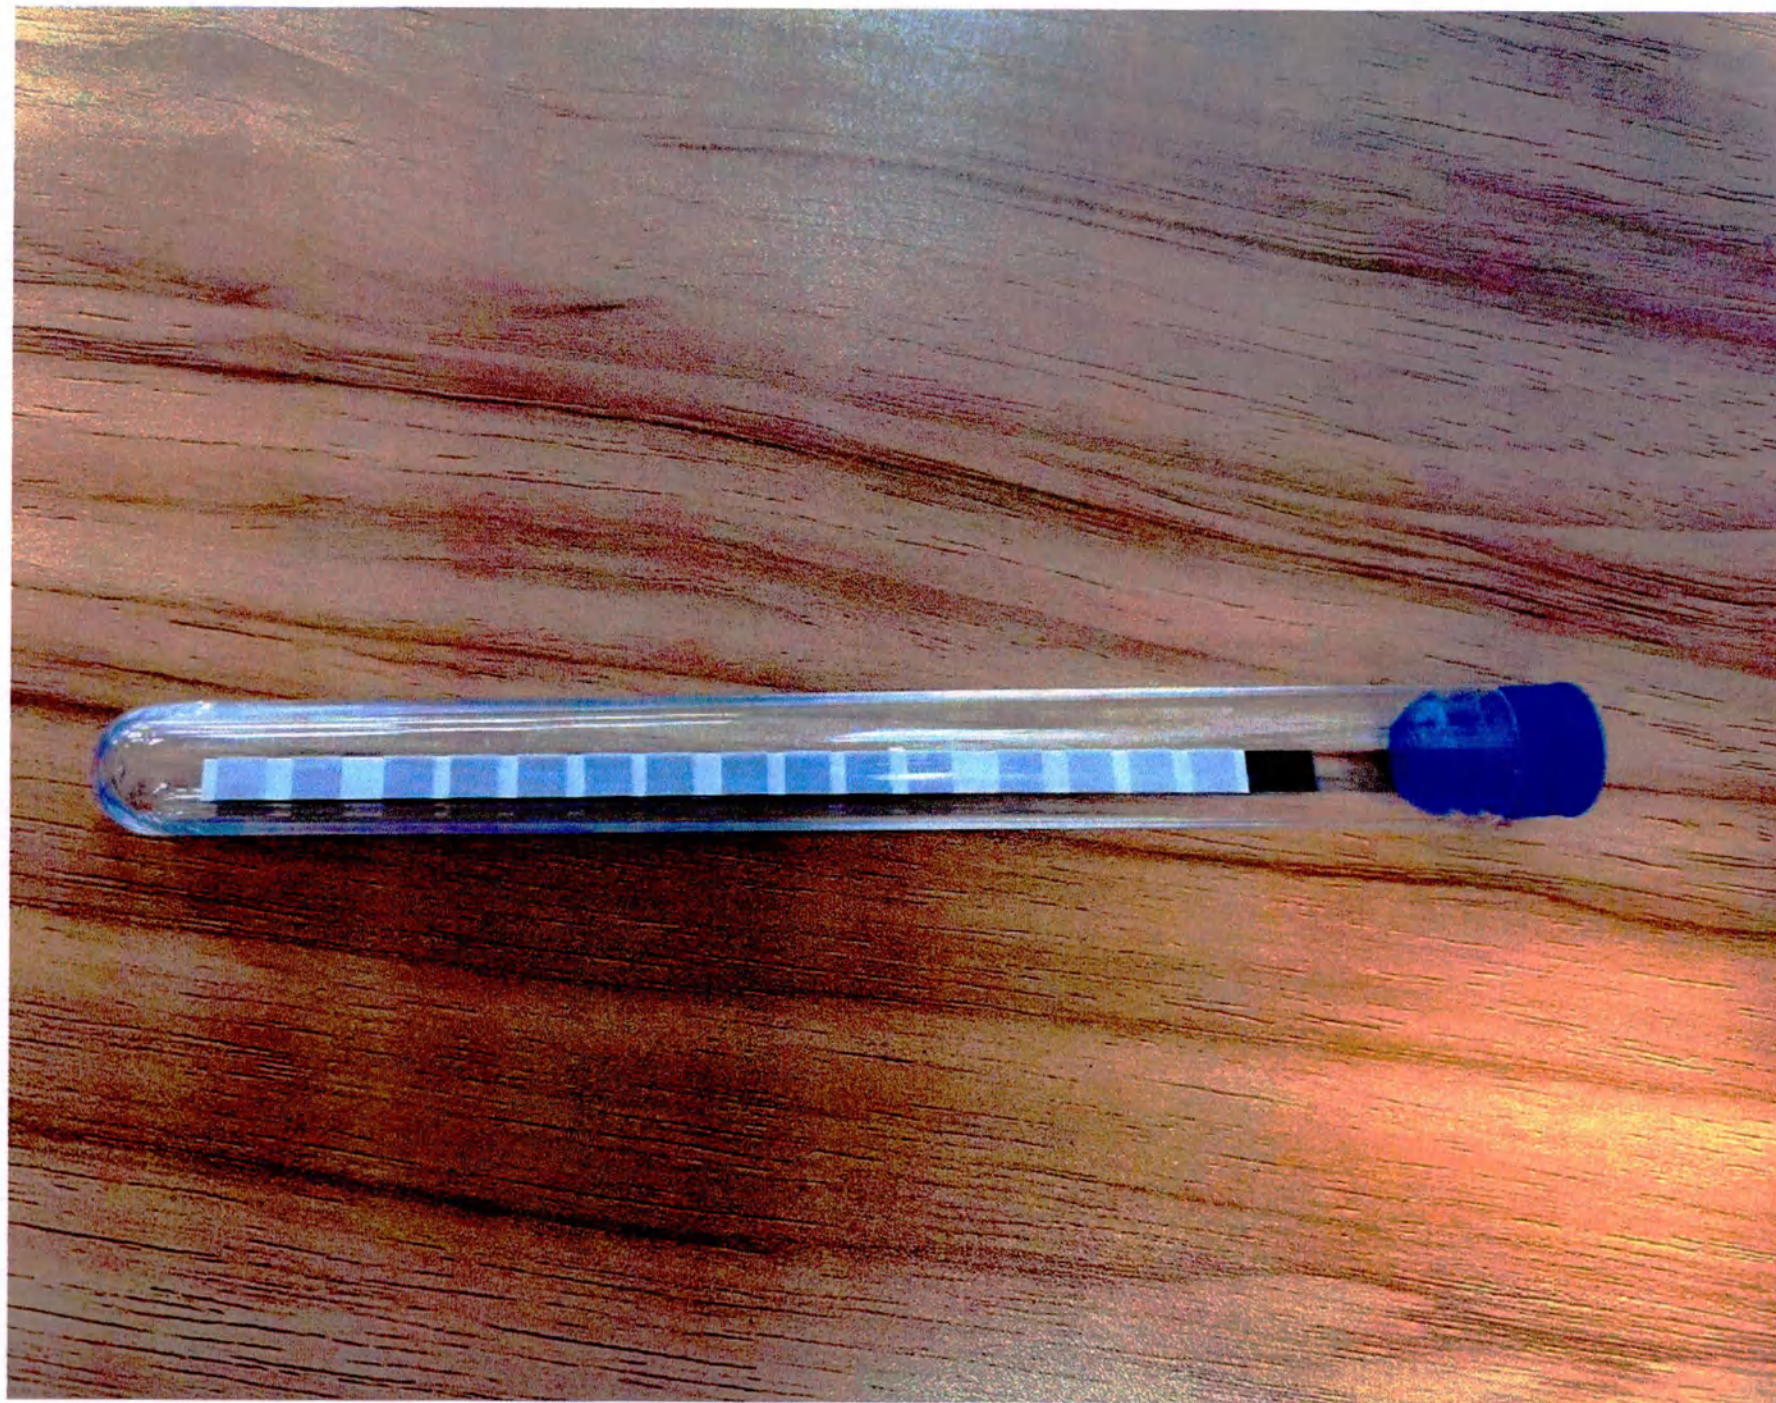


Тест-полоска контрольная

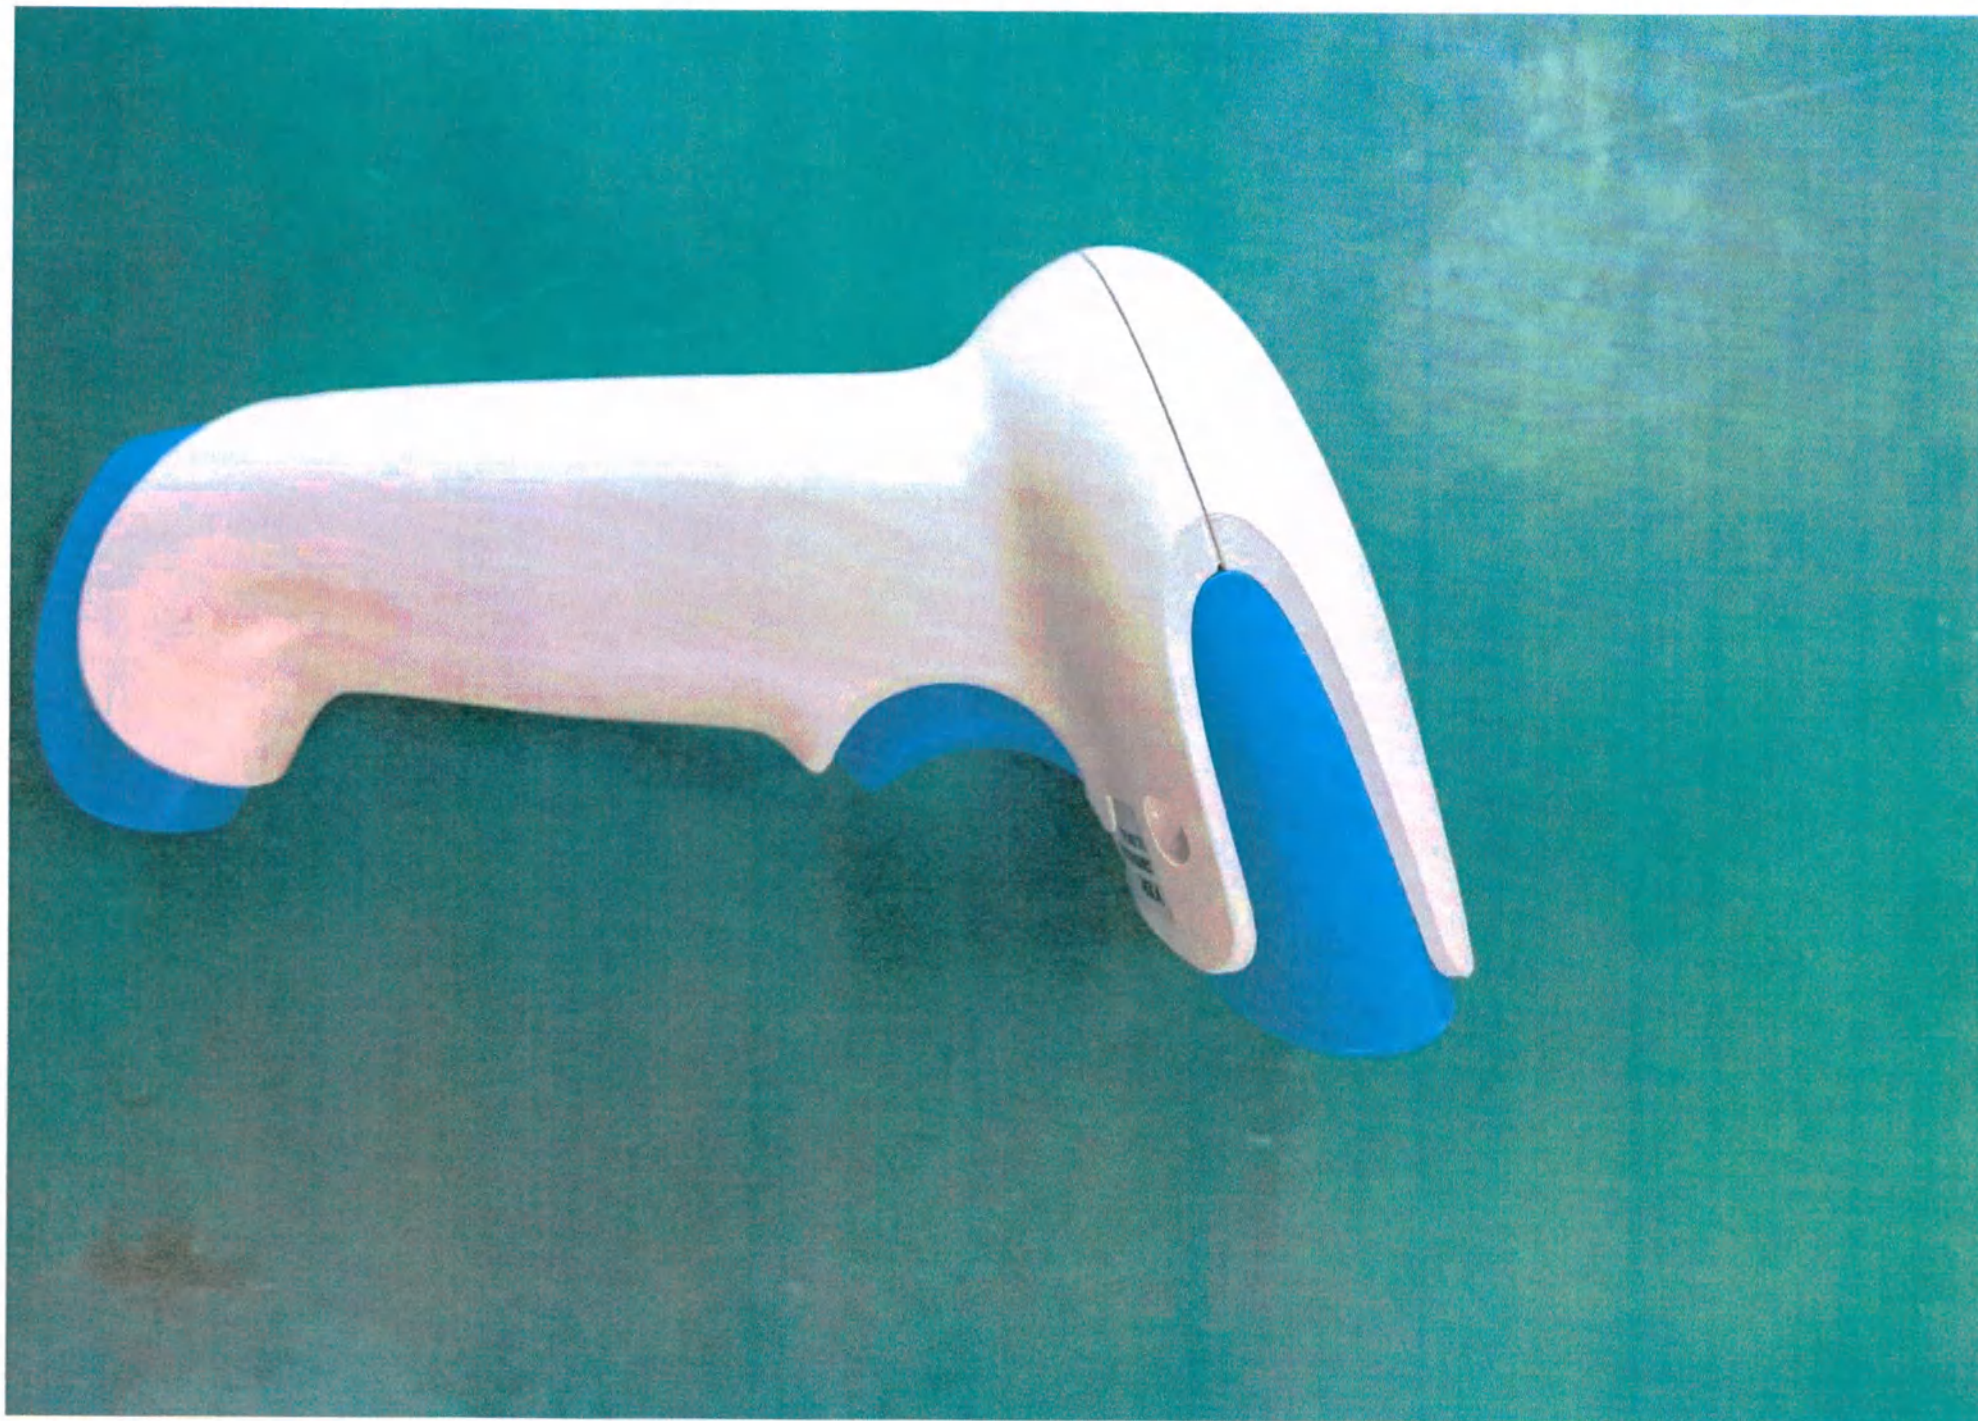


Сканер штрих-кодов

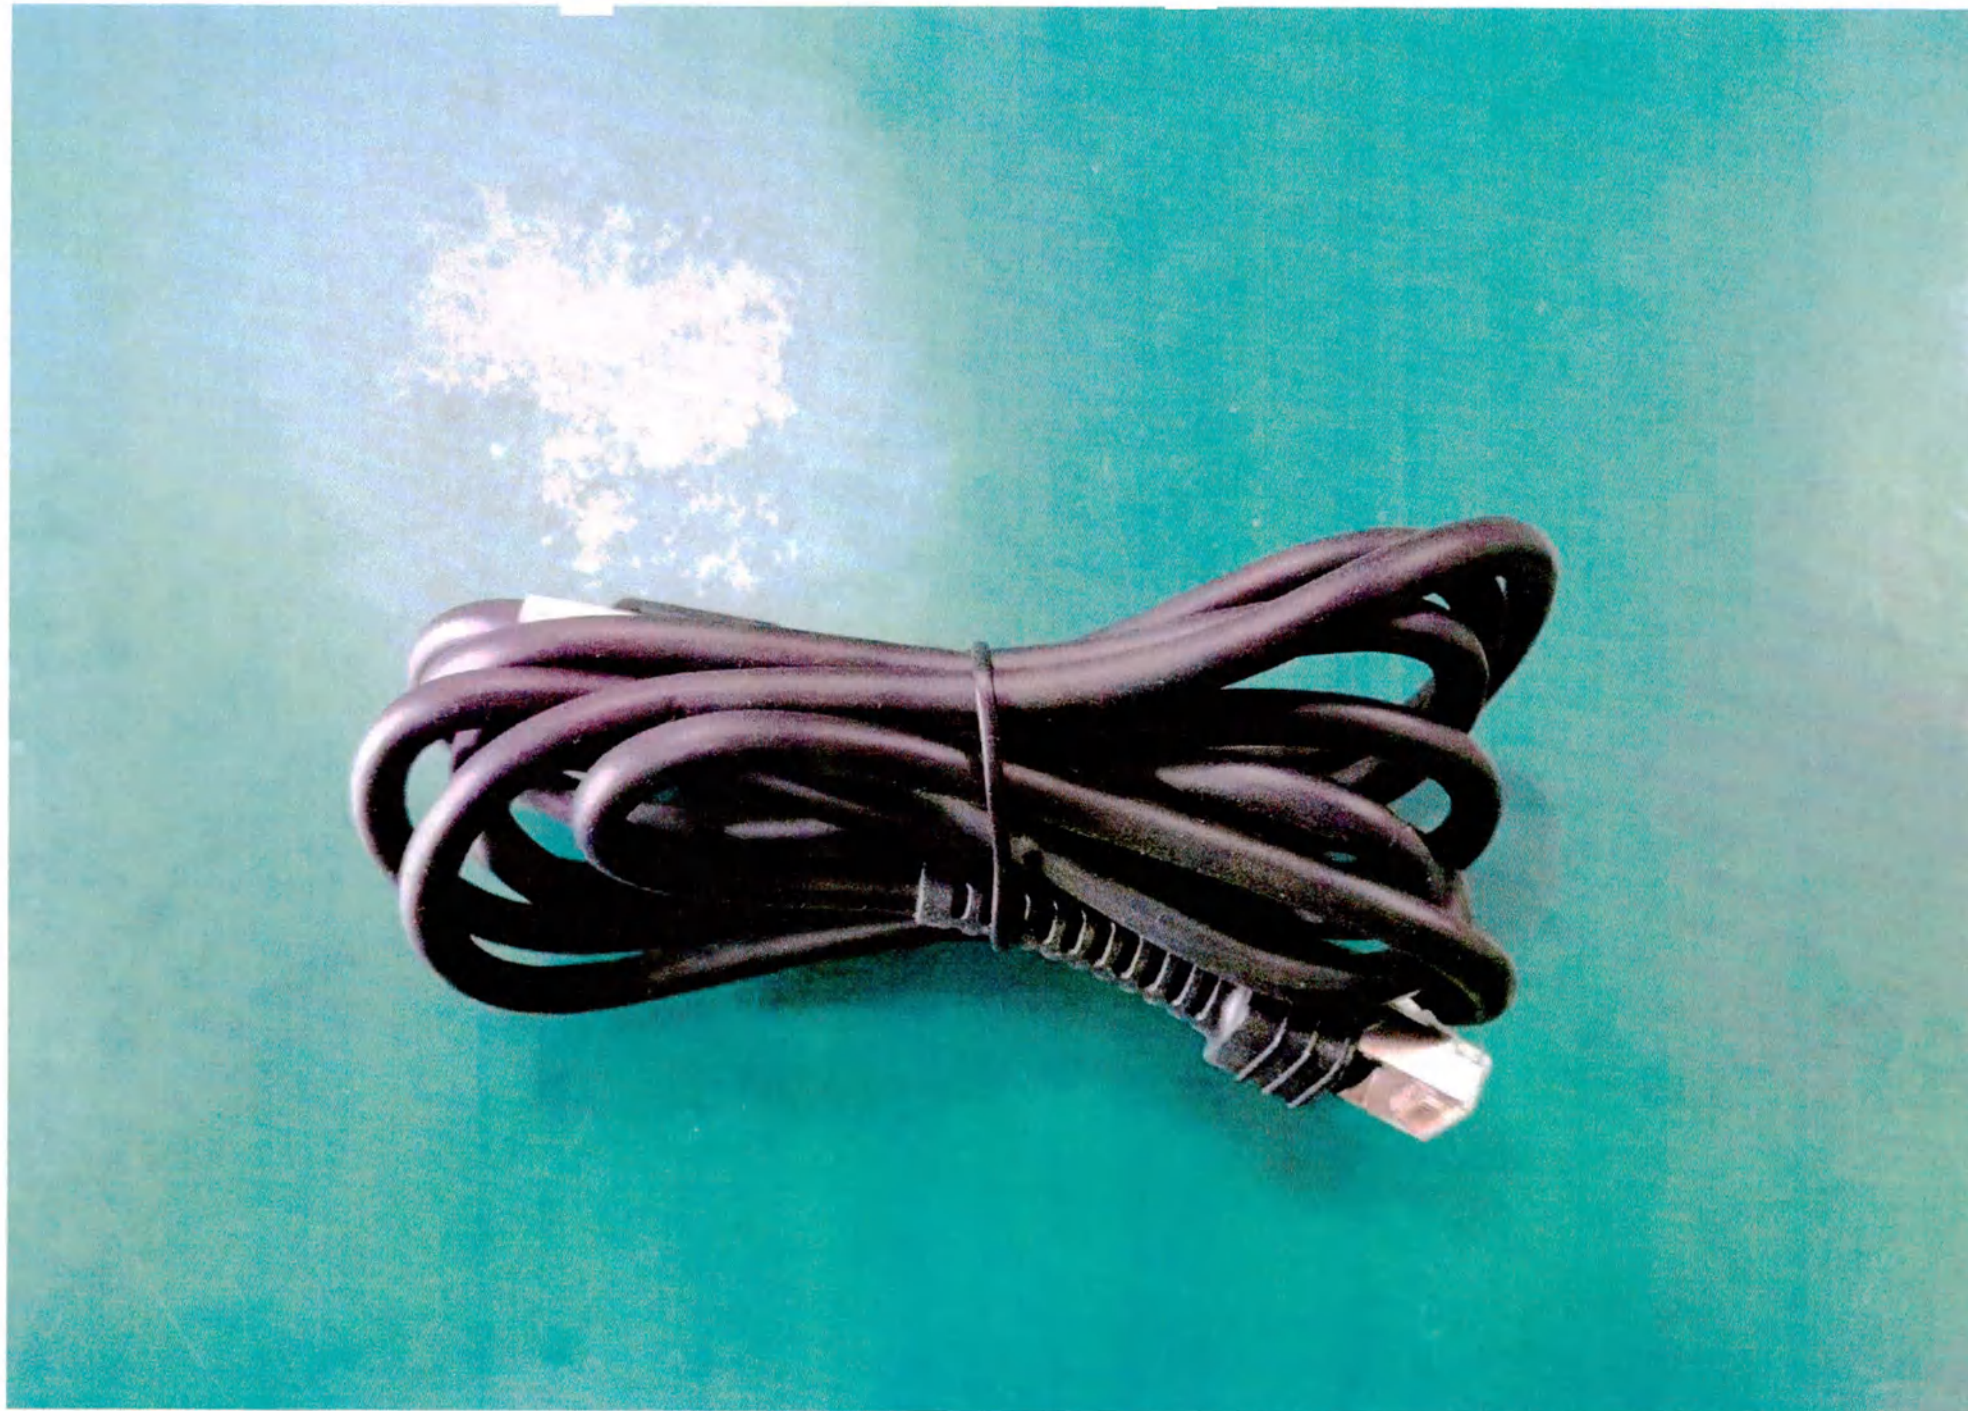

Кабель для внешнего сканера штрих-кодов

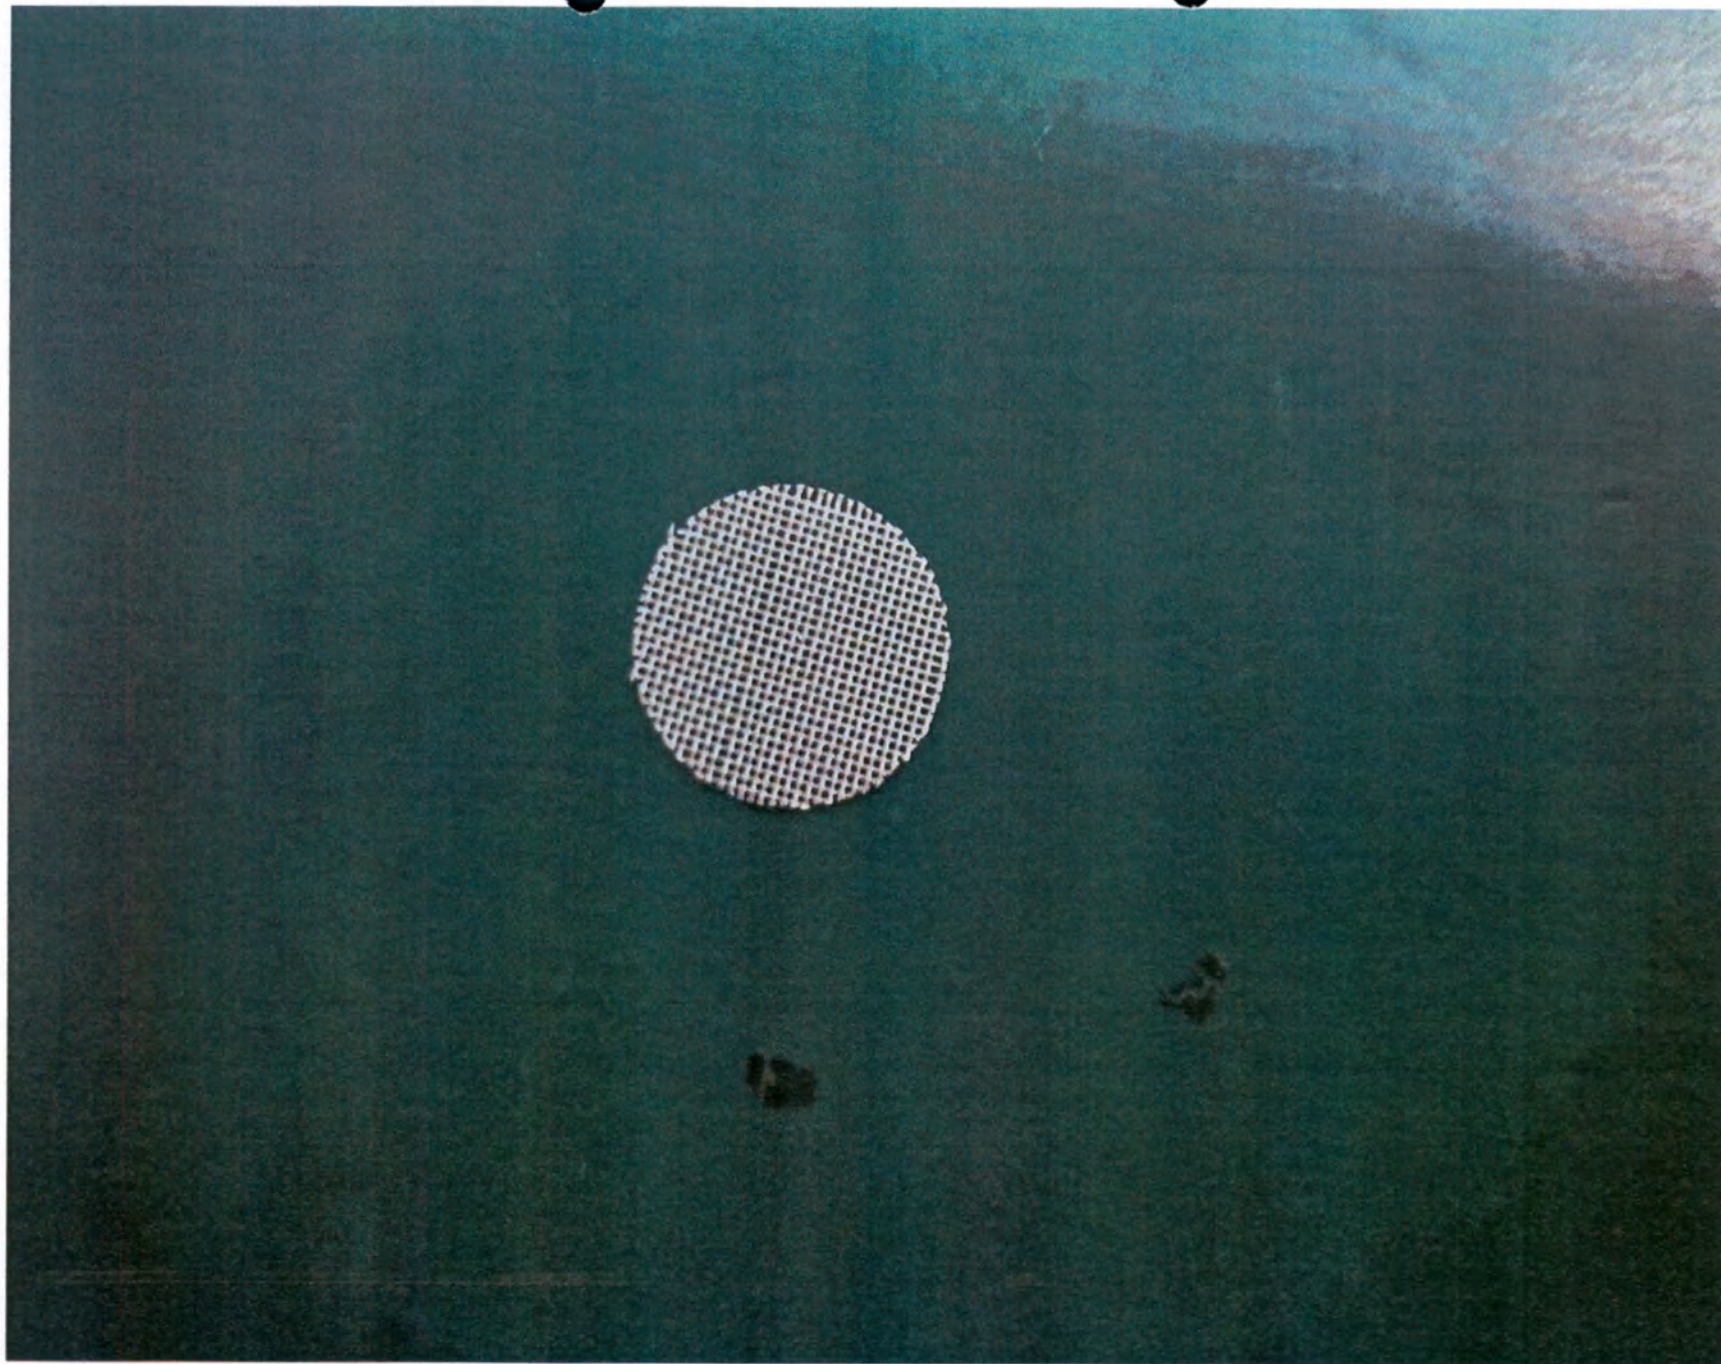

Фильтр

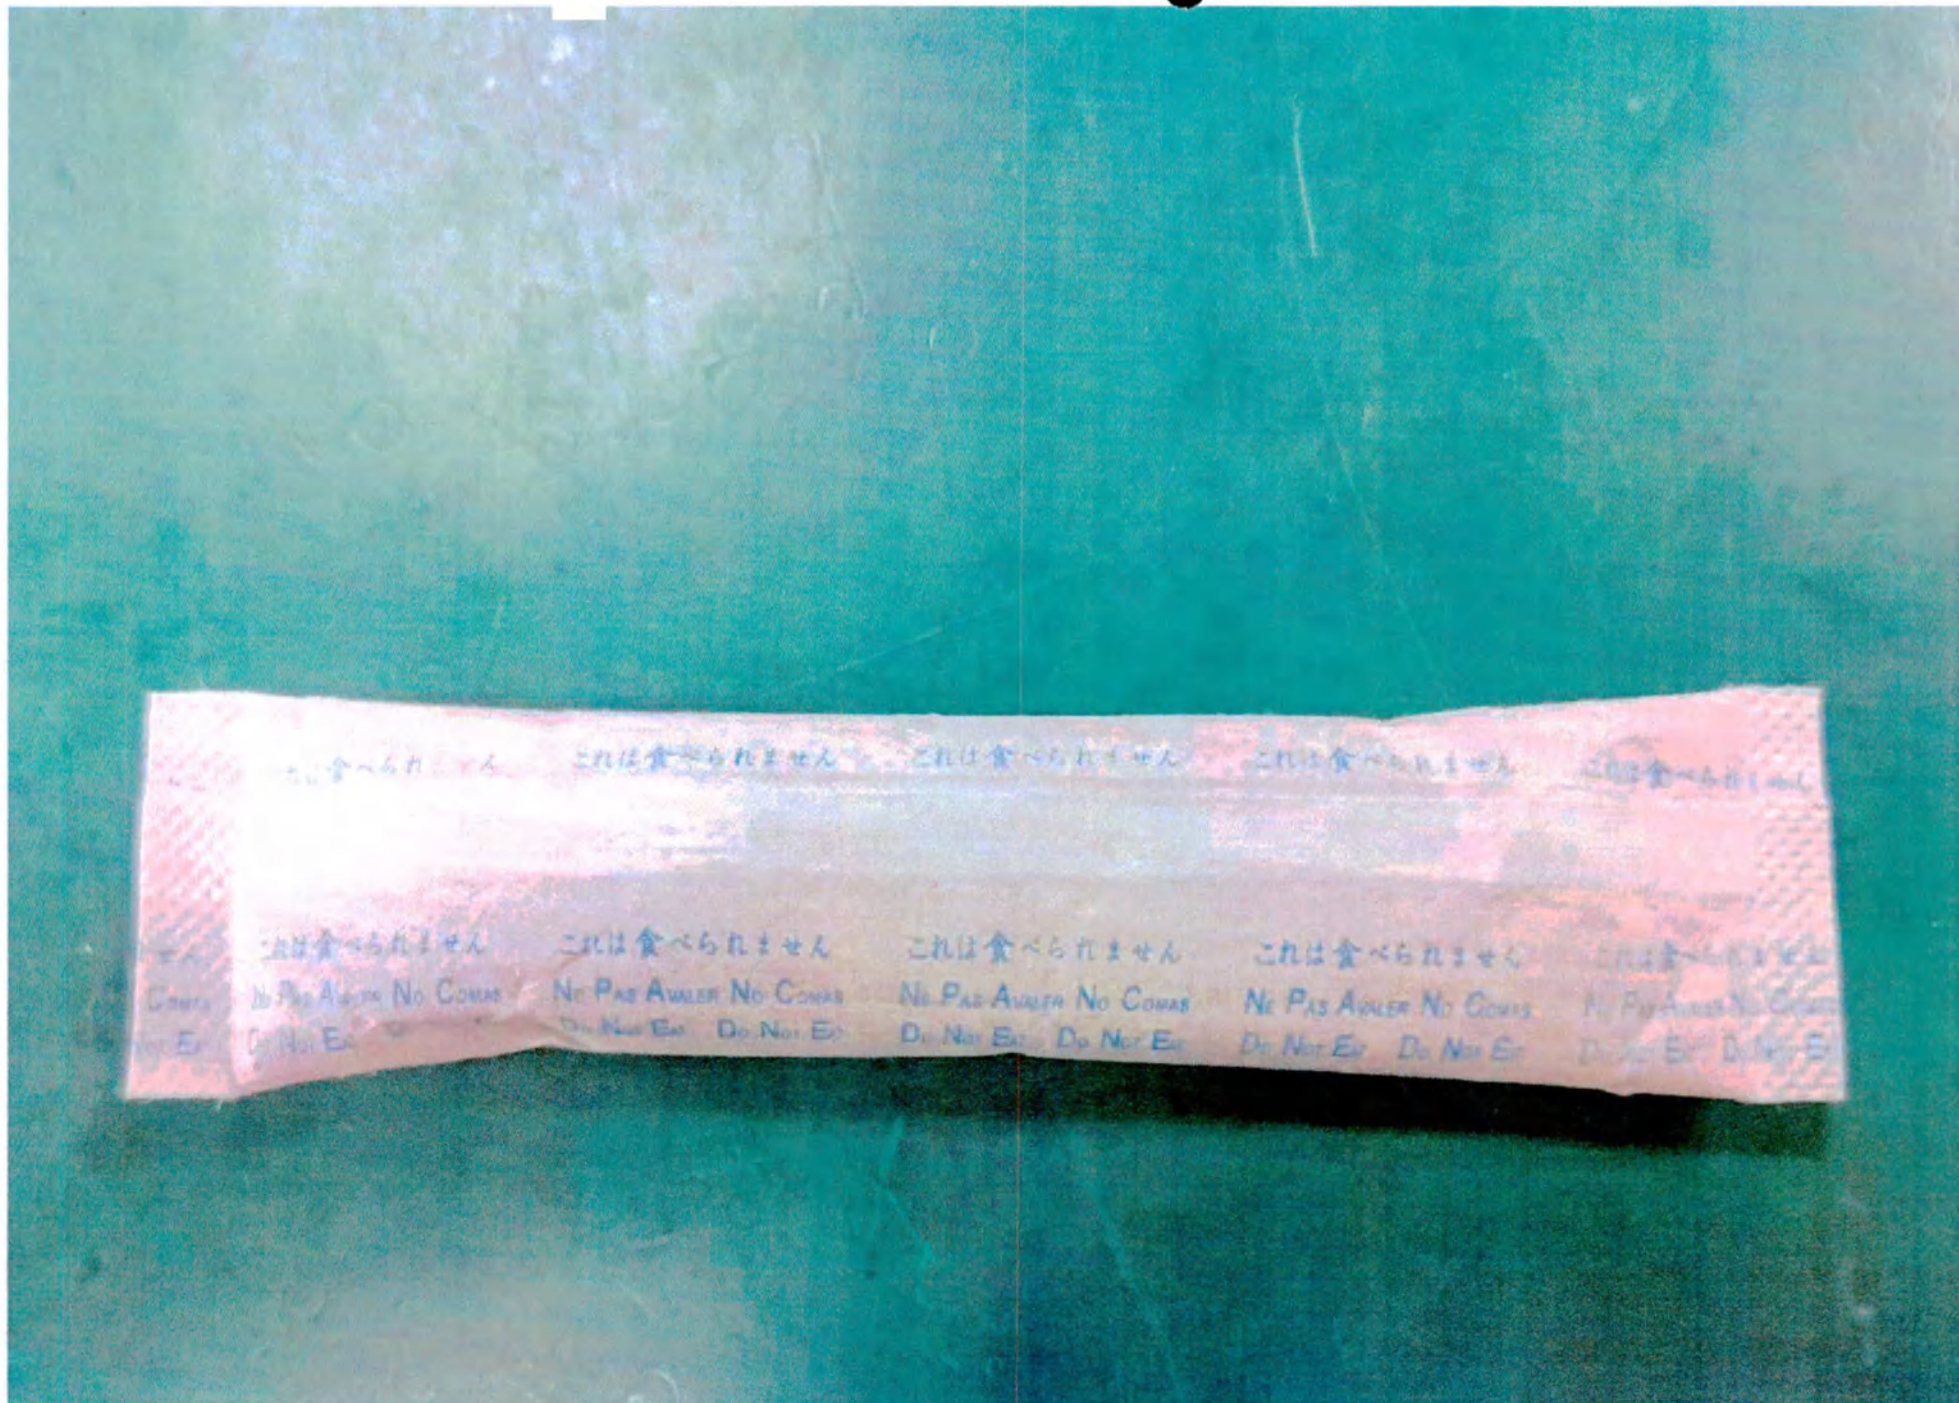

Влагопоглотитель



Наклейка «Биологическая опасность»

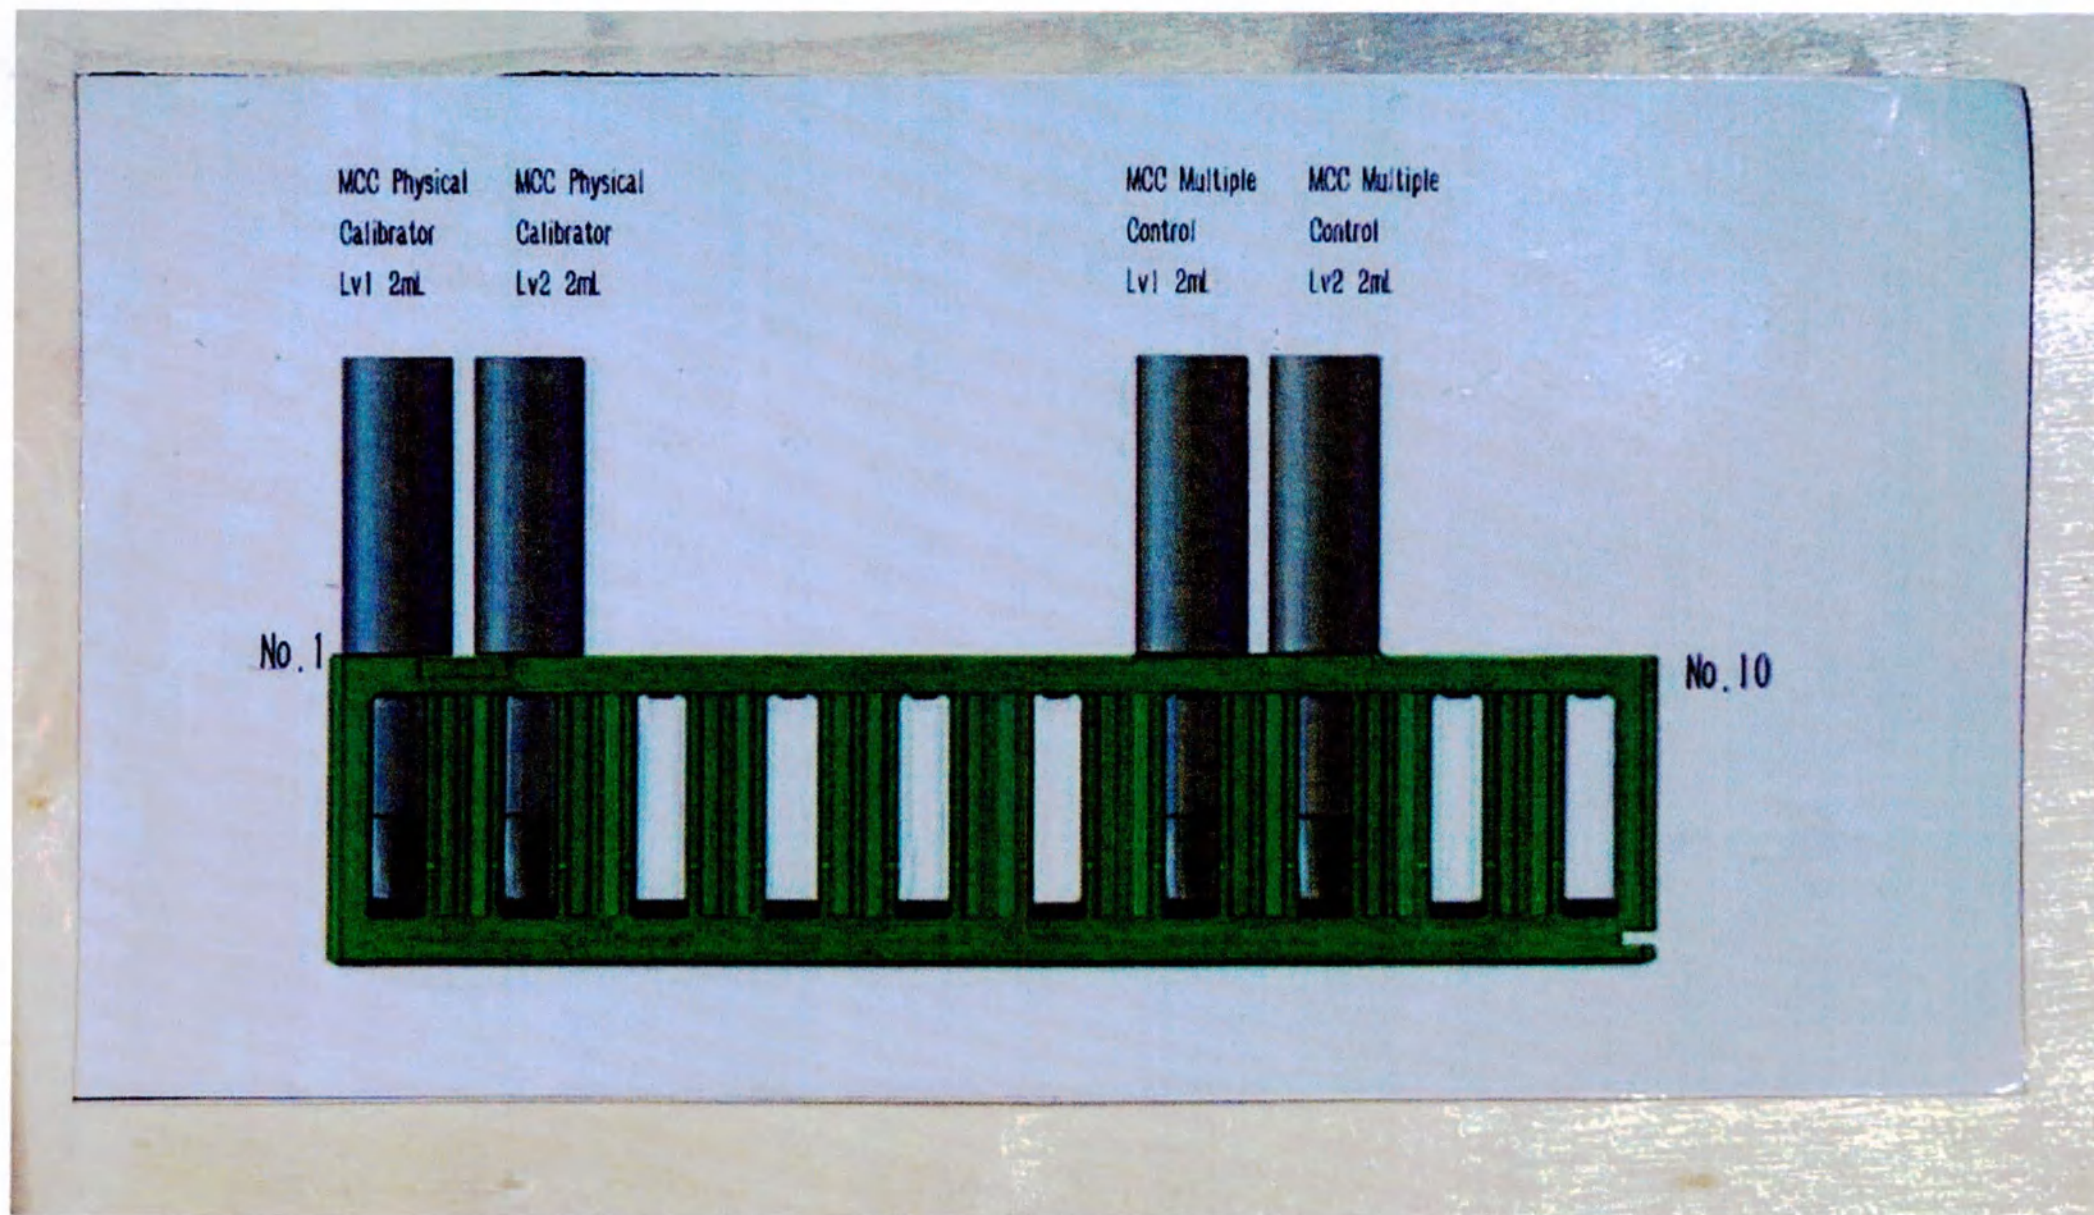


Схема загрузки штатива для контроля и калибровки СА-500


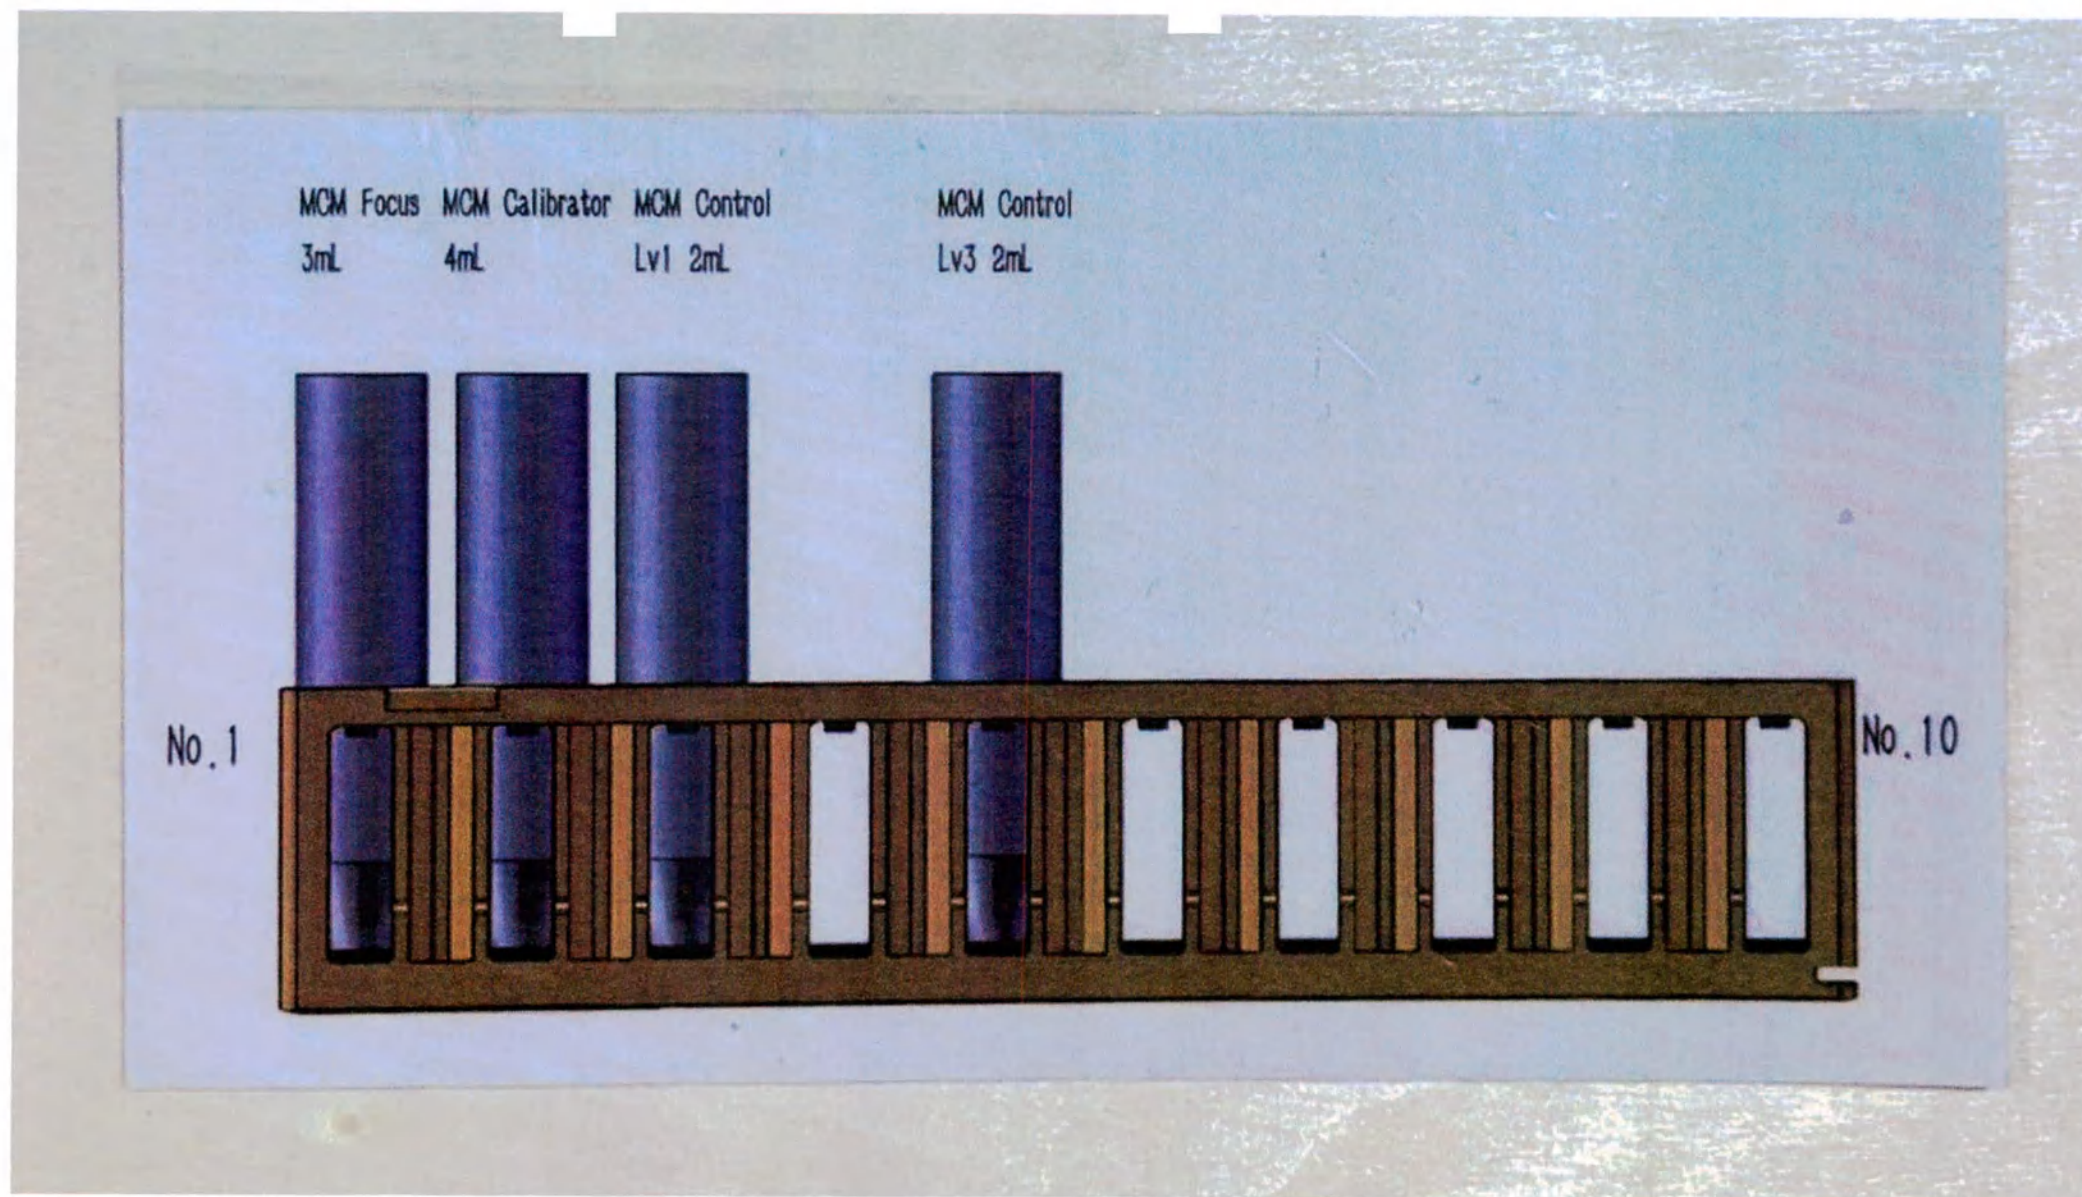


Схема загрузки штатива для контроля и калибровки МА-500



Заглушка для автоподатчика

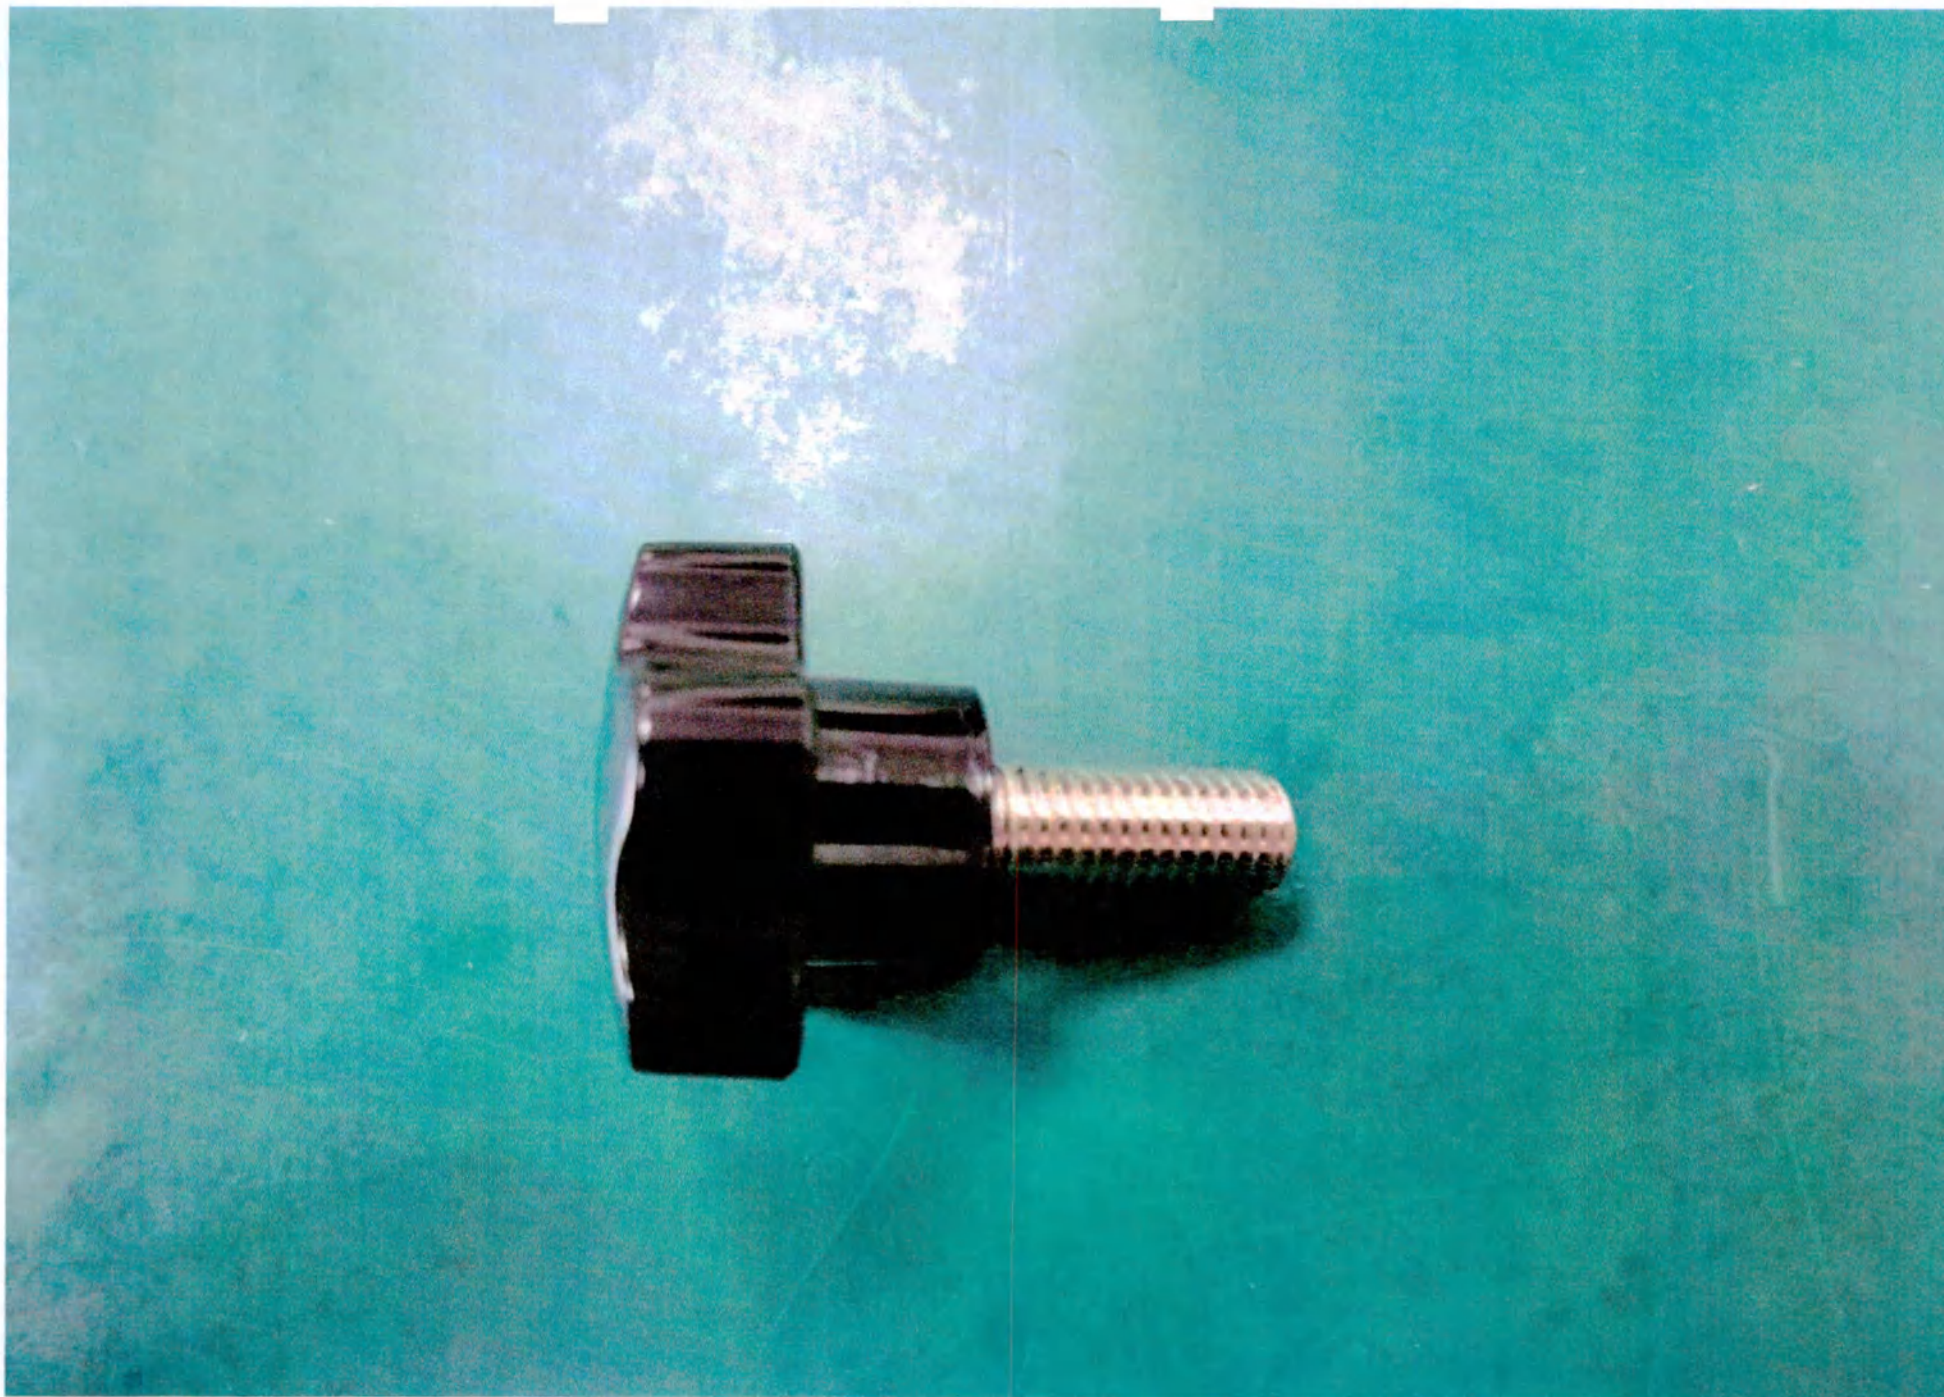


Винт для фиксации автоподатчика



Бумага для термопечати



Ключ

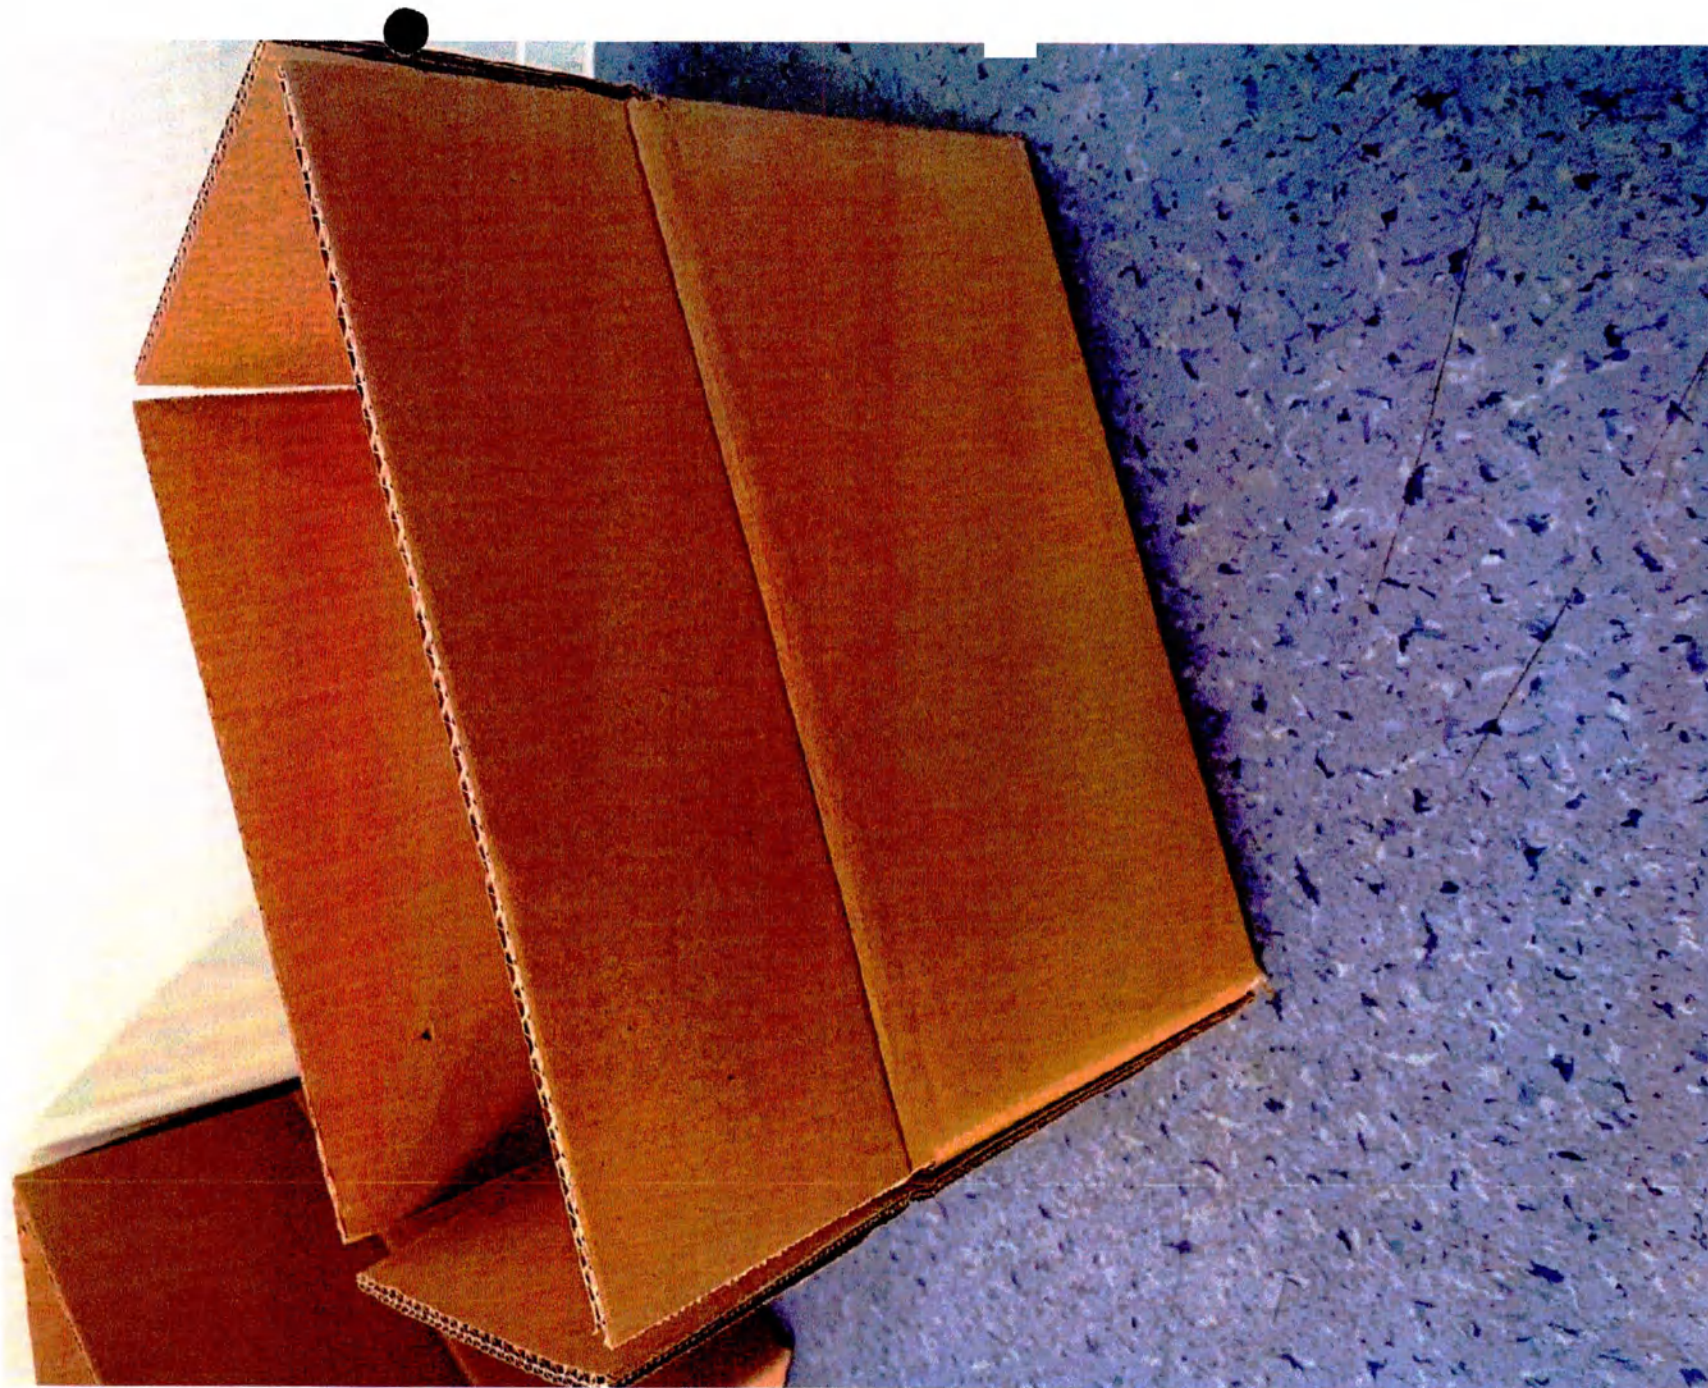

Упаковка набора компьютерных комплектующих №1, Упаковка набора компьютерных комплектующих №2, Упаковка набора компьютерных комплектующих №3

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Набор компьютерных комплектующих №1

Для уточнения состава набора обратитесь к информации о комплекте поставки.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan

County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China

Макет этикетки на упаковке набора компьютерных комплектующих №1

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Набор компьютерных комплектующих №2, в составе:

- Плата расширения 1 в 8 (Контроллер) – 1 шт.;
- Кабель-разветвитель последовательного порта (1 в 8) – 1 шт.;

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan

County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China

Макет этикетки на упаковке набора компьютерных комплектующих №2

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Набор компьютерных комплектующих №3

Для уточнения состава набора обратитесь к информации о комплекте поставки.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай


2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan

County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China

Макет этикетки на упаковке набора компьютерных комплектующих №3




Набор компьютерных комплектующих №1: Плата расширения 1 в 4 (Контроллер)

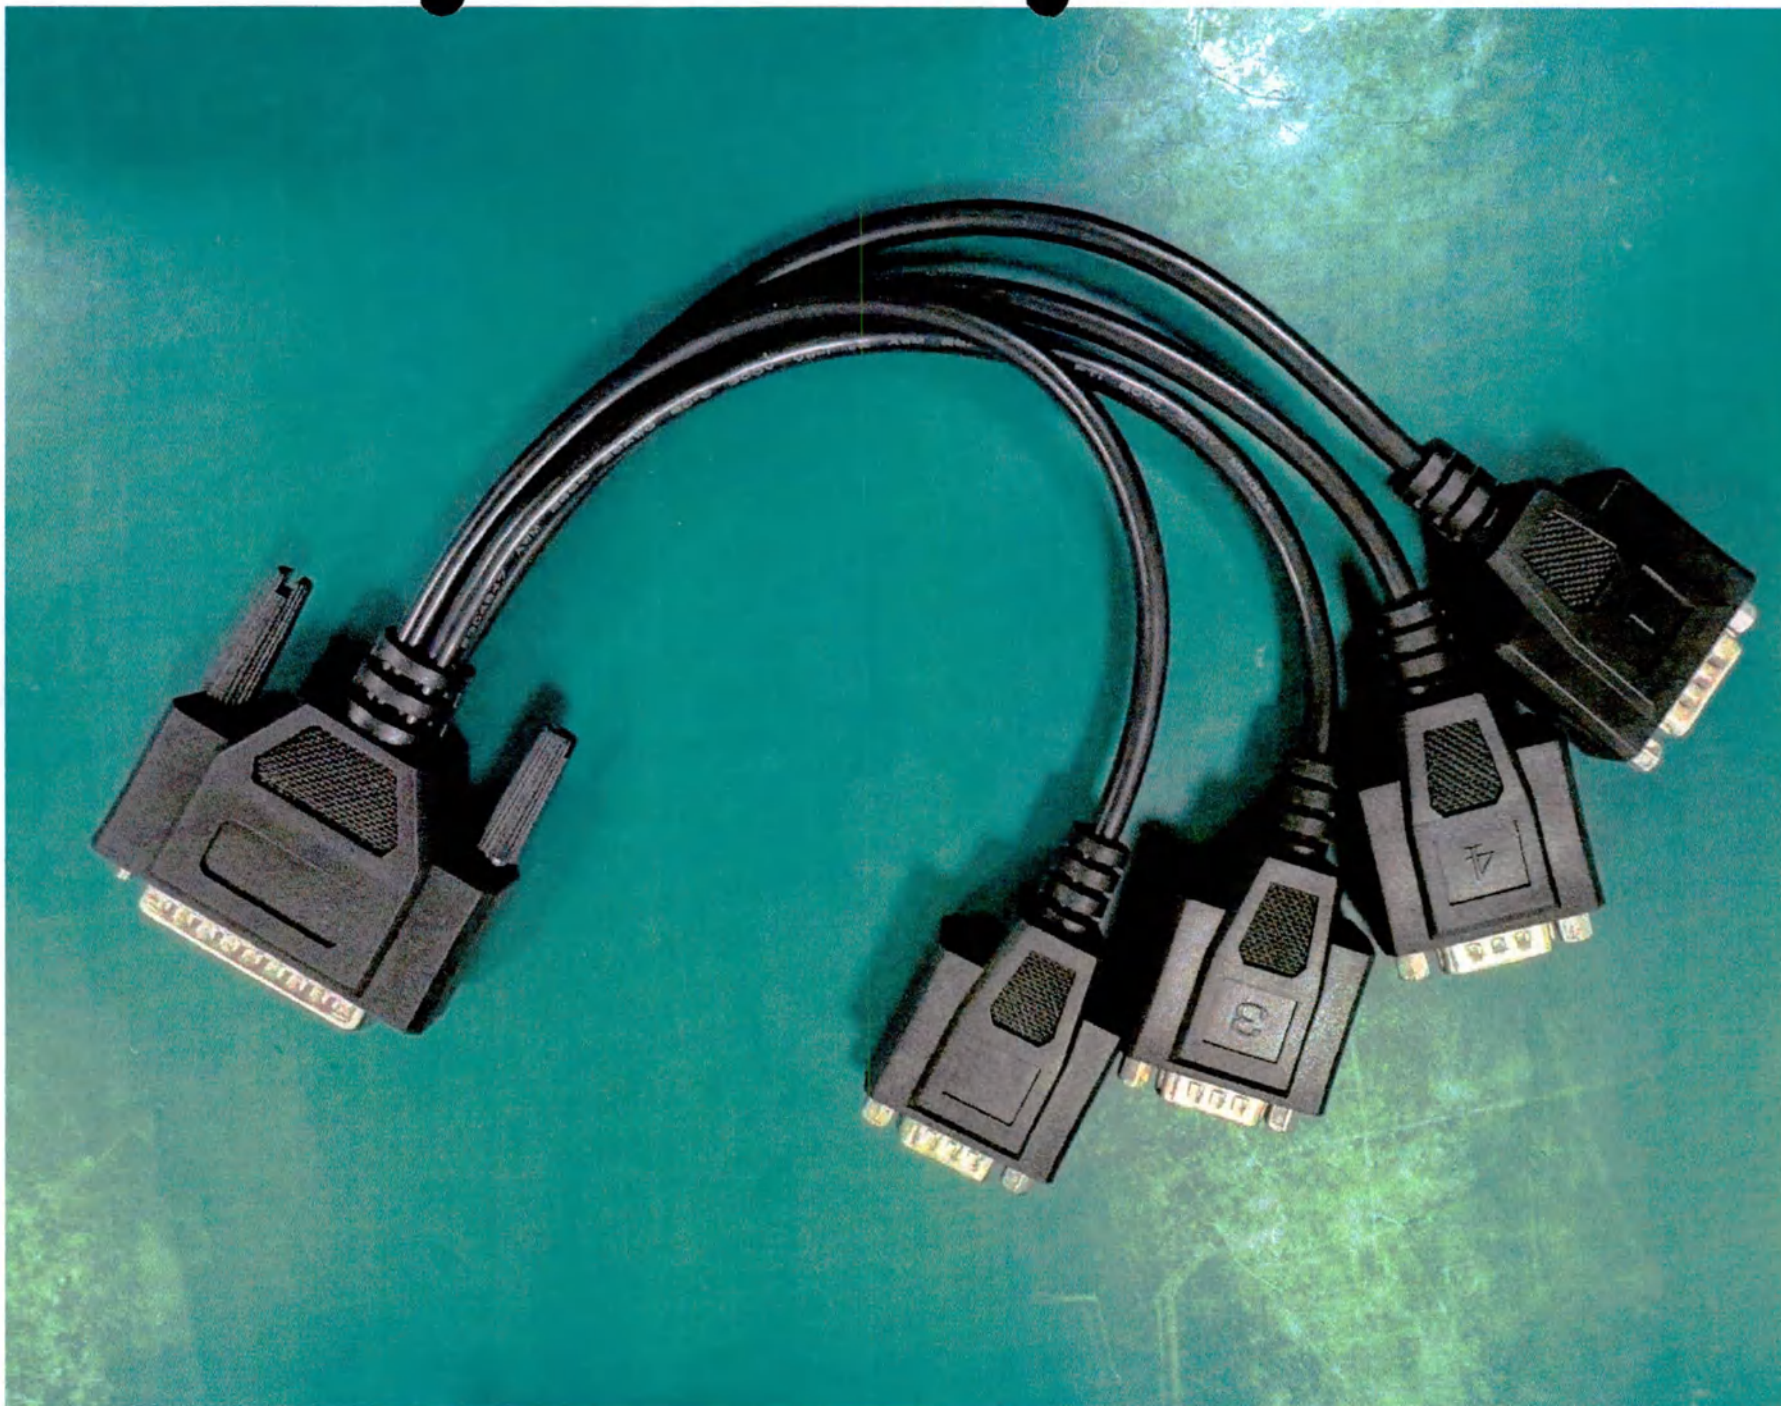


Набор компьютерных комплектующих №1: Кабель-разветвитель последовательного порта (1 в 4)




Набор компьютерных комплектующих №1: Винт

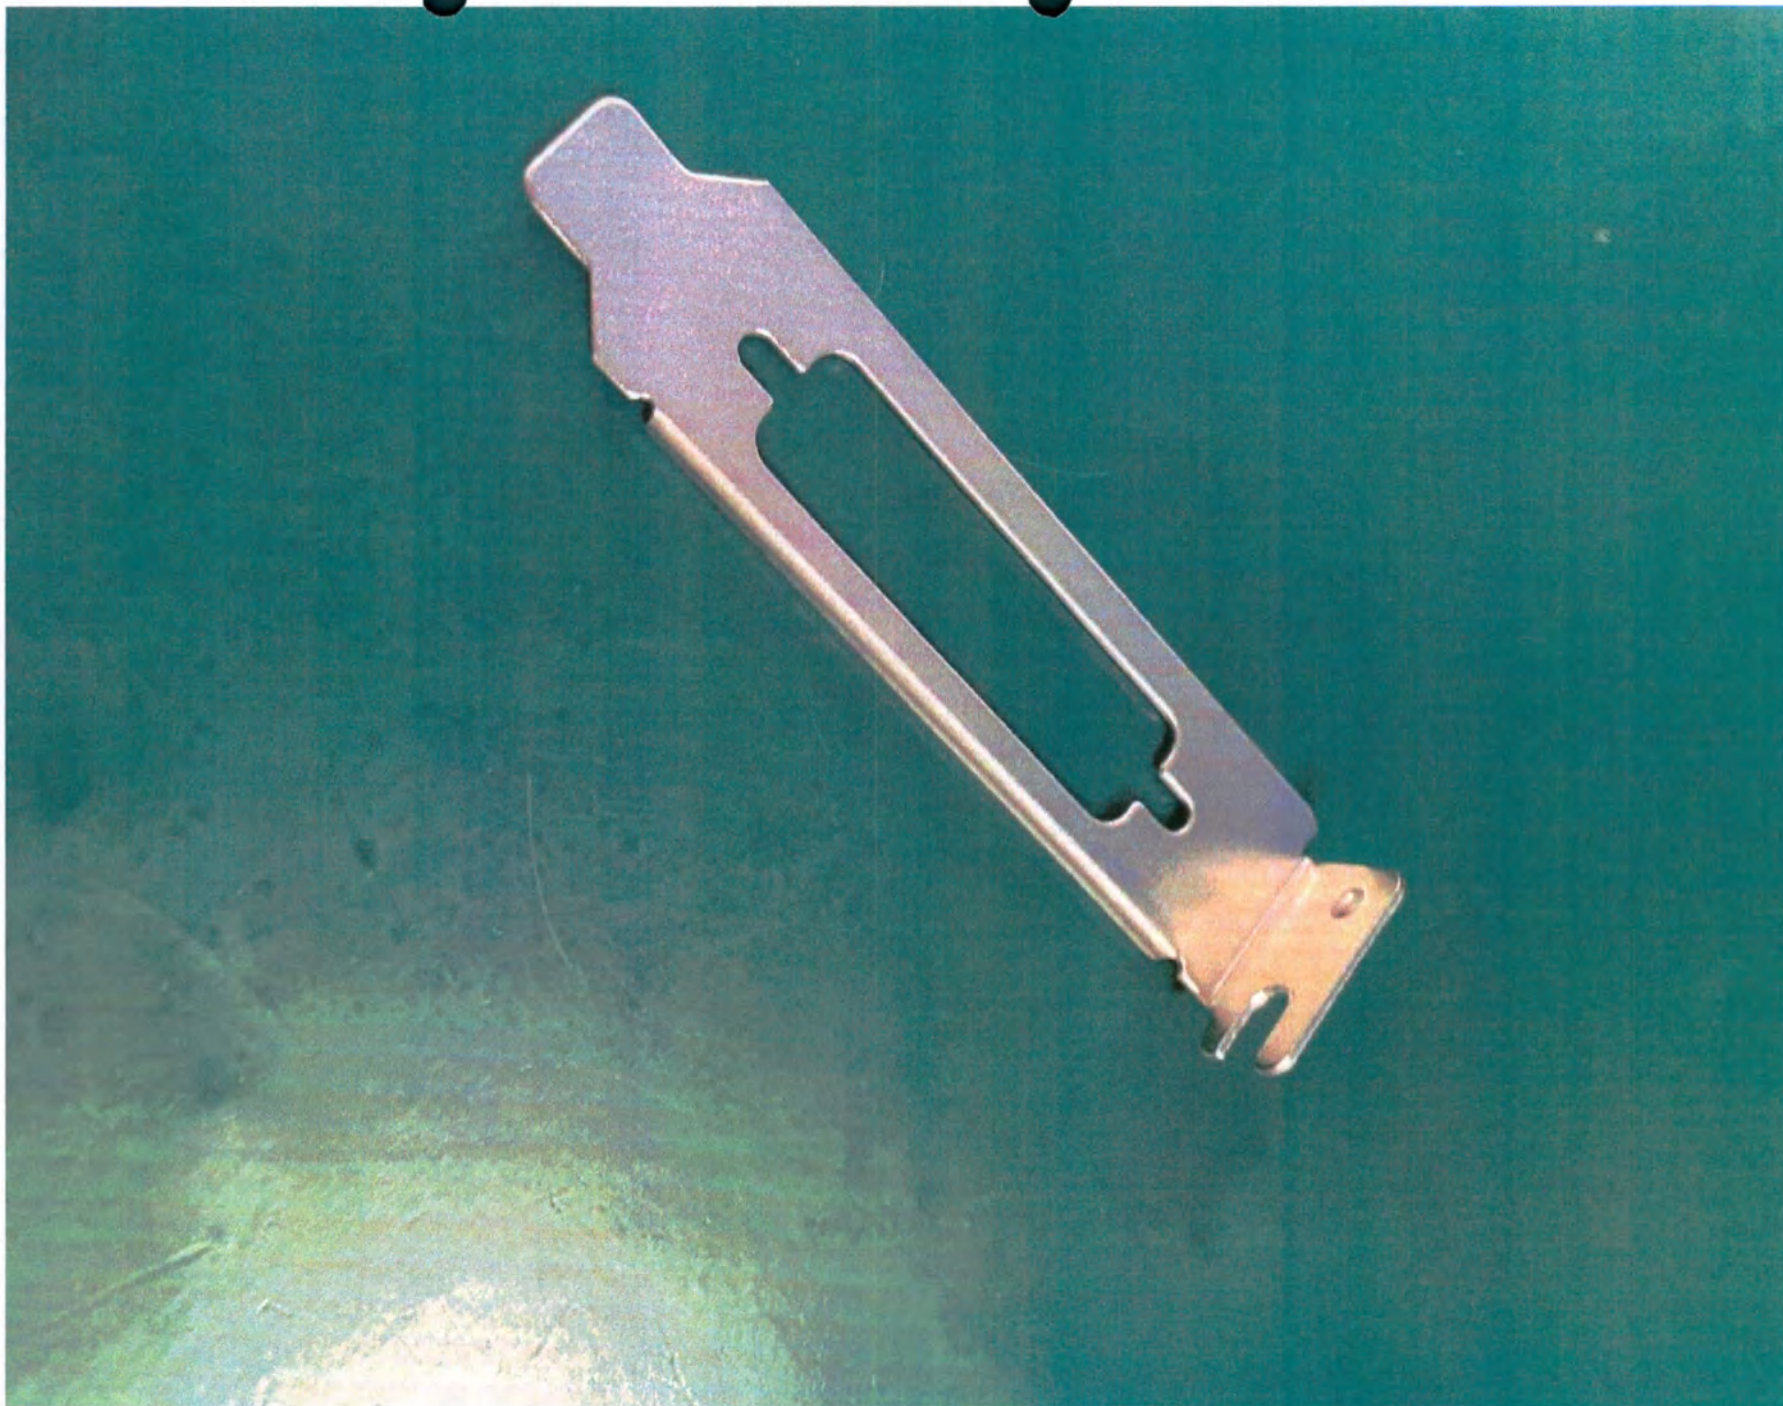

Набор компьютерных комплектующих №1: Пластина

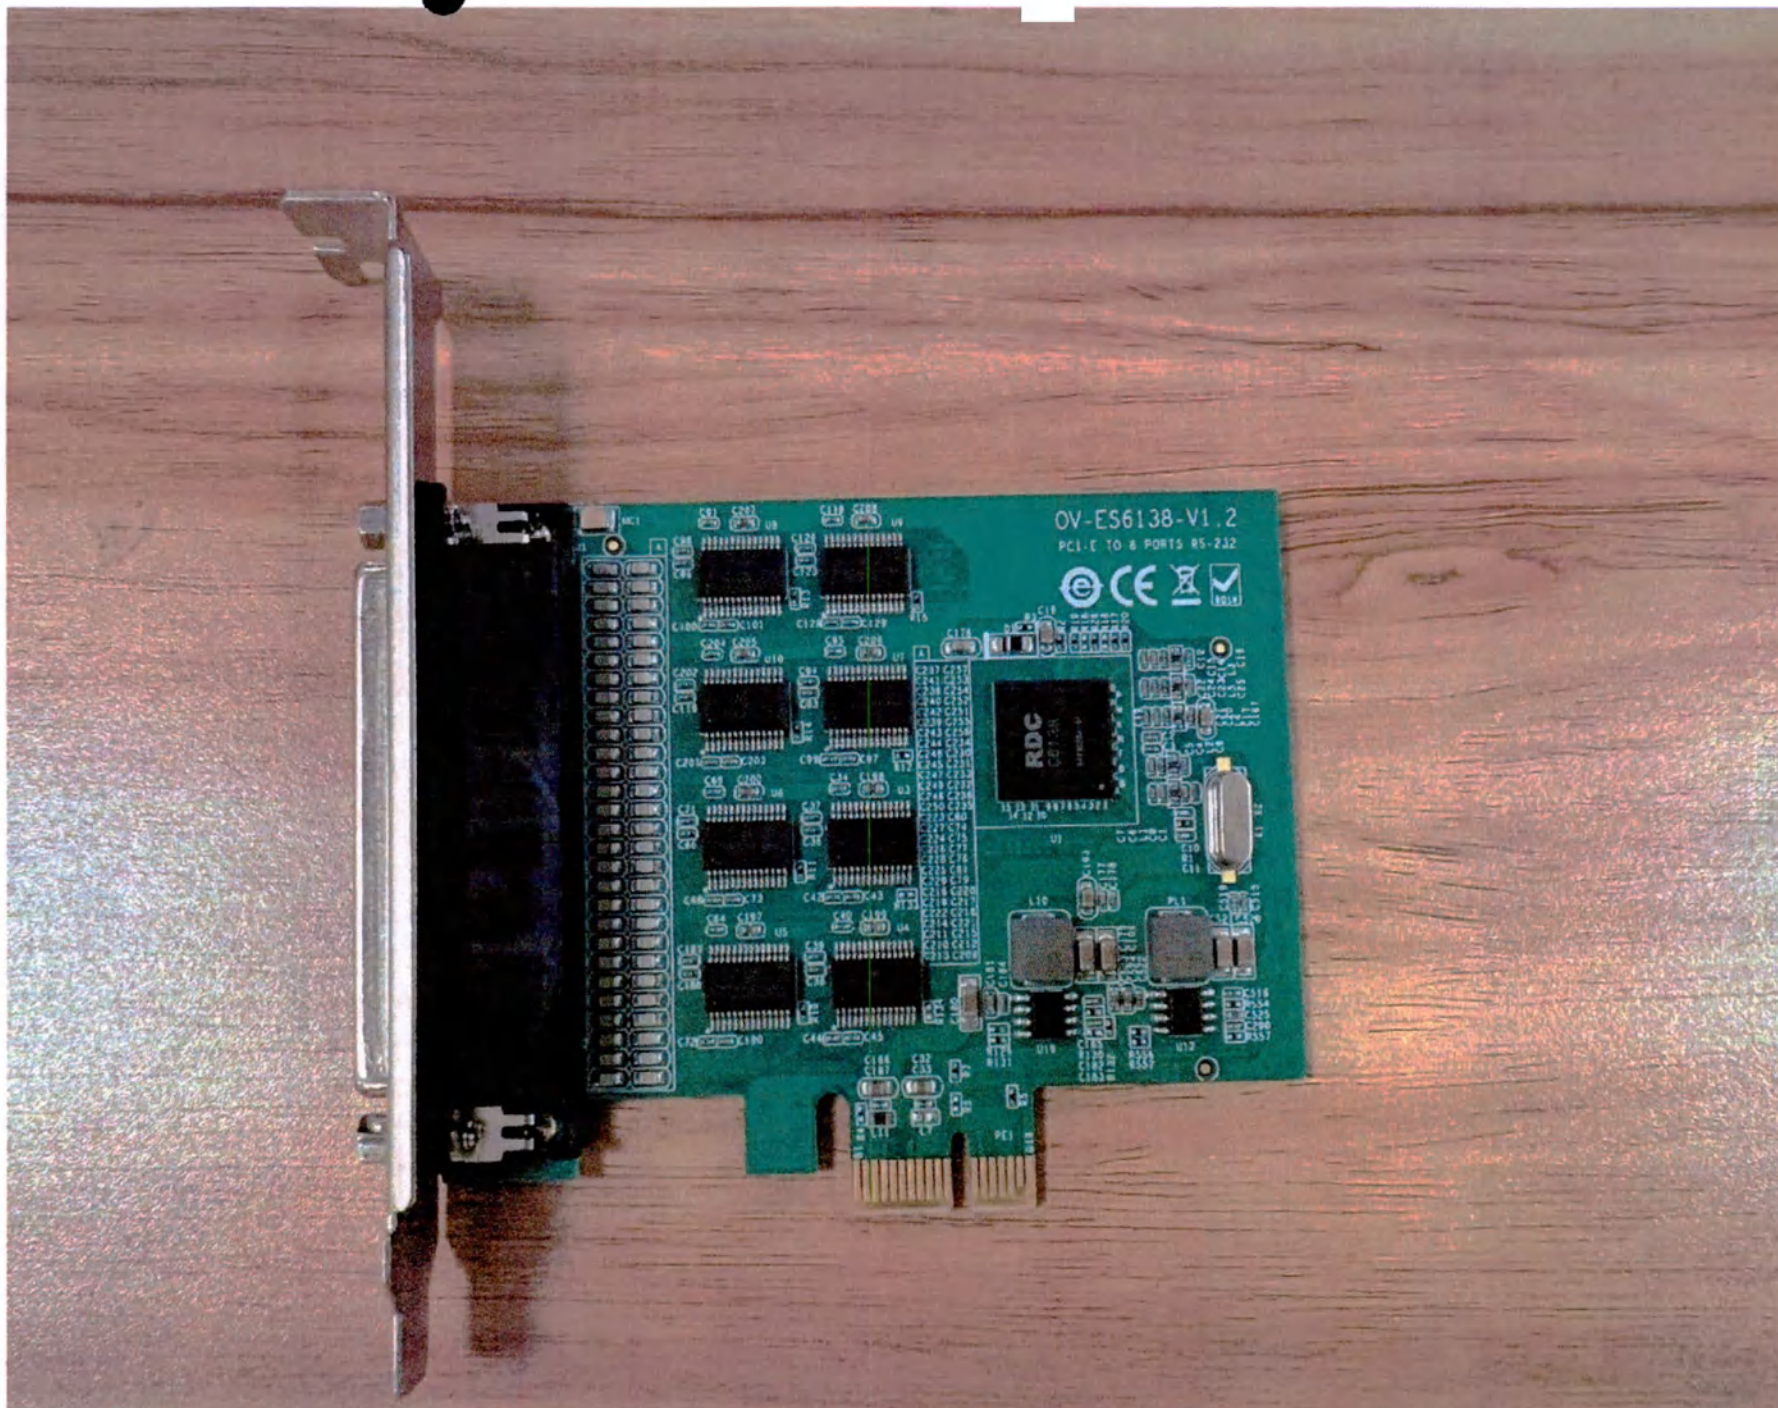


Набор компьютерных комплектующих №2: Плата расширения 1 в 8 (Контроллер)

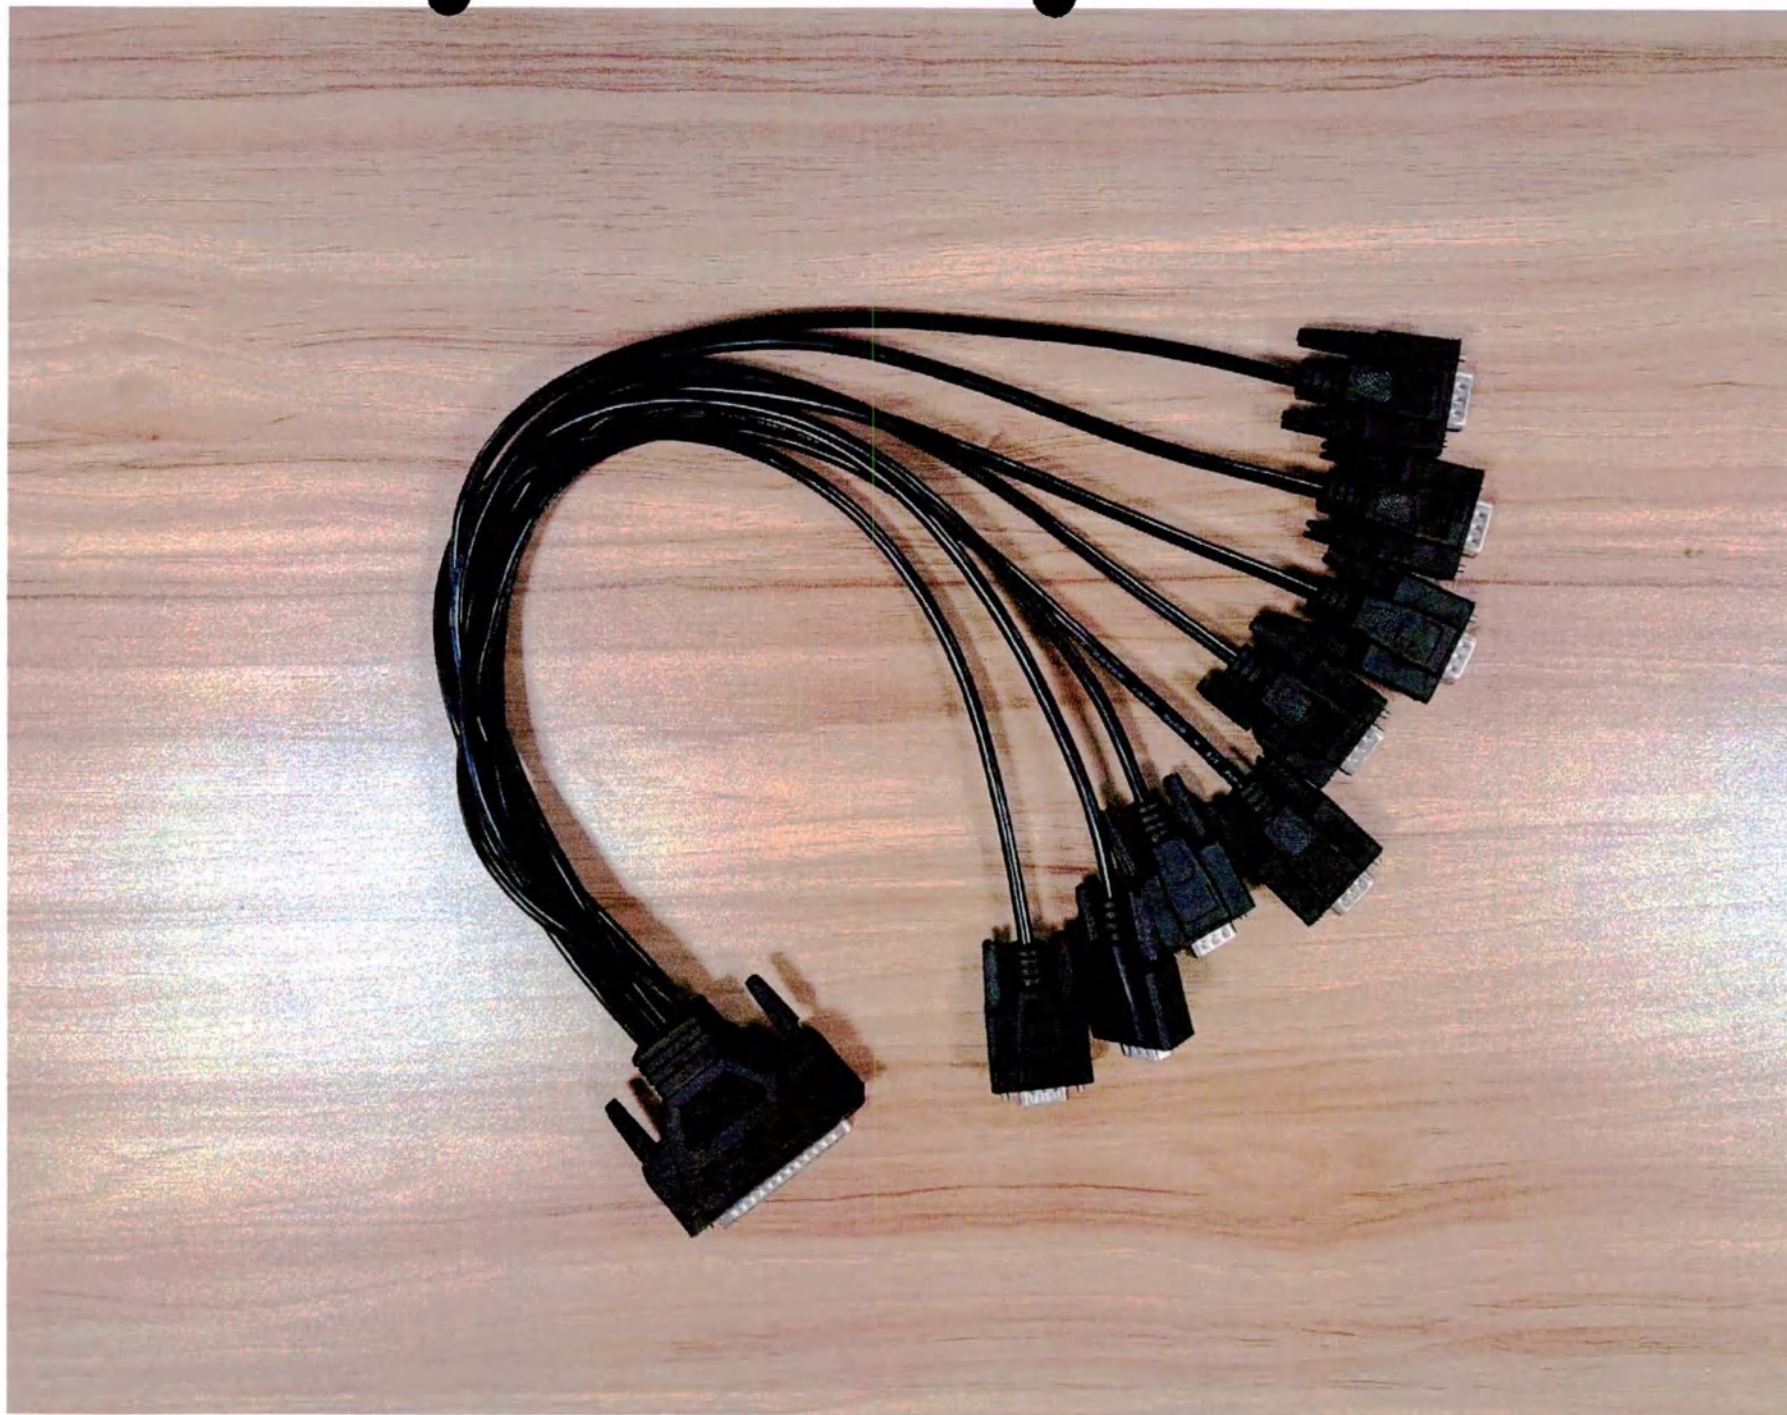


Набор компьютерных комплектующих №2: Кабель-разветвитель последовательного порта (1 в 8)




Набор компьютерных комплектующих №3: Устройство для считывания смарт-карт

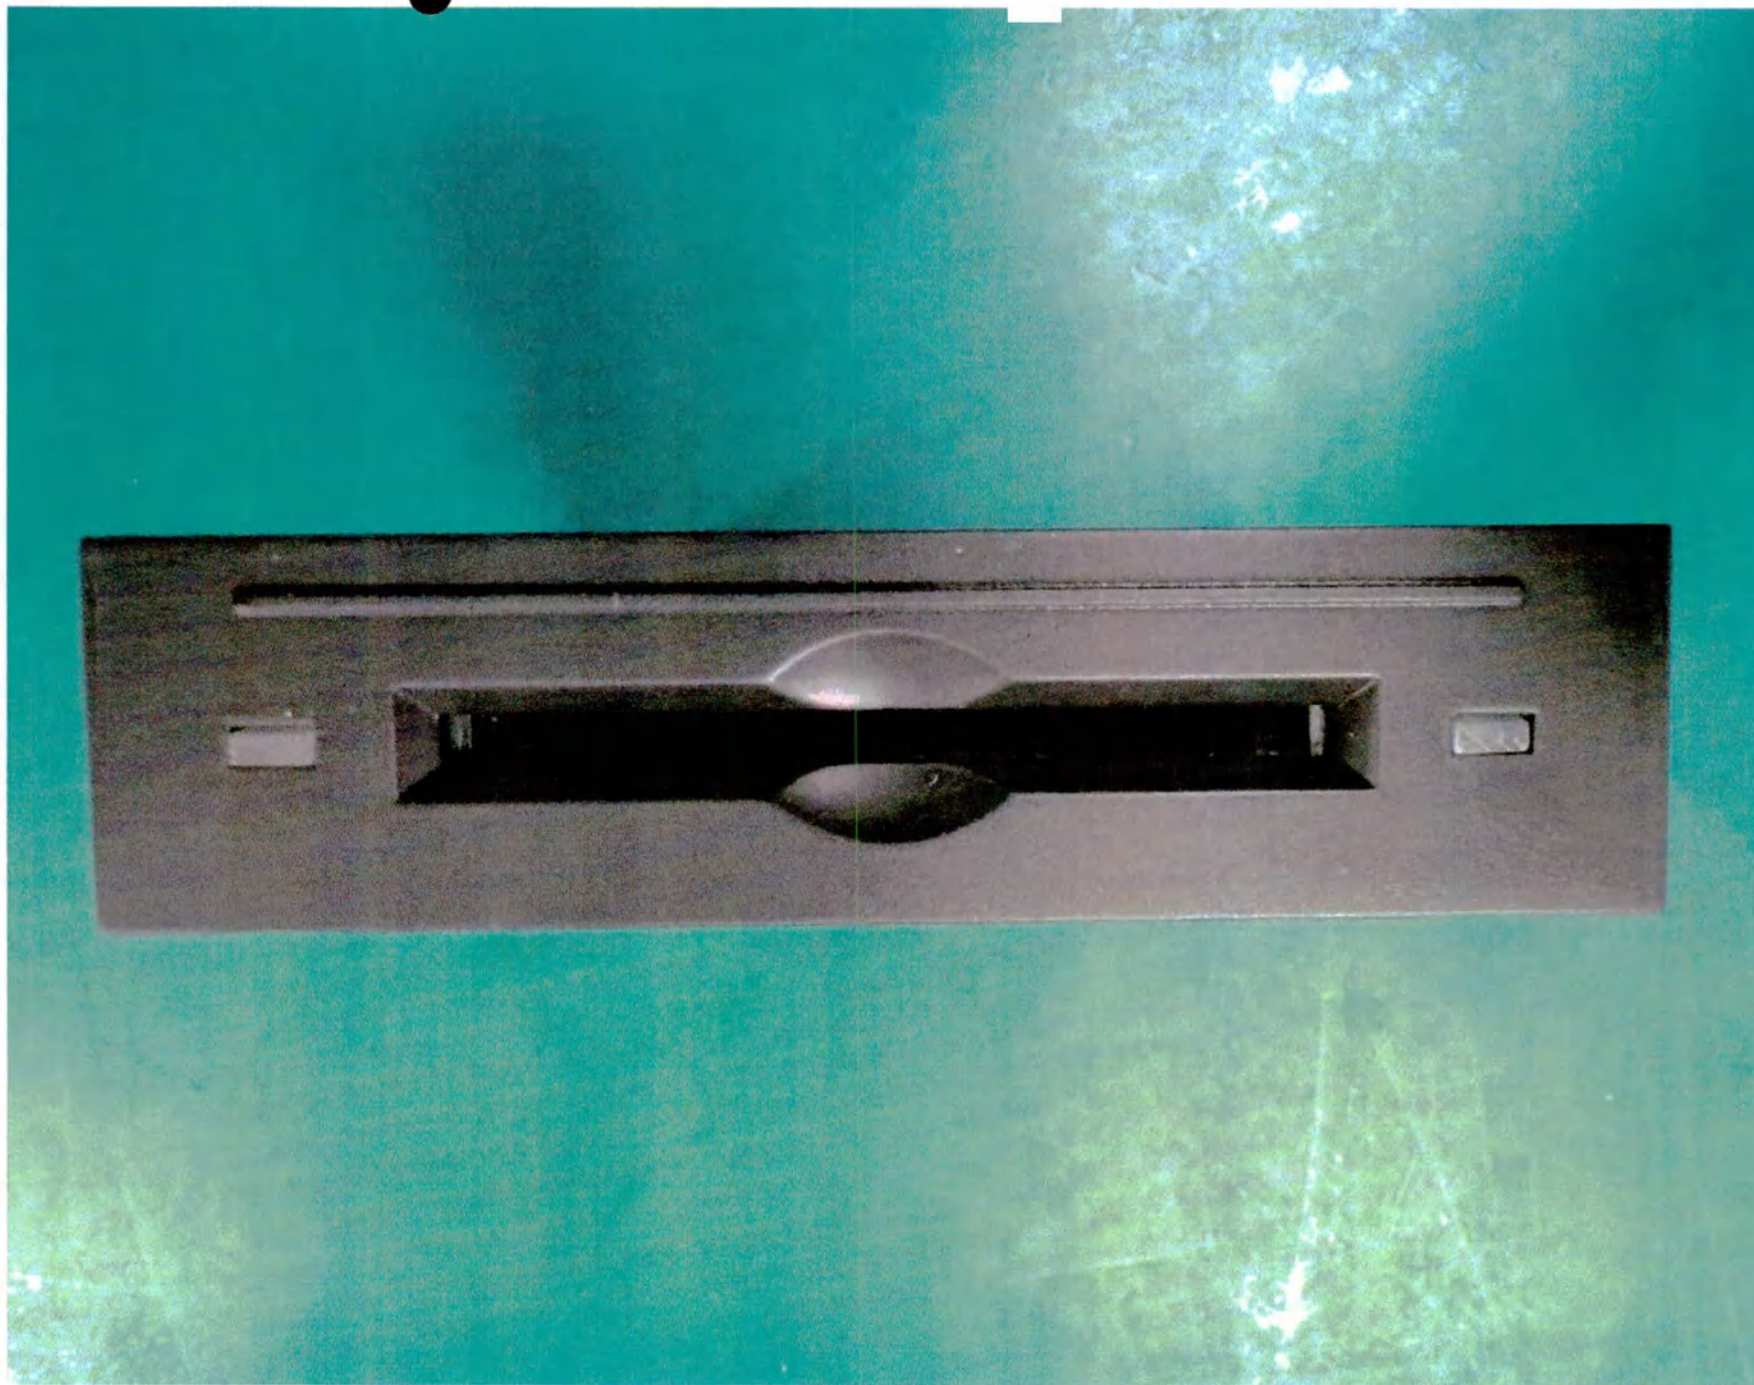

Набор компьютерных комплектующих №3: Устройство для считывания смарт-карт

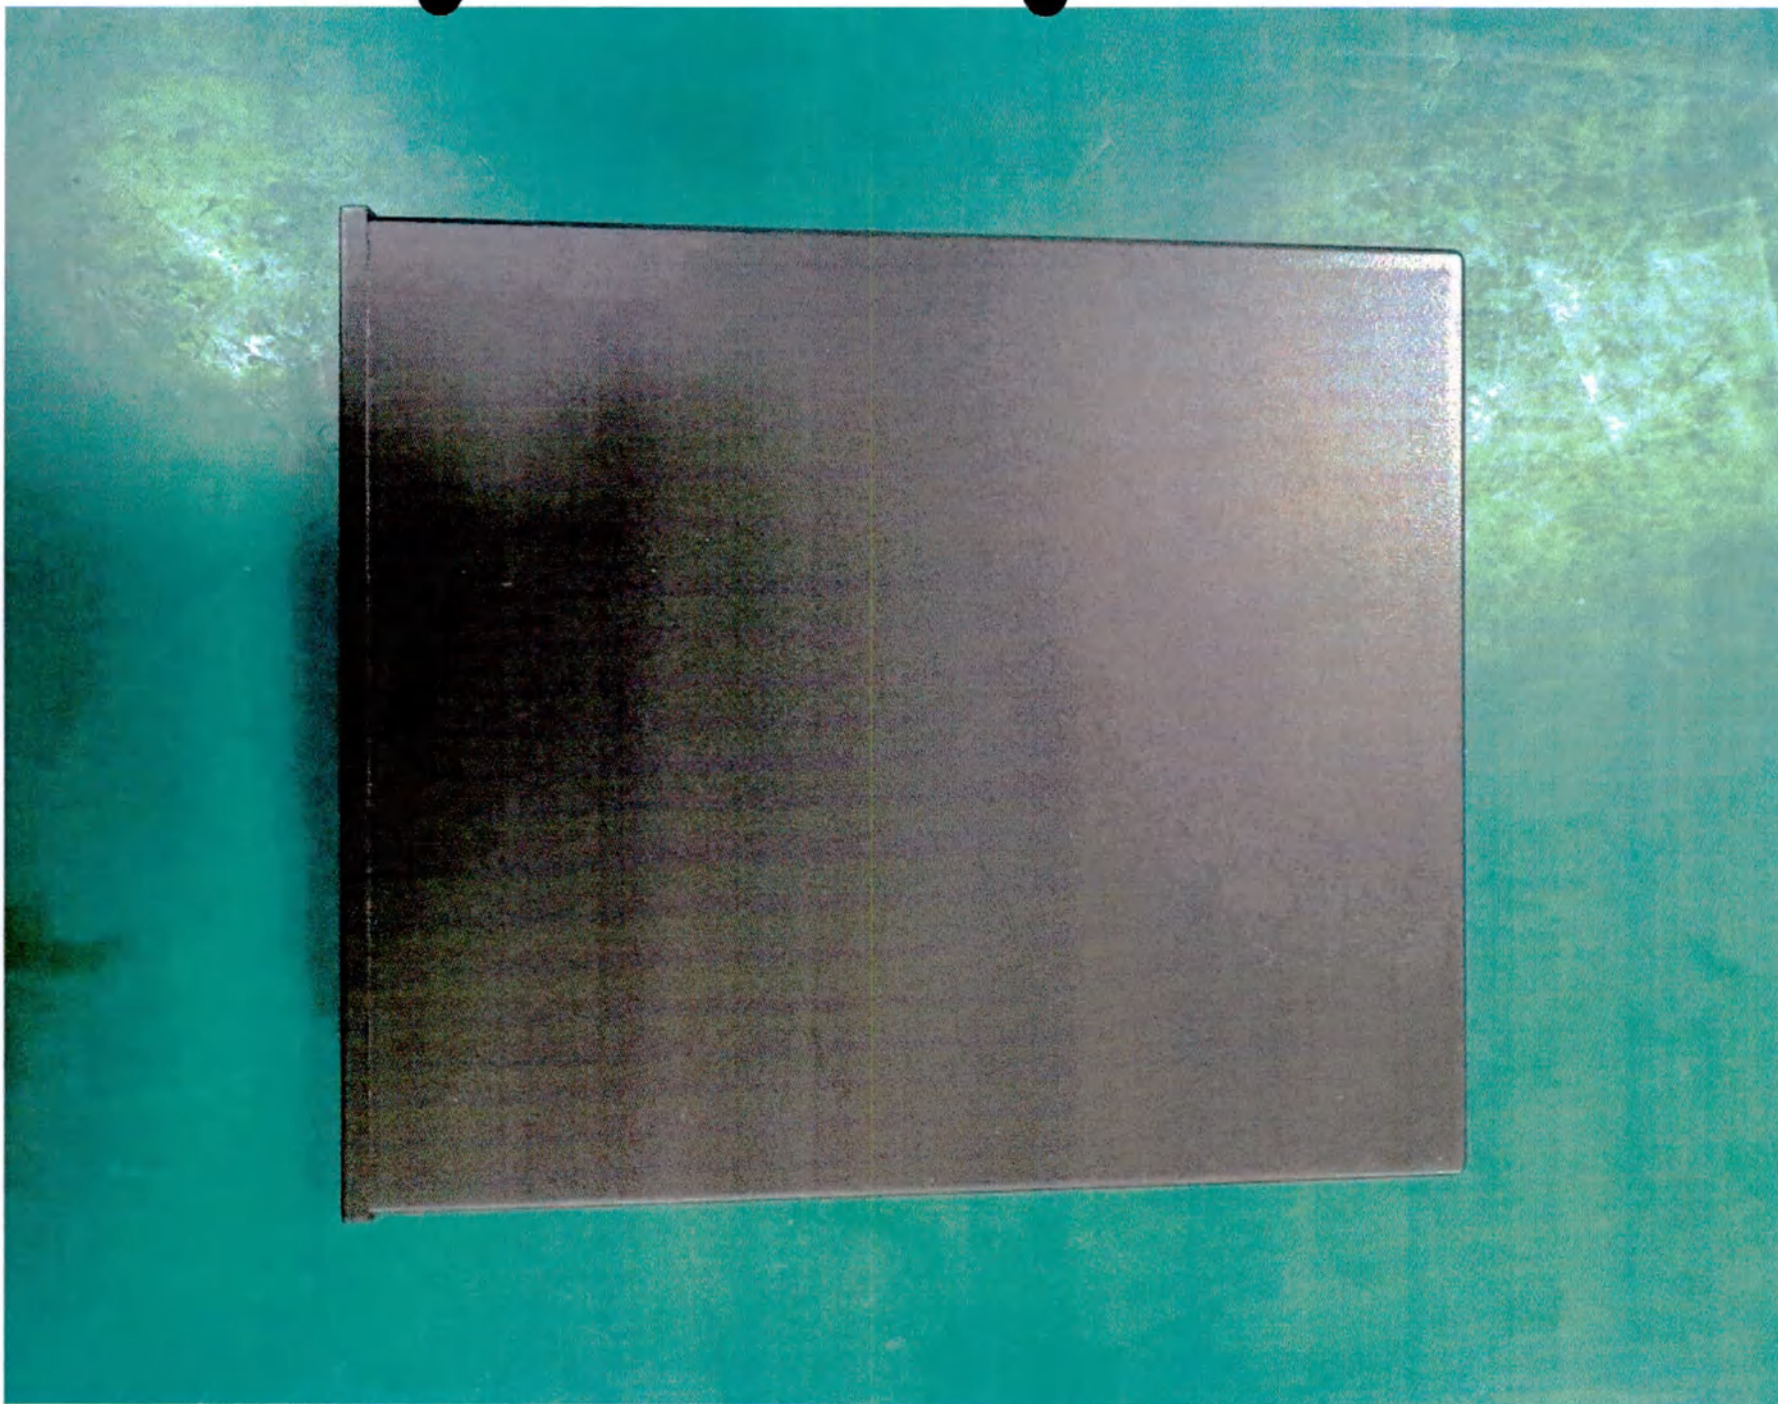

Набор компьютерных комплектующих №3: Устройство для считывания смарт-карт

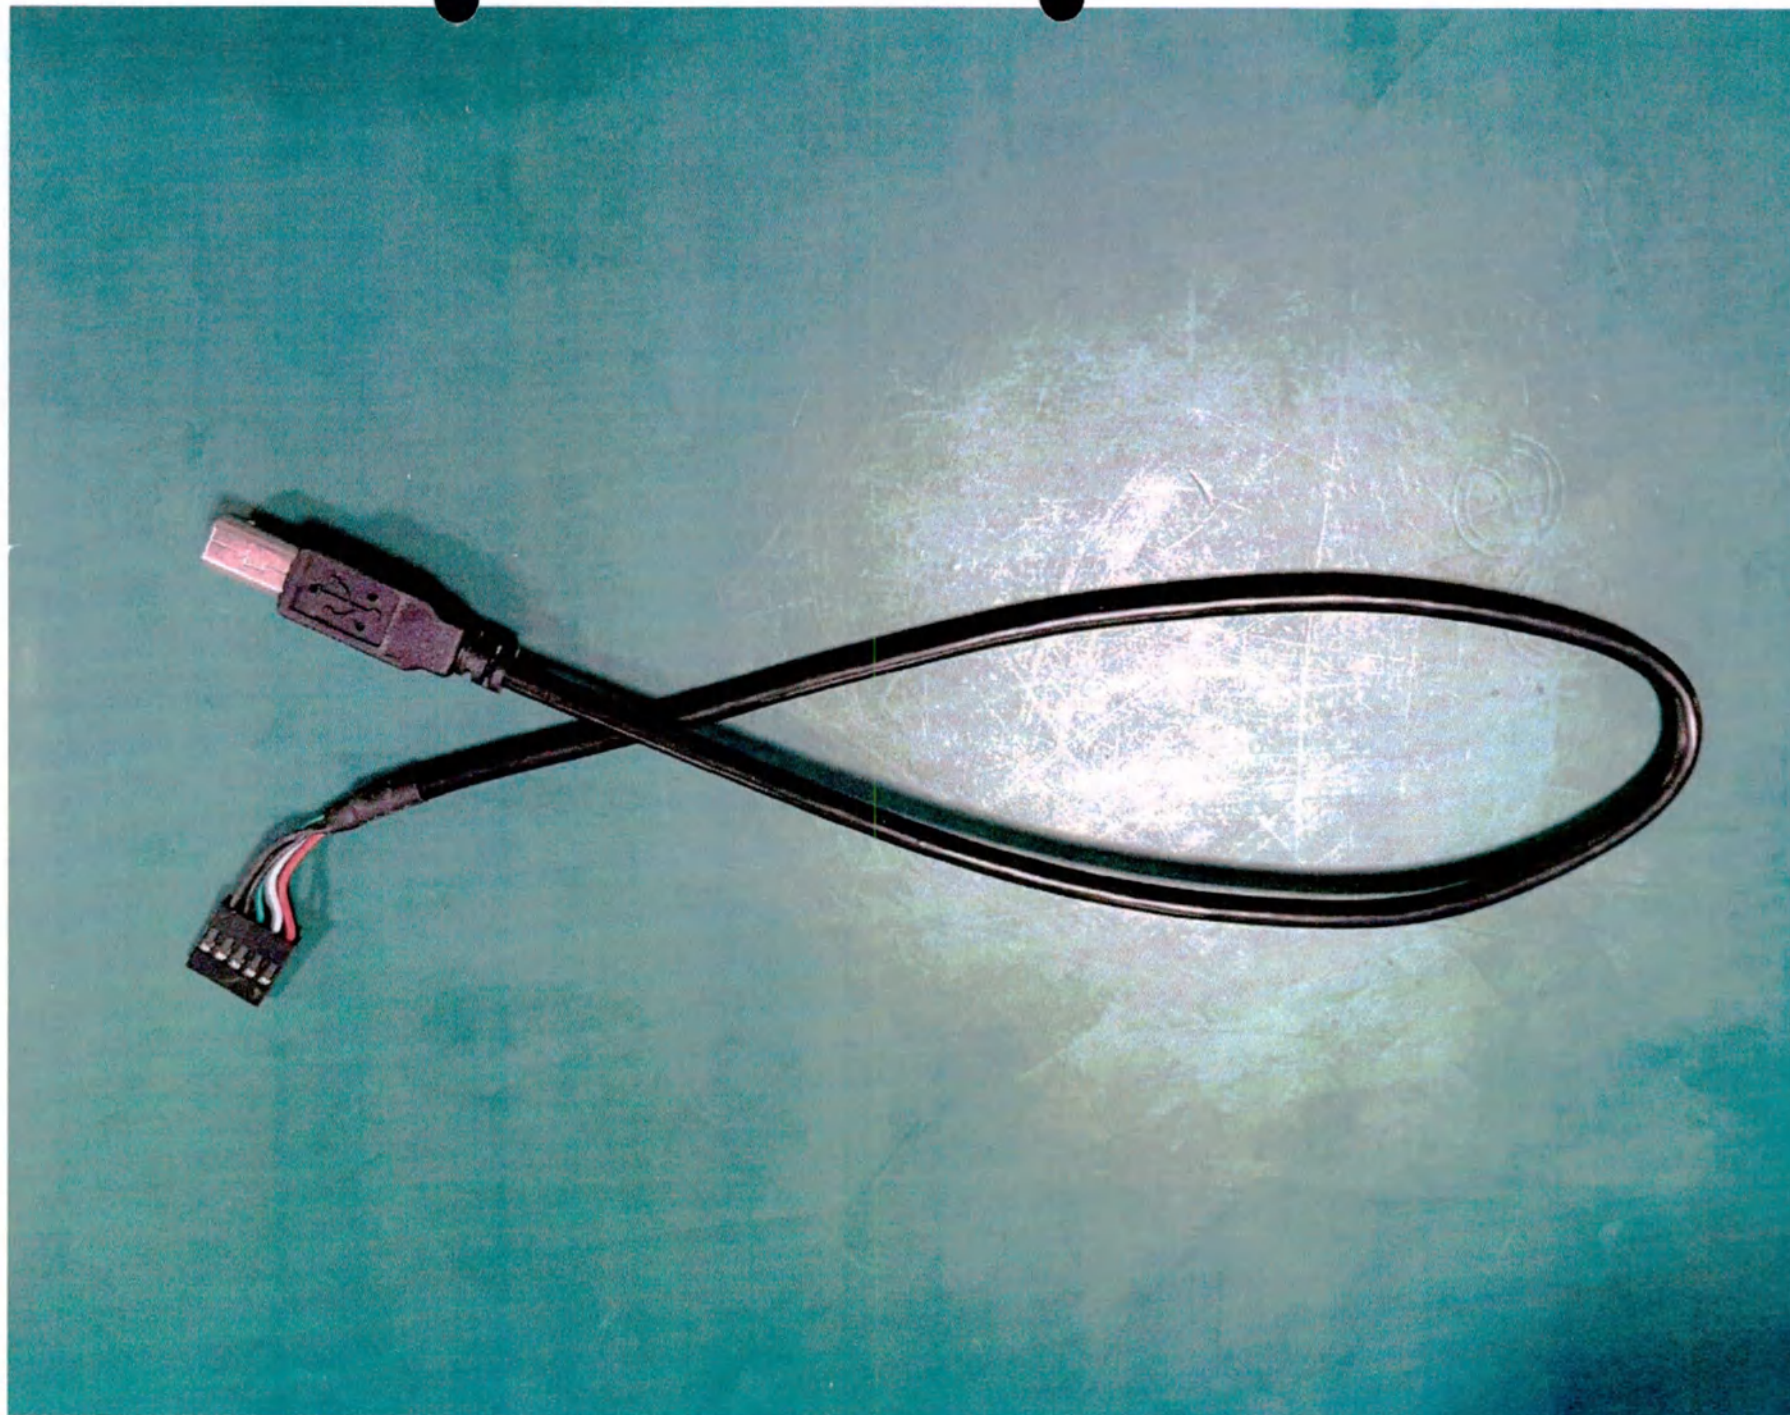

Набор компьютерных комплектующих №3: Кабель USB




Набор компьютерных комплектующих №3: Винт М3х6



Планка монтажная устройства для считывания смарт-карт



Модуль подачи образцов

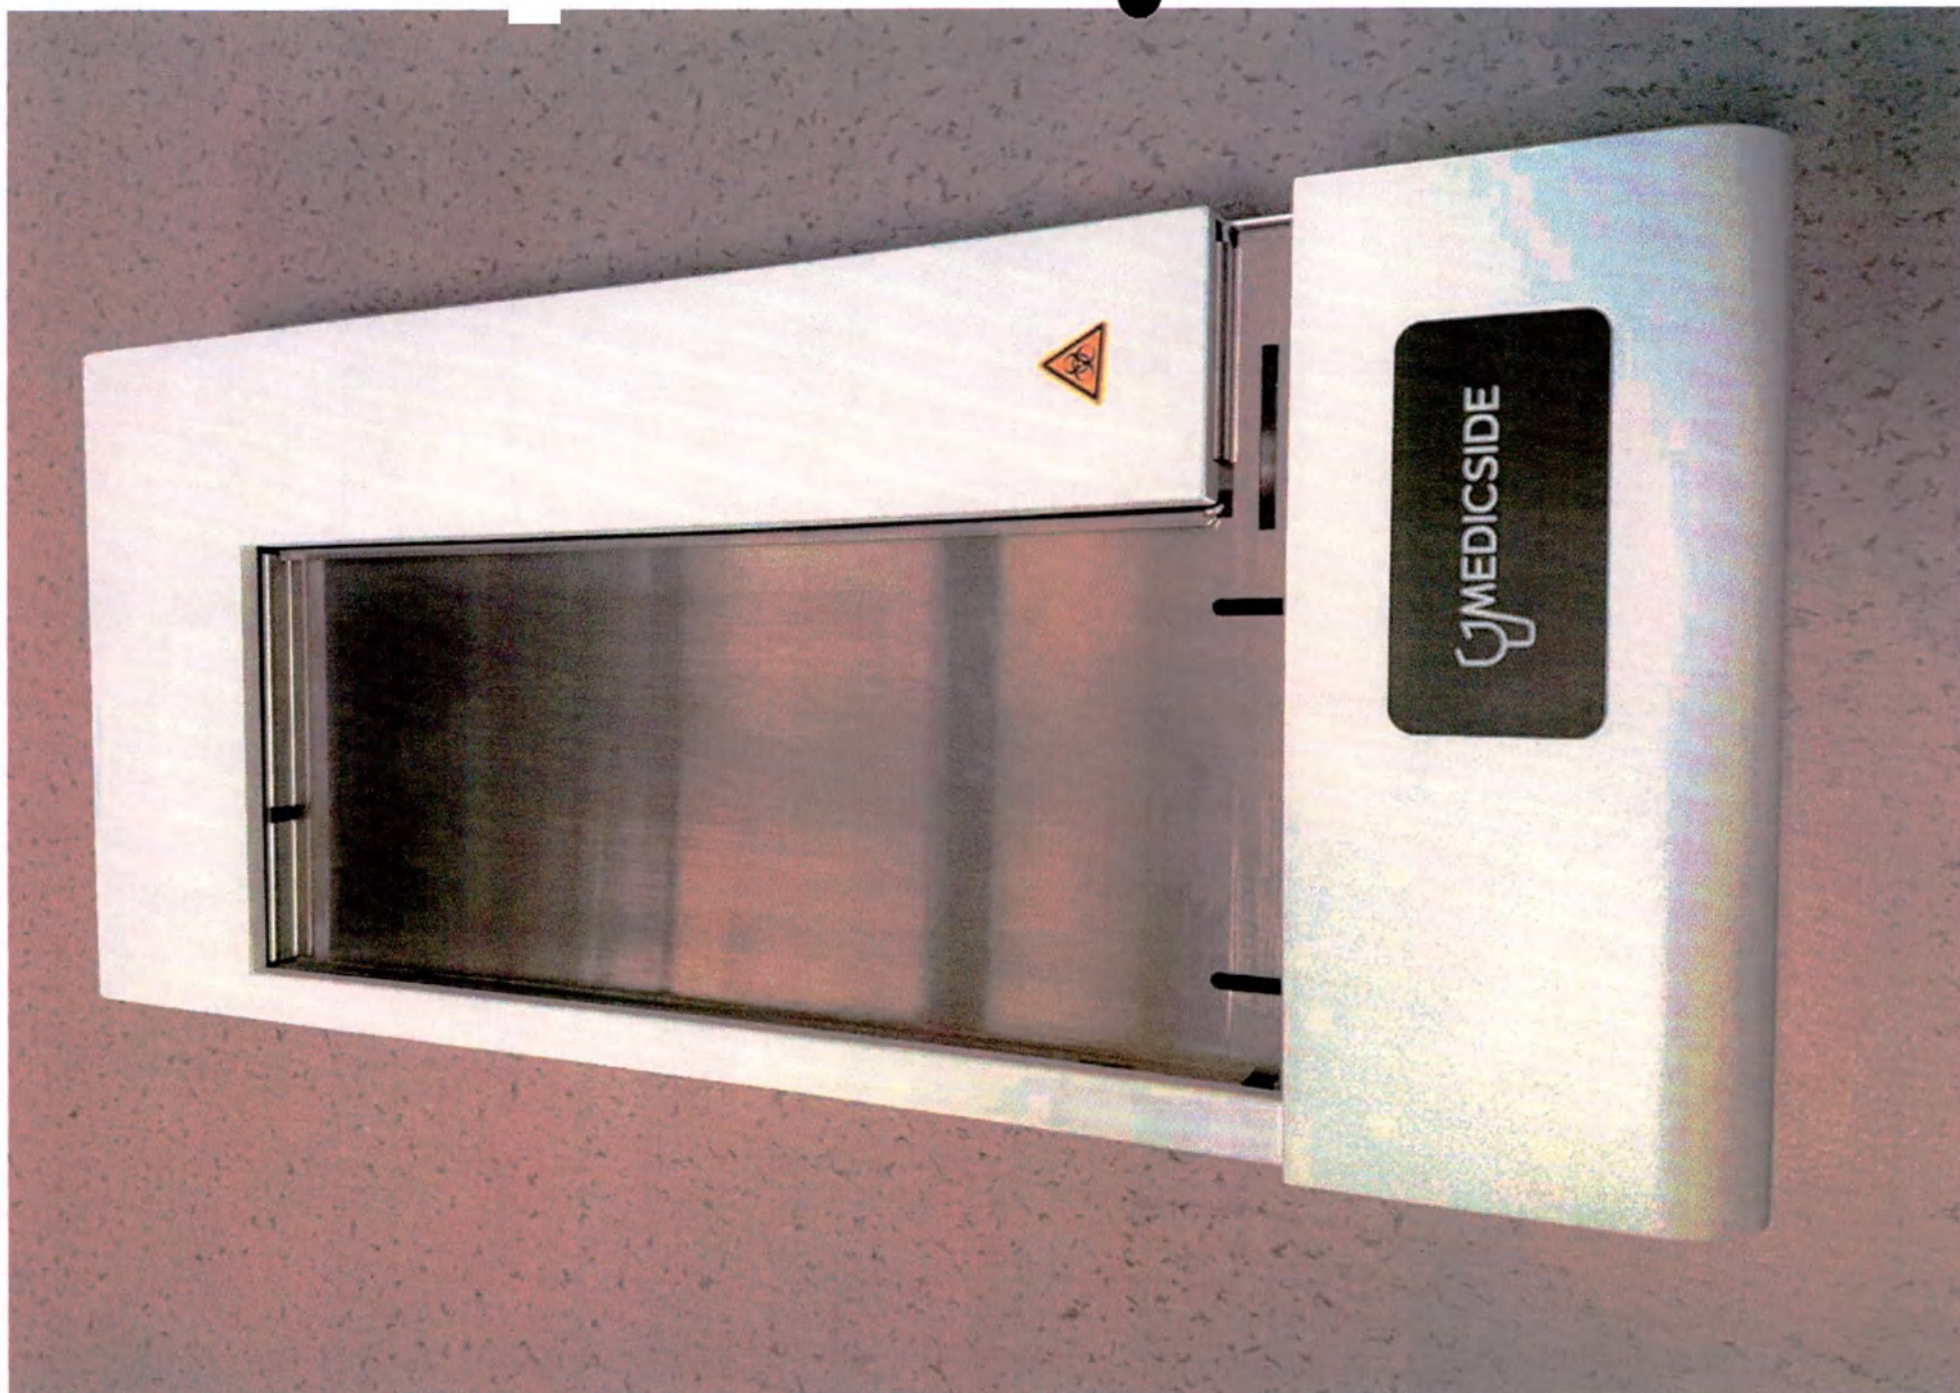


Модуль приёмки образцов




Кабель RS232 для модуля подачи образцов




Кабель электропитания для модуля приёмки образцов

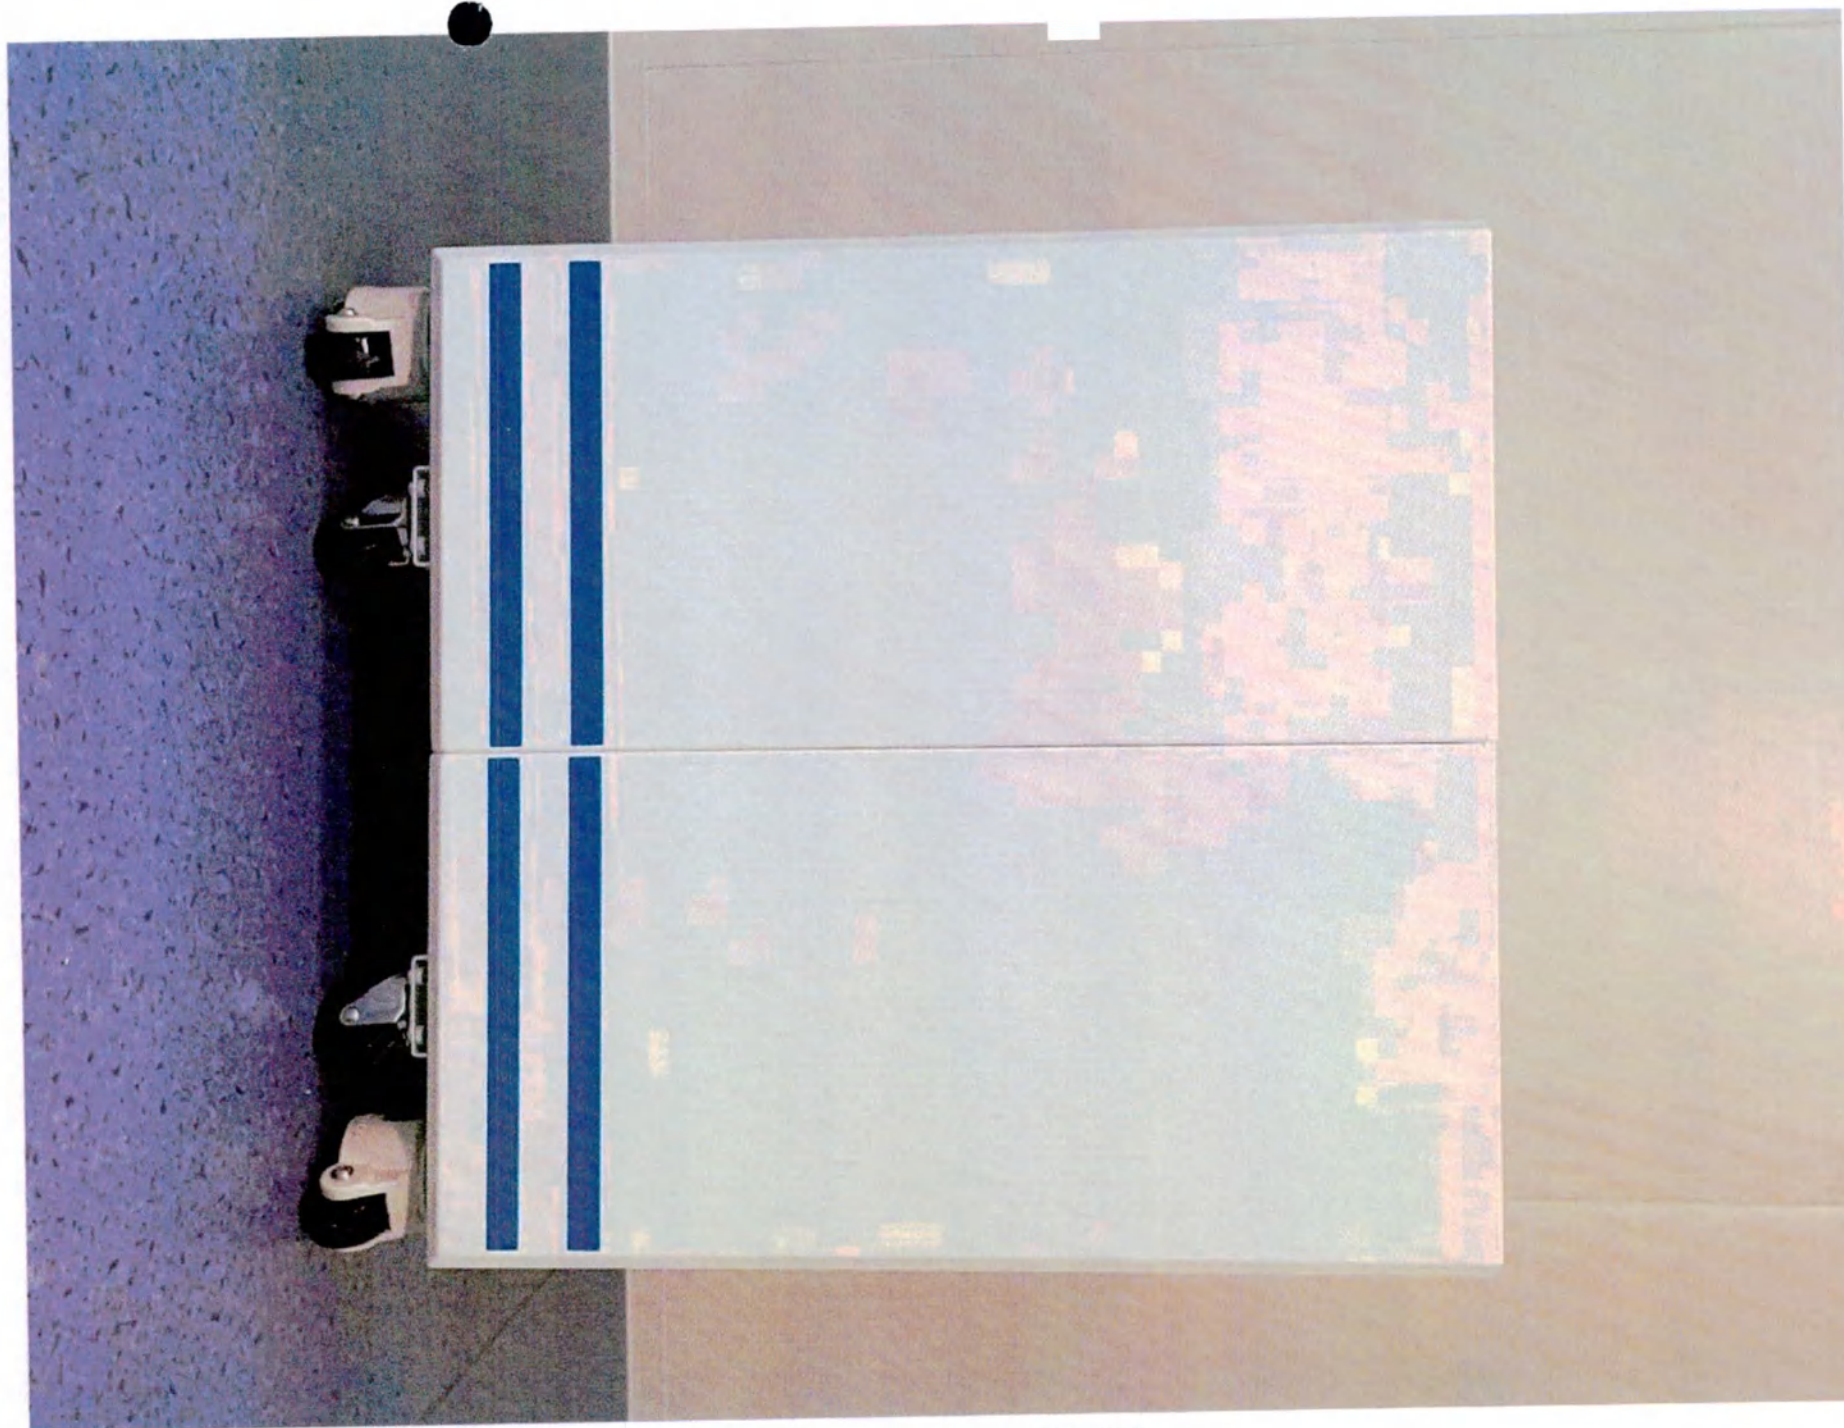

Стол анализатора СА-500

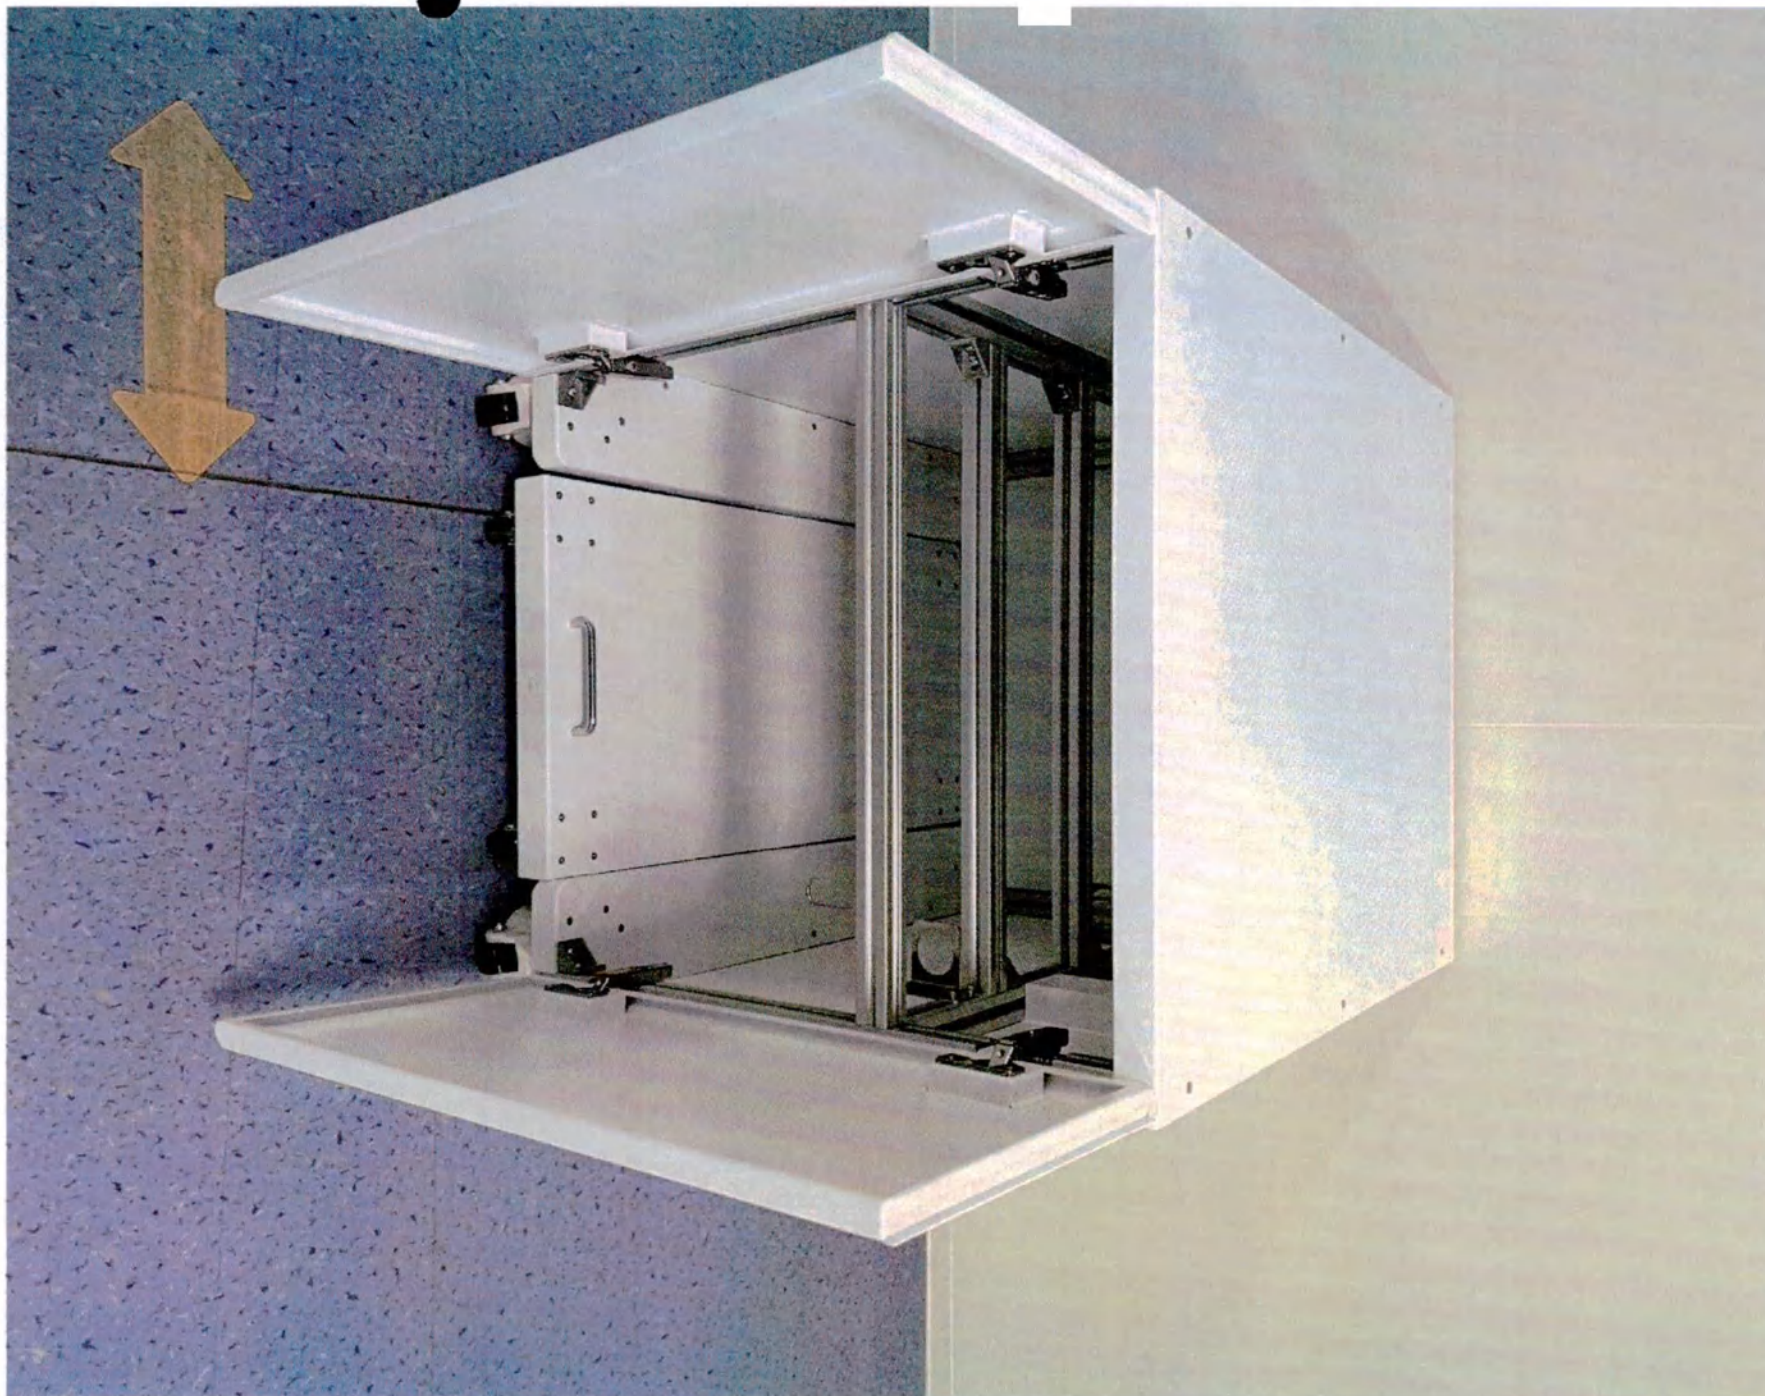


Стол анализатора СА-500

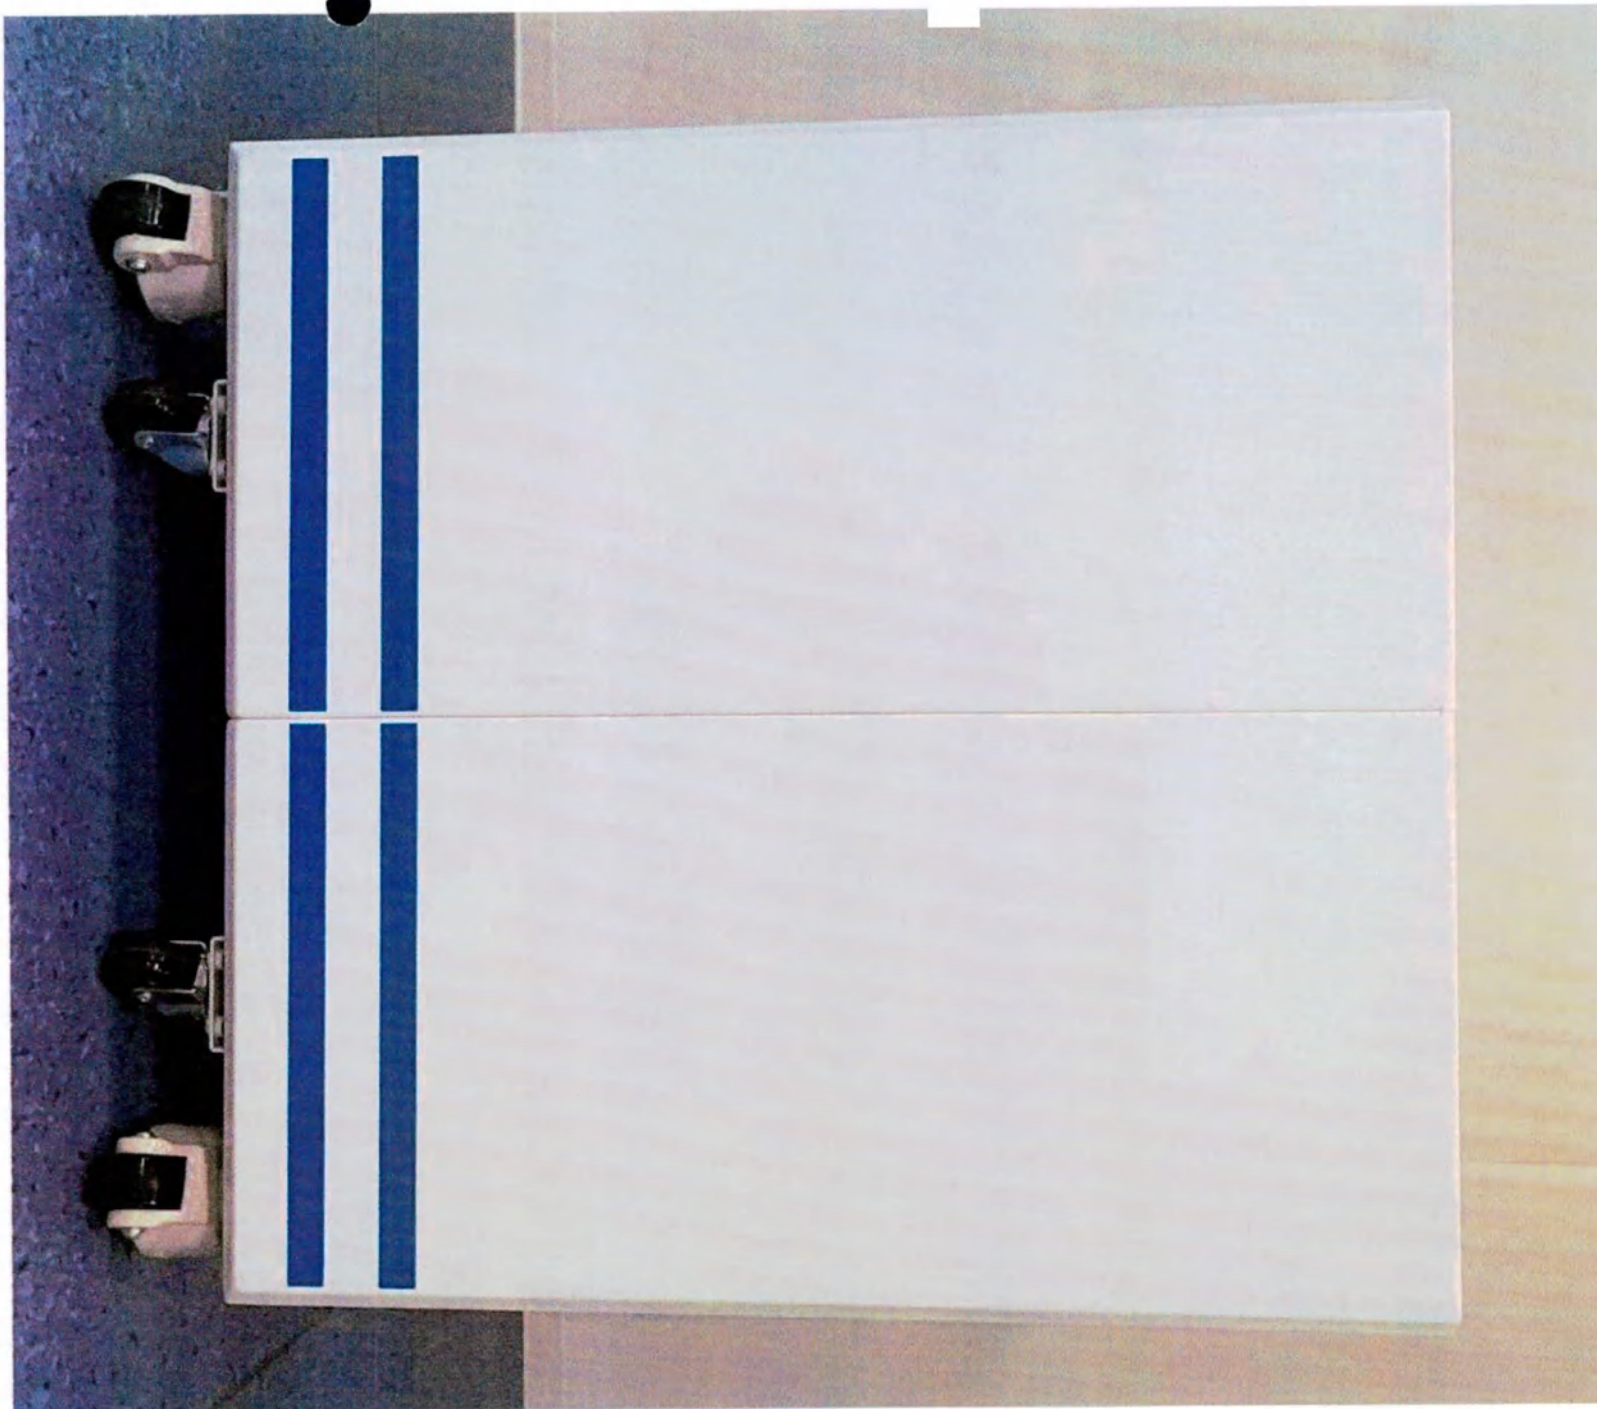


Стол анализатора МА-500




Стол анализатора МА-500

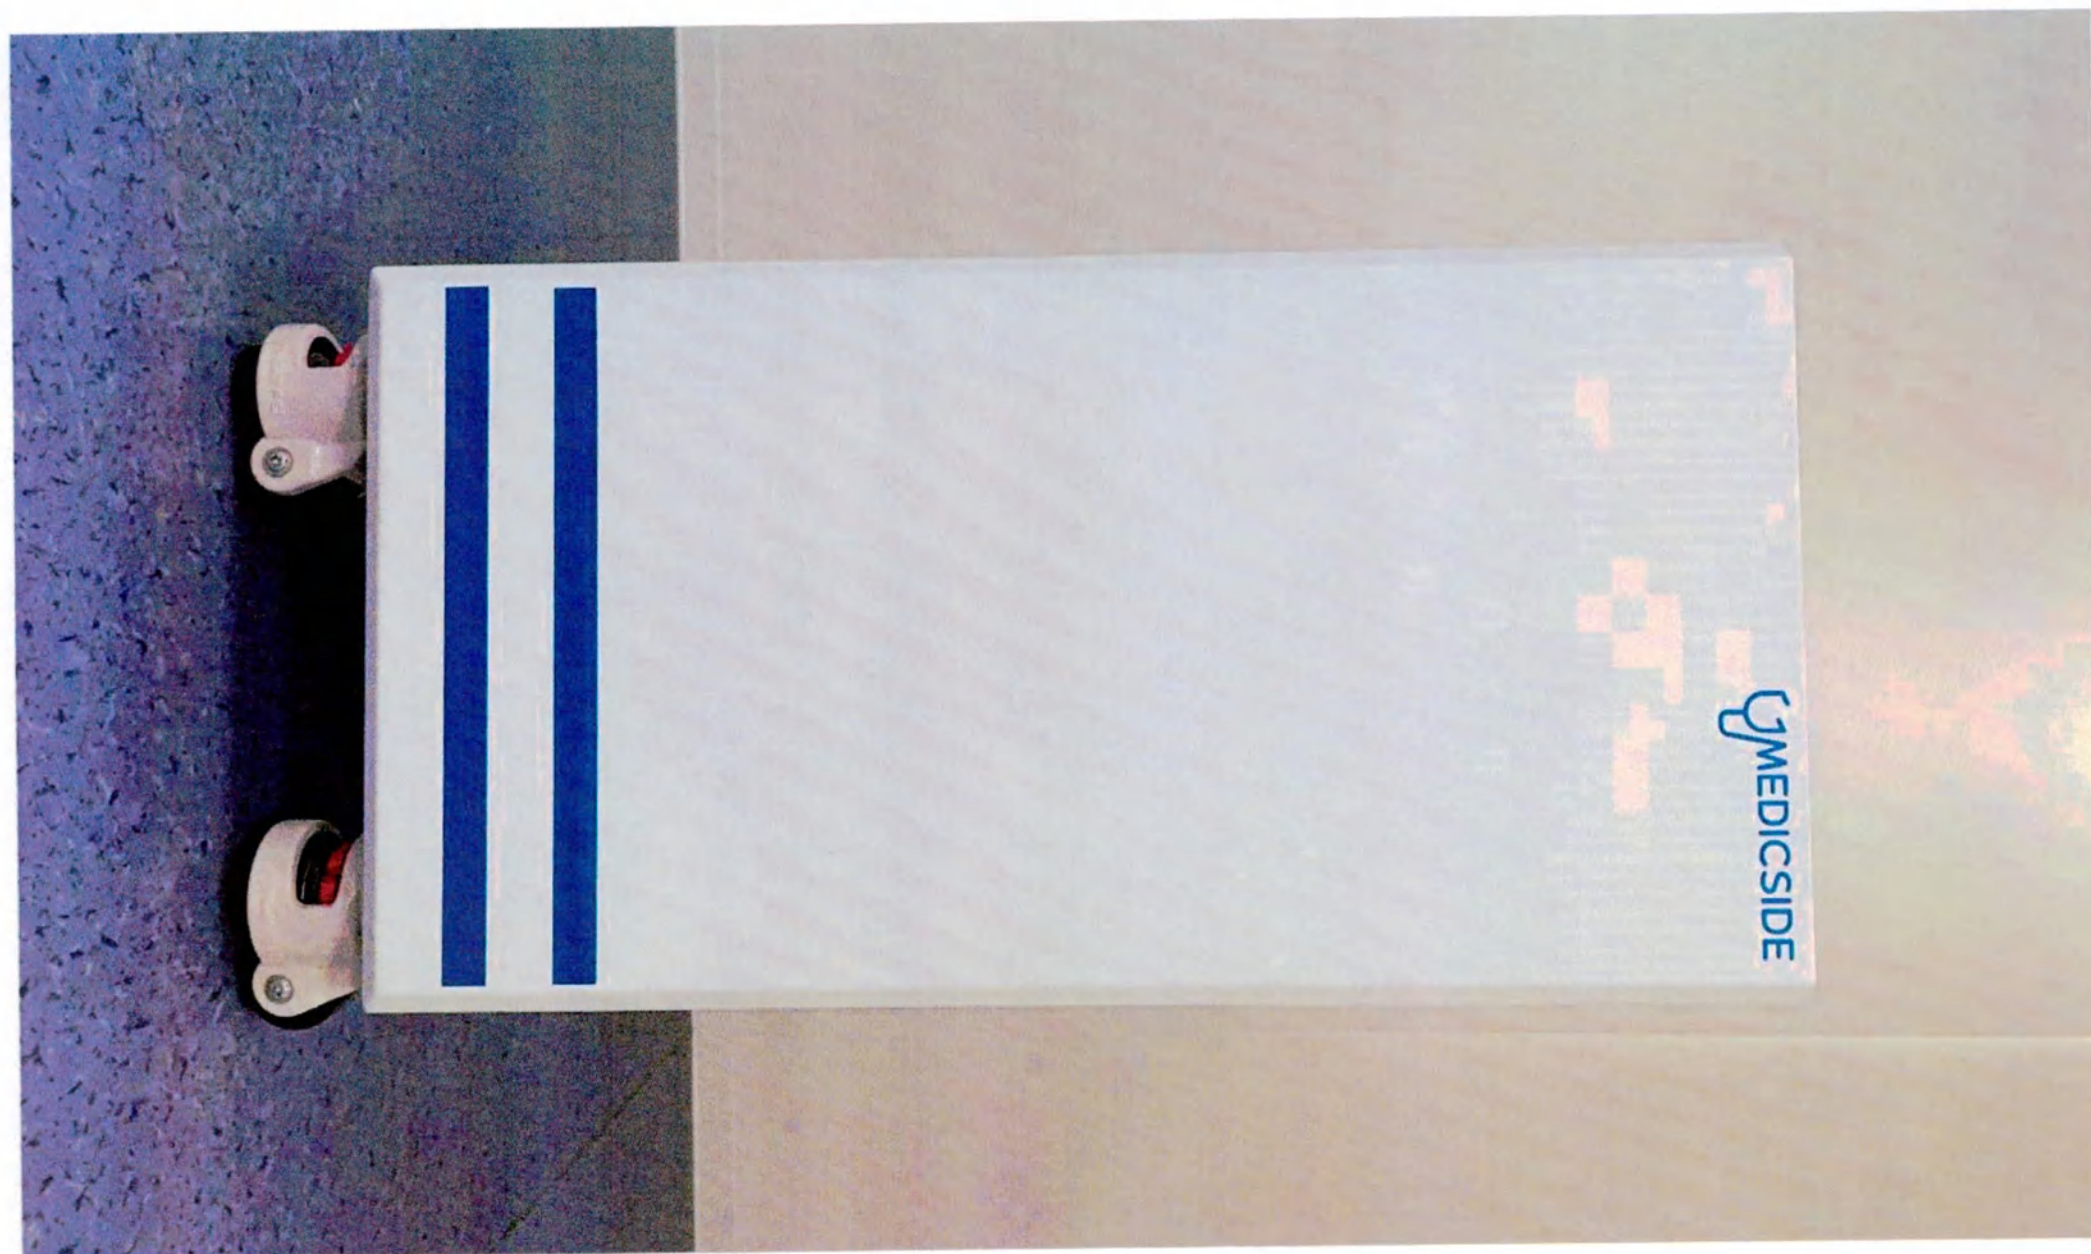


Стол модуля подачи образцов

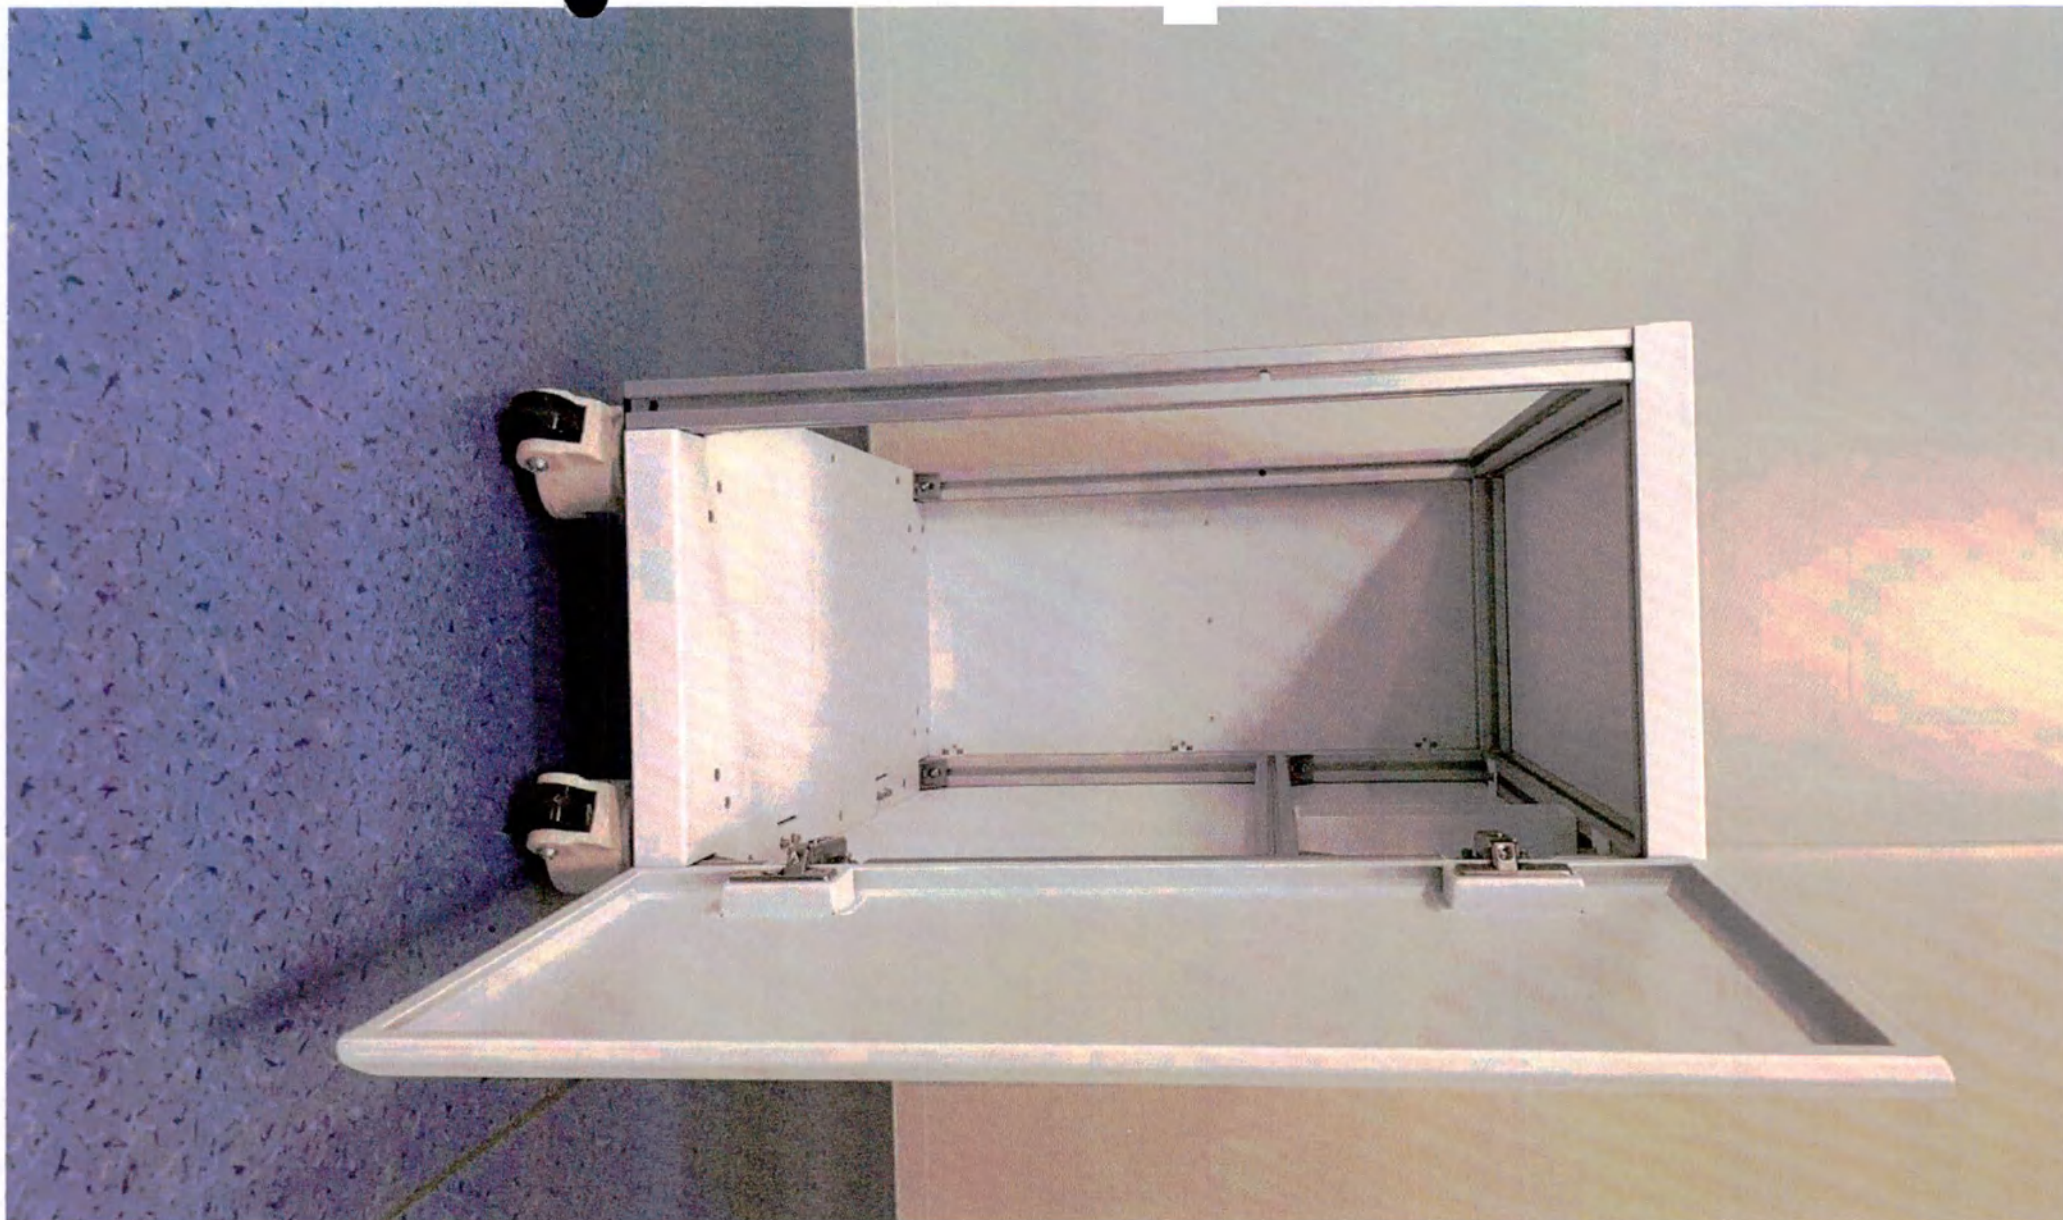


Стол модуля подачи образцов

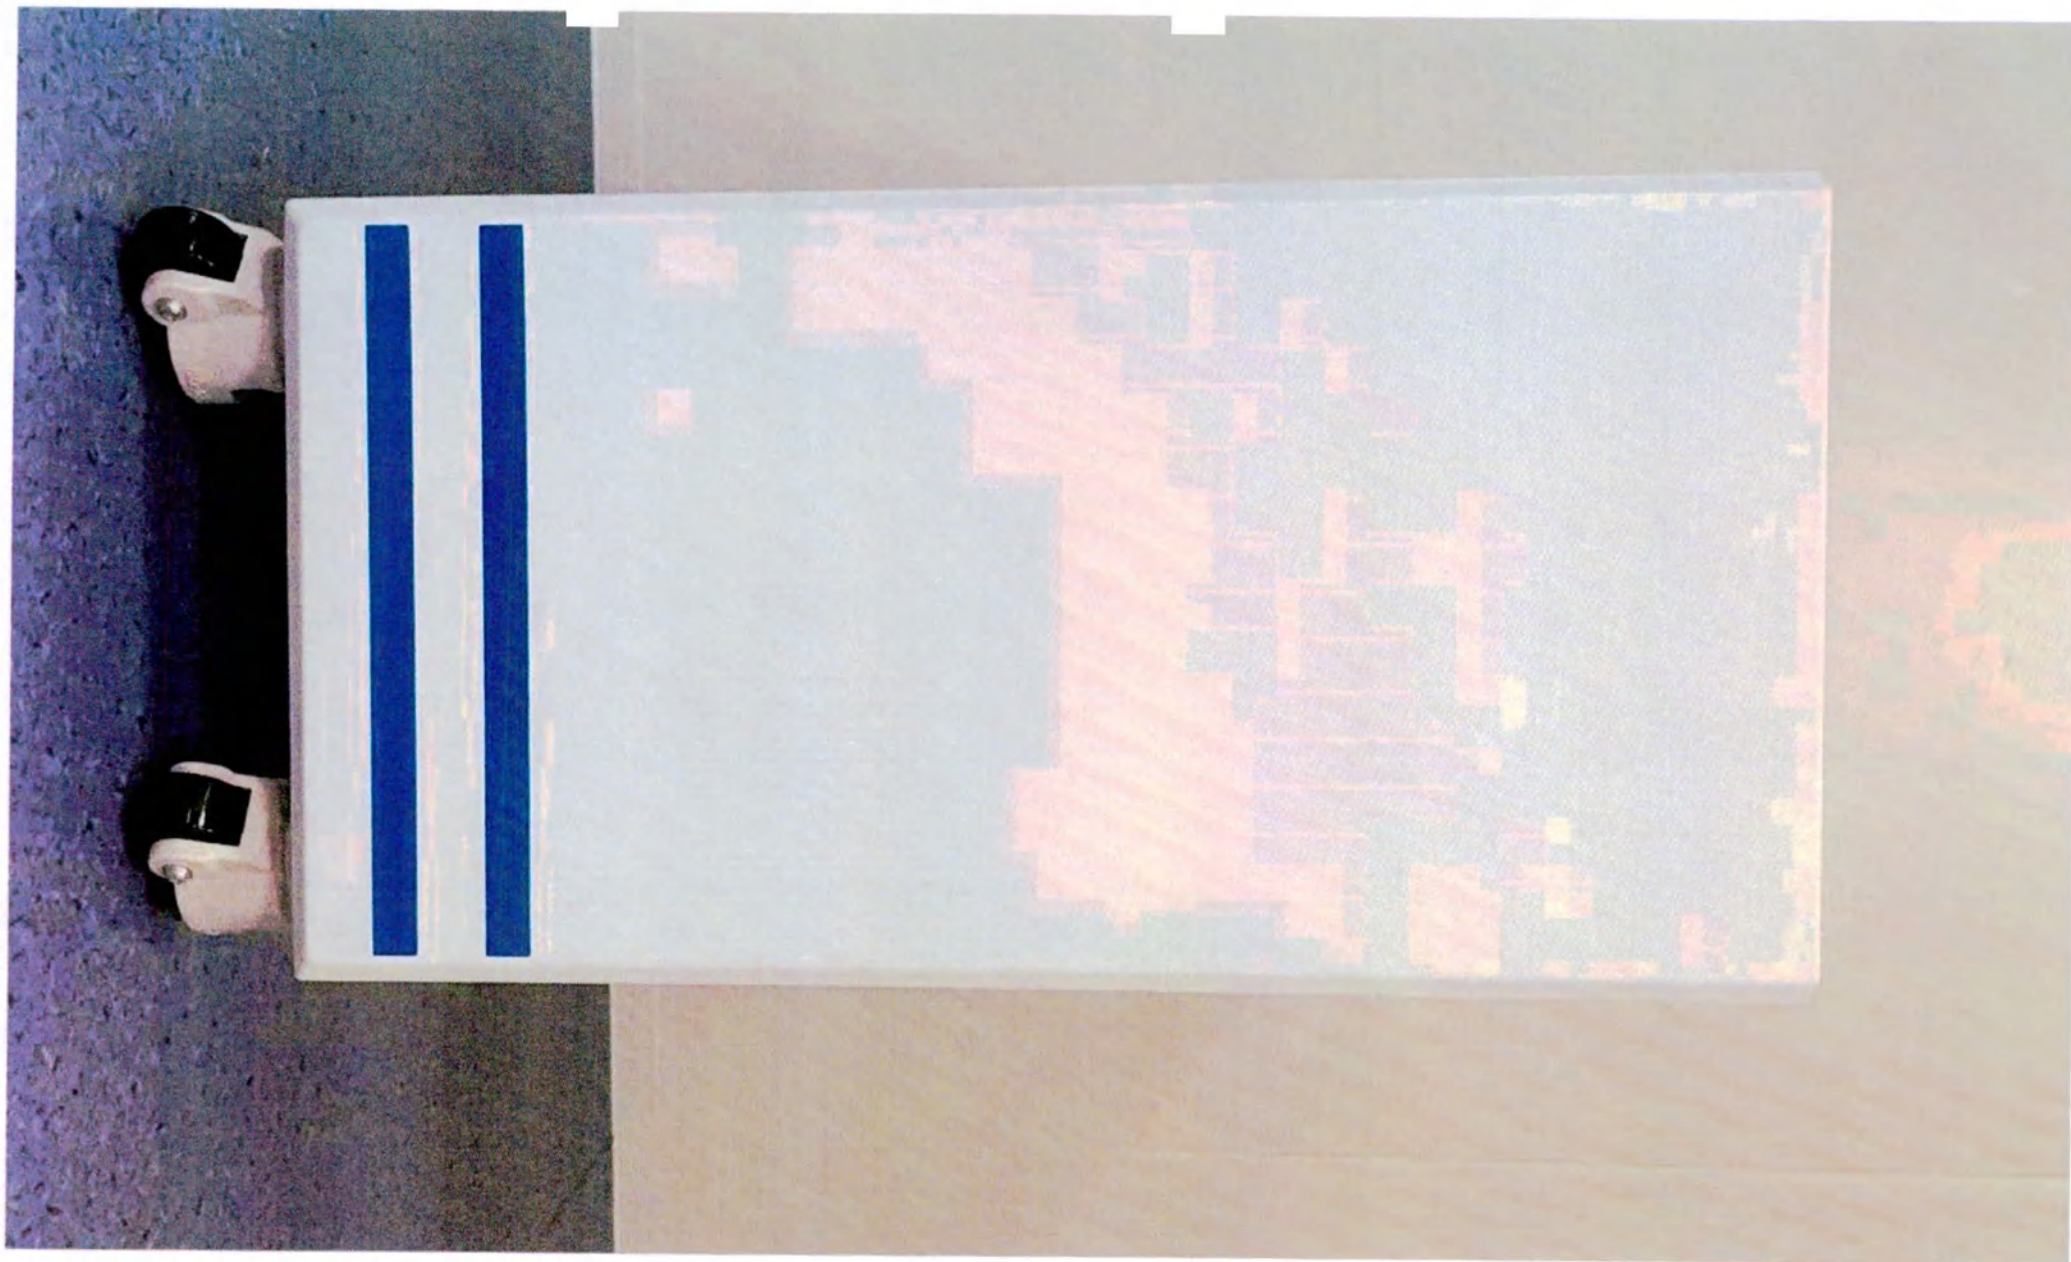


Стол модуля приёмки образцов

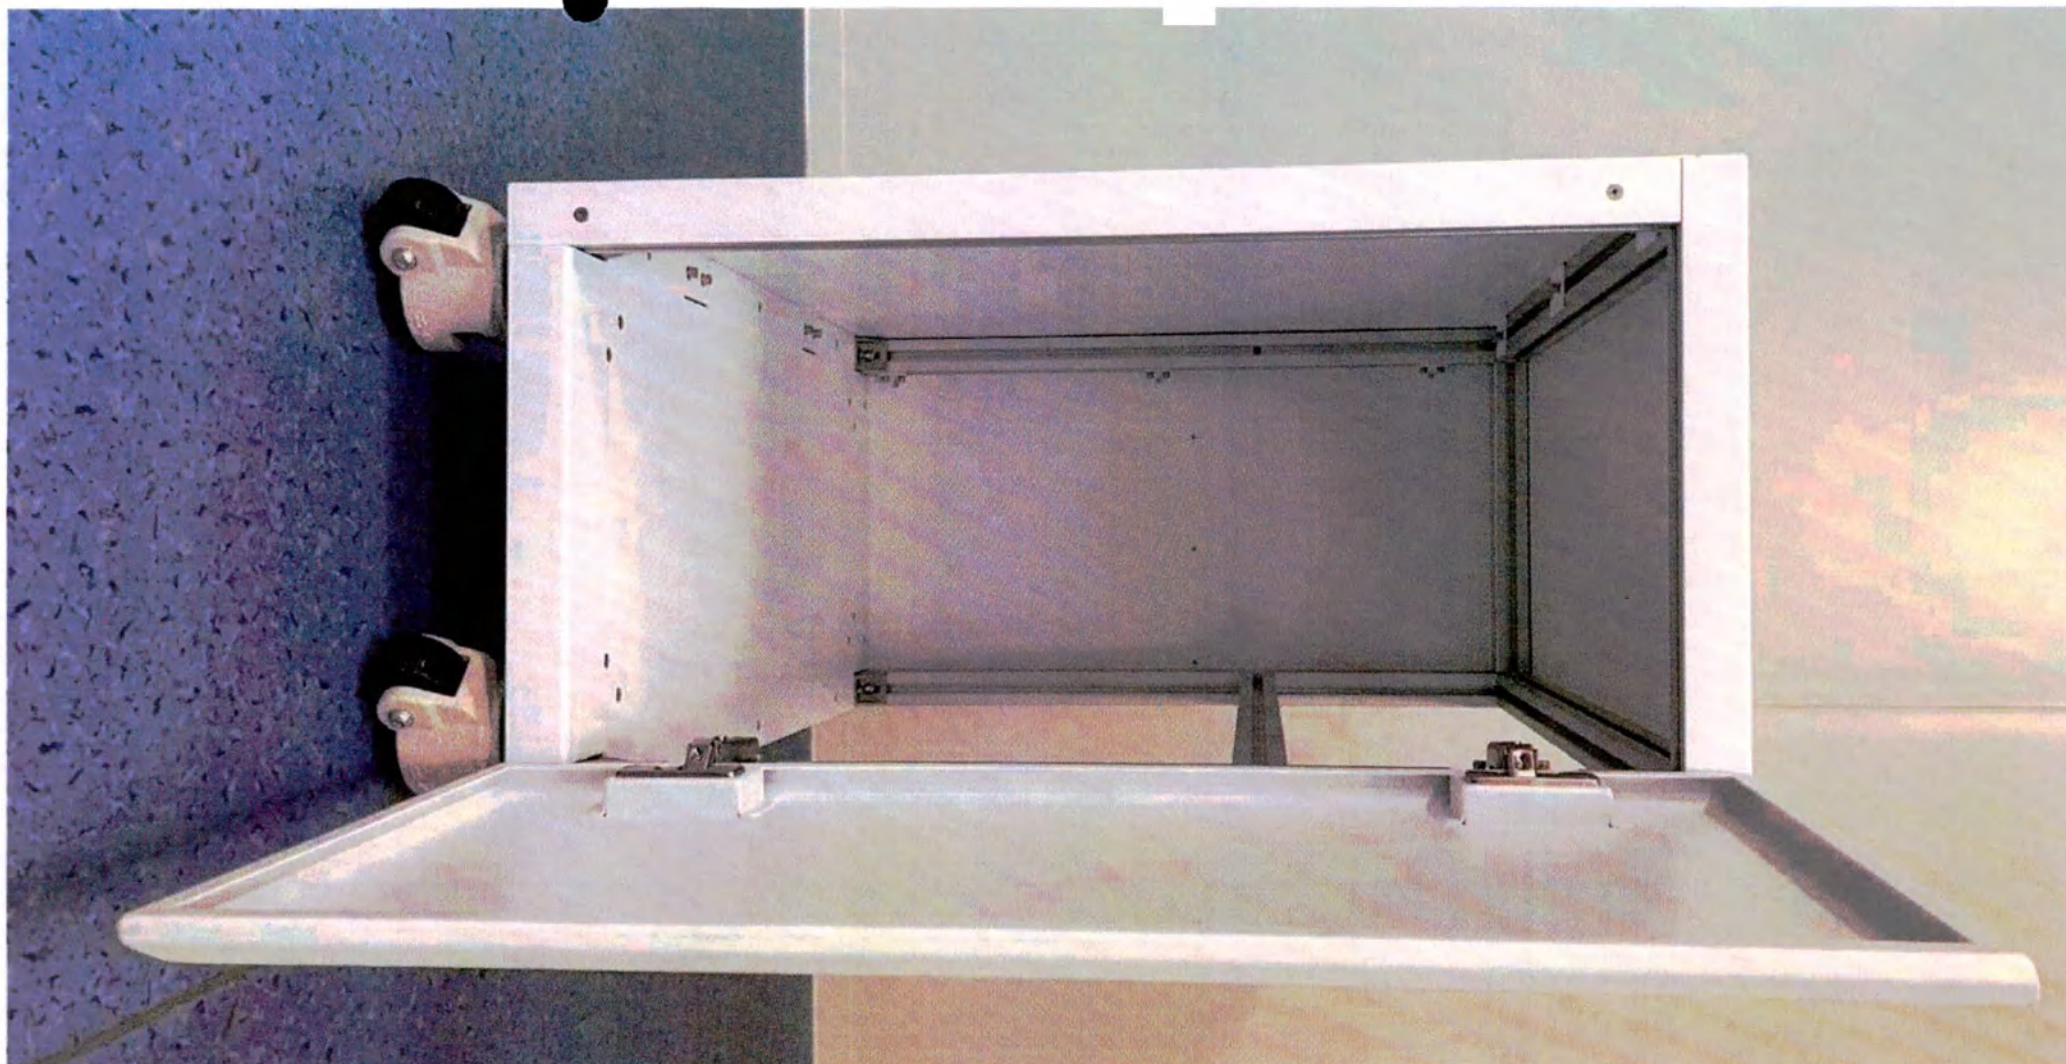


Стол модуля приёмки образцов

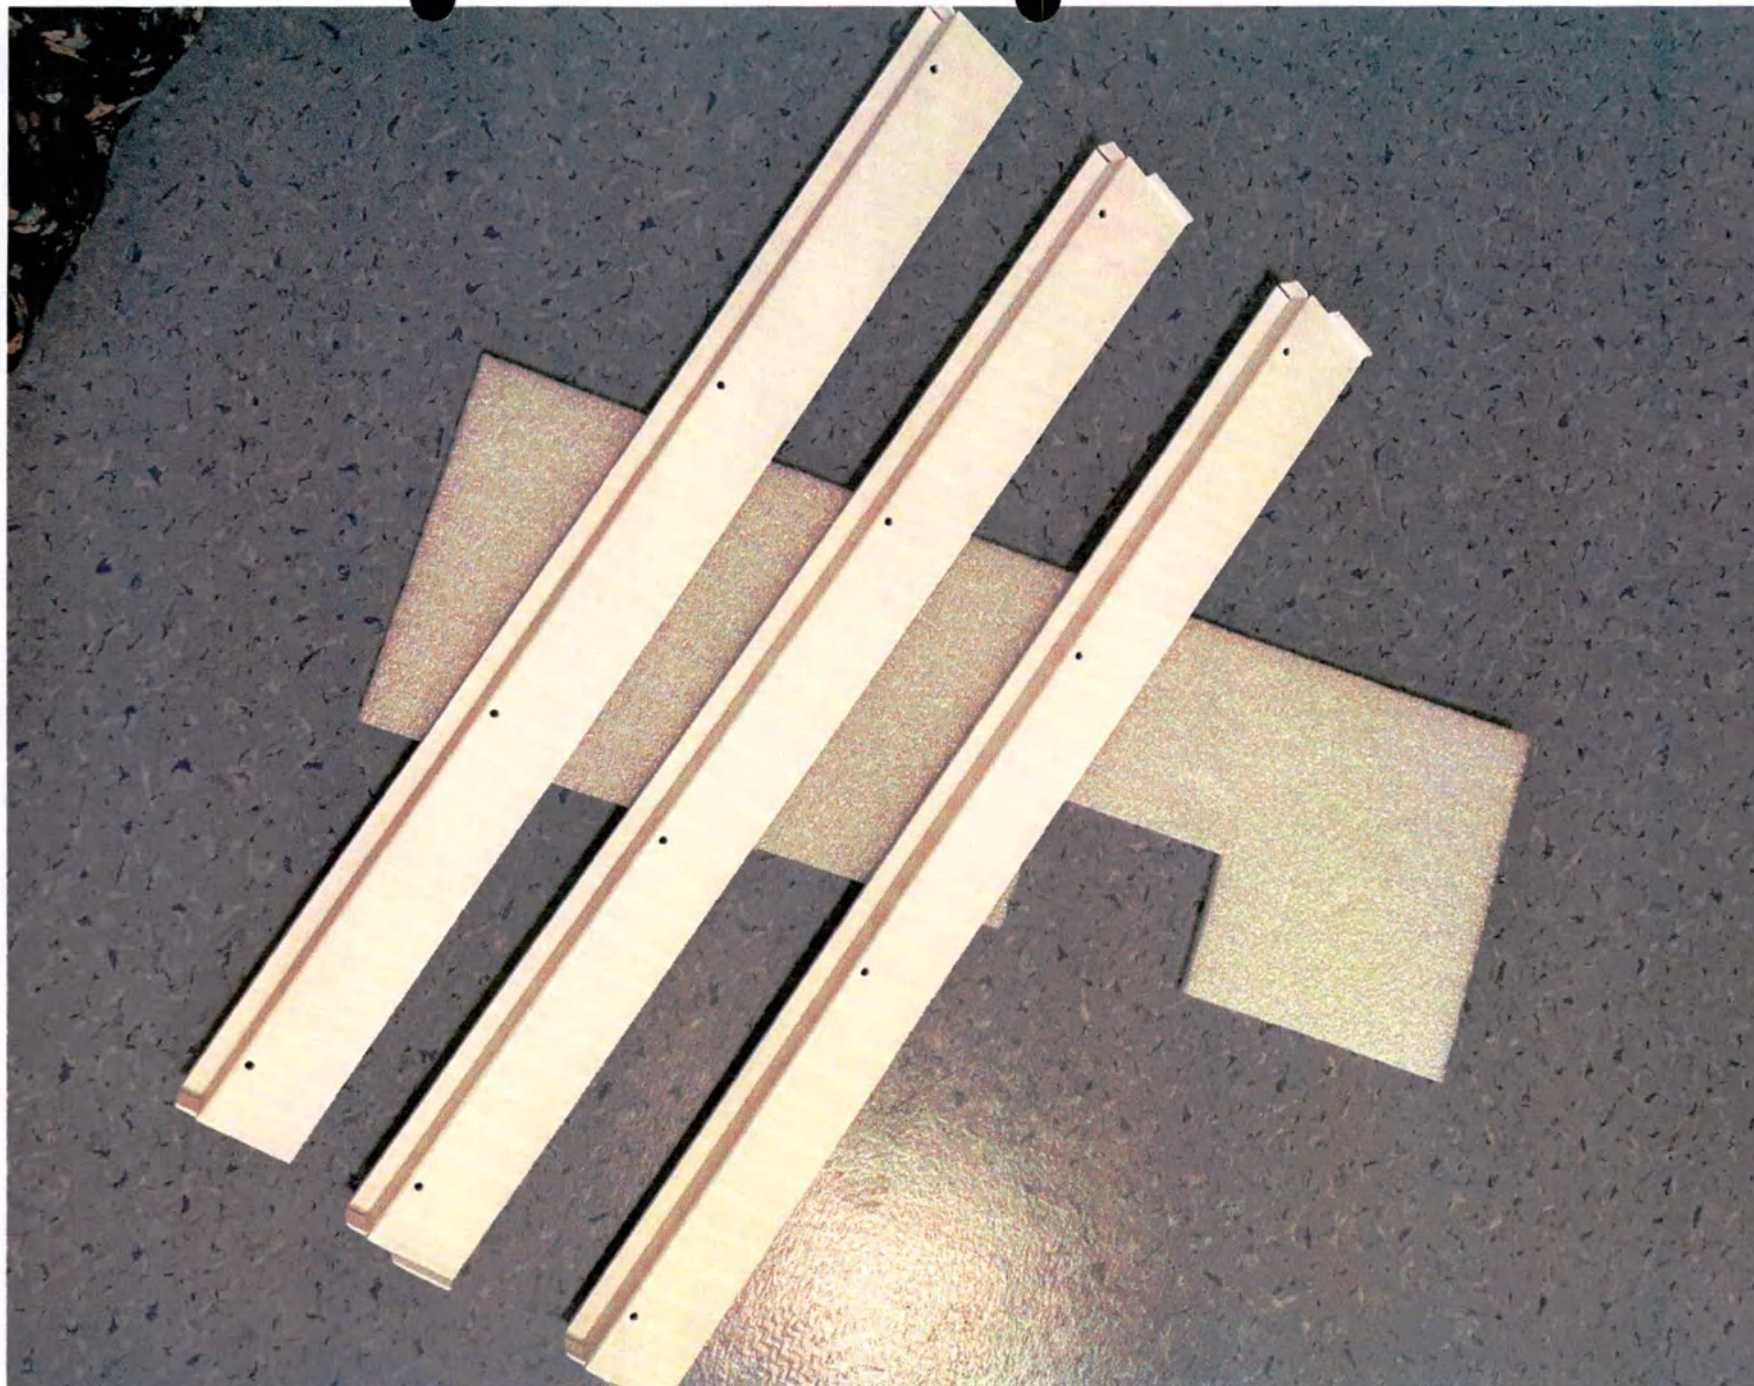

Заглушка передняя для стола анализатора

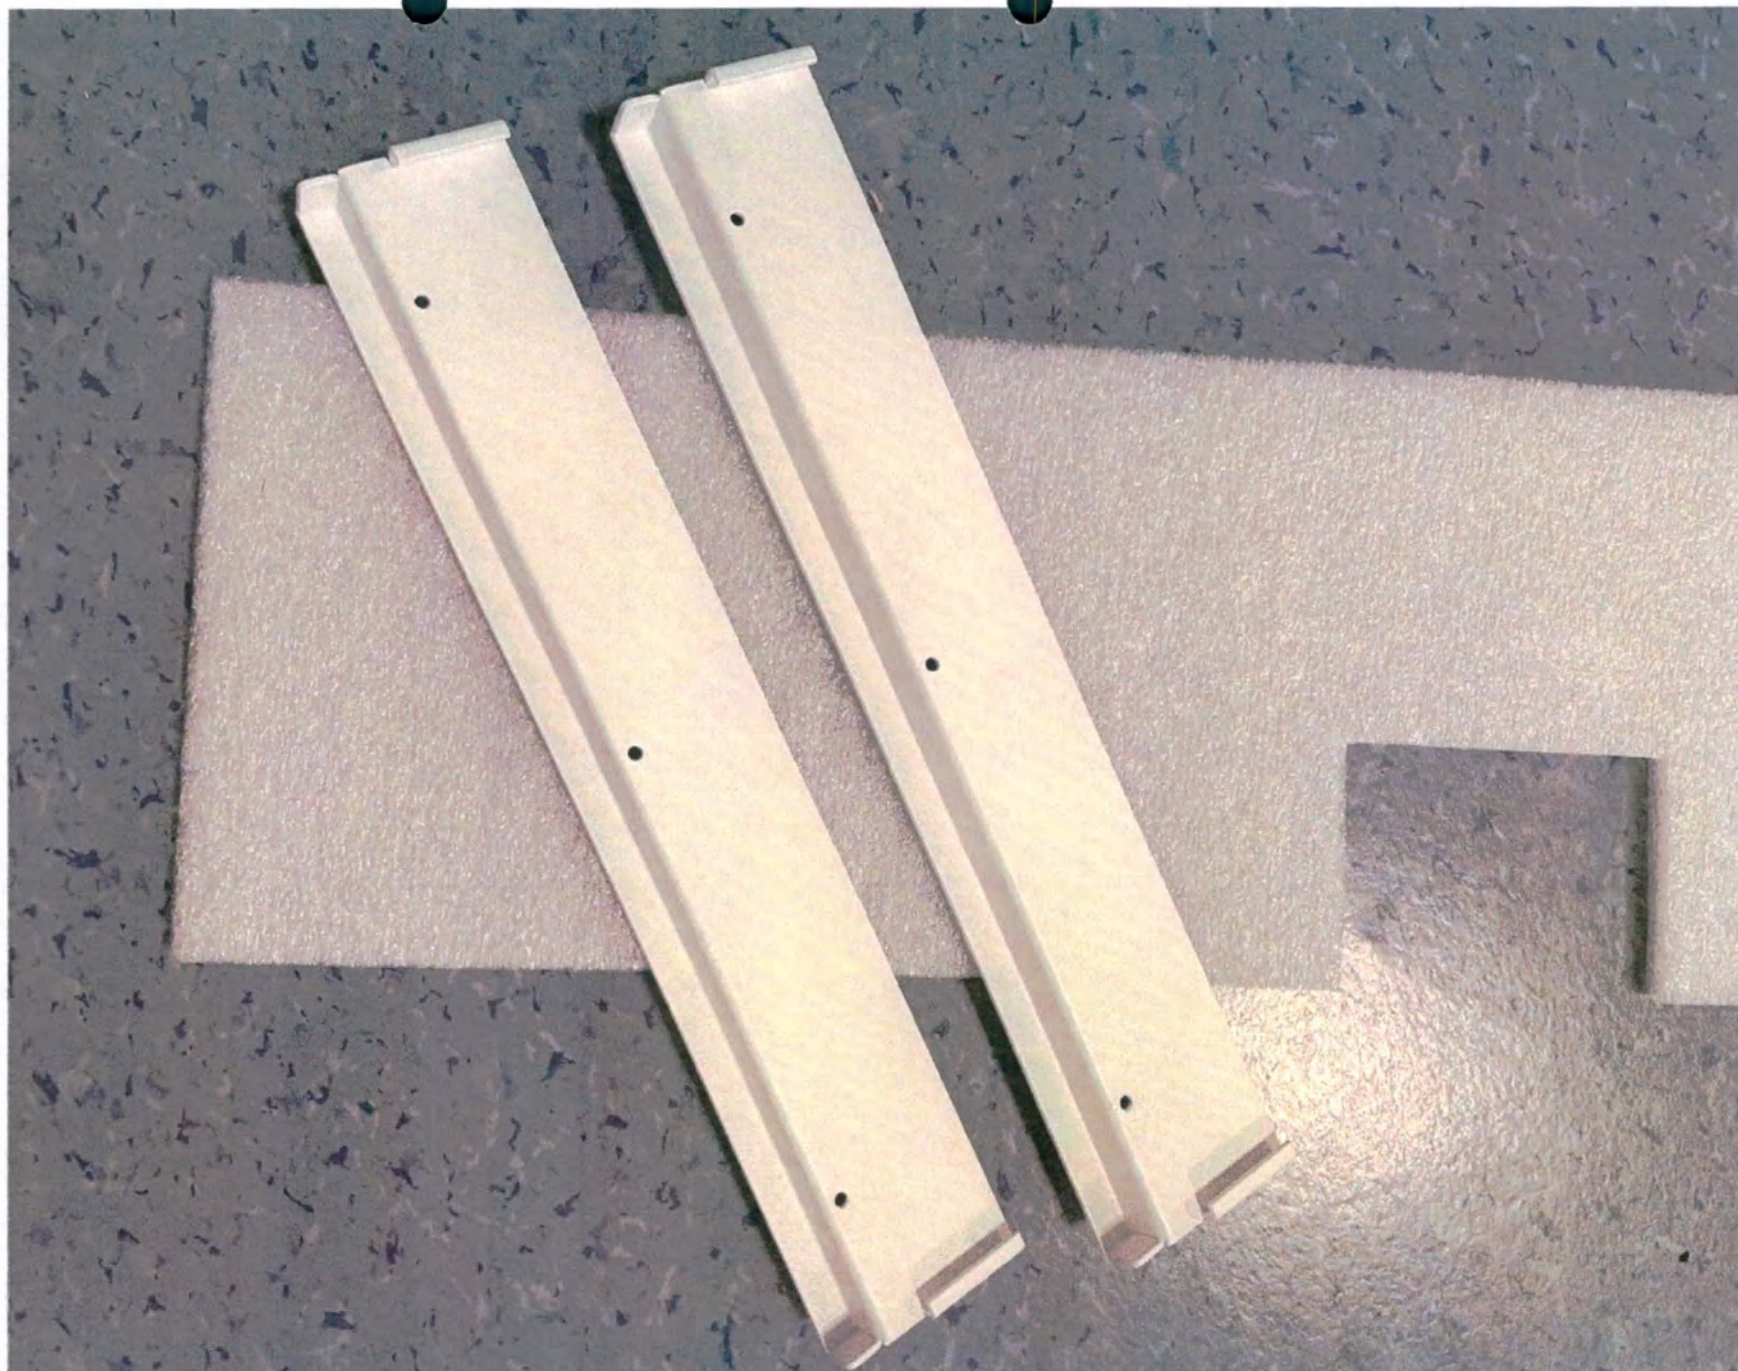


Заглушка передняя для столов модулей подачи и приёмки образцов

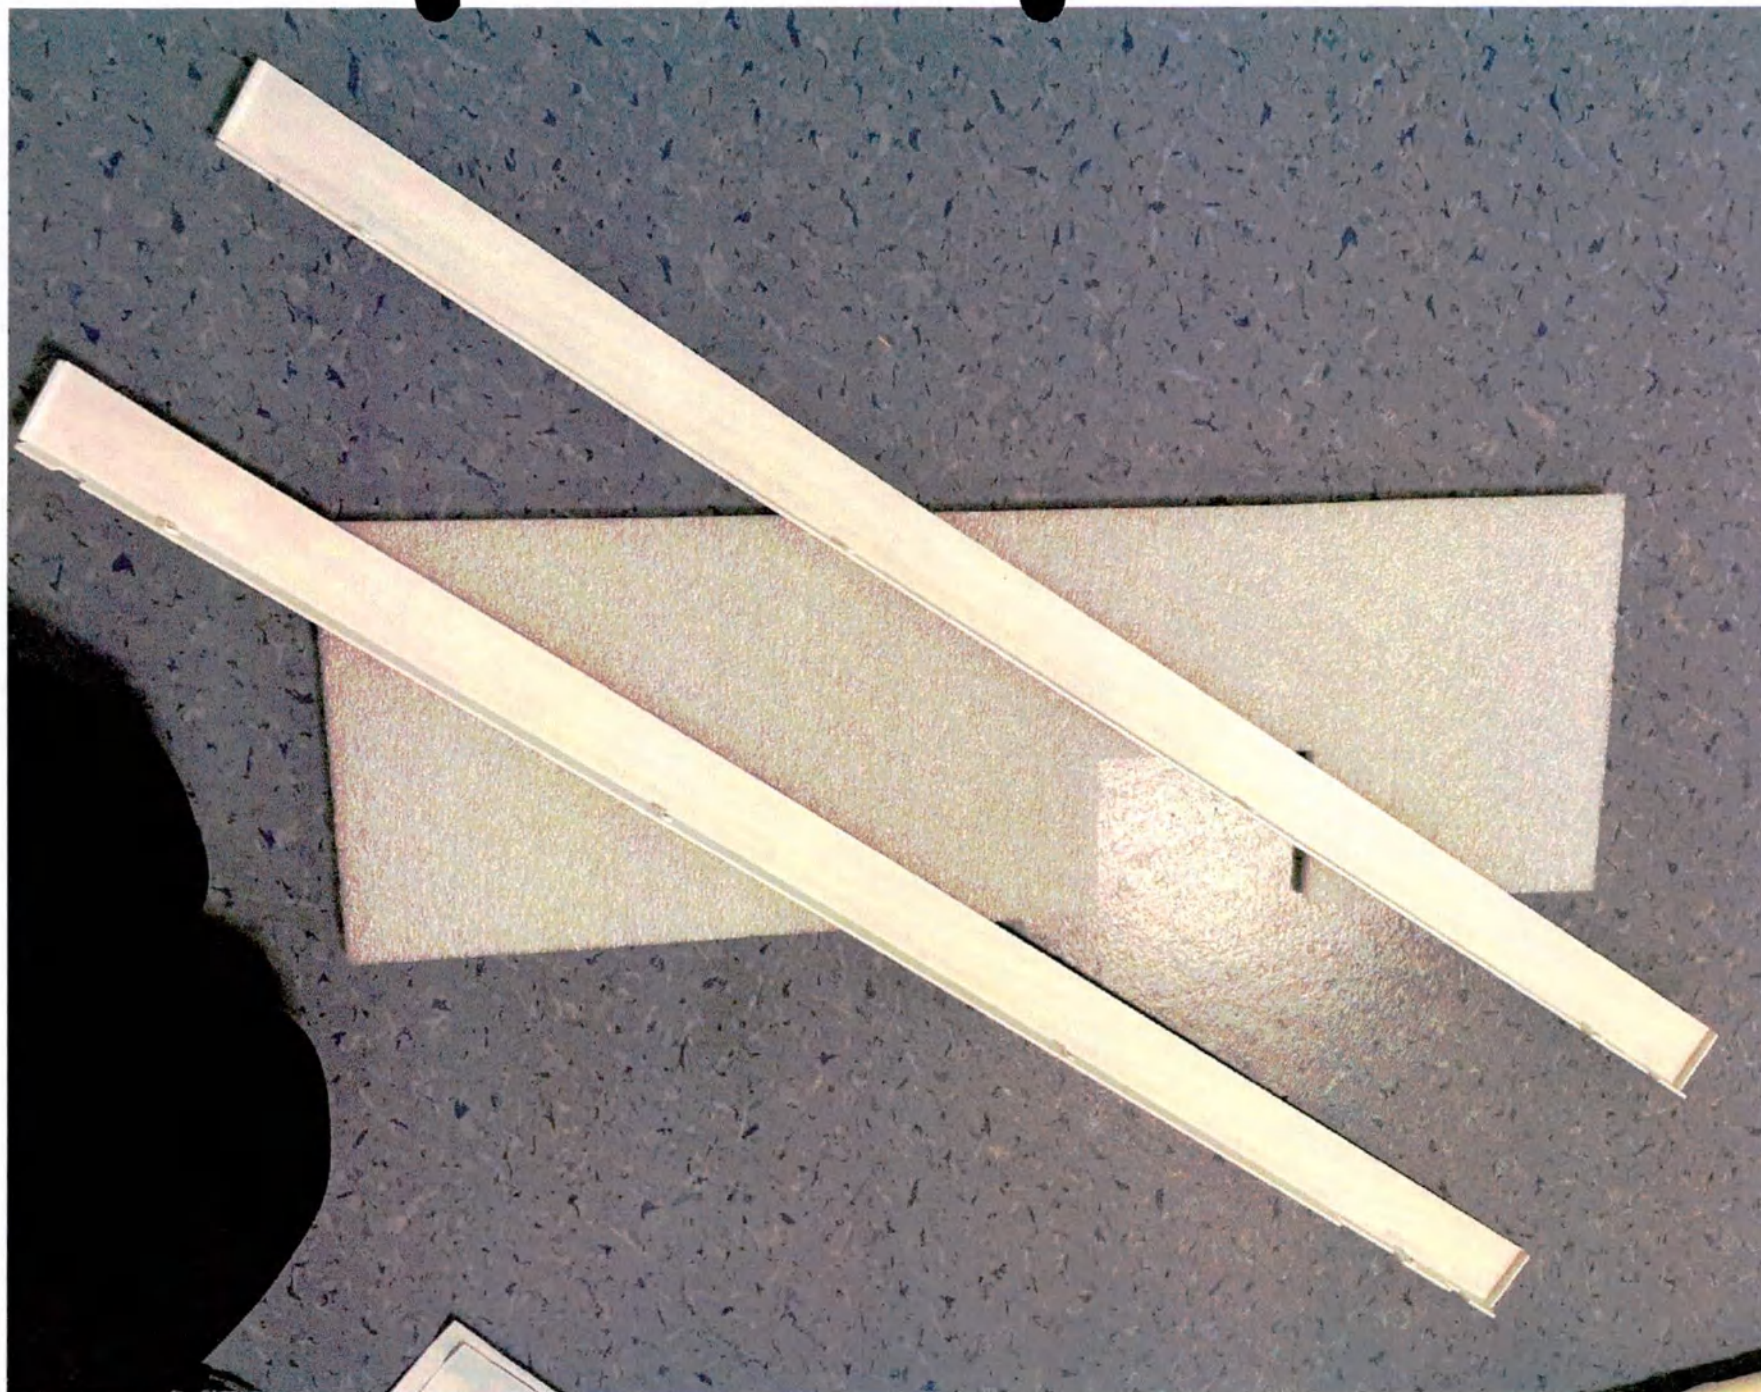


Заглушка боковая для столов модулей подачи и приёмки образцов




Винт М3×8

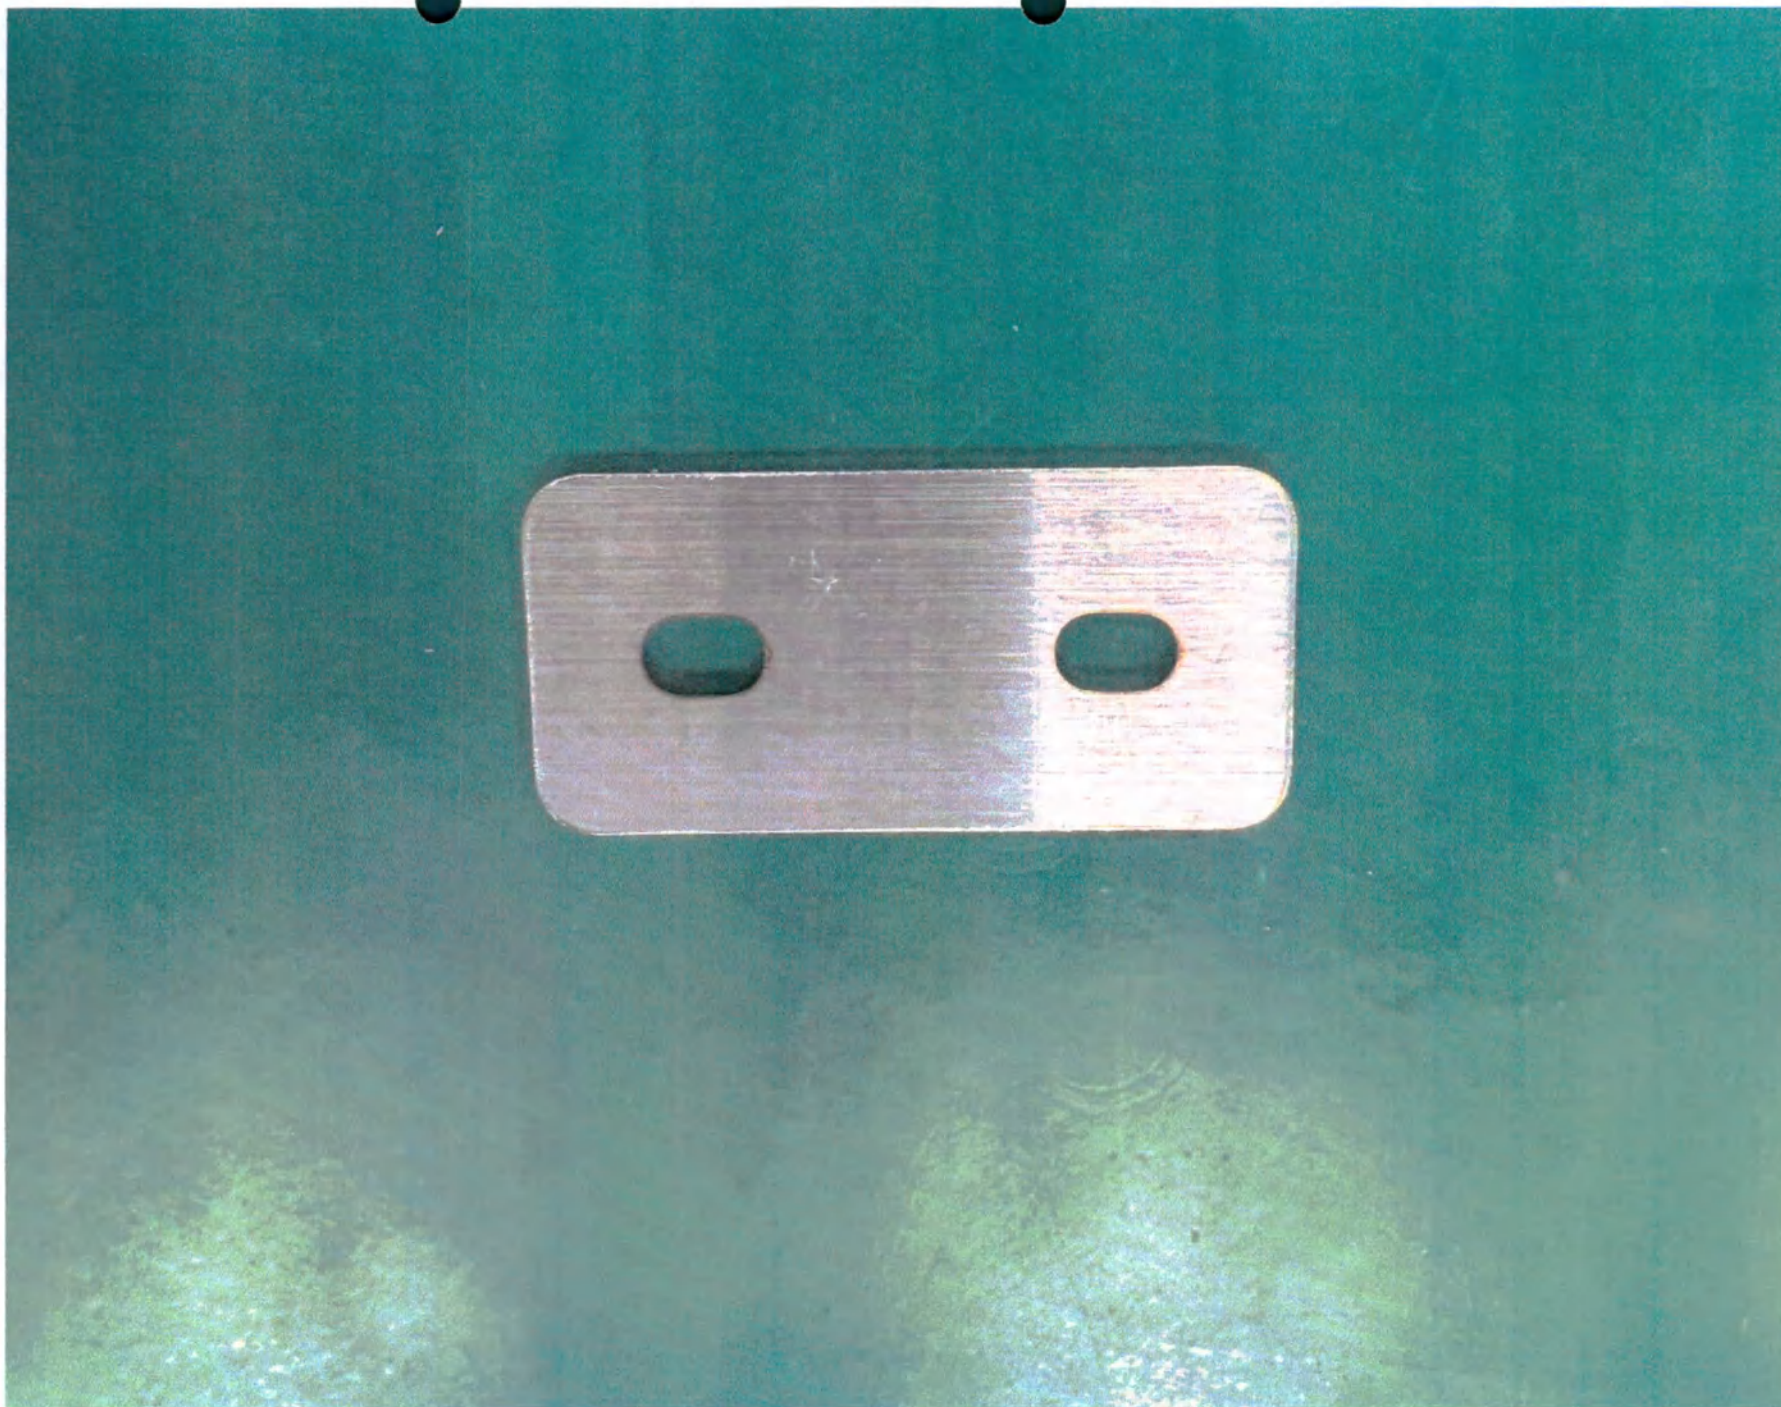


Планка соединительная (для столов)

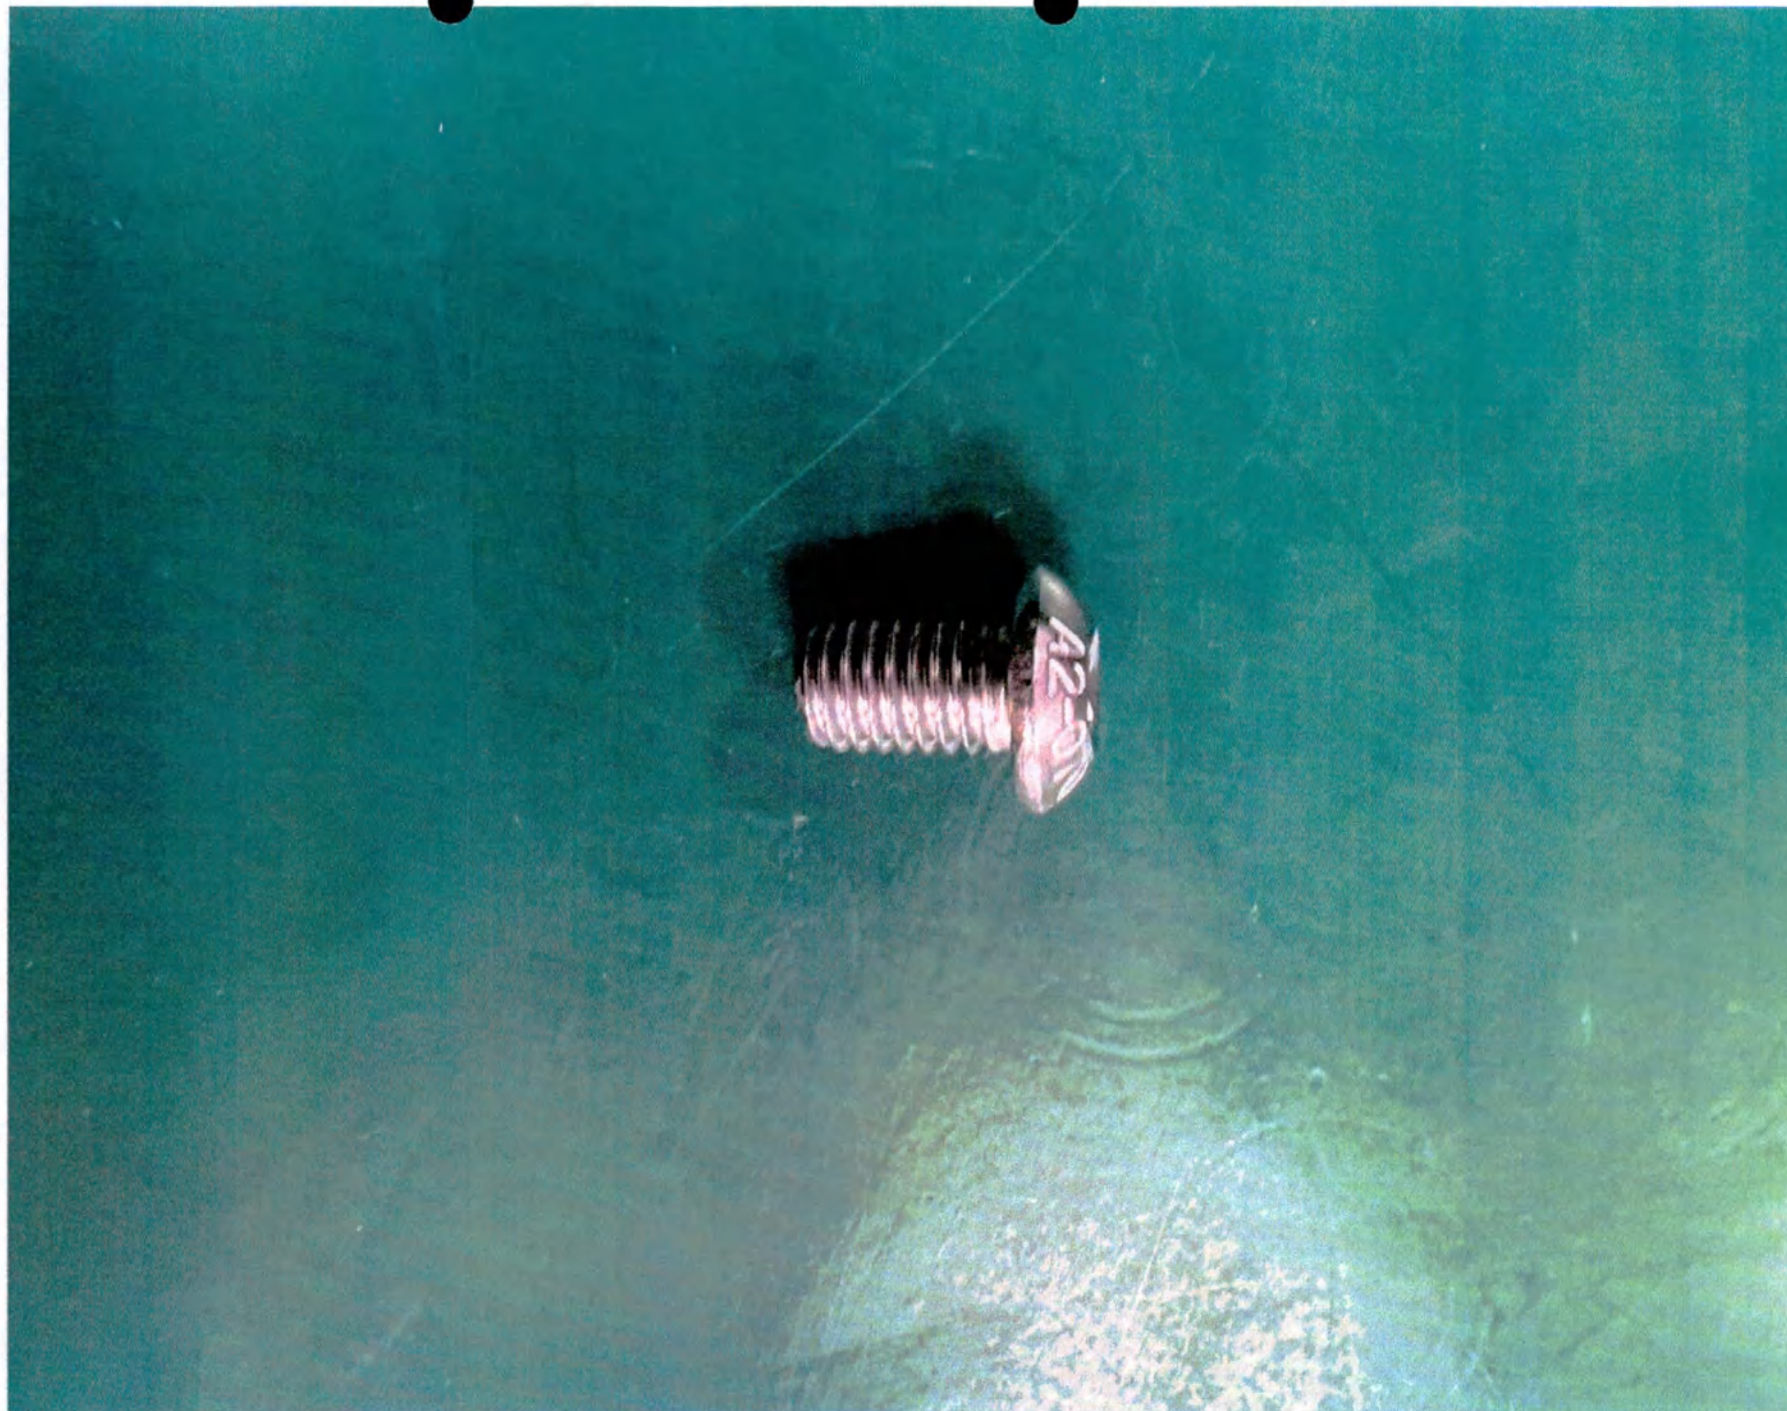


Болт М6×10

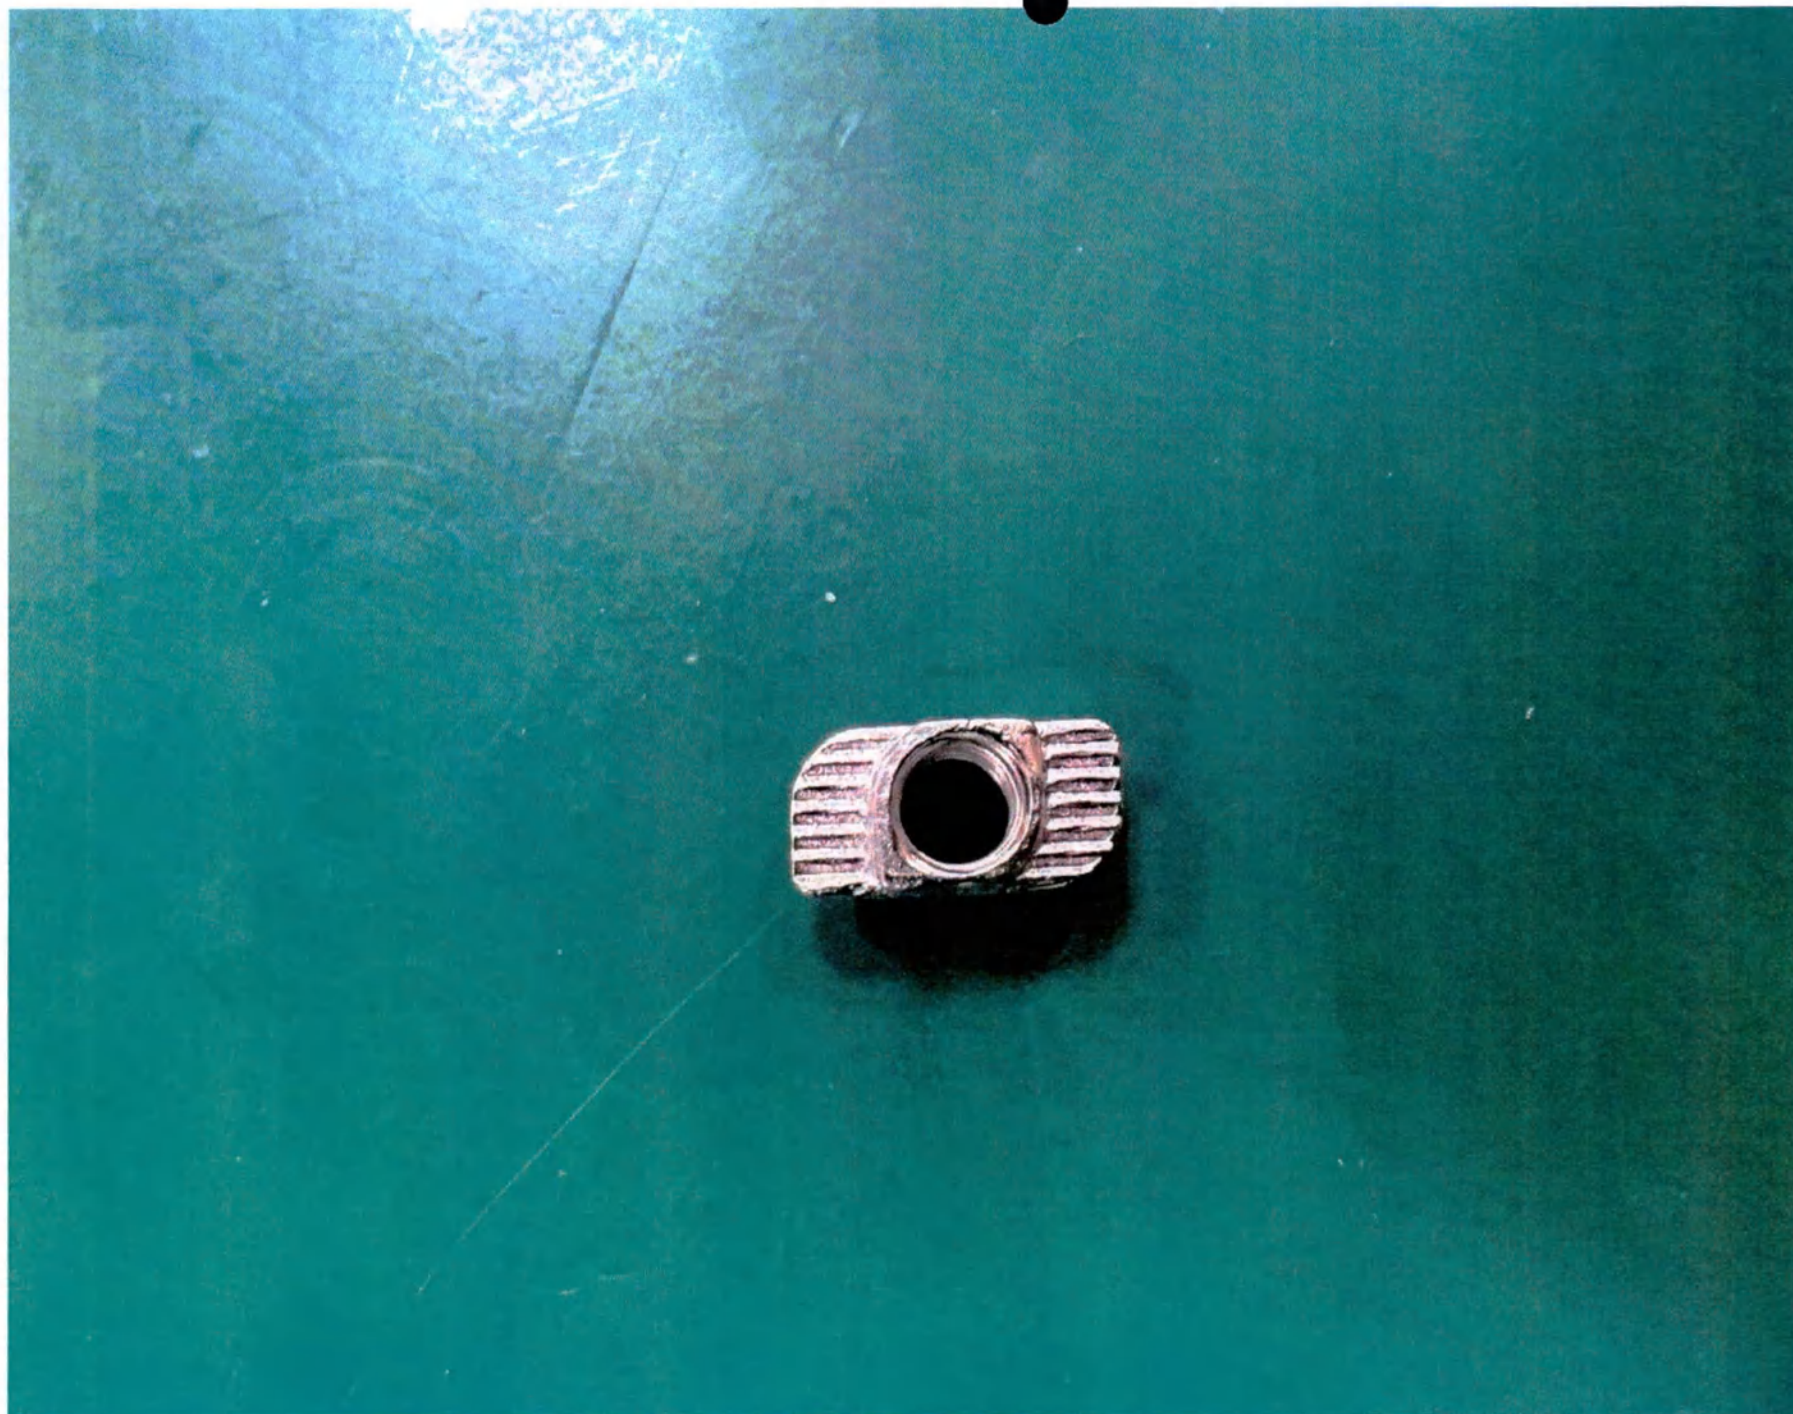

Гайка Т-образная М6

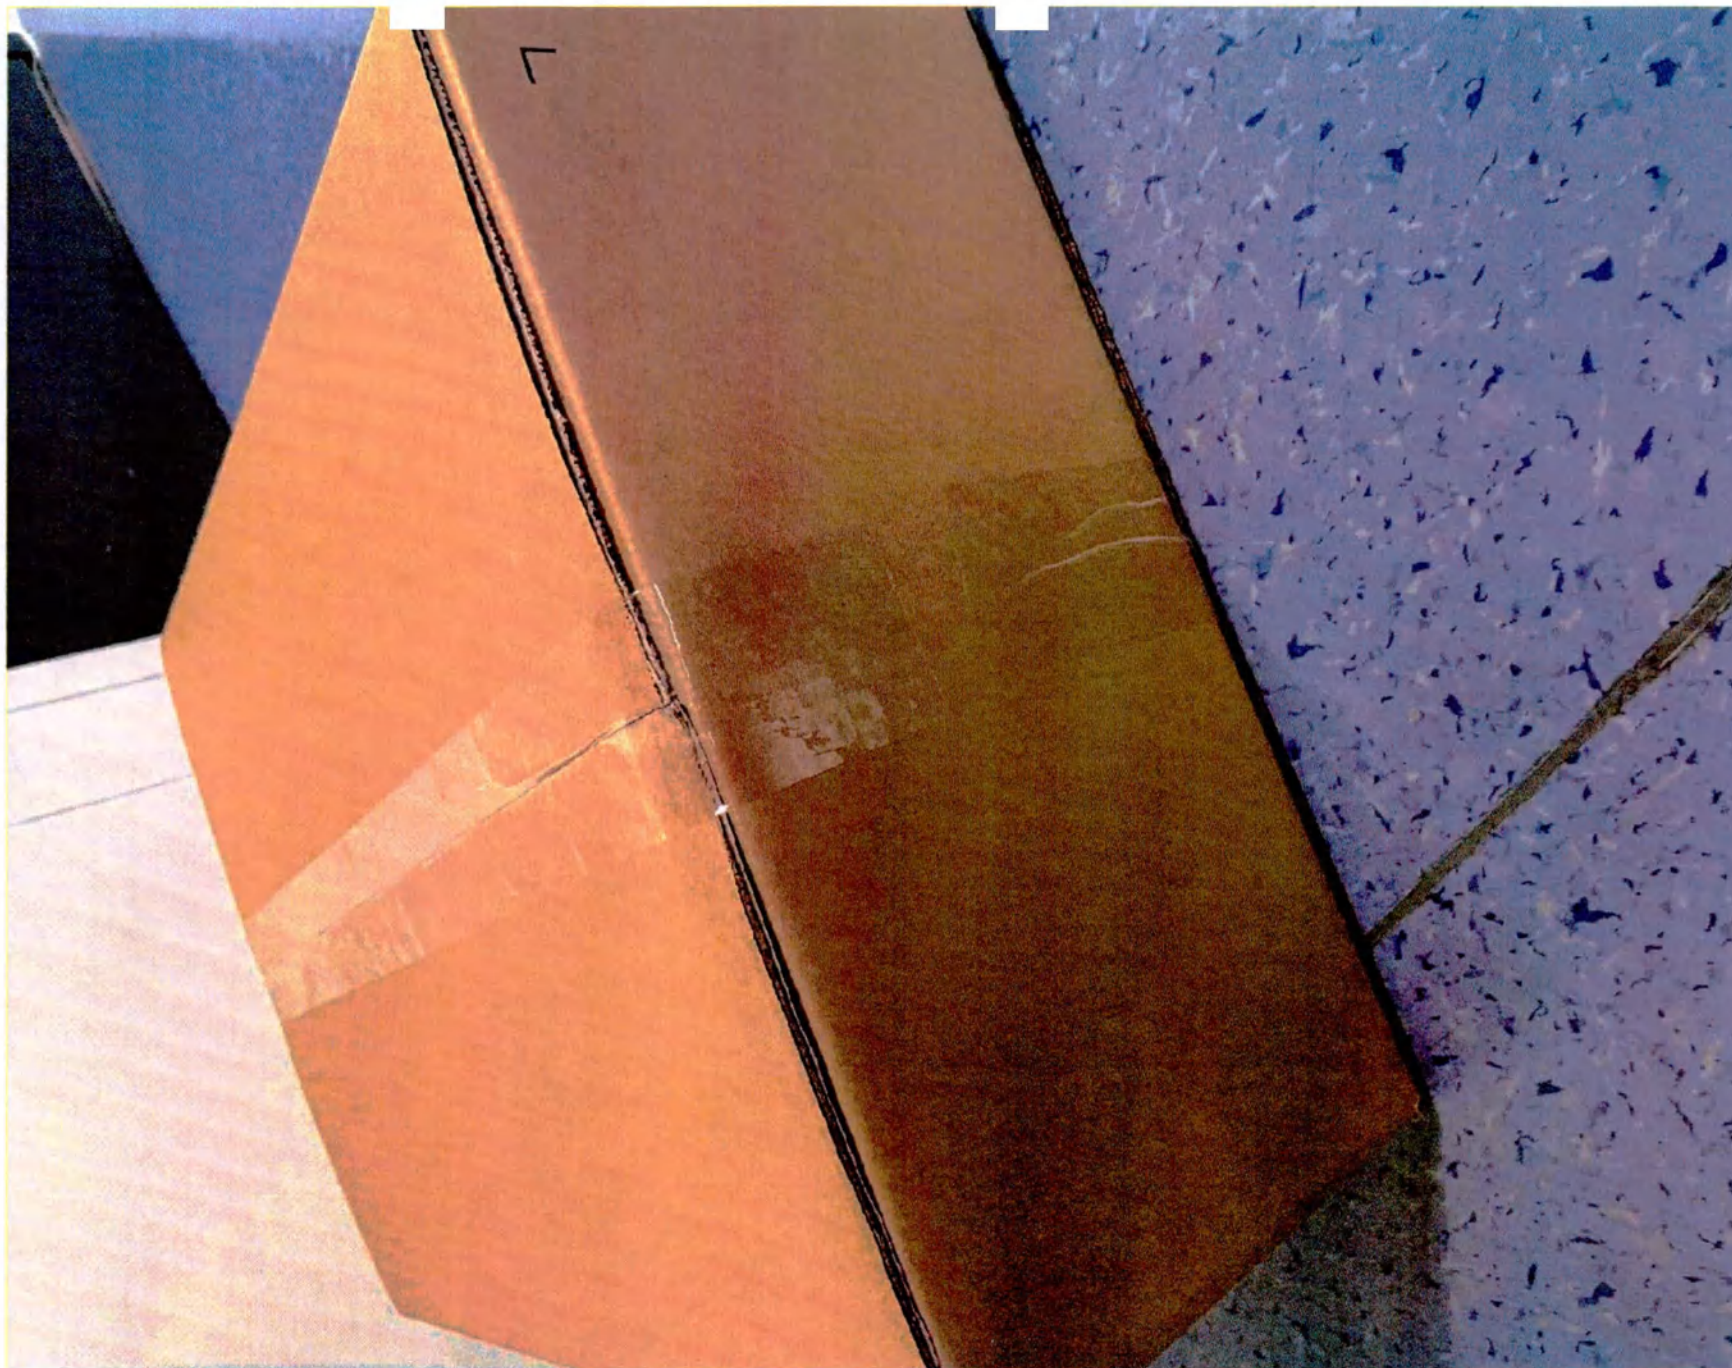

Держатель монитора (упаковка)

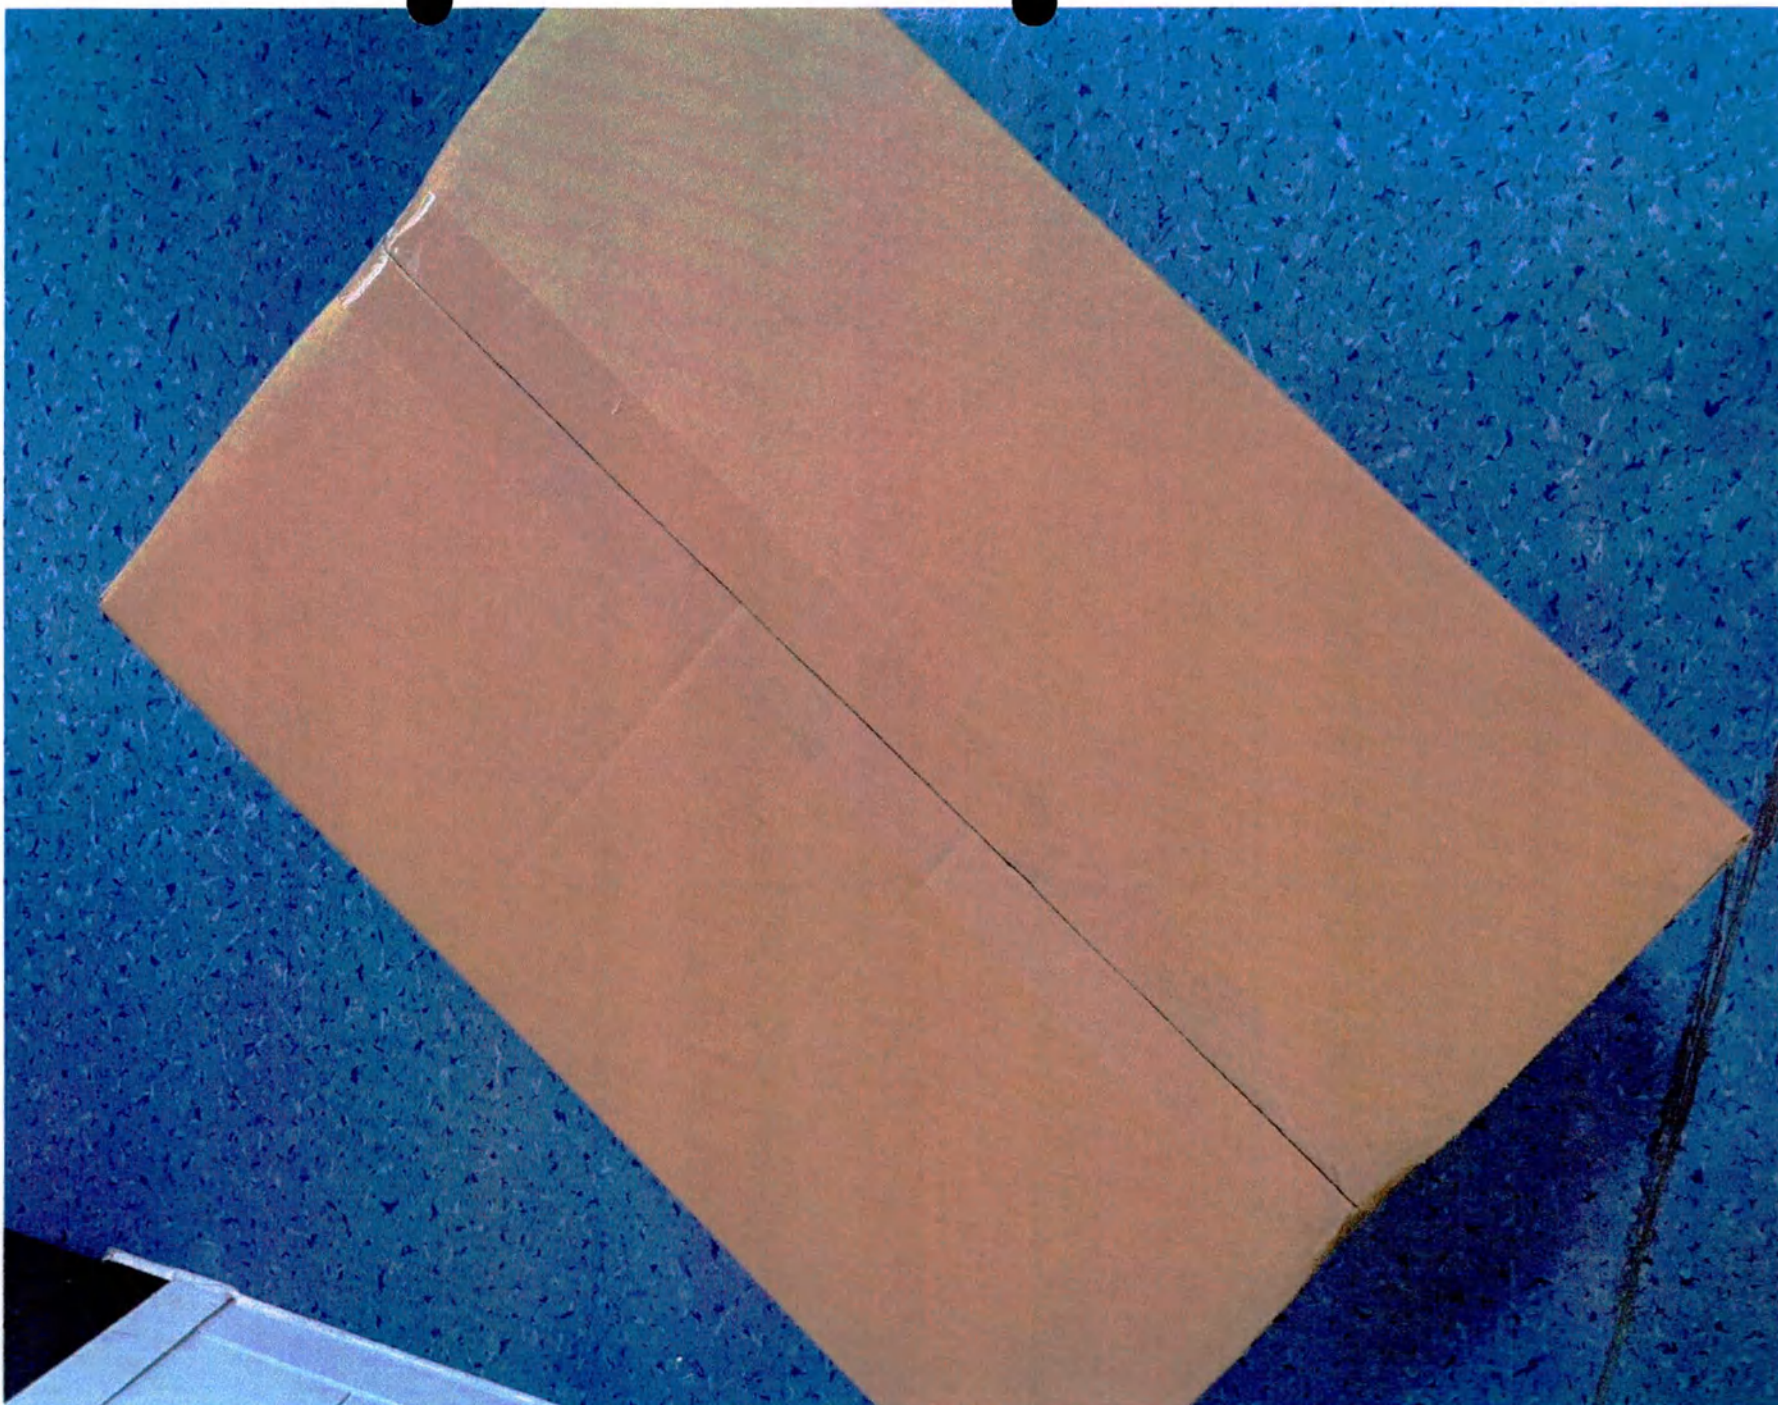

Держатель монитора (упаковка)

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Принадлежность

Держатель монитора, в составе:

- Головка торцевая – 1 шт.;
- Шарнир основной – 1 шт.;
- Фиксатор клавиатуры – 2 шт.;
- Столик для клавиатуры – 1 шт.;
- Винт M6x10 – 3 шт.;
- Ключ шестигранный 6 мм – 1 шт.;
- Винт M6x12 – 4 шт.;
- Винт M6x8 – 1 шт.;
- Ключ шестигранный 2,5 мм – 1 шт.;
- Ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.;
- Винт M8x20 – 1 шт.;
- Шайба пластиковая – 1 шт.;
- Шайба из нержавеющей стали – 1 шт.;
- Шарнир подъёмный – 1 шт.;
- Винт комбинированный M4x10 – 4 шт.;
- Дюбель – 4 шт.;
- Винт самонарезающий – 4 шт.;
- Шарнир крепёжный для кронштейна монитора – 1 шт.;
- Кронштейн под монитор – 1 шт.;
- Пластина внешняя к держателю монитора – 1 шт.;
- Винт M6x16 – 10 шт.;

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4




Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.),


Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China


Макет этикетки упаковки держателя монитора

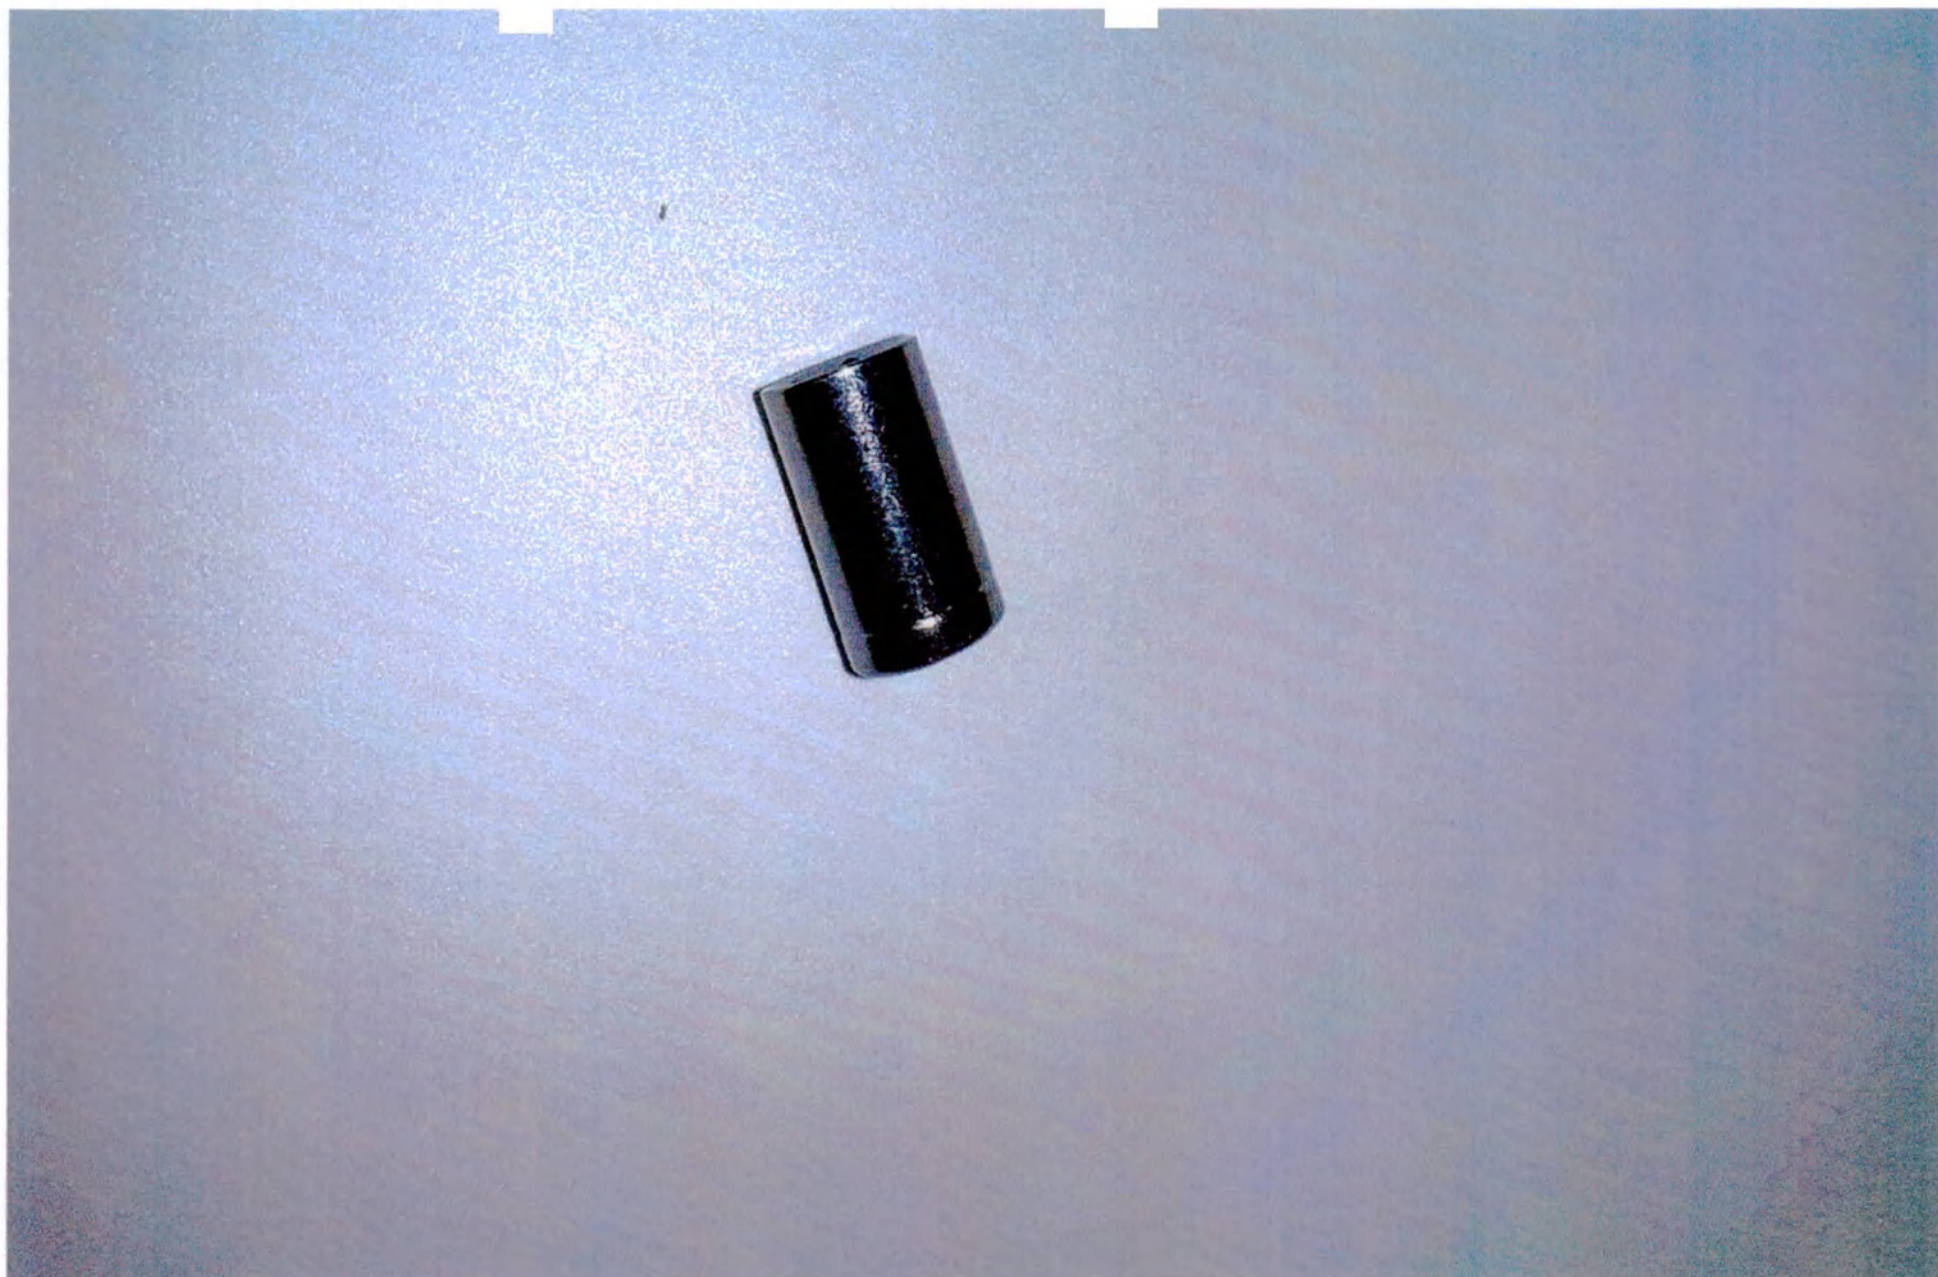


Головка торцевая

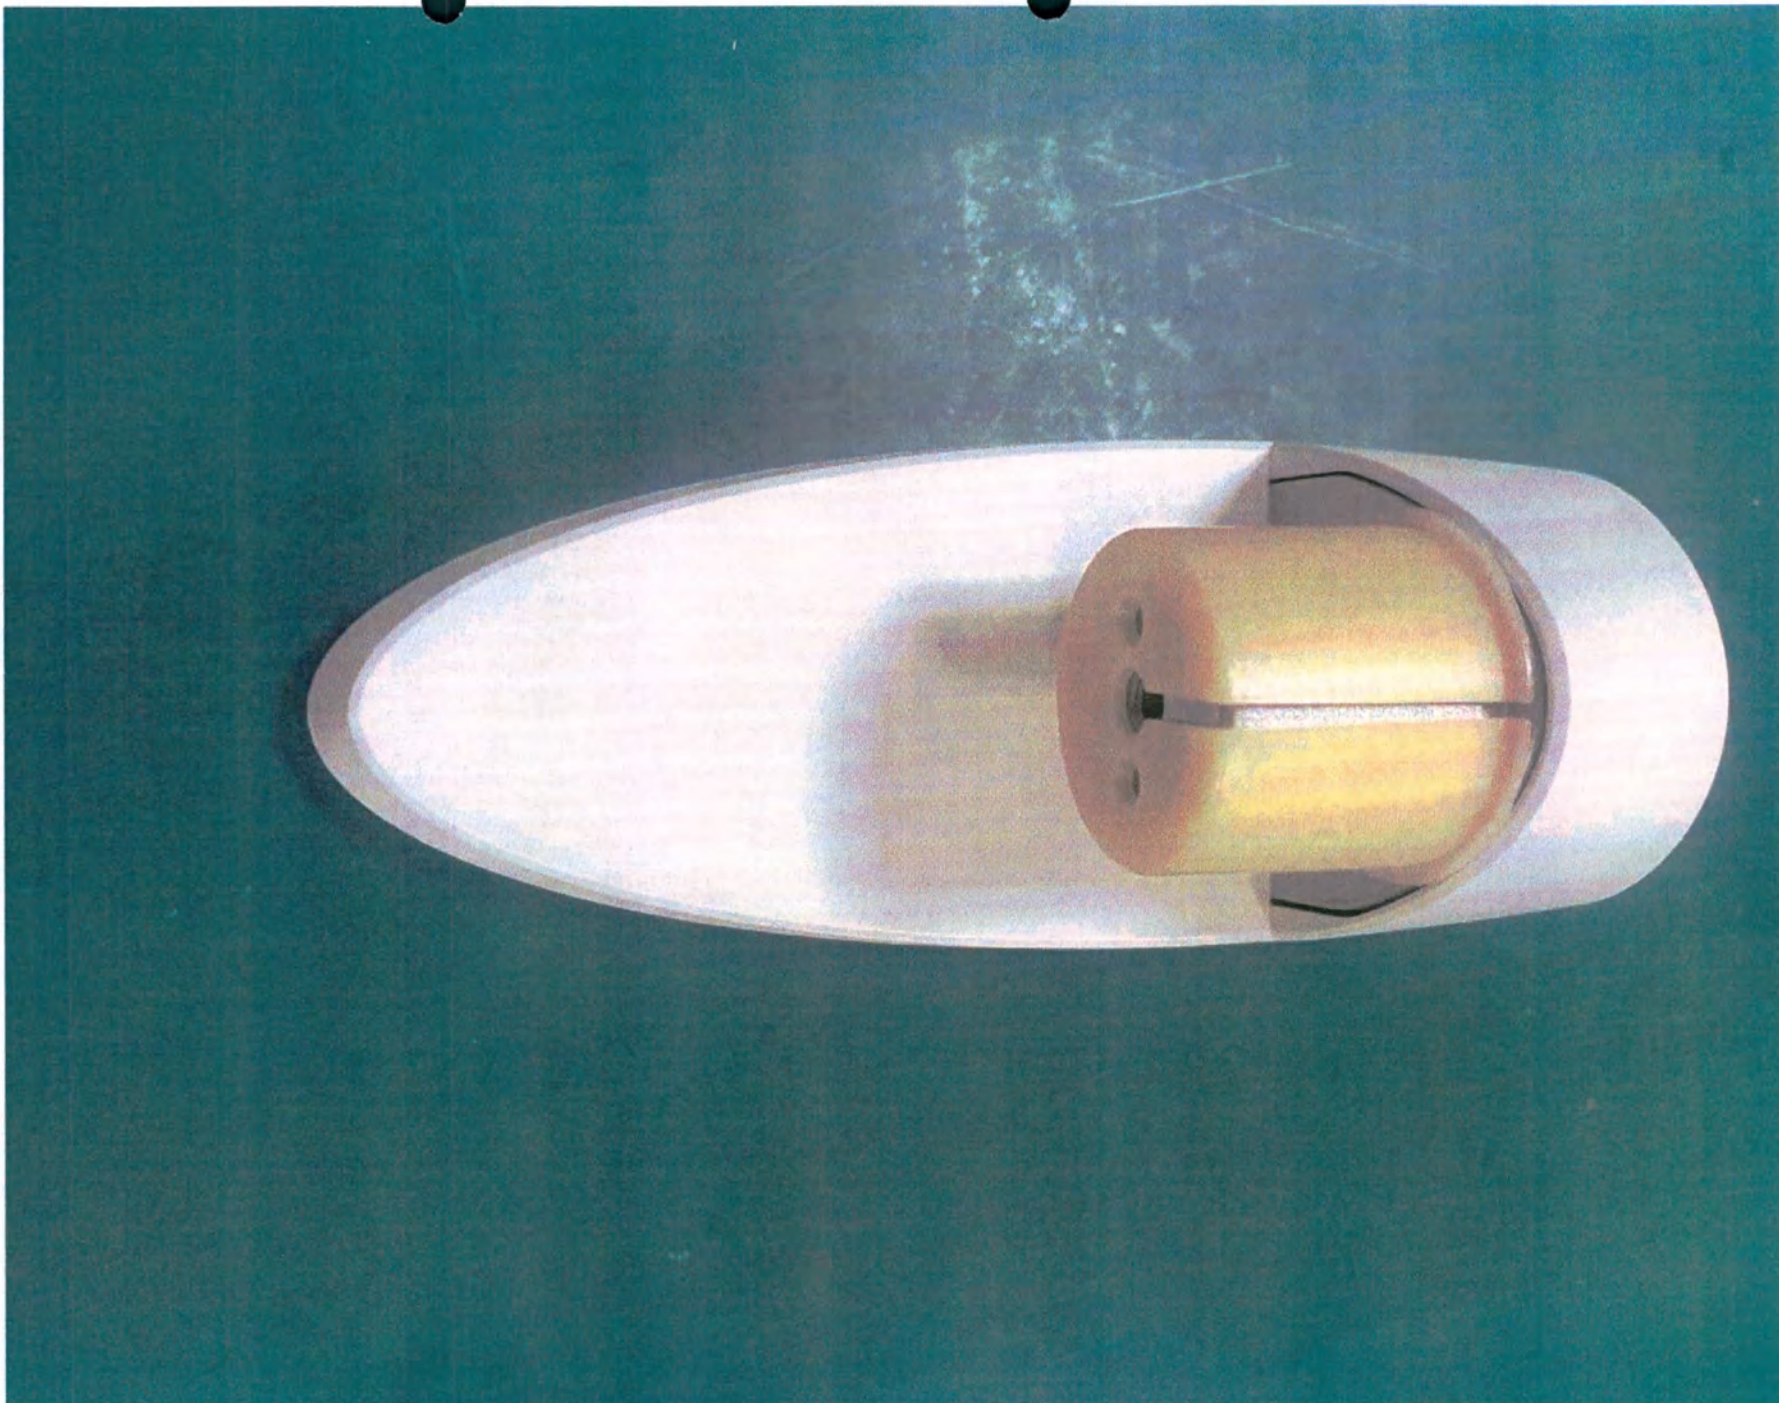

Шарнир основной

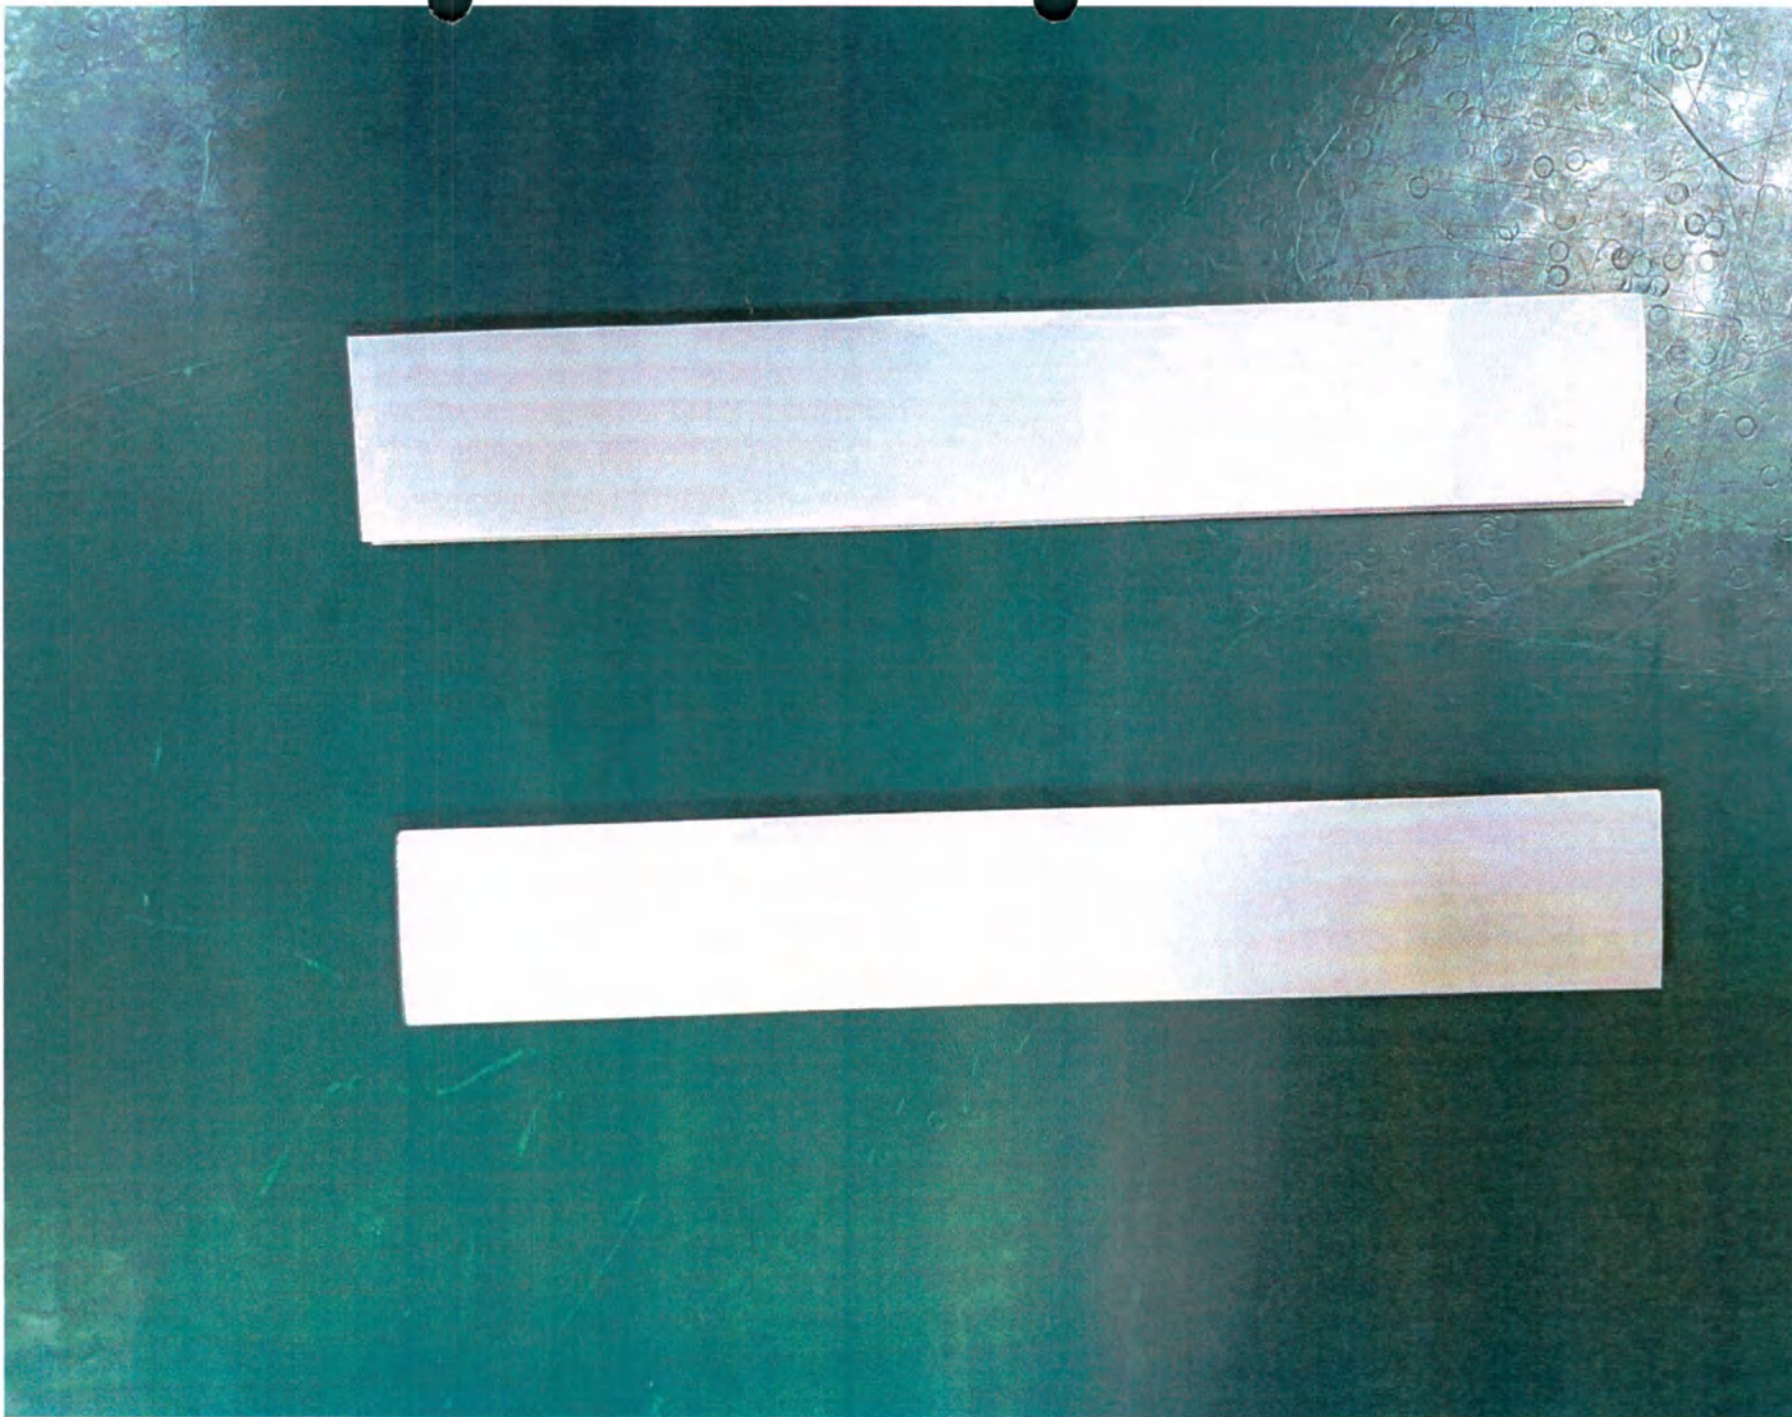

Фиксатор клавиатуры

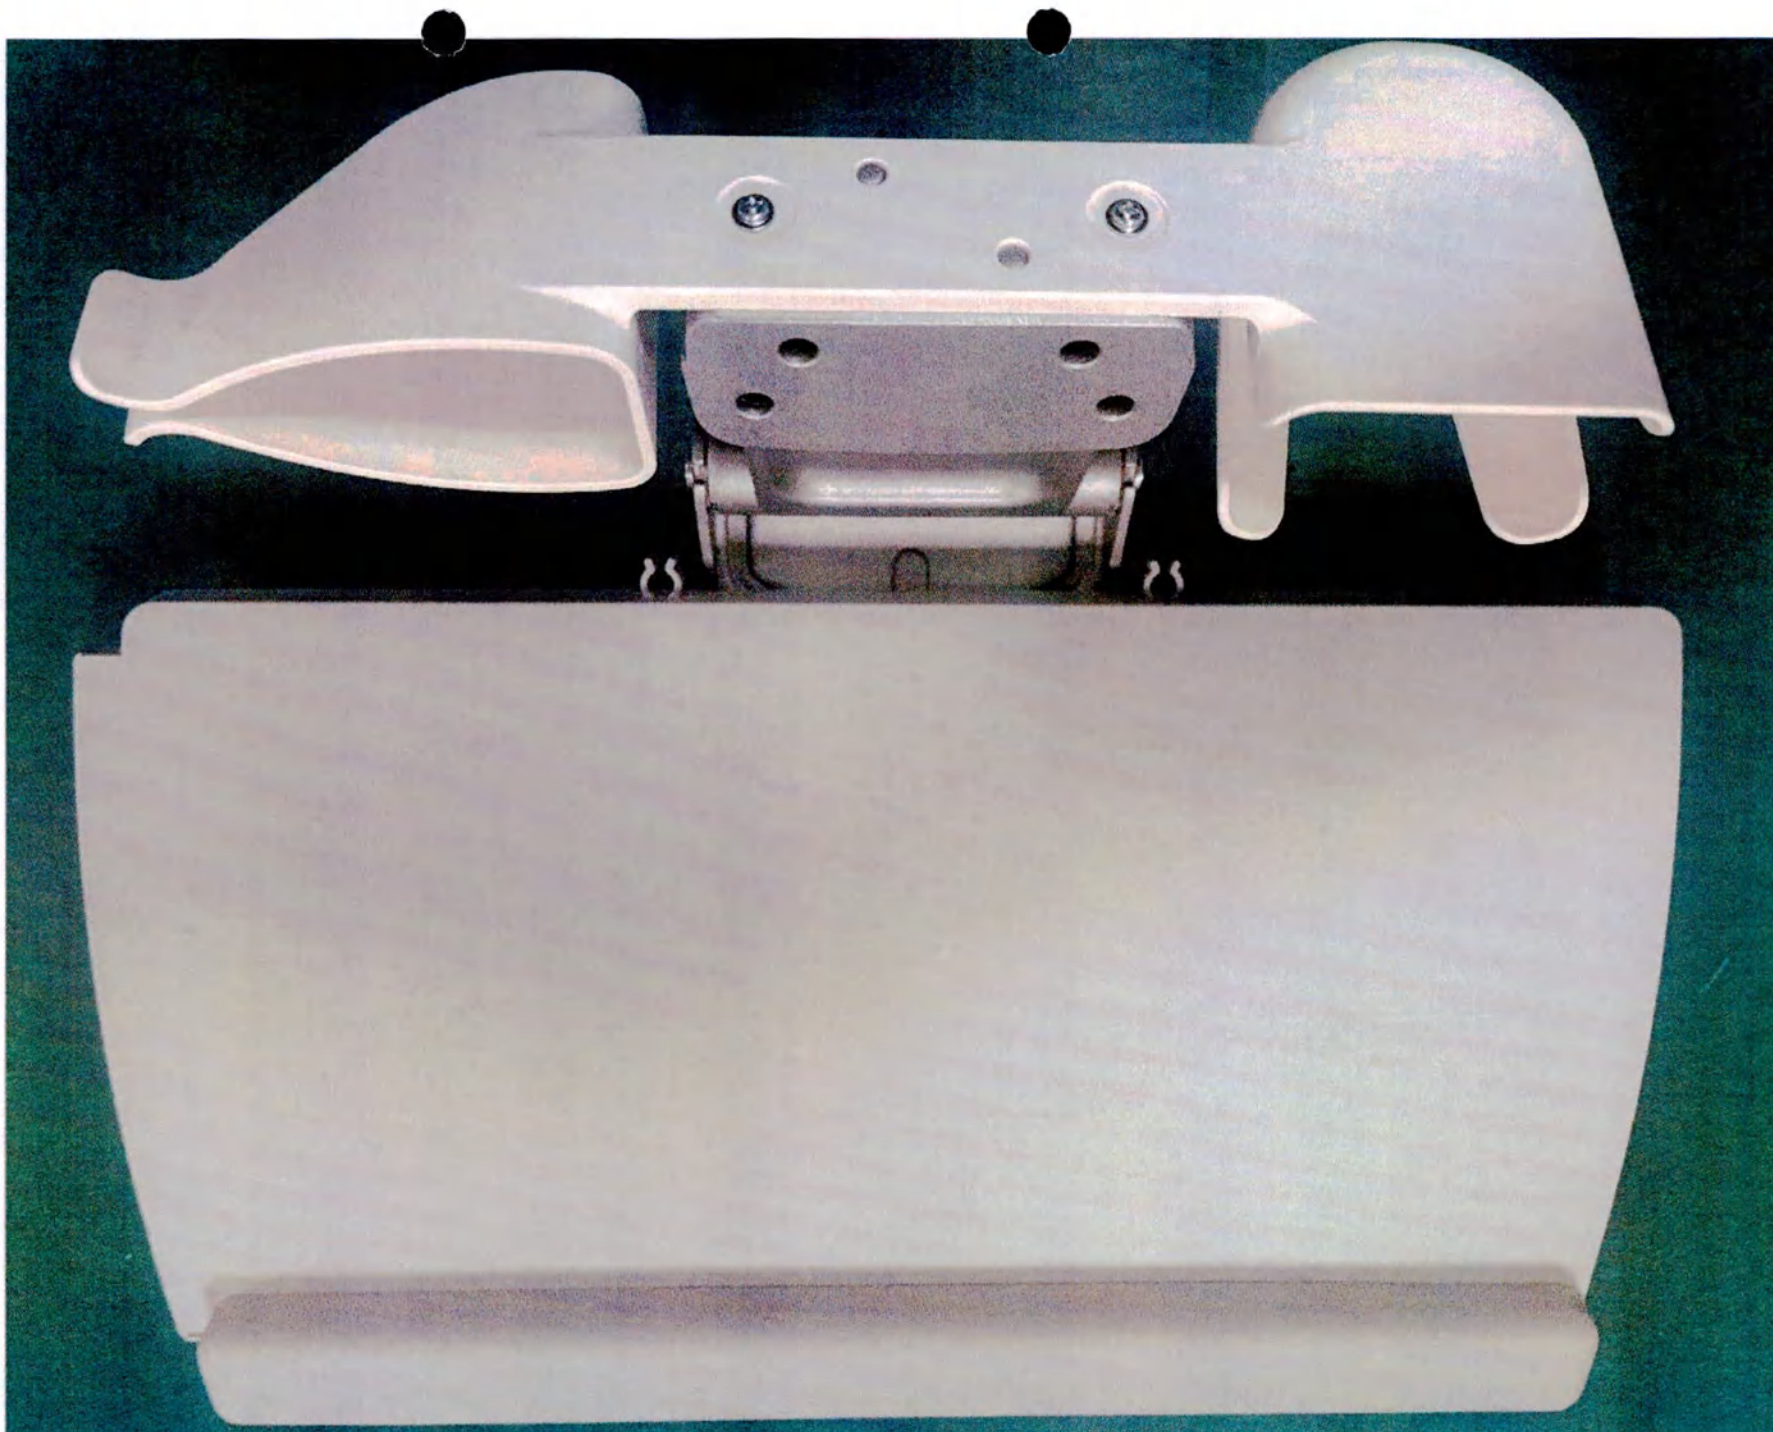


Столик для клавиатуры



Винт М6х10

Ключ шестигранный 6 мм

Стр. 79 из 112

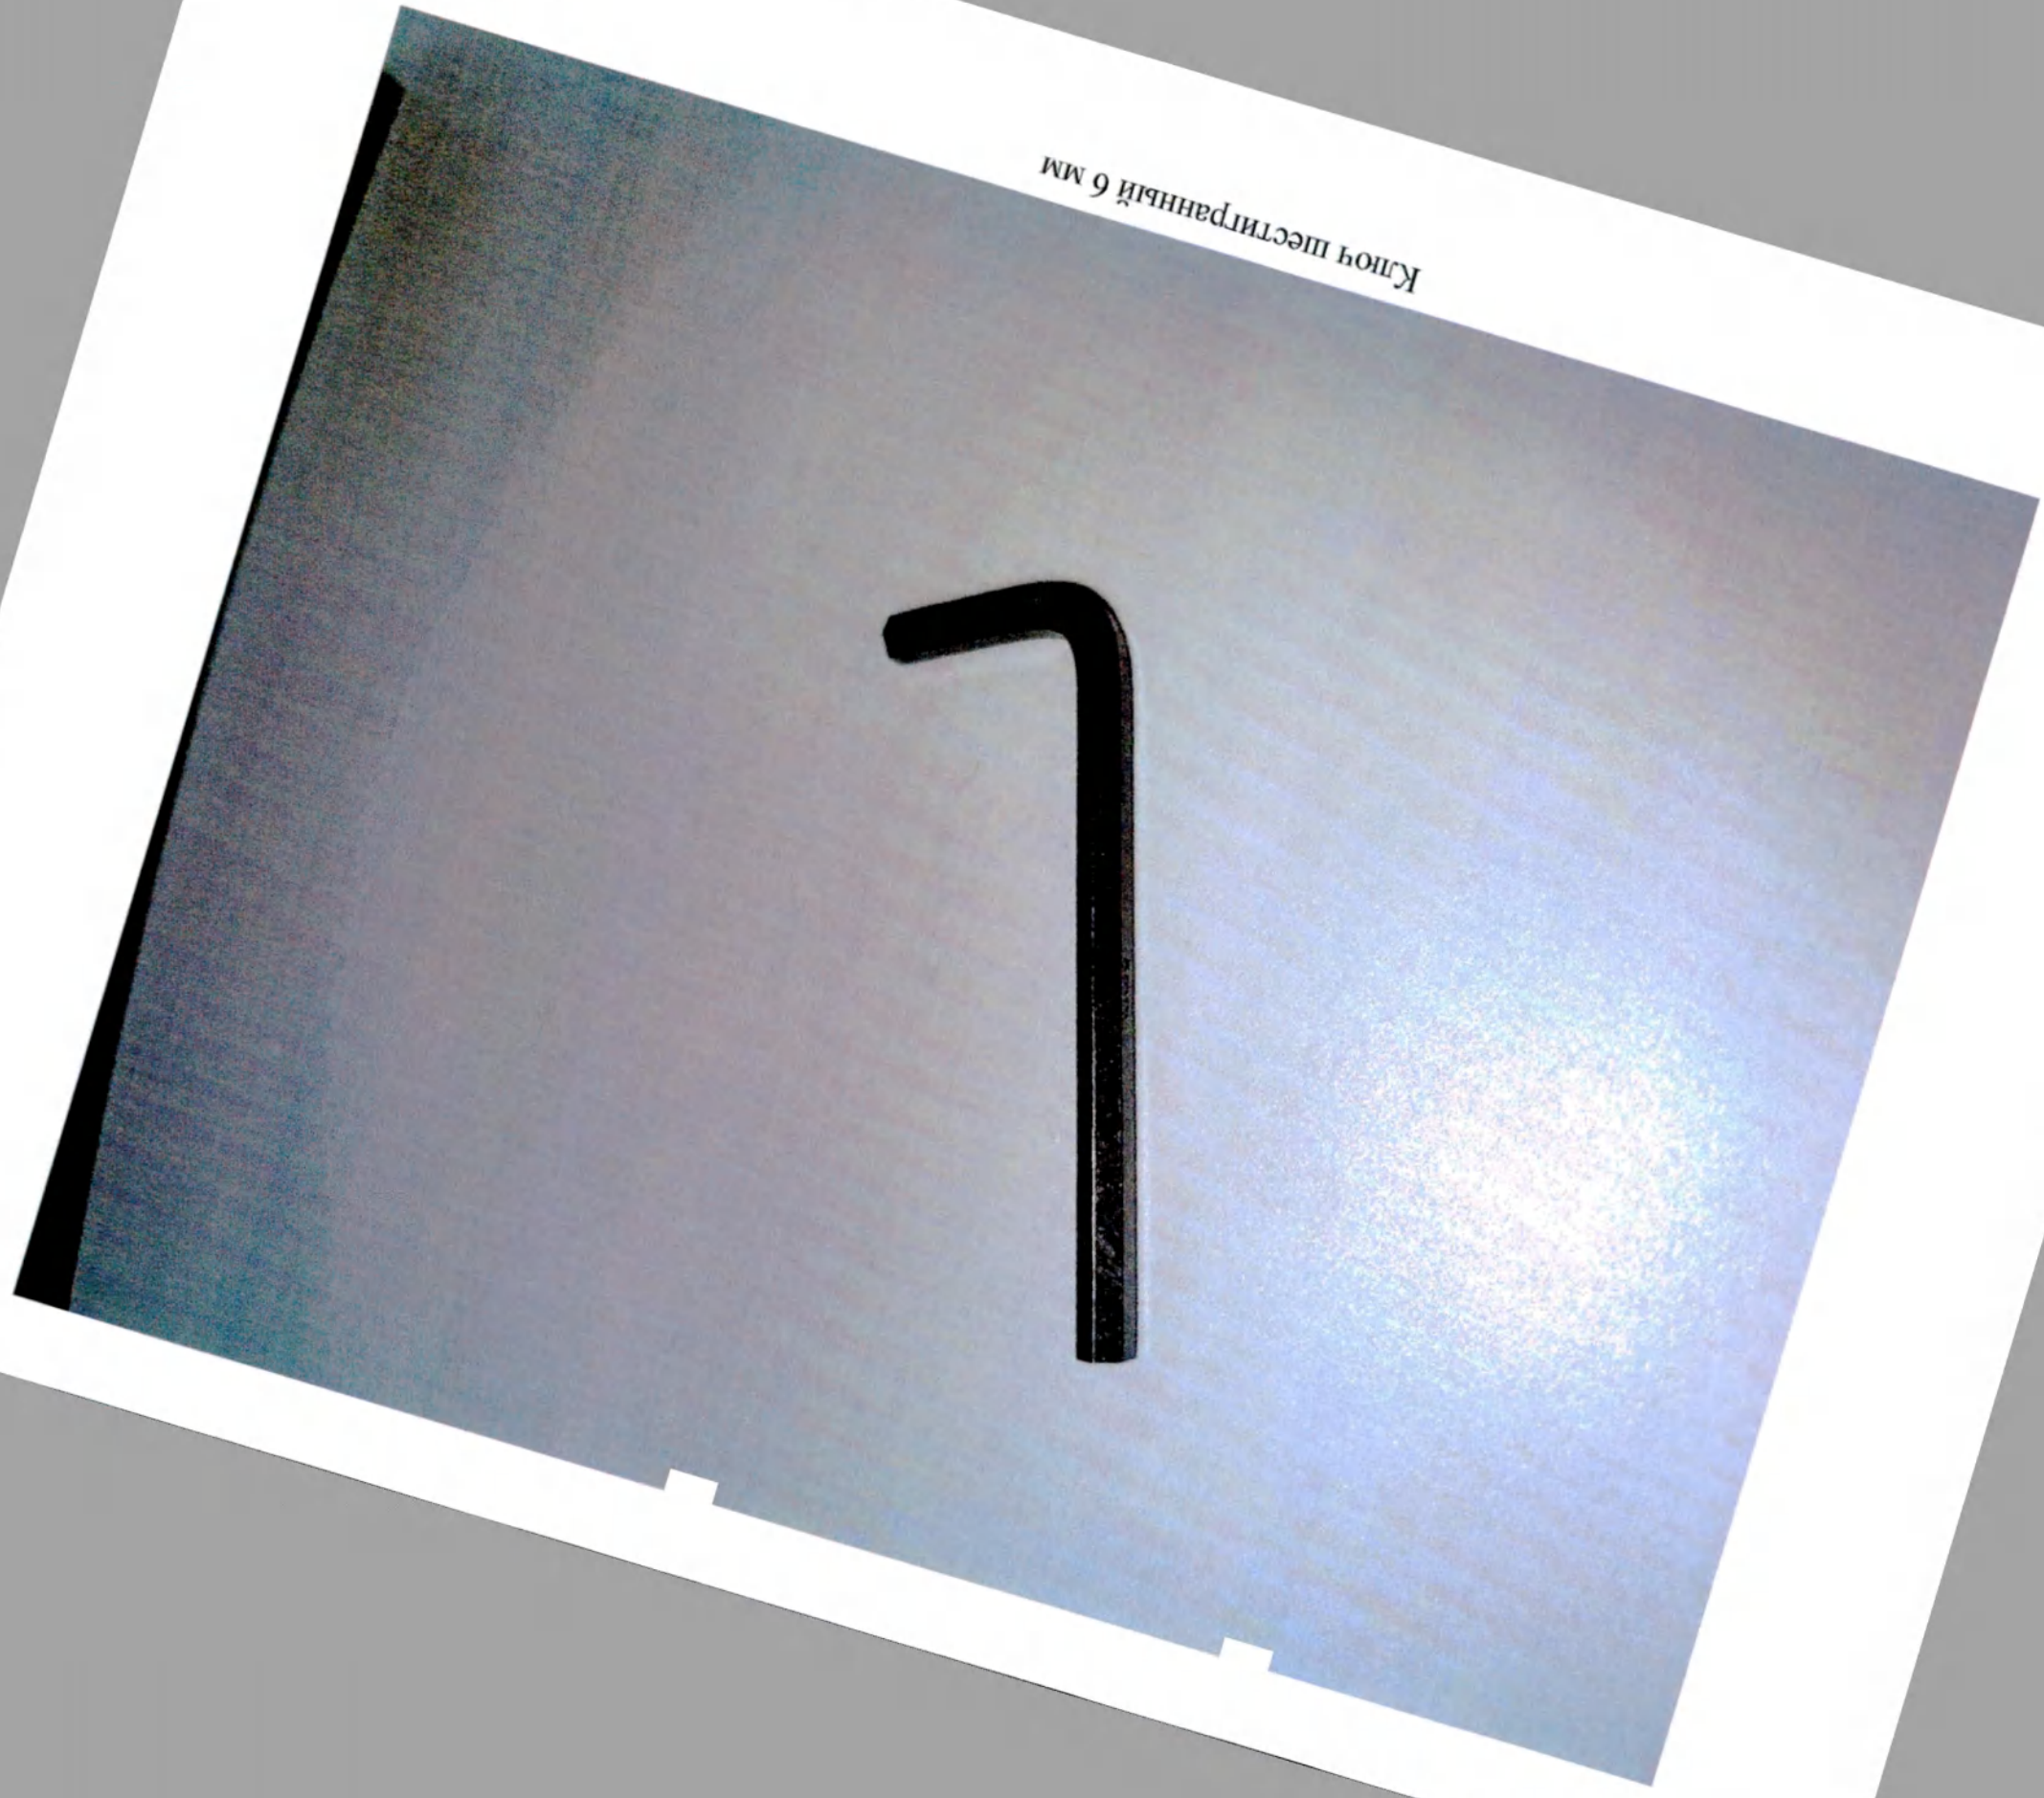



Винт М6х12



Винт М6х8



Ключ шестигранный 2,5 мм


Стр. 83 из 112

Ключ шестигранный 5 мм






Винт М8х20

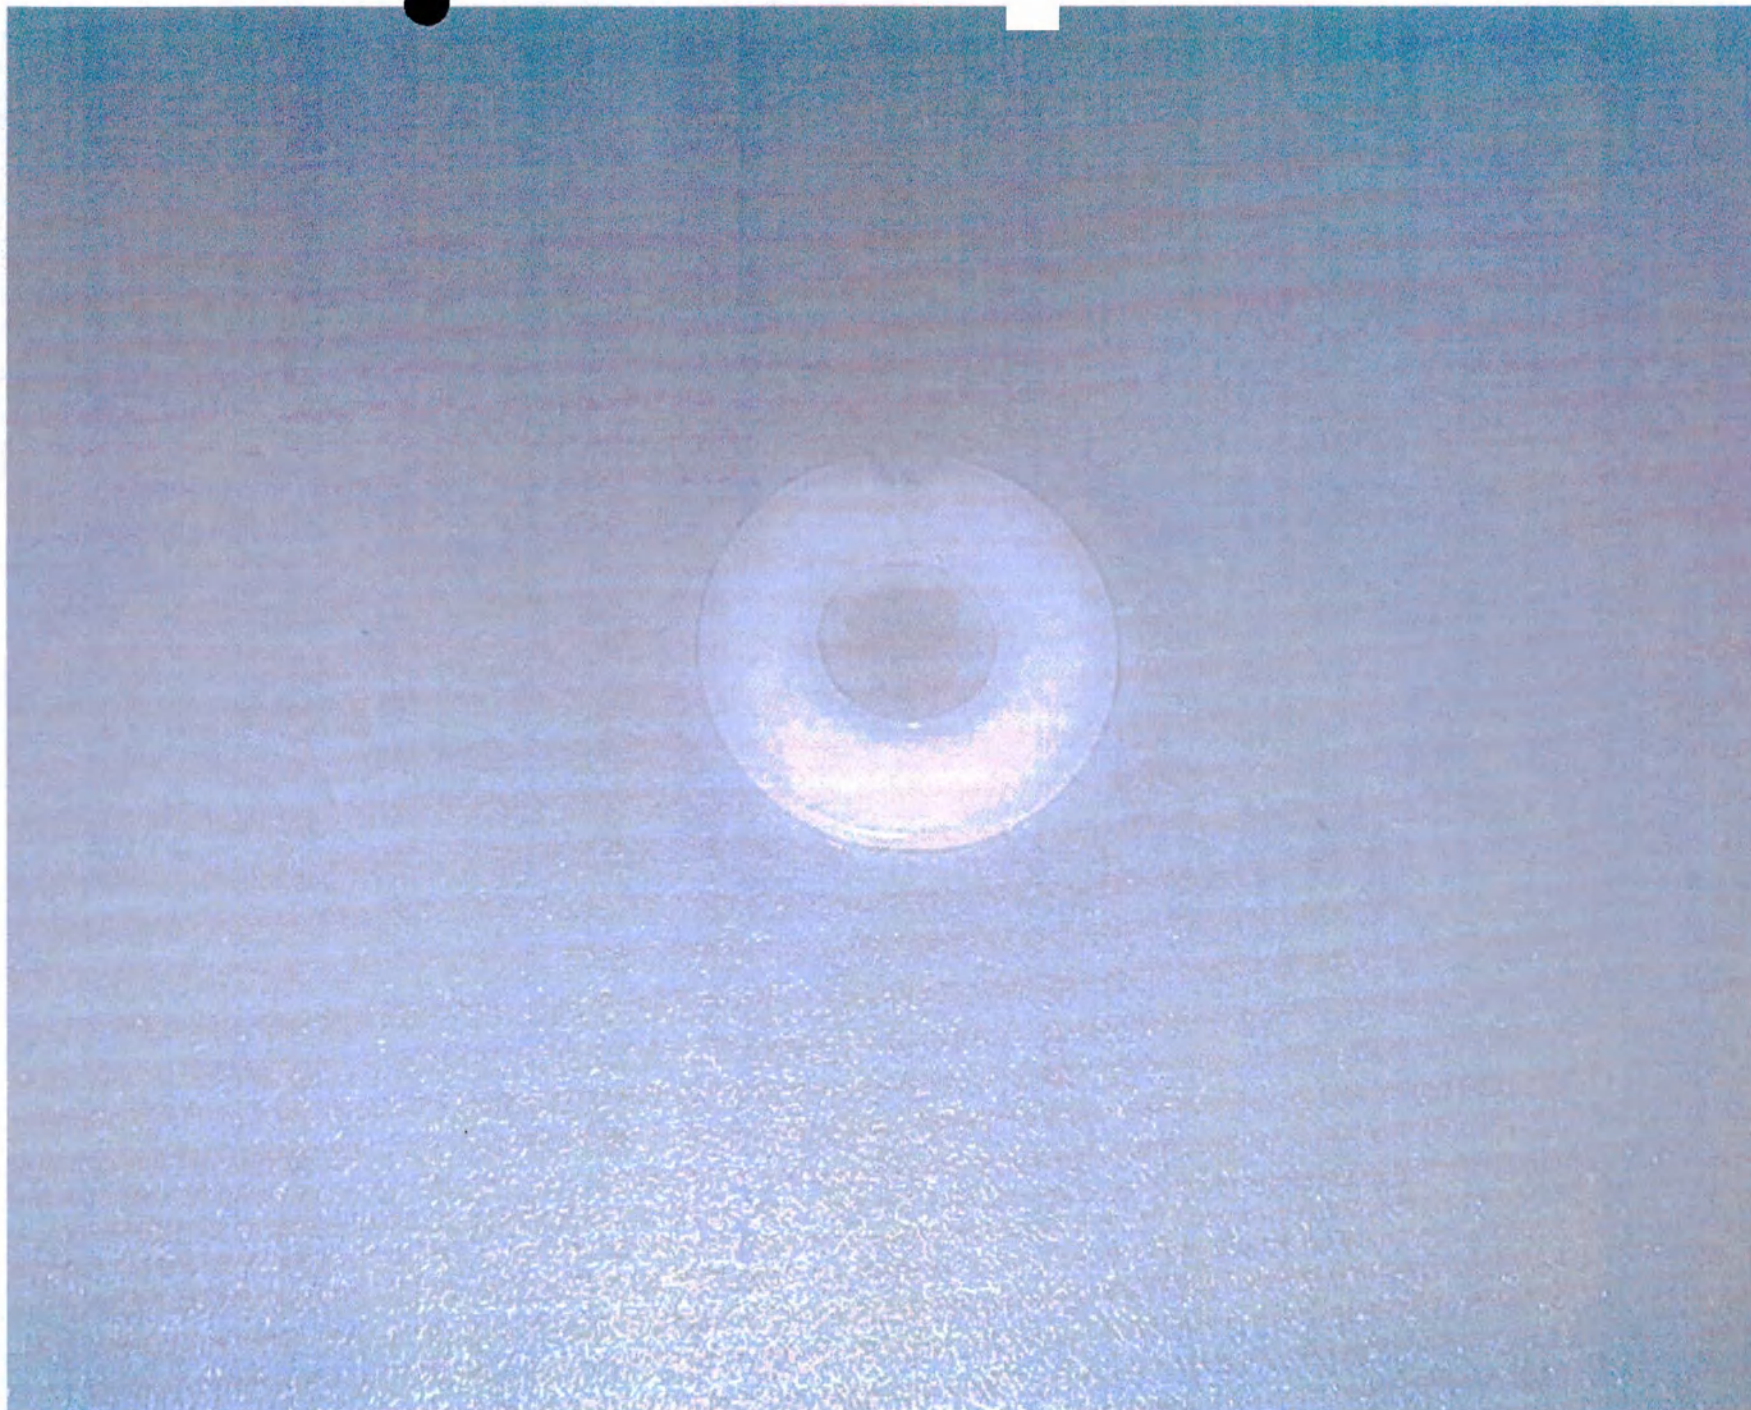


Шайба пластиковая

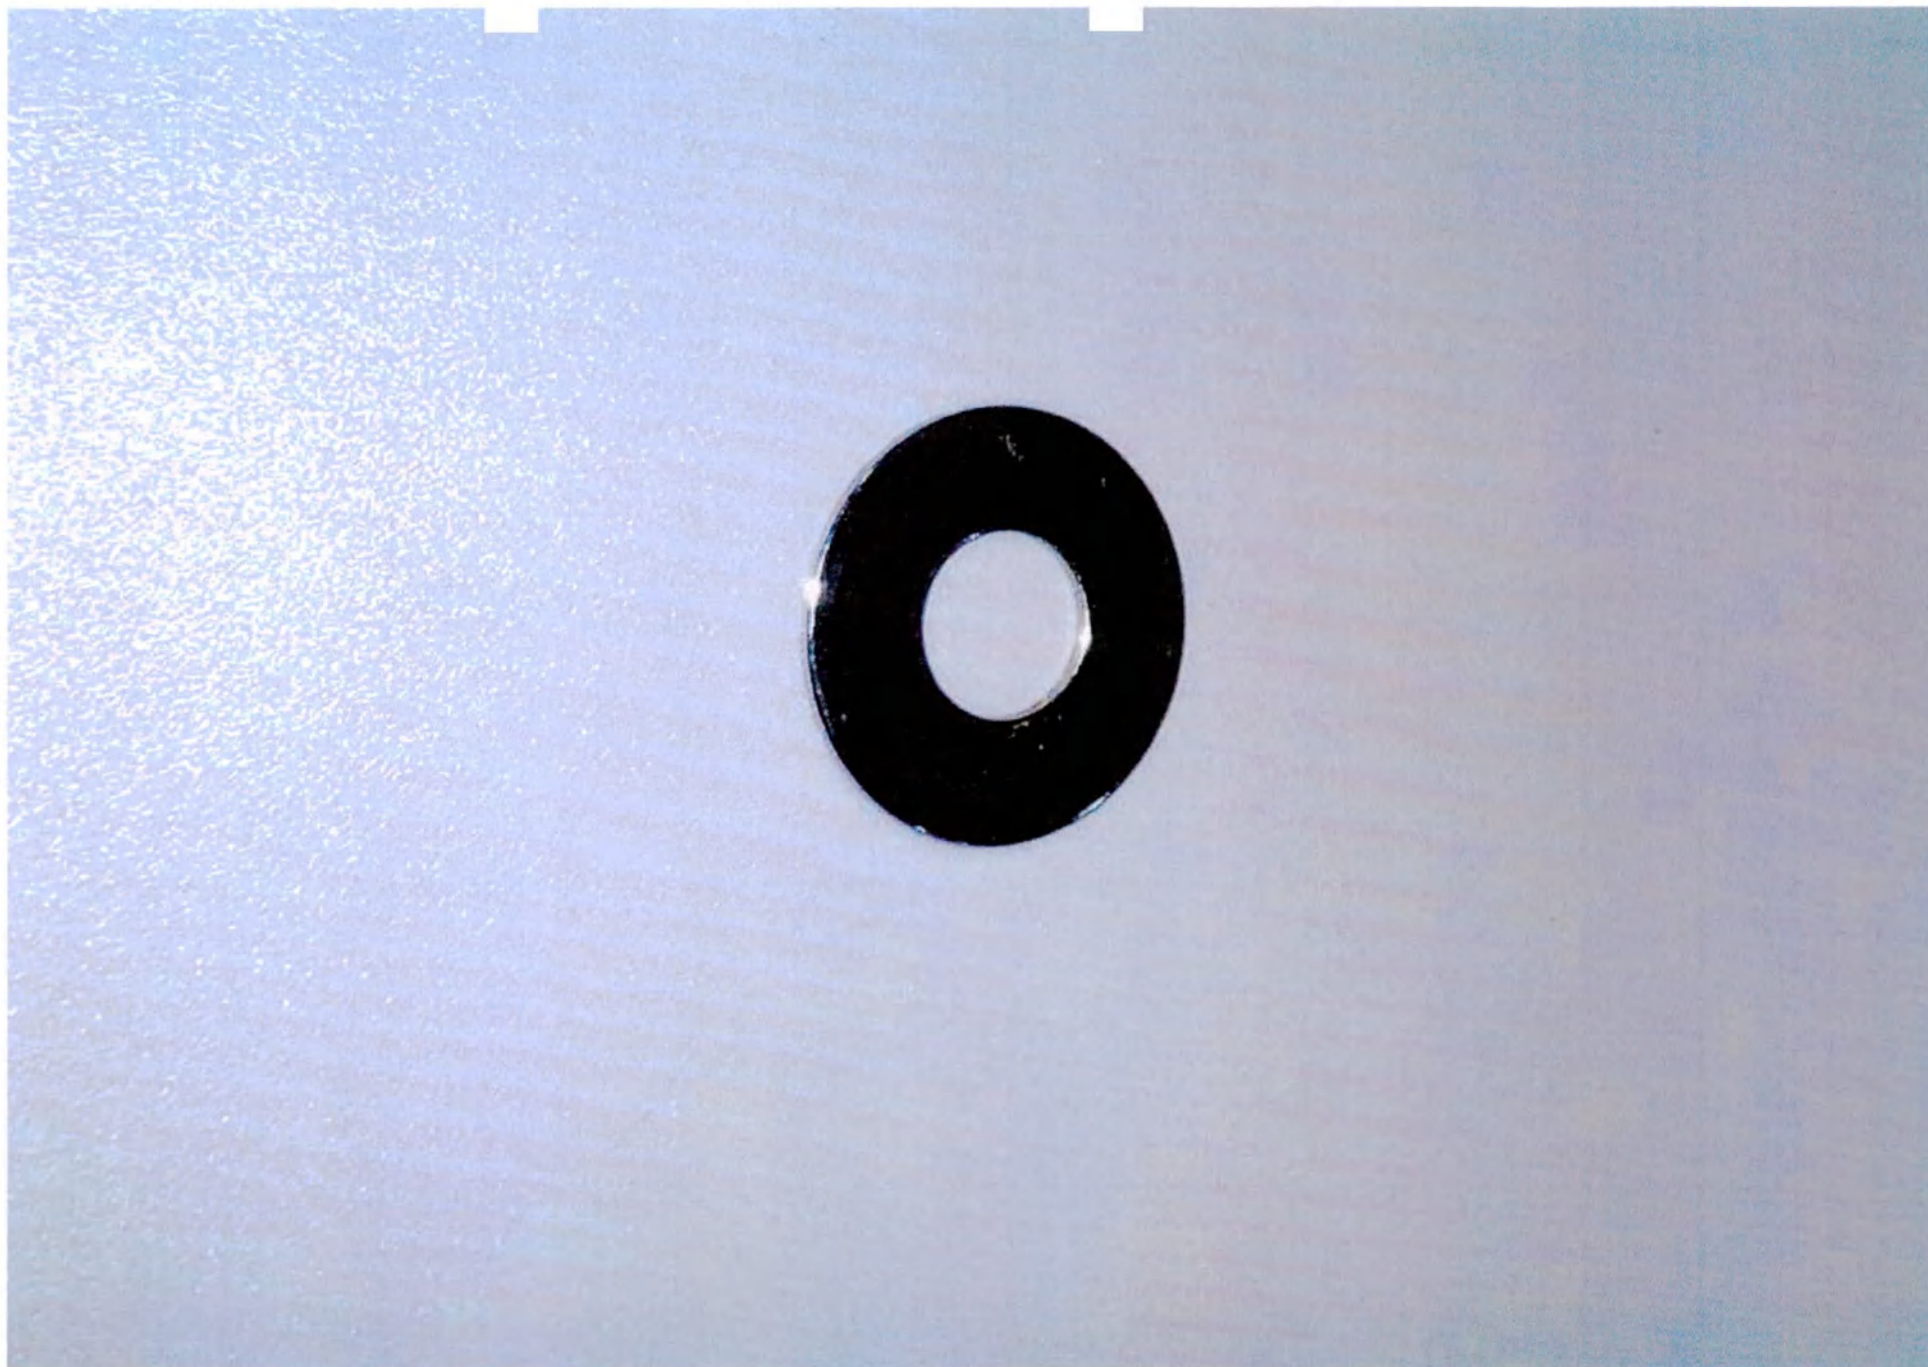


Шайба из нержавеющей стали




Шарнир подъемный

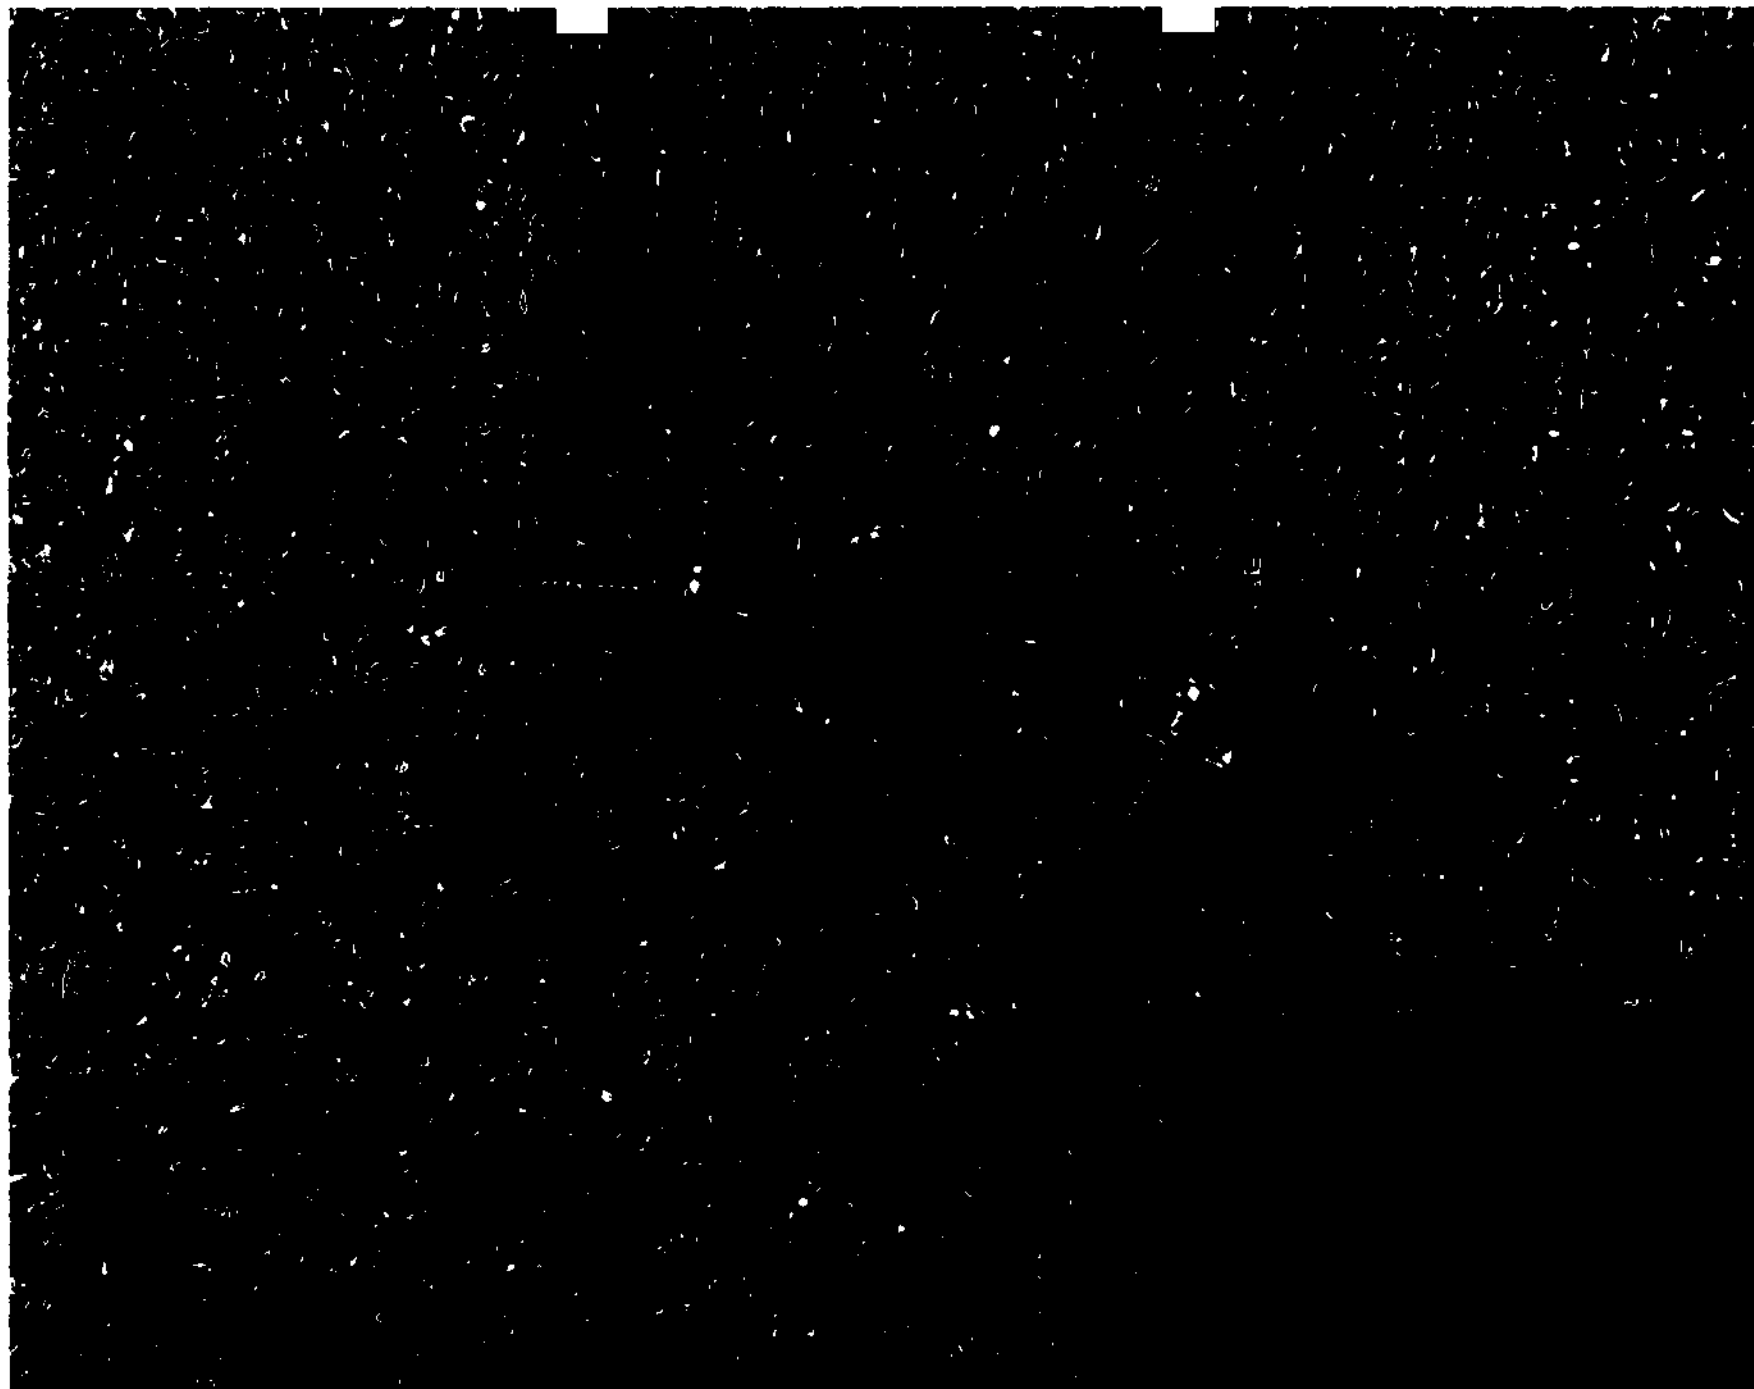


Винт комбинированный М4х10

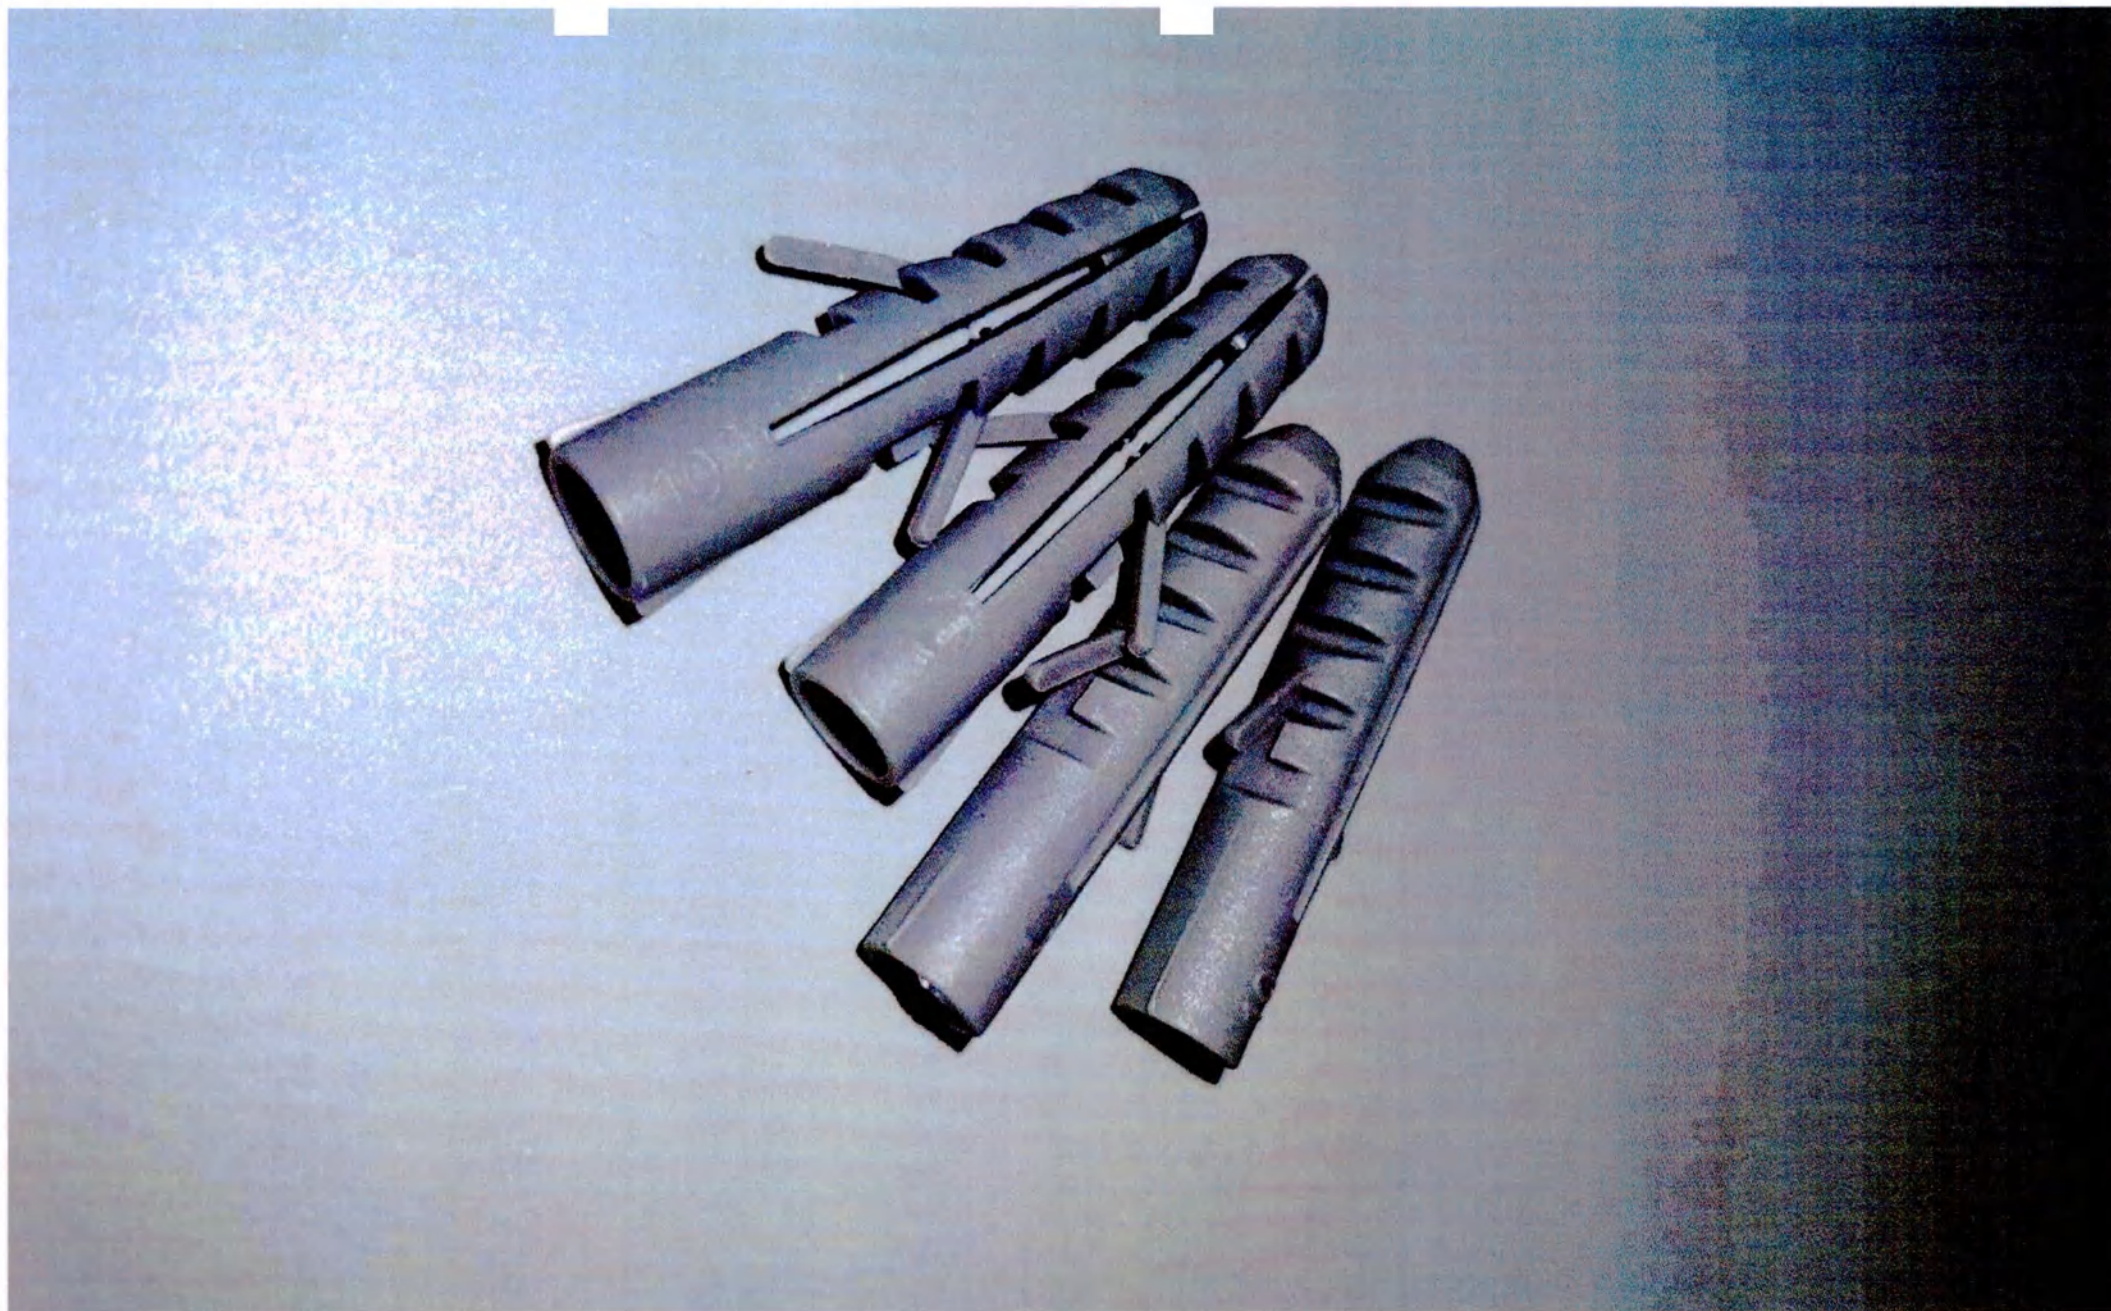


Дюбель

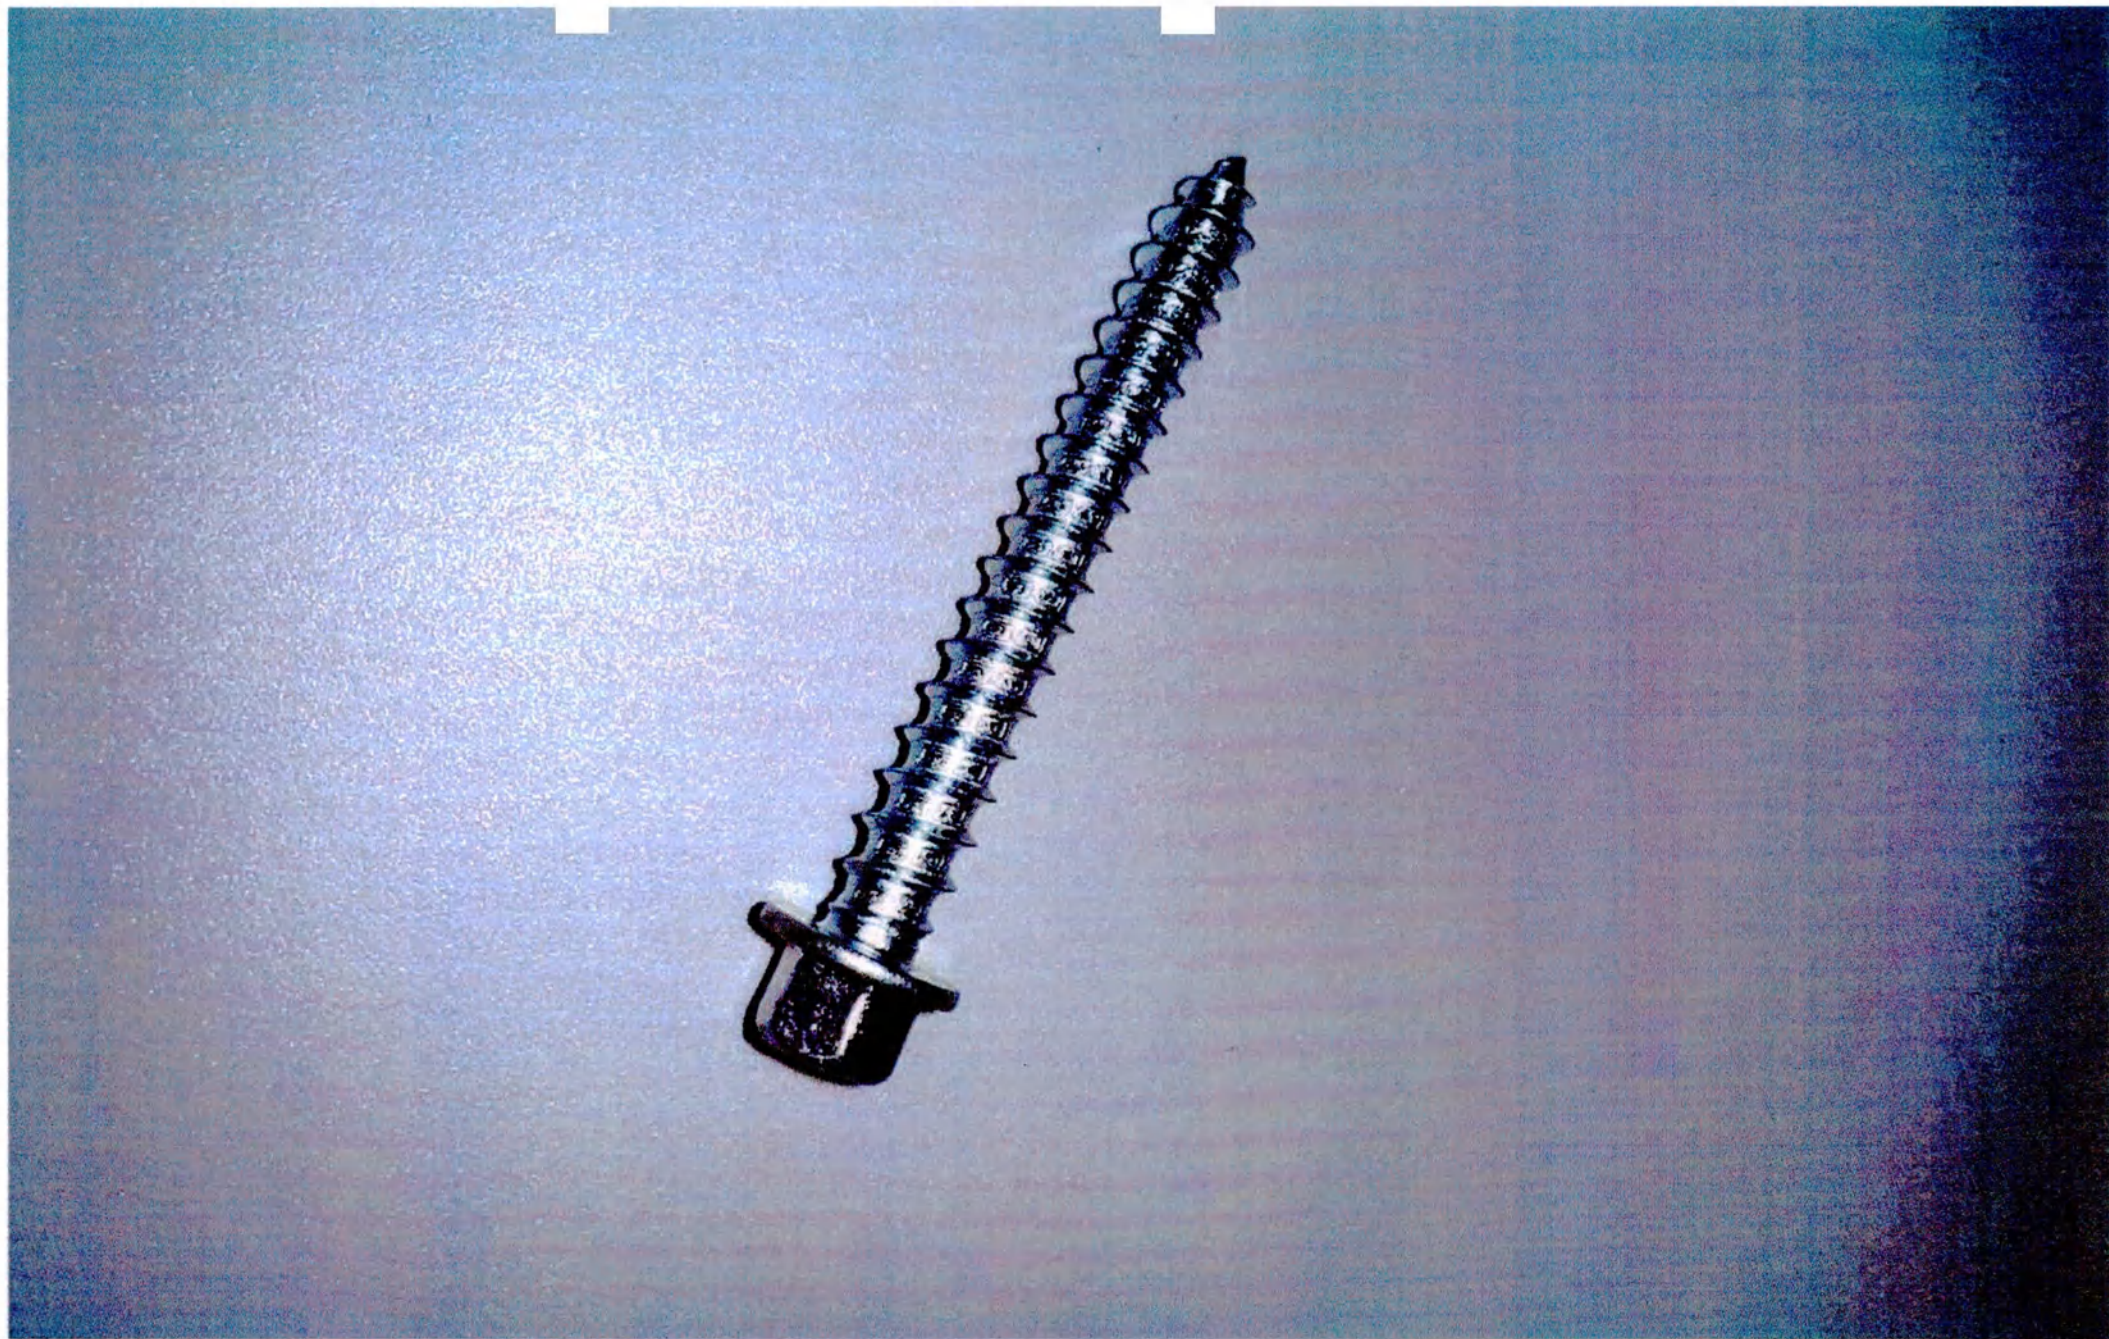


Винт самонарезающий

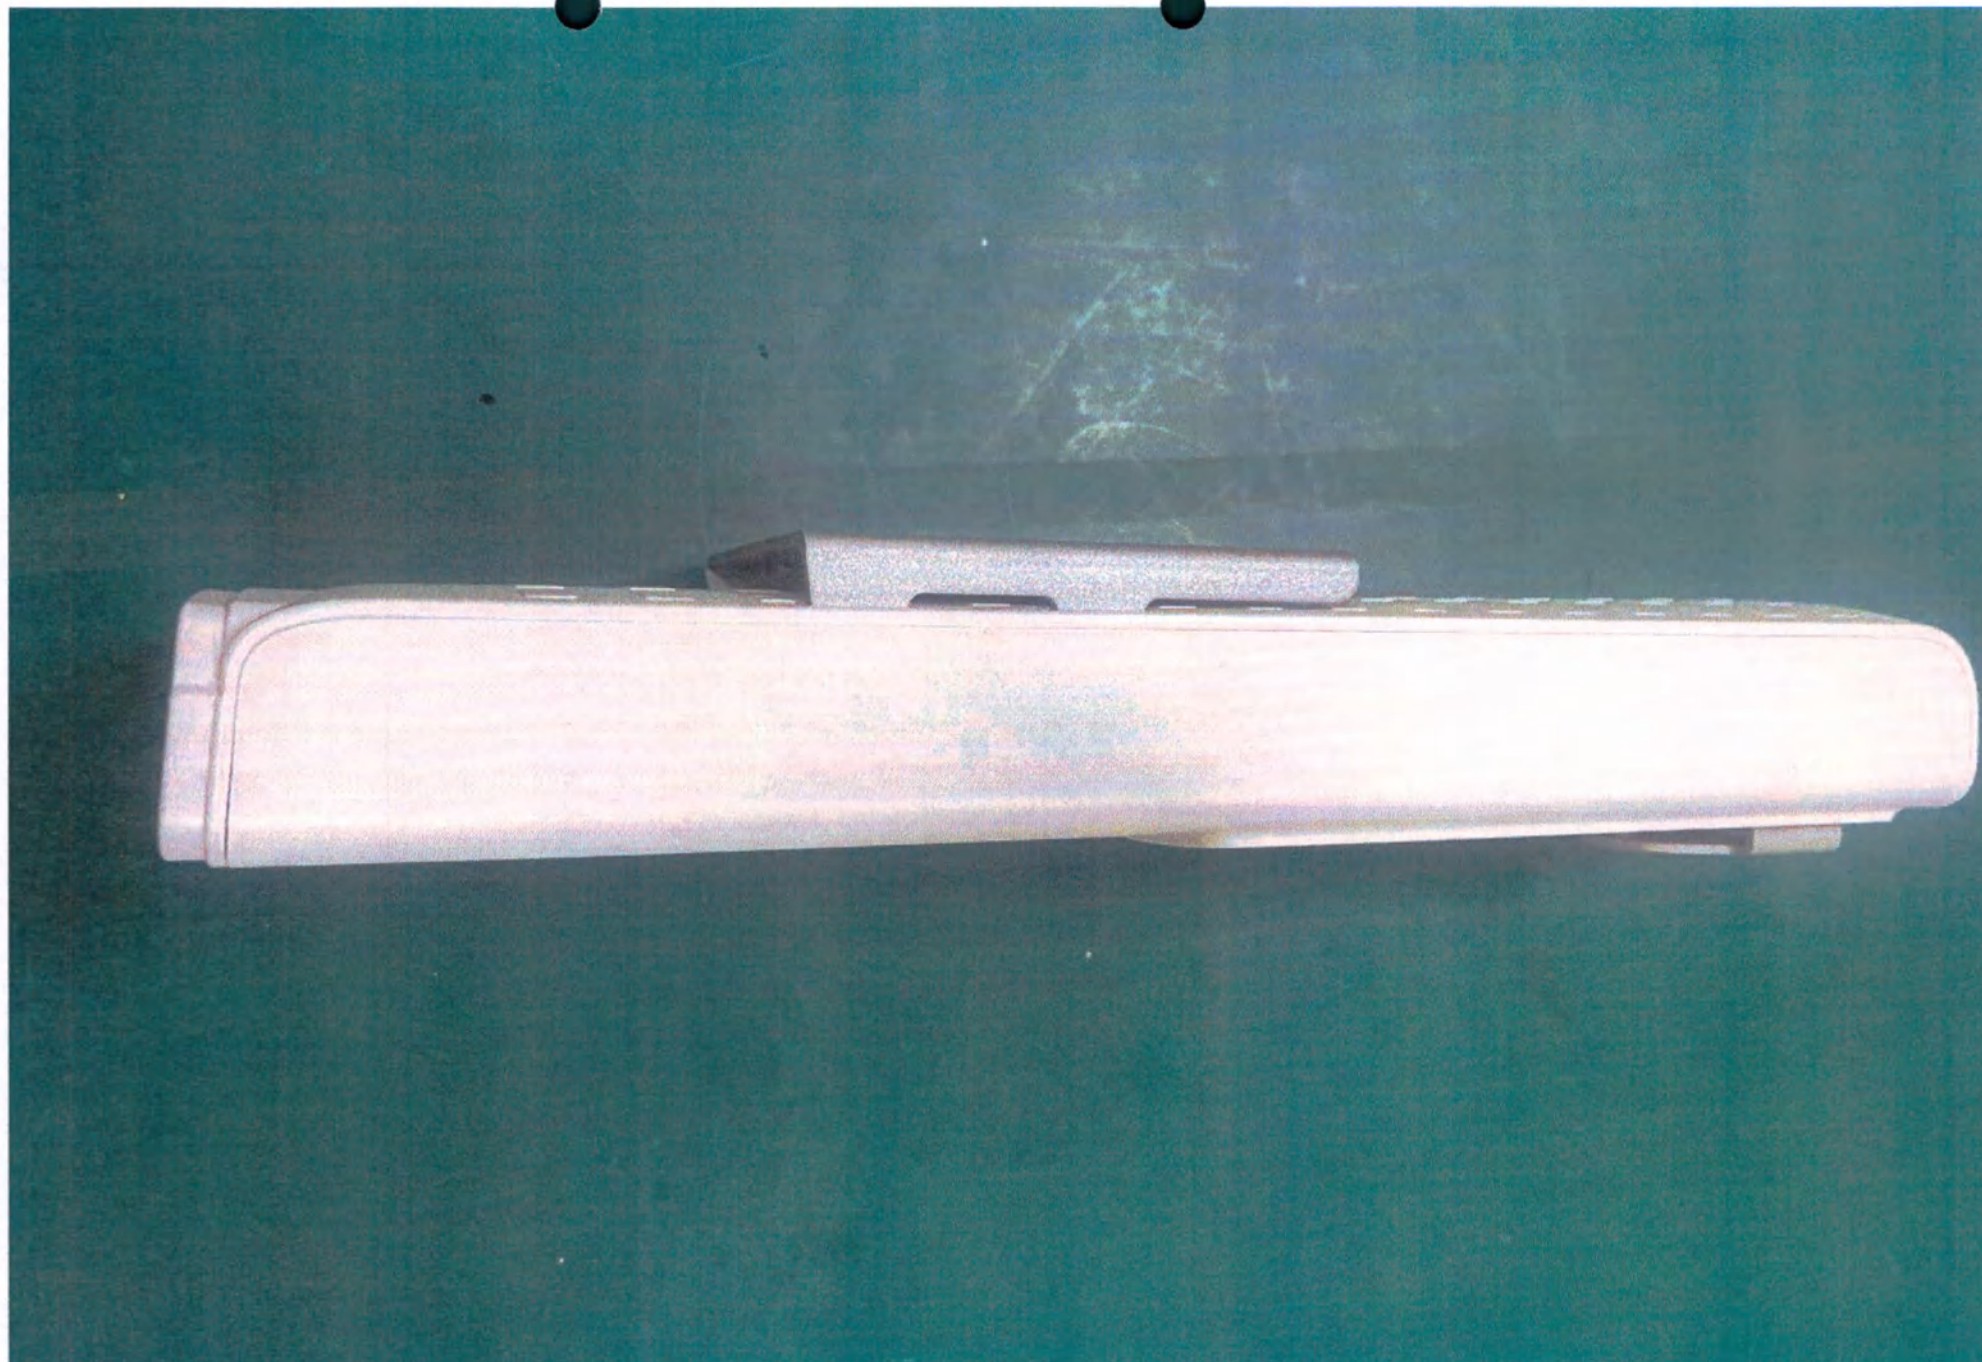

Шарнир крепежный для кронштейна монитора

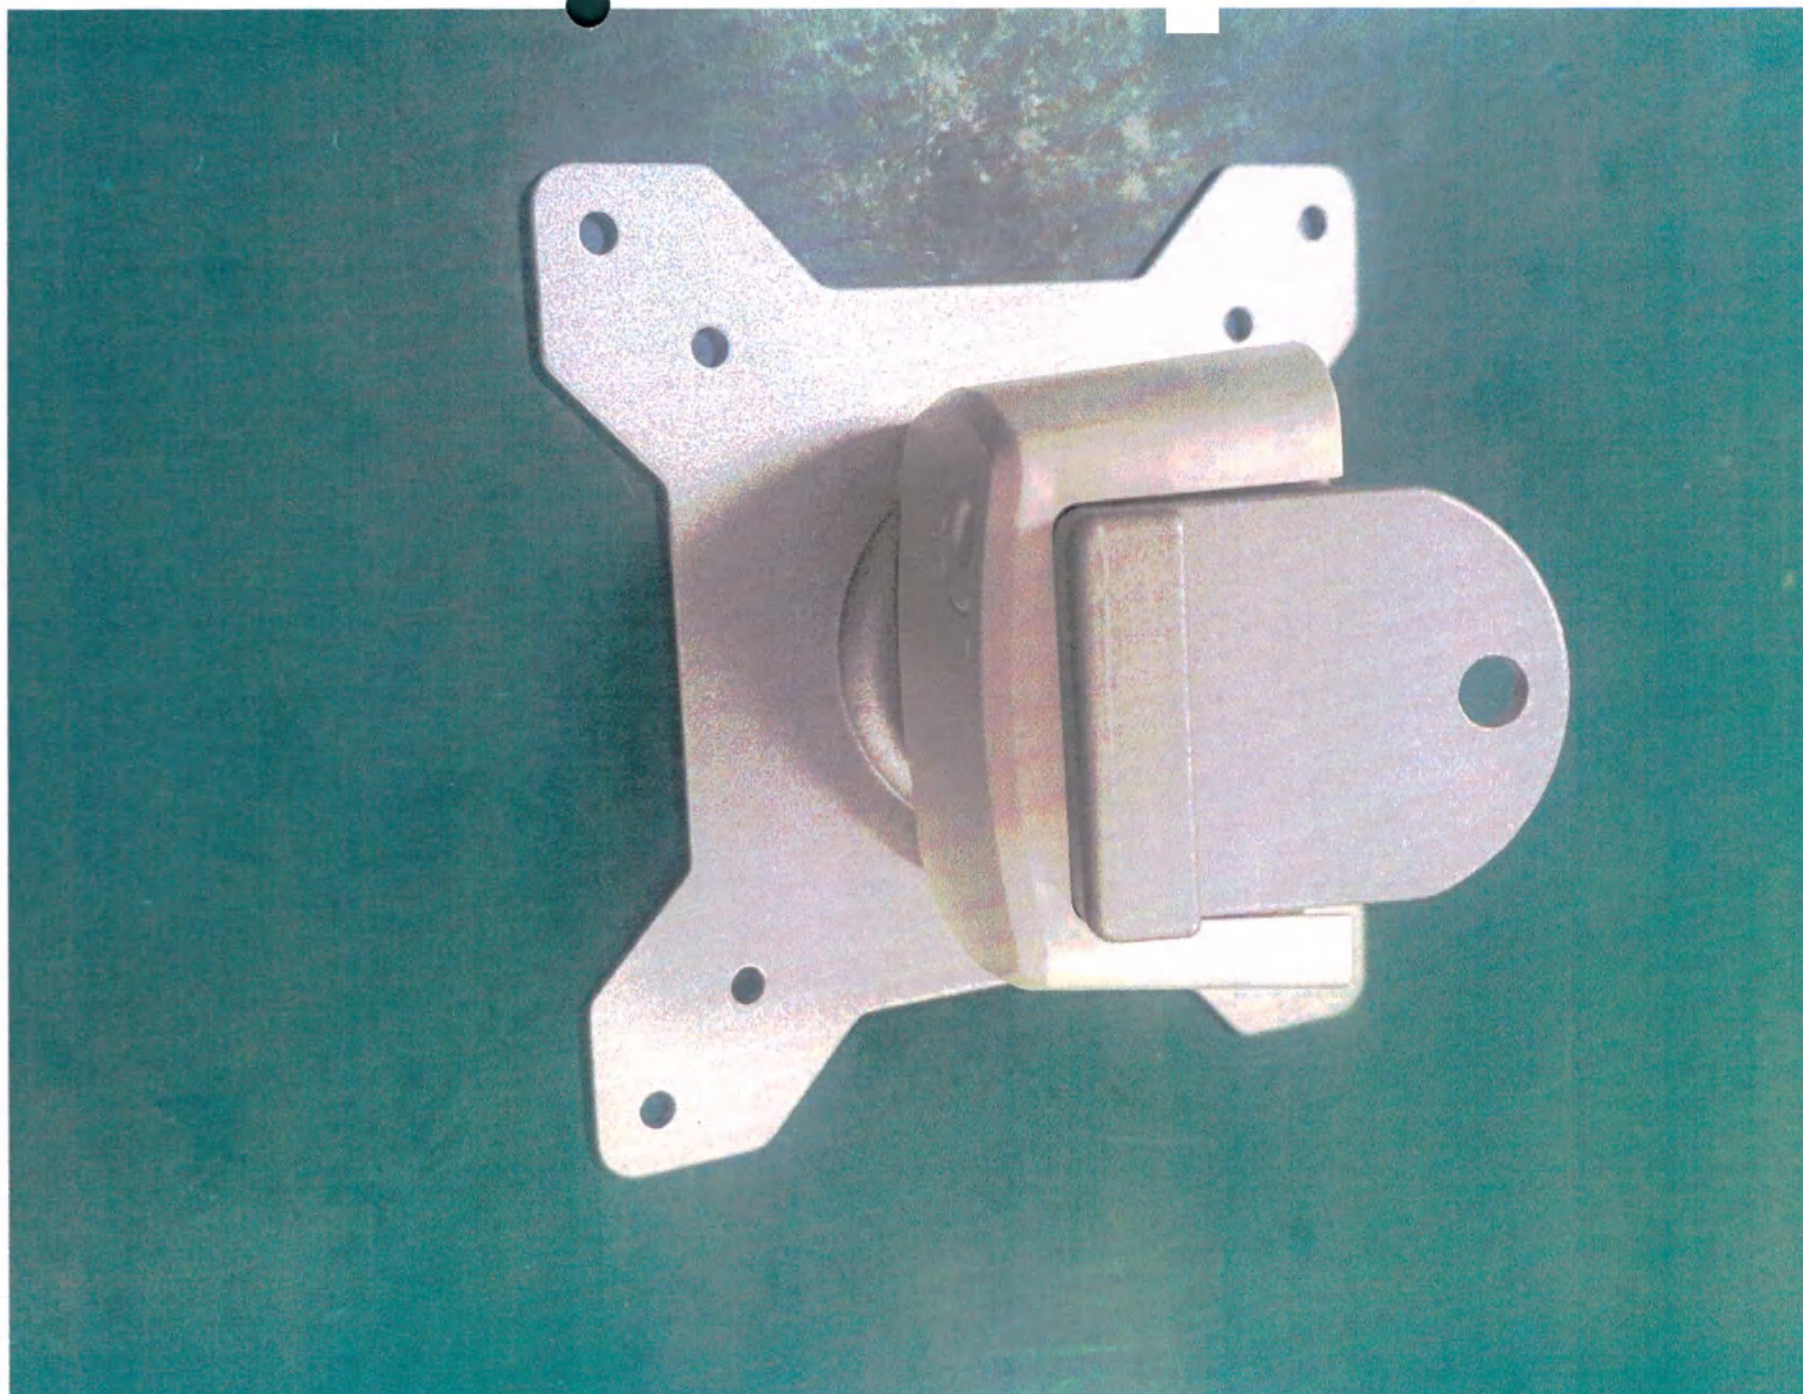


Кронштейн под монитор

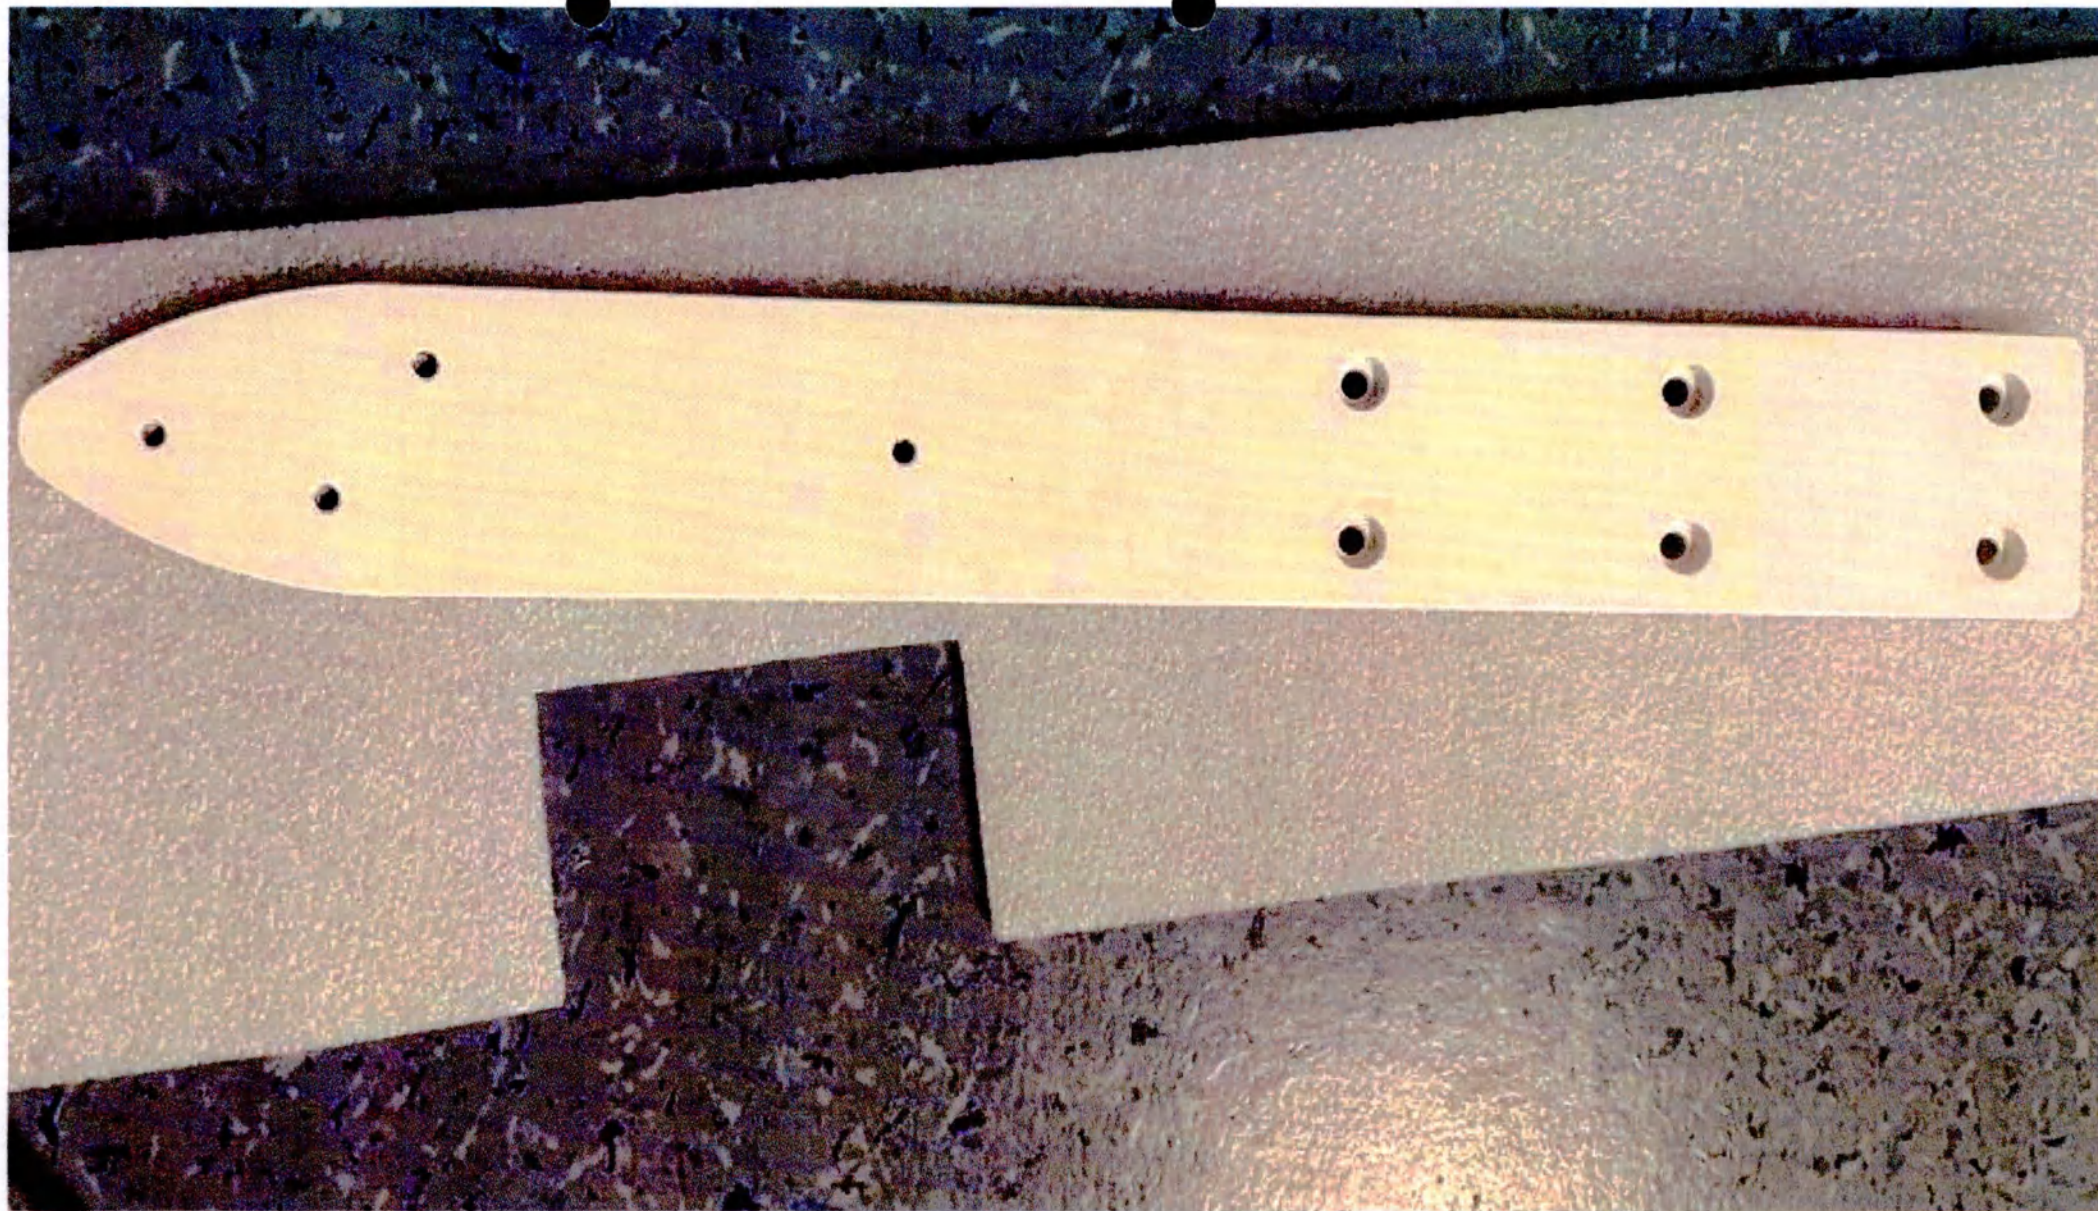

Пластина внешняя к держателю монитора



Винт М6х16

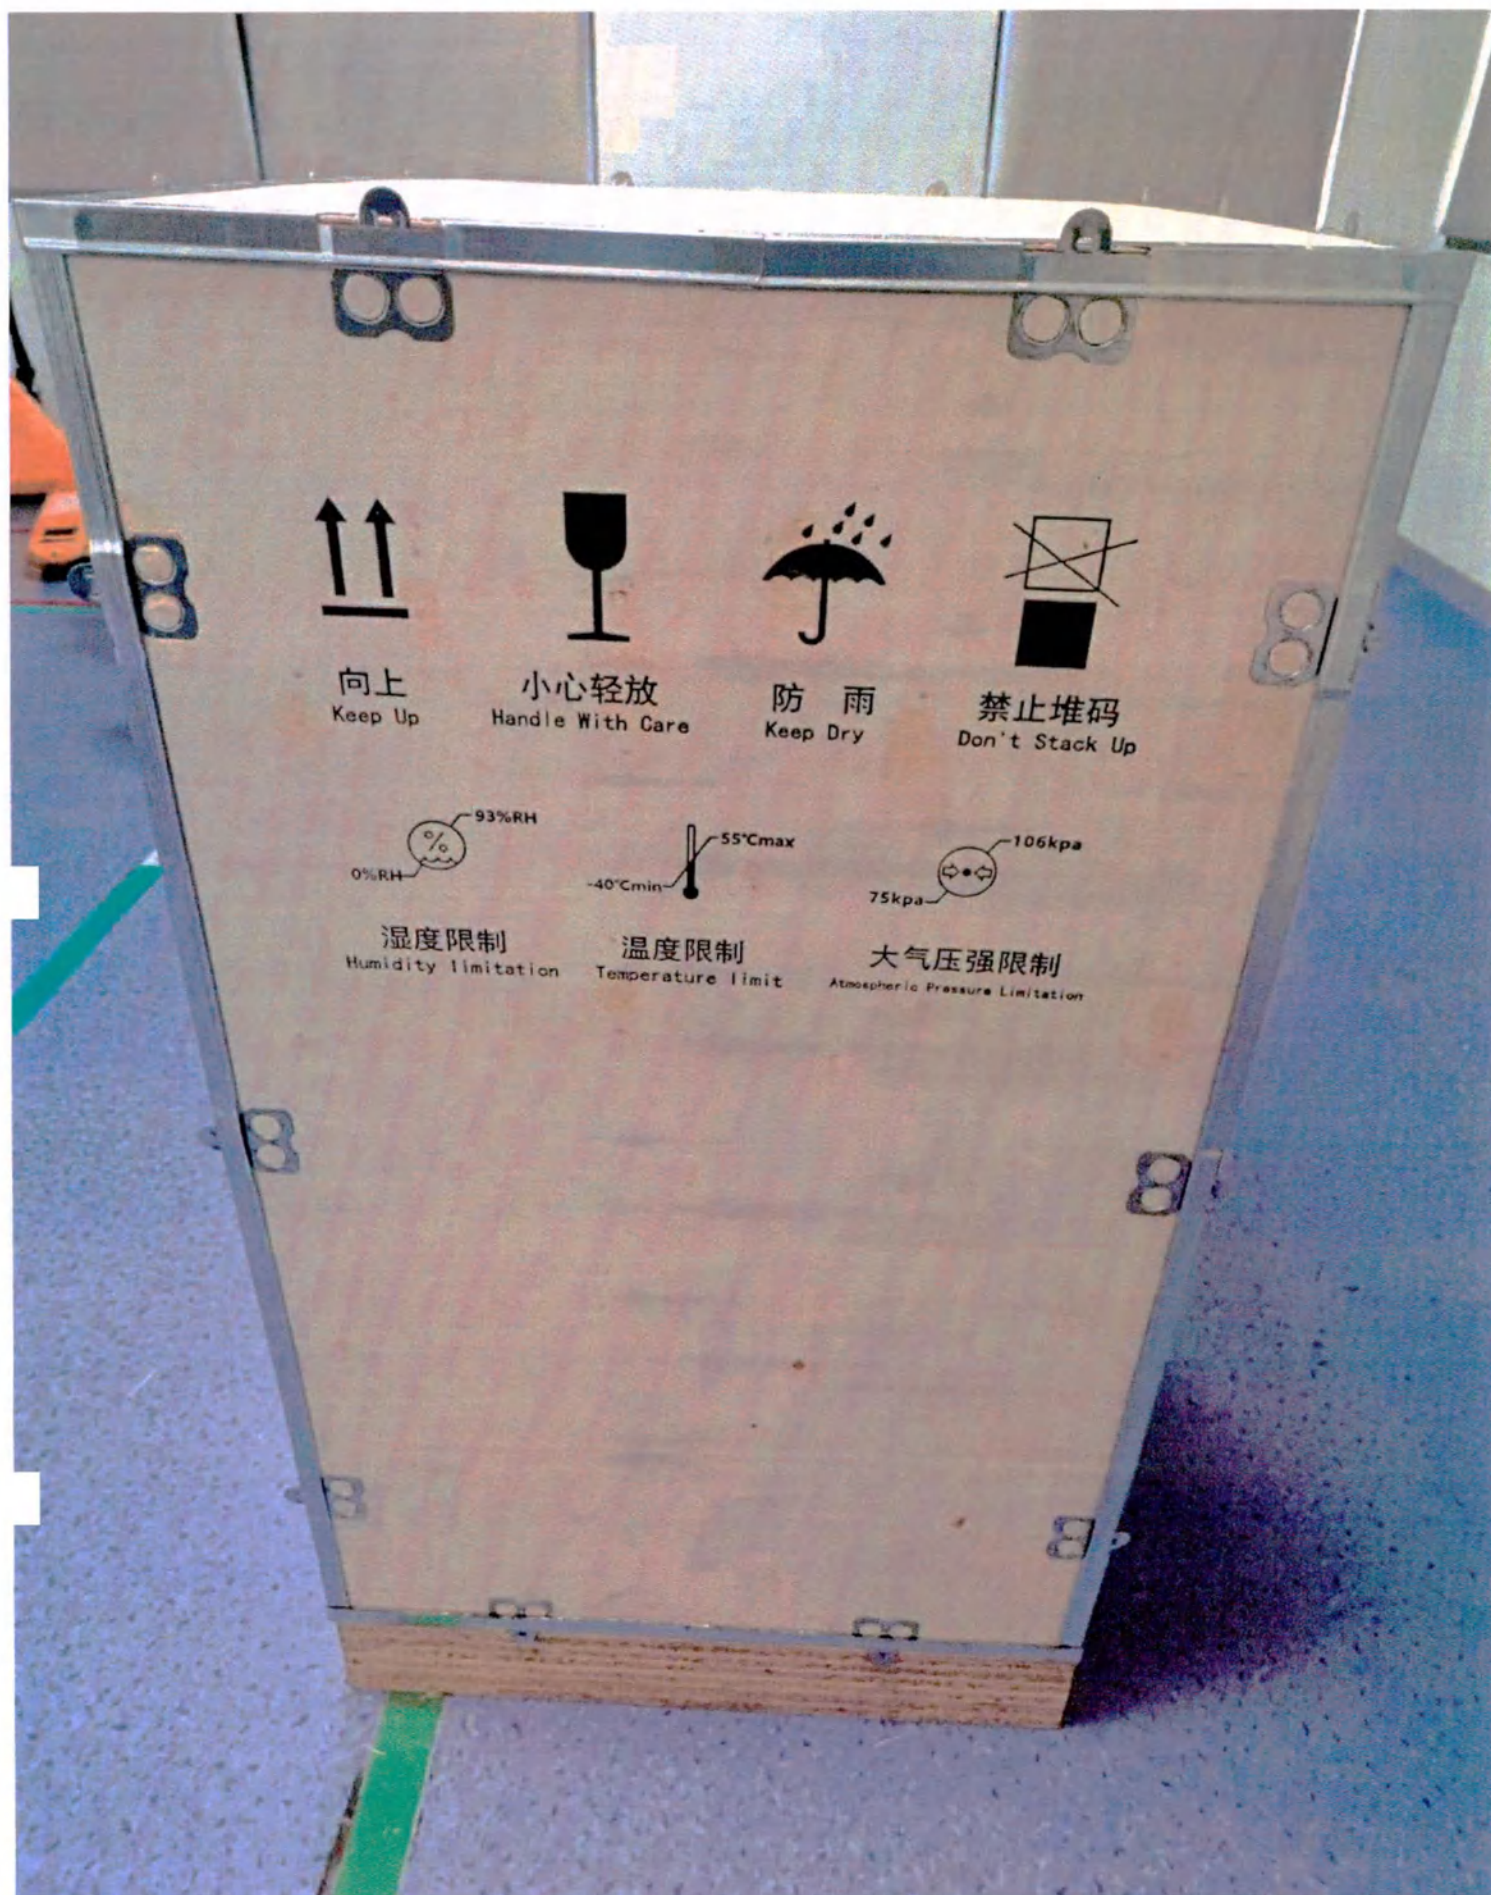

Транспортная упаковка деревянных ящиков состава изделия (Анализатор автоматический клеточного состава мочи МА-500)




Транспортная упаковка деревянных ящиков состава изделия (Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи СА-500)



Транспортная упаковка коробок из гофрированного картона состава изделия




Маркировка транспортной упаковки коробок из гофрированного картона состава изделия

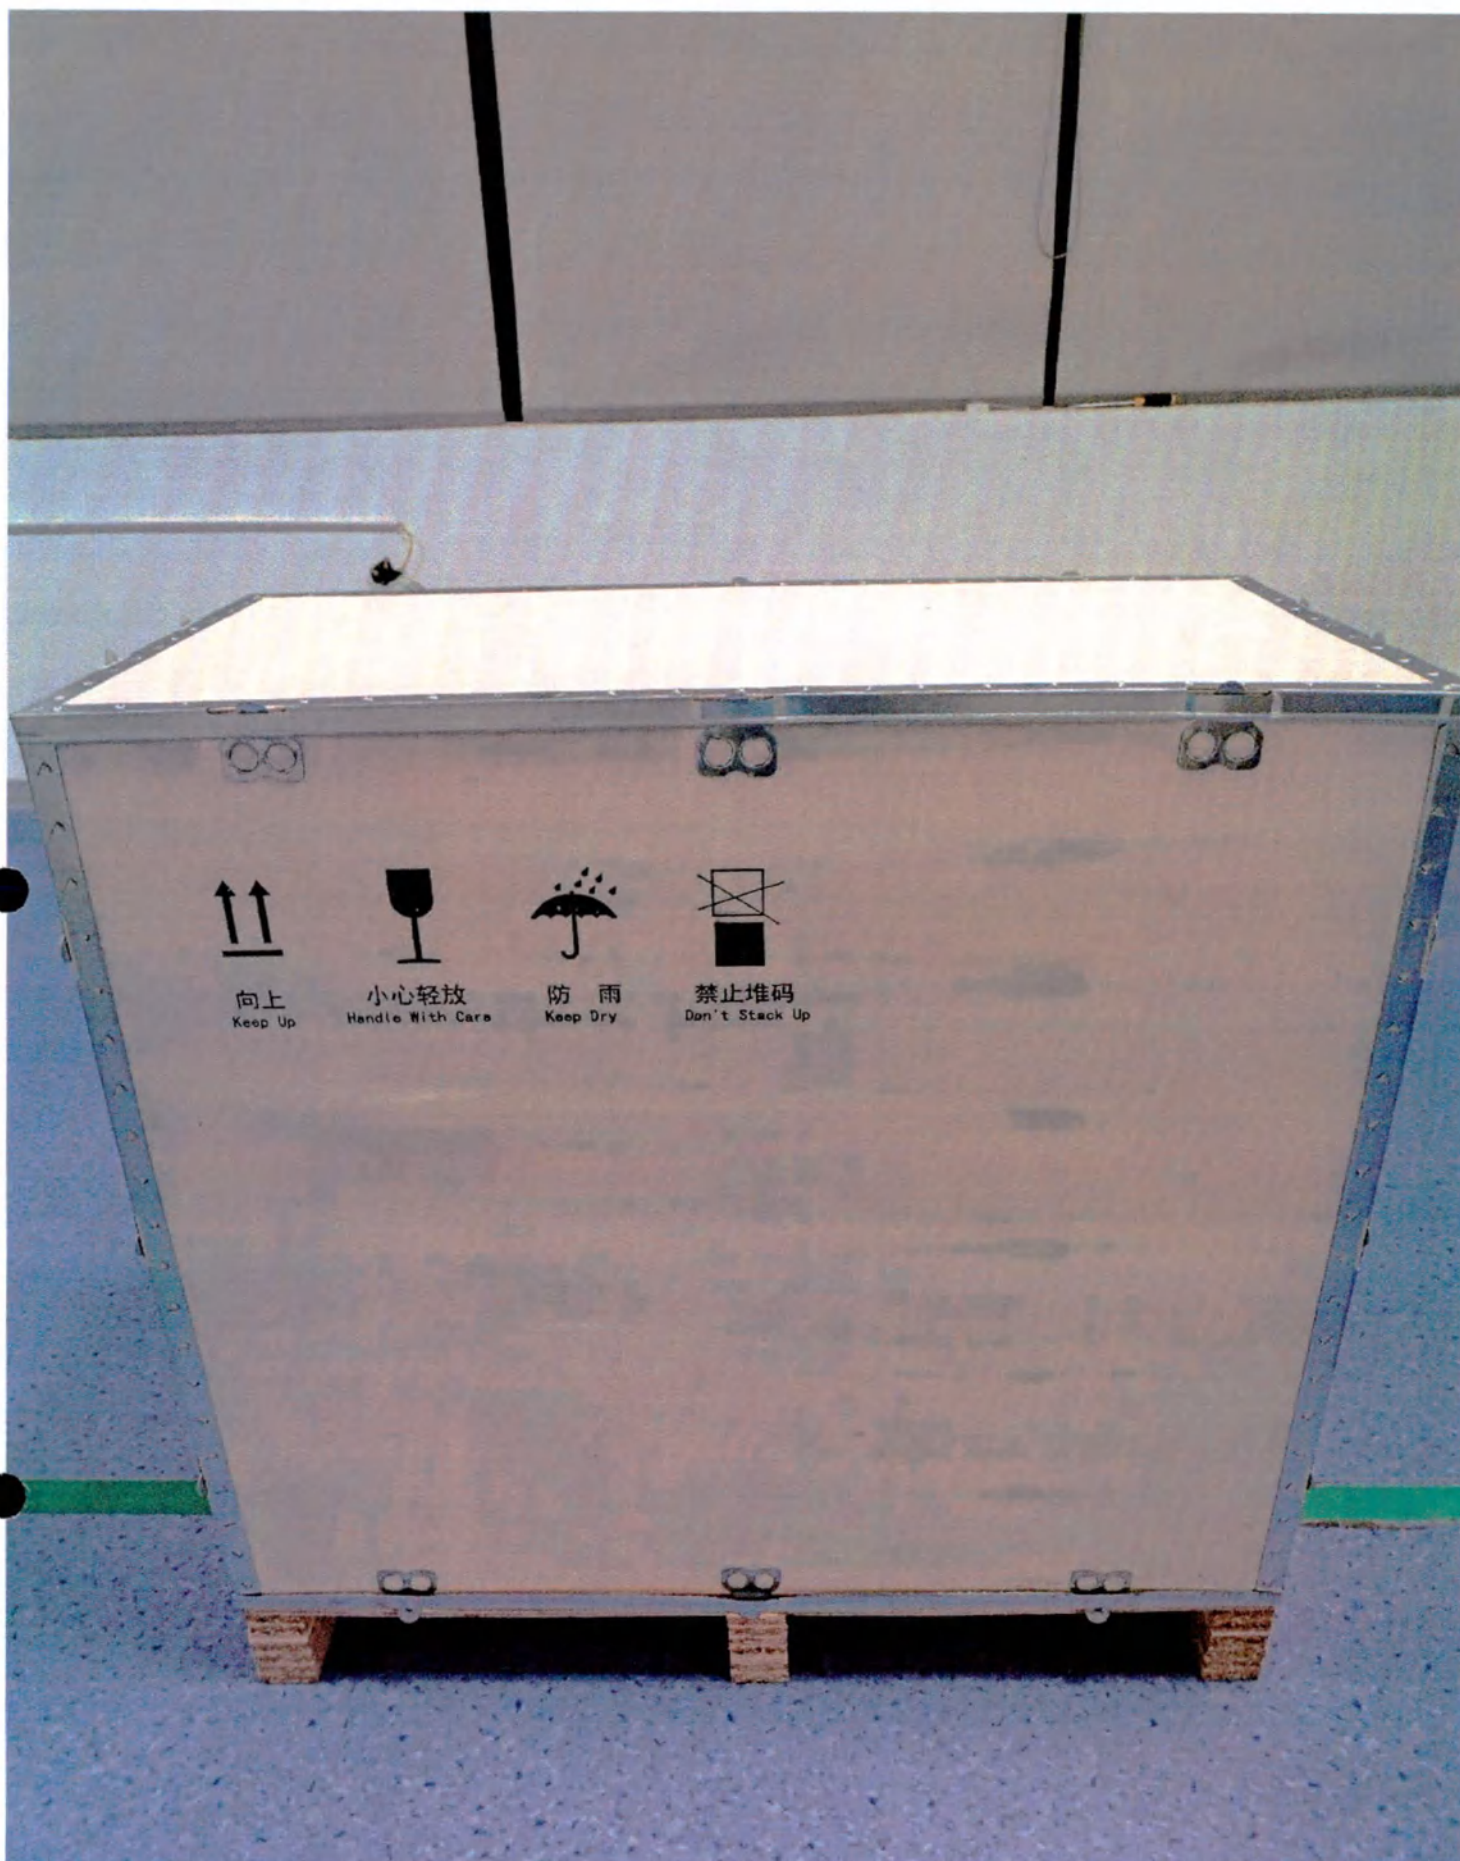

Транспортная упаковка деревянных ящиков принадлежностей (Стол анализатора СА-500, Стол анализатора МА-500, Стол модуля подачи образцов, Стол модуля приёмки образцов)



Транспортная упаковка деревянных ящиков принадлежностей (Модуль подачи образцов, Модуль приемки образцов)

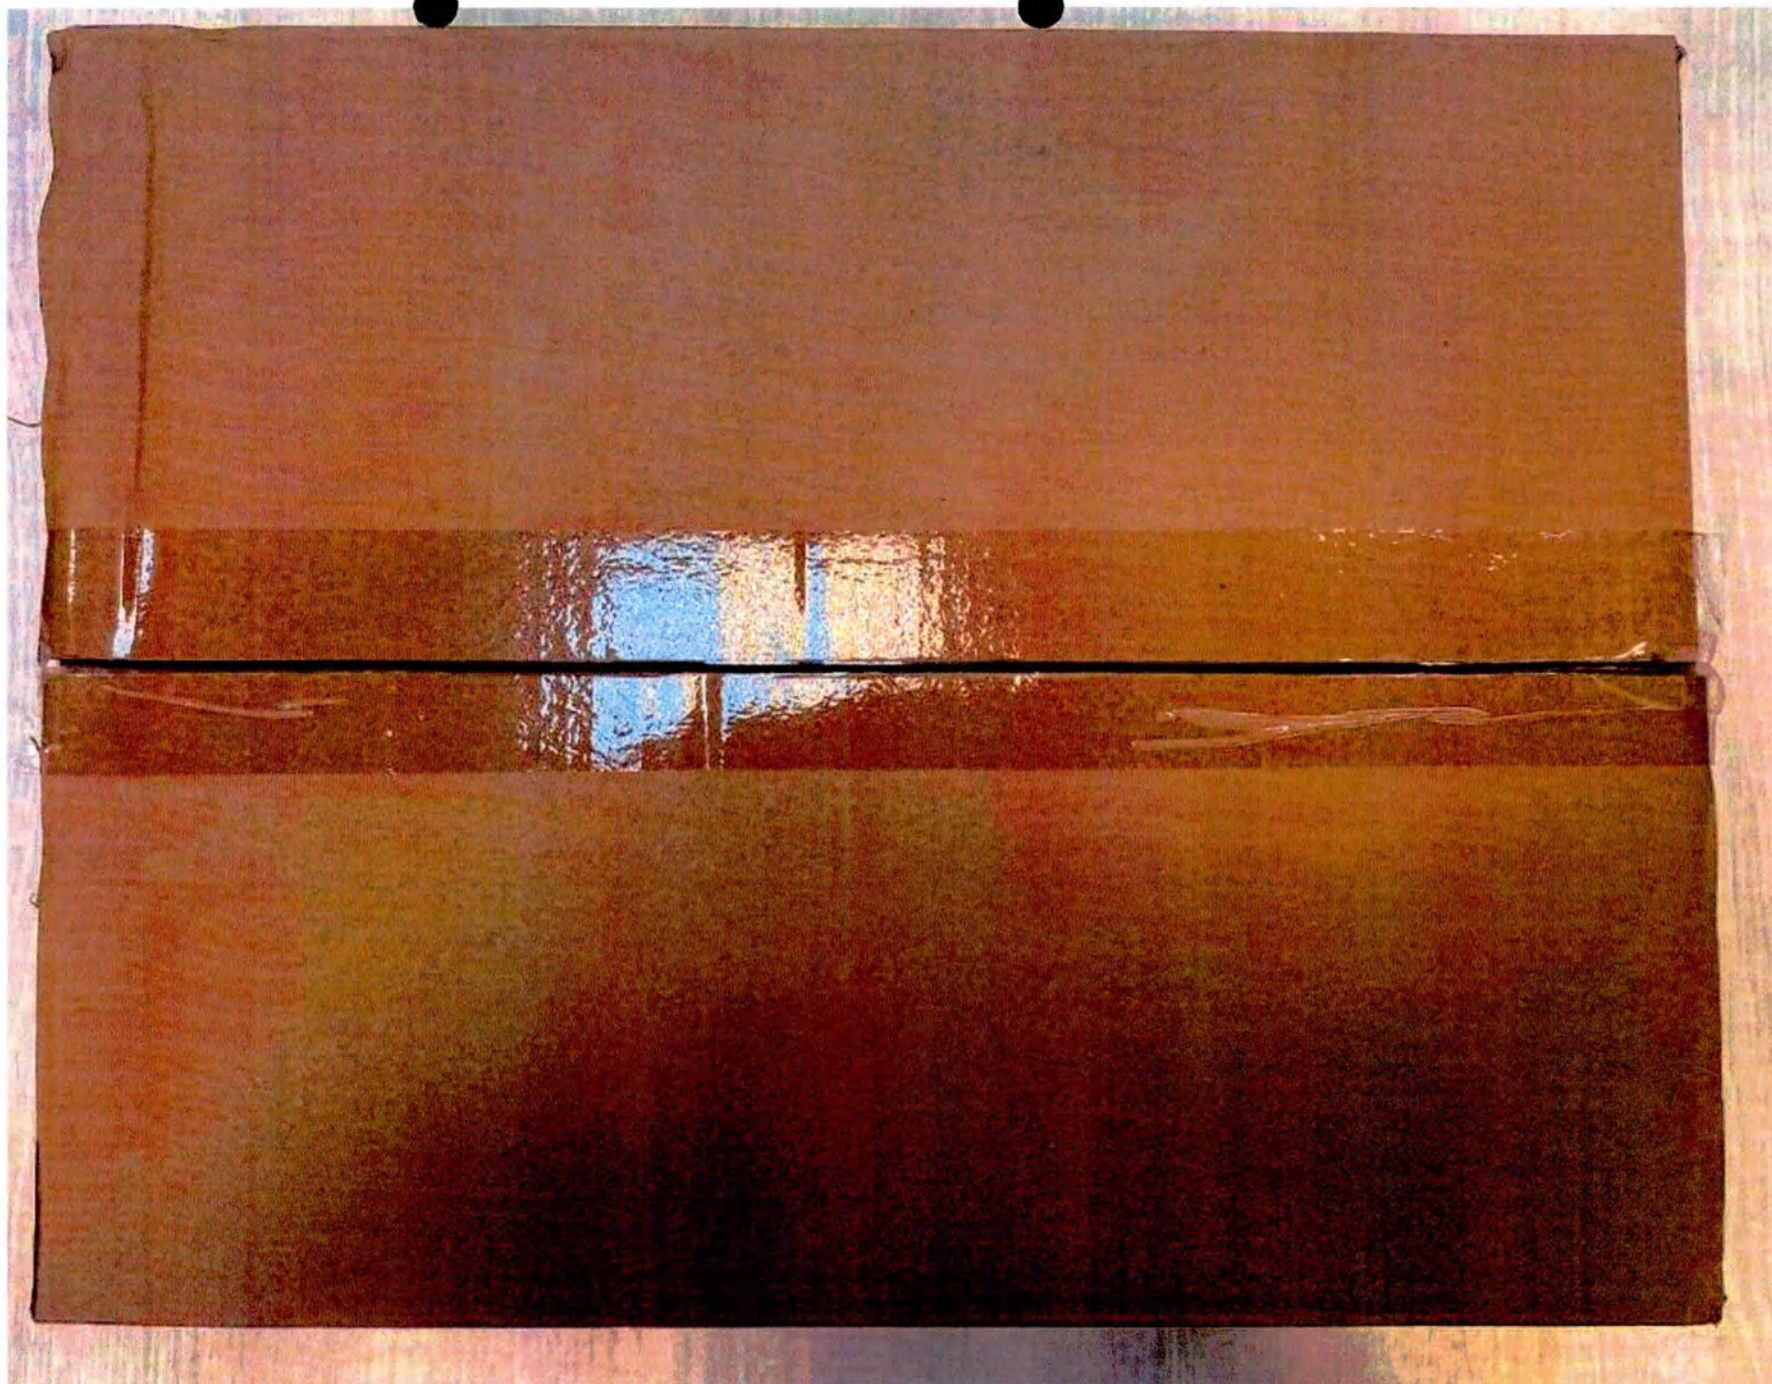


Транспортная упаковка коробок из гофрированного картона принадлежностей




防 雨
Keep Dry




小心轻放
Handle With Care



向上
Keep Up

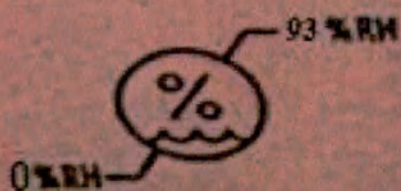

湿度限制
Humidity limitation

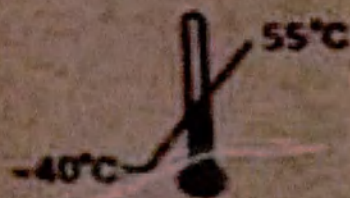

温度限制
Temperature limit



禁止堆放
No Stocking

Маркировка транспортная упаковки коробок из гофрированного картона принадлежностей

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Автоподатчик образцов анализатора мочи

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan

County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China

Маркировка автоподатчика образцов анализатора мочи

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Сканер штрих-кодов внешний, в составе:

- Сканер штрих-кодов – 1 шт.;
- Кабель для внешнего сканера штрих-кодов – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan

County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China

Маркировка сканера штрих-кодов внешнего

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Принадлежность

Модуль подачи образцов

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

**ЛАЗЕРНАЯ
АППАРАТУРА
КЛАССА 1**

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan

County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China

Маркировка модуля подачи образцов

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Принадлежность

Модуль приёма образцов

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

Род источника питания: переменный ток 100-240В, 50Гц/60Гц, 100 ВА

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan

County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China



Маркировка модуля приёма образцов

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Принадлежность

Стол анализатора CA-500

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan

County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China

Макет этикетки стола анализатора CA-500

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Принадлежность

Стол анализатора MA-500

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan

County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China

Макет этикетки стола анализатора MA-500

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Принадлежность

Стол модуля подачи образцов

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan

County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China

Макет этикетки стола модуля подачи образцов

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Принадлежность

Стол модуля приёмки образцов

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер: _____

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing Street, Jiashan

County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314100, P.R. China

Макет этикетки стола модуля приёмки образцов

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Состав:

Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи СА-500 – 1 шт.;

Автоподатчик образцов анализатора мочи – 1 шт.;

Ключ – 2 шт.

Транспортная упаковка ____ из ____

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4

Информацию на этикетке считать приоритетной



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко.,

Лтд.), Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park,

Luoxing Street, Jiashan County, Jiaxing City,

Zhejiang Province, 314100, P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXXXX

Остальные символы см. на оригинальной маркировке

Этикетка транспортной упаковки с анализатором СА-500

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Состав:

Анализатор автоматический клеточного состава мочи MA-500 – 1 шт.;

Автоподатчик образцов анализатора мочи – 1 шт.

Транспортная упаковка ____ из ____

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4

Информацию на этикетке считать приоритетной



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.),

Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing

Street, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province,

314100, P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXXXX

Остальные символы см. на оригинальной маркировке

Этикетка транспортной упаковки с анализатором MA-500

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Состав: см. упаковочный лист.

Транспортная упаковка ____ из ____

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4

Информацию на этикетке считать приоритетной



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.),

Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing

Street, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province,

314100, P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXXXX

Остальные символы см. на оригинальной маркировке

Этикетка транспортной упаковки коробок из гофрированного картона состава изделия

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Принадлежности

Состав:

Модуль подачи образцов – 1 шт.;

Модуль приёмки образцов – 1 шт.

Транспортная упаковка ____ из ____

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4

Информацию на этикетке считать приоритетной



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.),

Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing

Street, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province,

314100, P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXXXX

Остальные символы см. на оригинальной маркировке

Этикетка транспортной упаковки модуля подачи и модуля приёмки образцов

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Принадлежности

Состав: см. упаковочный лист.

Транспортная упаковка ____ из ____

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4

Информацию на этикетке считать приоритетной



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.),

Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing

Street, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province,


314100, P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXXXX



Остальные символы см. на оригинальной маркировке

Этикетка транспортной упаковки Стола анализатора СА-500, Стола анализатора МА-500, Стола модуля подачи образцов, стола модуля приёма образцов

Станция анализа мочи автоматическая Medicside CA500 + MA500 с принадлежностями

Принадлежности

Состав: см. упаковочный лист.

Транспортная упаковка ____ **из** ____

Регистрационное удостоверение № _____ **от** _____

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Пасифик Медикал Групп», адрес: 119415 г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, эт/пом/ком 6/1/4

Информацию на этикетке считать приоритетной



Zhejiang Medicside Medical Technology Co., Ltd.

(Чжэцзян Медиксайд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.),

Китай

2nd Floor, No. 66, Guigu 3rd Road, Guigu Park, Luoxing

Street, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province,

314100, P.R. China



XX.XX.XXXX



XXXXXXXXXX

Остальные символы см. на оригинальной маркировке

Этикетка транспортной упаковки коробок из гофрированного картона принадлежностей

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 112 листа (-ов)

Генеральный директор Ю.А. Кийко

