

Фотографические изображения медицинского изделия

Комплекс ангиографический рентгеновский

АКР-«МАКСИМА»

по ТУ 9442-031-1150760-2009



Фотография 1 – Комплекс ангиографический рентгеновский АКР-«Максима», АО «НИПК «Электрон». Вариант внешнего вида комплекса по спецификации АКР-00-0000 в комплектации со Штативом с поворотным кронштейном серии В и Столом для катетеризации серии С, Omega Medical Imaging

ЭЛЕКТРОН

Комплекс
ангиографический
рентгеновский
АКР-"МАКСИМА"
ГОСТ Р МЭК 60601-2-43

ОБОЗНАЧЕНИЕ МИ

AKR-00-0000-07:0

ТУ

9442-031-11150760-2009

Серийный номер МИ

GP0006102

Дата изготовления

2023-12


Изготовитель

АО "НИПК "Электрон"

NP-23-0510



3N~380 В, 50 Гц, 100 кВА

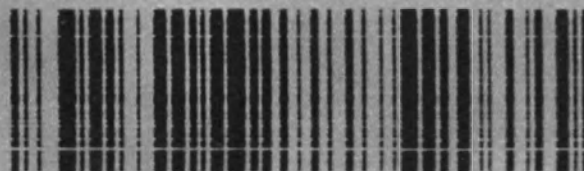

Фотография 2 – АКР-«МАКСИМА». Образец внешнего вида варианта маркировки

ЭЛЕКТРОН

Штатив
AKR-00-1000-01

Серийный номер
Дата изготовления

NN0005113
2023-12

Обозначение МИ

AKR-00-0000-07:0:220618

Серийный номер МИ

GP0006102

Изготовитель

АО «НИПК «Электрон»


NF-20-0200-01



~220 В, 50 Гц, 16 А



Фотография 3 – Штатив по спецификации AKR-00-1000. АО «НИПК «Электрон». Образец внешнего вида варианта маркировки

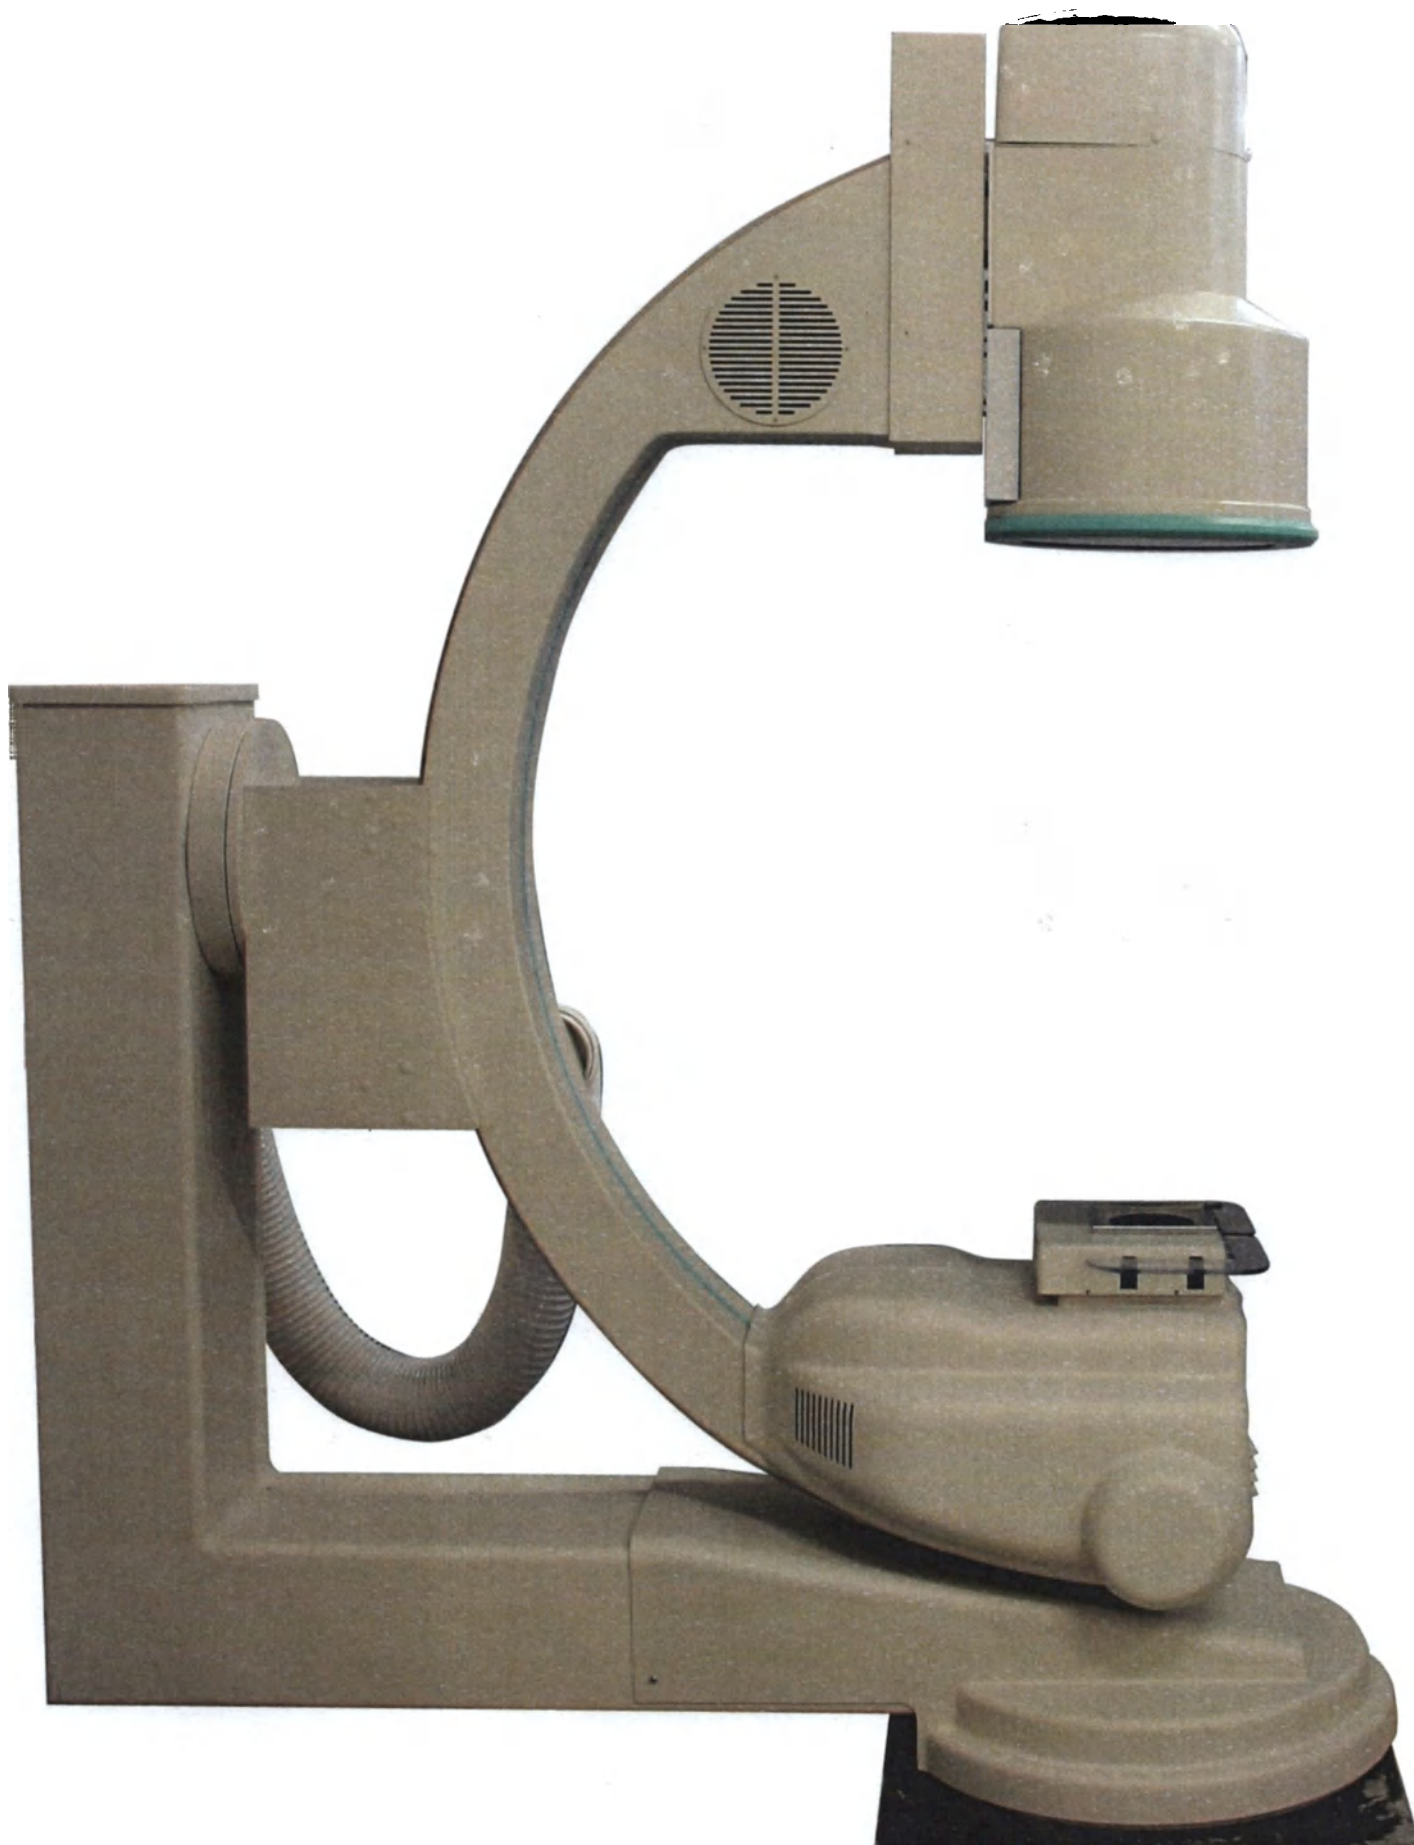

Фотография 4 – Штатив (вариант внешнего вида) по спецификации АКР-00-1000 АО «НИПК «Электрон» в комплектации: Штатив с поворотным кронштейном серии В, Omega Medical Imaging и Усилитель рентгеновского изображения УРИ по ТУ 9442-027-11150760-2007, АО «НИПК «Электрон», РУ № ФСР 2008/02453



Фотография 5 – Штатив (вариант внешнего вида) по спецификации АКР-00-1000 АО «НИПК «Электрон» в комплектации: Штатив с поворотным кронштейном серии В, Omega Medical Imaging и Система визуализации рентгеновских изображений СВР по ТУ 9442-039-11150760-2015, АО «НИПК «Электрон», РУ № РЗН 2016/5112

Omega Medical Imaging, LLC.

675 Hickman Circle, Sanford, FL 32771

Made in the U.S.A

Configuration: Stand with Rotary Holder
B-200/C-300

Series: B

Serial Number: 121-16

Power: 208/220/240 ~ 15A ~ 50/60 Hz



TYPE B
IEC60601-1

Complies with 21 CFR
Subchapter J
at the date of manufacture.

IEC60601-1




UL60601-1
CSA C22.2
No. 601.1


Date of Manufacture: August 2016

Label P/N 0310-0041 Rev 2


Фотография 6 – Штатив с поворотным кронштейном серии B, Omega Medical Imaging. Образец внешнего вида варианта маркировки

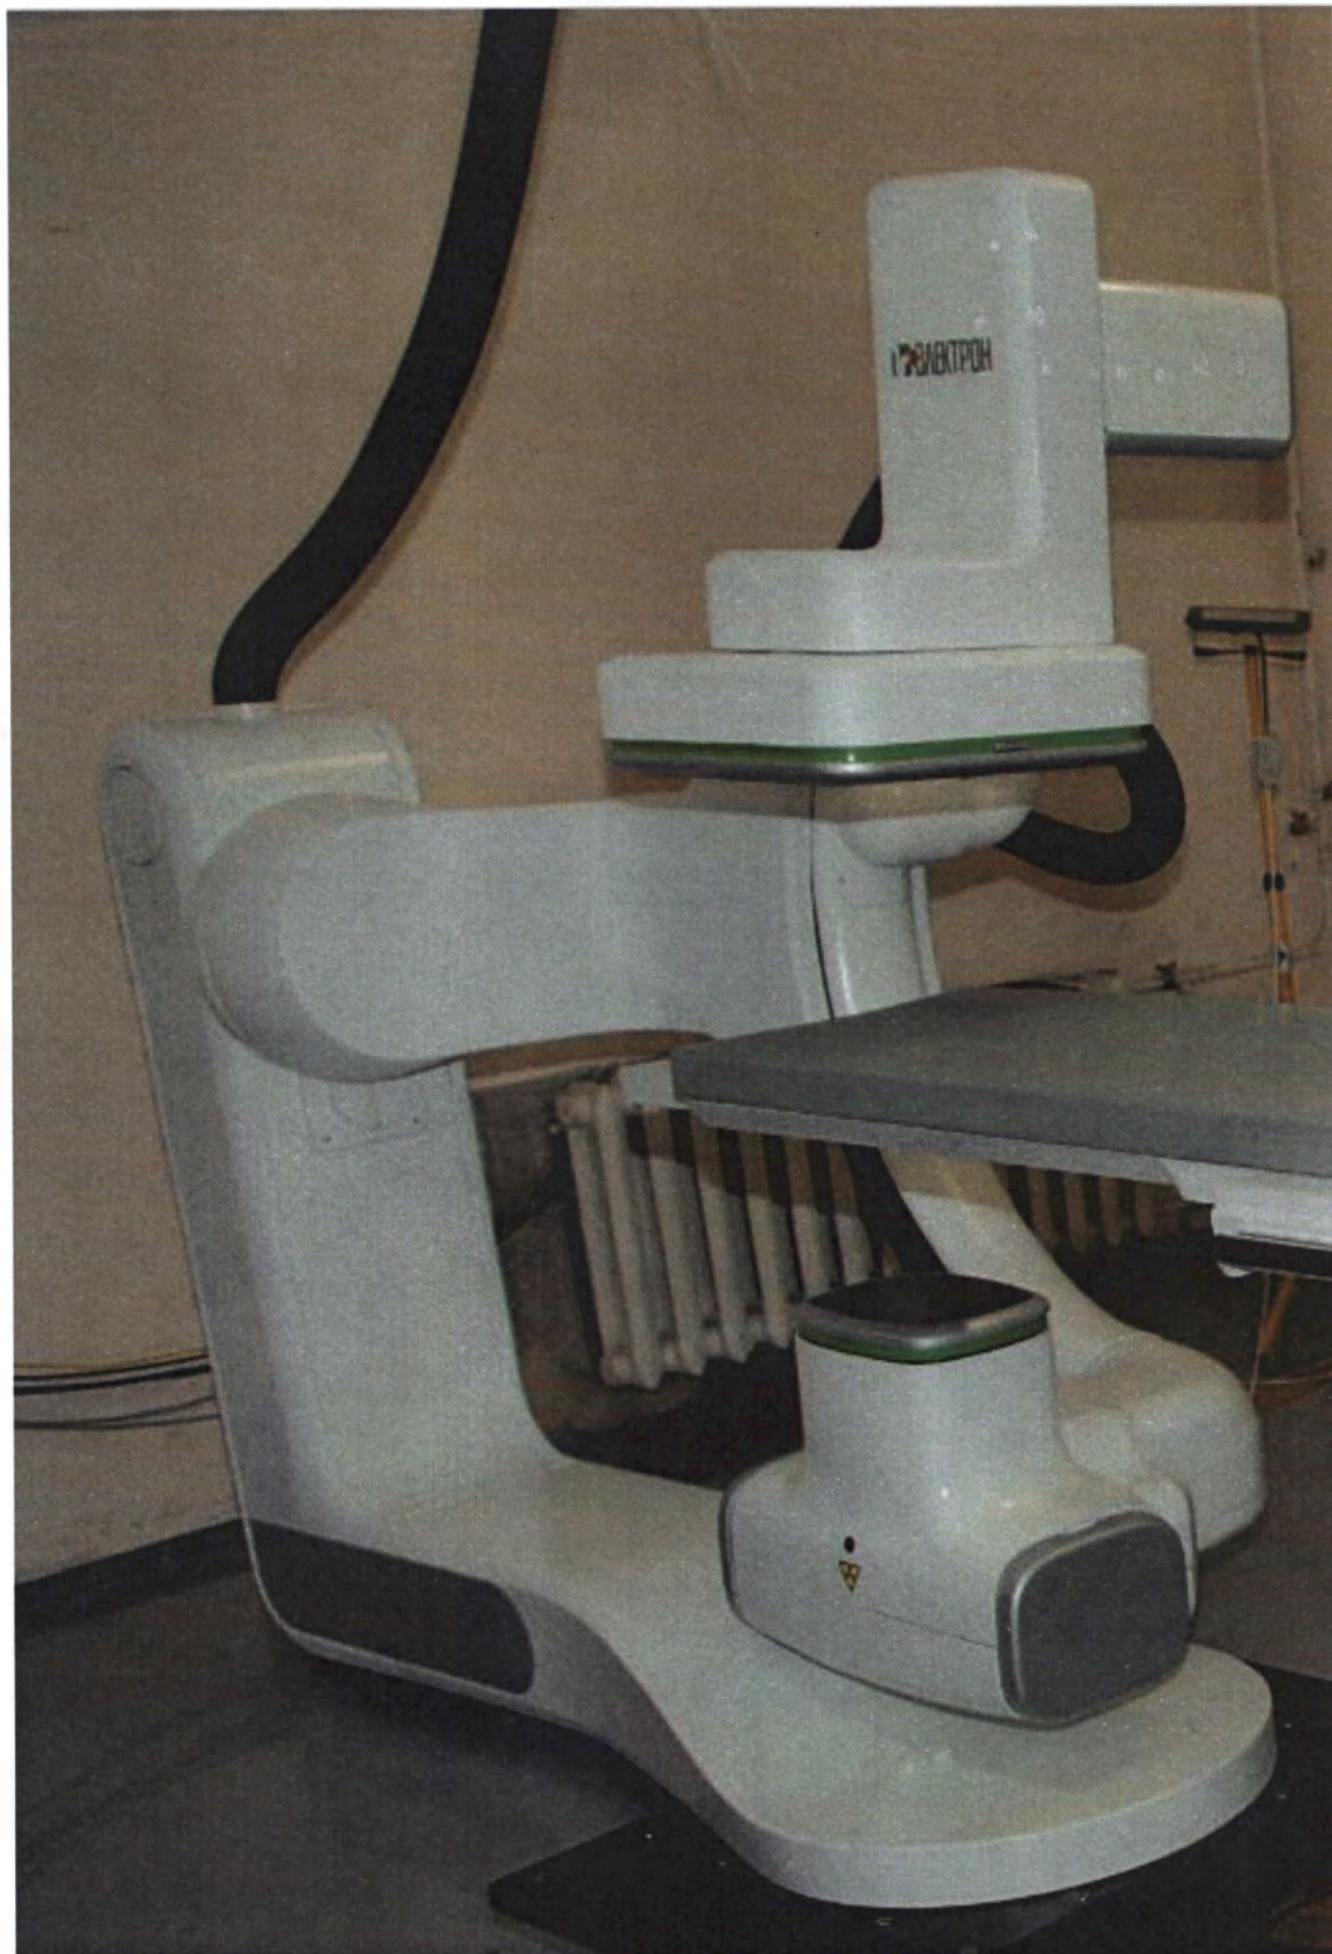

Фотография 7 – Штатив (вариант внешнего вида) по спецификации АКР-00-1000 АО «НИПК «Электрон» в комплектации: Штатив ангиографический С-дуга серии VCV (напольный), Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd

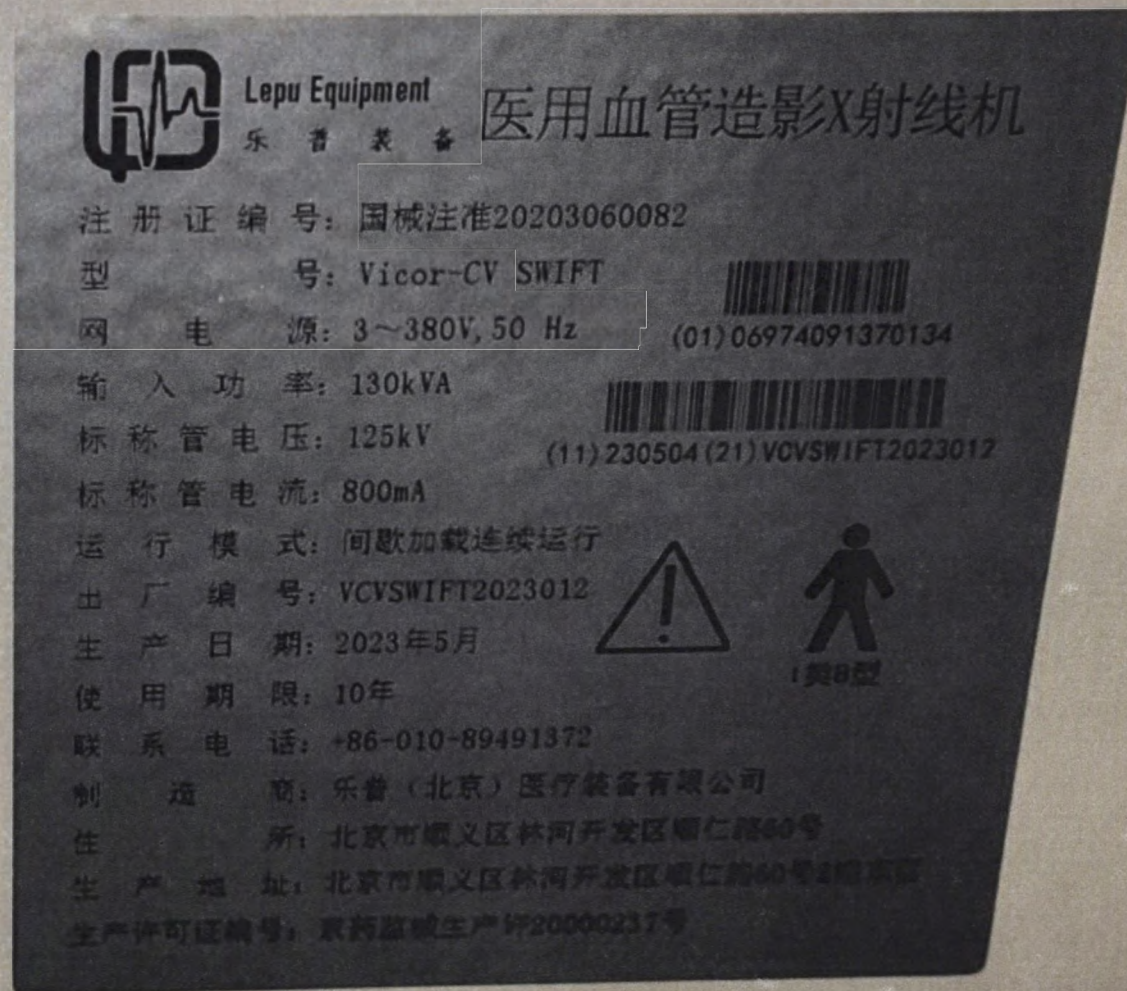

Фотография 8 – Штатив ангиографический С-дуга серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd., SWIFT LDCS10 012. Образец внешнего вида варианта маркировки

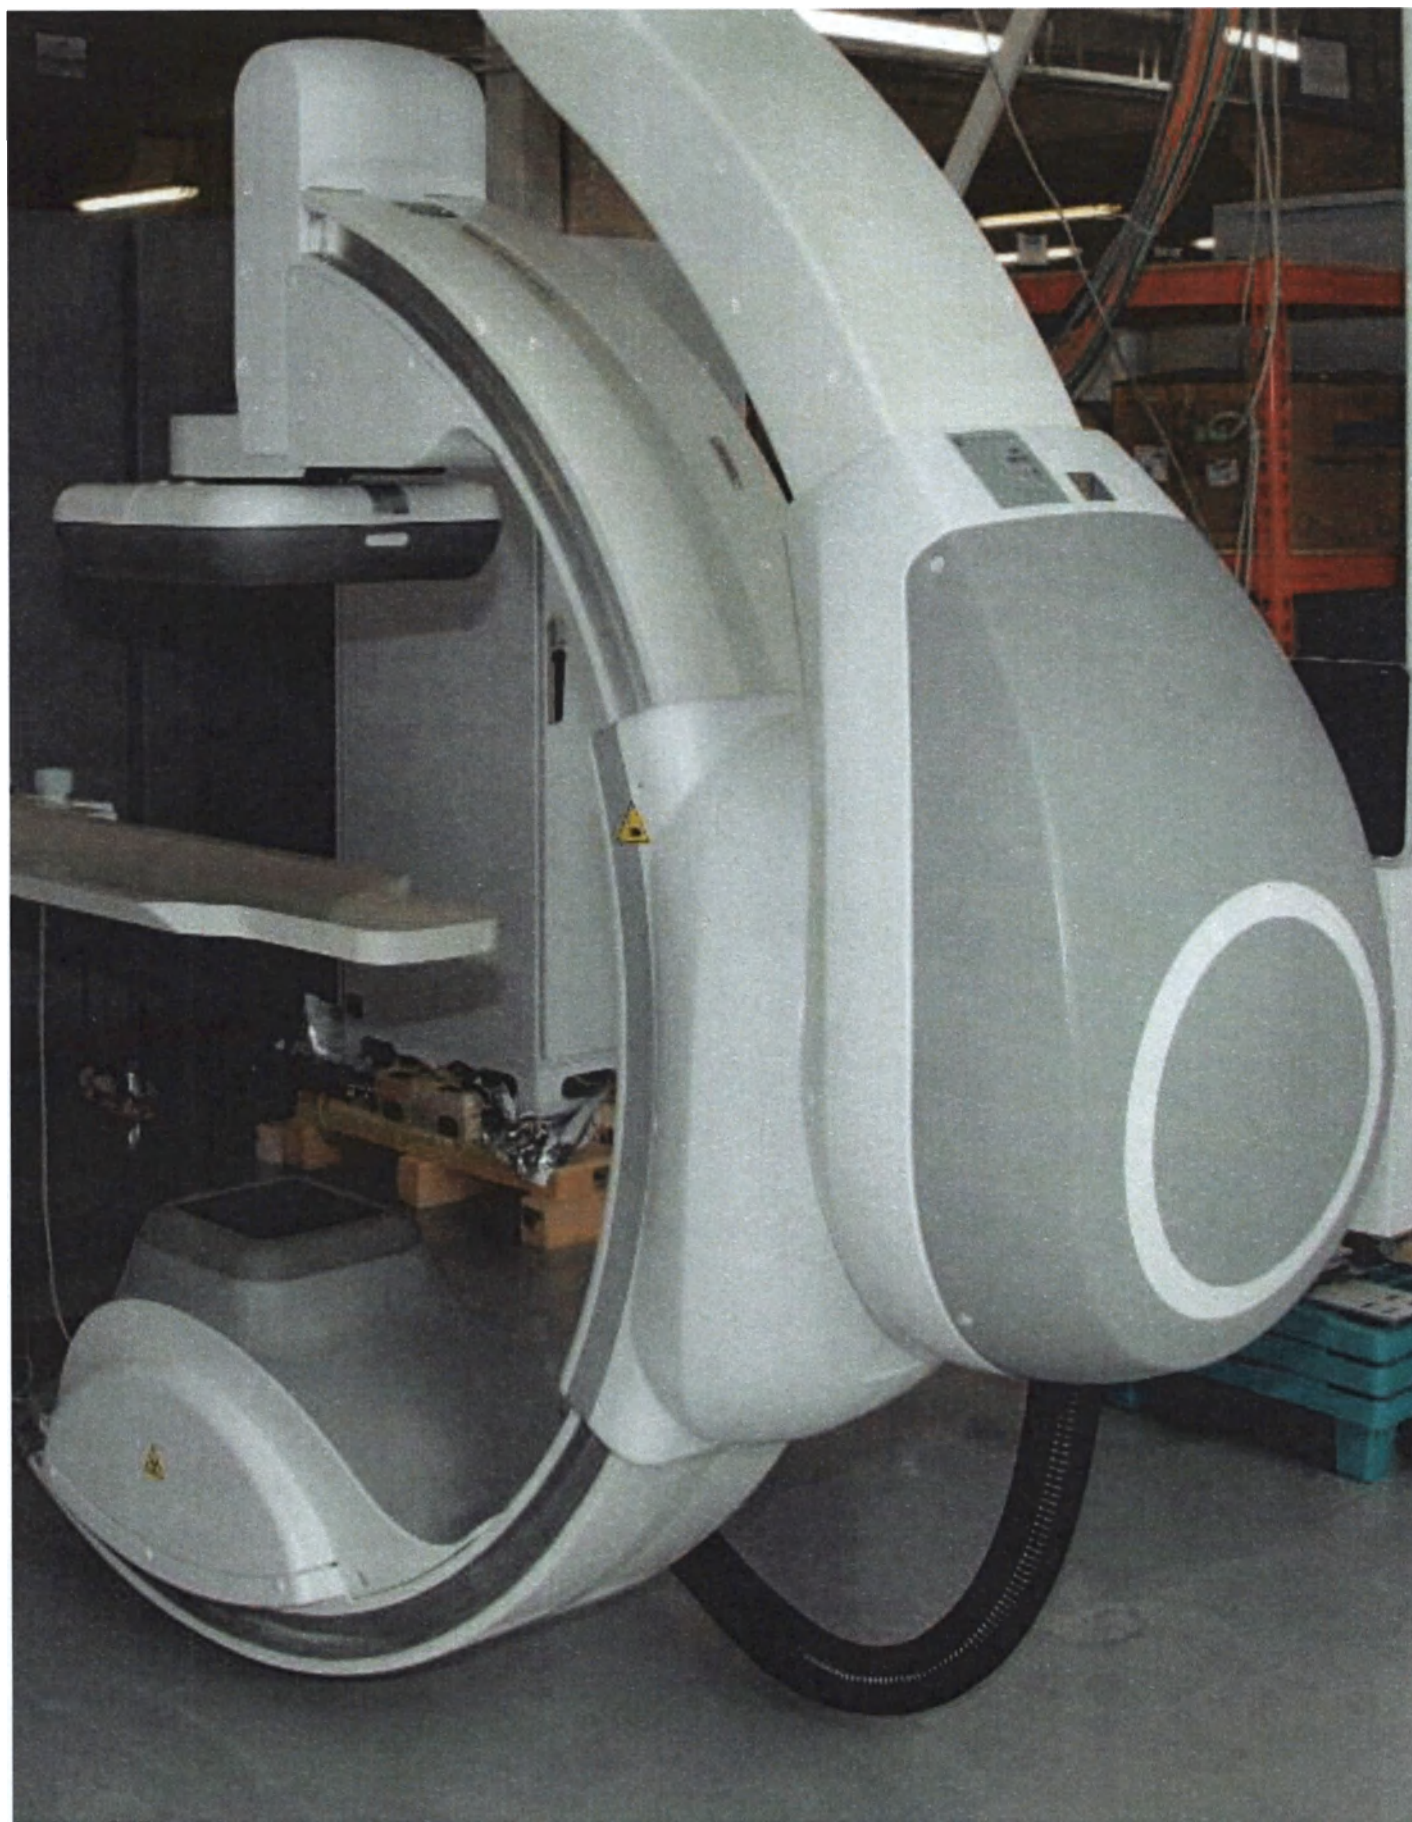

Фотография 9 – Штатив (вариант внешнего вида) по спецификации АКР-00-1000 АО «НИПК «Электрон» в комплектации: Штатив ангиографический С-дуга серии VCV (потолочный), Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd

 Lepu Equipment 乐普装备 **医用血管造影X射线机**

注册证编号: 国械注准20203060083

型号: Vicor-CV Robin C

网 电 源: 3~380V, 50 Hz

输入功率: 150kVA

标称管电压: 150kV

标称管电流: 1000mA

运行模式: 连续运行

出厂编号: VCVRobinC2022007

生产日期: 2023年2月

使用期限: 10年

联系电话: +86-010-89491372

制 造 商: 乐普(北京)医疗装备有限公司

住 所: 北京市顺义区林河开发区顺仁路60号

生 产 地 址: 北京市顺义区林河开发区顺仁路60号2幢东区

生产许可证编号: 京药监械生产许20000237号

(01)06974091370158

(11)230227(21)VCVRob nC2022007

  I类B型

 Lepu Equipment 乐普装备

部件名称: 悬吊C臂机架

型 号: VCV-11

部 件 号: Robin C XDC11 007

QC

检验员: 05

其他内容详见
说明书

Фотография 10 – Штатив ангиографический С-дуга серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 11 – Шкаф управления штативом серии VCV, Lery Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Вариант внешнего вида



Lepu Equipment

Lepu Medical
Equipment(Beijing)Co.Ltd

Distribution cabinet
serie VCV-30/S

No.60, Shunren Road, Linhe Development Zone. Shunyi
District, Beijing, China



Lepu Equipment

乐 普 装 备

部件名称: 配电机柜

型 号: VCV-30/S

部 件 号: SWIFT PDJS30 012


检验员: 05



Фотография 12 – Шкаф управления штативом серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 13 – Выключатель педальный серии МКР, Leri Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Вариант внешнего вида

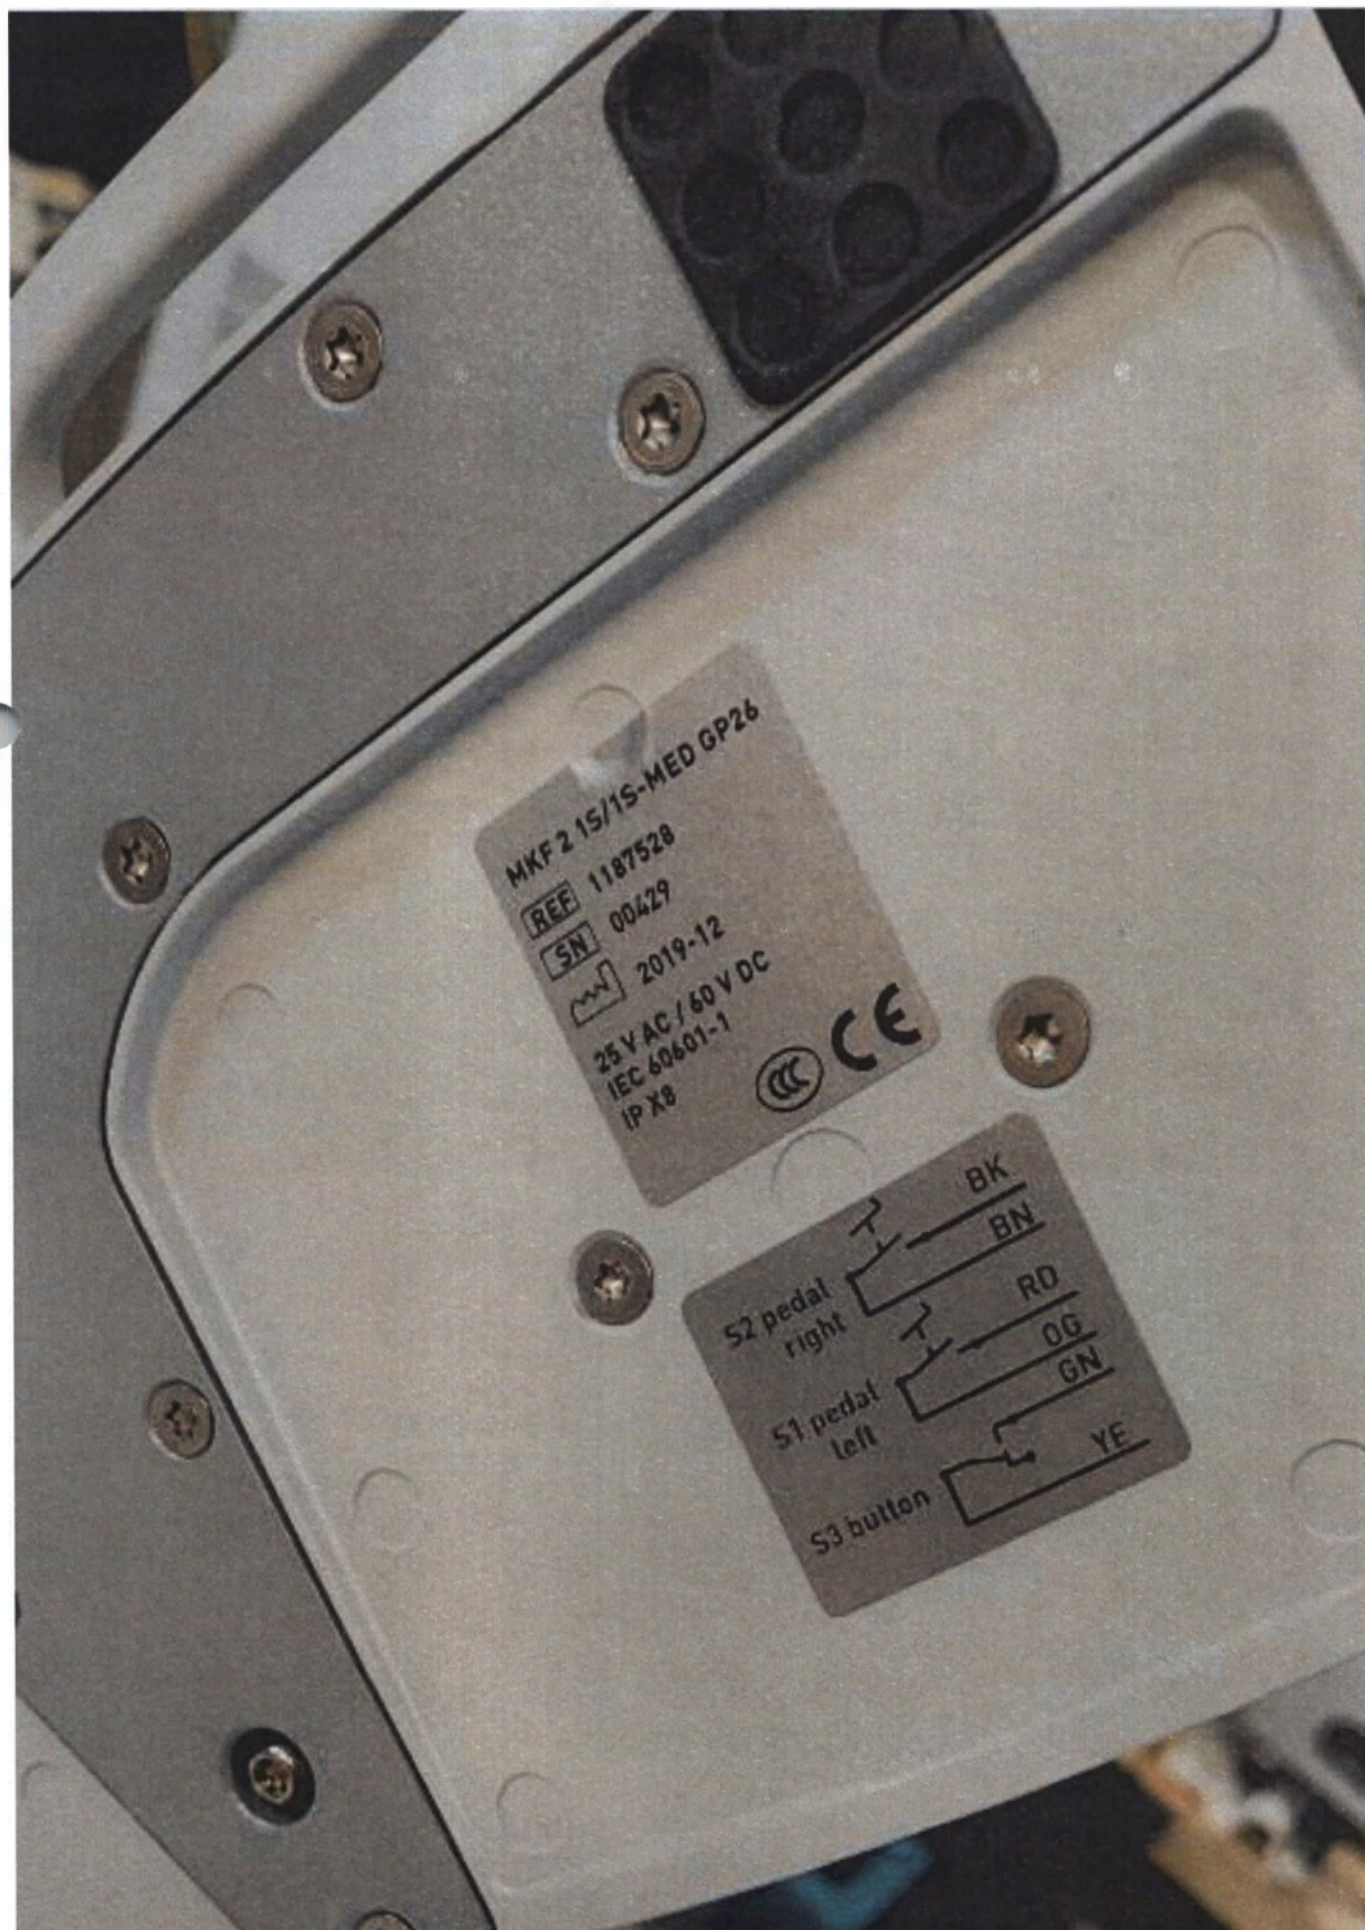


Фотография 14 – Выключатель педальный серии MKF, Lery Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 15 – Выключатель педальный серии MKF, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 16 – Выключатель педальный серии MKF, Steute Technologies GmbH & Co. KG. Вариант внешнего вида

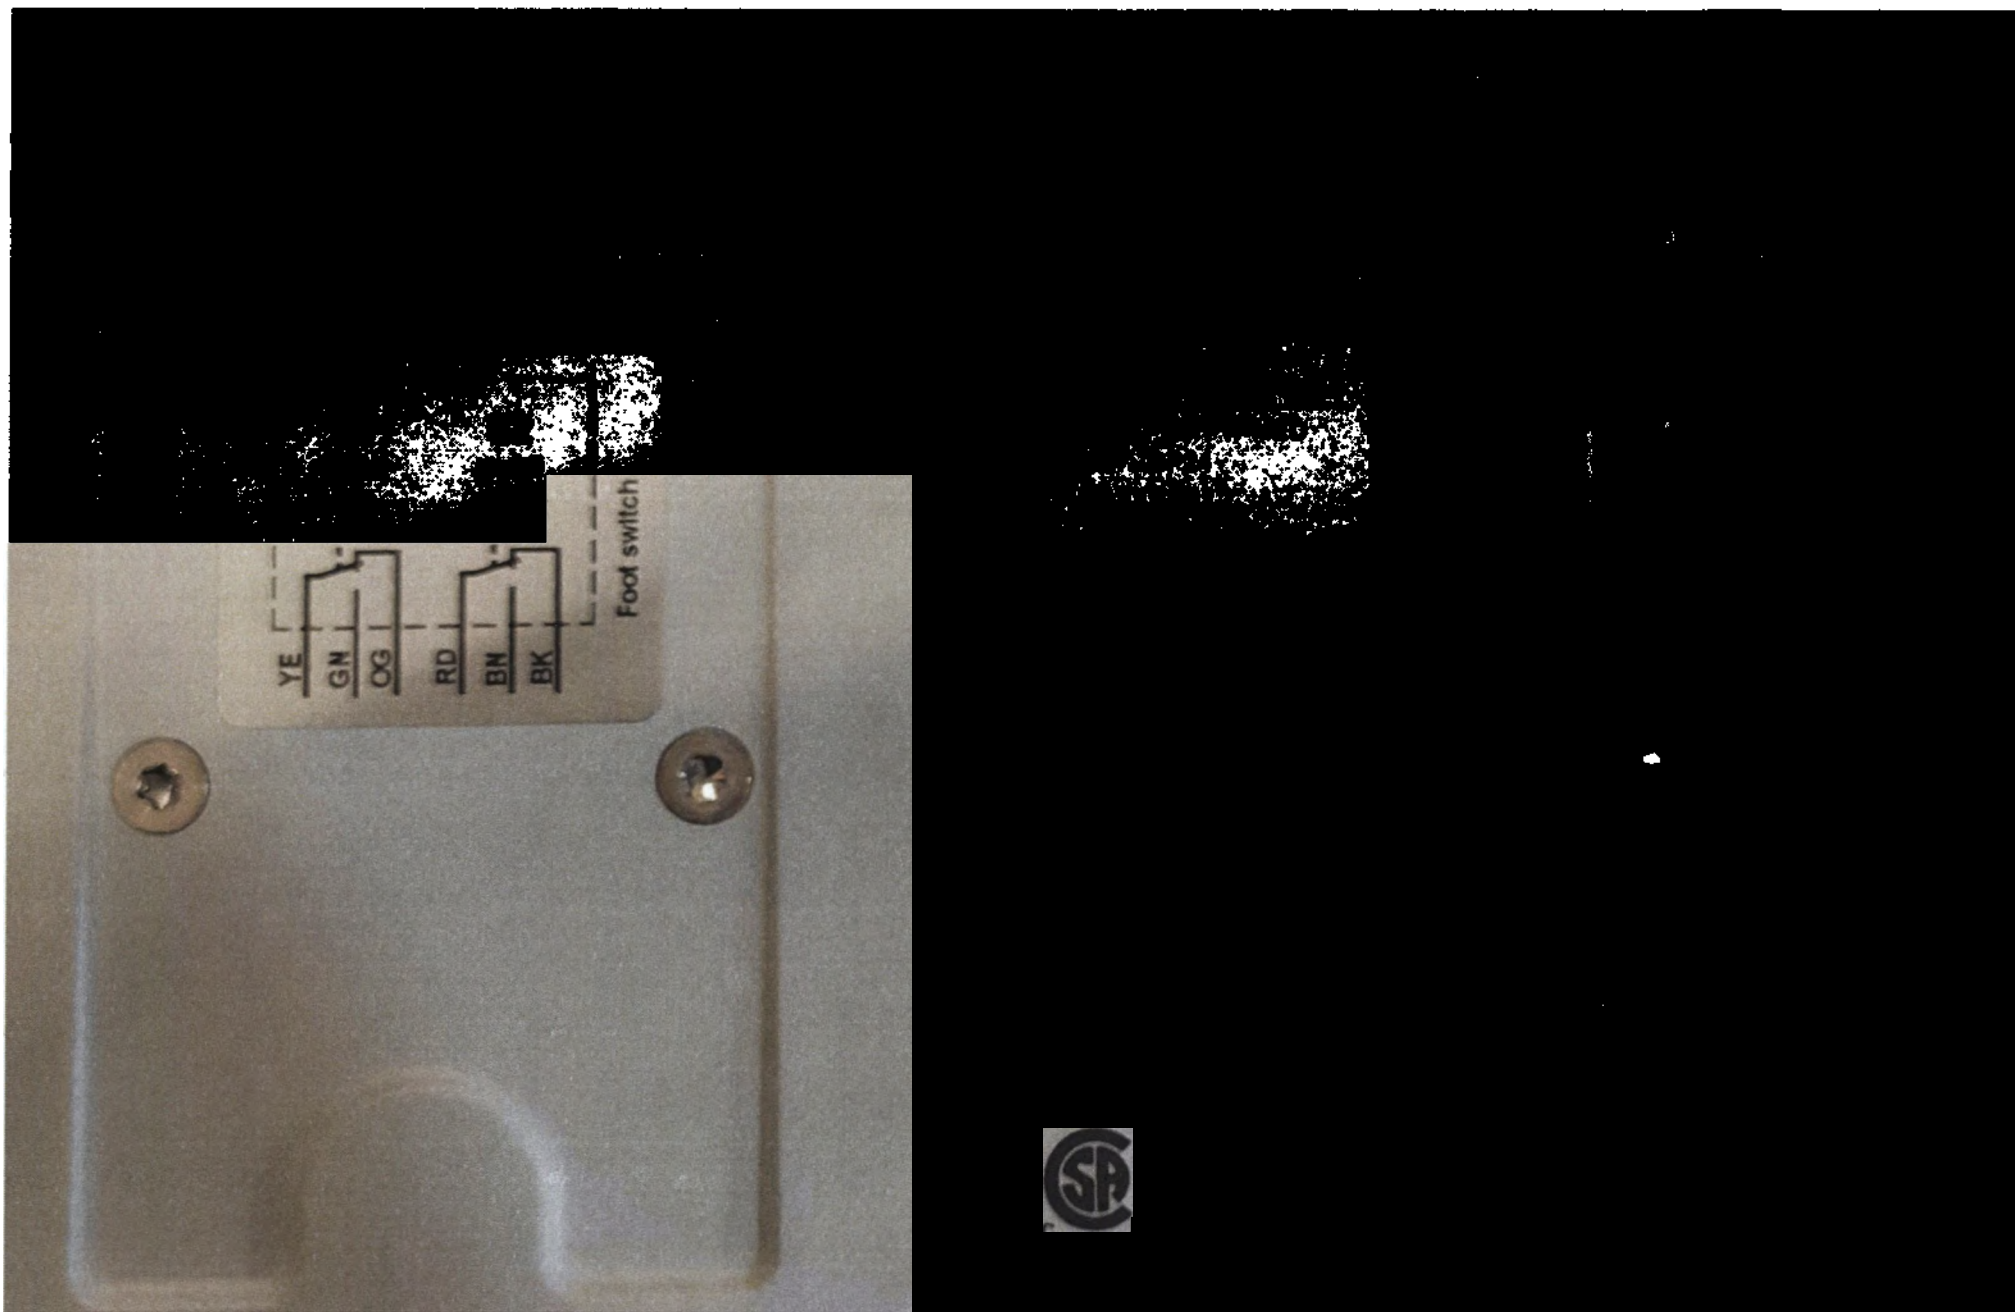

Фотография 17 – Выключатель pedalный серия MKF, Steute Technologies GmbH & Co. KG. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 18 – Педаль с кабелем по спецификации KRT-10-0670, АО «НИПК «Электрон». Вариант внешнего вида

ЭЛЕКТРОН

Педаль с кабелем
KRT-10-0670

Серийный номер
Дата изготовления

NN0006134
2023-09

Обозначение МИ

AKR-00-0000-07:0:220618

Серийный номер МИ

GP0006102

Изготовитель

АО "НИПК "Электрон"


NP-20-0200-02



IPX8




Фотография 19 – Педаль с кабелем KRT-10-0670. Образец внешнего вида варианта маркировки

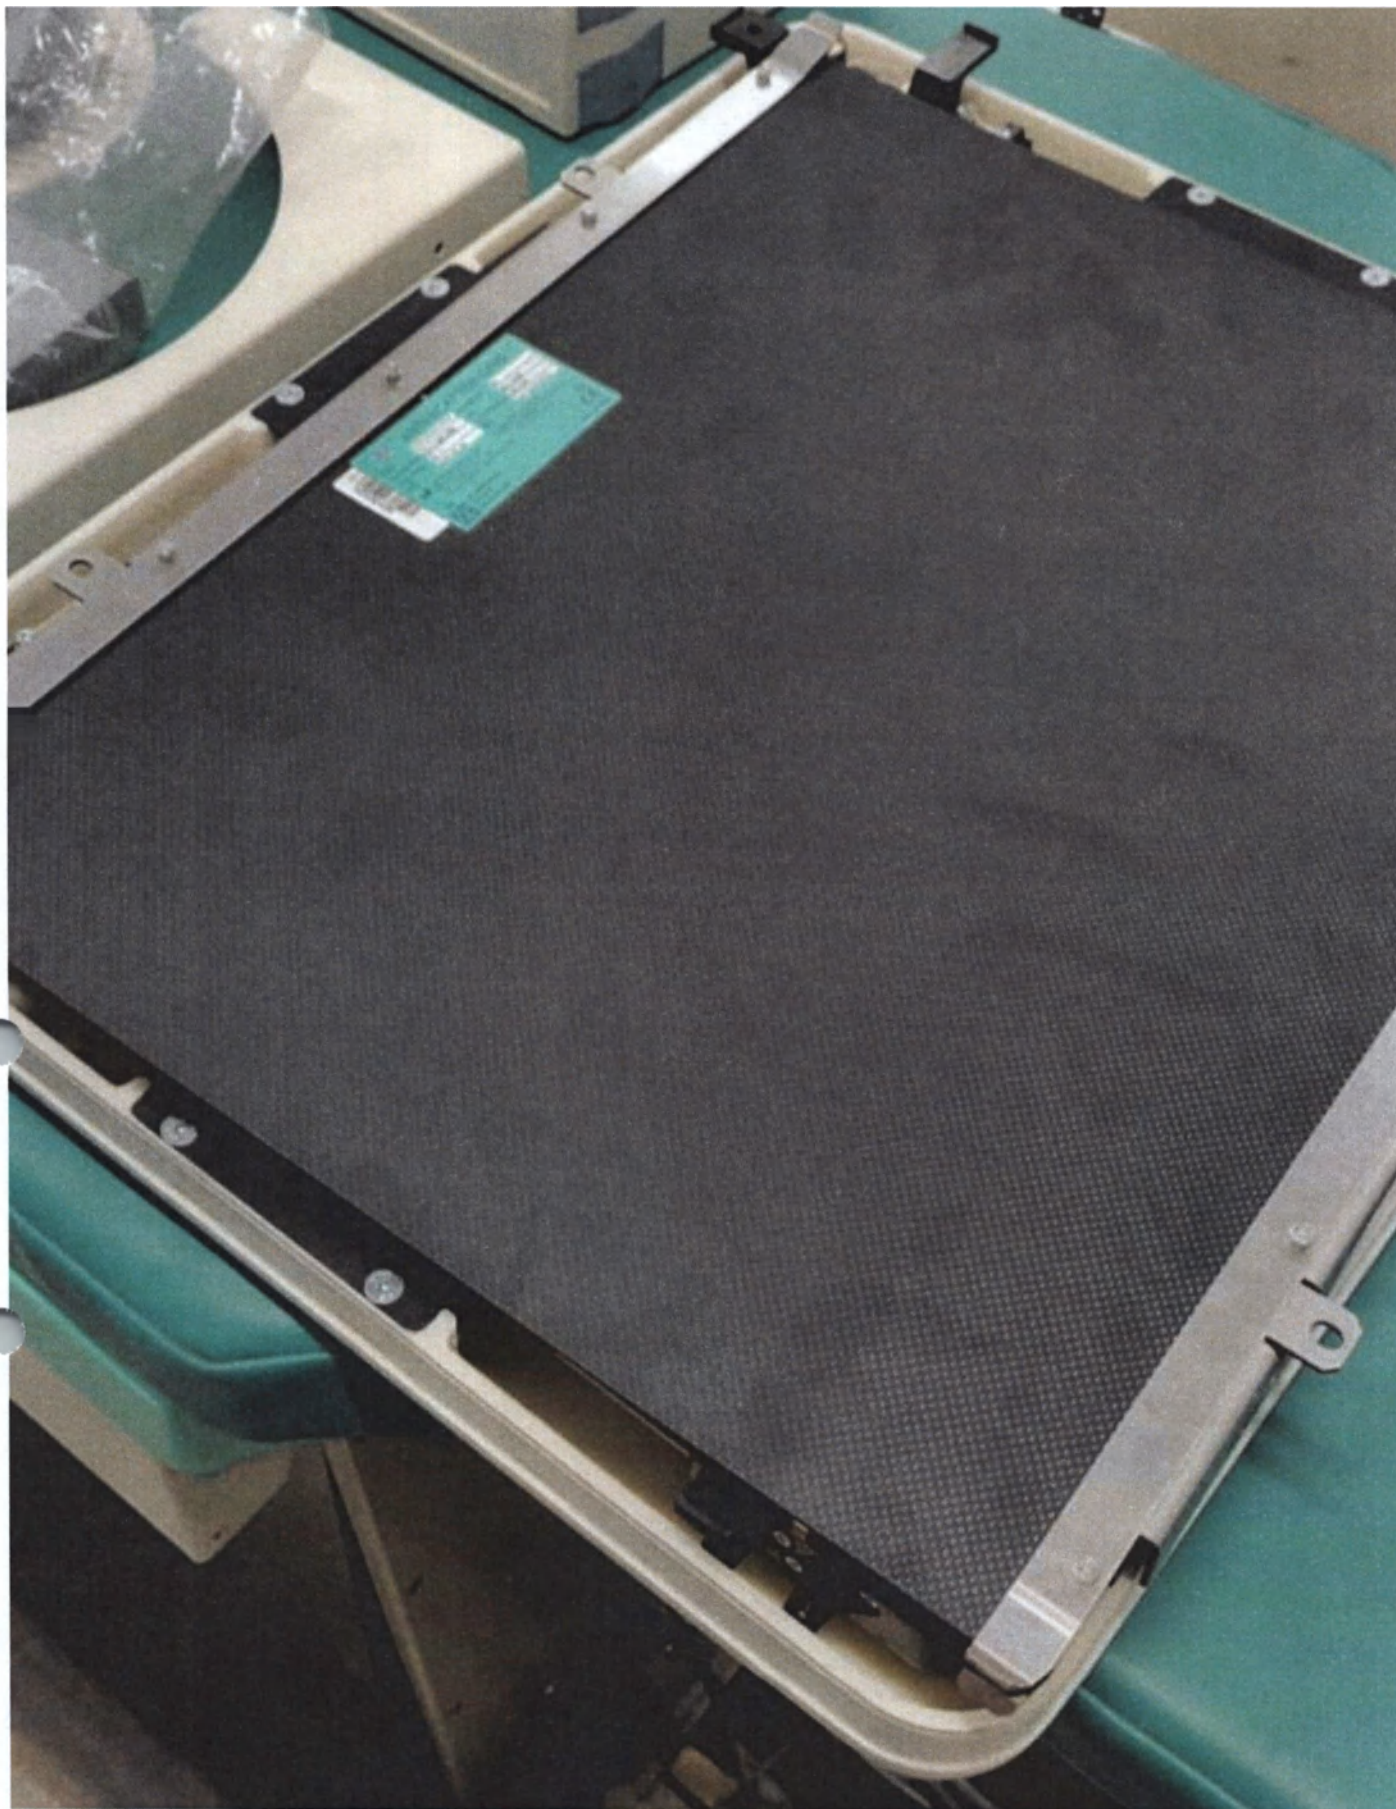

Фотография 20 – Решетка фокусирующая (растр рентгеновский) серии JPI GRID Jungwon Precision Ind. Co., Ltd и место нанесения маркировки (в условиях эксплуатации растр закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

NP230426



ANTI-SCATTER GRID


Type	Focused grid series JPI grid	Interspacer	AL
Overall Size	454 x 360 MM	Line	90 L/CM
Grid Ratio	12 : 1	Focal Distance	100 CM
	2023.02.28		JW 23215312



JPI Healthcare Co., Ltd.

808-HO, 28, DIGITAL-RO 35GIL,
GURO-GU, SEOUL, KOREA, 08377

TEL : (82-2) 2108-2580 FAX : (82-2) 2108-1180



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 26, 2514 AP The Hague,
The Netherlands


TEL (31) (0) 70 345 8570



(01) 08809413810204

(11) 230228

(21) JW 23215312



MADE IN KOREA


Фотография 21 – Решетка фокусирующая (растр рентгеновский) серии JPI GRID Jungwon Precision Ind. Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 22 – Решетка фокусирующая (растр рентгеновский) SIEMENS, Siemens Healthcare GmbH. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 23 – Решетка фокусирующая серии SIEMENS и место нанесения маркировки (при эксплуатации растр закрыт кожухом аппарата). Вариант внешнего вида

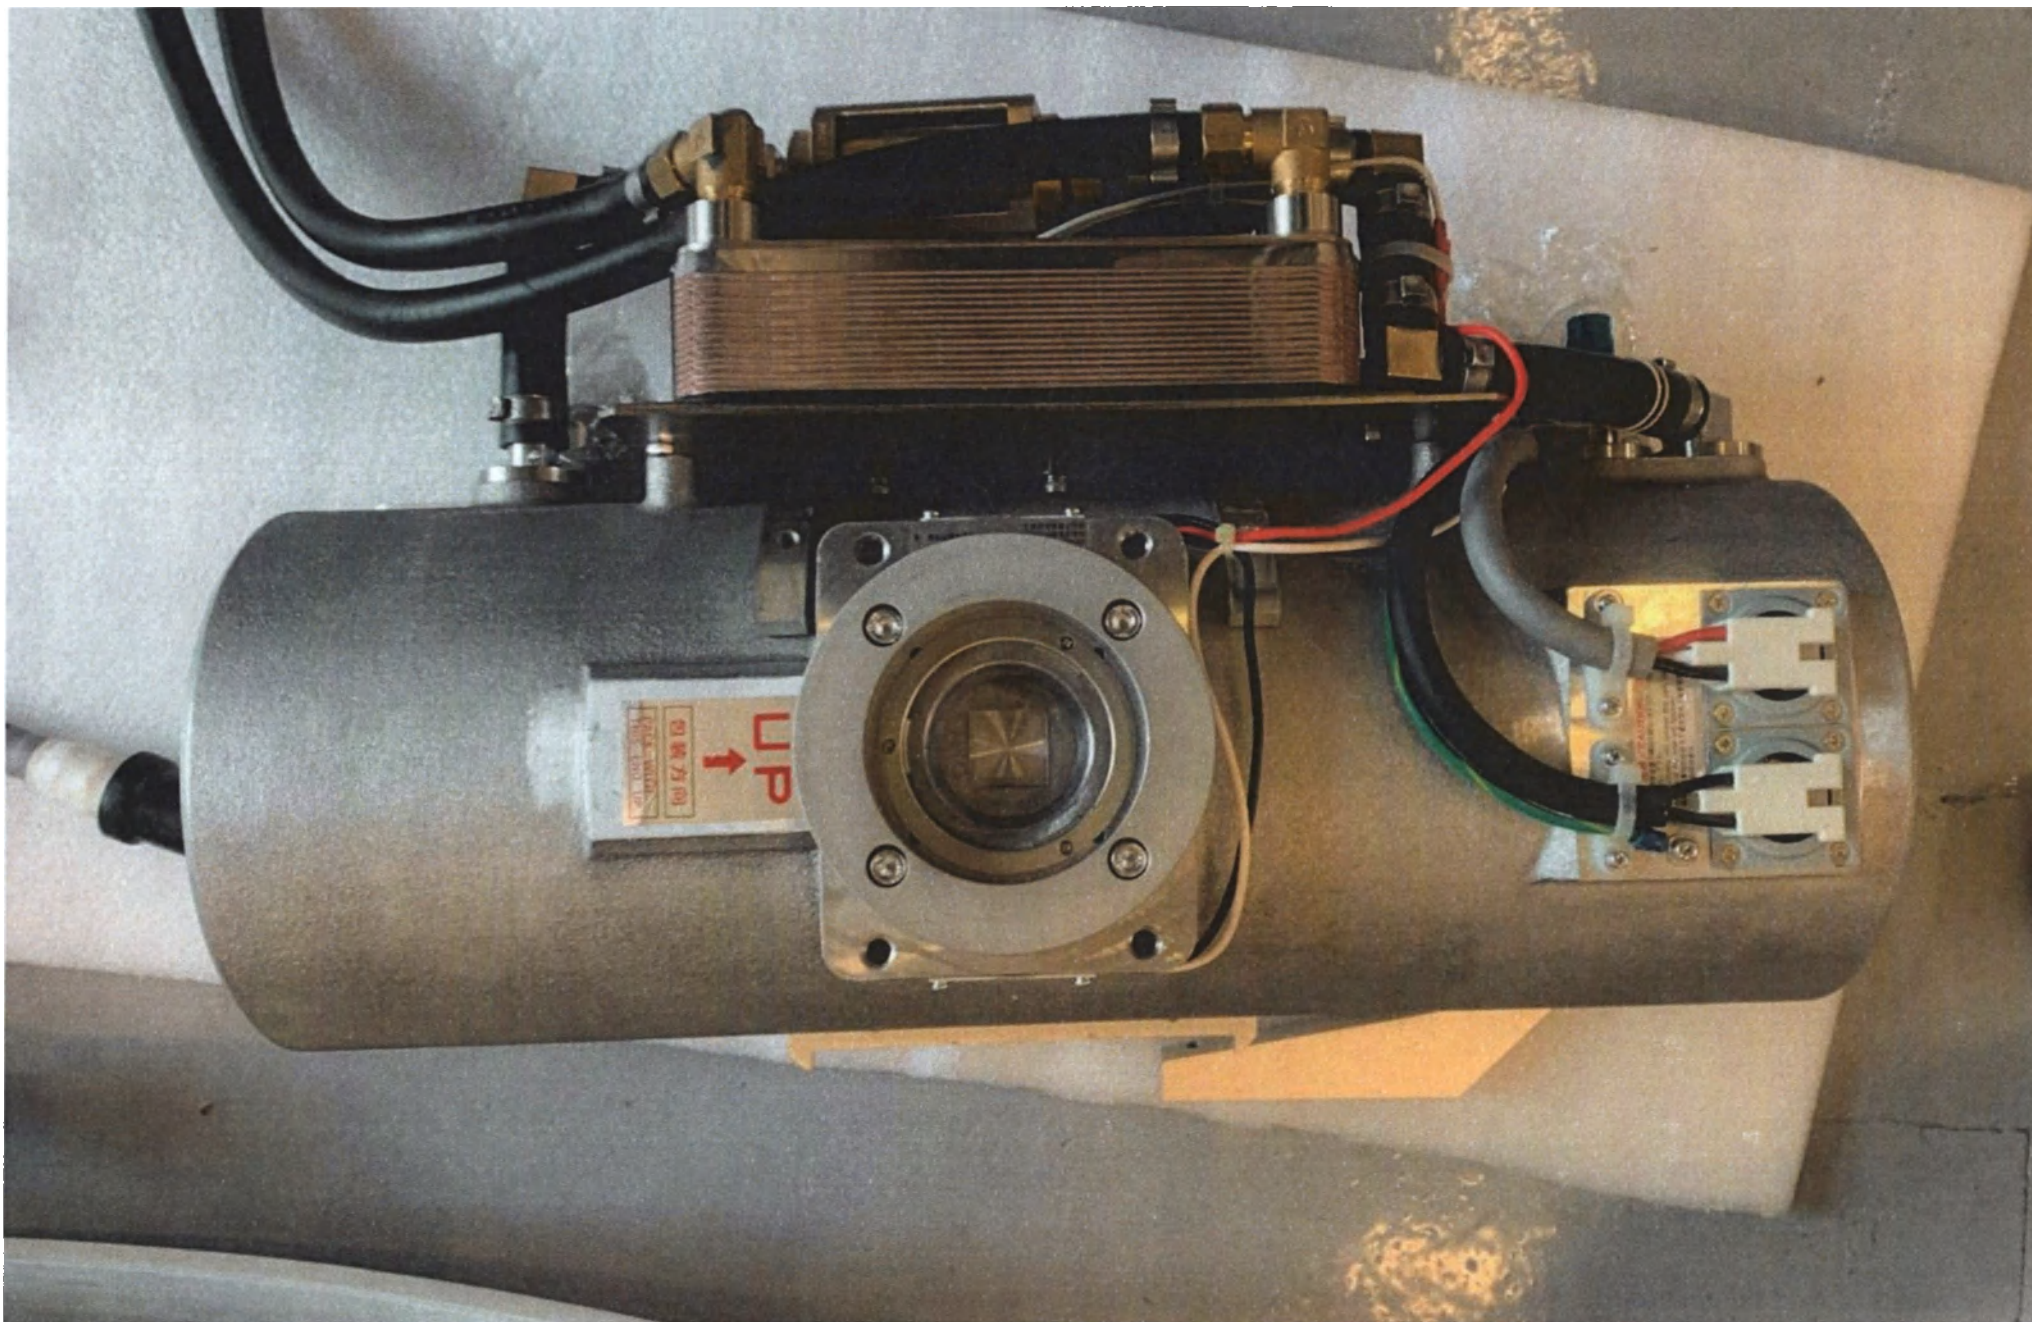


Фотография 24 – Излучатель рентгеновский серии E, Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd (в условиях эксплуатации излучатель закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

CANON ELECTRON TUBES
& DEVICES CO., LTD.


ROTANODE™

使用期限 详见说明书

产品名称
NAME OF DEVICE 医用诊断 X 射线管组件

 生产日期
MANUFACTURED March 2021 / 2021-03

产品型号
UNIT MODEL E79039X 其他内容详见说明书


 生产序列号
SER. NO. 21C806 焦点尺寸
FOCAL SPOT 1.0/0.6

管芯型号
INSERT MODEL E79039 子号
SUP SYMBOL CN

管芯生产序列号
SER. NO. 1B803 最大管电压
MAX. VOLTAGE 125 kV

固有滤过
PERMANENT FILTRATION 1.1 Al/ 75 定子阻抗
STATOR XS-AX

Фотография 25 – Излучатель рентгеновский серии E, Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки

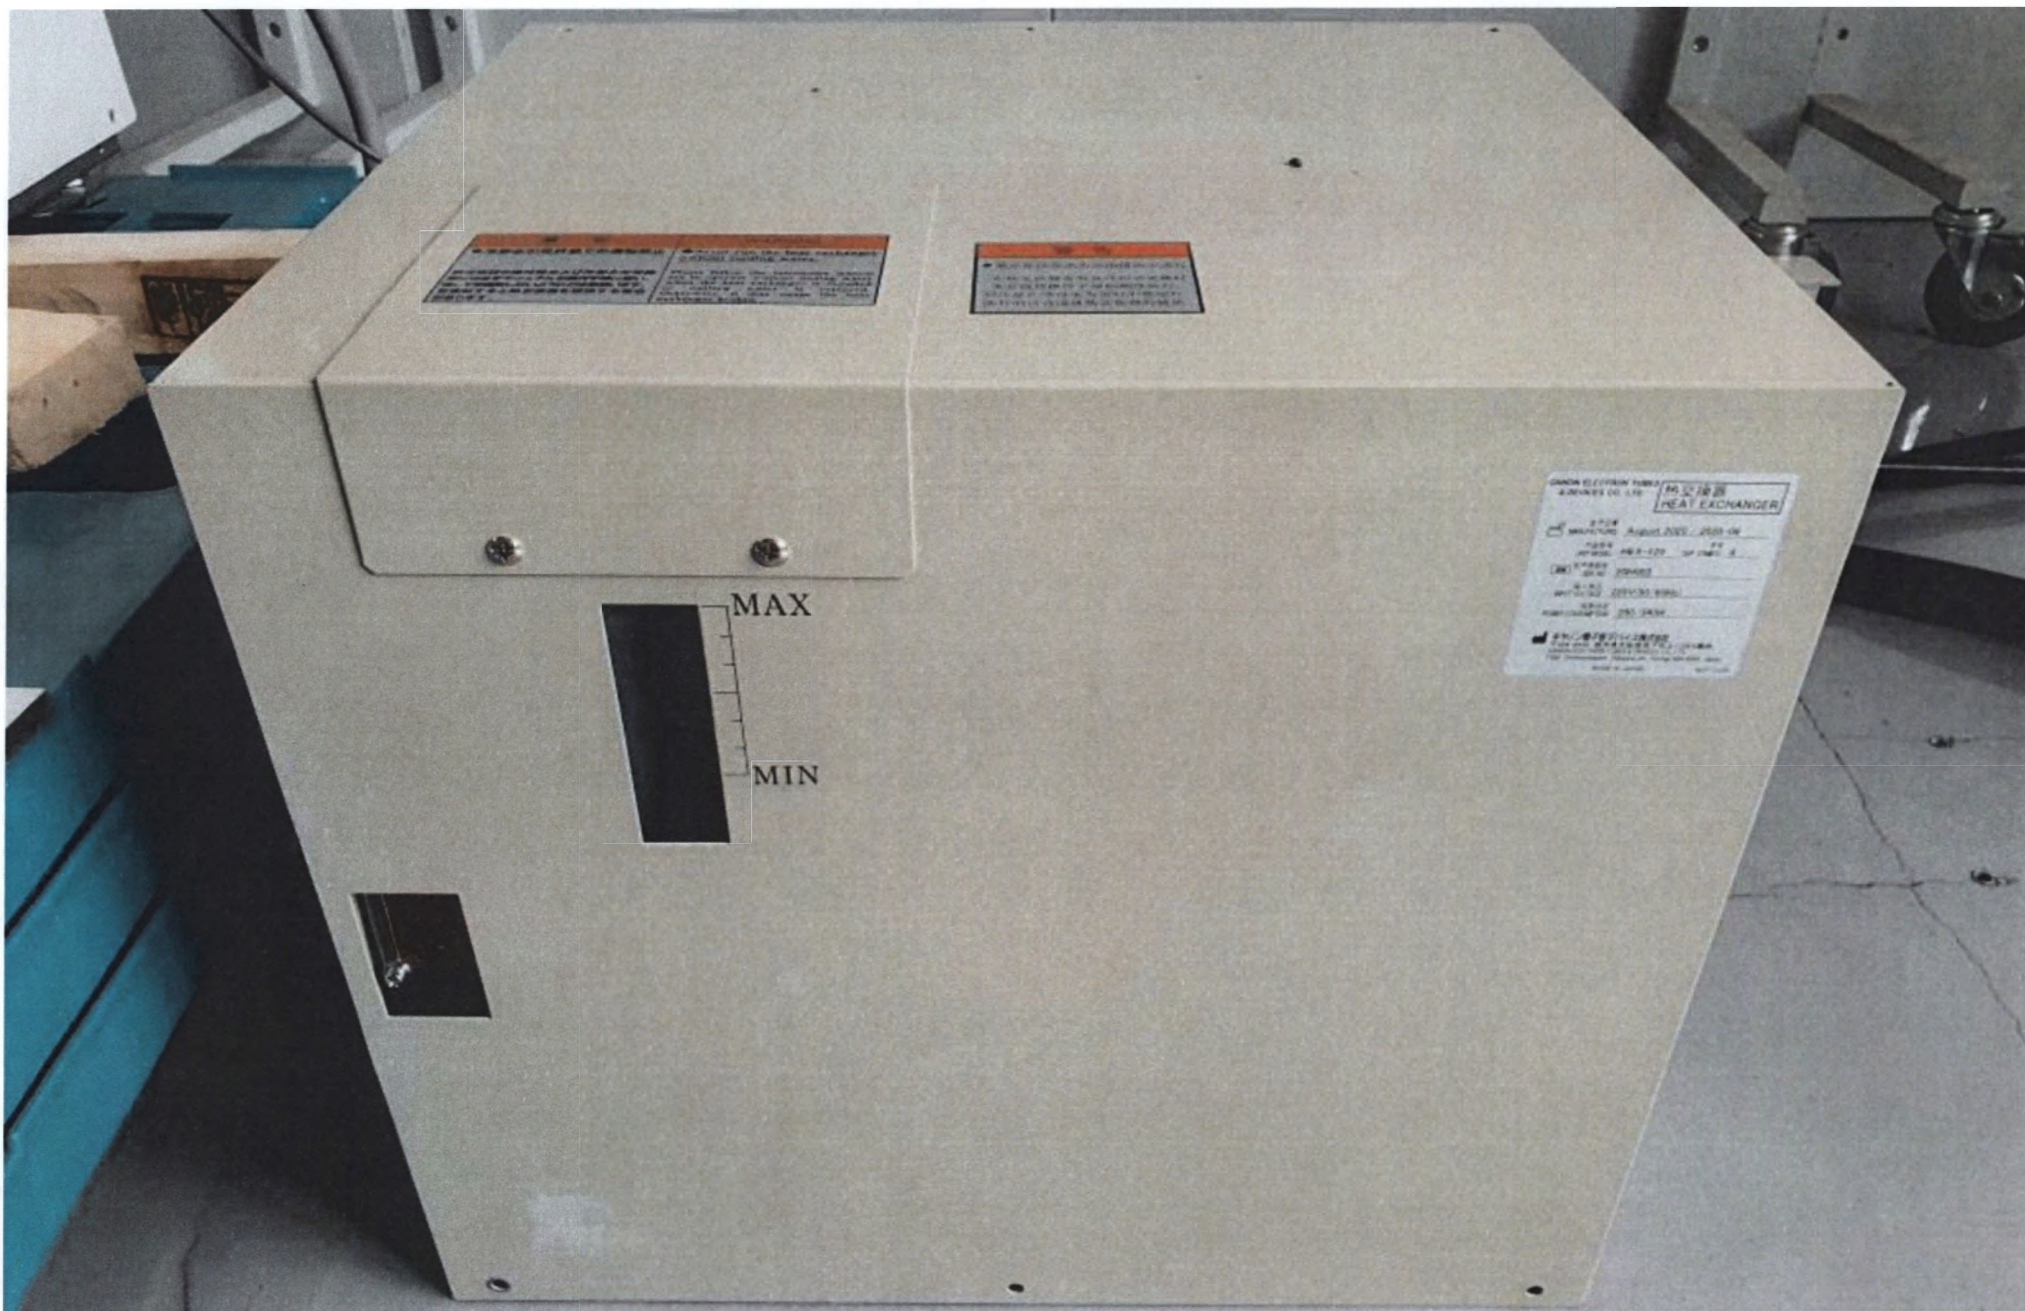

Фотография 26 – Система охлаждения излучателя рентгеновского HEX-125 Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd (в составе излучателя Canon). Вариант внешнего вида

CANON ELECTRON TUBES
& DEVICES CO., LTD.

热交换器
HEAT EXCHANGER



生产日期

MANUFACTURED: August 2020 / 2020-08

产品型号

UNIT MODEL: HEX-125

子号

SUP. SYMBOL: A

生产序列号

SN

SER. NO.: 20H002

输入电压

INPUT VOLTAGE: 220V(50/60Hz)

消费功率

POWER CONSUMPTION: 280/340W



キヤノン電子管デバイス株式会社

〒324-8550 栃木県大田原市下石上1385番地


CANON ELECTRON TUBES & DEVICES CO., LTD.

1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 324-8550, Japan


MADE IN JAPAN

MZF-CL03


Фотография 27 – Система охлаждения излучателя рентгеновского HEX-125, Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd
(в составе излучателя Canon). Образец внешнего вида варианта маркировки

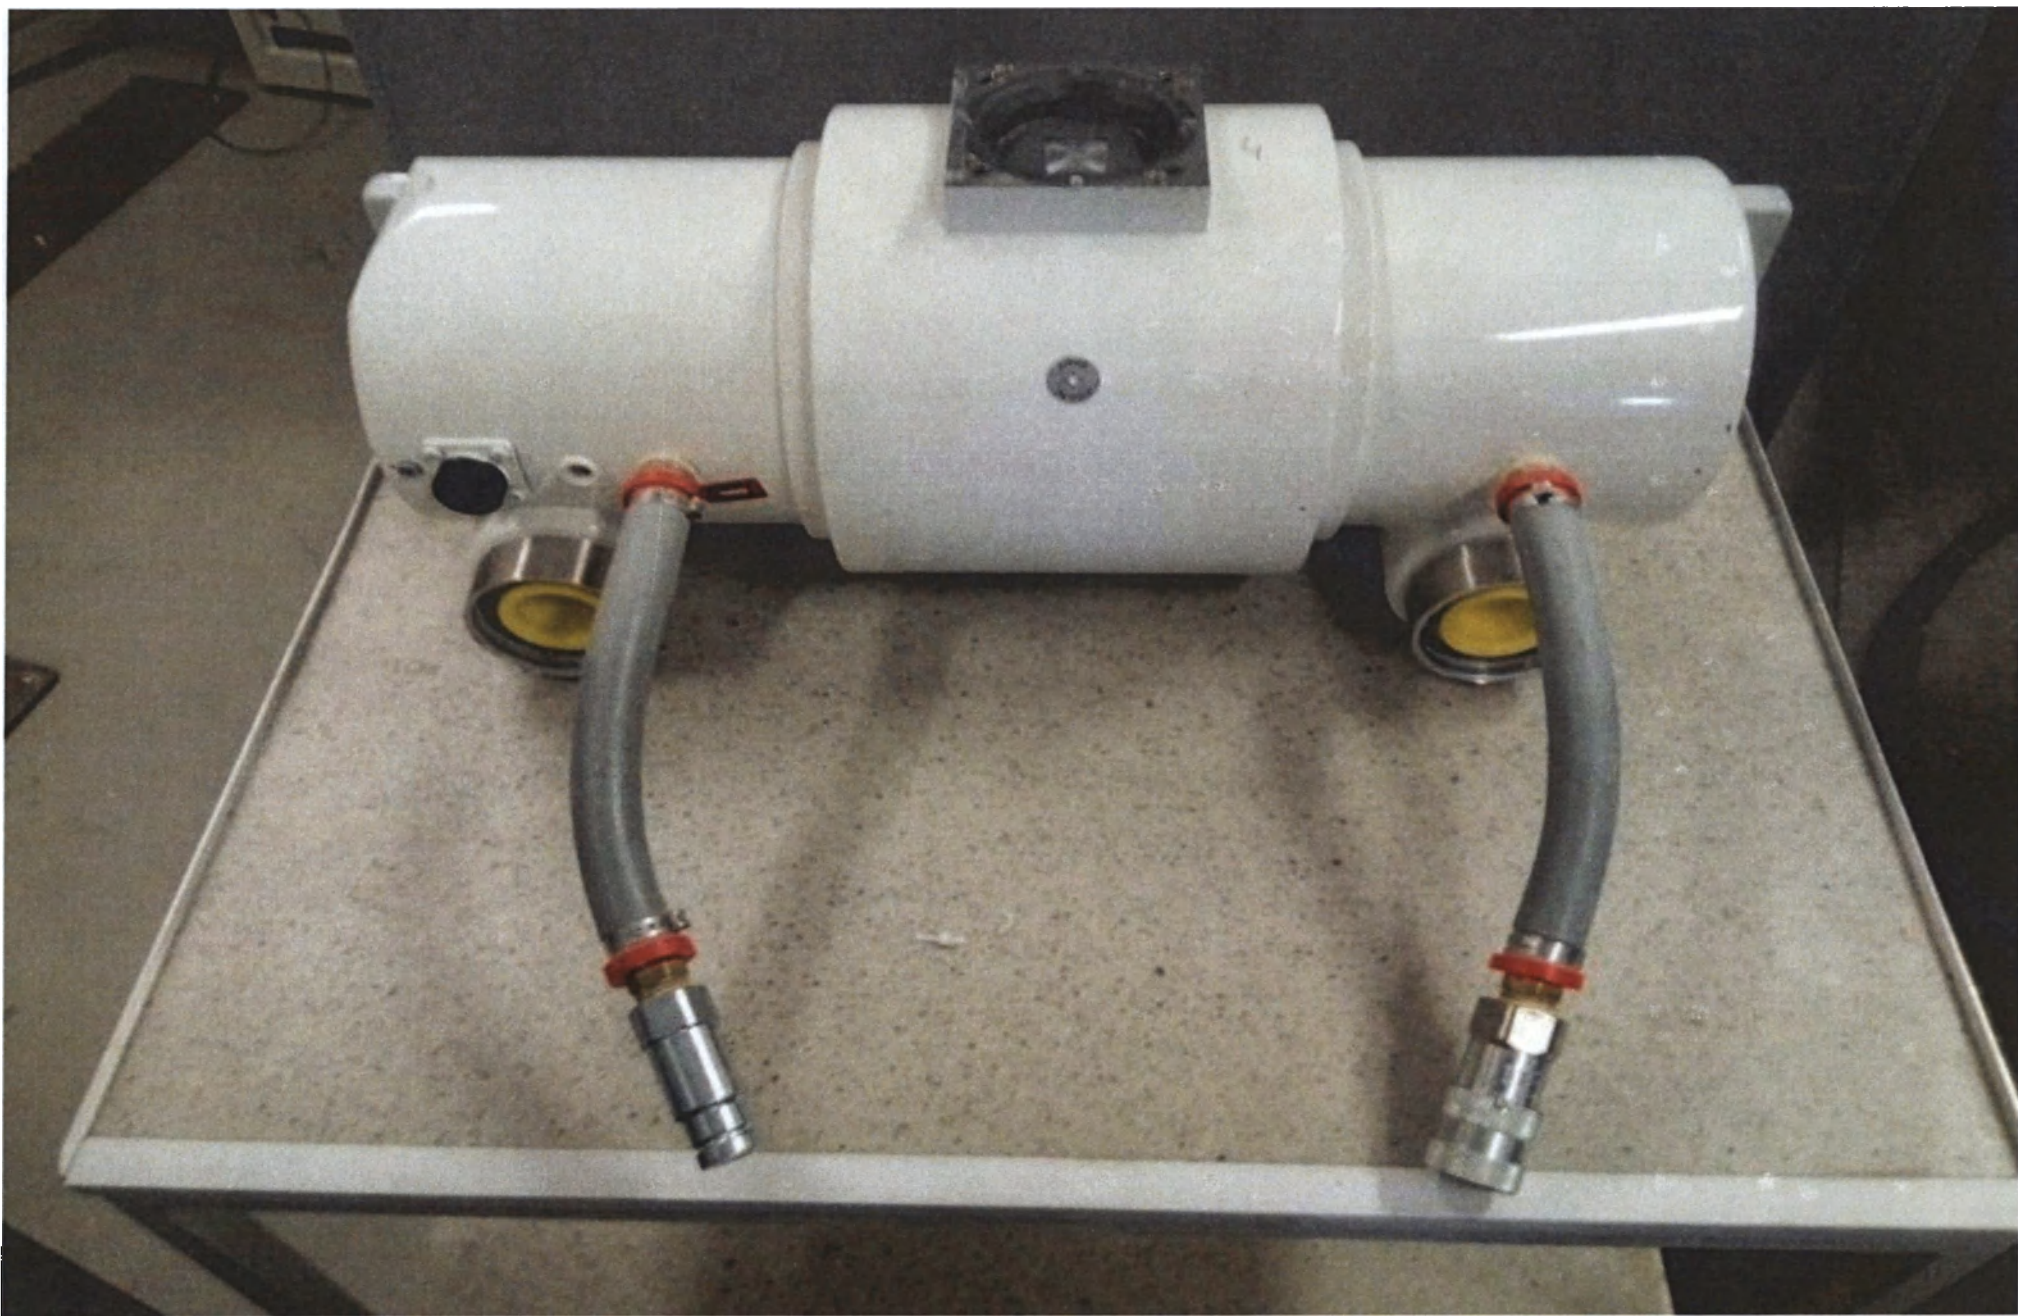


Фотография 28 – Излучатель рентгеновский серии Roesys XRT, Roesys GmbH (при эксплуатации излучатель закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

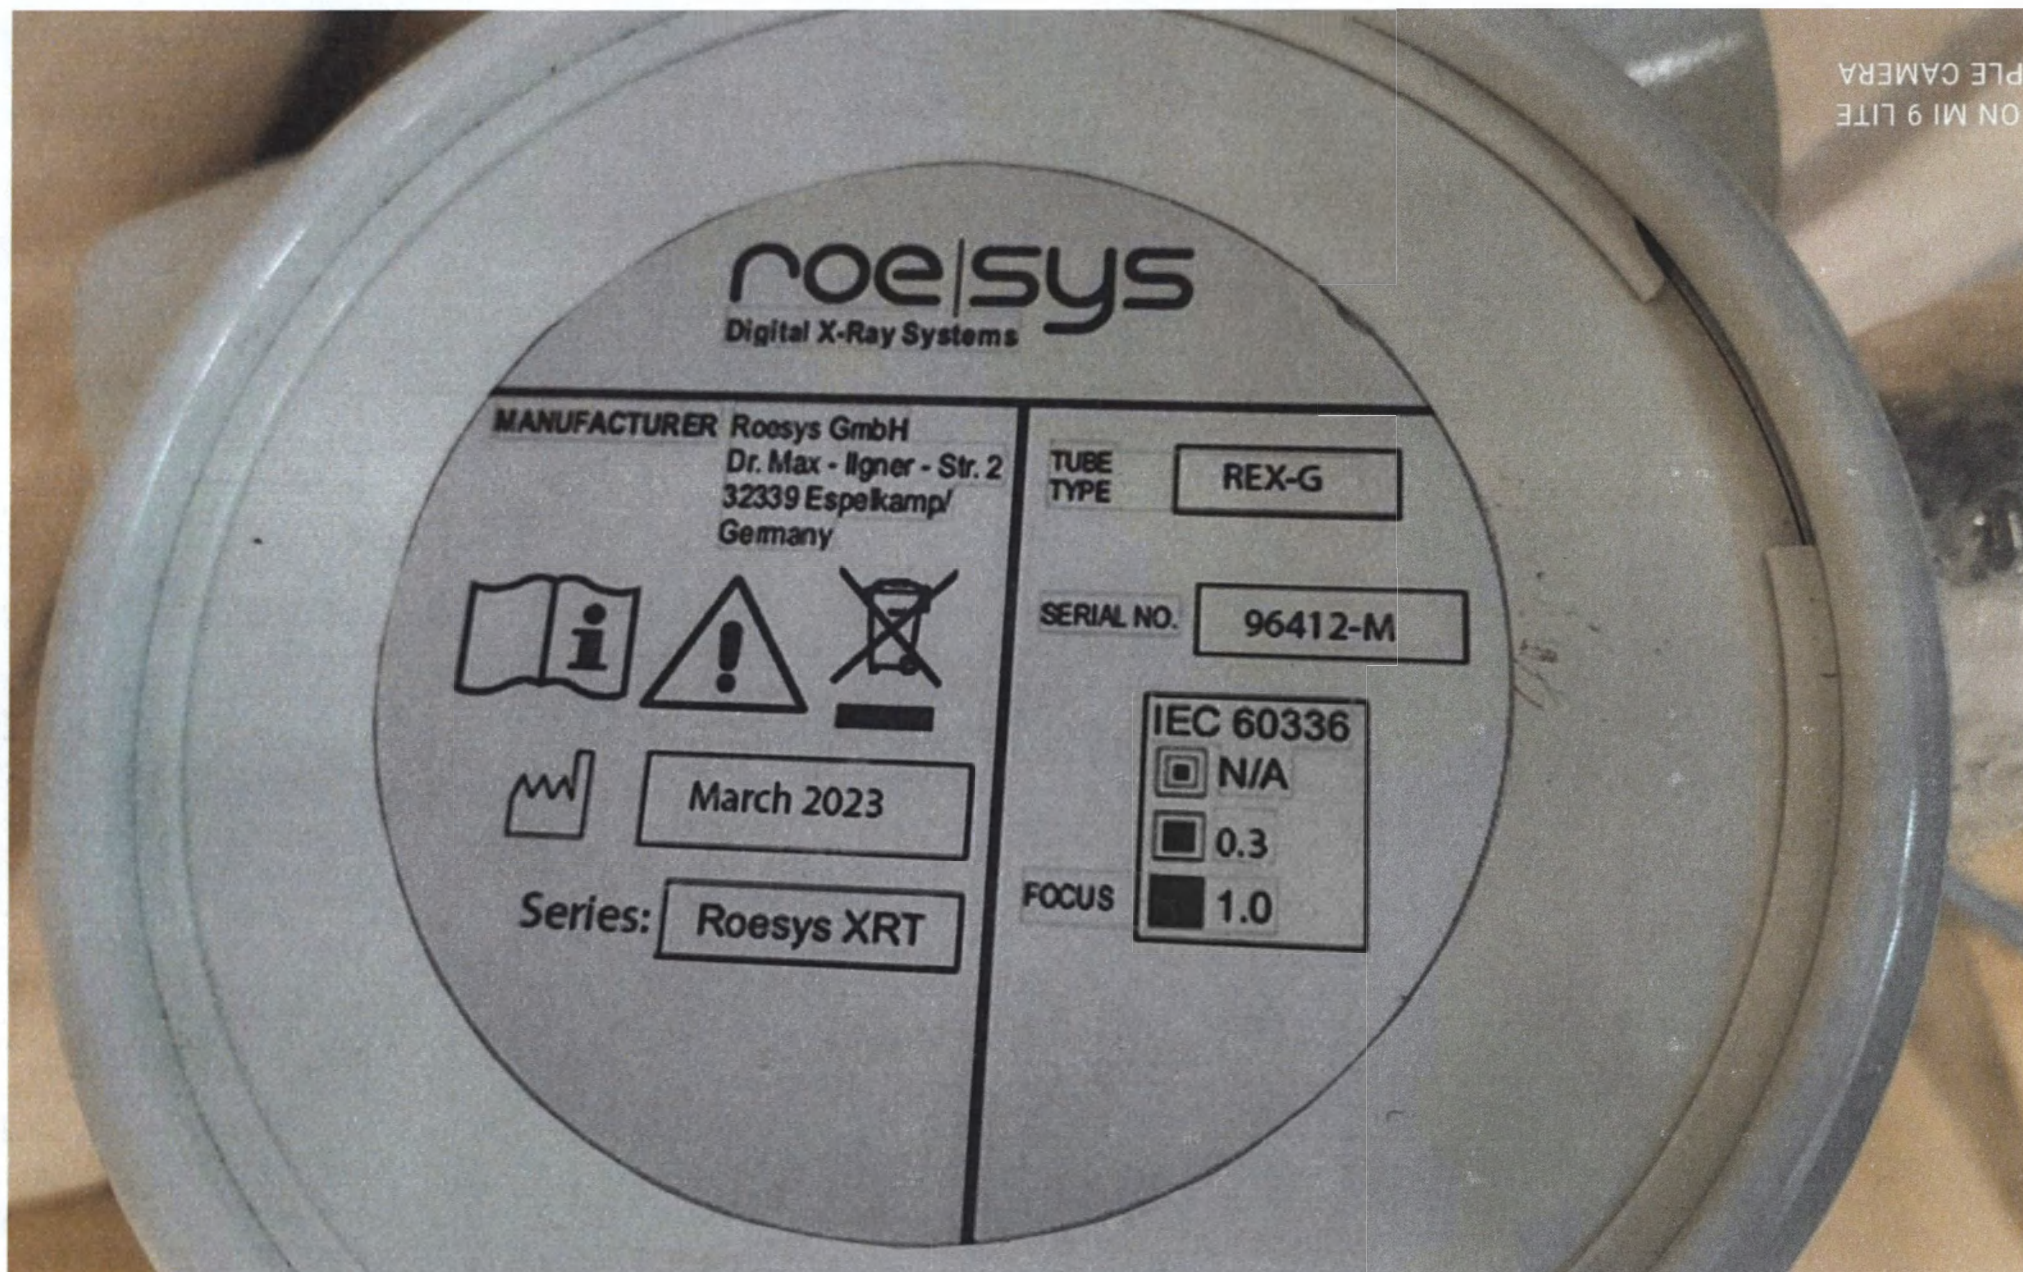


Фотография 29 – Излучатель рентгеновский серии Roesys XRT, Roesys GmbH. Образец внешнего вида варианта маркировки

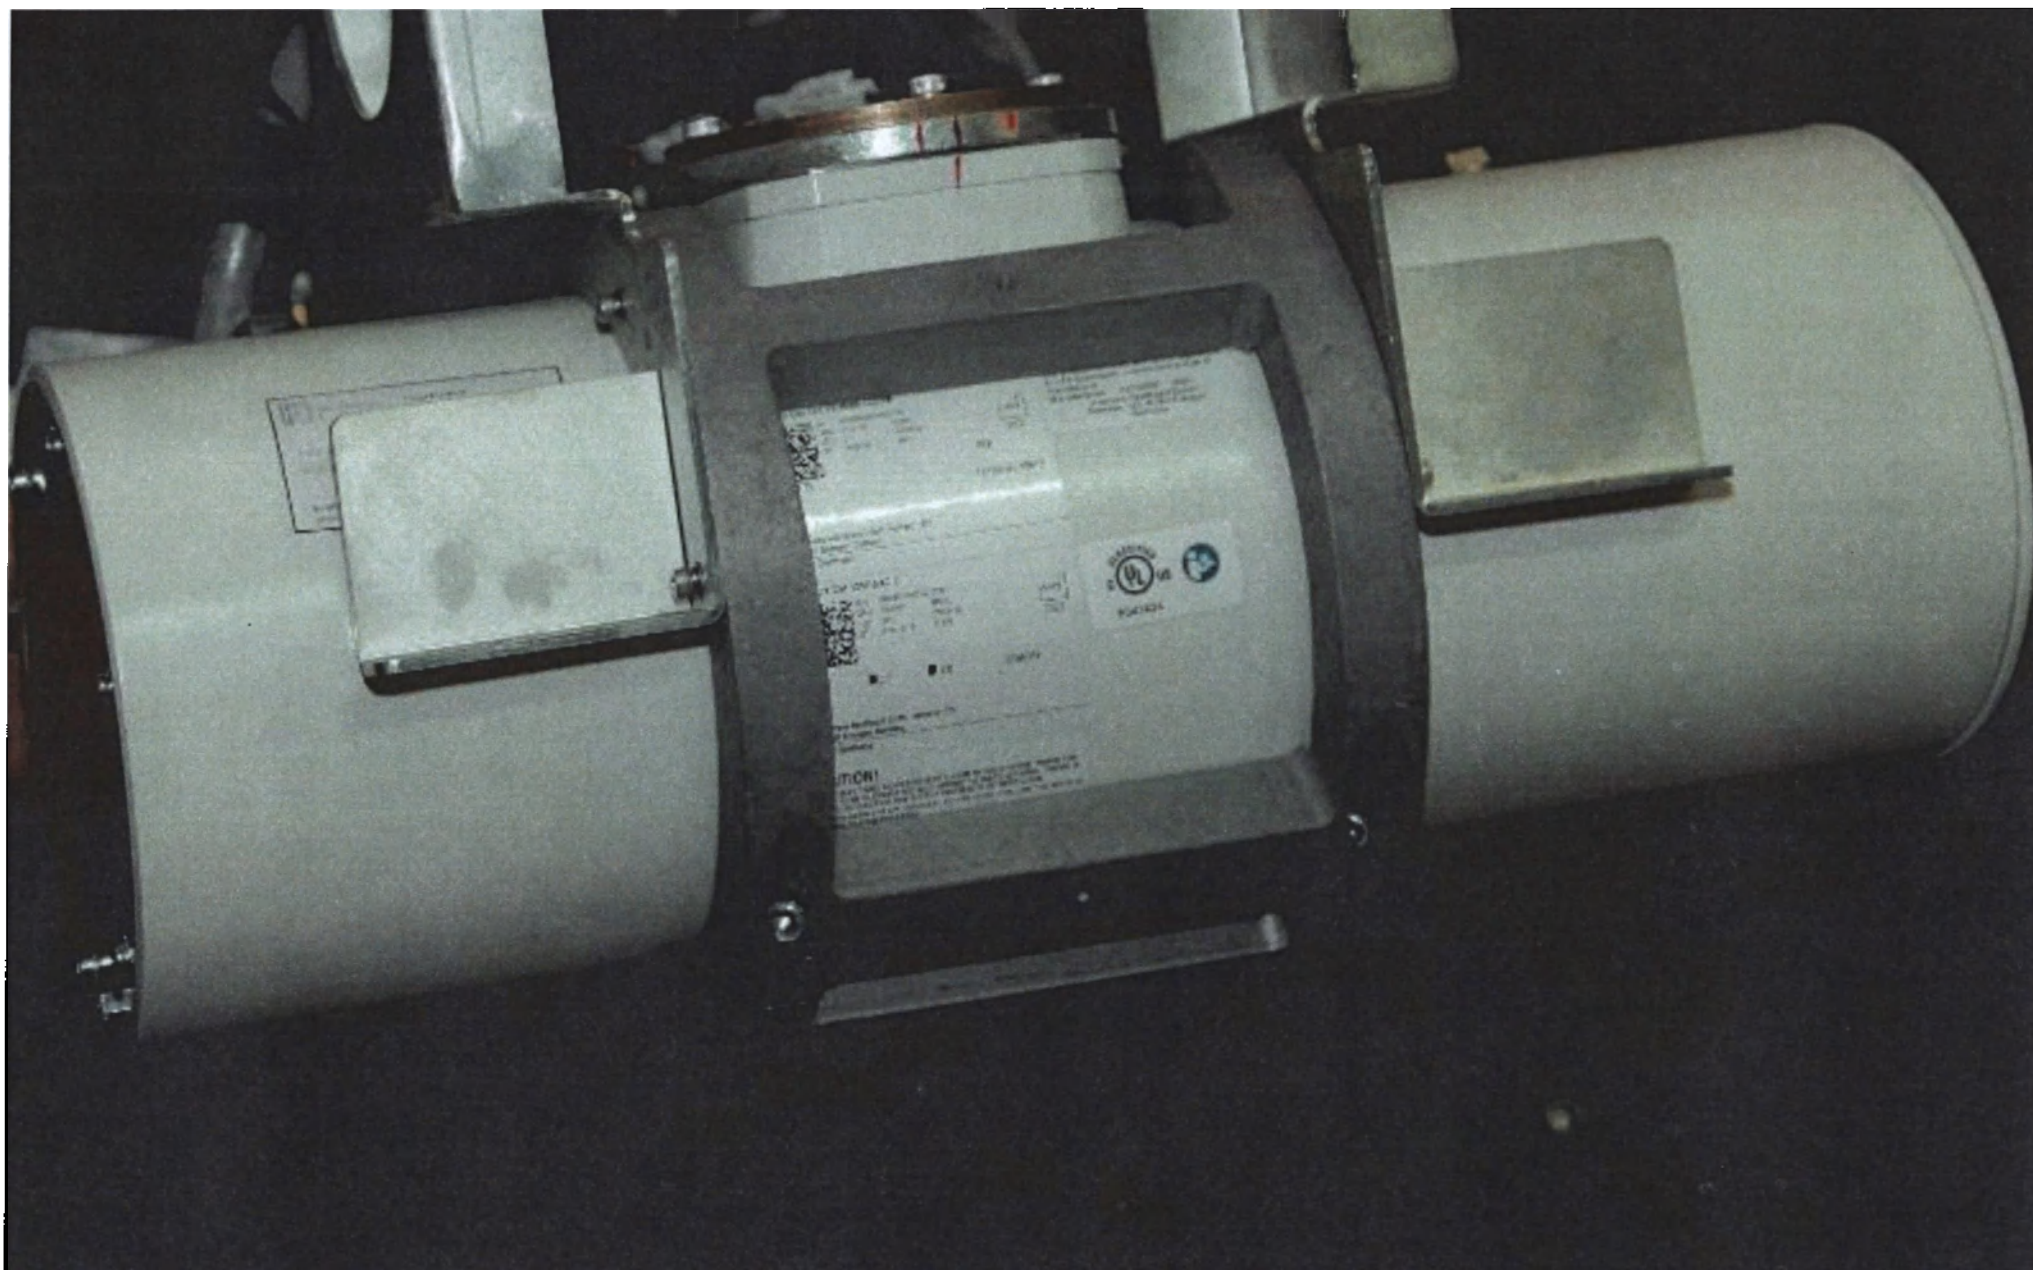


Фотография 30 – Излучатель рентгеновский MegaLix Cat, Siemens Healthcare GmbH (в условиях эксплуатации излучатель закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

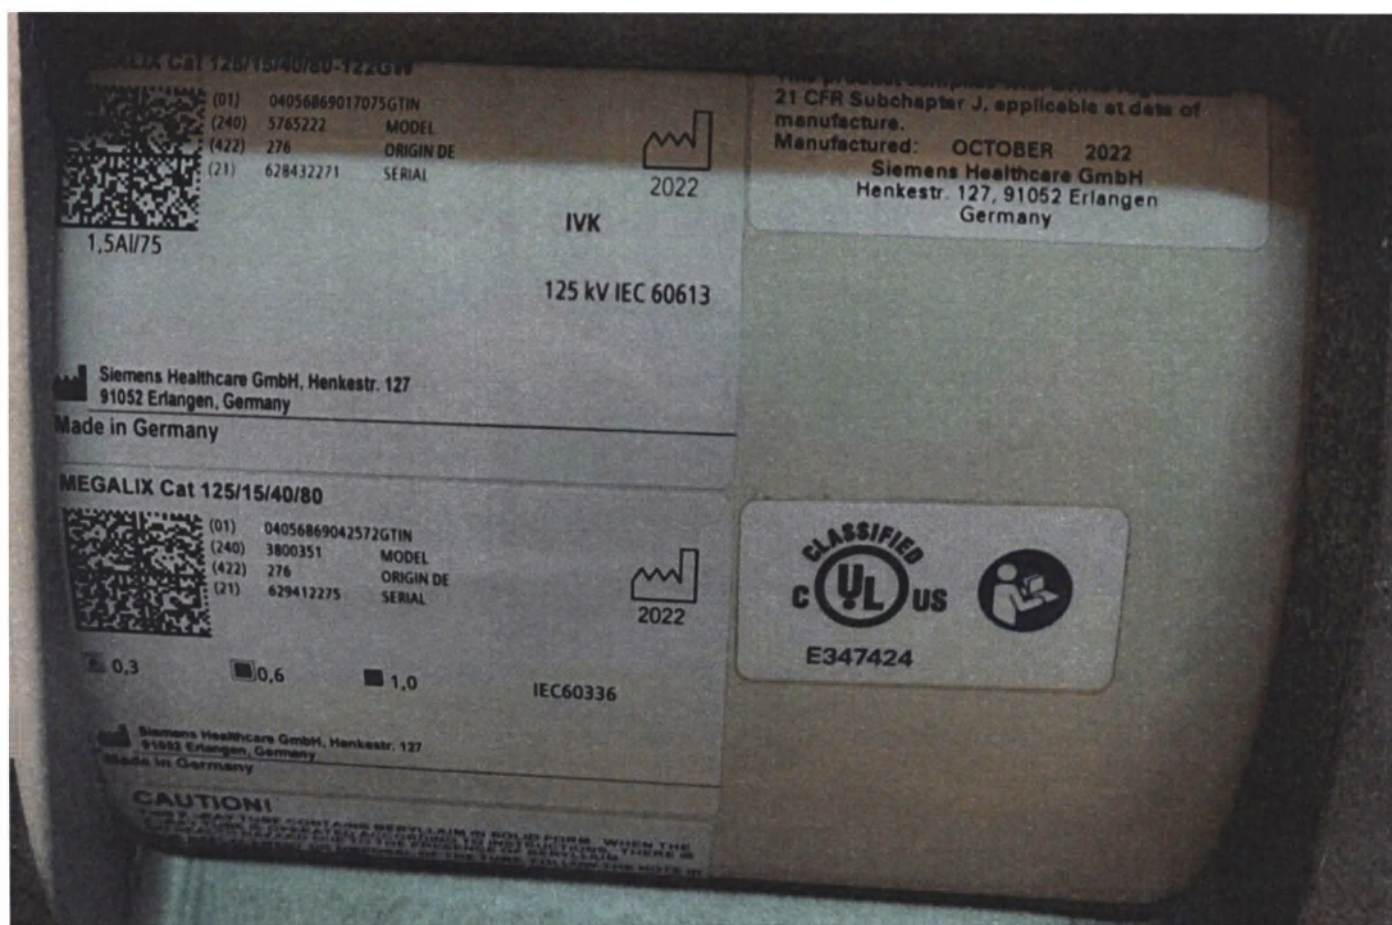


Фотография 31 – Излучатель рентгеновский MegaLix Cat, Siemens Healthcare GmbH. Образец внешнего вида варианта маркировки

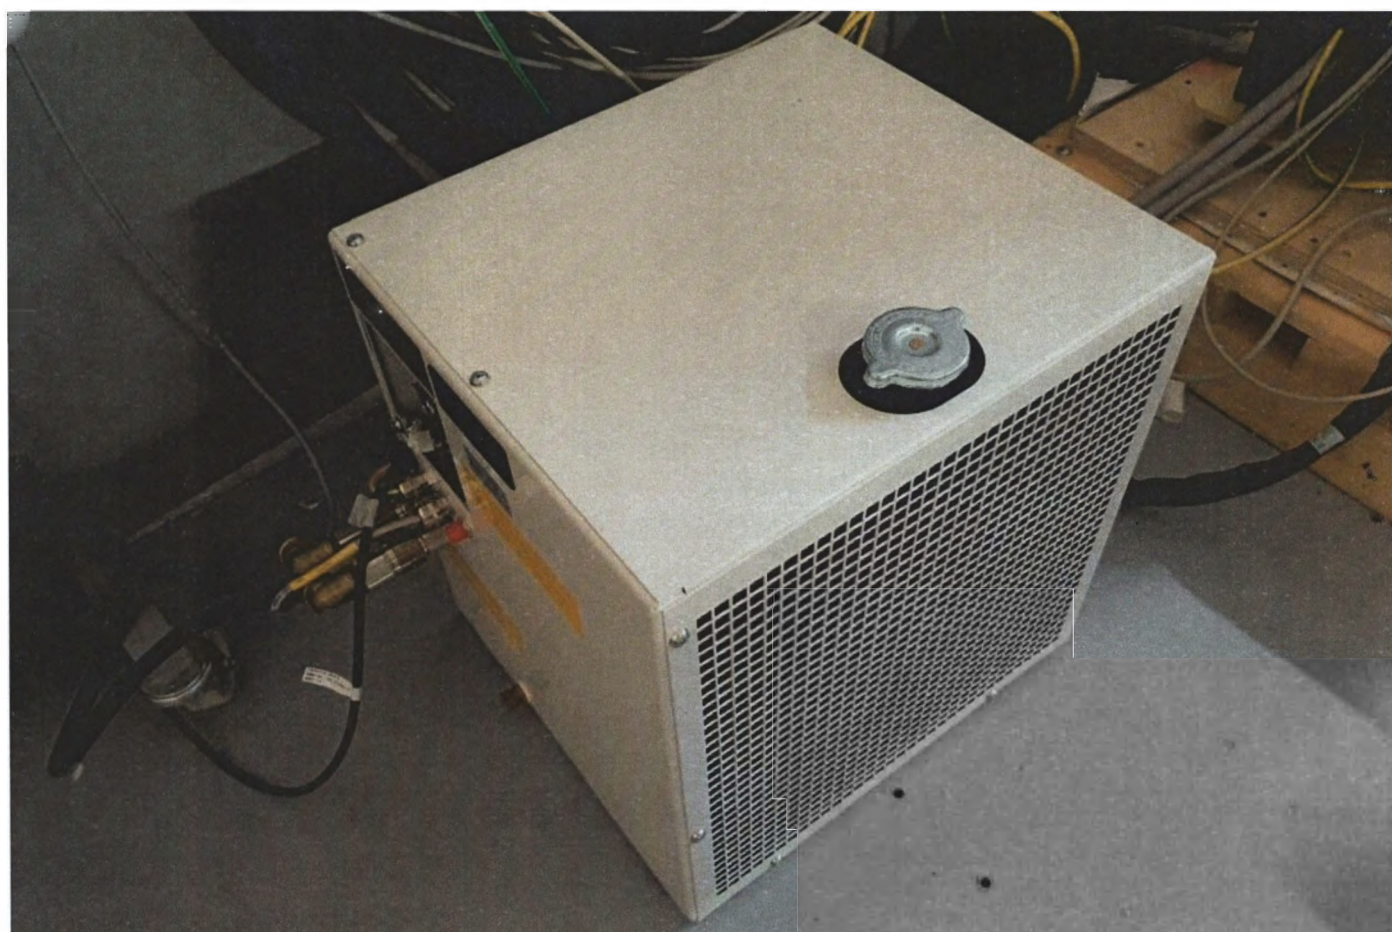


Фотография 32 – Система охлаждения излучателя рентгеновского WL 3000 SU, Siemens Healthcare GmbH (в составе рентгеновского излучателя Siemens Healthcare). Вариант внешнего вида

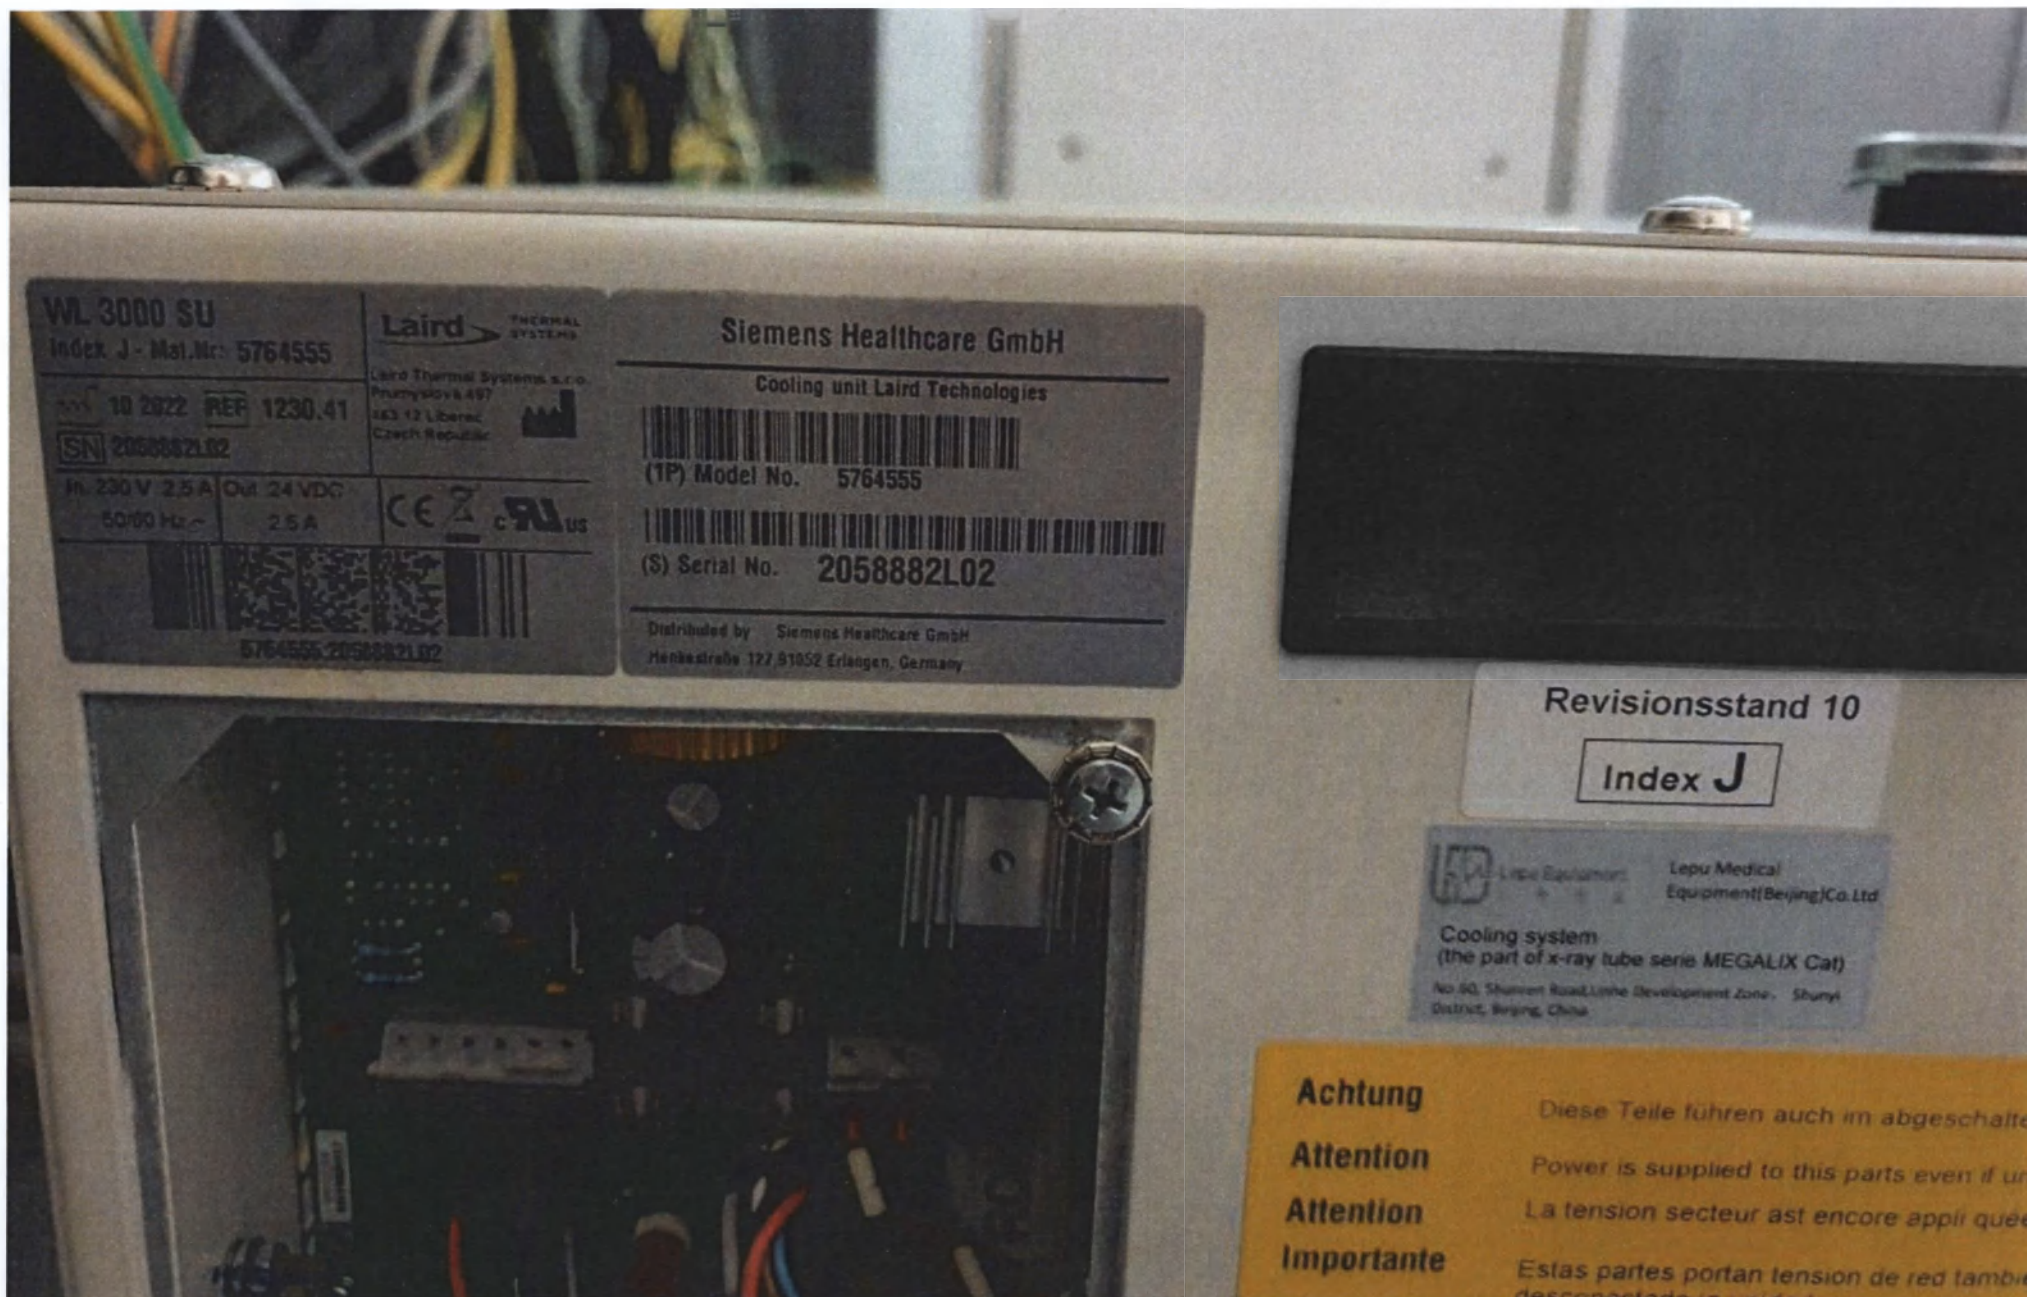


Фотография 33 – Система охлаждения излучателя рентгеновского WL 3000 SU, Siemens Healthcare GmbH (в составе рентгеновского излучателя Siemens Healthcare). Образец внешнего вида варианта маркировки

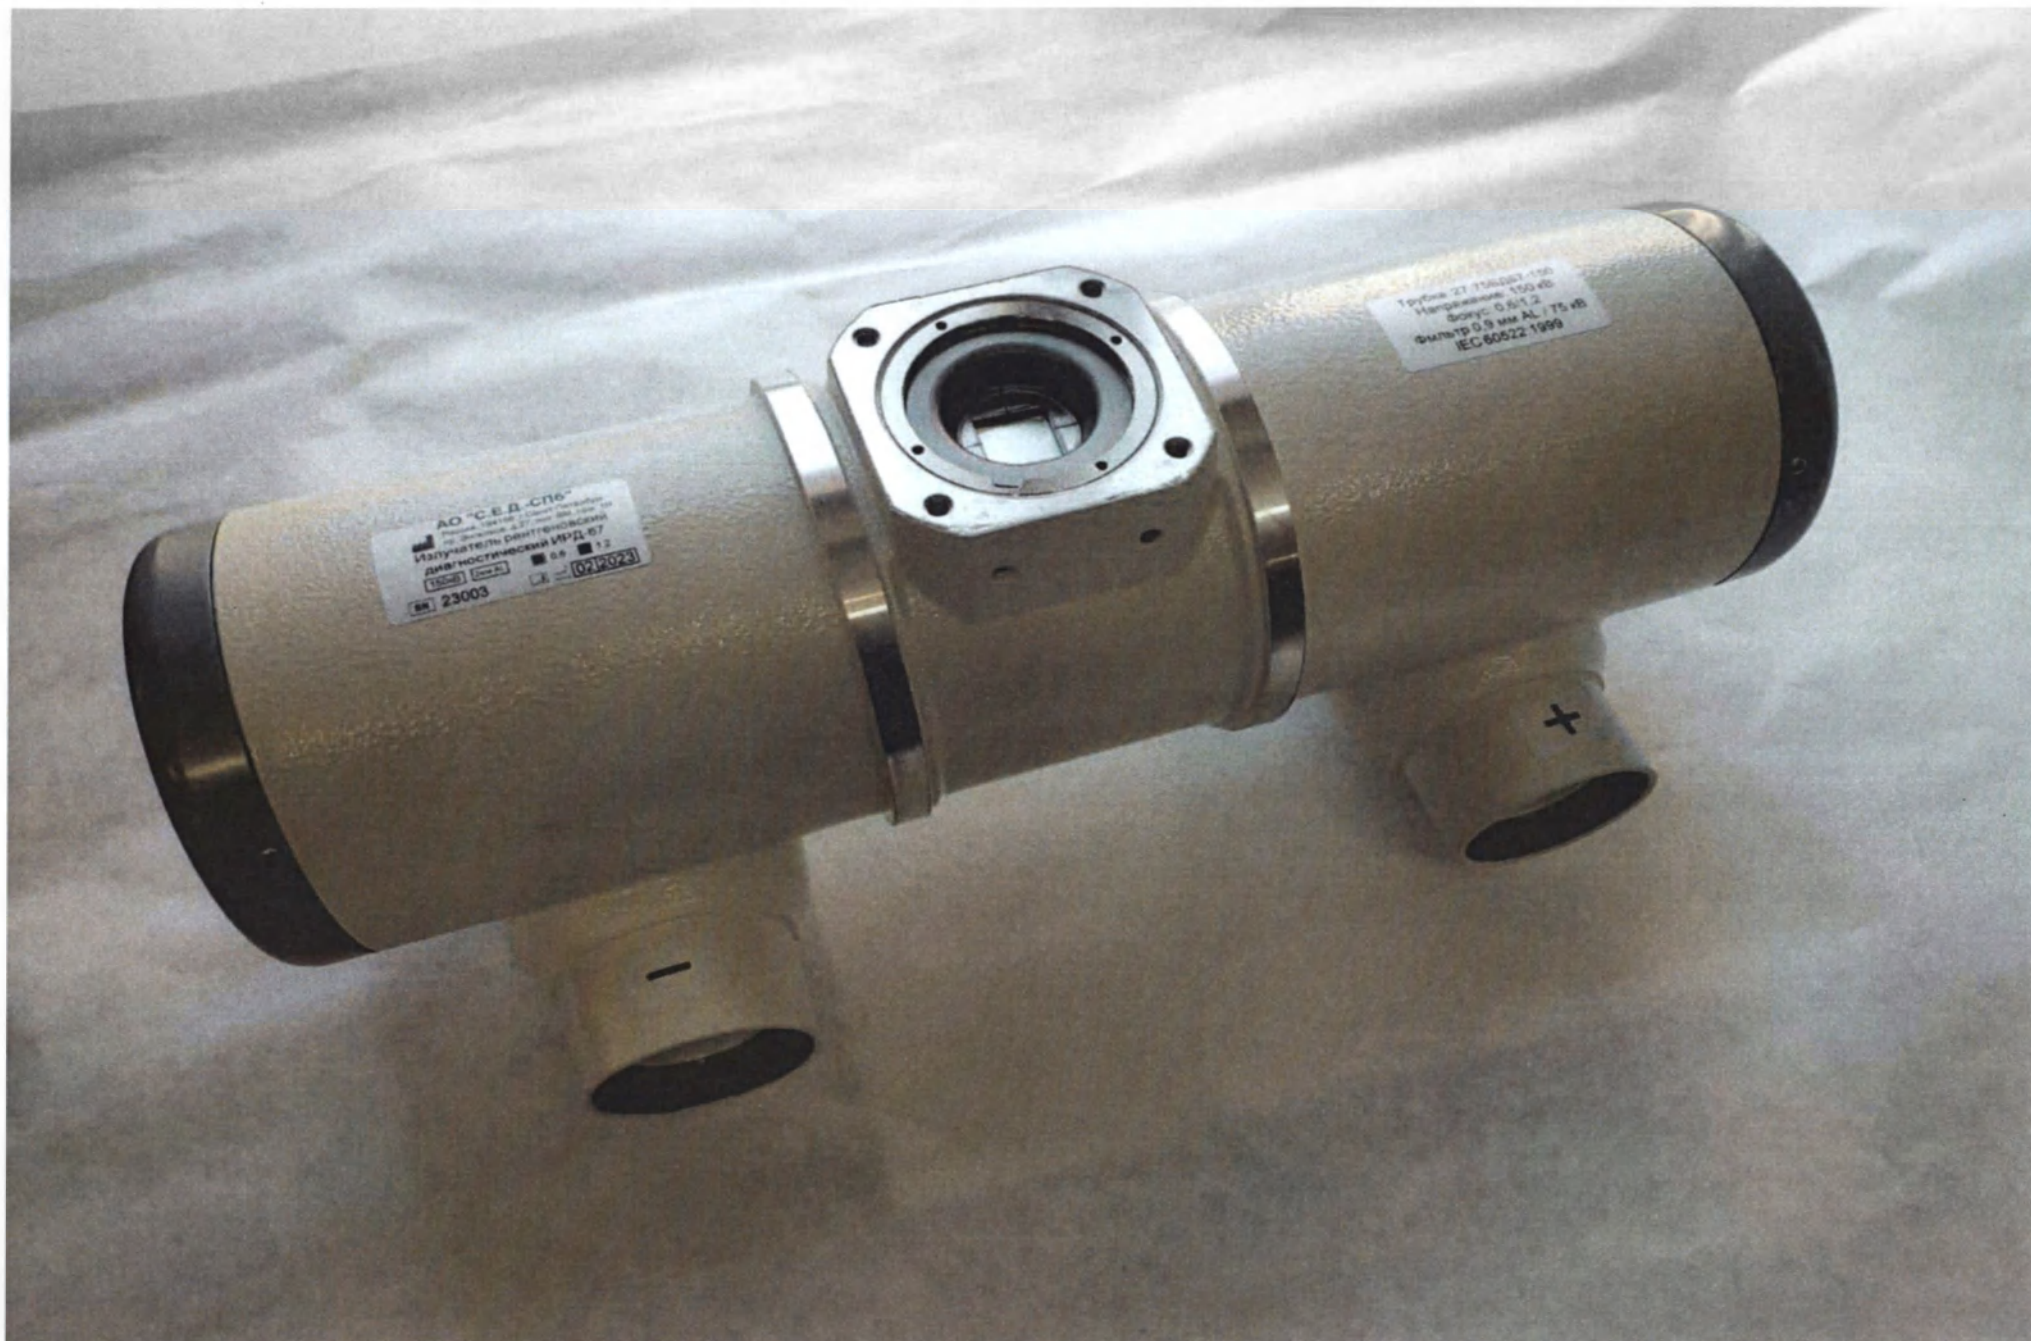


Фотография 34 – Излучатель рентгеновский серии ИРД, АО «С.Е.Д.-СПб» с трубкой рентгеновской серии БД, АО «Светлана-Рентген», Россия. Вариант внешнего вида

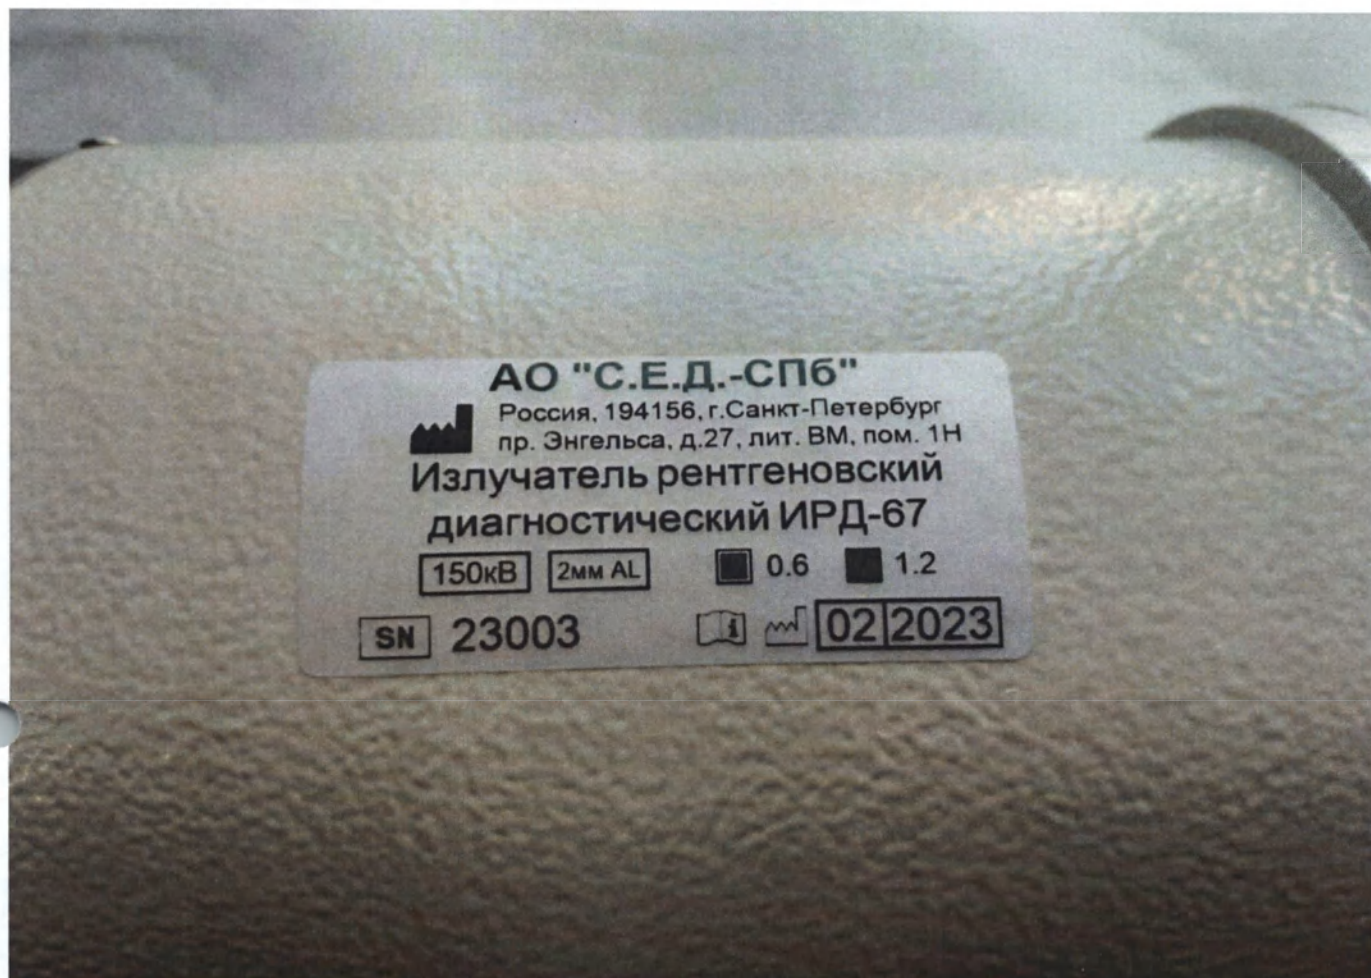

Фотография 35 – Образец внешнего вида варианта маркировки излучателя рентгеновского серии ИРД, АО «С.Е.Д.-СПб»

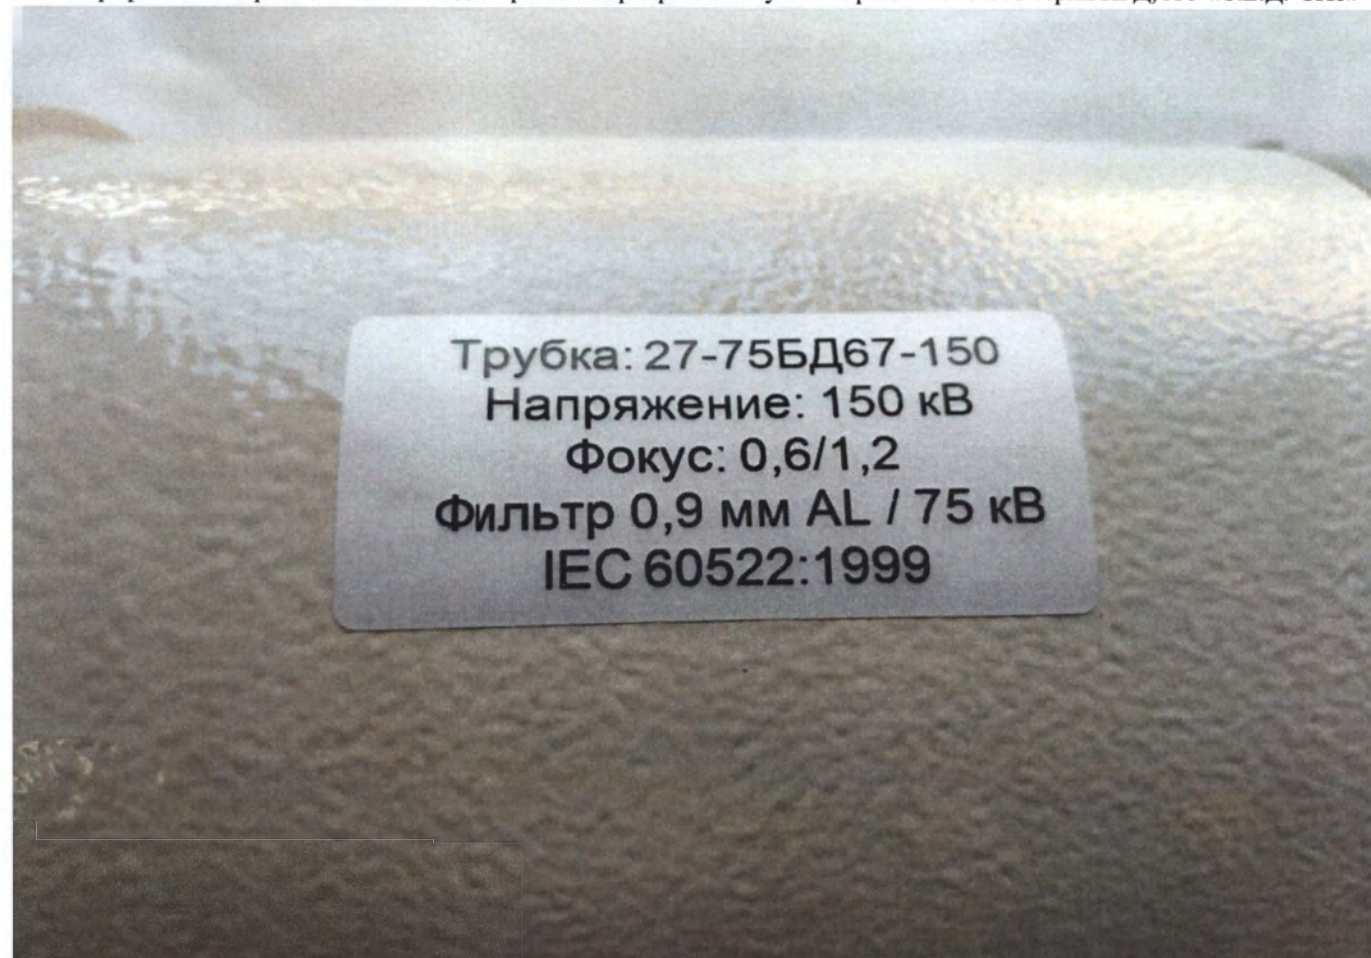


Фотография 36 – Образец внешнего вида варианта маркировки трубки серии БД, АО «Светлана-Рентген»

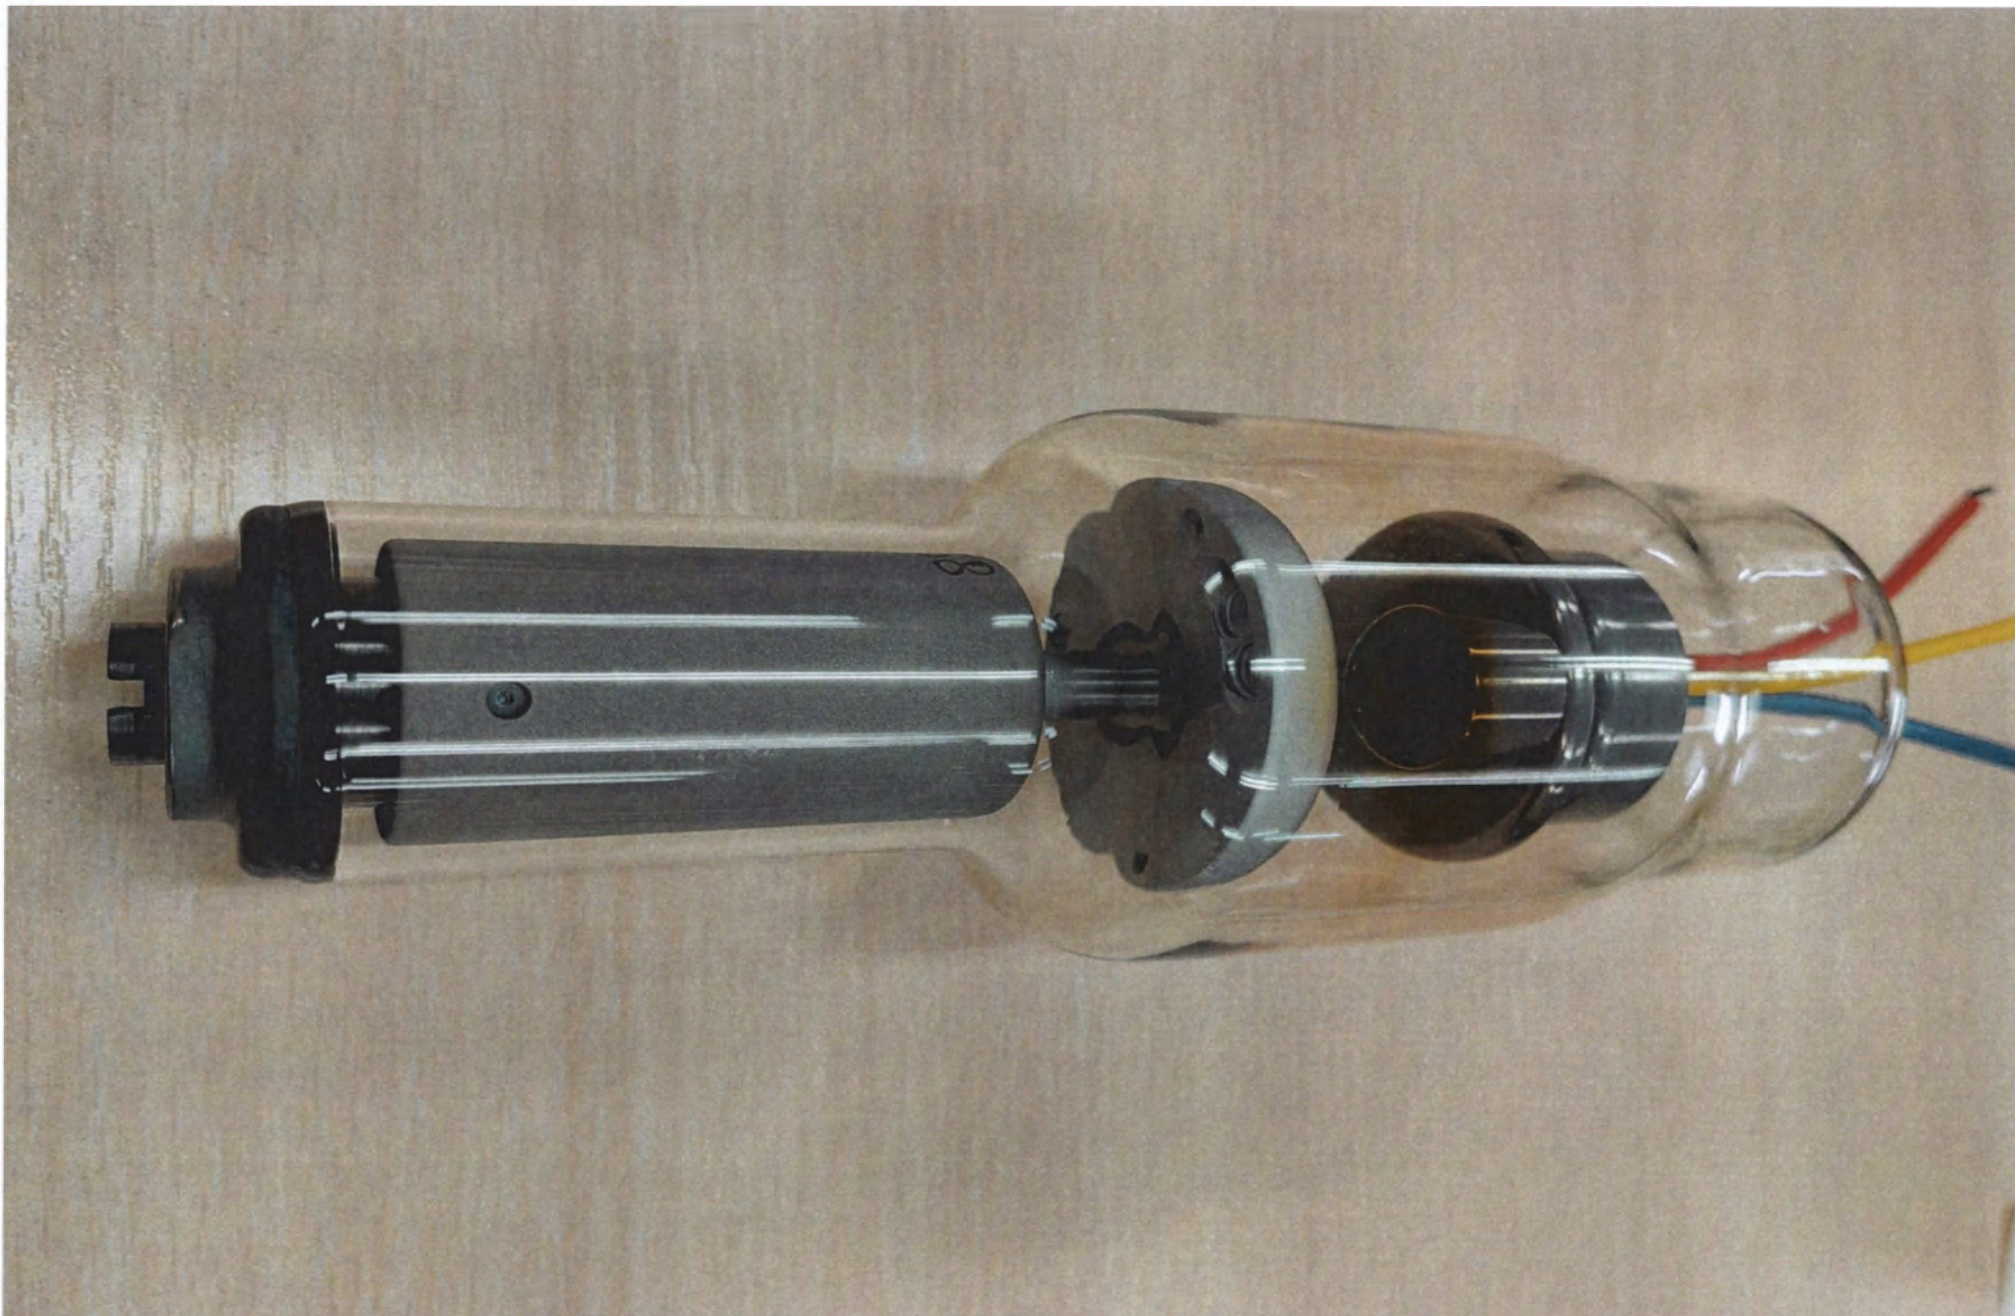

Фотография 37 – Трубка серии БД, АО «Светлана-Рентген». Вариант внешнего вида



Фотография 38 – Излучатель рентгеновский серии RAD, Varex Imaging. Вариант внешнего вида

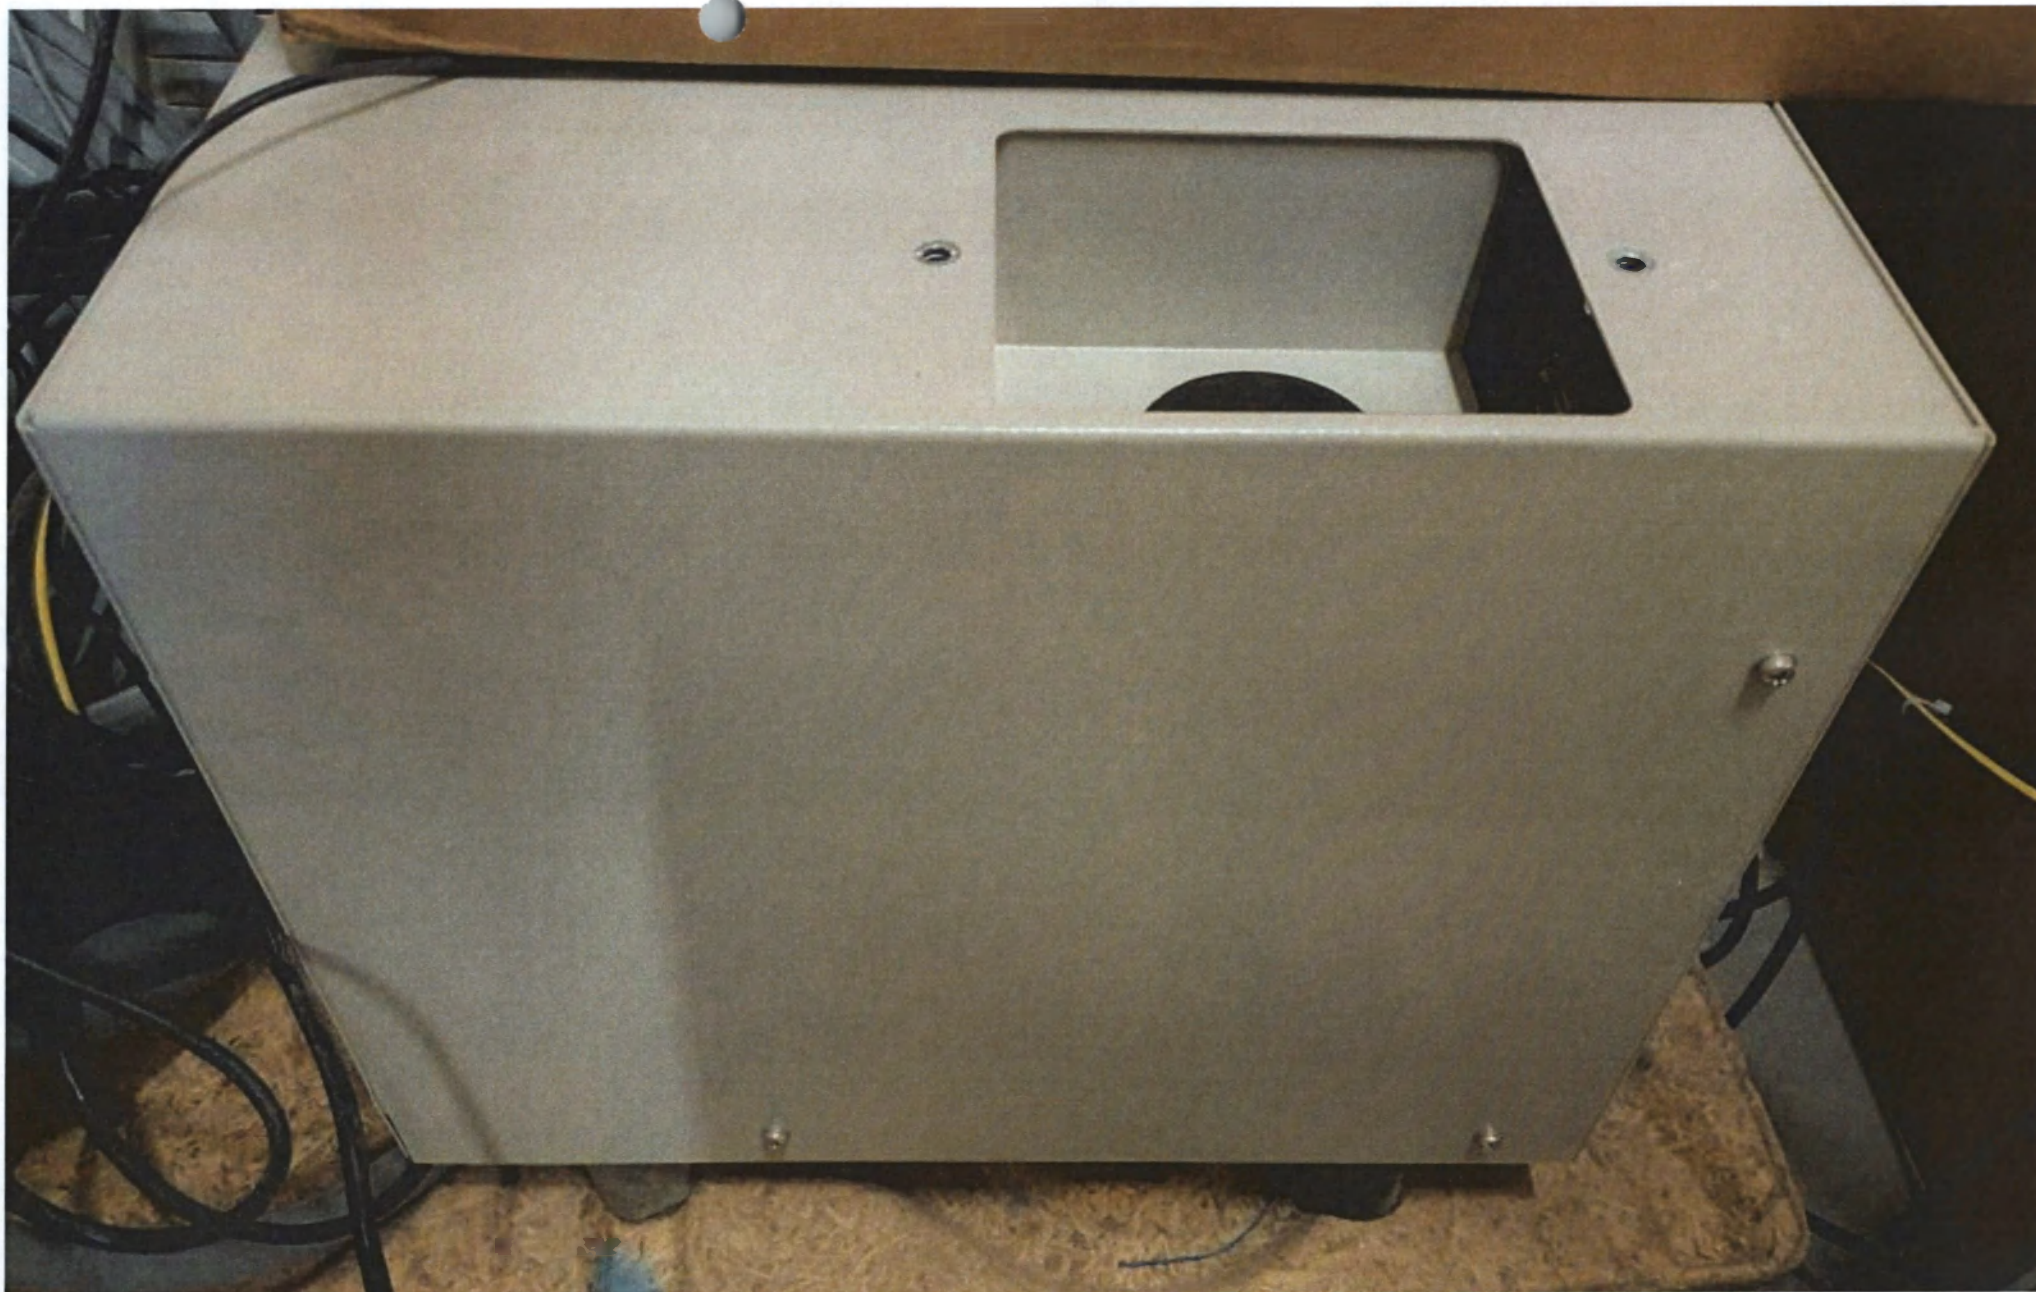


Фотография 39 – Система охлаждения излучателя рентгеновского Lytron, Varex Imaging (в составе излучателя рентгеновского). Вариант внешнего вида



Фотография 40 – Система охлаждения излучателя рентгеновского Lytron, Varex Imaging (в составе излучателя рентгеновского). Образец внешнего вида варианта маркировки




Фотография 41 – Излучатель, коллиматор и дозиметр, установленные под кофухом штатива (вариант внешнего вида)

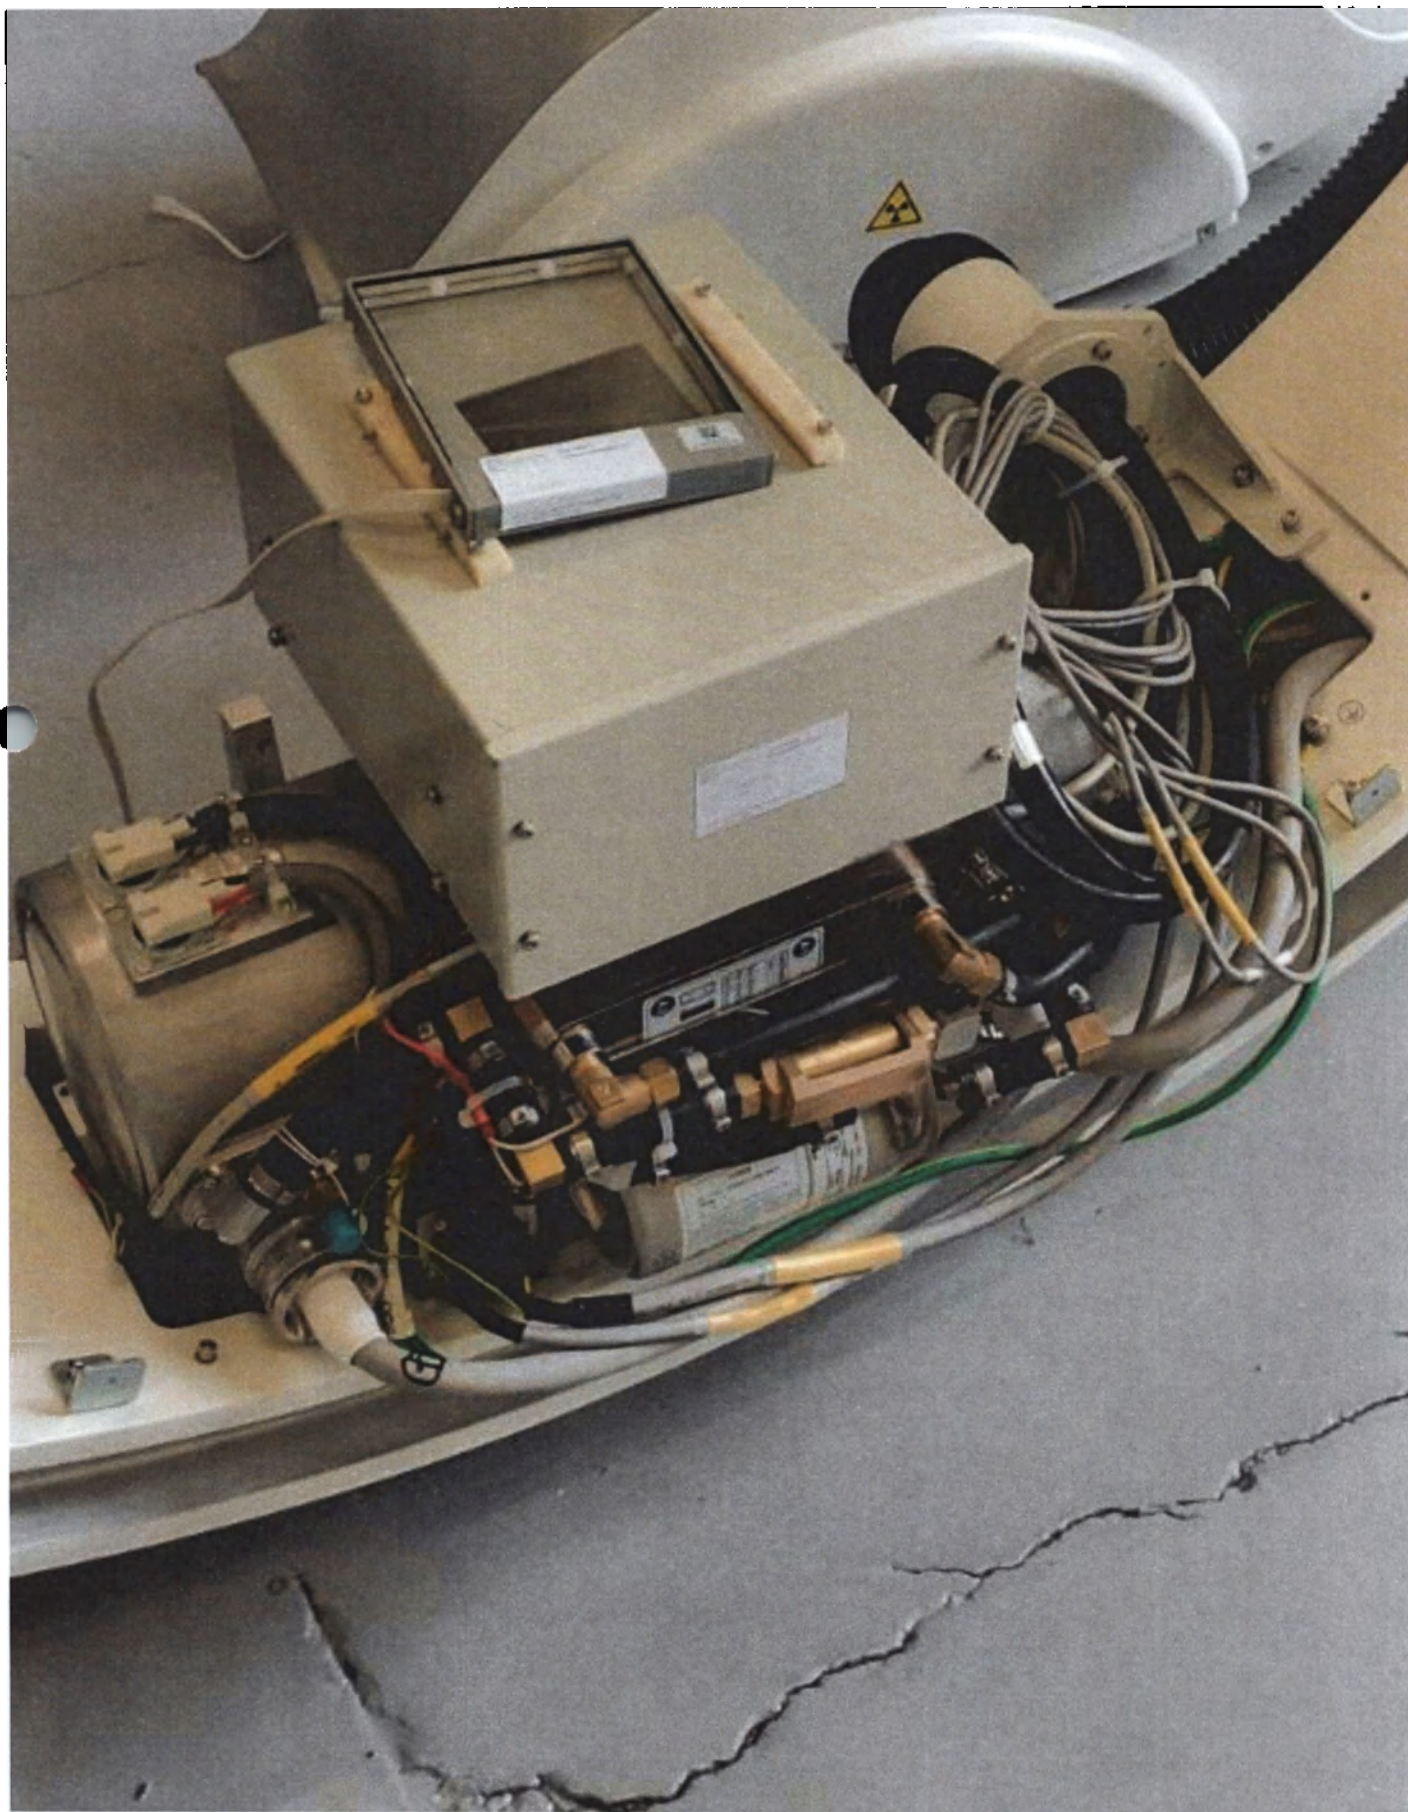

Фотография 42 – Излучатель, коллиматор и дозиметр в сборе, установленные на штатив (без кожуха). Вариант внешнего вида



Фотография 43 – Излучатель рентгеновский серии RAD, Varex Imaging и коллиматор (диафрагма) серии R 650CV, RaiCo (при эксплуатации излучатель и коллиматор закрыты кожухом штатива). Вариант внешнего вида

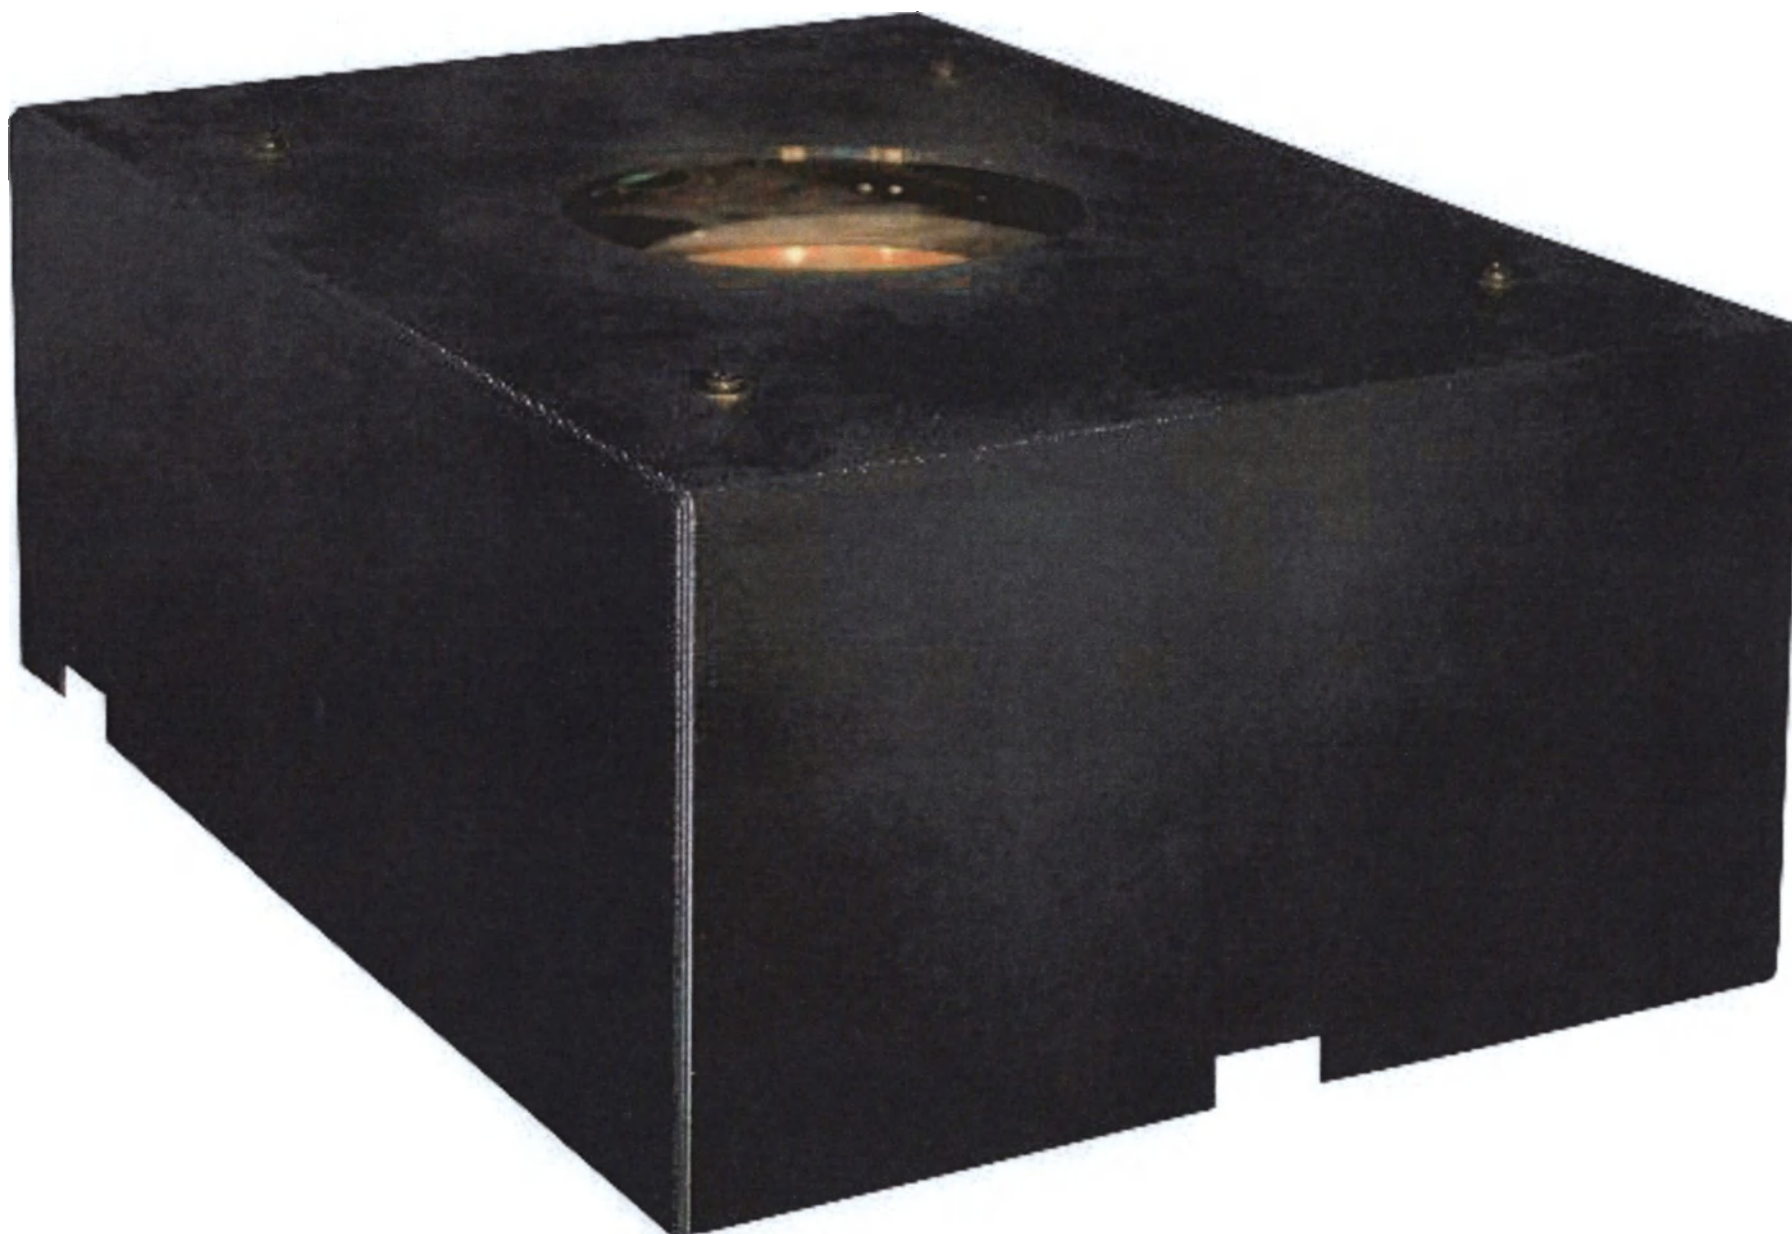


Фотография 44 – Коллиматор (диафрагма) серии R 650CV, Raico. Вариант внешнего вида




Фотография 45 – Коллиматор (диафрагма) серии R650CV, Ralco. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 46 – Коллиматор серии Ralco R 225 ACS DHHS. Образец внешнего вида варианта маркировки

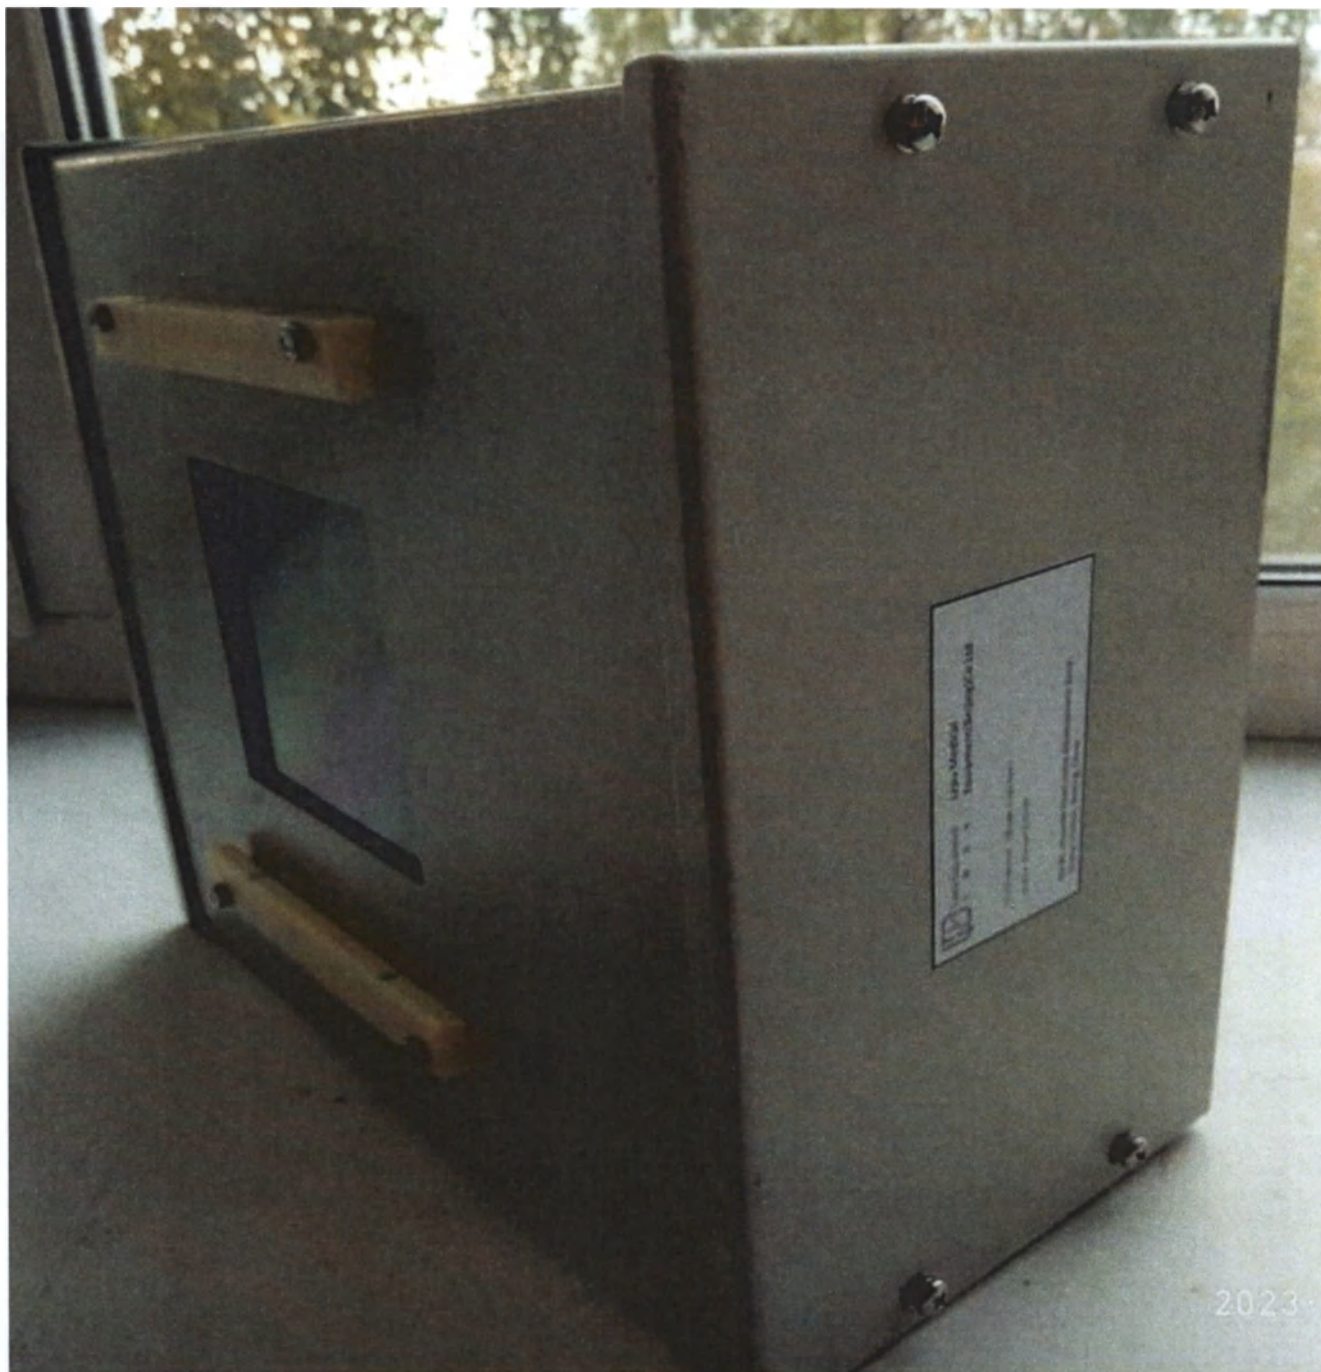

Фотография 47 – Коллиматор (диафрагма) серии Vicor-LD100, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd (при эксплуатации коллиматор закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида и место нанесения маркировки

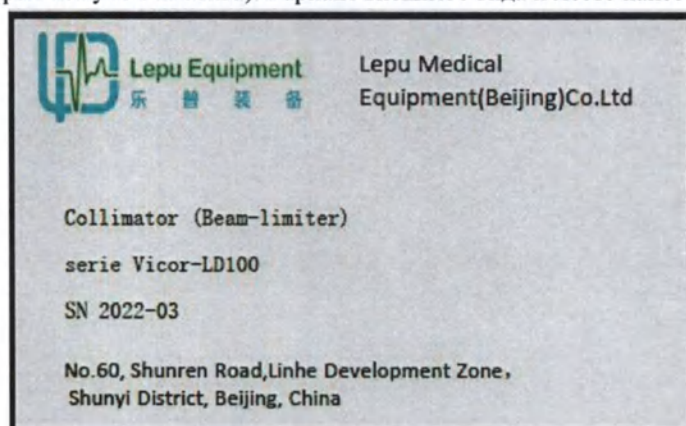

Фотография 48 – Коллиматор (диафрагма) серии Vicor-LD100. Образец внешнего вида варианта маркировки

ЭЛЕКТРОН

Стол пациента
AKR-00-4000-01

Серийный номер
Дата изготовления

NN0005313
2023-09

Обозначение МИ

AKR-00-0000-07:0:220618

Серийный номер МИ

GP0006102

Изготовитель

АО «НИПК «Электрон»

№ 20-0200-01



~220 В, 50 Гц, 5 А, IPX4



Фотография 49 – Стол пациента по спецификации AKR-00-4000, АО «НИПК «Электрон». Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 50 – Стол пациента по спецификации AKR-00-4000, АО «НИПК «Электрон» (вариант внешнего вида) в комплектации: Стол для катетеризации серии C, Omega Medical Imaging

Omega Medical Imaging, LLC.

675 Hickman Circle, Sanford, FL 32771

Made in the U.S.A

Configuration: Table for Catheterization
B-200/C300

Series: C

Serial Number: 69-16

Power: 208/220/240 ~ 15A ~ 50/60 Hz



TYPE B
IEC60601-1

Complies with 21 CFR
Subchapter J
at the date of manufacture.


IEC60601-1




Date of Manufacture: August 2016

Label P/N 0310-0041 Rev 2

Фотография 51 – Стол для катетеризации серии C, Omega Medical Imaging. Образец внешнего вида варианта маркировки

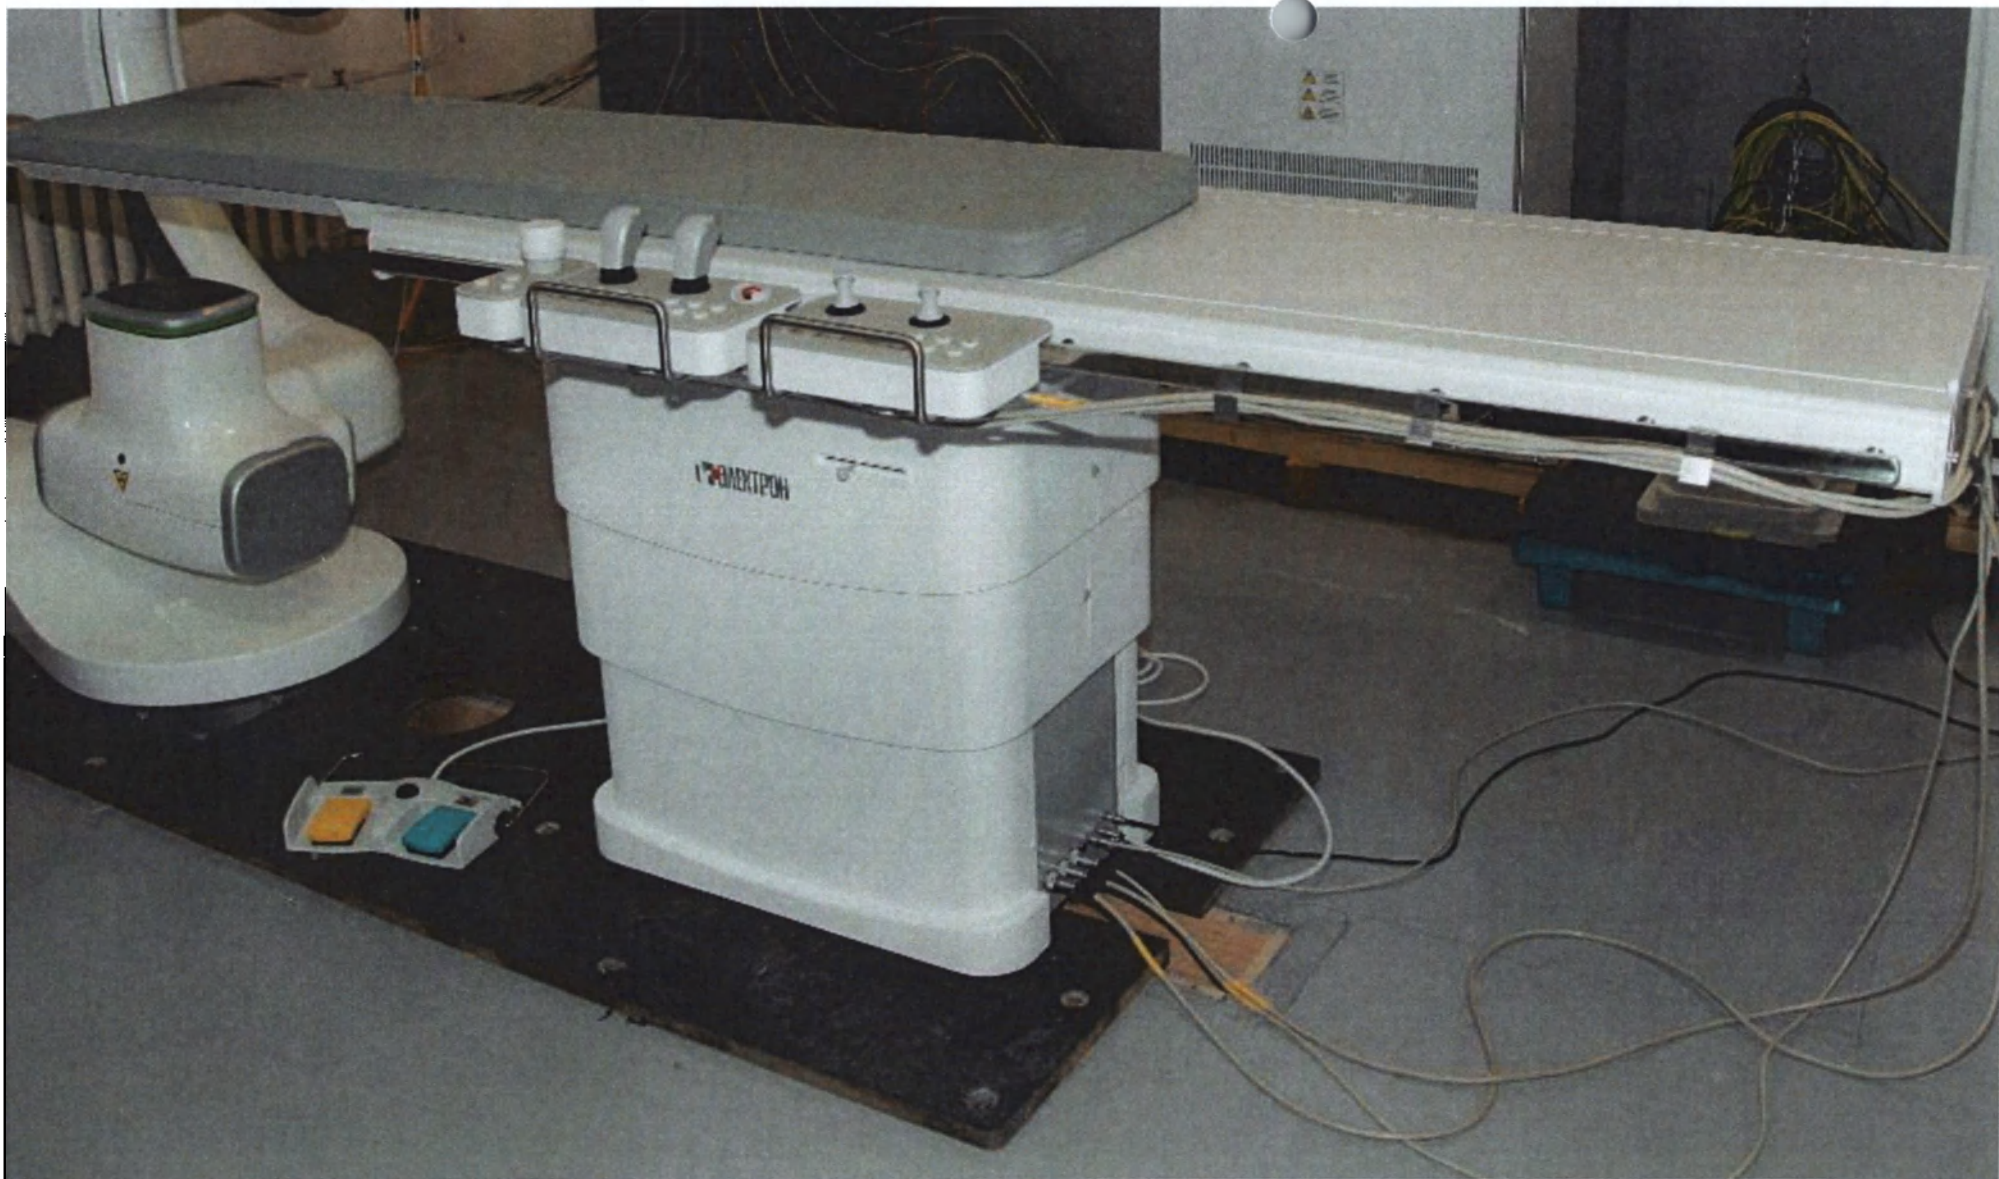

Фотография 52 – Стол пациента по спецификации AKR-00-4000, АО «НИПК «Электрон» (вариант внешнего вида) в комплектации: Стол для катетеризации серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd.

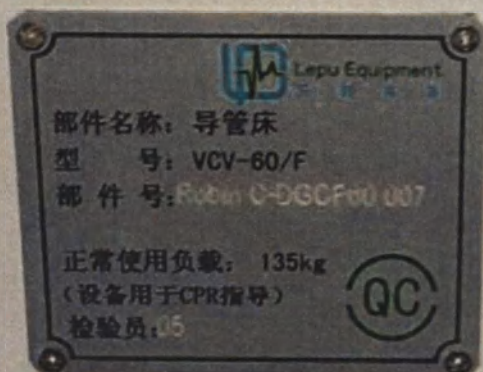


Фотография 53 – Стол для катетеризации серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 54 – Система позиционирования рентгеновская серии Roesyz XRS, Roesyz (образец, вариант исполнения)



Фотография 55 – Пульты управления стола пациента серии VCV, VCV-401, VCV-402, VCV-403, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Вариант внешнего вида

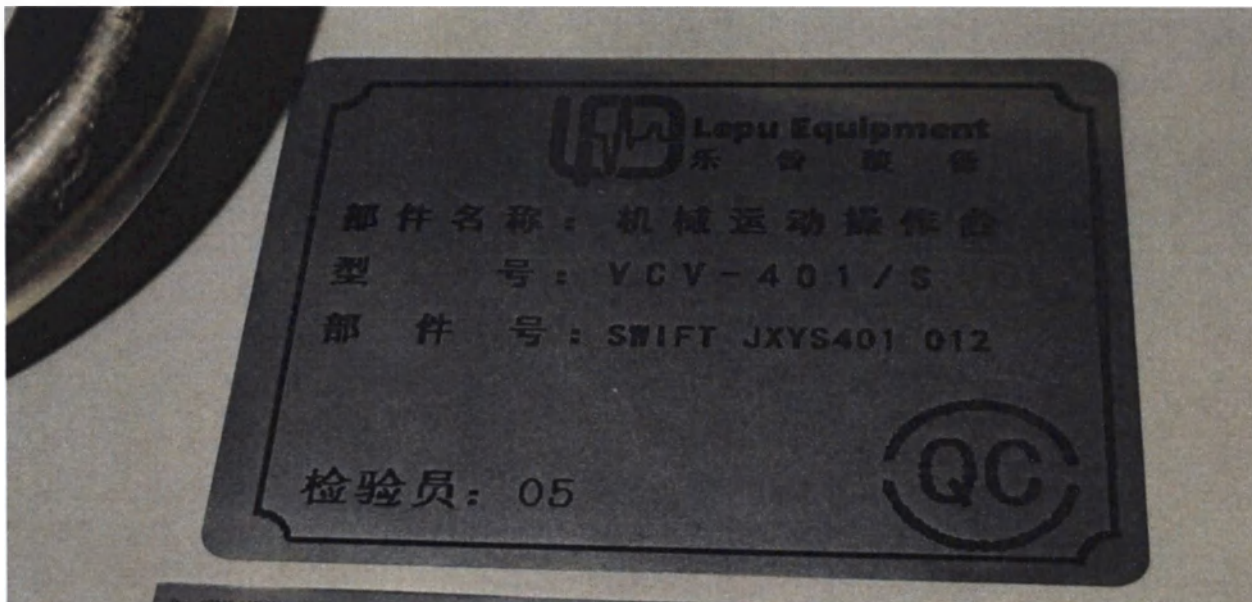

Фотография 56 – Пульт управления серии VCV-401, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 57 – Пульт управления серии VCV-402, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки




Фотография 58 – Пульт управления серии VCV-403, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 59 – Пульт управления серии VCV; VCV 414, Lery Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd, (сенсорный) с креплением. Вариант внешнего вида



Фотография 60 – Пульт управления серии VCV; VCV 414, Lery Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd, (сенсорный) с креплением. Вариант внешнего вида

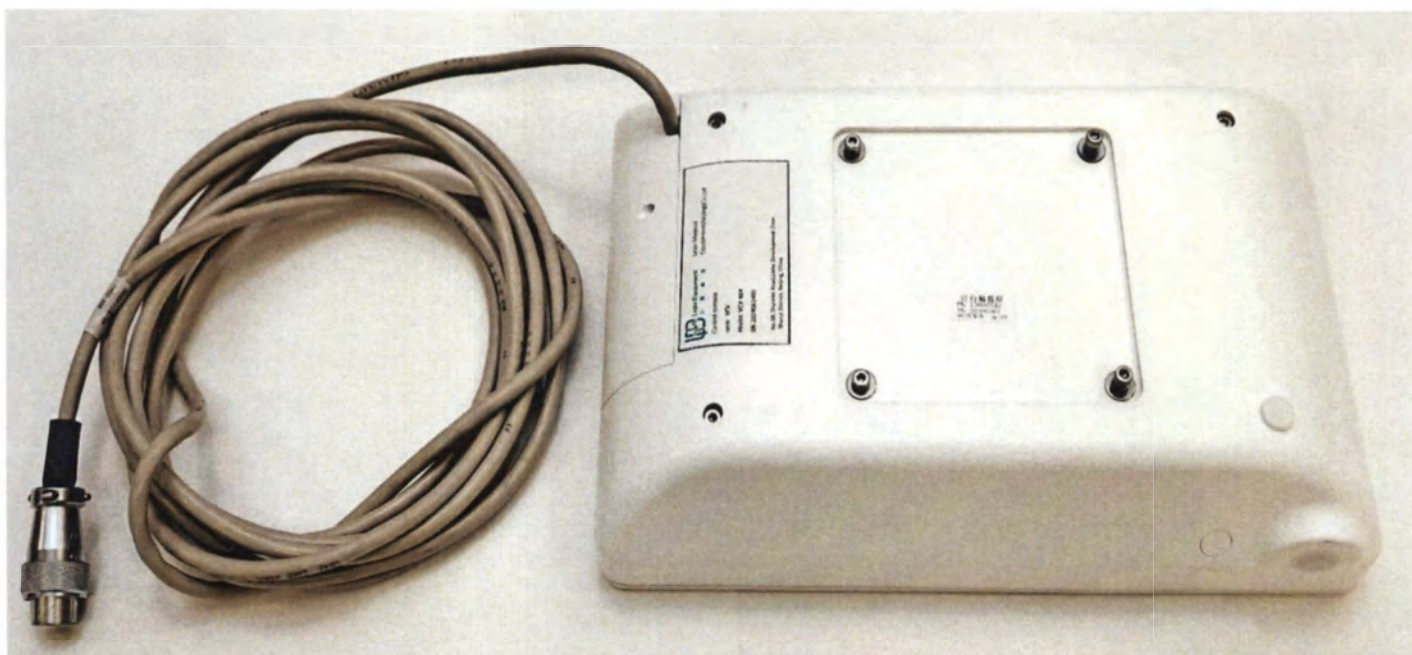

Фотография 61 – Пульт управления серии VCV; VCV 414, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd, (Вариант внешнего вида сзади, место нанесения маркировки).



Фотография 62 – Пульт управления серии VCV; VCV 414, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd, Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 63 – Устройство рентгеновское питающее. Вариант внешнего вида и место нанесения маркировки

ЭЛЕКТРОН

Устройство рентгеновское
питающее РПУ-"ОКО"
РПУ80Е (RPU80E-00-0000)

ТУ	9442-022-11150760-2006
Серийный номер	NN0005117
Дата изготовления	2023-09

Обозначение МИ AKR-00-0000-07:0:220618

Серийный номер МИ GP0006102

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"

NP 20-0600



3N~380 В, 50 Гц, 100 кВт



Фотография 64 – РПУ-«ОКО» по ТУ 9442-022-11150760-2006, АО «НИПК «Электрон», РУ № ФСР 2010/09310. Образец внешнего вида варианта маркировки

ЭЛЕКТРОН

Пульт управления
7358

Серийный номер NN0005111
Дата изготовления 2023-09

Обозначение МИ AKR-00-0000-07:0:220618

Серийный номер МИ GP0006102

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"


NP-23-0200-01



24 В



Фотография 65 – Пульт управления (в составе РПУ). Образец внешнего вида варианта маркировки

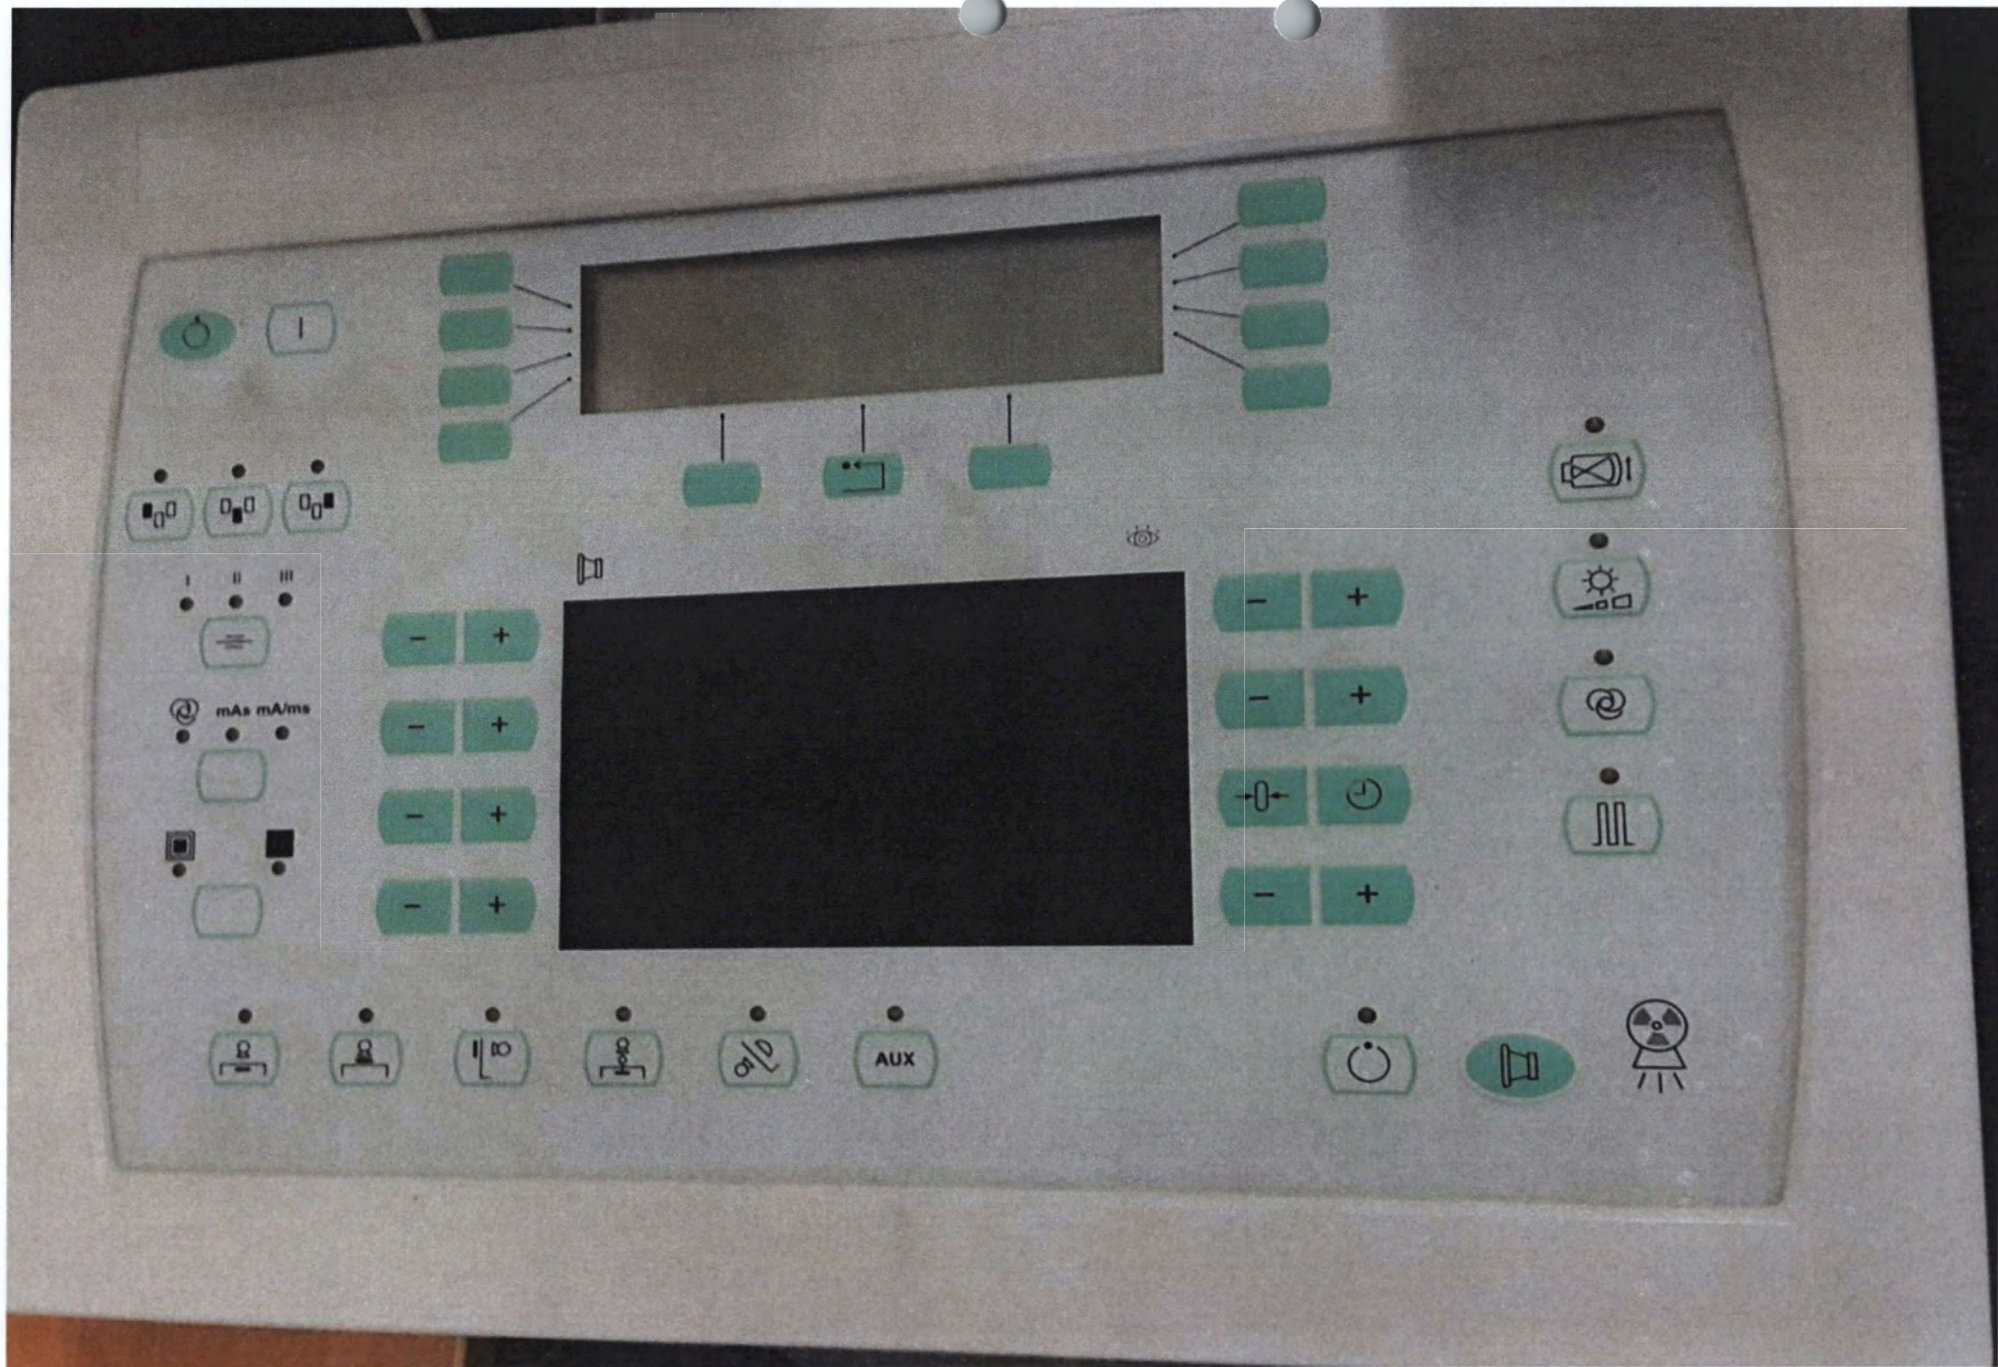

Фотография 66 – Пульт управления РПУ. Вариант внешнего вида

ЭЛЕКТРОН

Устройство рентгеновское
питающее
AKR-00-5000

Серийный номер NN1464420
Дата изготовления 2023-12

Обозначение МИ AKR-00-0000-07:0:220618

Серийный номер МИ GP0006186

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"

3N~380 В, 50 Гц, 100 кВт

NP-00-0200-01



Фотография 67 – Устройство рентгеновское питающее РПУ по спецификации АО «НИПК «Электрон» AKR-00-5000, включающей источник бесперебойного питания мощный. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 68 – Источник бесперебойного питания, Импульс. Вариант внешнего вида



Фотография 69 – Источник бесперебойного питания, модель Боксер, Импульс. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 70 – Источник бесперебойного питания модель Boxer, Makelsan, Турция. Вариант внешнего вида.



MAKELSAN®
Uninterruptible Power Supplies

www.makelsan.com.tr

TYPE : HF330120

POWER : 120 KVA

INPUT VOLTAGE : 230/400VAC

OUTPUT VOLTAGE : 230/400VAC

INPUT CURRENT : 263.0 A

OUTPUT CURRENT : 174.0 A

INPUT ORDER : 60Hz, PF = 1.0, 3 Ph + N

OUTPUT ORDER : 60Hz, PF = 0.9, 3 Ph + N

GROSS WEIGHT : 240.0 KG

DIMENSIONS : (WxL xH) 640x806x1290 mm

ICW : 26 kA



ISO 9001 : 2015 / ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018 / ISO 10002 : 2018
ISO - IEC 27001 : 2013



**MADE IN
TURKEY**



HF3301203024BX01162A

Фотография 71 – Источник бесперебойного питания модель Вохер, Makelsan, Турция. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 72 – Кабель высоковольтный с комплектом монтажных частей серии CABLE ASSY, Varex Imaging Corporation. Вариант внешнего вида



Roesys HVC model WBX-Z75-T15

From S/N: BP 2301196197

To S/N: BP 2301196198


Quantity: 2 units

Length in meter: 15M

Фотография 73 – Кабель высоковольтный Roesys HVC. Образец внешнего вида варианта маркировки



**Фотография 74 – Кабель высоковольтный с комплектом монтажных частей серии Wanbo Tianjin Wanbo Wire & Cable CO., LTD., Китай.
Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки**

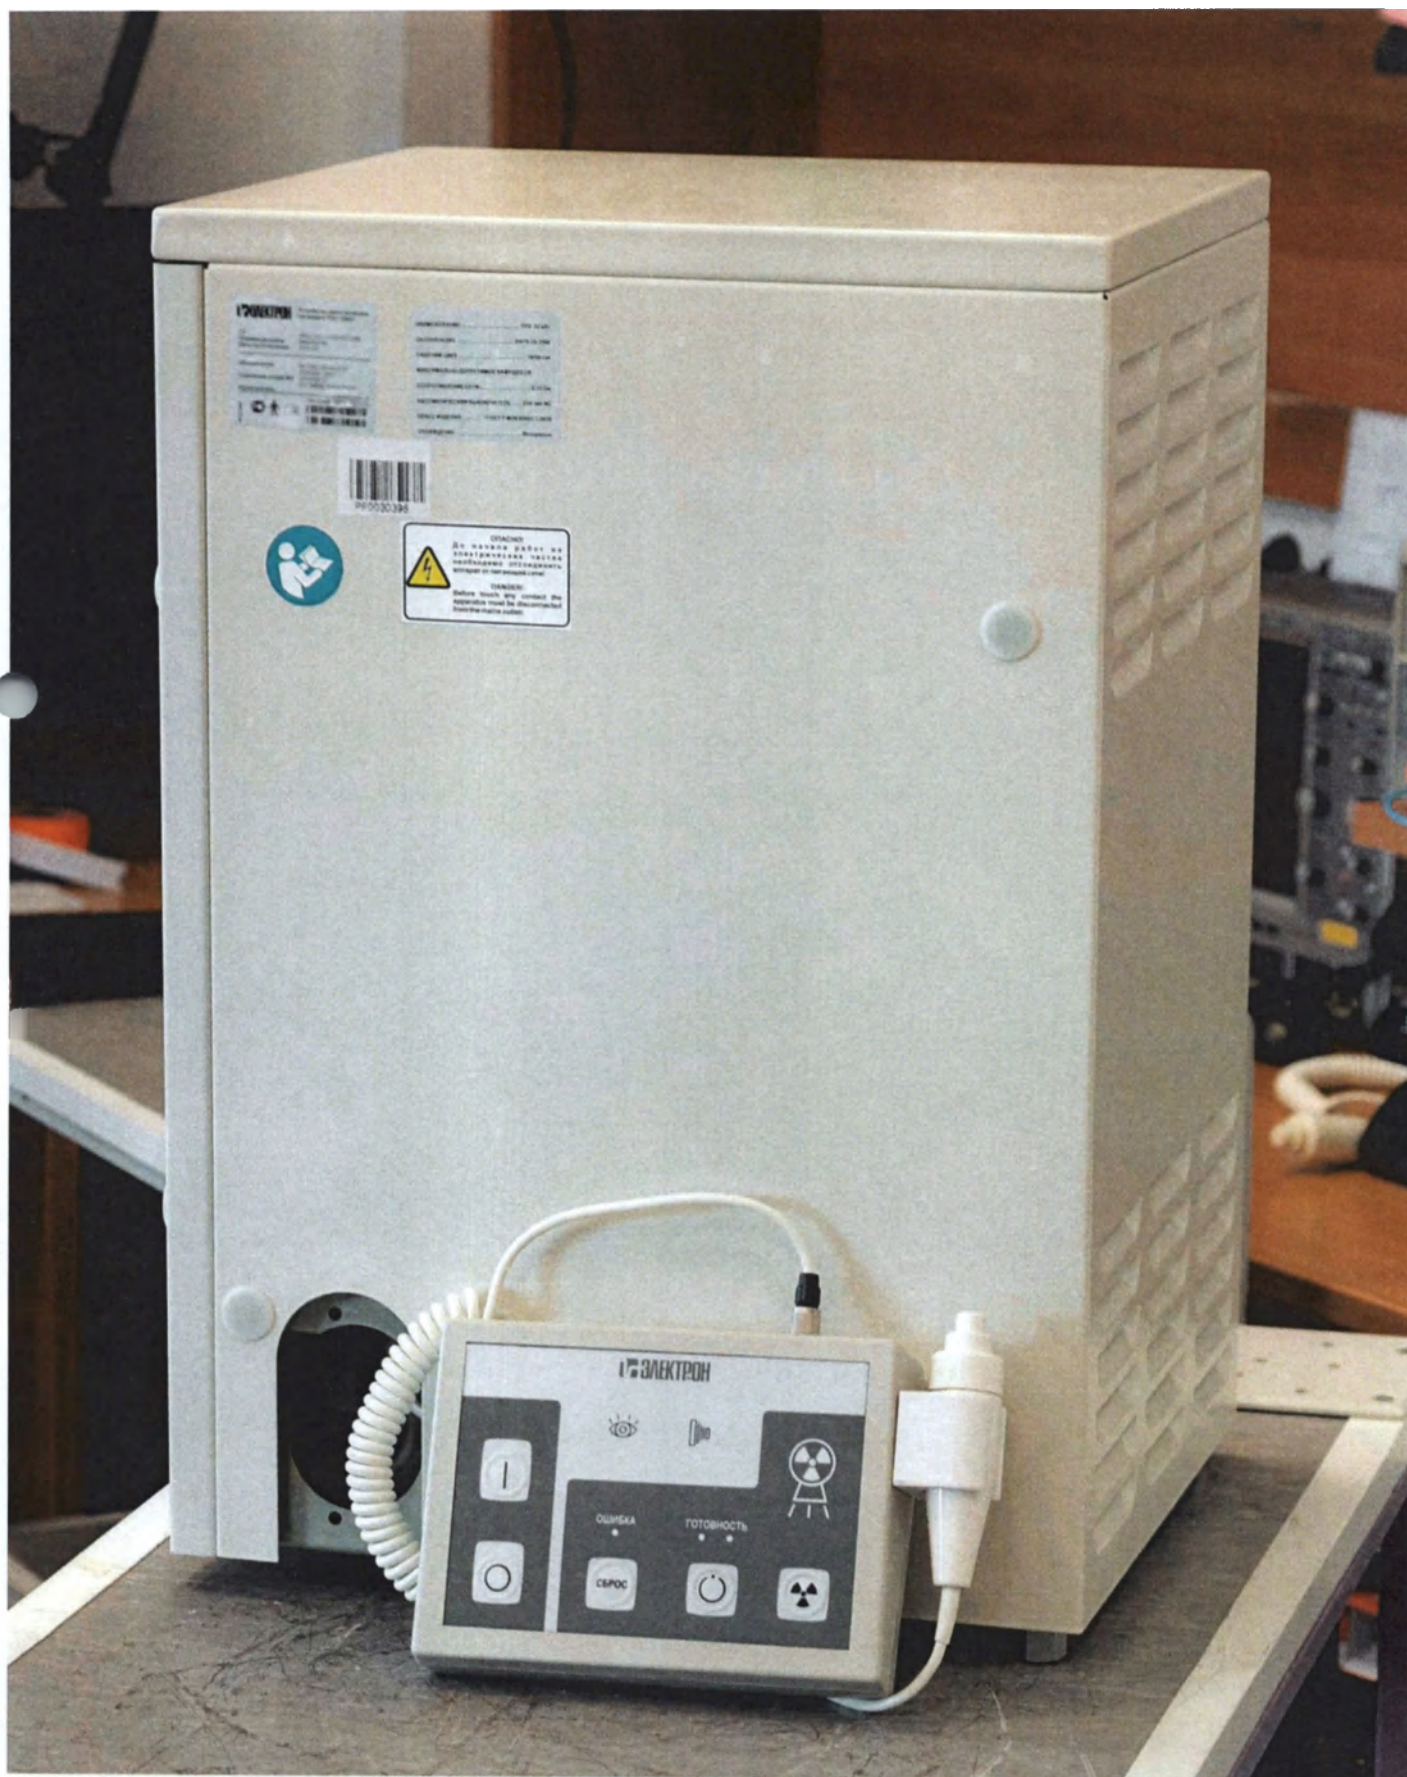

**Фотография 75 – Генератор рентгеновский XRPS-10-6380 по спецификации АО «НИПК «Электрон» с пультом управления.
Вариант внешнего вида**

ЭЛЕКТРОН

Генератор рентгеновский
XRPS-10-6380

Серийный номер NN0030390
Дата изготовления 2023-07

Обозначение МИ РПУ80Е
(RPU80E-00-0000)
Серийный номер МИ GP0006186


Изготовитель АО «НИПК «Электрон»

3N~380В, 50 Гц, 100 кВА

ИФ-20-0200-02



Фотография 76 – Генератор рентгеновский XRPS-10-6380 АО «НИПК «Электрон». Образец внешнего вида варианта маркировки

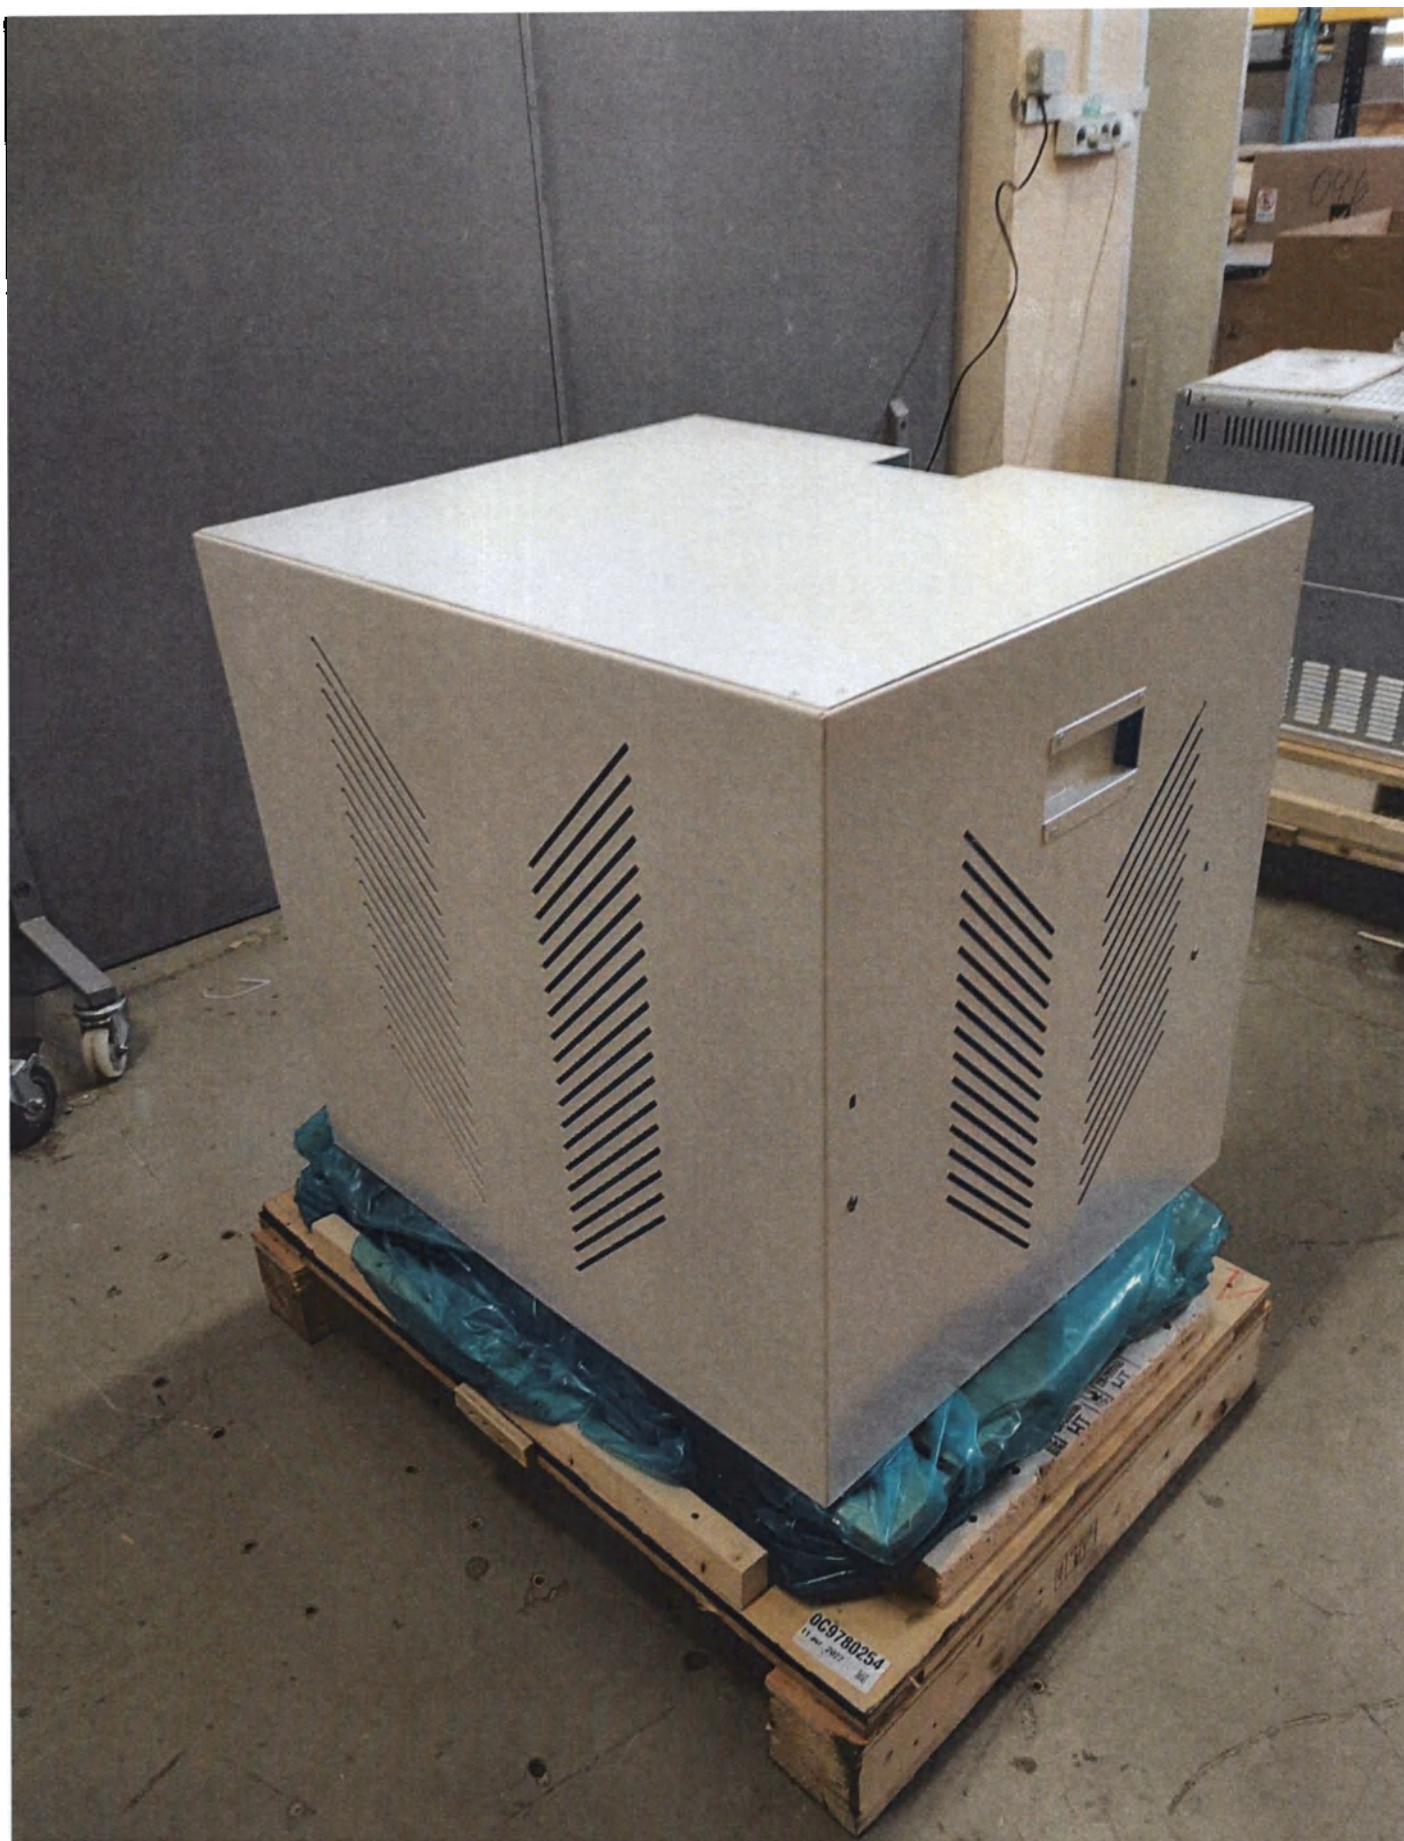

Фотография 77 – Генератор рентгеновский серии EPS, Emd Technologies. Вариант внешнего вида

 **Emd Technologies**
400 du Parc
Saint-Eustache (Quebec)
Canada, J7R 0A1

Epsilon High Voltage X-Ray Generator

REF/Model: EPS 45-80
Configuration: **EPS ETA 50R**

PN: **10000.368**
SN: **22-E0077**



IEC 60601-1, CLASS I, TYPE B



Manufactured:
May 2022



MADE IN CANADA

9912.00.S8

ETL CLASSIFIED



Intertek
58611

Medical Electrical Equipment

CE
0413

This product complies with DHHS radiation performances of 21 CFR, Sub-chapter J in effect at date of manufacturing.

EMD's High Voltage Generators are protected by one or more claims of EMD's United States Patent Number 7,936,544, 6,738,275, 6,967,559 and 7,375,993 and EMD's European Patent 1 102 388 B1. Additional EMD patent applications pertinent to the product are pending.



9913.04

Фотография 78 – Генератор рентгеновский серии EPS, Emd Technologies. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 79 – Генератор рентгеновский серии Cetus, High Voltage Tech. Вариант внешнего вида

HVT X-RAY GENERATOR

HVT X线高压发生器

MODEL

型号: Cetus 80R01 PN: 03490014

SN

产品序列号: CE0809100831222001



Manufactured: 生产日期: 2022-9-16

CLASS I - CONTINUOUS OPERATION WITH INTERMITTENT LOADING

I类 间歇加载 连续运行

Refer to Service Manual for Power Line Ratings

电源要求请参考服务手册



Made in China by High Voltage Technologies

Room 406, Building 24, No. 588, Xijunhuan Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China

海瑞电子科技(上海)有限公司 上海市闵行区新骏环路588号24号楼406室 中国制造

Фотография 80 – Генератор рентгеновский серии Cetus, High Voltage Tech. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 81 – Генератор рентгеновский серии PROGEN, Listem Corporation. Вариант внешнего вида

고전압 발생장치
HIGH-VOLTAGE GENERATOR

LISTEM

모델명 Model	PROGEN-650RH		
제조번호 Serial Number	SN	0076	제조일자 Data
전원전압 Supply Voltage	380	V	3 ~ 50/60 Hz 80 kVA
정격 Rating	-	mA	- kVp
	640	mA	100 kVp
	400	mA	150 kVp
제조사 Manufacturer	 주식회사 리스템 LISTEM Corporation		

주소
Address

26365, 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 94
94, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Won
ju-si, Gangwon-do, 26365, Republic of Korea
Tel : +82-1577-8522 / Fax : +82-2-860-9530
www.listem.co.kr

90 KR



Фотография 82 – Генератор рентгеновский серии PROGEN, Listem Corporation. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 83 – Генератор рентгеновский серии OPERA, Communications & Power Industries Canada Inc. Вариант внешнего вида



UDI

(01)00885310000038

(21)CPD42104M22

SYSTEM PART NO.:

VZW2556RB2-YK

SYSTEM SN.:

CPD42104M22

SYSTEM ACCESSORY LISTING
(per factory configuration)

CONSOLE SN:

HV MODULE SN:

G0440576M22

ADR SYSTEM SN:

SYSTEM CONTAINS

FIRMWARE

PART NO.:

90176400

REVISION:

AM

COMPATIBLE WITH

SYSTEM MODEL :

VZW2556RB2-YK

RoHS

MANUFACTURED FOR

General Medical Merate S.p.A.

24068 SERIATE (BG) - ITALIA

BY

Communications & Power Industries Canada Inc.
45 River Drive, Georgetown, Ontario, Canada, L7G 2J4

MADE IN CANADA

MODEL NO.: VZW2556RB2-YK

SERIES: Opera G500DR

PART NO.: 95113818

SERIAL NO.: CPD42104M22

MFG. DATE: December 2022

VOLTS AC: 400/480

	MOMENTARY	NOMINAL
AMPS AC:	100/80	5

FREQ:	50/60 Hz	PHASE:	3
-------	----------	--------	---

COMPLIES WITH IEC 60601-2-54: 2009
& CDRH RADIATION PERFORMANCE
STANDARD 21 CFR, SUBCHAPTER J

Фотография 84 – Генератор рентгеновский серии OPERA, Communications & Power Industries Canada Inc. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 85 – Генератор рентгеновский серии Indico IQ, Communications & Power Industries Canada Inc. Вариант внешнего вида

系统所含软件

配件号码:

90940700

版本:

B

兼容系统型号:

VZW2558FJ812

SYSTEM CONTAINS
SOFTWARE

PART NO.:

90940700

REVISION:

B

COMPATIBLE WITH
SYSTEM MODEL:

VZW2558FJ812

RoHS

生产商

CPI

Communications
& Power Industries

45 River Drive, Georgetown, Ontario, 加拿大, L7G 2J4
加拿大制造

型号: VZW2558FJ812
配置: -05
系列: INDICO IQ X射线诊断高压发生装置
部件号码: VZW2558FJ812-05
序列号: AMQ03375J21
生产日期: 2021年09月
交流电压(V): 400-480

	瞬间值	标称值
交流电流(A):	220-170	4
频率:	50/60 Hz	相数: 3

符合IEC标准 60601-2-54: 2009 以及
CDRH 放射性能标准
21 CFR, 子章节 J

RoHS

MANUFACTURED BY

CPI

Communications
& Power Industries

45 River Drive, Georgetown, Ontario, Canada, L7G 2J4
MADE IN CANADA

MODEL NO.: VZW2558FJ812
CONFIGURATION: -05
SERIES: INDICO IQ RF 100kW
PART NO.: VZW2558FJ812-05
SERIAL NO.: AMQ03375J21
MFG. DATE: September 2021
VOLTS AC: 400-480

	MOMENTARY	NOMINAL
AMPS AC:	220-170	4
FREQ: 50/60 Hz	PHASE: 3	

COMPLIES WITH IEC 60601-2-54: 2009
& CDRH RADIATION PERFORMANCE
STANDARD 21 CFR, SUBCHAPTER J

产品名称 高压发生器

有效期限: 10年

工作方式: 间歇加载, 连续运行

类别: I类

其他内容详见说明书



注意高压



查阅随机文件

PRODUCT NAME: Diagnostic X-Ray Generator

EXPIRY DATE: 10 Years

MODE OF OPERATION: Continuous operation with intermittent loading

CLASSIFICATION: CLASS I

OTHER CONTENTS REFER TO MANUAL FOR DETAILS




CAUTION HIGH VOLTAGE



REFER TO RELATED FILE

Фотография 86 – Генератор рентгеновский серии Indico IQ, Communications & Power Industries Canada Inc. Образец внешнего вида варианта маркировки

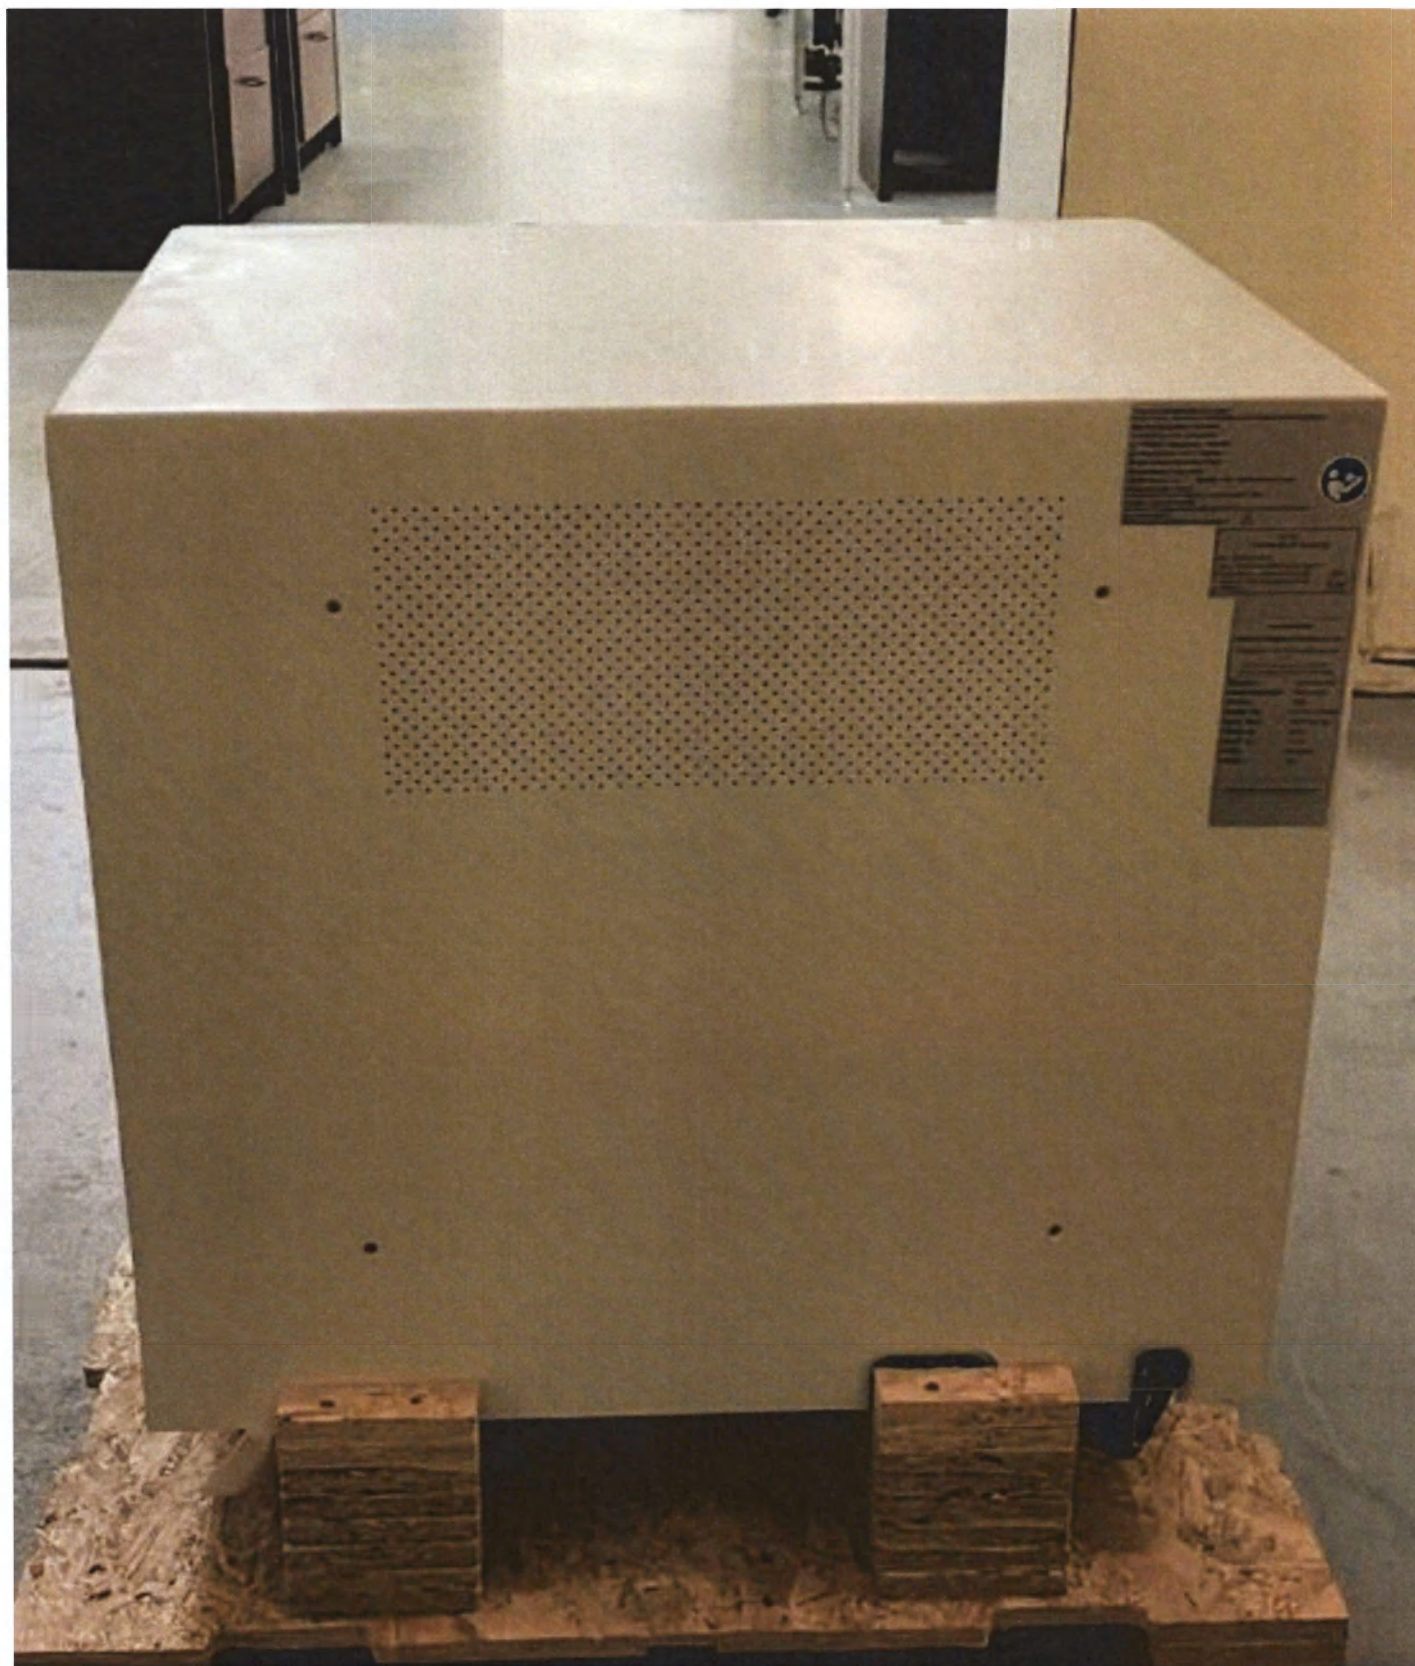

Фотография 87 – Генератор рентгеновский серии PSG, Suzhou Powersite Electric Co., Ltd. Вариант внешнего вида



产品名称: 医用X射线高频高压发生器组件
Product Name: Medical X-ray High Frequency High Voltage Generator Assembly
规格/型号Configuration: PSG-HR65L
产品序列号Serial No.: 03102211009
生产日期Date of Manufacture: 2023/04/27
输入电压Input Volts: 380V 3N~ 50/60Hz
最大输入功率Max Input Power: 110kVA
待机功率Standby Power: 700VA
整机版本Version:V1.0 使用期限: 10年 Validity Period: 10 Years
按防电击类型分类: I类设备
Classification by Type of Electric Shock Protection: Class I
运行模式: 连续运行间歇加载
Classified by Operation Mode: Continuous operation under intermittent loading
其他内容详见说明书
Refer to Instructions for Use for more details.



Фотография 88 – Генератор рентгеновский серии PSG, Suzhou Powersite Electric Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки




Фотография 89 – Генератор рентгеновский серии R, Odel s.r.l. Вариант внешнего вида

		 Odel s.r.l. Via Lavoratori Autobianchi, 1 Lotto 24B - 20832 Desio (MB) - ITALY	
H.V. Generator		Program HF US3	
REF		R306.48	
SN		5404-F23	
UDI  (01)08051380400081(21)5404F23			
Continuous power		800 VA	
Intermittent power		150 kVA	
 IT [2023/06]	400V $\pm$ 10% 50-60Hz 3~		
	 e-IFU indicator (CDROM)		

2023-08-22 15:13

Фотография 90 – Генератор рентгеновский серии R, Odel s.r.l. Образец внешнего вида варианта маркировки

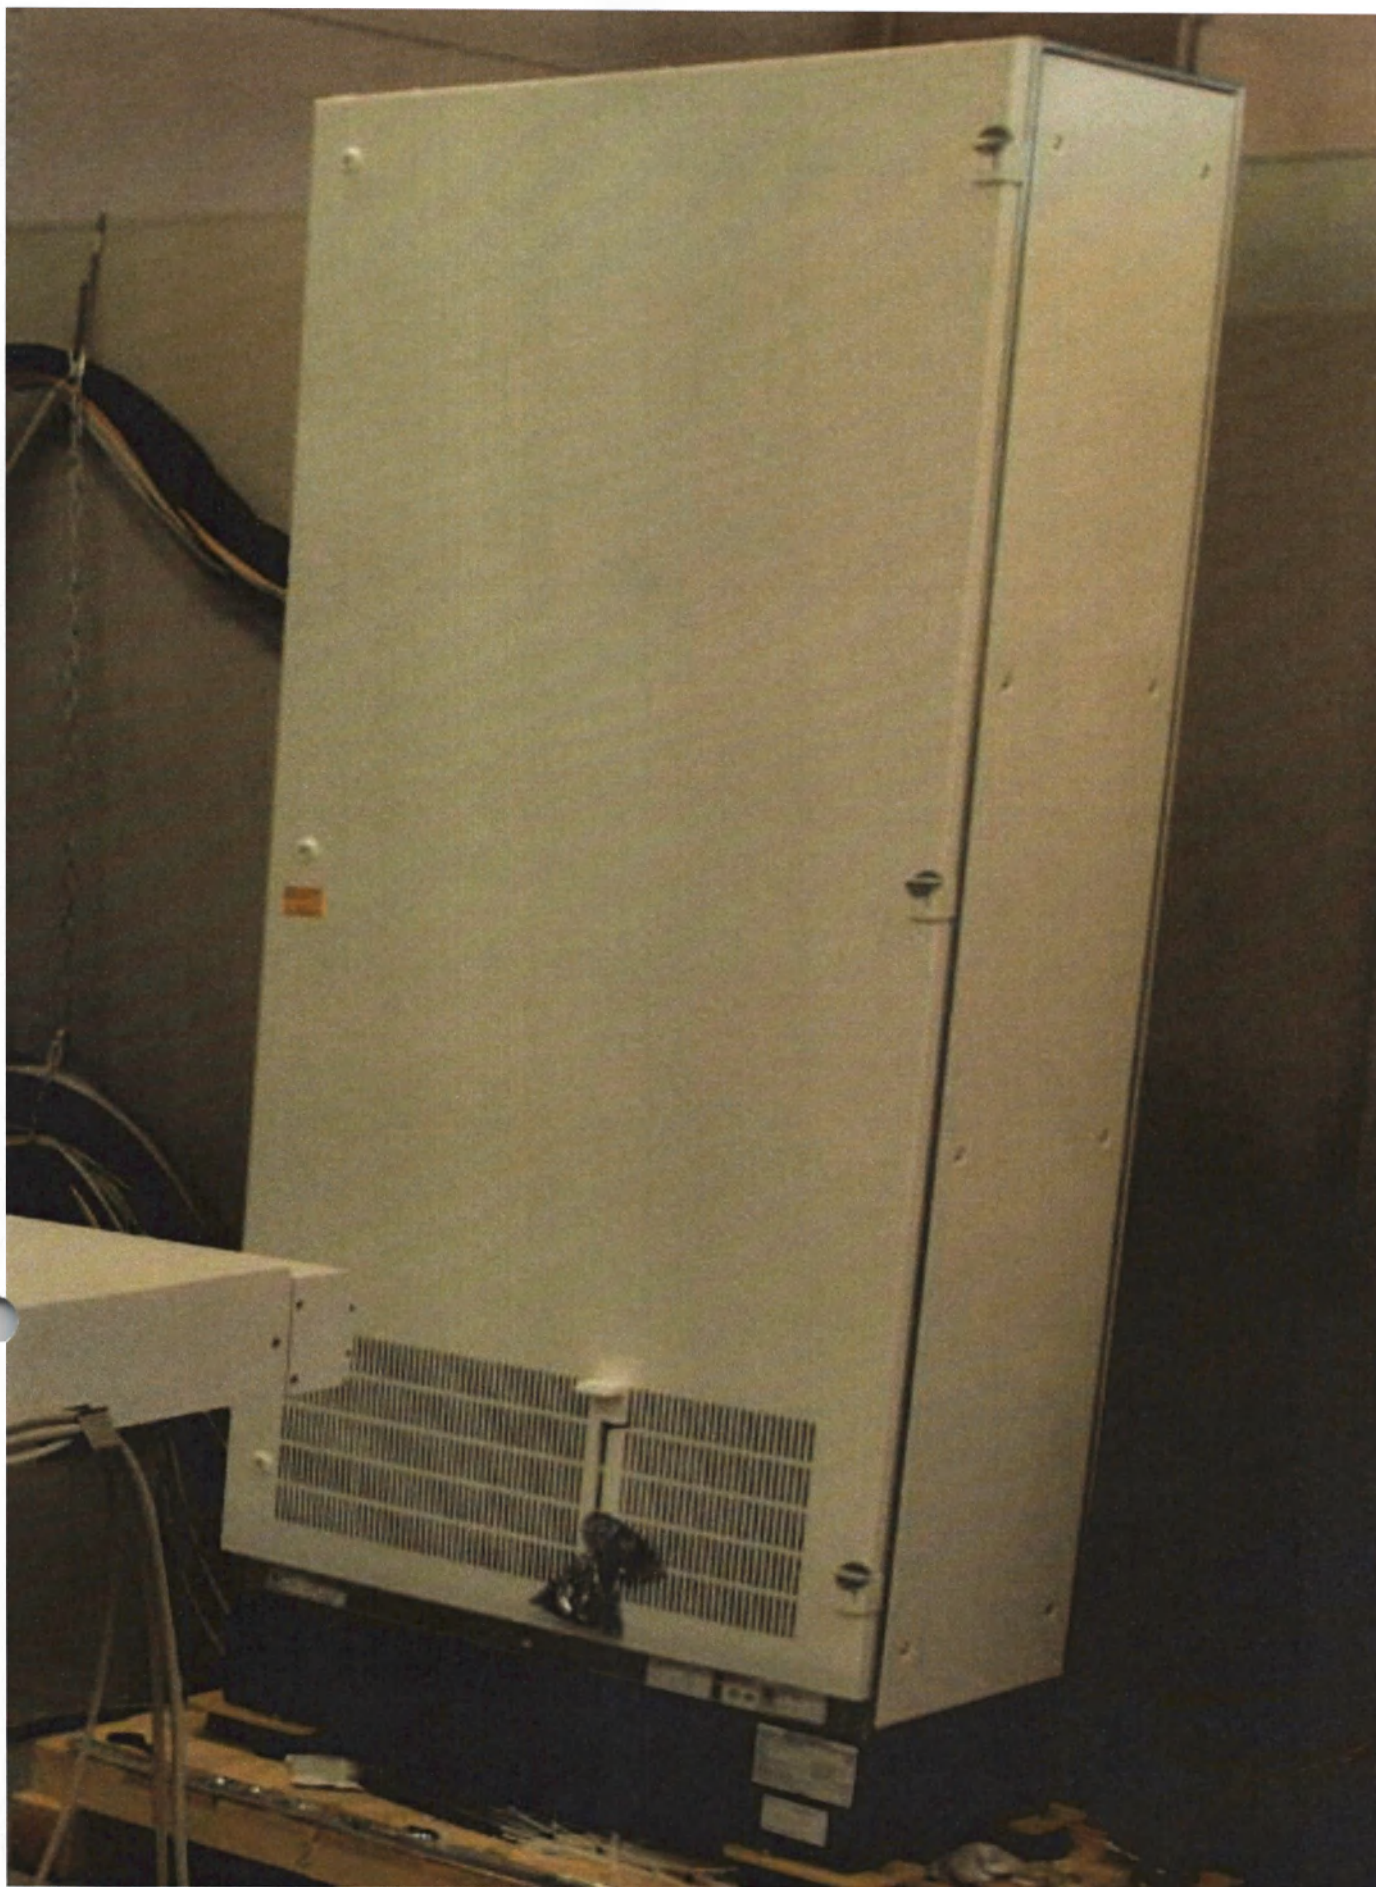

Фотография 91 – Генератор рентгеновский серии Polydorus, Siemens Healthcare GmbH. Вариант внешнего вида

3/PE - 380/400/420/440/460/480V (phase to phase)
50/60Hz
MOMENT kVA: 160
LONG-TIME kVA: 8

☐ 380V ☐ 400V ☐ 420V
☐ 440V ☐ 460V ☐ 480V

Bitte Zutreffendes ankreuzen / Please mark the appropriate box

Polydoros A100 Plus 195cm
(240) 11115702 MODEL
(422) 276 ORIGIN DE
(21) 1188 SERIAL

CLASSIFIED
C UL US
E347424

SIEMENS
Polydoros A100 Plus
(01) 04056869019475 GTIN
(240) 10563420 MODEL
(422) 276 ORIGIN DE
(21) 11108 SERIAL

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
Made in Germany

IVK

9 LITE
CAMERA

SIEMENS

产品名称: X射线高频高压发生器
产品型号: Polydoros A100 Plus
物料号: 10563420
序列号: 1188
注册证号:
代理人名称:
西门子爱克斯射线真空技术(无锡)有限公司
代理人住所:
中国江苏省无锡市梅育路112号 214028
代理人联系方式: 0510-66662888

类别: I类 GB 9706.11-1997
工作制: 间歇加载连续运行
电源: 三相交流
输入功率: 最大160kVA
使用期限: 见说明书
生产日期: 2022年 其他参照说明书

注册人/生产企业: Siemens Healthcare GmbH
注册人/生产企业住所: Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Germany
生产地址: Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Germany

德国制造

LEPU Equipment
Lepu Medical
Equipment(Beijing)Co.Ltd
X-Ray generator
serie Polydoros A100 Plus
No. 60, Shuangbei Road, Zhongguo Development Zone
Shuangbei District, Beijing, China

Фотография 92 – Генератор рентгеновский серии Polydoros, Siemens Healthcare GmbH. Образец внешнего вида варианта маркировки

ЭЛЕКТРОН

Система визуализации
рентгеновского изображения
AKR-00-6000

Серийный номер NN0005517

Дата изготовления 2023-09

Обозначение МИ AKR-00-0000-07:0:220618

Серийный номер МИ GP0006102

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"

НП-20-0200-01



~220 В, 50 Гц, 60 Вт



Фотография 93 – Система визуализации рентгеновского изображения (приемник) по спецификации AKR-00-6000. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 94 – Усилитель рентгеновского изображения УРИ, АО «НИПК «Электрон», РУ № ФСР 2008/02453 (при эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

86



Усилитель рентгеновского
изображения УРИ
УРИ1018- 000

ТУ	9442-027-11150760-2007
Серийный номер	NN14594100
Дата изготовления	2022-07

Обозначение МИ	AKR-00-0000-07:0:220618
----------------	-------------------------

Серийный номер МИ	GP0005719
-------------------	-----------

Изготовитель	АО "НИПК "Электрон"
--------------	---------------------


0290-02-0650




~220В, 50 Гц, 3 кВА




Фотография 95 – Усилитель рентгеновского изображения УРИ. Образец внешнего вида варианта маркировки

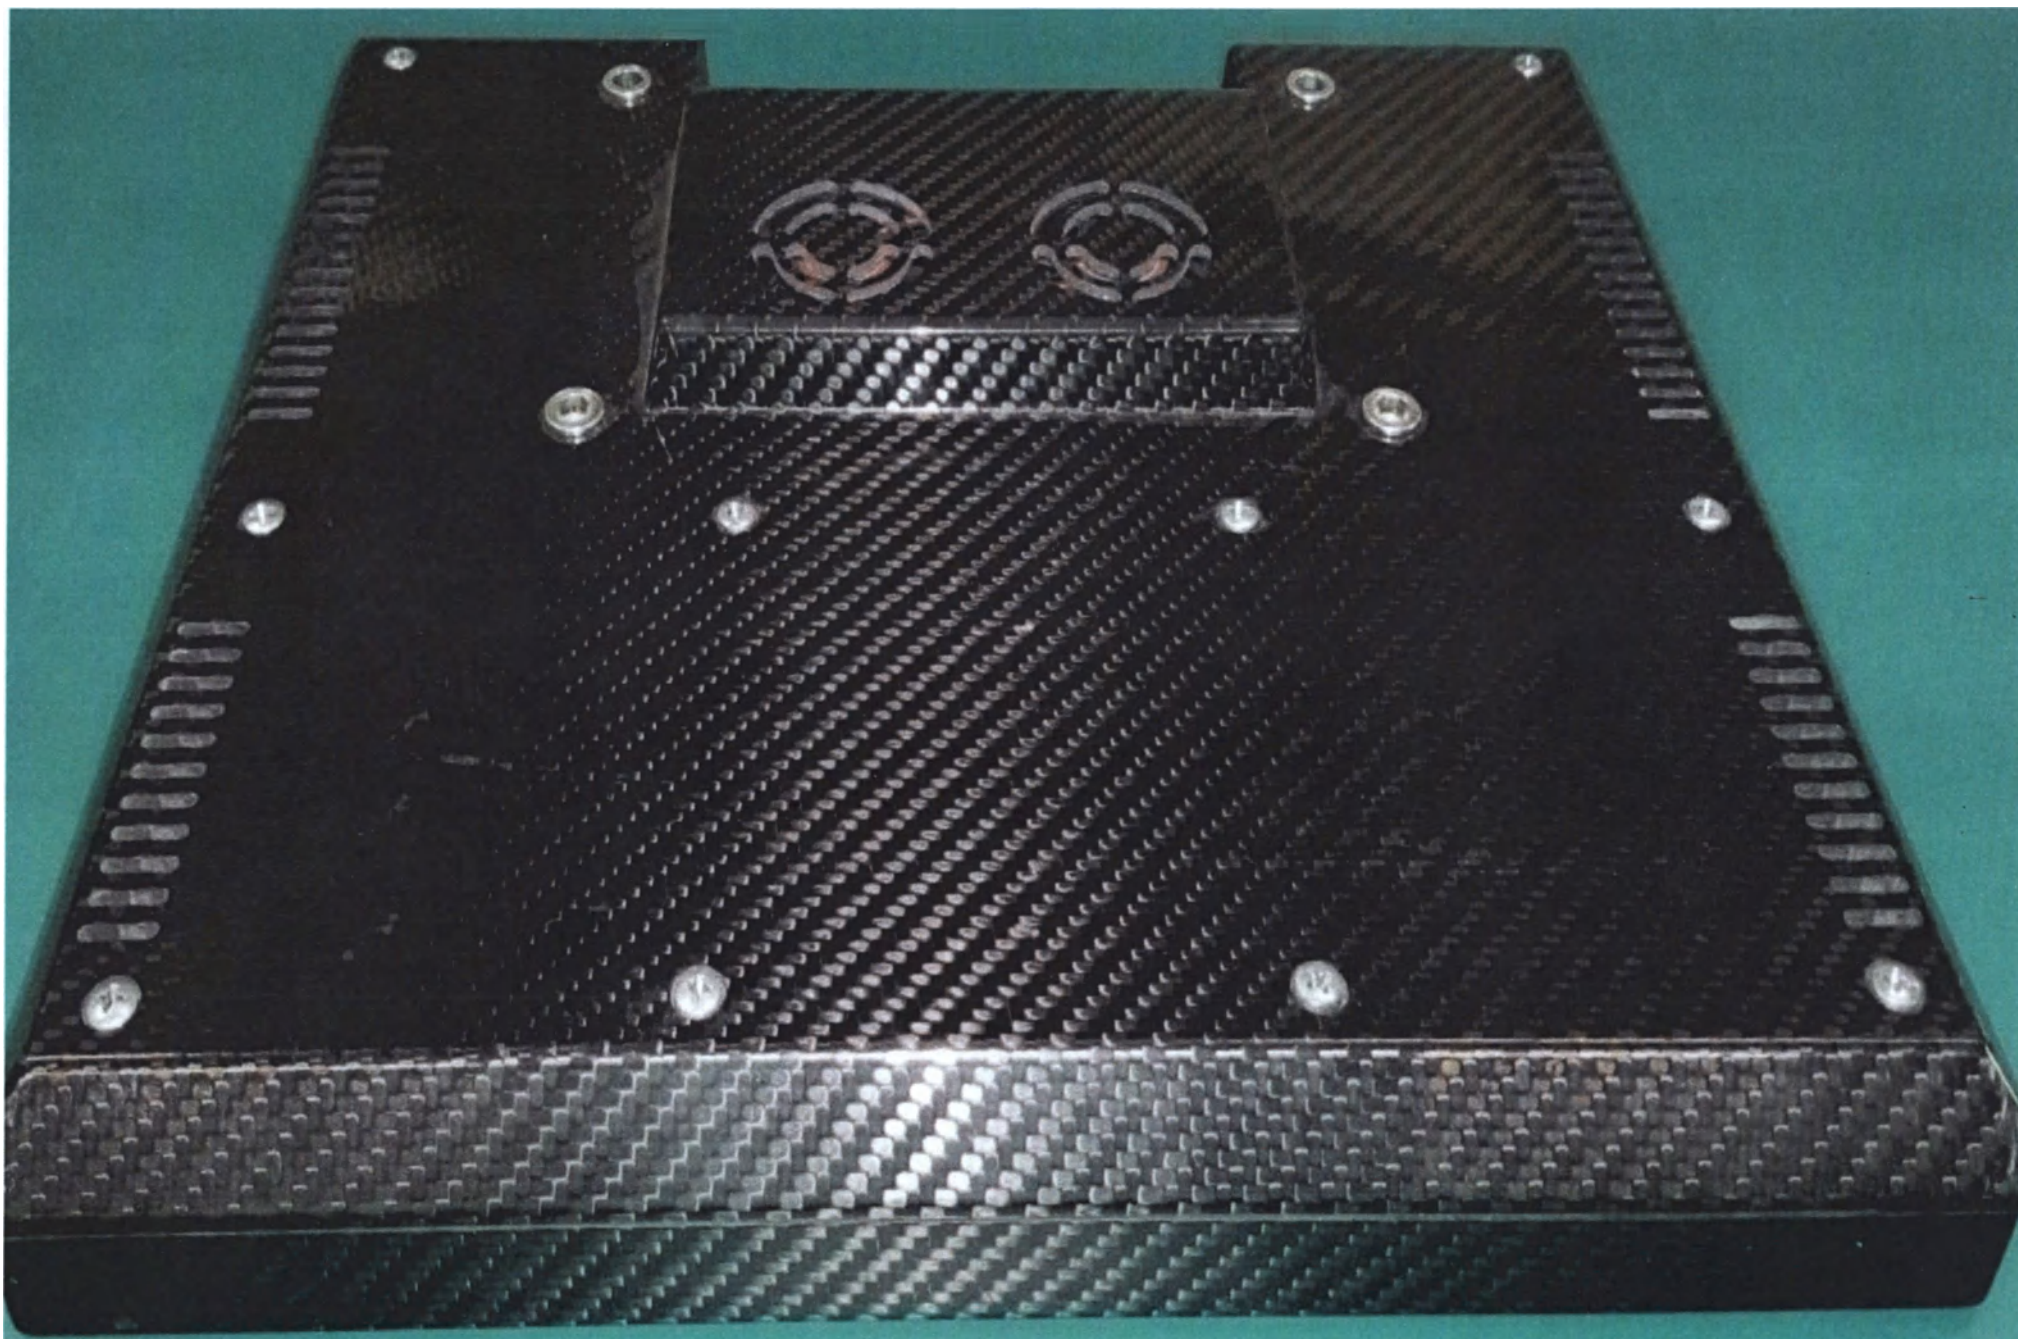


Фотография 96 – Блок датчика серии Roesys KRC1 – 200, Roesys GmbH (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

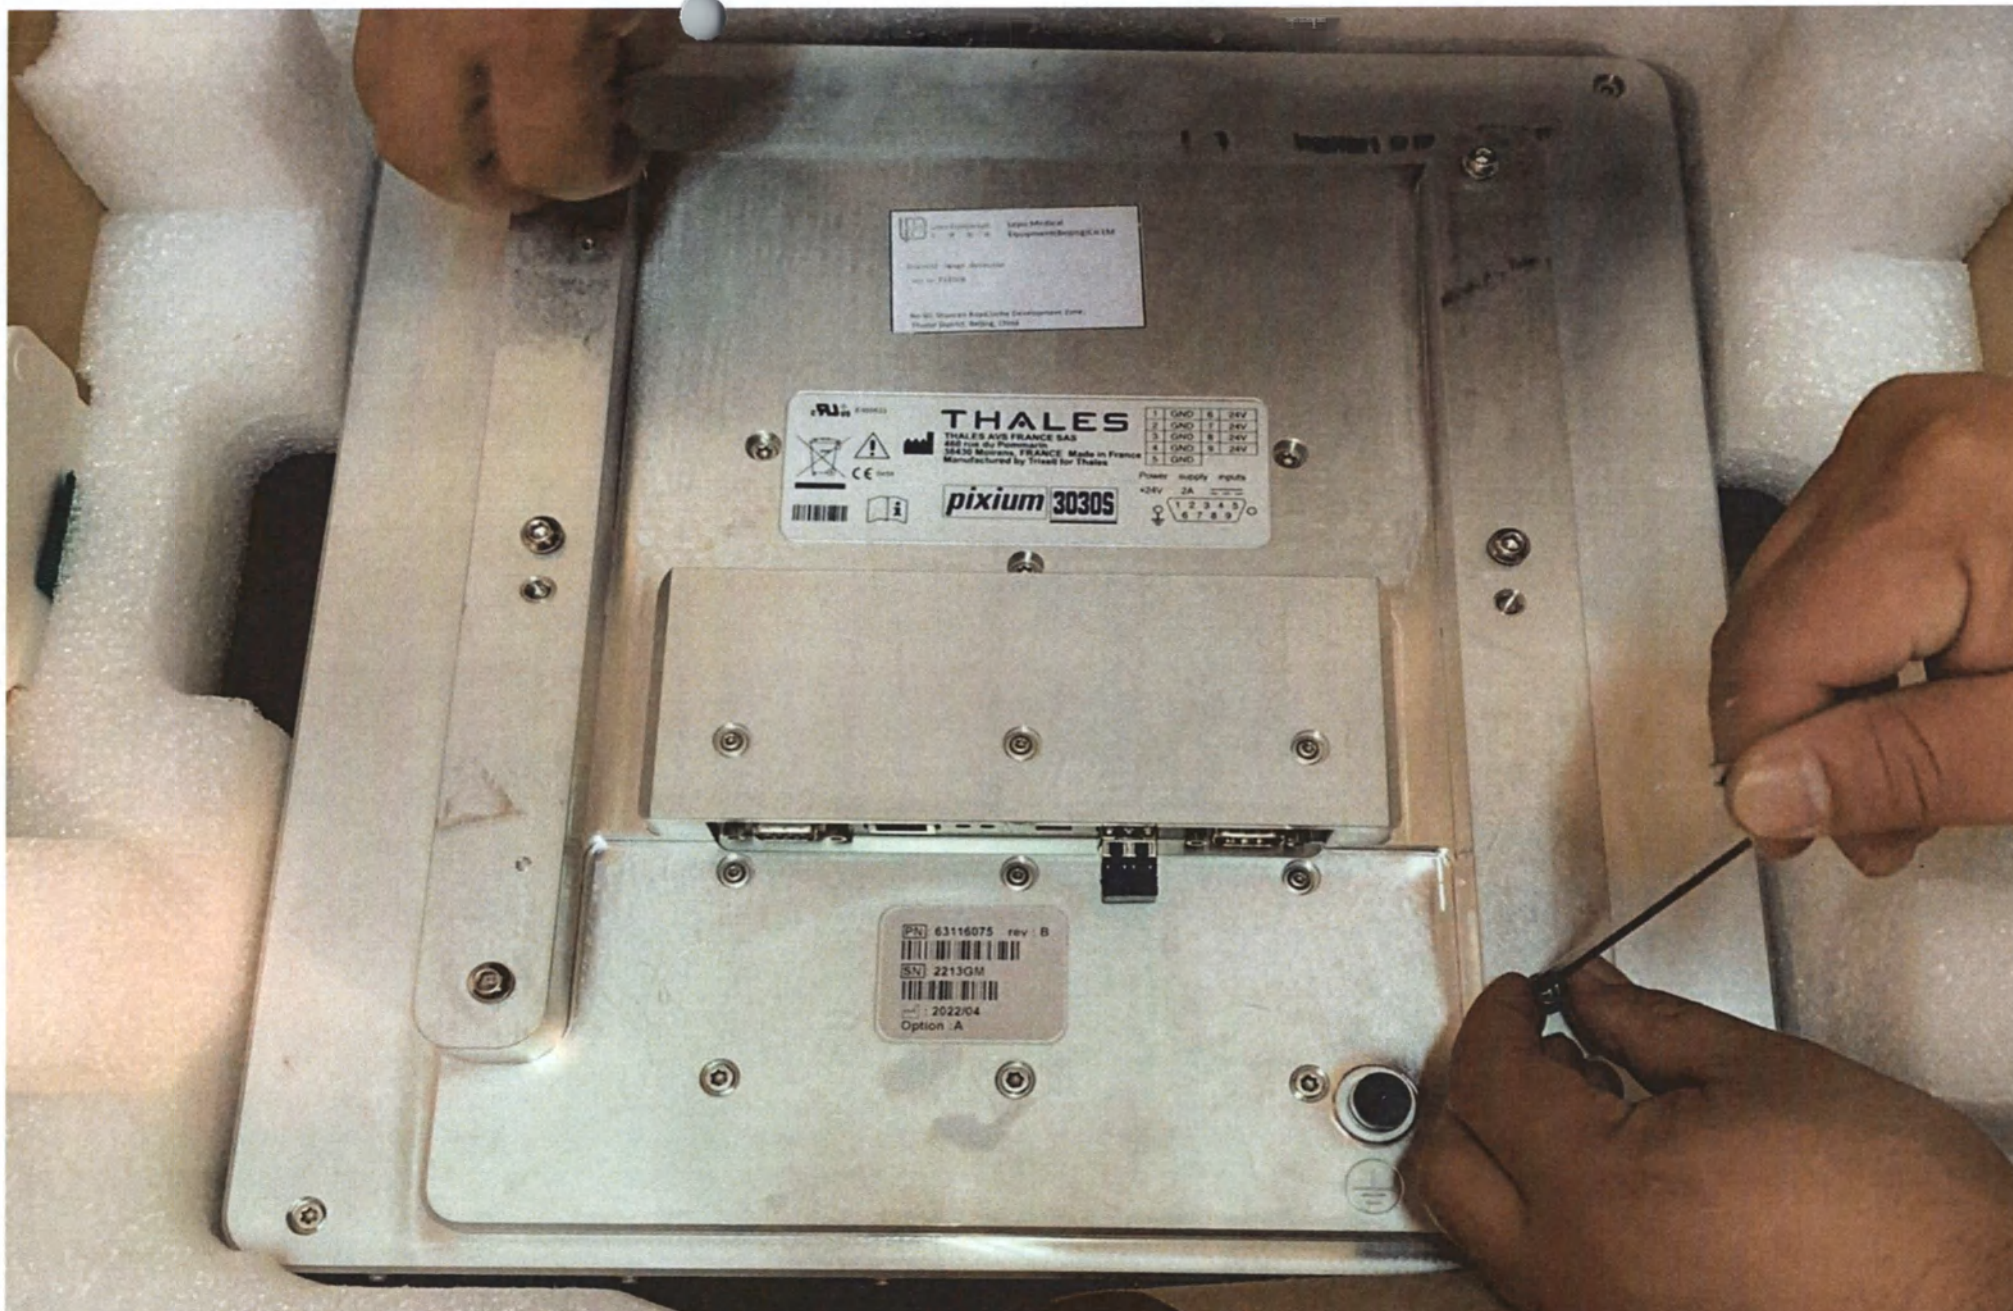


Фотография 97 – Блок датчика серии PIXIUM, Trixell (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива) Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки

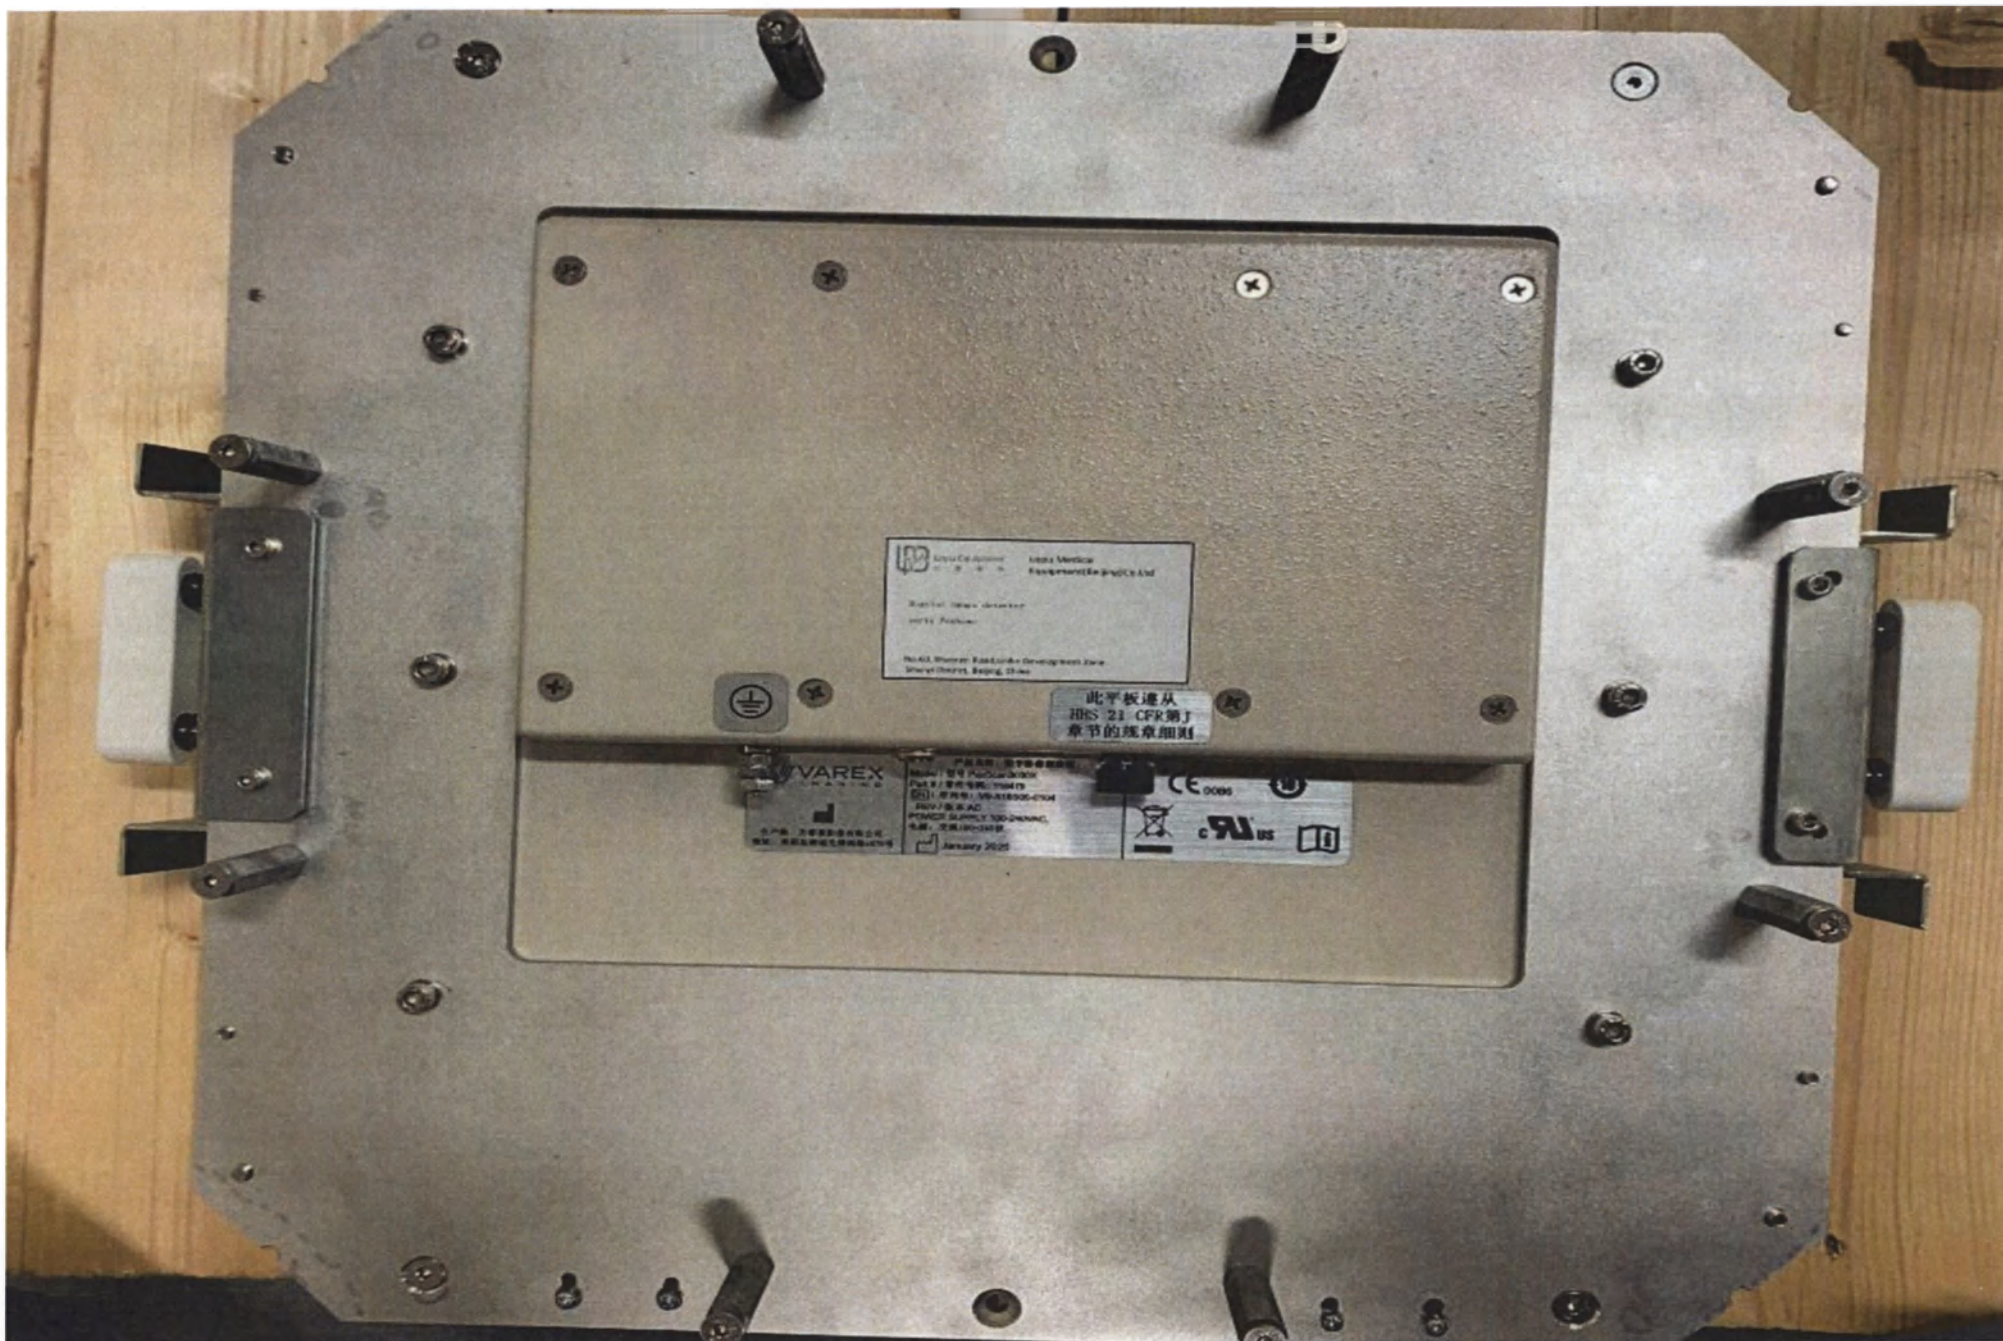


Фотография 98 – Блок датчика серии PaxScan, Varex Imaging (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

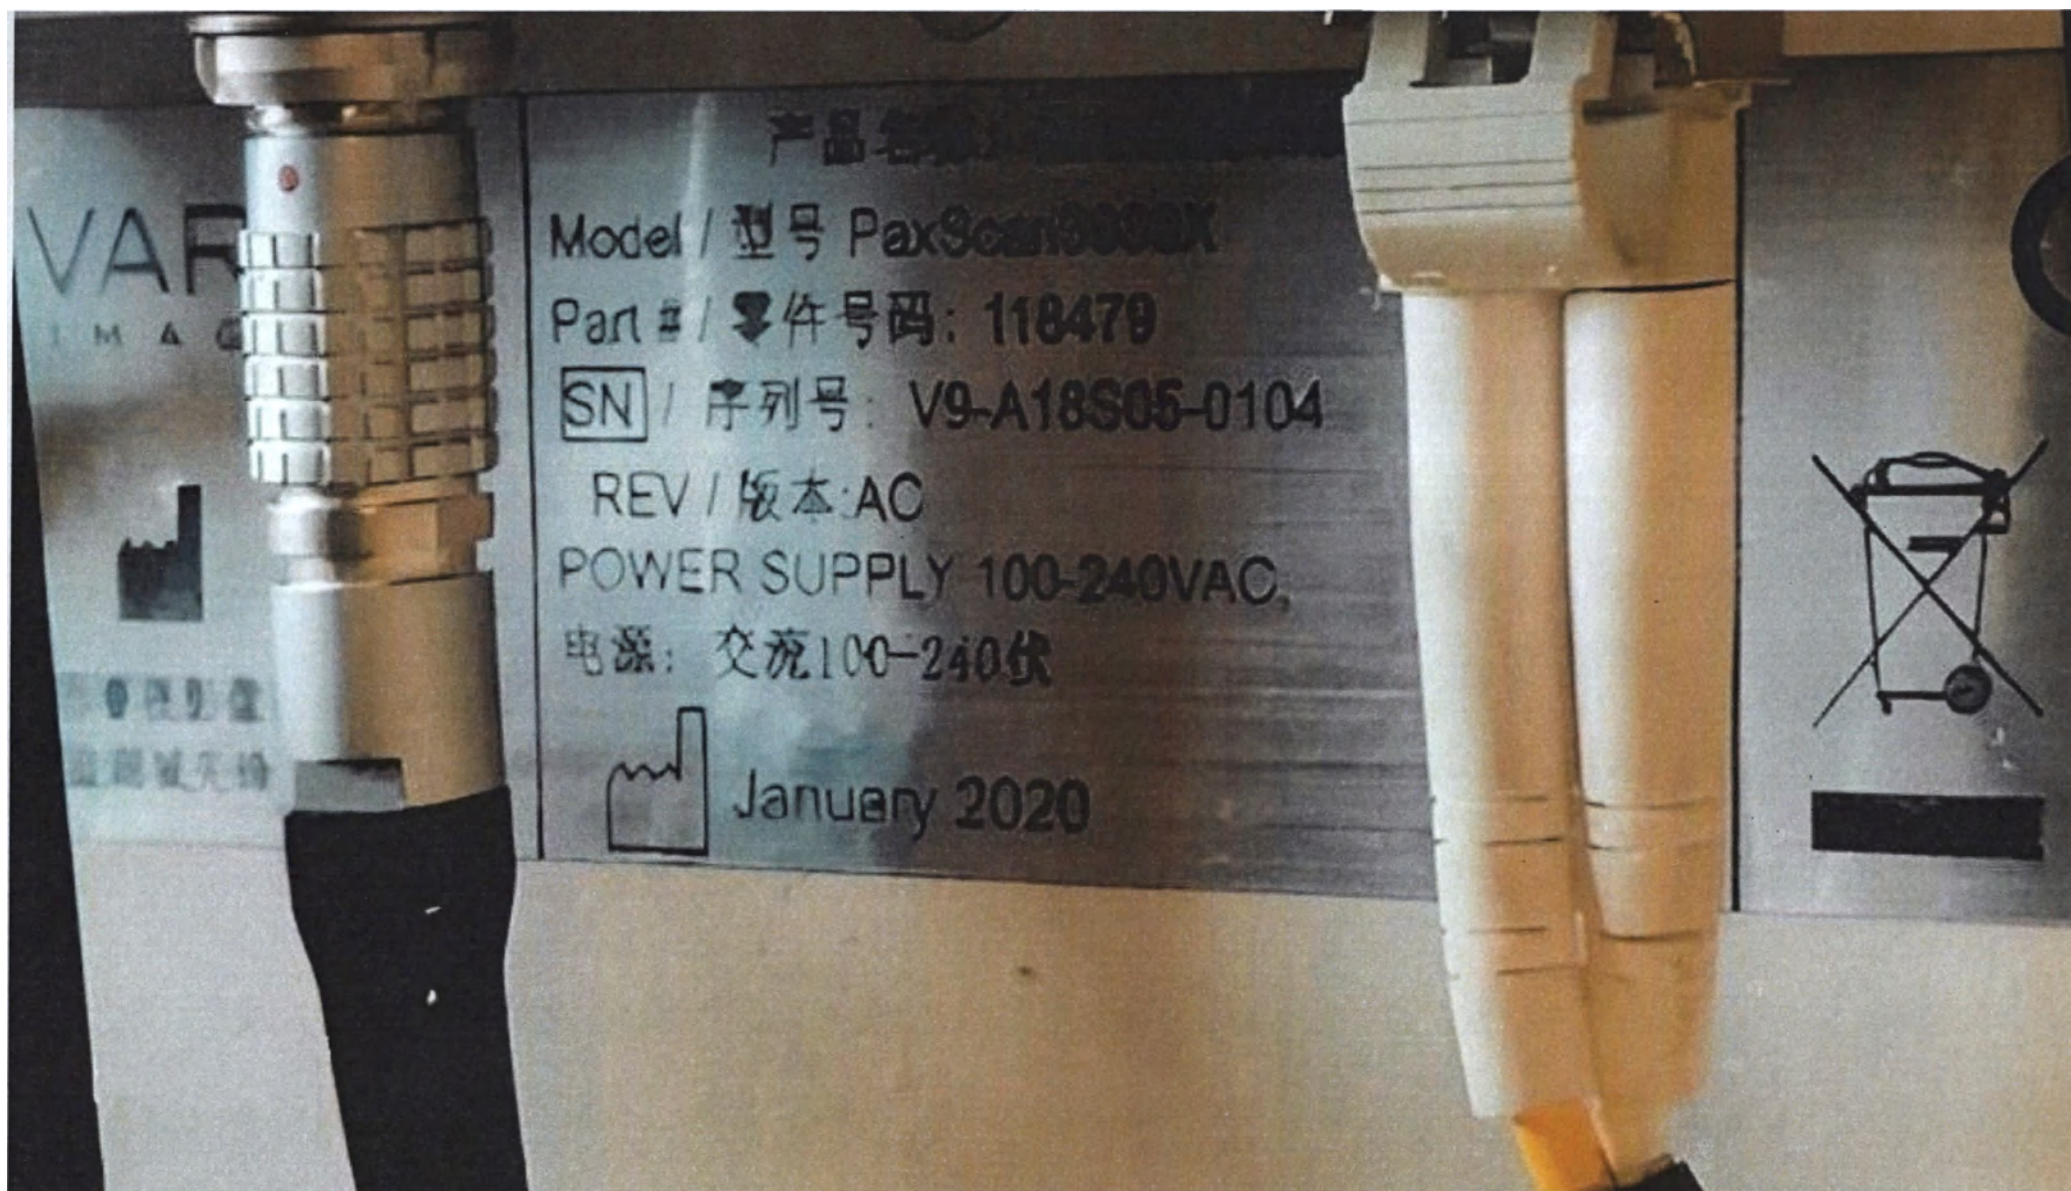

Фотография 99 – Блок датчика серии PaxScan, Varex Imaging. Образец внешнего вида варианта маркировки

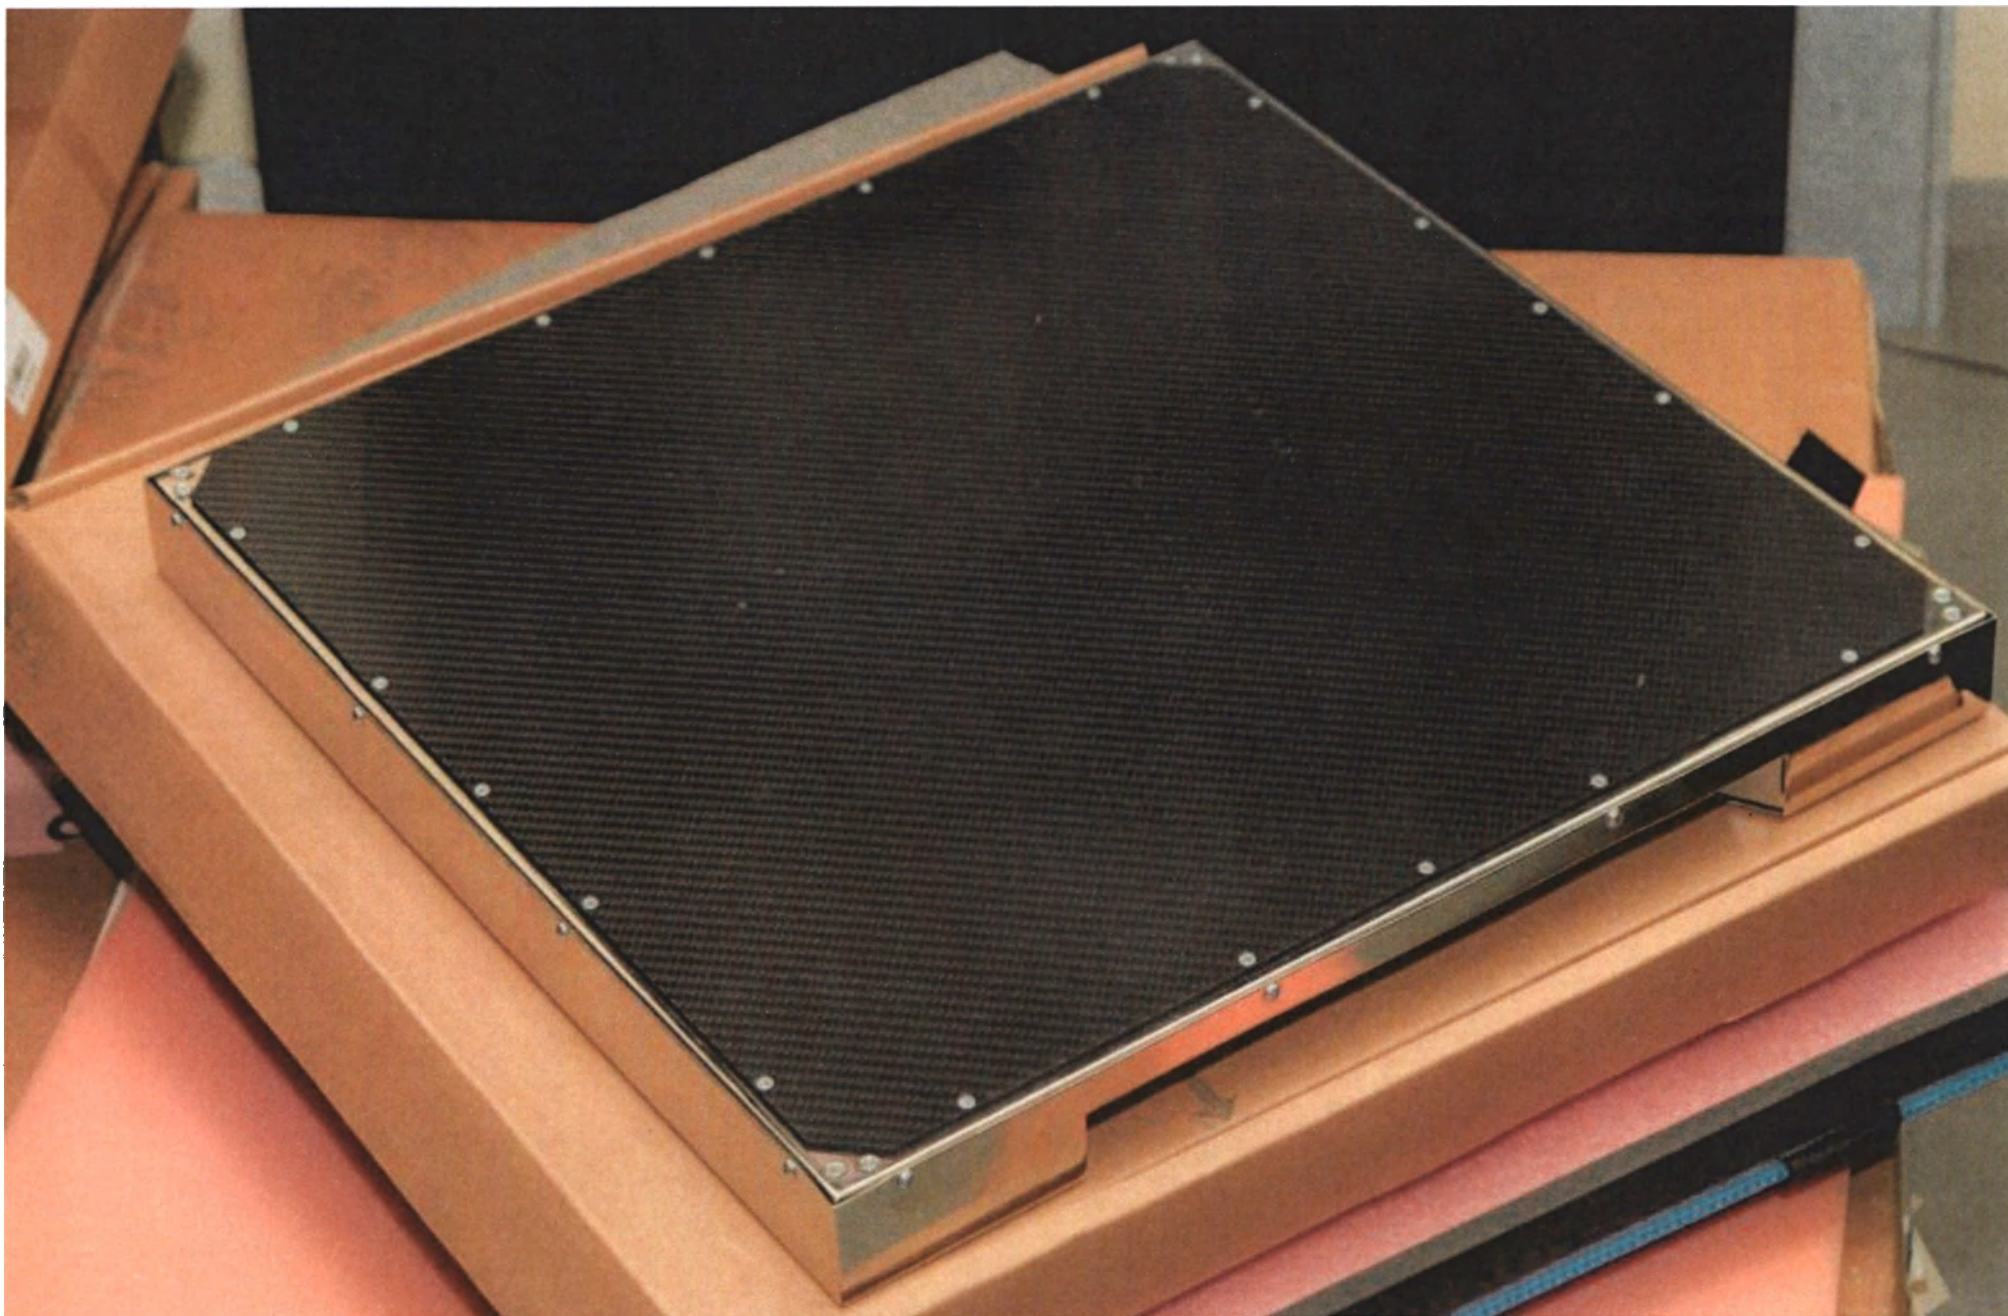

**Фотография 100 – Камера рентгеновская цифровая КРЦ по ТУ 9442-026-11150760-2007 АО «НИПК «Электрон» (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива)
РУ № ФСР 2008/02452. Вариант внешнего вида**

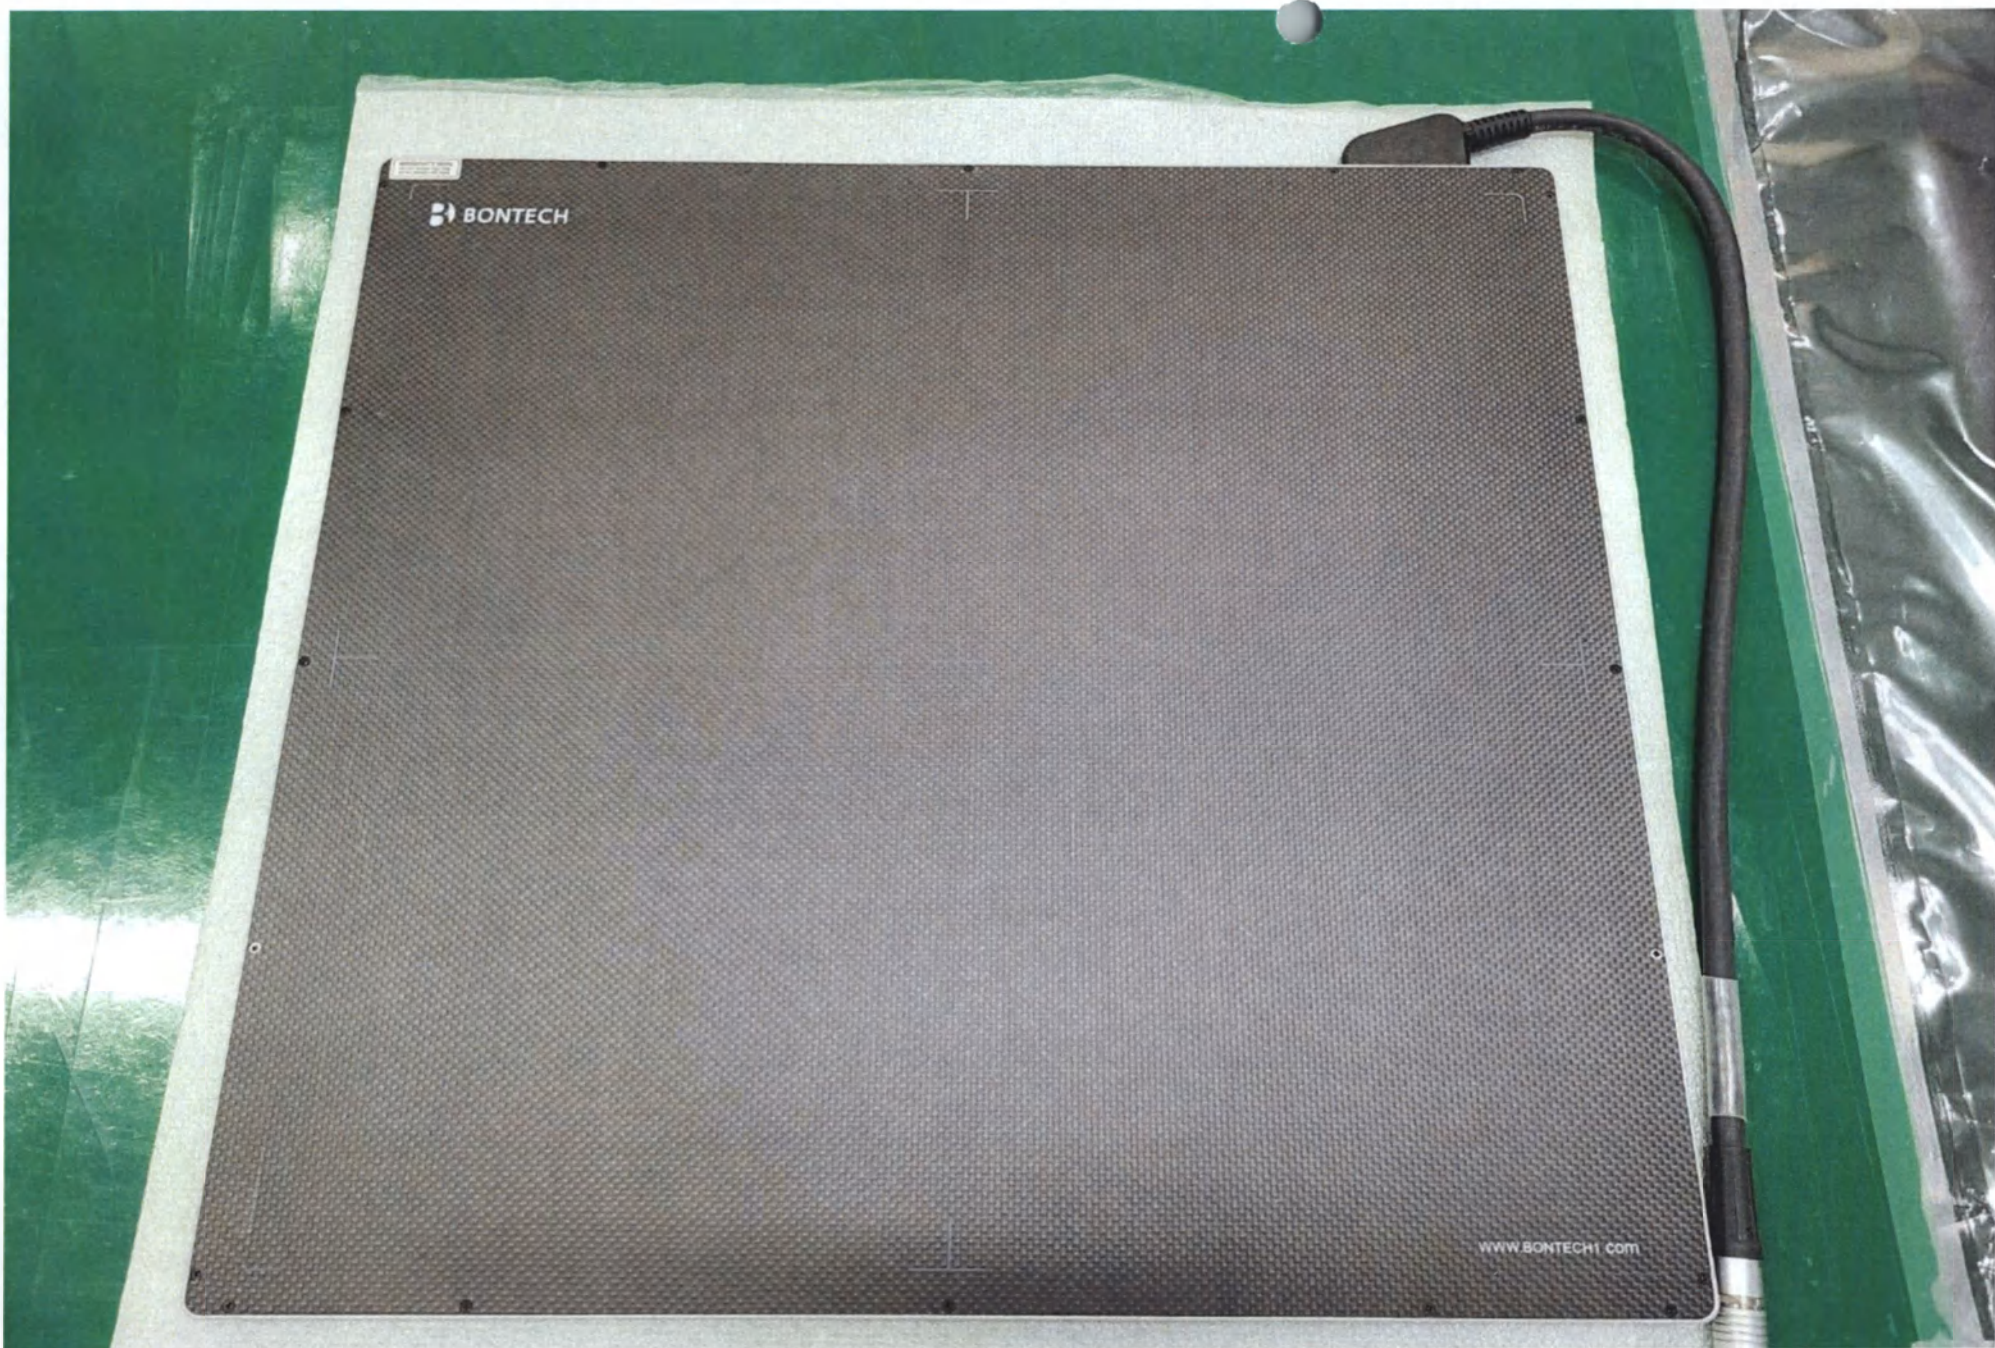

Фотография 101 – Цифровой радиографический детектор серии ВТ, BONTECH Co., Ltd (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида


BONTECH
 www.bontech1.com

 **BONTECH Co., Ltd.**

Digital Empire D-Building #1201,1202,1203
 16. Deogyong-daero 1556 beon-gil,
 Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyunggi-do, Korea
 TEL : 82-31-303-5253 FAX : 82-31-303-5255

Product Name : Flat Panel Digital X-ray Detector

REF BT-DA24-IA

SN BT018B001



2018-11-02
 (M1FDS16M1GNR-5)

Rating : 12V --- 2.5A



MEDICAL EQUIPMENT



UL 60501-1, CAN/CSA C22 2 No 601.1
 E476455 E476455

"This product complies with 21 CFP. Subchapter J"

CE
 2460



Follow
 Instruction
 For Use



CMC Medical Devices & Drugs S.L.
 C/Horadio Lengo N' 18. CP 29006, Malaga, Spain.

Made in Korea

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Фотография 102 – Цифровой радиографический детектор серии BT, BONTECH Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



**Фотография 103 – Цифровой радиграфический детектор серии PIXX и серии PRUDENT, PIXXGEN Corporation (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива).
Вариант внешнего вида**

PIXXGEN

Product Name : Flat Panel Digital X-ray Detector

Model Name : PIXX1717

SN A721229F8

- Manufactured Date :
- Specification : 460 X 461 X 15mm
- Weight : 3.0Kg
- Battery : DC14.8V, 3300mAh
- Manufacturer : PIXXGEN Corporation

[!] Caution : Please refer to the manual enclosed

[*] Performance and Instruction For Use :
Please refer to the manual enclosed


ⓘ **For use with Charger PIXXGEN Model PICB only**

EC REP CMC Medical Device & Drugs S.L.

C/Horacio Lengo N° 18, CP 29006, Málaga, Spain

CE
1370

FC
Tested To comply with
FCC Standards



The equipment can use
regardless of FCC ID and Type No.



PIXXGEN Corporation
MADE IN KOREA

5F, SMART BAY, 123, Beolmal-ro, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do, 14056, Korea

Фотография 104 – Цифровой радиографический детектор серии PIXX, PIXXGEN Corporation. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 105 – Цифровой радиографический детектор серии DRA, ASTEL Inc. (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида



Digital Flat Panel X-ray Detector


REF DRA-1417MC

SN D0CMEHD2001

RATING 15V $\equiv$ Max. 4.2A



Caution : For use with Power & Control box, RFA-PCON only



Apr. 2023



Made In Korea




ASTEL Inc.

26-79, Gajeongbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea, 34113

Tel. +82-42-360-2100 / Fax. +82-42-360-2113



Фотография 106 – Цифровой радиографический детектор серии DRA, ASTEL Inc. Образец внешнего вида варианта маркировки

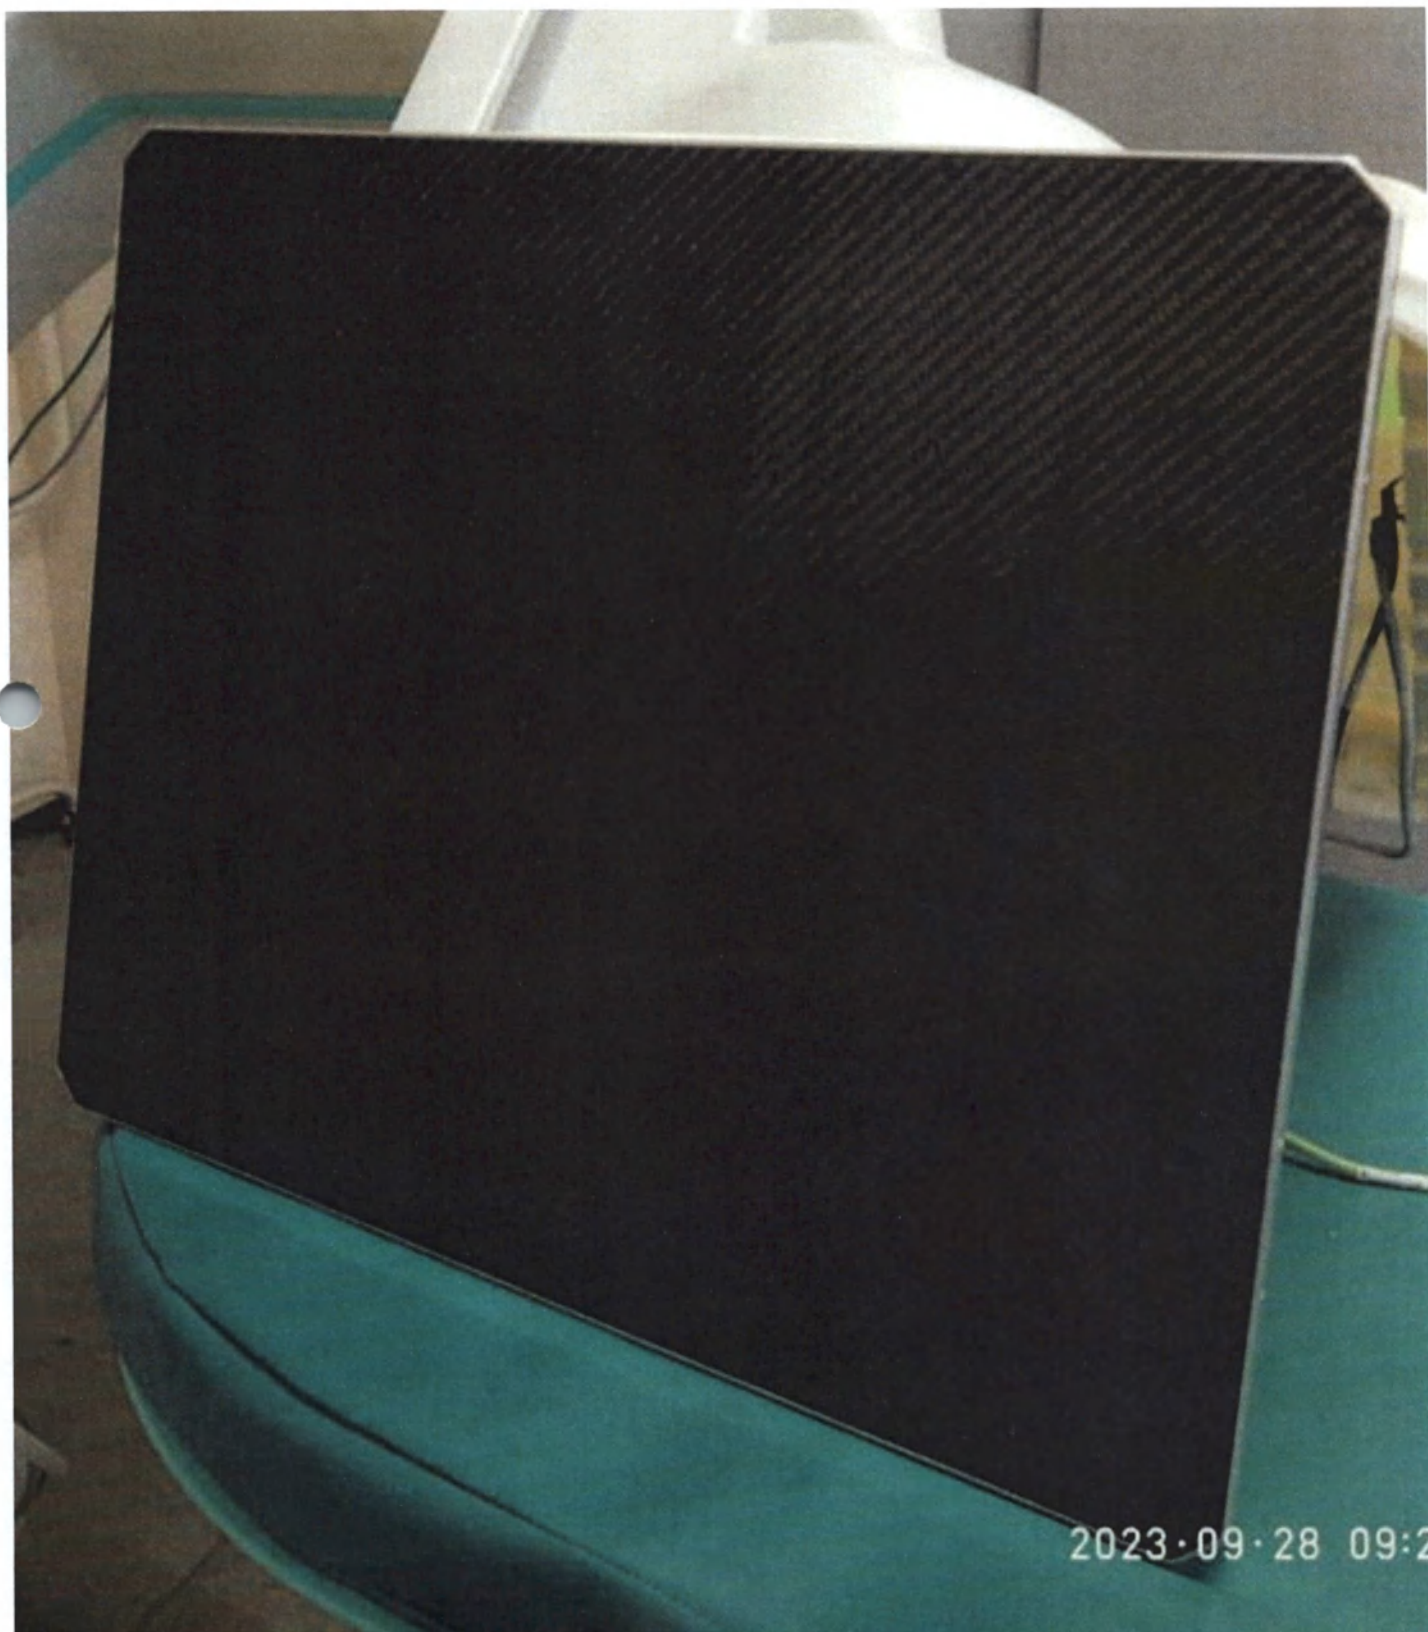

Фотография 107 – Система визуализации рентгеновских изображений СВР по ТУ 9442-039-11150760-2015, АО «НИПК «Электрон» (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). РУ № РЗН 2016/5112. Вариант внешнего вида



Система визуализации
рентгеновских изображений
СВР (СВР3)

ВРАЕ.941211.001-05

ТУ

9442-039-11150760-2015

Серийный номер

NN0005548

Дата изготовления

2023-09

Обозначение МИ

AKR-00-0000-07:0:220618

Серийный номер МИ

GP0006102

Изготовитель

АО «НИПК «Электрон»

ИР-20-0600



~220 В, 50 Гц, 60 Вт




Фотография 108 – Система визуализации рентгеновских изображений СВР, АО «НИПК «Электрон» РУ № РЗН 2016/5112.
Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 109 – Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс РПАК. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 110 – Комплекс программно-аппаратный ПАК ТУ 9442-030-11150760-2009 АО «НИПК «Электрон», РУ № ФСР 2009/05504. Образец внешнего вида варианта маркировки

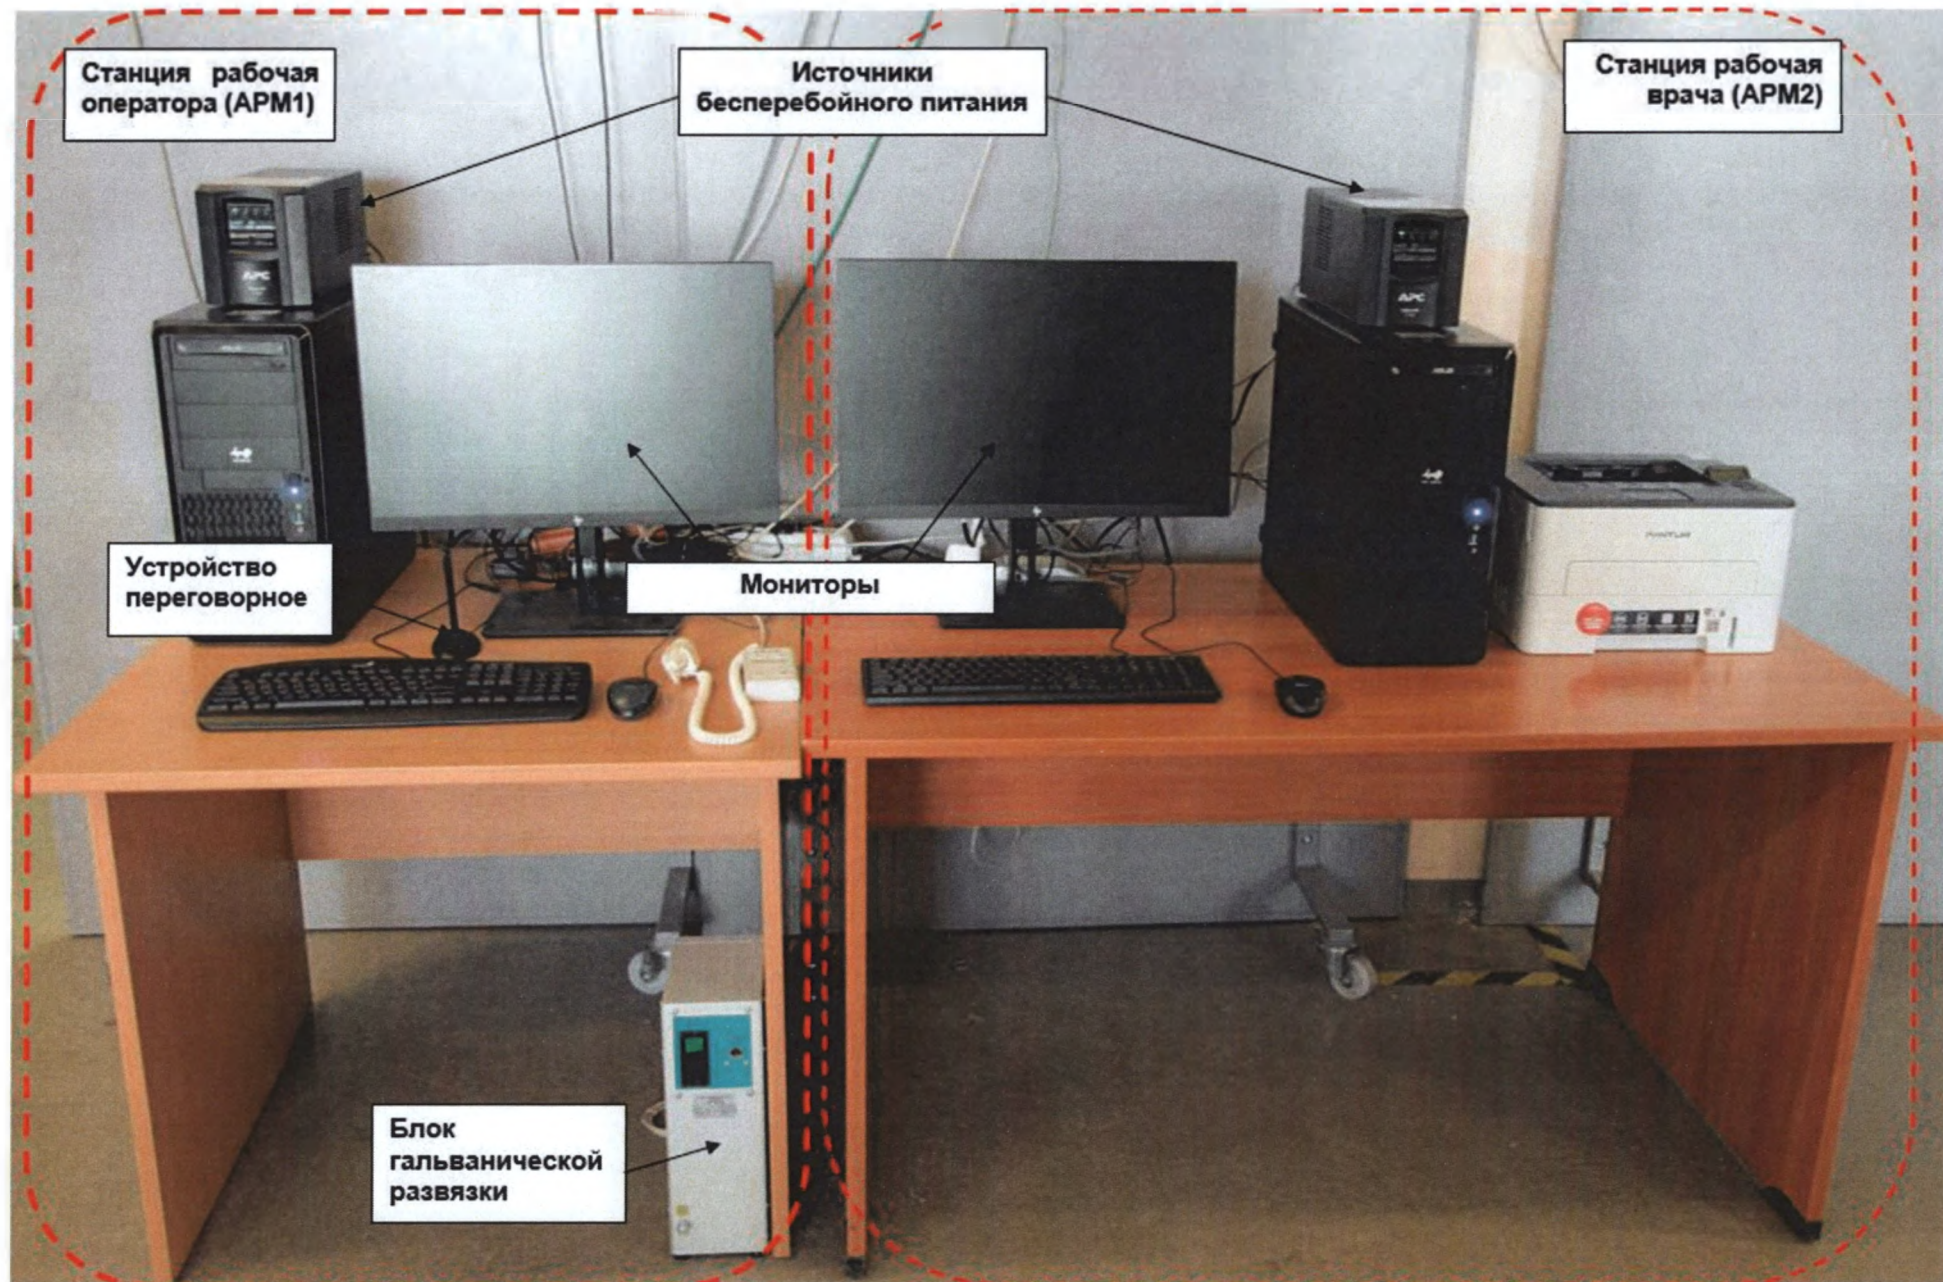

Фотография 111 – Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс (РПАК) в составе CWS по спецификации АО «НИПК «Электрон». Вариант общего внешнего вида



Фотография 112 – Станция рабочая оператора/рентген-лаборанта (АРМ1). Вариант внешнего вида.

ИГ+ЭЛЕКТРОН

Станция
рабочая оператора/
рентген-лаборанта (APM1)
WST1-00-5400

Серийный номер NN0006135
Дата изготовления 2023-09

Обозначение МИ AKR-00-0000-07:0:220618

Серийный номер МИ GP0006102

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"


№ 20-0200-01



~220 В, 50 Гц, 6 А



Фотография 113 – Станция рабочая оператора / рентген - лаборанта (APM1). Образец внешнего вида варианта маркировки

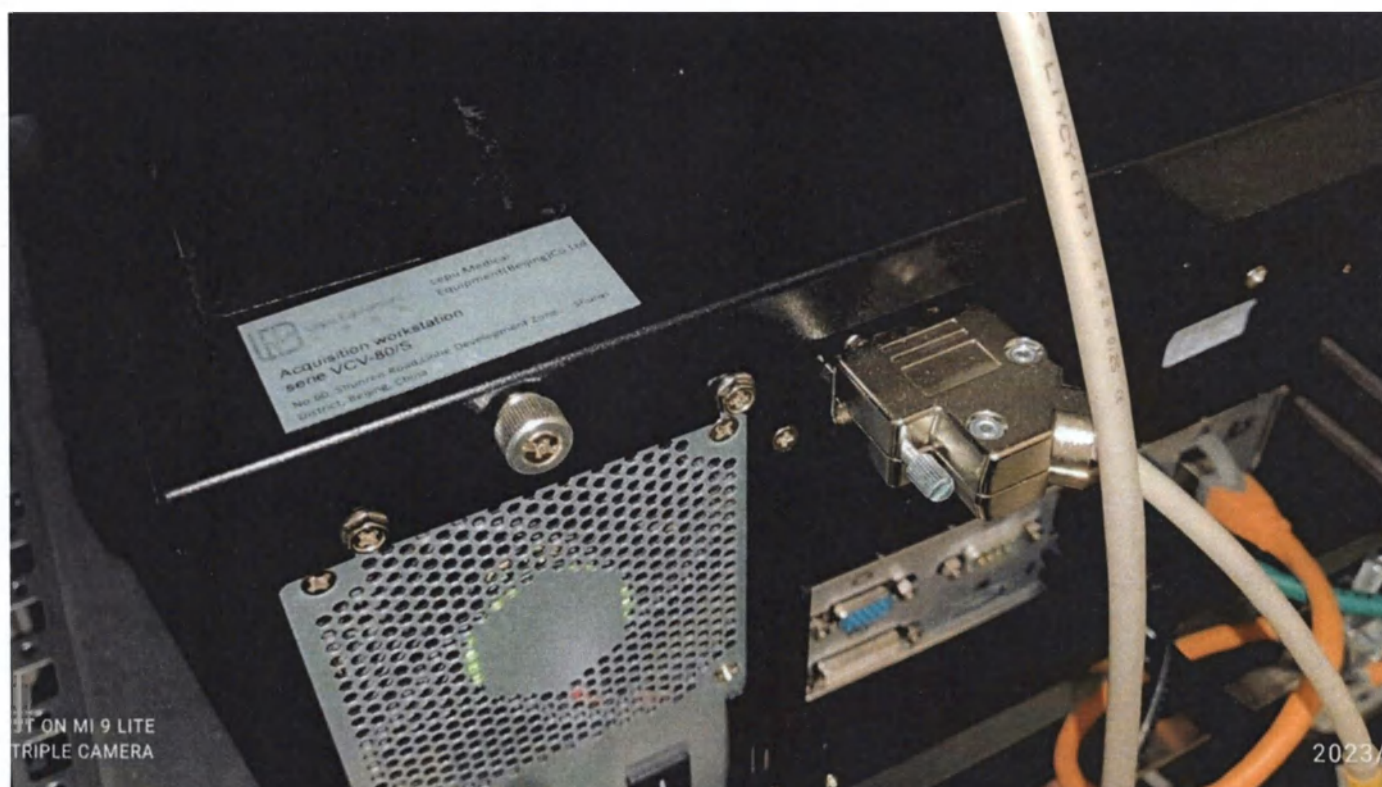

Фотография 114 – Станция рабочая оператора / рентген - лаборанта серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing). Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 115 – Станция рабочая врача (АРМ2). Вариант внешнего вида

ЭЛЕКТРОН

Станция рабочая
врача-рентгенолога
(APM2)
WST2-00-1400

Серийный номер NN0006137
Дата изготовления 2023-09

Обозначение МИ AKR-00-0000-07:0:220618

Серийный номер МИ GP0006102

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"


NP-20-0200-01



~220 В, 50 Гц, 6 А



Фотография 116 – Станция рабочая врача-рентгенолога (APM2). Образец внешнего вида варианта маркировки

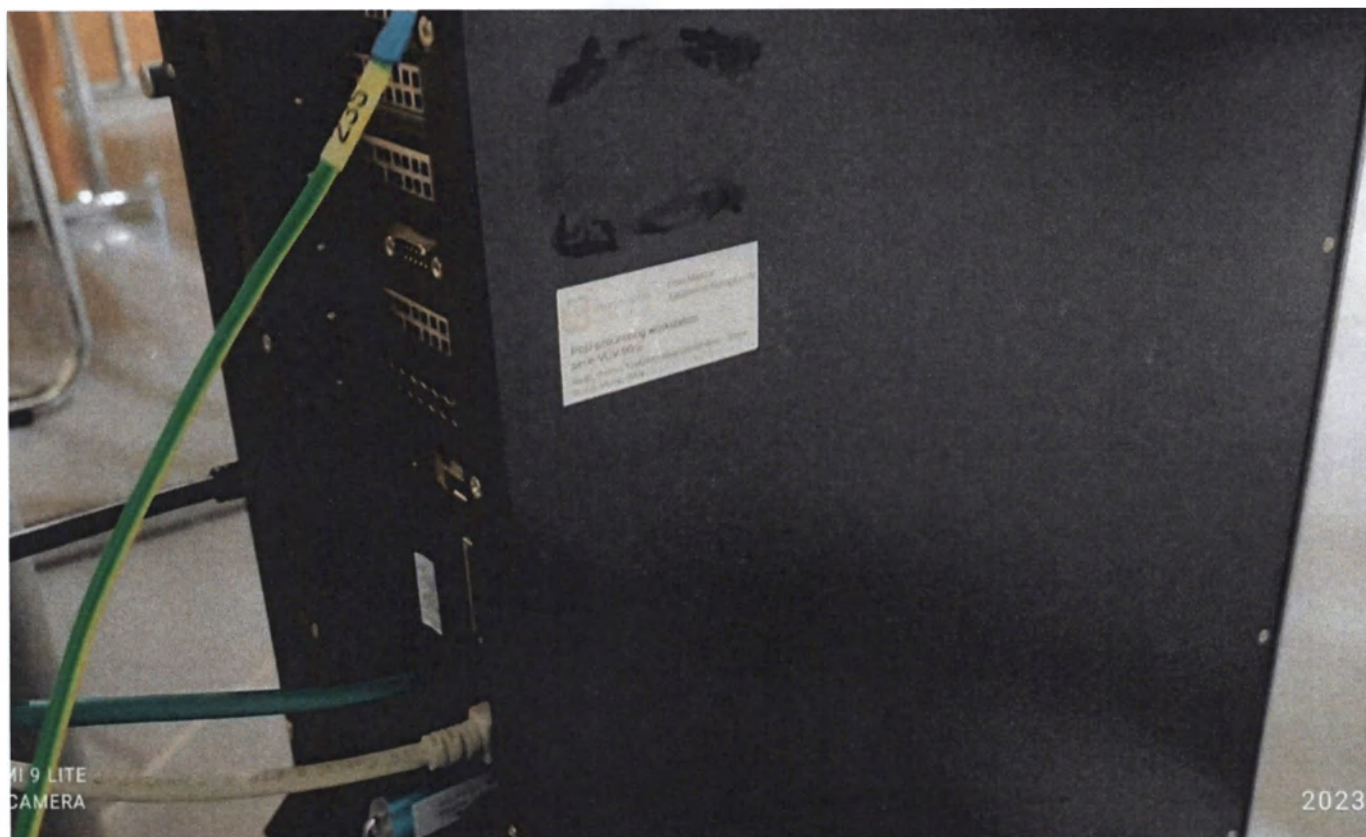

Фотография 117 – Станция рабочая врача серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing). Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 118 – Станция рабочая регистратора (АРМ3). Вариант внешнего вида

НИПЭК ЭЛЕКТРОН		Сервер SRV-00-1500	
Серийный номер		NN0005214	
Дата изготовления		2023-09	
Обозначение МИ		AKR-00-0000-07:0:220618	
Серийный номер МИ		GP0006102	
Изготовитель		АО "НИПК "Электрон"	
NF-20-0200-01   		~220 В, 50 Гц, 16 А  	

Фотография 119 – Сервер SVR-00-1500. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 120 – Сервер SVR-00-1500, АО НИПК «Электрон» (вариант внешнего вида)



Фотография 122 – Монитор серии IF (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки), WIDE Corporation, Республика Корея



Фотография 123 – Монитор серии NEC (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки), NEC Display Solutions, Япония, США, Китай или Sharp NEC Display Solutions, Ltd, Япония, США, Китай Маркировка



Фотография 124 – Монитор серии EndoVue (вариант внешнего вида), National Display Systems Inc., США РУ № РЗН 2013/998



Фотография 125 – Мониторы и маркировка iiyama International Co серии ProLite, Нидерланды или Китай. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 126 – Монитор серии RadiForce (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки) EIZO NANAO CORPORATION, РУ № РЗН 2022/17113 и маркировка



Фотография 127 – Монитор серии G, Shenzhen Beacon Display Technology Co. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки. РУ РЗН 2022/17702



Фотография 128 – Монитор 55" Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd., РУ РЗН 2022/17702. Вариант внешнего вида

LCD Monitor 液晶显示器


Model 型号: S556

Power Supply 电源: 100-240V~ 50/60Hz 3.5-1.5A


REF S556A01

SN A0003

2023-08-11



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam, Netherlands



RoHS



S556A23320003



制造商: 深圳市巨烽显示科技有限公司

Manufacturer: Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd.

Web: www.beacon-display.cn

中国制造 MADE IN CHINA

地址: 深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁
恒大时尚慧谷大厦(东区)6栋15层

Address: 15F, Building 6, Hengda Shishang Huigu(East),
Fulong Road, Dalang Subdistrict, Longhua,
Shenzhen, 518109, P.R. China


Фотография 129 – Монитор 55" Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd., РУ РЗН 2022/17702. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 130 – Монитор модель серии С (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки), Nanjing Jusha Display Technology Co с маркировкой РУ № РЗН 2020/12645



Фотография 131 – Монитор Барго серии MDRC (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки).
 РУ № РЗН 2019/9134

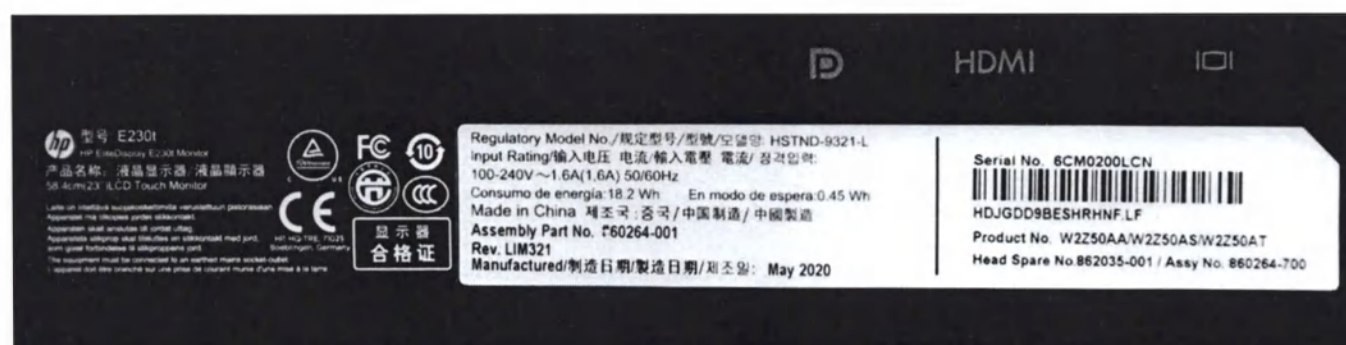

Фотография 132 – Монитор серии Е (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки), производства HP Inc




Фотография 133 – Монитор серии Dell (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки), производства Dell Inc



BenQ		Product Name: LCD Monitor Название продукта: ЖК-монитор Назва продукту: Монитор LCD			
Model ID Код модели/Модель:	GW2480-T	Type/Тип:	BL2480T		
Rating Рейтинг/ Параметры:	100-240V~, 50/60Hz, 1.60A				
Mfg. Date/Дата изг. Дата виробництва:	April 2022				
Rev.:	40-003-KB				
P / N :	9H.LHFLA.FPE				
S / N :	ETM4N0264201Q				
EU Importer: BenQ Europe B.V. Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR, Eindhoven, The Netherlands Імпортёр: BenQ Europe B.V. Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR, Ейндговен, Нідерланди UK Importer: BenQ UK Limited, 7/10 Chandos Street, Cavendish Square, London W1G 9DQ F40G238W881-5E—P.XY					

Apparätens stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.
 Laite on luotettava suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
 Apparatet må tilkoples jordat stikkontakt.
 Apparatet skall anslutas till jordat uttag.
 BenQ Corporation (16 Jihu Road, Neihu, Taipei 114, Taiwan / Тайвань)
 Корпорация Бенк'ю (16 Джиху Роад, Нейху, Тайпей 114, Тайвань)
 Made in China Сделано в Китае

Фотография 134 – Мониторы модели серии GW и BL, BenQ, Китай, Тайвань. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки

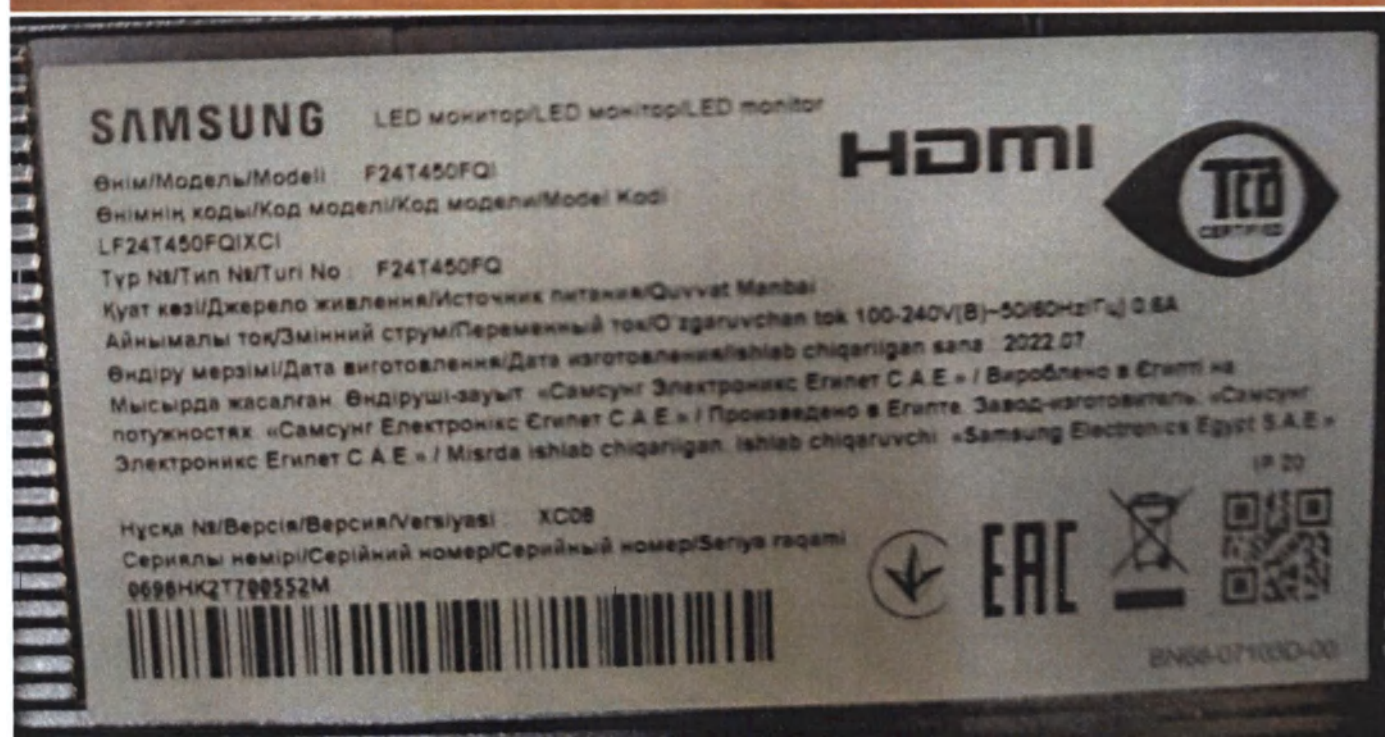

Фотография 136 – Монитор модель серии F, Samsung. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 137 – Монитор модель серии Professional X24P1, AOC. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 138 – Монитор серии VA, производства ASUS. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 139 – Монитор модель серии G, Gigabyte. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 140 – Монитор модель серии В, ACER. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 142 – Стойка приборная. Вариант исполнения по спецификации СП-815 (вариант внешнего вида)



а) Вариант исполнения по спецификации СП-815



б) Вариант исполнения по спецификации СП-815

Фотография 143 – Стойка приборная. Вариант исполнения по спецификации СП-815 (вариант внешнего вида)



Фотография 144 – Камера медицинская термографическая мультформатная серии DRYPIX. Fujifilm Corporation, РУ № РЗН 2013/911. Вариант внешнего вида



Фотография 145 – Устройство для печати медицинских изображений, серии UP Sony Corporation РУ № ФСЗ 2007/00084. Вариант внешнего вида




Фотография 146 – Камера мультиформатная термографическая серии Drystar Agfa N.V., РУ № ФСЗ 2008/02792. Вариант внешнего вида




Фотография 147 – Камера лазерная мультиформатная серии DRYVIEW для печати медицинских изображений. Carestream Health, Inc., РУ № ФСЗ 2011/10352. Вариант внешнего вида



**Фотография 148 – Камера лазерная мультимедийная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями Konica Minolta, Inc.,
РУ № РЗН 2012/12920. Вариант внешнего вида**

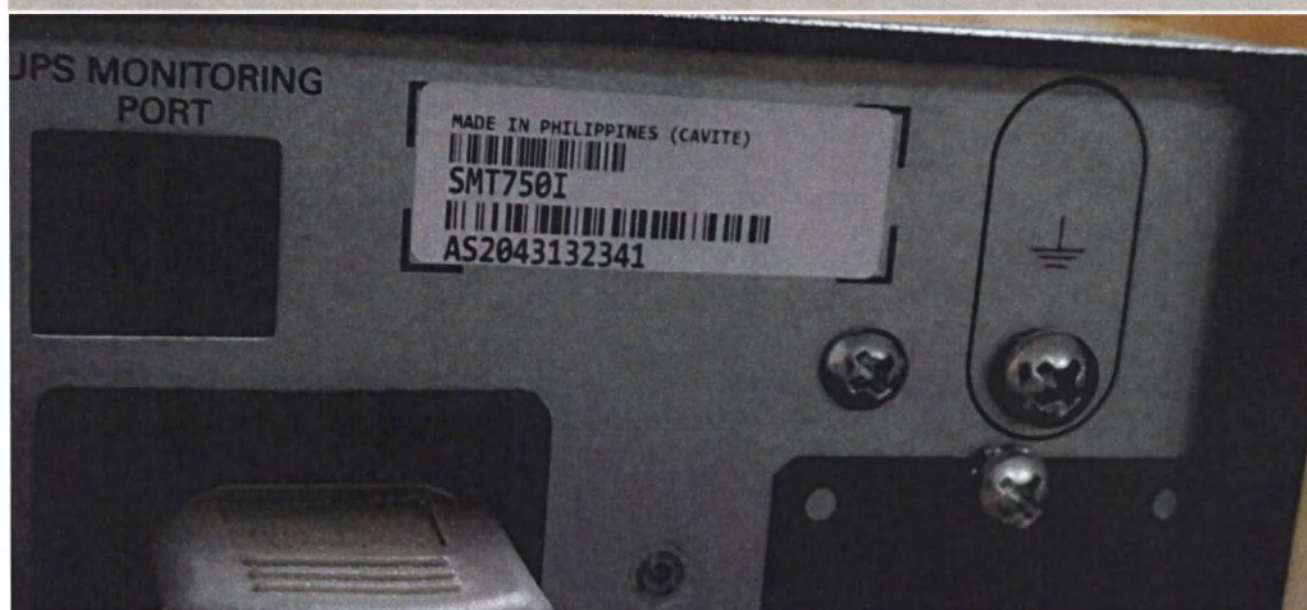

Фотография 149 – Источник бесперебойного питания APC (в составе АРМ). Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки

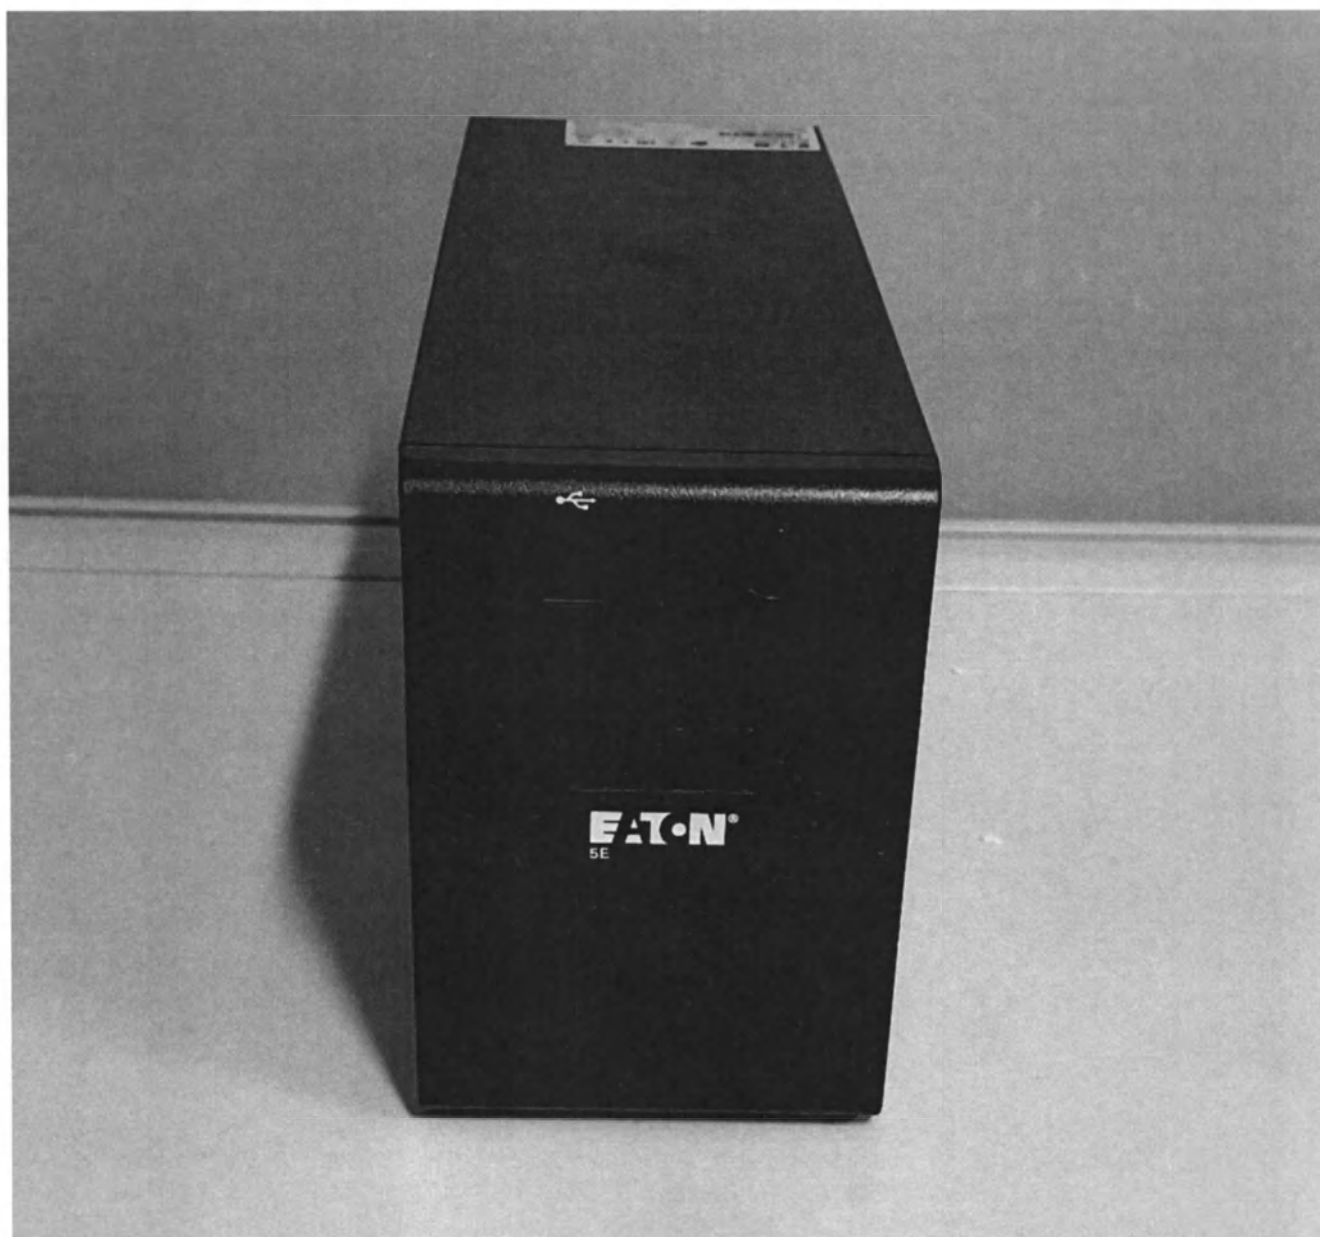

EAT•N

Catalog Nb: 5E850iUSB

MFG ID: 9C00-53219 Rev:F0P

S/N: P463M41514



CE compliance contact:

Eaton I.F. SAS- 110 rue Blaise Pascal
38330 Montbonnot St Martin- France



INPUT: 220-240V~50/60Hz

5.6A Ph+N+PE

OUTPUT: 220V-240V~50/60Hz

3.8A Ph+N+PE


850VA/480W

Protective Class I

Icc:3KA

Made in Philippines

Фотография 150 – Источник бесперебойного питания Eaton (в составе АРМ). Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки

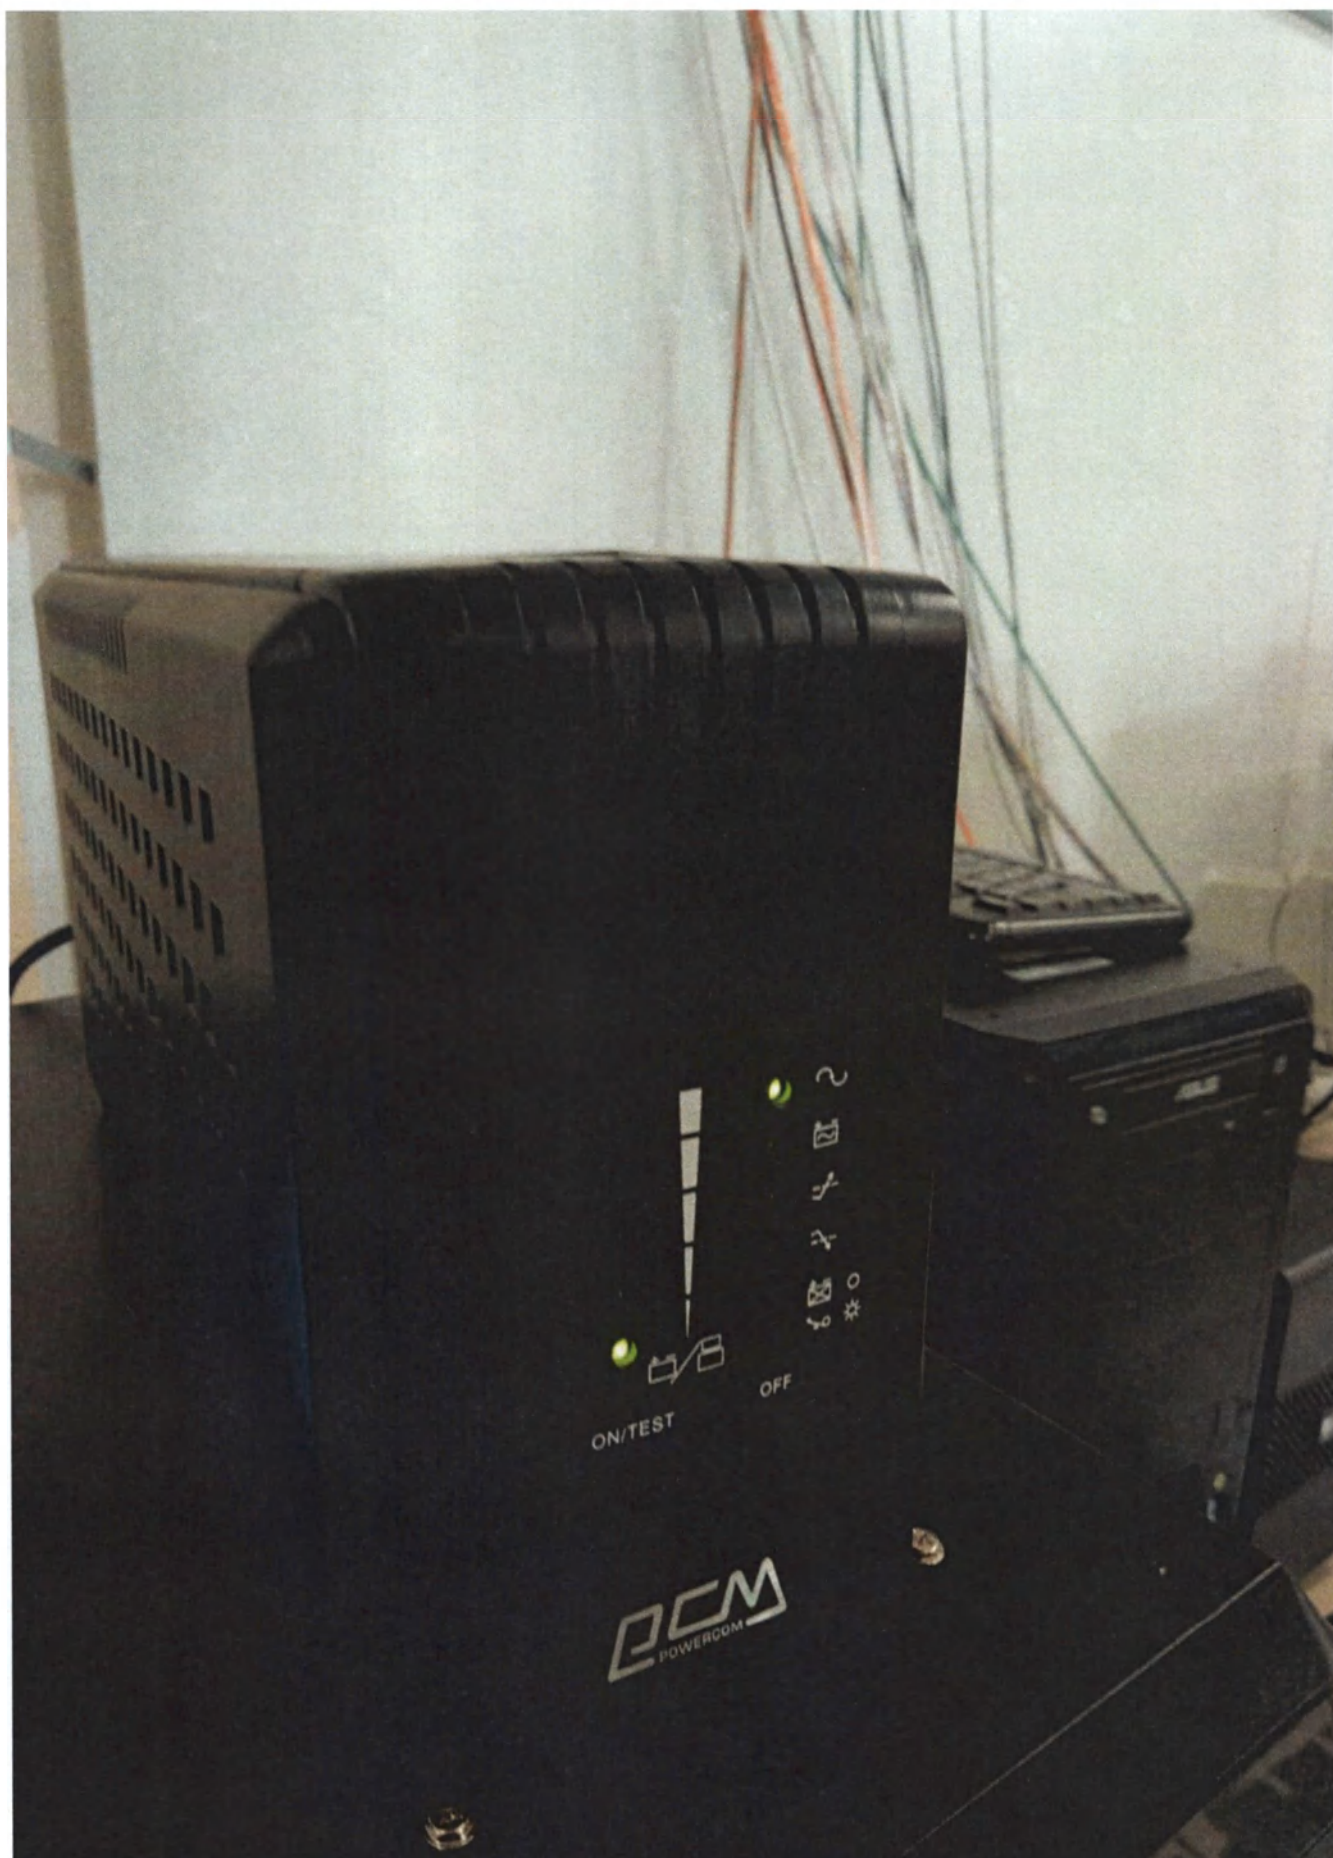

Фотография 151 – Источник бесперебойного питания (в составе АРМ) серии SPT, POWERCOM CO., Ltd Тайвань.
Вариант внешнего вида




Model:
SPT-700A CE
Input :AC 220-240V
50/60Hz 8A max.
Battery Backup Output:
AC ■ 220V □ 230V □ 240V
50/60Hz 560W max.
Surge Protected Output:
Total 8A max. with
Battery backup output.



S/N:40223522209

Фотография 152 – Источник бесперебойного питания (в составе АРМ) серии SPT, POWERCOM CO. Образец внешнего вида варианта маркировки

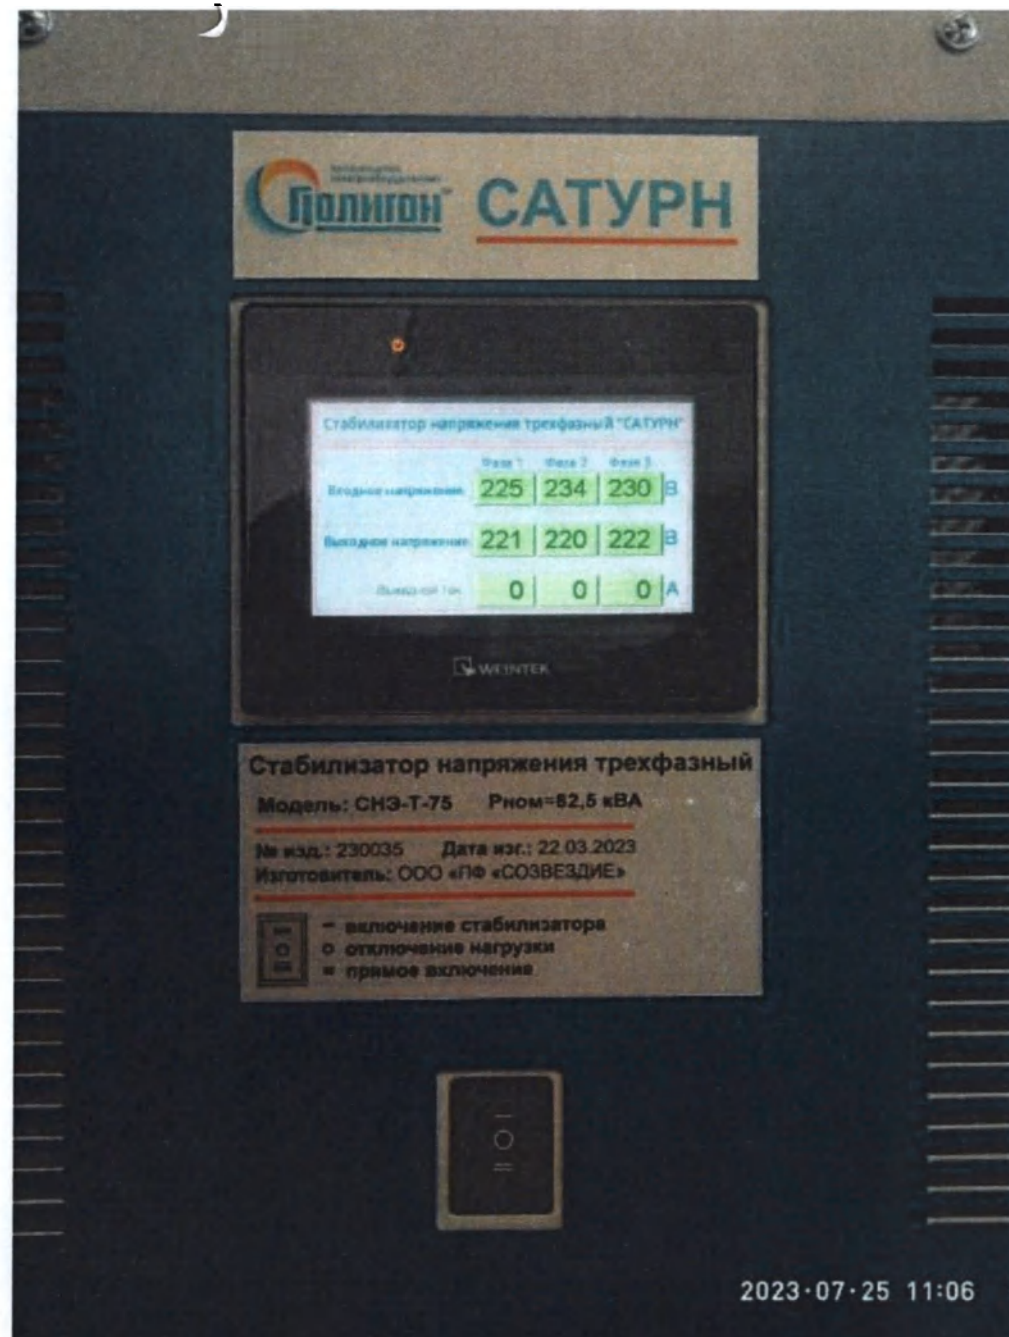

Фотография 153 – Стабилизатор серии СНЗ (вариант внешнего вида) в составе спецификации АРМ WST1-00, АО «НИПК «Электрон»



Фотография 154 – Стабилизатор серии АСН (вариант внешнего вида) в составе спецификации АРМ WST1-00, АО «НИПК «Электрон». Вариант внешнего вида




Фотография 155 – Дозиметр серии KermaX, IBA Dosimetry GmbH. Вариант внешнего вида




Фотография 156 – Дозиметр серии MICRO IBA Dosimetry GmbH. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 157 – Дозиметр ДРК-1 с упаковкой и документацией. Вариант внешнего вида

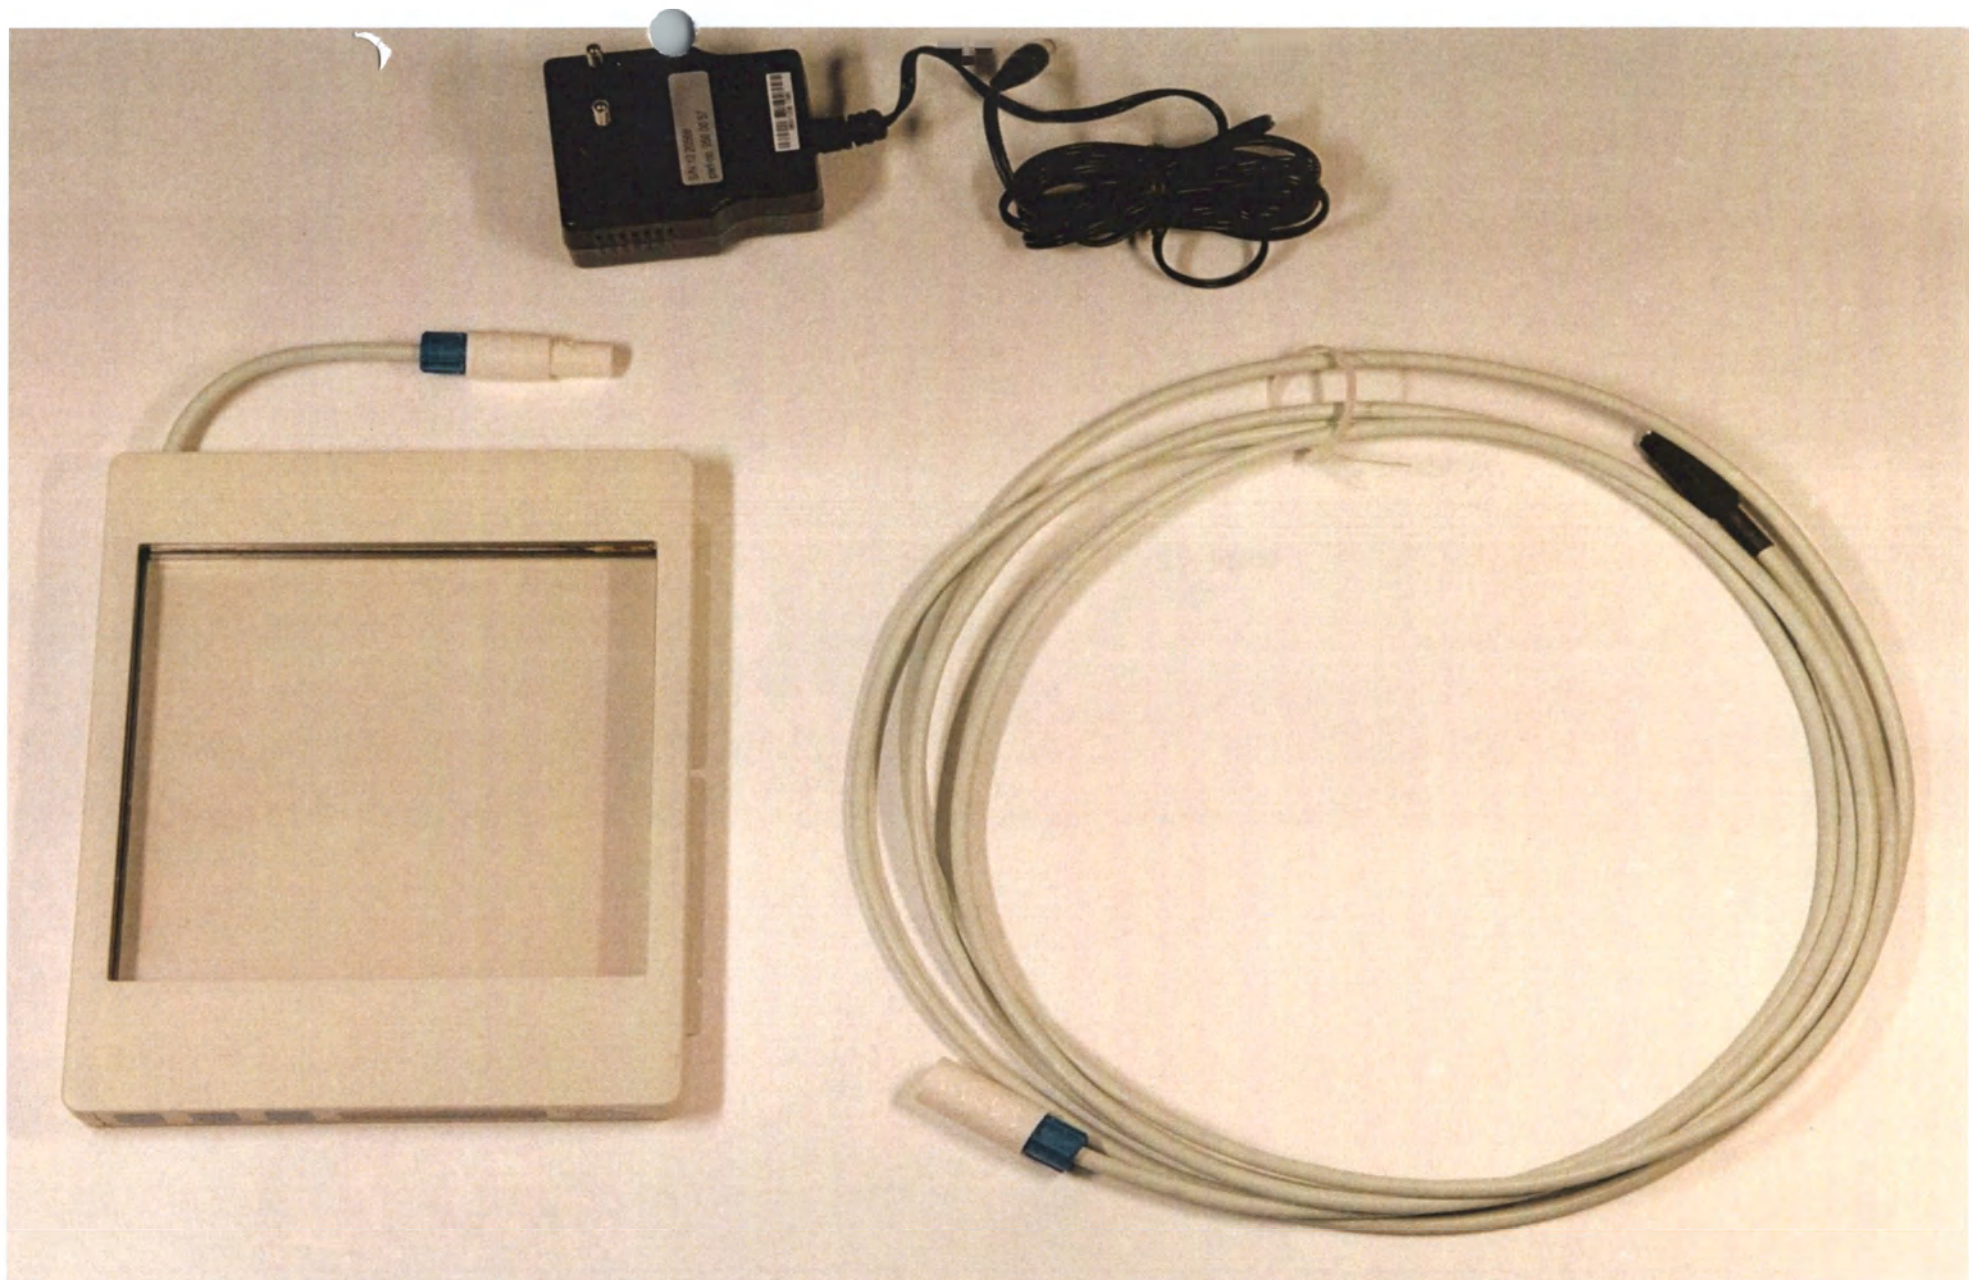

Фотография 158 – Дозиметр серии VacuDAP, VacuTec, Meßtechnik GmbH, ФРГ/РУ № ФСЗ 2012/11816. Вариант внешнего вида

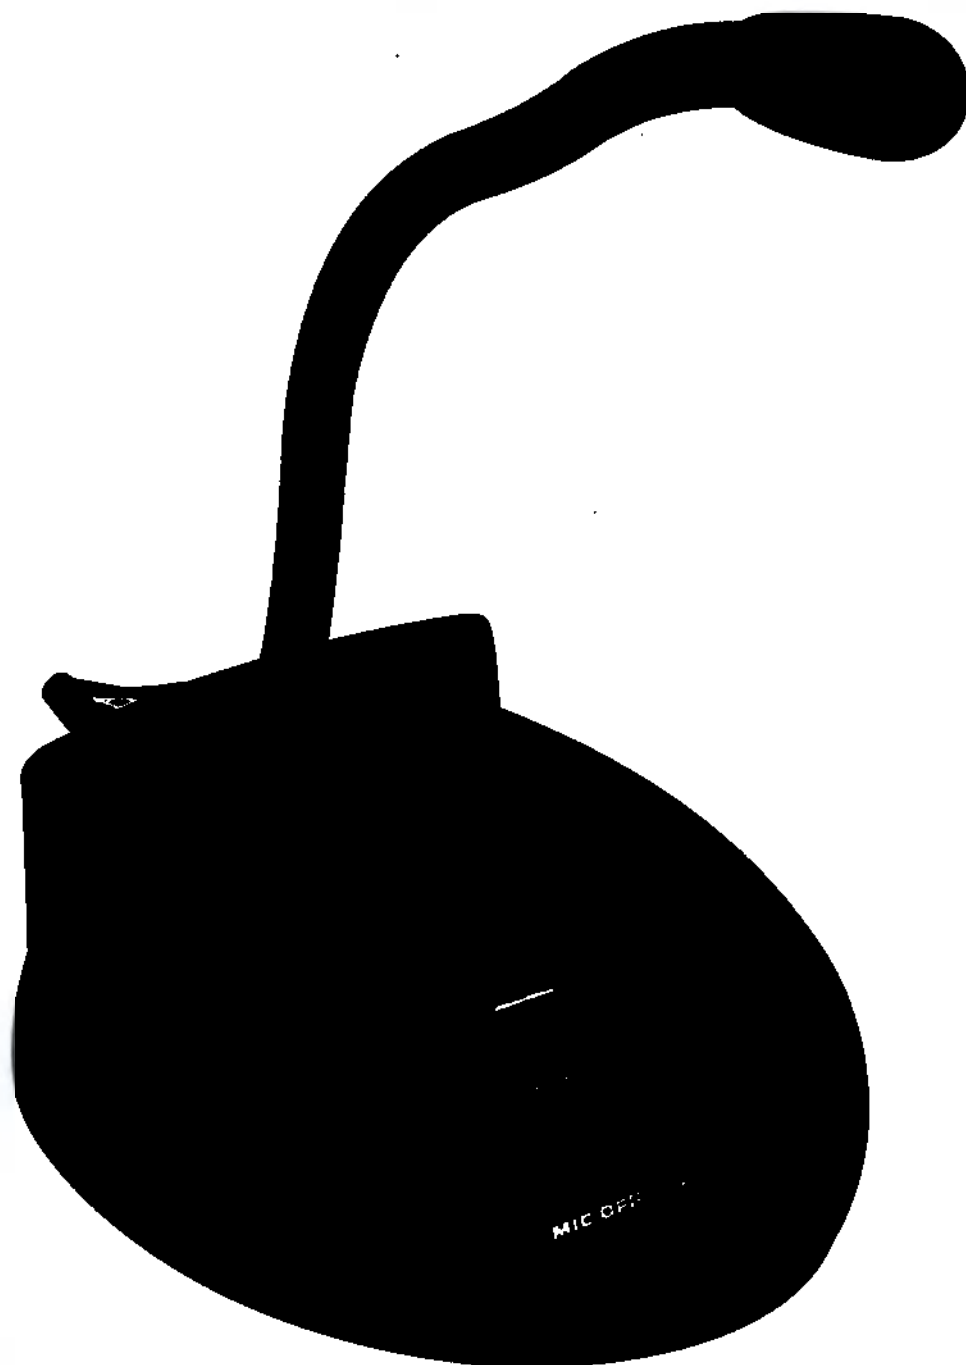

Фотография 159 – Устройство переговорное KRT-10-0910. Вариант внешнего вида

НАИМЕНОВАНИЕ	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ	KRT-10-0910
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
+7,5В 0,23А	

Фотография 160 – Устройство переговорное KRT-10-0910. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 161 – Инъектор автоматический серии Vicor-HI Angio, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Вариант внешнего вида



Lepu Equipment
乐普装备

Lepu Medical
Equipment(Beijing)Co.Ltd

Angio Angiographic High-Pressure Injecto

serie Vicor-HI Angio

No.60, Shunren Road,Linhe Development Zone,
Shunyi District, Beijing, China



Lepu Equipment
乐普装备

血管造影高压注射器

注册证编号: 京械注准20222060411

型号: Vicor-HI Angio

(01) 06974091370110

网电 源: ~220V, 50 Hz

输入功率: 1kVA

出厂编号: VHIAngle2023007

(11) 230627 (21) VHIAngle2023007

生产日期: 2023年3月

使用年限: 10年

联系电话: +86-010-89491372

注册人/生产企业名称: 乐普(北京)医疗装备有限公司

注册人/生产企业住所: 北京市顺义区林河开发区顺仁路60号

生产地址: 北京市顺义区林河开发区顺仁路60号2幢东区

生产许可证编号: 京药监械生产许20000237号



IPX1




其他内容详见
说明书

Фотография 162 – Инъектор автоматический серии Vicor-HI Angio, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 163 – Инъектор автоматический серии Mark MEDRAD Inc. Вариант внешнего вида

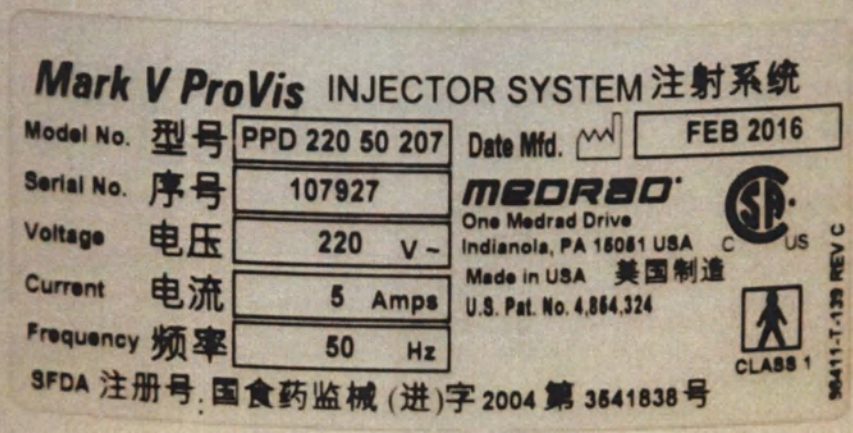

Фотография 164 – Инъектор автоматический серии Mark MEDRAD Inc. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 165 – Система инъекционная для ангиографии MEDRAD Avanta с принадлежностями, Bayer Medical Care Inc., США, РУ № РЗН 2016/4162. Вариант внешнего вида



Фотография 166 – Инъектор автоматический для введения контрастного вещества Accutron с принадлежностями, MEDTRON AG, Германия, РУ № ФСЗ 2011/09220. Вариант внешнего вида



Фотография 167 – Инжекторы автоматические для введения контрастного вещества исполнения Optivantage DH с принадлежностями, Liebel-Flarsheim Company LLC, РУ № ФСЗ 2012/13277. Вариант внешнего вида



Фотография 168 – Система подачи контрастного вещества с принадлежностями SmartShot Alpha и/или Dual Shot Alpha 7, Nemoto Kyorindo Co Ltd, Япония, РУ № РЗН 2016/4501 , РУ № РЗН 2016/4368. Вариант внешнего вида



Фотография 169 – Окно рентгенозащитное серии MACO, Hans O.Mahn & Co. KG. Вариант внешнего вида



Фотография 170 – Окно рентгенозащитное, ЗАО «Ренекс». Вариант внешнего вида



Фотография 171 – Окно рентгенозащитное серии Roesys XPW, Roesys GmbH, Германия. Вариант внешнего вида

roesys
Digital X-Ray Systems

**Roesys GmbH Dr. Max-Ilgner Str.2
32339 Espelkamp / Germany**

Protective glass
Series: Roesys XPW
Model: 1000x800
Lead equivalent: 2,5 mm

Produced by Roesys GmbH, Germany

Фотография 172 – Окно рентгенозащитное серии Roesys XPW, Roesys GmbH. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 173 – Окно ОАРЗ по ТУ 6968-002-91065324-2016 ООО «ПКФ «Промет-Урал», Россия. Вариант внешнего вида



Фотография 174 – Монитор для анестезиологии и интенсивной терапии МАИТ, ООО «Медицинские системы», РУ ФСР 2009/04980. Вариант внешнего вида




Фотография 175 – Монитор для анестезиологии и интенсивной терапии МАИТ, ООО «Медицинские системы». Образец внешнего вида варианта маркировки. РУ ФСР 2009/04980



Фотография 176 – Средства отображения состояния пациента: Монитор серии K, Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. Вариант внешнего вида



Фотография 177 – Средства отображения состояния пациента: монитор серии К, Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. (вариант внешнего вида сзади, место нанесения маркировки)

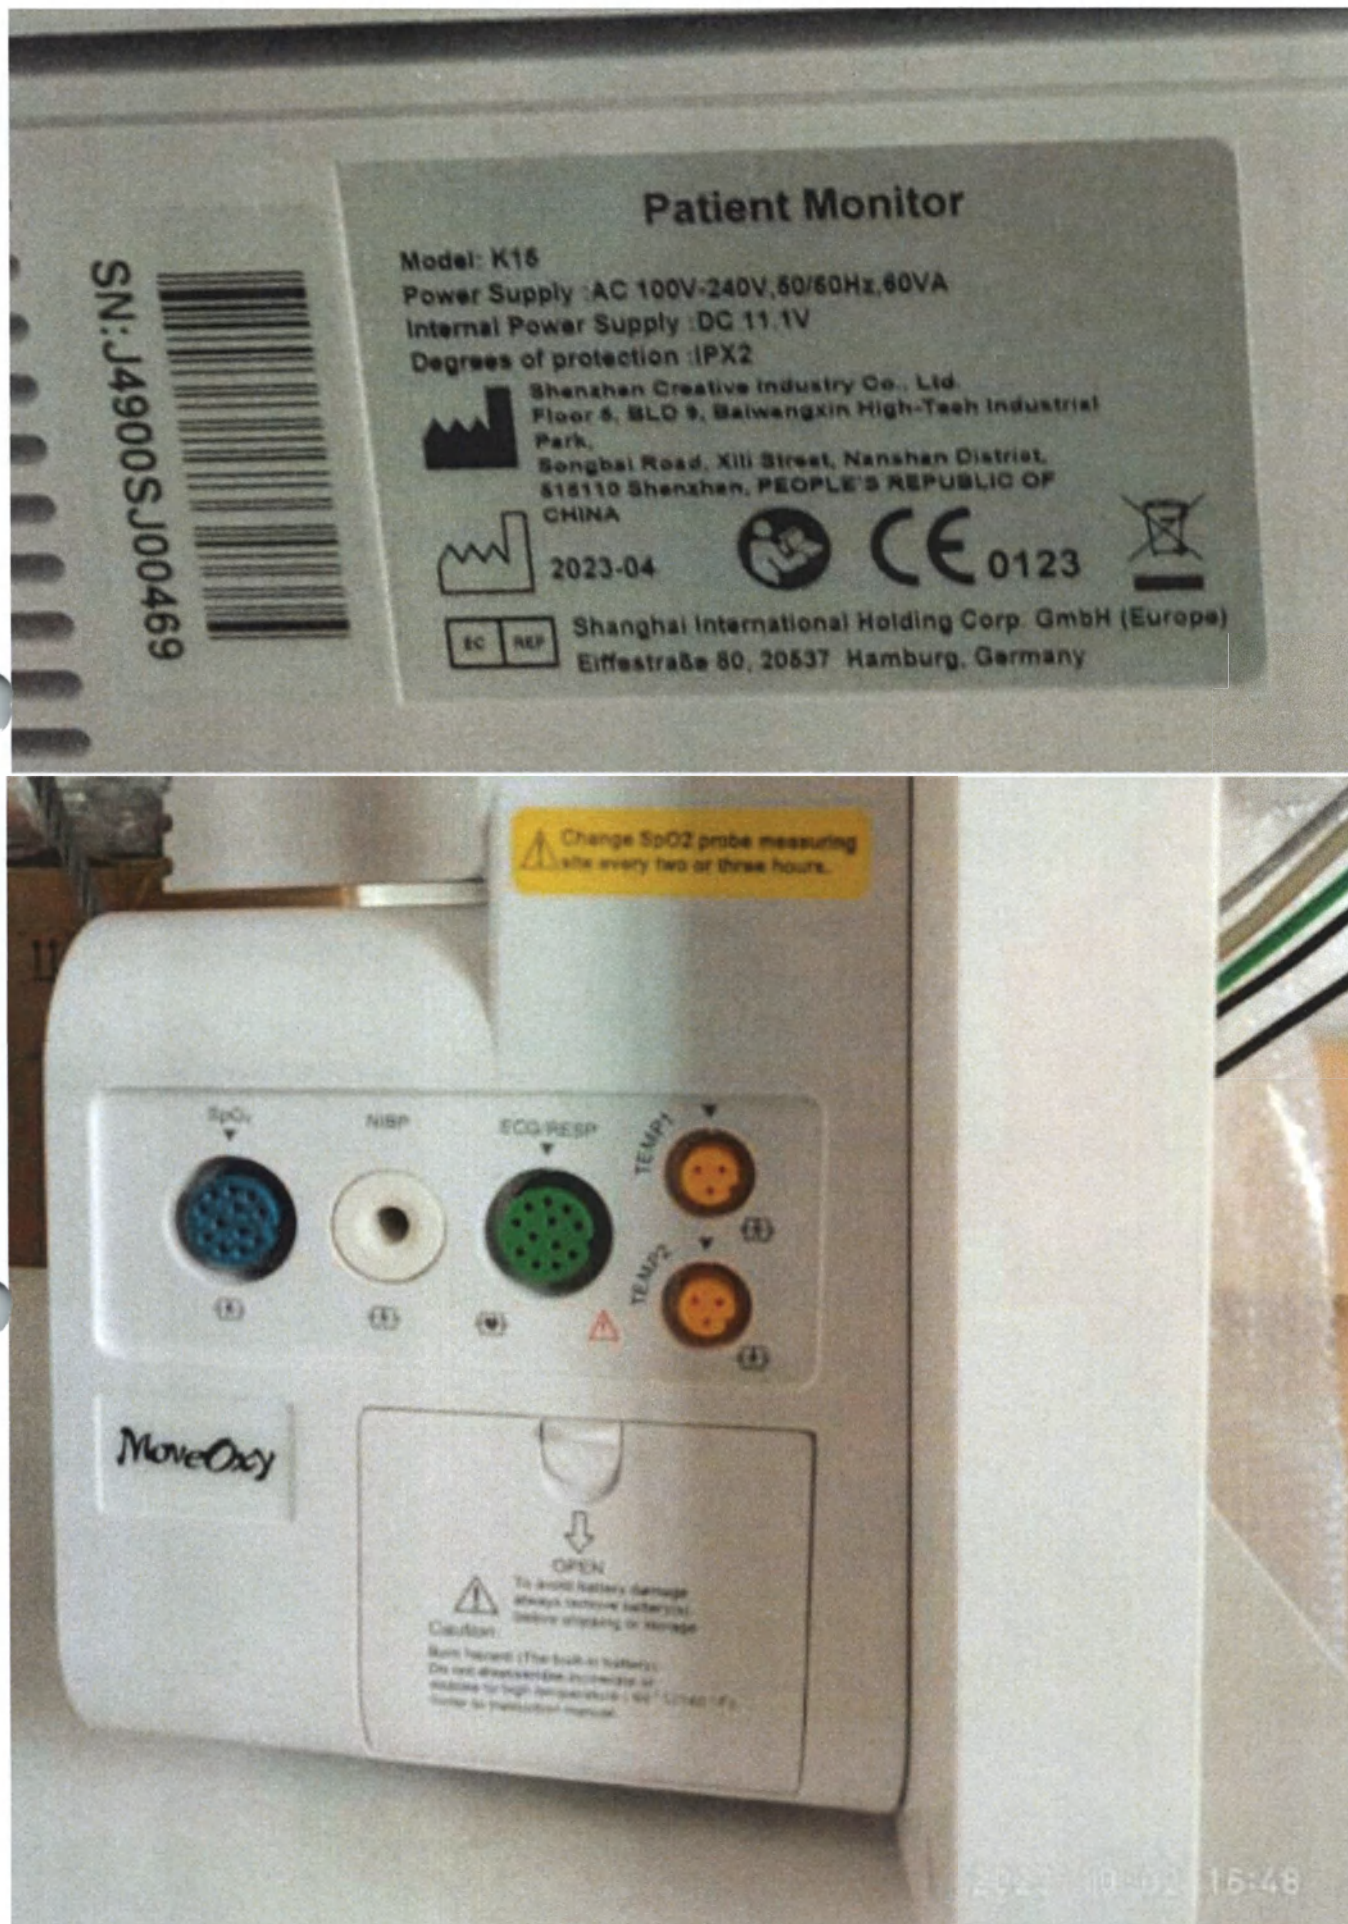

Фотография 178 – Средства отображения состояния пациента: монитор серии K. Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. Вариант внешнего вида сзади и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 179 – Монитор пациента с принадлежностями серии BeneView T9, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., РУ № РЗН 2018/6916. Вариант внешнего вида



Фотография 180 – Монитор пациента серии BeneView T5 RUS, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», РУ № РЗН 2018/6952. Вариант внешнего вида




Фотография 181 – система мониторинга физиологических показателей пациентов с принадлежностями исполнения BeneVision N22, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., ПУ № ПЗН 2019/9516. Вариант внешнего вида



Фотография 182 – Монитор пациента с принадлежностями система мониторинга физиологических показателей с принадлежностями серии BeneVision, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., ПУ № ПЗН 2020/9549. Вариант внешнего вида



Фотография 183 – центральная система мониторинга серии BeneVision. Вариант внешнего вида

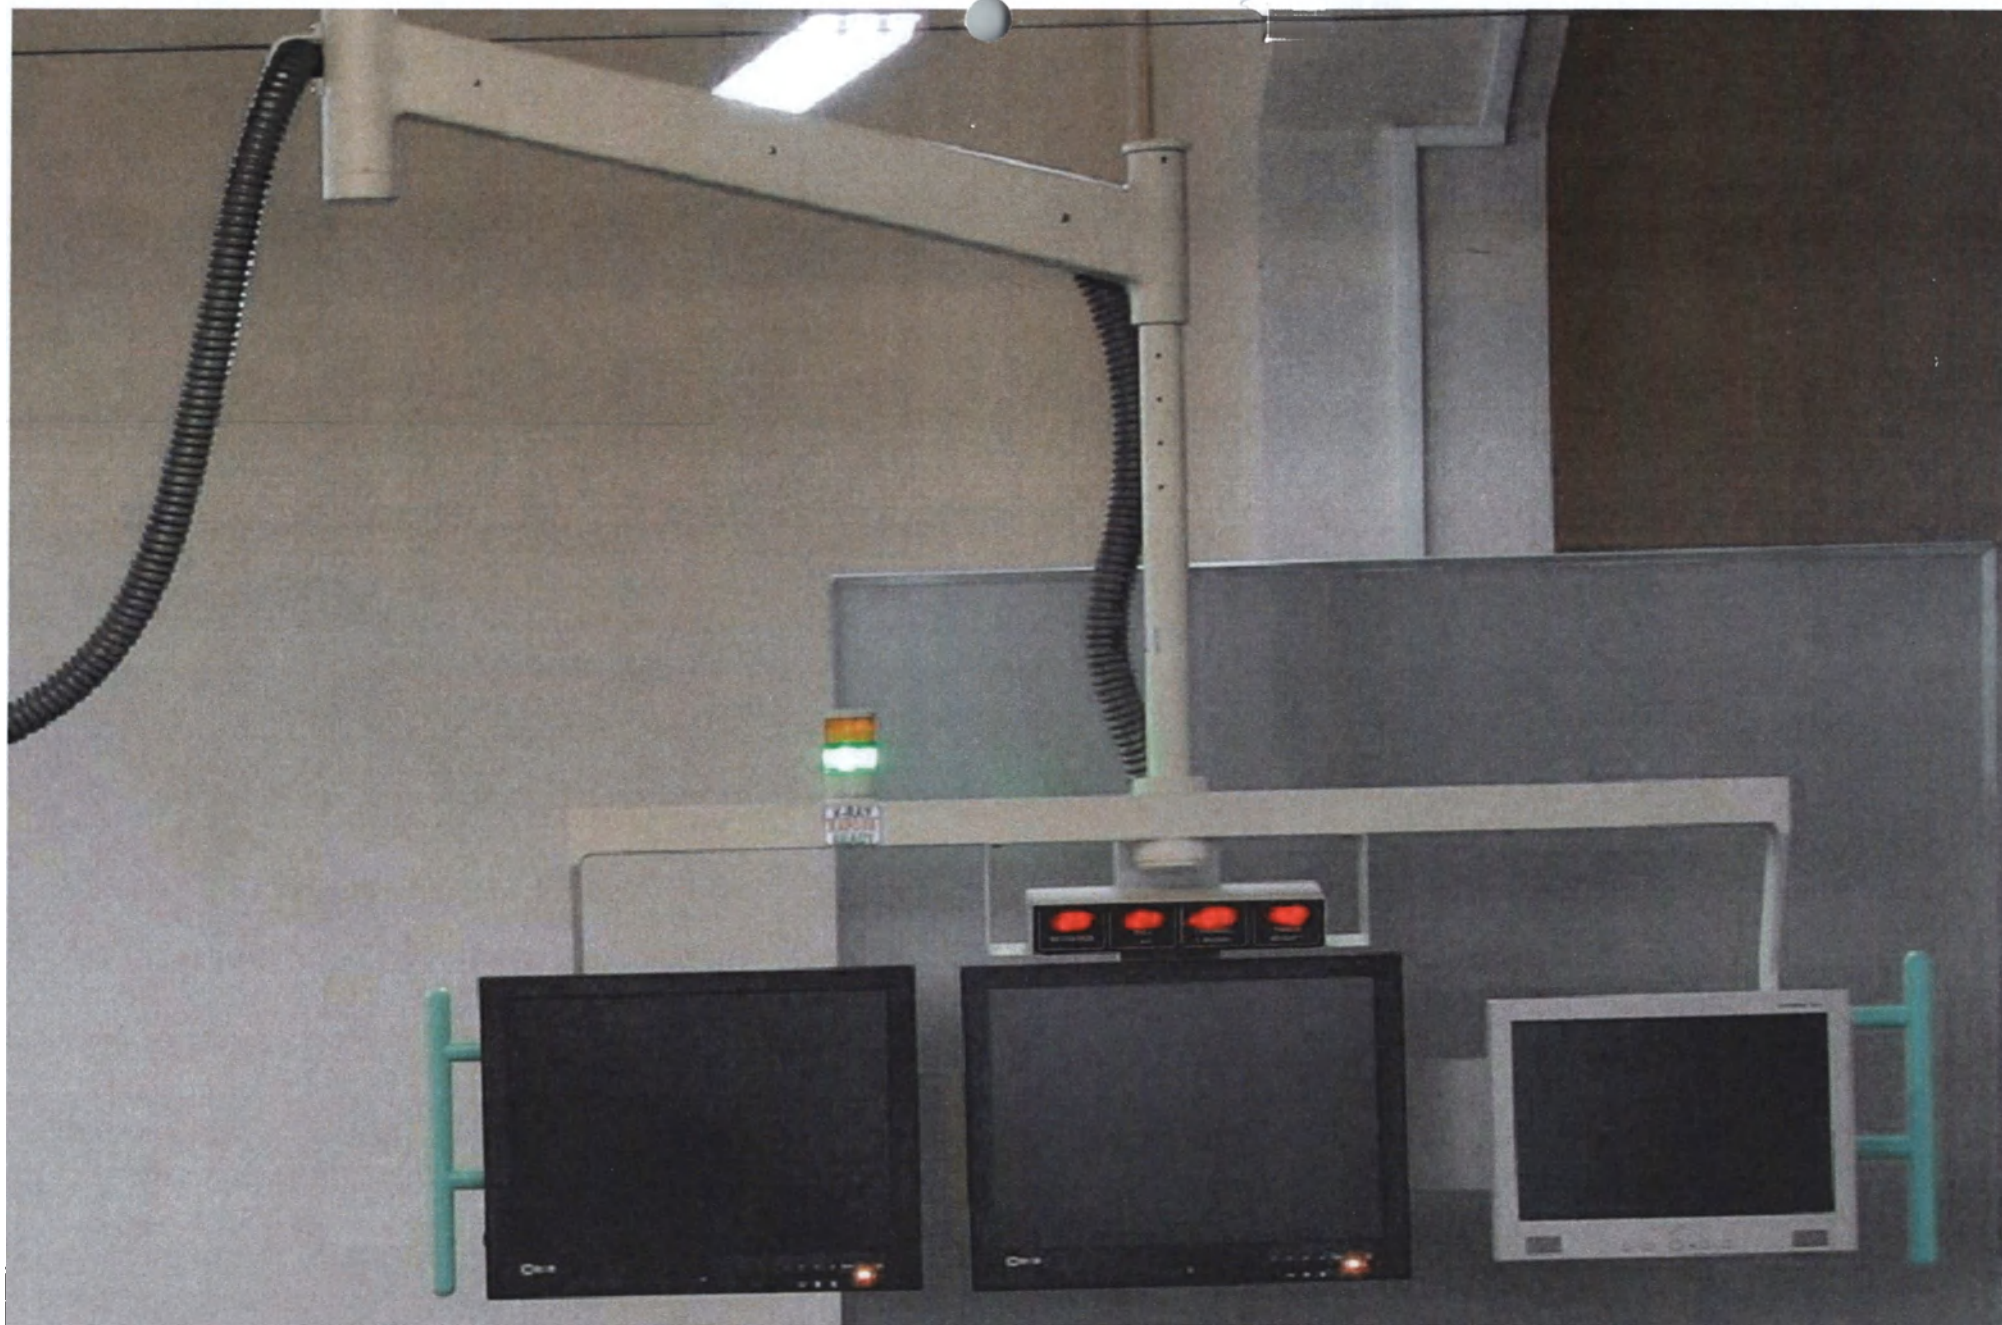

Фотография 184 – Подвес мониторов серии D, Omega Medical Imaging. Вариант внешнего вида

Omega Medical Imaging, LLC.

675 Hickman Circle, Sanford, FL 32771

Made in the U.S.A

Monitor Suspension
Configuration: B-200/C-300 (Lower Section)

Series: D

Serial Number: 6026

Power: 208/220/240 ~ 15A ~ 50/60 Hz



TYPE B
IEC60601-1

Complies with 21 CFR
Subchapter J
at the date of manufacture.

IEC60601-1




Date of Manufacture: August 2016

Label P/N 0310-0041 Rev 2

Фотография 185 – Подвес мониторов серии D, Omega Medical Imaging. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 186 – Подвес мониторов серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Вариант внешнего вида

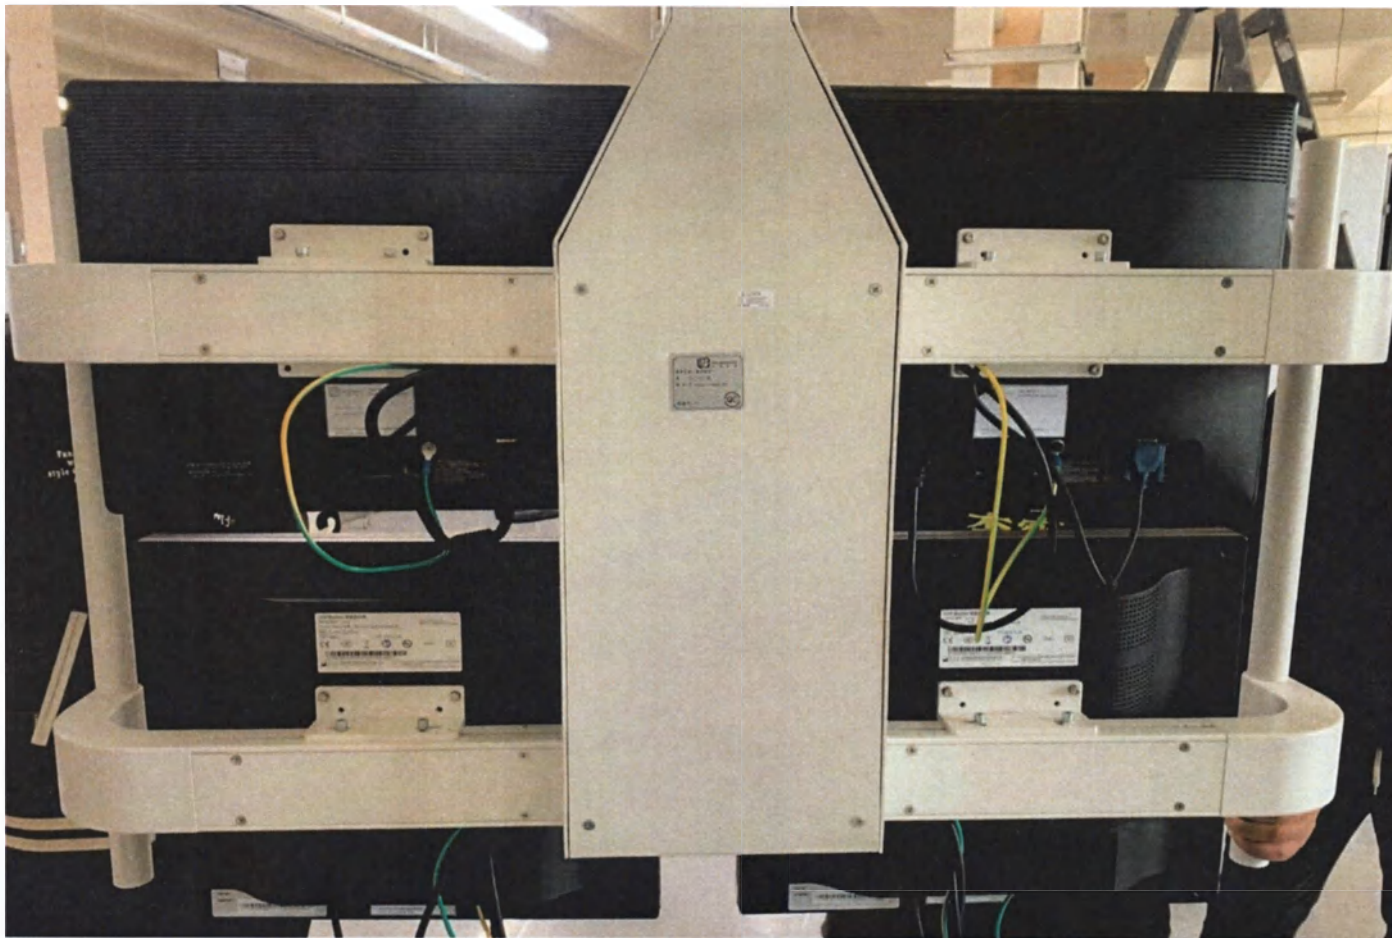

Фотография 187 – Подвес мониторов серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd (вариант внешнего вида сзади, место нанесения маркировки)



Фотография 188 – Подвес мониторов серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Маркировка
Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 189 – Светильники хирургические настенные и потолочные ЭМАЛЕД (образец) Завод ЭМА, РУ № ФСР 2010/07446. Вариант внешнего вида



Фотография 190 – Светильники медицинские хирургические Armed (образец), Shanghai Medical Instrument Co Ltd, РУ № РЗН ФСЗ 2012/12303. Вариант внешнего вида



а) - образец серии HyLED серии 8



б) - образец серии HyLED X

Фотография 191 – Светильник хирургический светодиодный с принадлежностями серии HyLED и/или HyLED серии 8 и/или серии HyLED X 8, Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd,
 РУ № РЗН 2014/2265, РУ № РЗН 2021/16155, РУ № РЗН 2021/13450. Вариант внешнего вида



Фотография 192 – КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004 (образец из состава комплекта). Вариант внешнего вида



а) – образец жилета рентгенозащитного из комплекта



б) – образец набора рентгенозащитных пластин из комплекта

Фотография 193 – Комплект индивидуальных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«ПРОМЕТ» по ТУ 14.12.30-001-39575739-2019, ООО «ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН». Вариант внешнего вида



Комплекс ангиографический рентгеновский АКР

№GP*****

МЕСТО № 1/X

Контракт №

Заказчик

Поставщик

Грузополучатель

Пункт назначения

БРУТТО *** Кг

Грузоотправитель:


НЕТТО *** Кг

АО «НИПК «Электрон»,
197758, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.
Г. Поселок Песочный, ул. Садовая, д. 88,
стр. 1, помещ. 8Н

*** х *** х *** СМ

ВНИМАНИЕ!

Вскрывать только в присутствии представителя поставщика



Фотография 194 – Фотография варианта внешнего вида изделия в упаковке и макет образца внешнего вида варианта маркировки



Комплекс ангиографический рентгеновский АКР

№GP*****

МЕСТО № 1/X

Контракт №

Заказчик

Поставщик

Грузополучатель

Пункт назначения

БРУТТО *** Кг

Грузоотправитель:

НЕТТО *** Кг

АО «НППК «Электрон»,
197758, г. Санкт-Петербург, ВН ТЕР.
Г. Поселок Песочный, ул. Садовая, д. 88,
стр. 1, помещ. 8Н

*** х *** х *** см

ВНИМАНИЕ!

Вскрывать только в присутствии представителя поставщика



Фотография 194 – Фотография варианта внешнего вида изделия в упаковке и макет образца внешнего вида варианта маркировки

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 142
(Сило ссылаемся лист(ов))
96a)

РУКОВОДИТЕЛЬ
СЕРТИФИКАЦИИ
ДЕНИСОВА О.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ

