

Фотографические изображения медицинского изделия

Комплекс ангиографический рентгеновский

АКР-«ОКО»

по ТУ 9442-031-1150760-2009



Фотография 1 – Комплекс ангиографический рентгеновский АКР-ОКО, АО «НИПК «Электрон». Вариант внешнего вида комплекса по спецификации АКР-00-0000-30 в комплектации с напольным штативом ангиографическим С-дуга серии VCV и столом для катетеризации серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd

ЭЛЕКТРОН

Комплекс
ангиографический
рентгеновский
АКР-"ОКО"
ГОСТ Р МЭК 60601-2-43

ОБОЗНАЧЕНИЕ МИ

AKR-00-0000-30:0

ТУ

9442-031-11150760-2009

Серийный номер МИ

GP0006186


Дата изготовления

2023-12

Изготовитель

АО "НИПК "Электрон"

NP-20-0510



3N~380 В, 50 Гц, 100 кВА



Фотография 2 – АКР-«ОКО». Образец внешнего вида варианта маркировки

ЭЛЕКТРОН

**Штатив
AKR-00-1000**

**Серийный номер
Дата изготовления**

**NN0006113
2023-12**

Обозначение МИ

AKR-00-0000-30:0

Серийный номер МИ

GP0006186

Изготовитель

АО «НИПК «Электрон»


NF-20-0200-01




~220 В, 50 Гц, 16 А



Фотография 3 – Штатив по спецификации AKR-00-1000. АО «НИПК «Электрон». Образец внешнего вида варианта маркировки

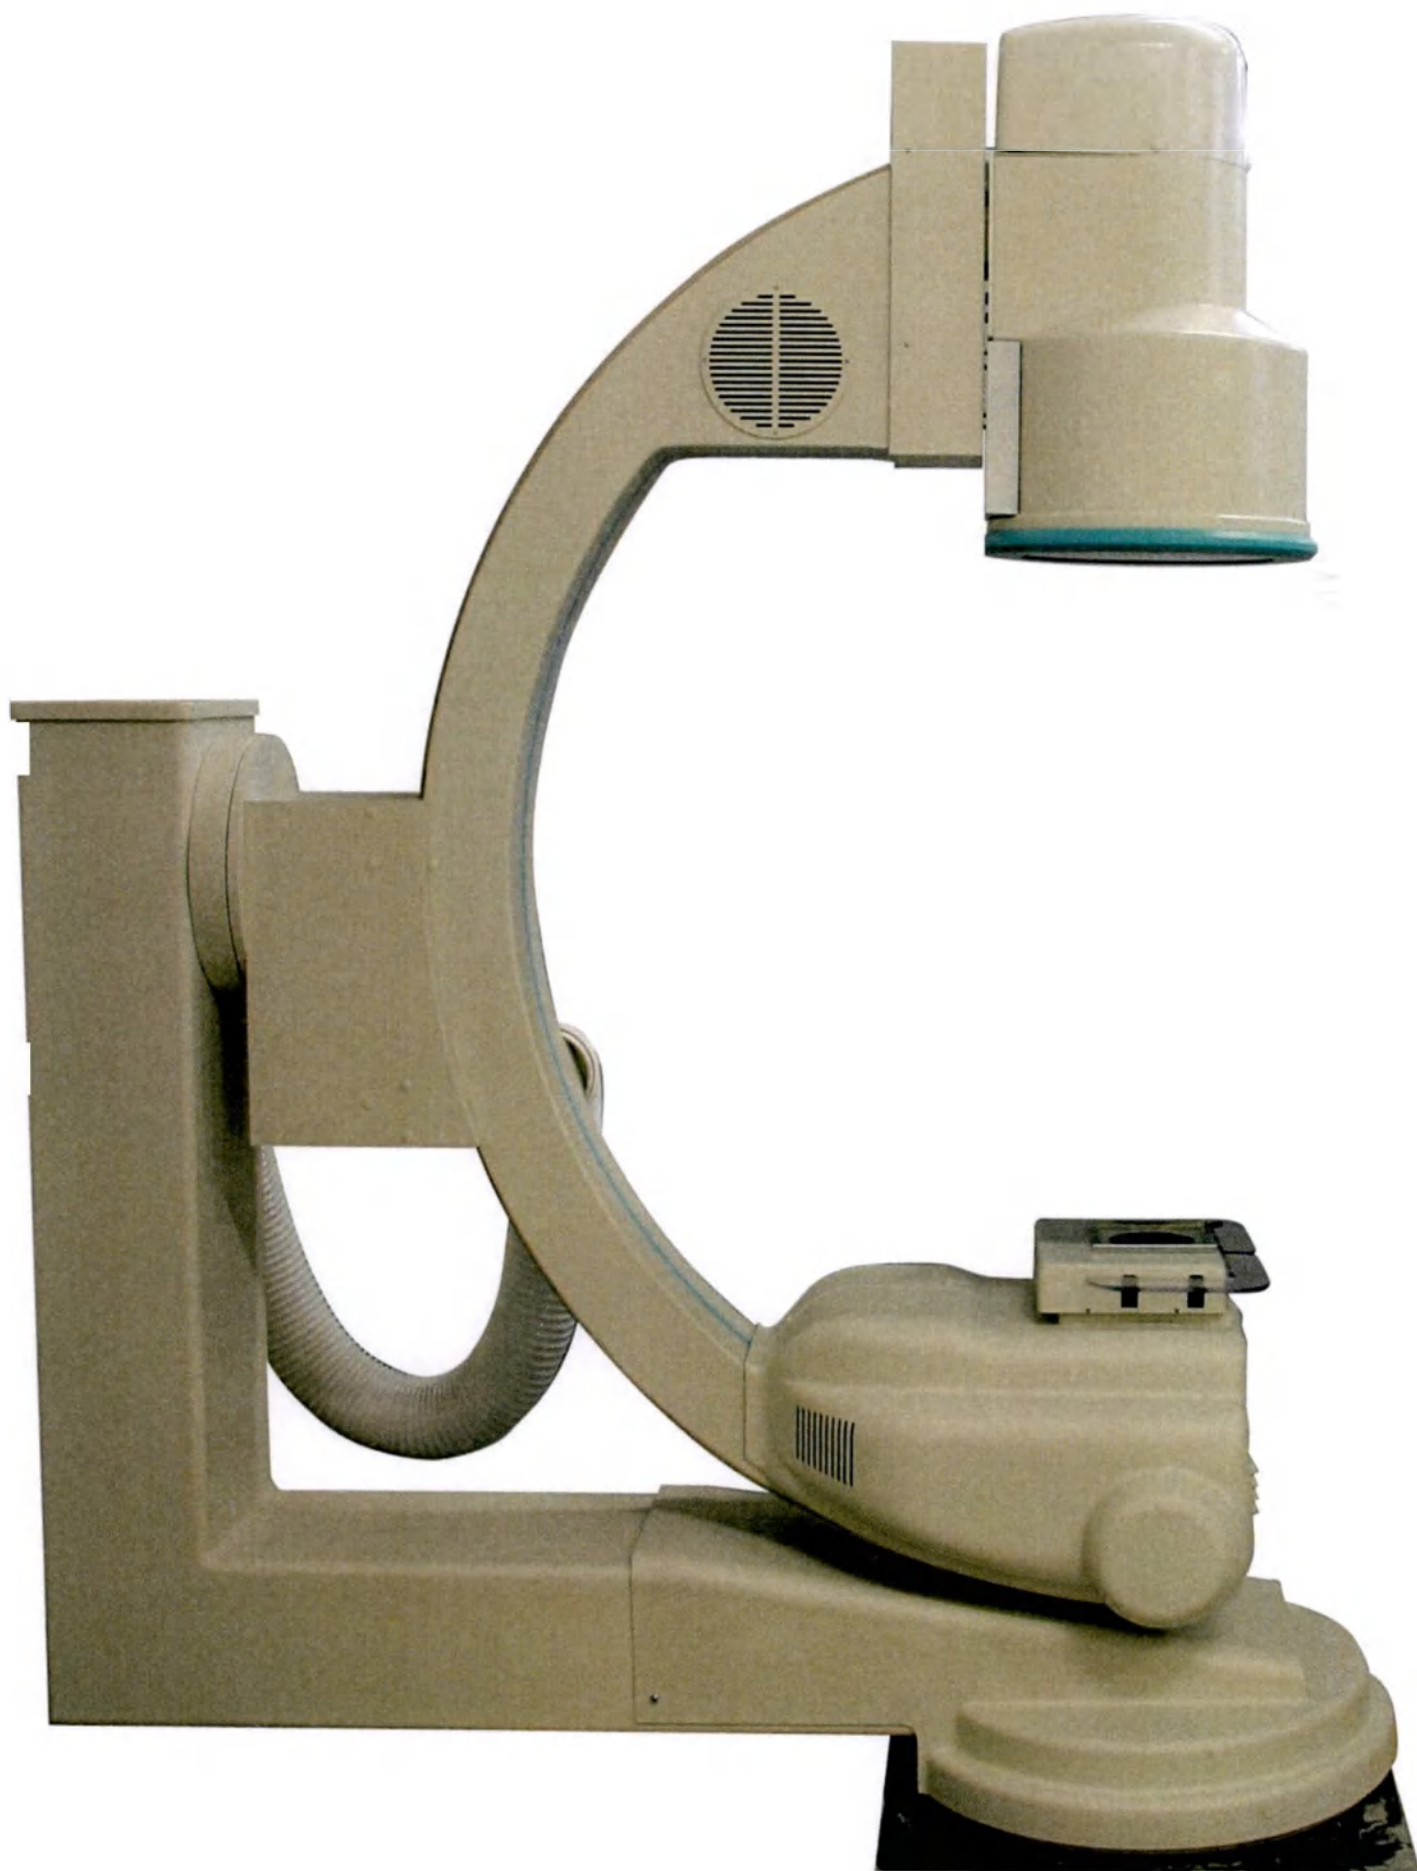

Фотография 4 – Штатив (вариант внешнего вида) по спецификации АКР-00-1000 АО «НИПК «Электрон» в комплектации: Штатив с поворотным кронштейном серии В, Omega Medical Imaging и Усилитель рентгеновского изображения УРИ по ТУ 9442-027-11150760-2007, АО «НИПК «Электрон», РУ № ФСР 2008/02453

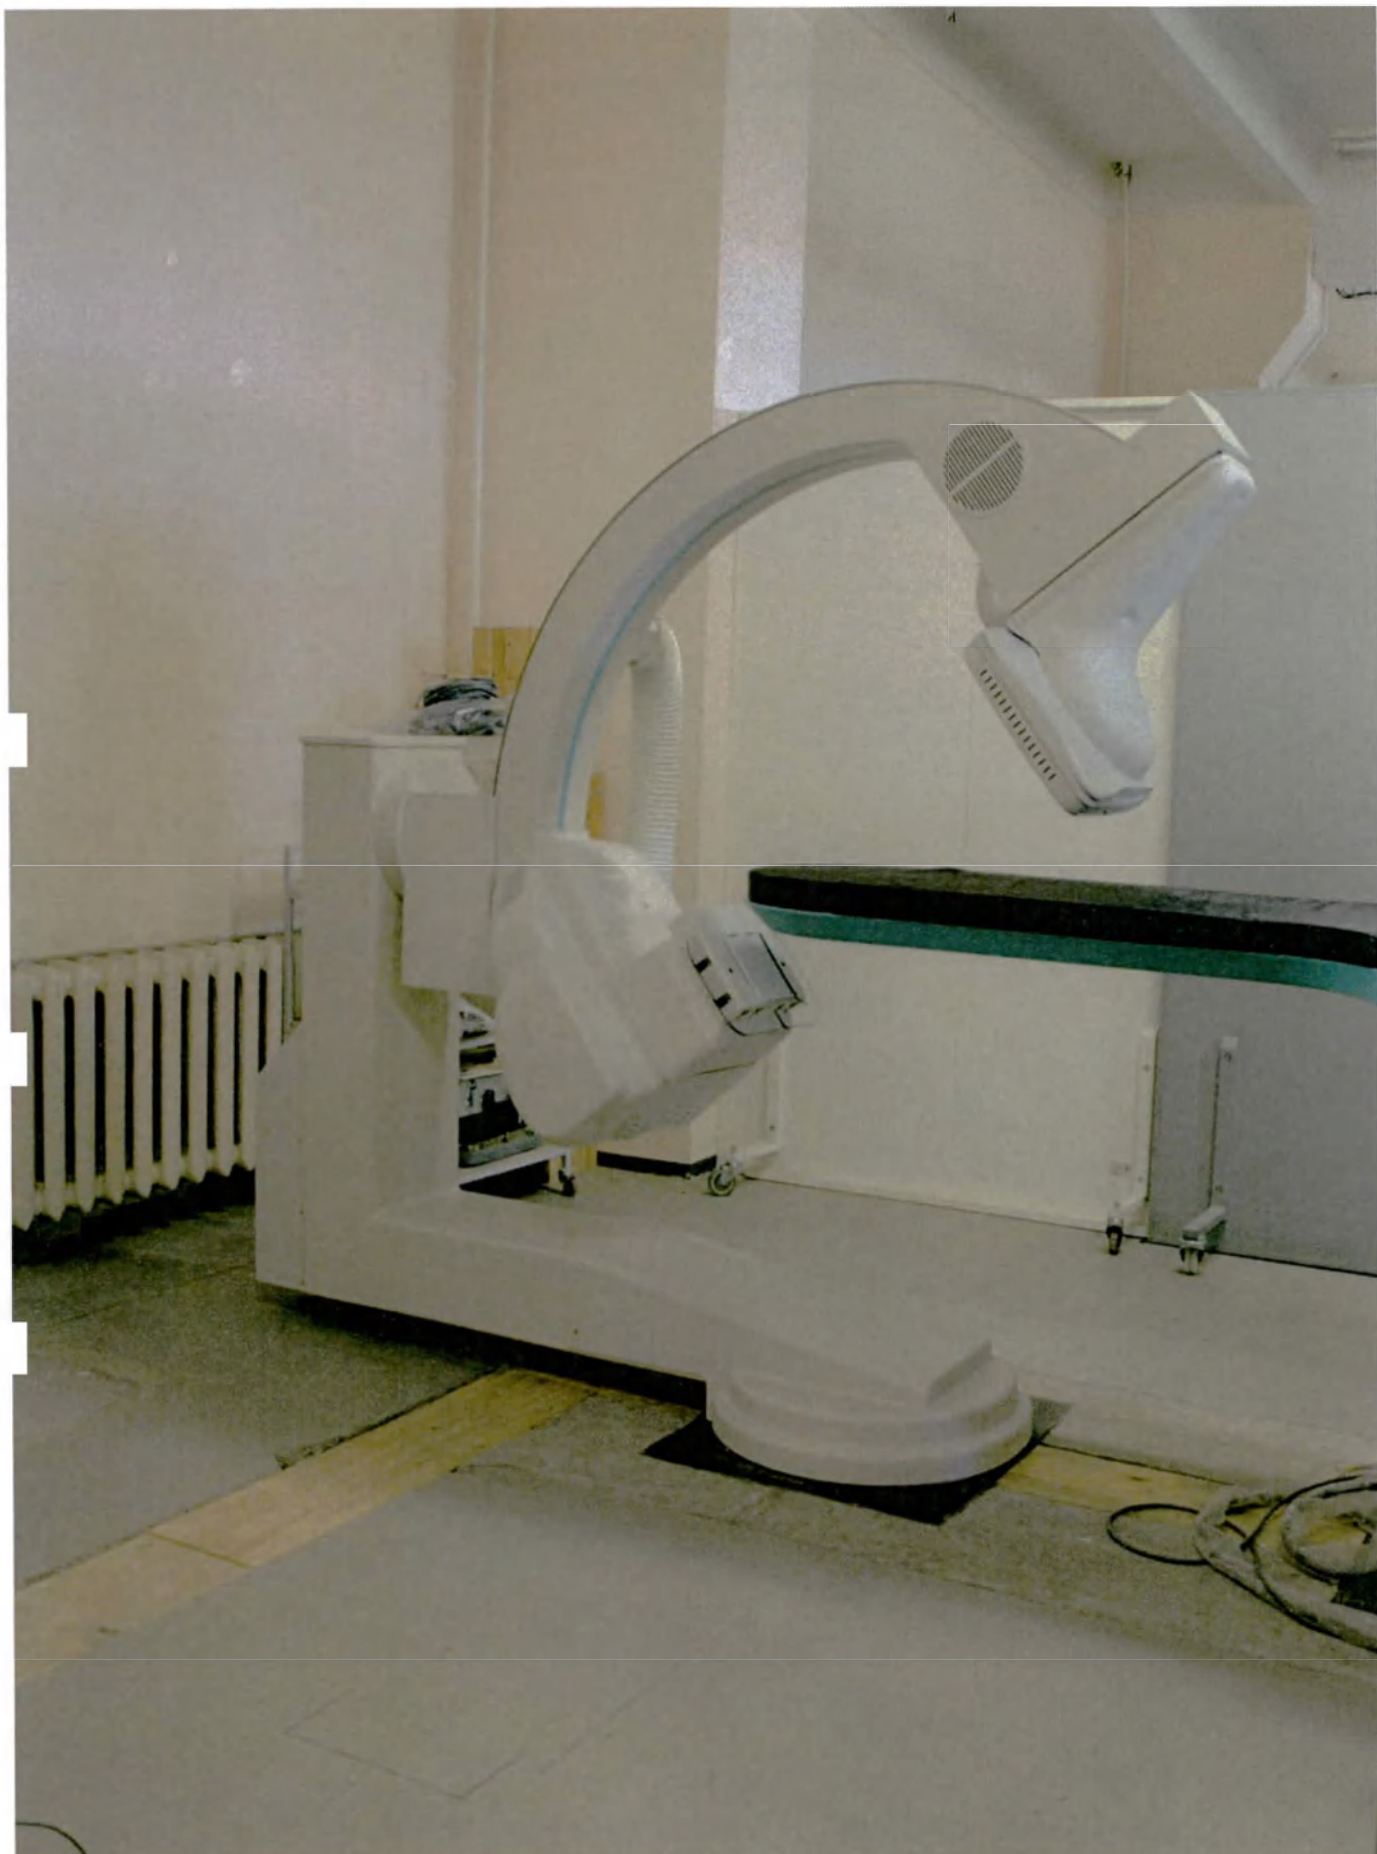

Фотография 5 – Штатив (вариант внешнего вида) по спецификации АКР-00-1000 АО «НИПК «Электрон» в комплектации: Штатив с поворотным кронштейном серии В, Omega Medical Imaging и Система визуализации рентгеновских изображений СВР по ТУ 9442-039-11150760-2015, АО «НИПК «Электрон», РУ № РЗН 2016/5112

Omega Medical Imaging, LLC.

675 Hickman Circle, Sanford, FL 32771

Made in the U.S.A

Configuration: Stand with Rotary Holder
B-200/C-300

Series: B

Serial Number: 121-16

Power: 208/220/240 ~ 15A ~ 50/60 Hz



TYPE B
IEC60601-1

Complies with 21 CFR
Subchapter J
at the date of manufacture.

IEC60601-1





Date of Manufacture: August 2016

Label P/N 0310-0041 Rev 2


Фотография 6 – Штатив с поворотным кронштейном серии В, Omega Medical Imaging. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 7 – Штатив (вариант внешнего вида) по спецификации AKR-00-1000 АО «НИПК «Электрон» в комплектации: Штатив ангиографический С-дуга серии VCV (напольный), Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd

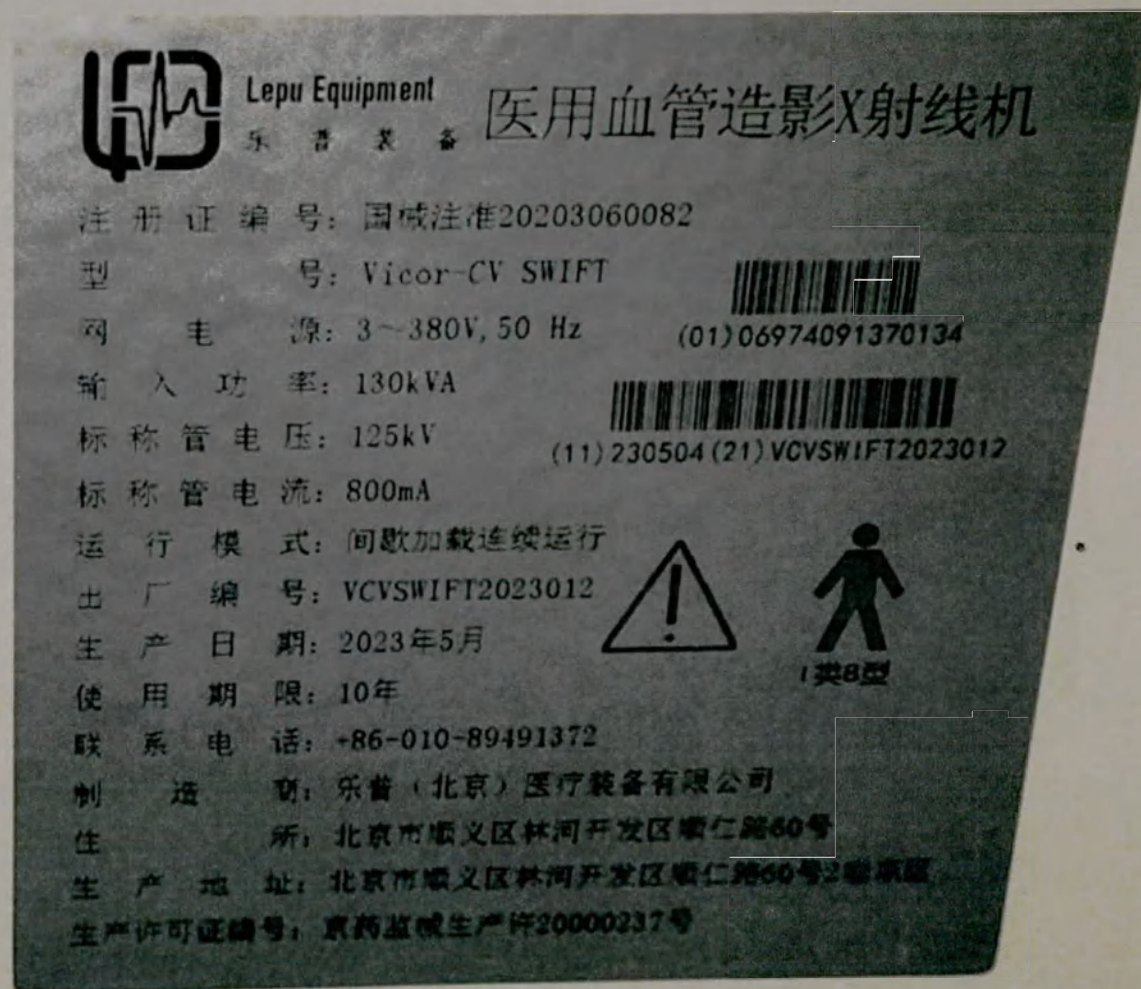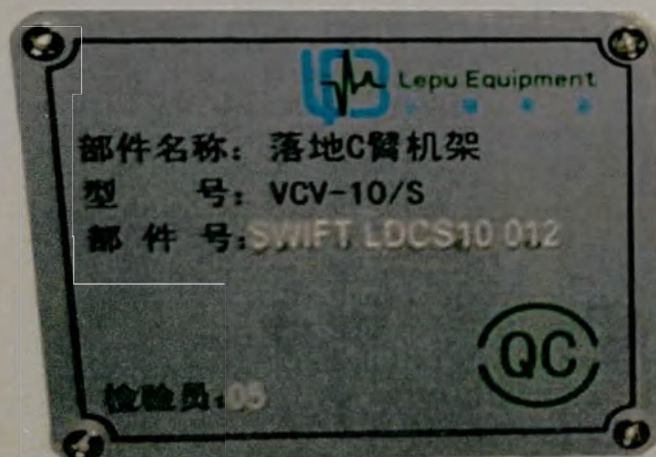

Фотография 8 – Штатив ангиографический С-дуга серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd., SWIFT LDCS10 012. Образец внешнего вида варианта маркировки

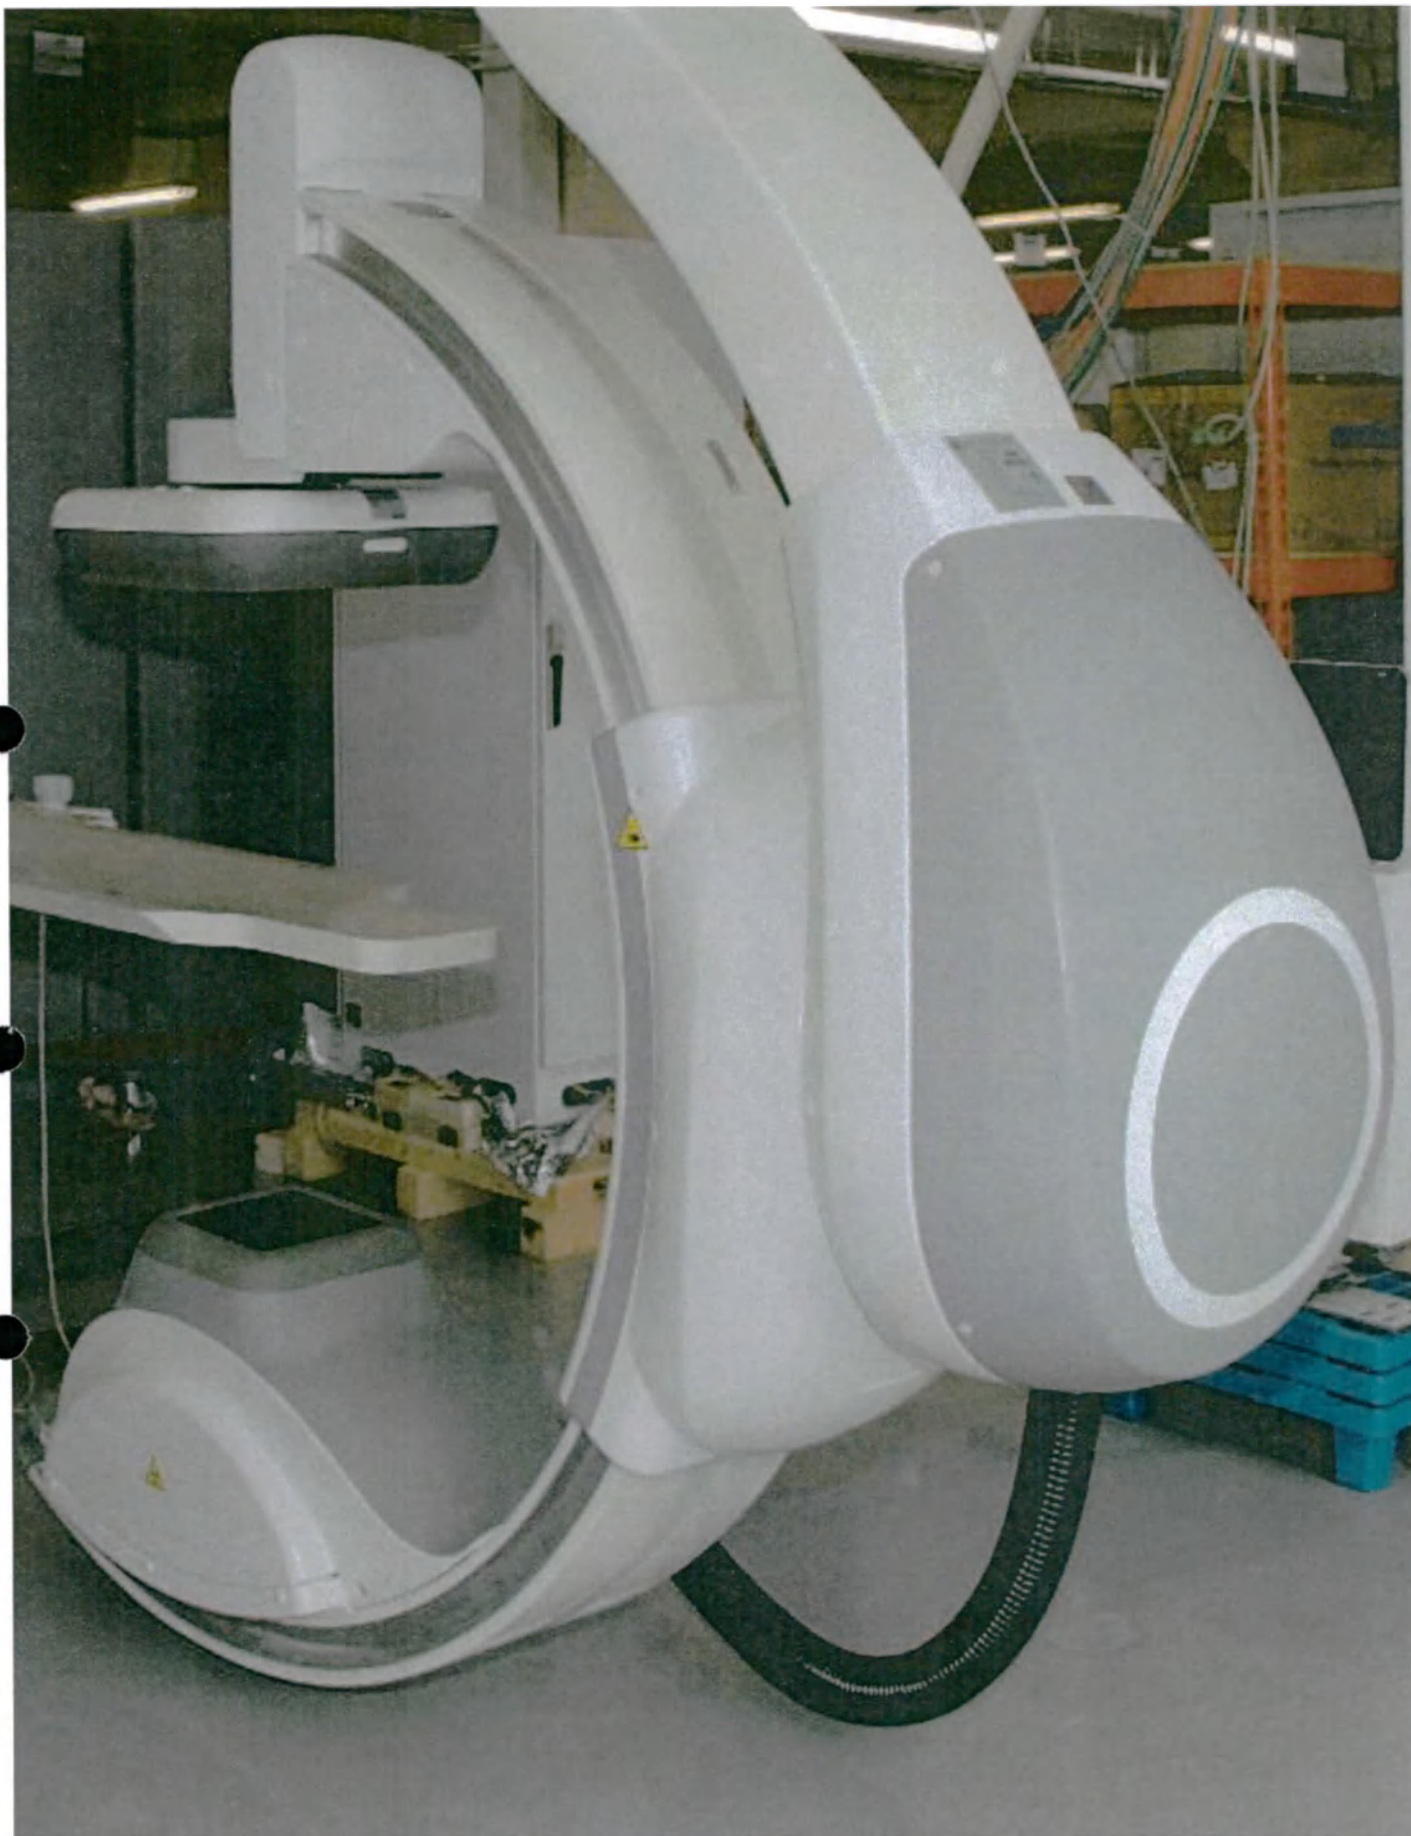

Фотография 9 – Штатив (вариант внешнего вида) по спецификации АКР-00-1000 АО «НИПК «Электрон» в комплектации: Штатив ангиографический С-дуга серии VCV (потолочный), Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd



Lepu Equipment
乐普装备

医用血管造影X射线机

注册证编号: 国械注准20203060083

型号: Vicor-CV Robin C

网 电 源: 3~380V, 50 Hz

输入功率: 150kVA

标称管电压: 150kV

标称管电流: 1000mA

运行模式: 连续运行

出厂编号: VCVRobinC2022007

生产日期: 2023年2月

使用期限: 10年

联系电话: +86-010-89491372

制造商: 乐普(北京)医疗装备有限公司

住所: 北京市顺义区林河开发区顺仁路60号

生产地址: 北京市顺义区林河开发区顺仁路60号2幢东区


生产许可证编号: 京药监械生产许20000237号



(01)06974091370158



(11)230227(21)VCVRob nC2022007



I类B型




Lepu Equipment
乐普装备

部件名称: 悬吊C臂机架

型 号: VCV-11

部 件 号: Robin C XDC11 007



检验员: 05




其他内容详见
说明书

Фотография 10 – Штатив ангиографический C-дуга серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 11 – Шкаф управления штативом серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Вариант внешнего вида

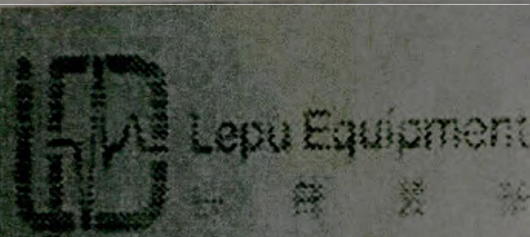

Lepu Medical
Equipment(Beijing)Co.Ltd

Distribution cabinet
serie VCV-30/S

No.60, Shunren Road, Linhe Development Zone, Shunyi
District, Beijing, China



Lepu Equipment
乐 普 装 备

部件名称: 配电机柜

型 号: VCV-30/S

部 件 号: SWIFT PDJS30 012

检验员: 05



Фотография 12 – Шкаф управления штативом серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 13 – Выключатель педальный серии MKF, Lery Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Вариант внешнего вида



Фотография 14 – Выключатель педальный серии MKF, Lery Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 15 – Выключатель педальный серии MKF, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 16 – Выключатель педальный серии MKF, Steute Technologies GmbH & Co. KG. Вариант внешнего вида



Фотография 17 – Выключатель педальный серии MKF, Steute Technologies GmbH & Co. KG. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 18 – Педаль с кабелем по спецификации KRT-10-0670, АО «НИПК «Электрон». Вариант внешнего вида



Педаль с кабелем
KRT-10-0670

Серийный номер
Дата изготовления

NN0006134
2023-09

Обозначение МИ

AKR-00-0000-30:0

Серийный номер МИ

GP0006186


Изготовитель

АО "НИПК "Электрон"


NF-20-0200-C2



IPX8



Фотография 19 – Педаль с кабелем KRT-10-0670. Образец внешнего вида варианта маркировки

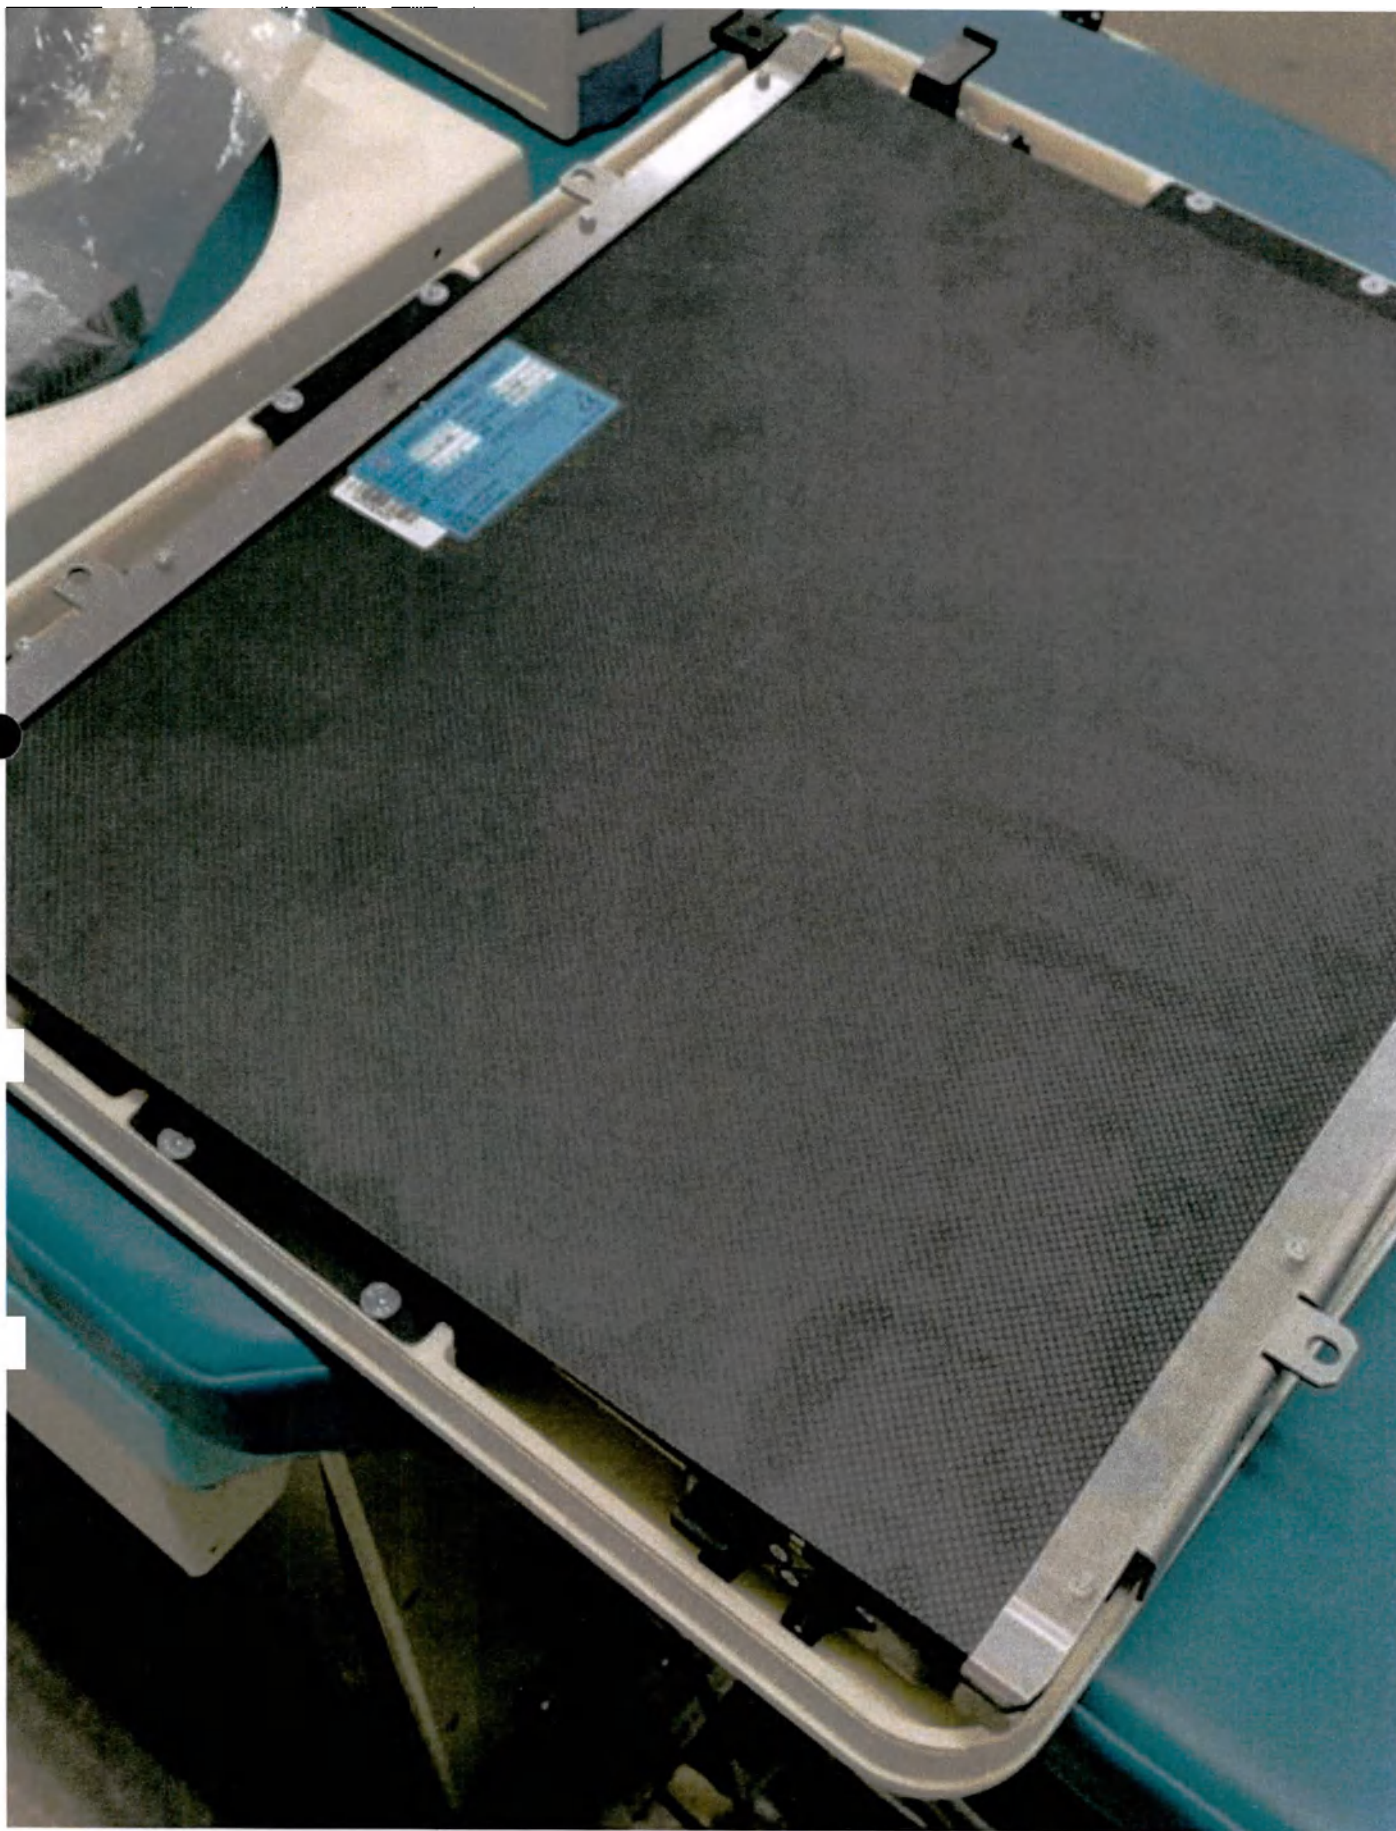

Фотография 20 – Решетка фокусирующая (растр рентгеновский) серии JP1 GRID Jungwon Precision Ind. Co., Ltd и место нанесения маркировки (в условиях эксплуатации растр закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

NP230426



ANTI-SCATTER GRID

Type	Focused grid series JPI grid	Interspacer	AL
Overall Size	454 x 360 MM	Line	90 L/CM
Grid Ratio	12 : 1	Focal Distance	100 CM
	2023.02.28	SN	JW 23215312



JPI Healthcare Co., Ltd.

608-HO, 28 DIGITAL-RO 33GIL,
GURO-GU, SEOUL, KOREA, 08377


TEL : (82-2) 2108-2580 FAX : (82-2) 2108-1180



EMERGO EUROPE

Prinsesaengracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands

TEL : (31) (0) 70 345 8570



(01) 08809413810204

(11) 230228

(21) JW 23215312



MADE IN KOREA

Фотография 21 – Решетка фокусирующая (растр рентгеновский) серии JPI GRID Jungwon Precision Ind. Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



01N2 16203

SIEMENS

(01) 04056869103709	GTIN
(240) 11344934	MODEL
(422) 276	ORIGIN DE
(21) 1022	SERIAL



Pb r17 N70 Io100




Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany

Made in Germany

Фотография 22 – Решетка фокусирующая (растр рентгеновский) SIEMENS, Siemens Healthcare GmbH. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 23 – Решетка фокусирующая серии SIEMENS и место нанесения маркировки (при эксплуатации растр закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

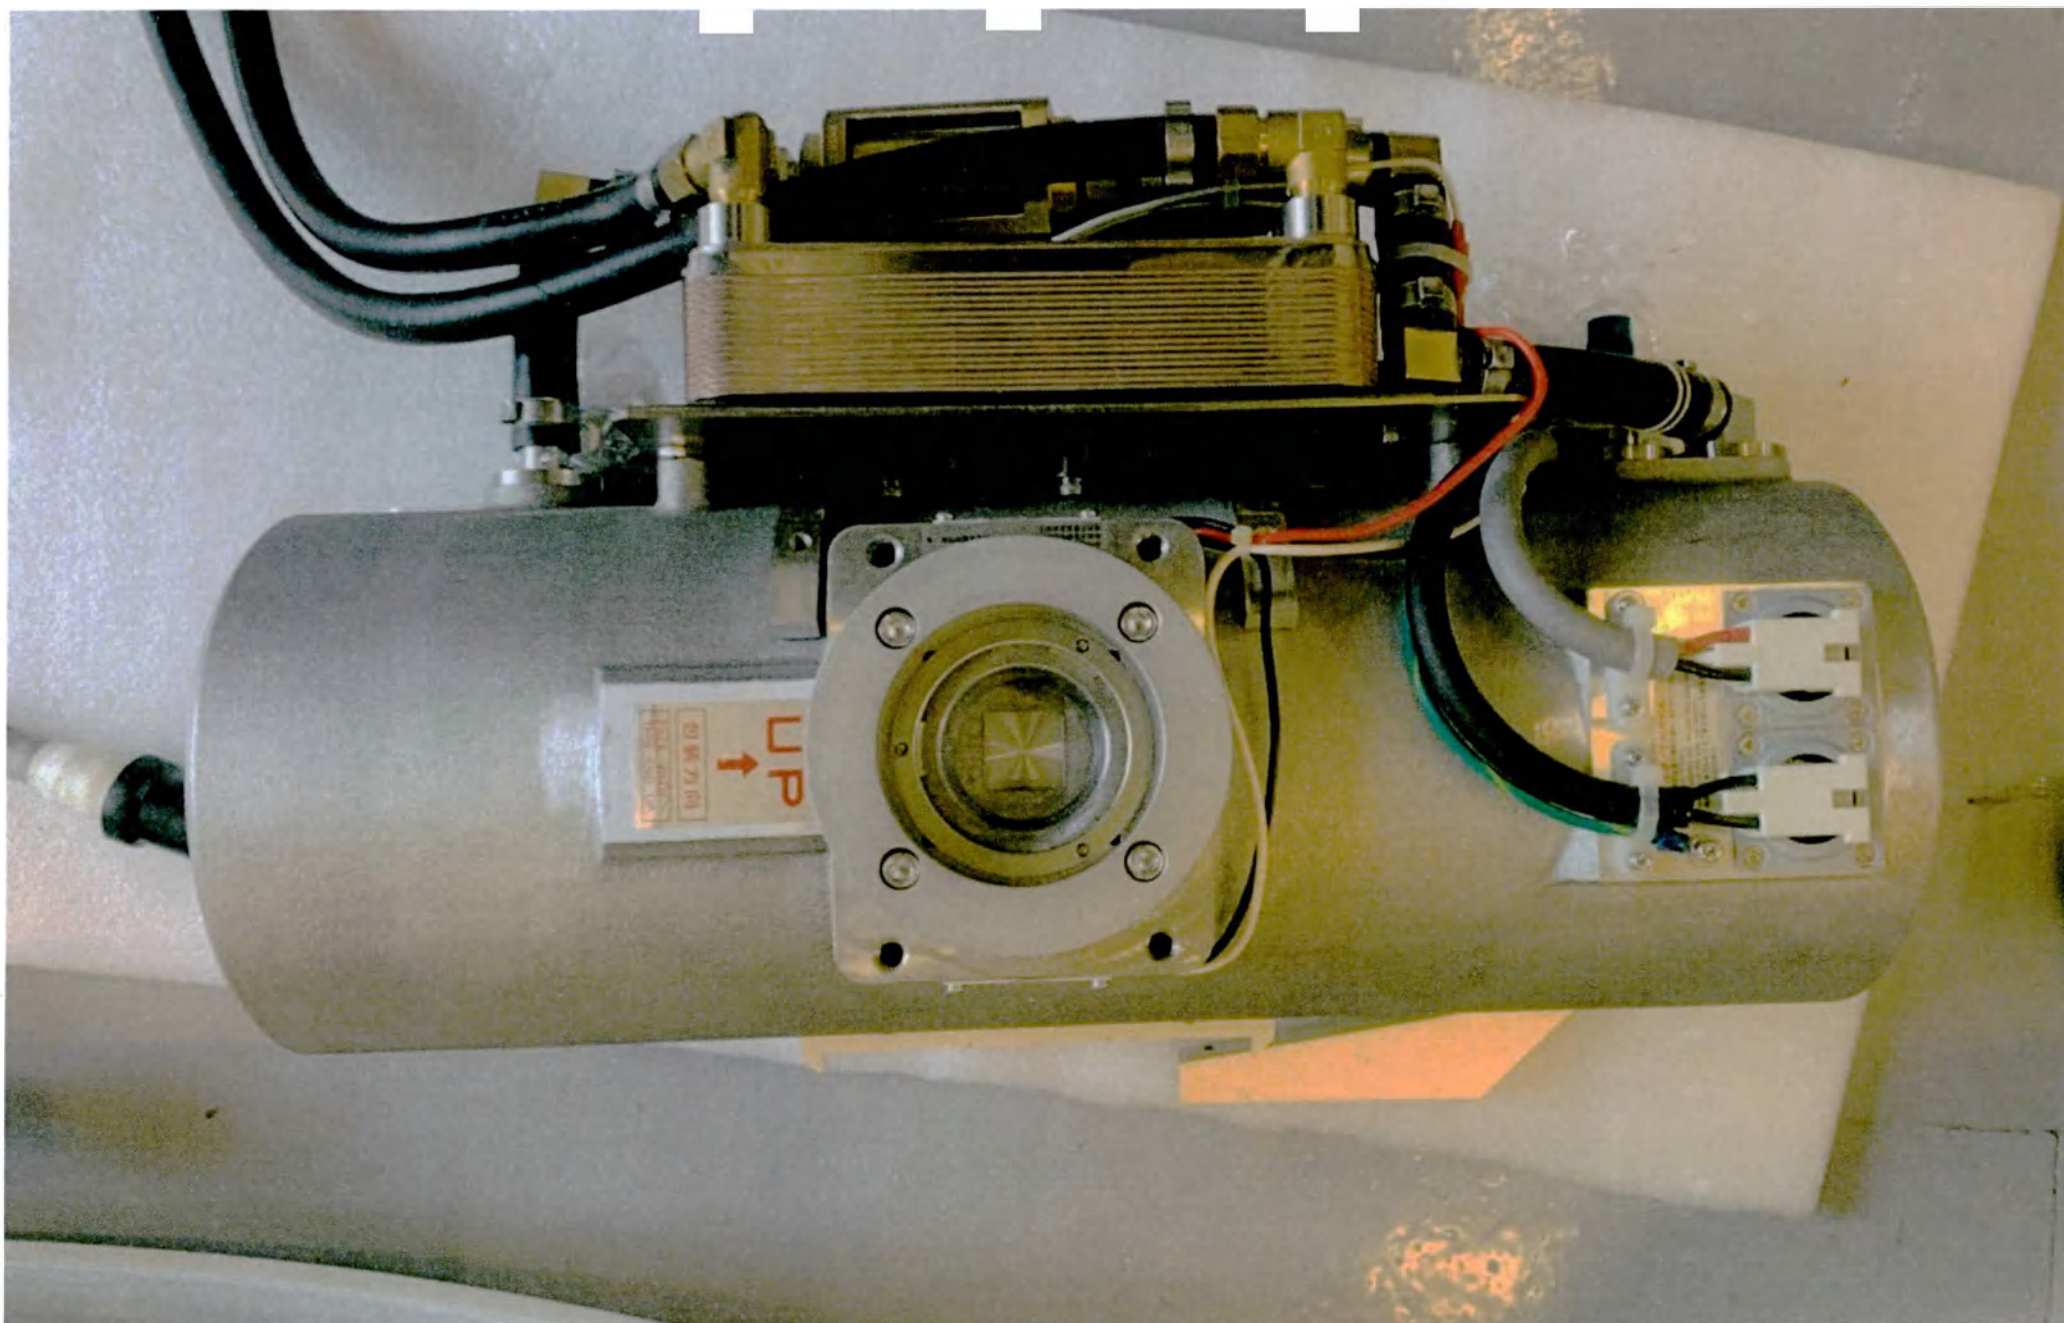

Фотография 24 – Излучатель рентгеновский серии E, Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd (в условиях эксплуатации излучатель закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

CANON ELECTRON TUBES
& DEVICES CO., LTD.


ROTANODE™

使用期限

详见说明书

产品名称
NAME OF DEVICE

医用诊断X射线管组件



生产日期
MANUFACTURED

March 2021 / 2021-03

产品型号
UNIT MODEL

E79039X

其他内容详见说明书

SN

生产序列号
SER. NO.

21C806

焦点尺寸
FOCAL SPOT

1.0/0.6

管芯型号
INSERT MODEL

E79039

子号
SUP SYMBOL

CN

管芯生产序列号
SER. NO.

1B803

最大管电压
MAX. VOLTAGE

125 kV

固有滤过
PERMANENT FILTRATION

1.1 Al/ 75

定子阻抗
STATOR

XS-AX

Фотография 25 – Излучатель рентгеновский серии E, Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 26 – Система охлаждения излучателя рентгеновского HEX-125 Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd (в составе излучателя Canon). Вариант внешнего вида

CANON ELECTRON TUBES
& DEVICES CO., LTD.

热交换器
HEAT EXCHANGER

 生产日期
MANUFACTURED: August 2020 / 2020-08

产品型号
UNIT MODEL: HEX-125

子号
SUP. SYMBOL: A

 生产序列号
SER. NO.: 20H002

输入电压
INPUT VOLTAGE: 220V(50/60Hz)


消费功率
POWER CONSUMPTION: 280/340W

 キヤノン電子管デバイス株式会社
〒324-8550 栃木県大田原市下石上1385番地
CANON ELECTRON TUBES & DEVICES CO., LTD.
1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 324-8550, Japan


MADE IN JAPAN

MZF-CL03

Фотография 27 – Система охлаждения излучателя рентгеновского HEX-125, Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd
(в составе излучателя Canon). Образец внешнего вида варианта маркировки

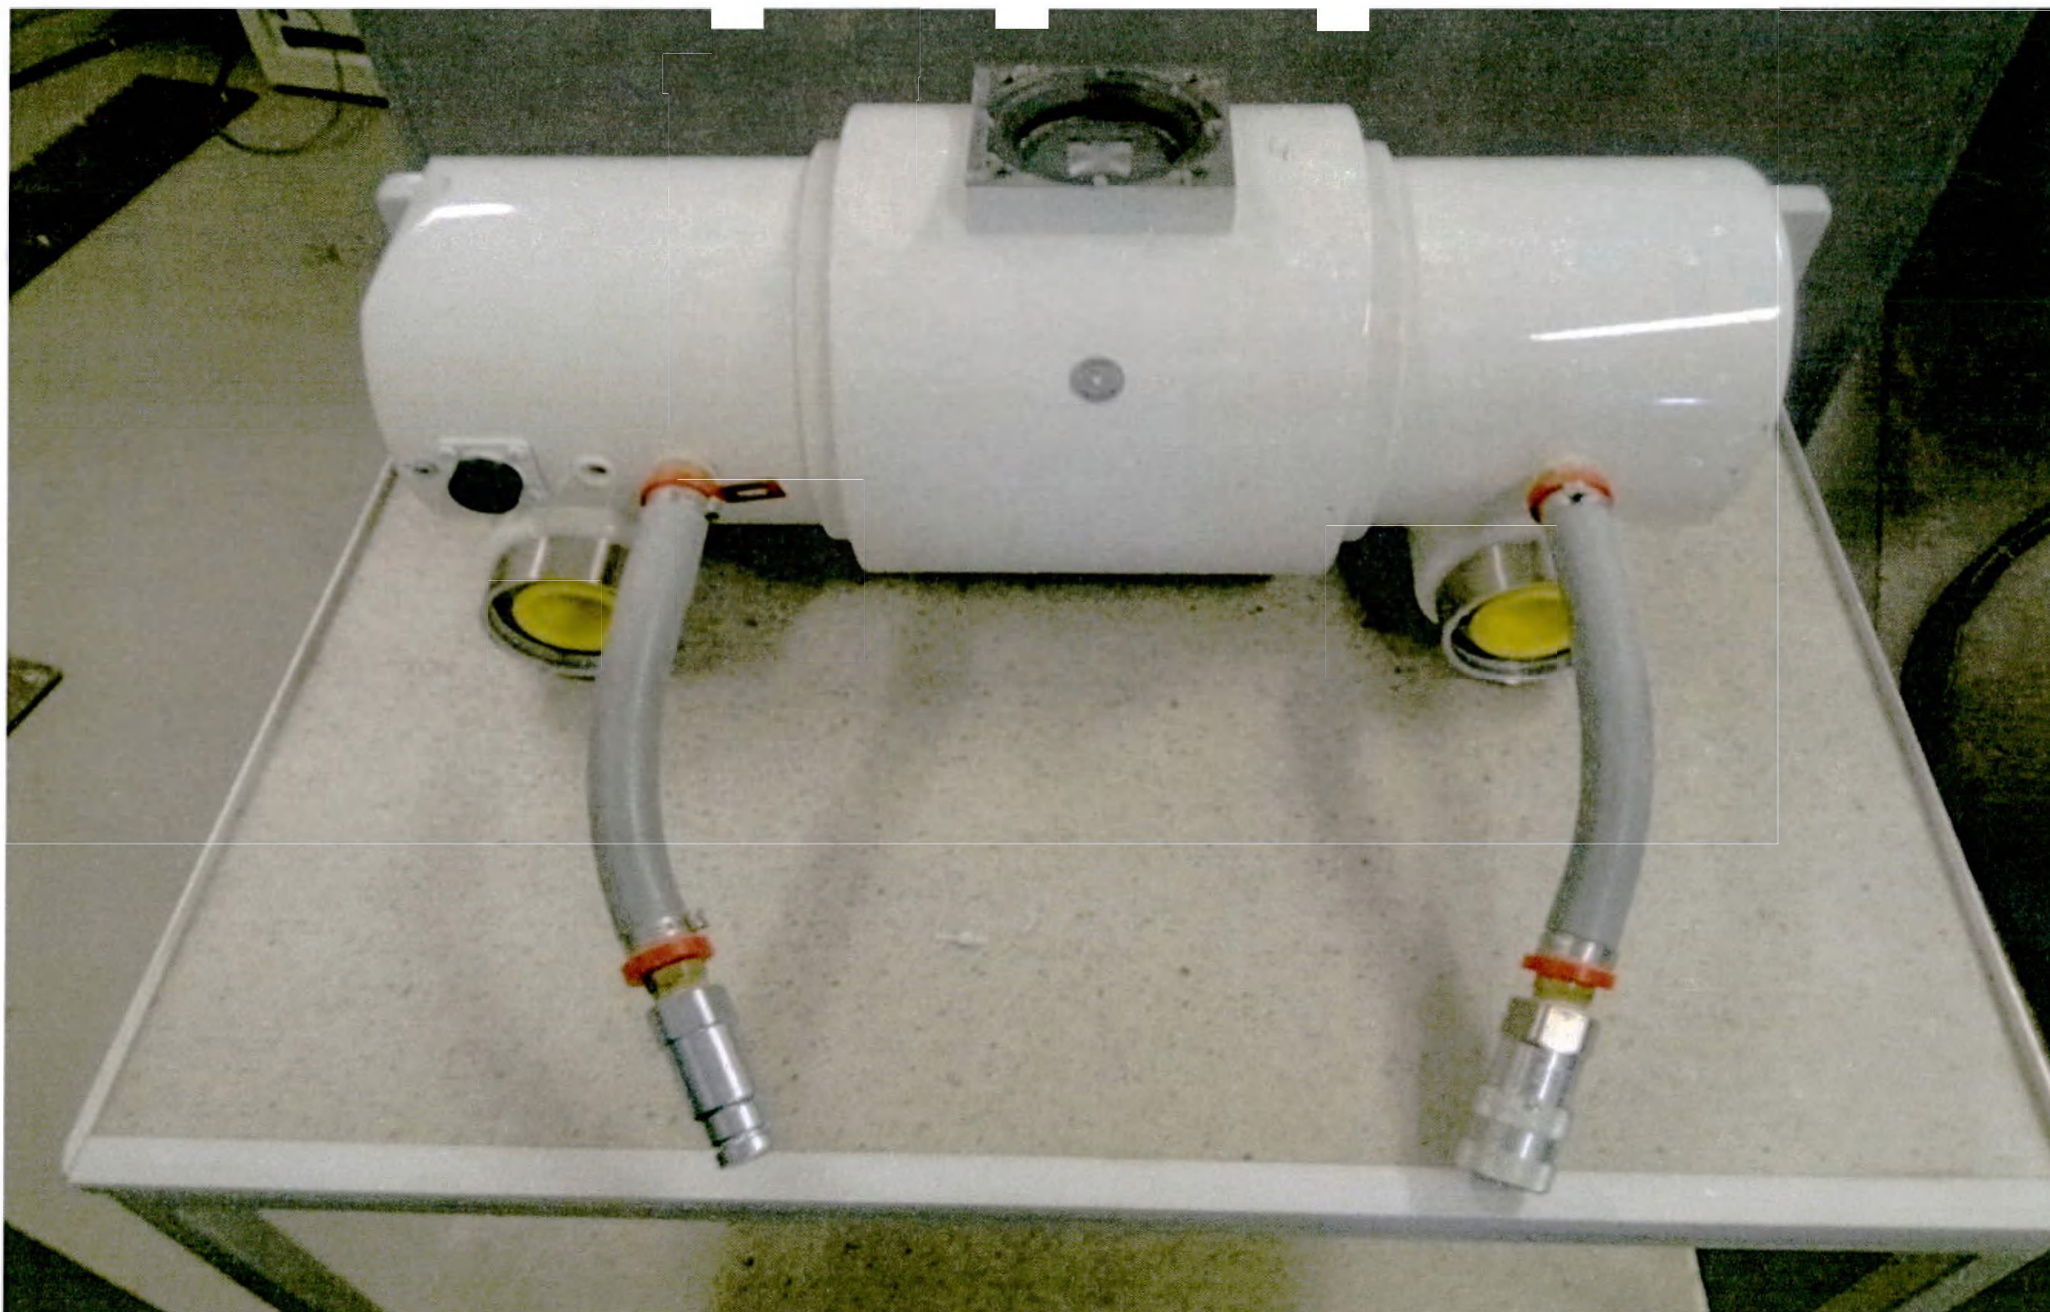


Фотография 28 – Излучатель рентгеновский серии Roesys XRT, Roesys GmbH (при эксплуатации излучатель закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

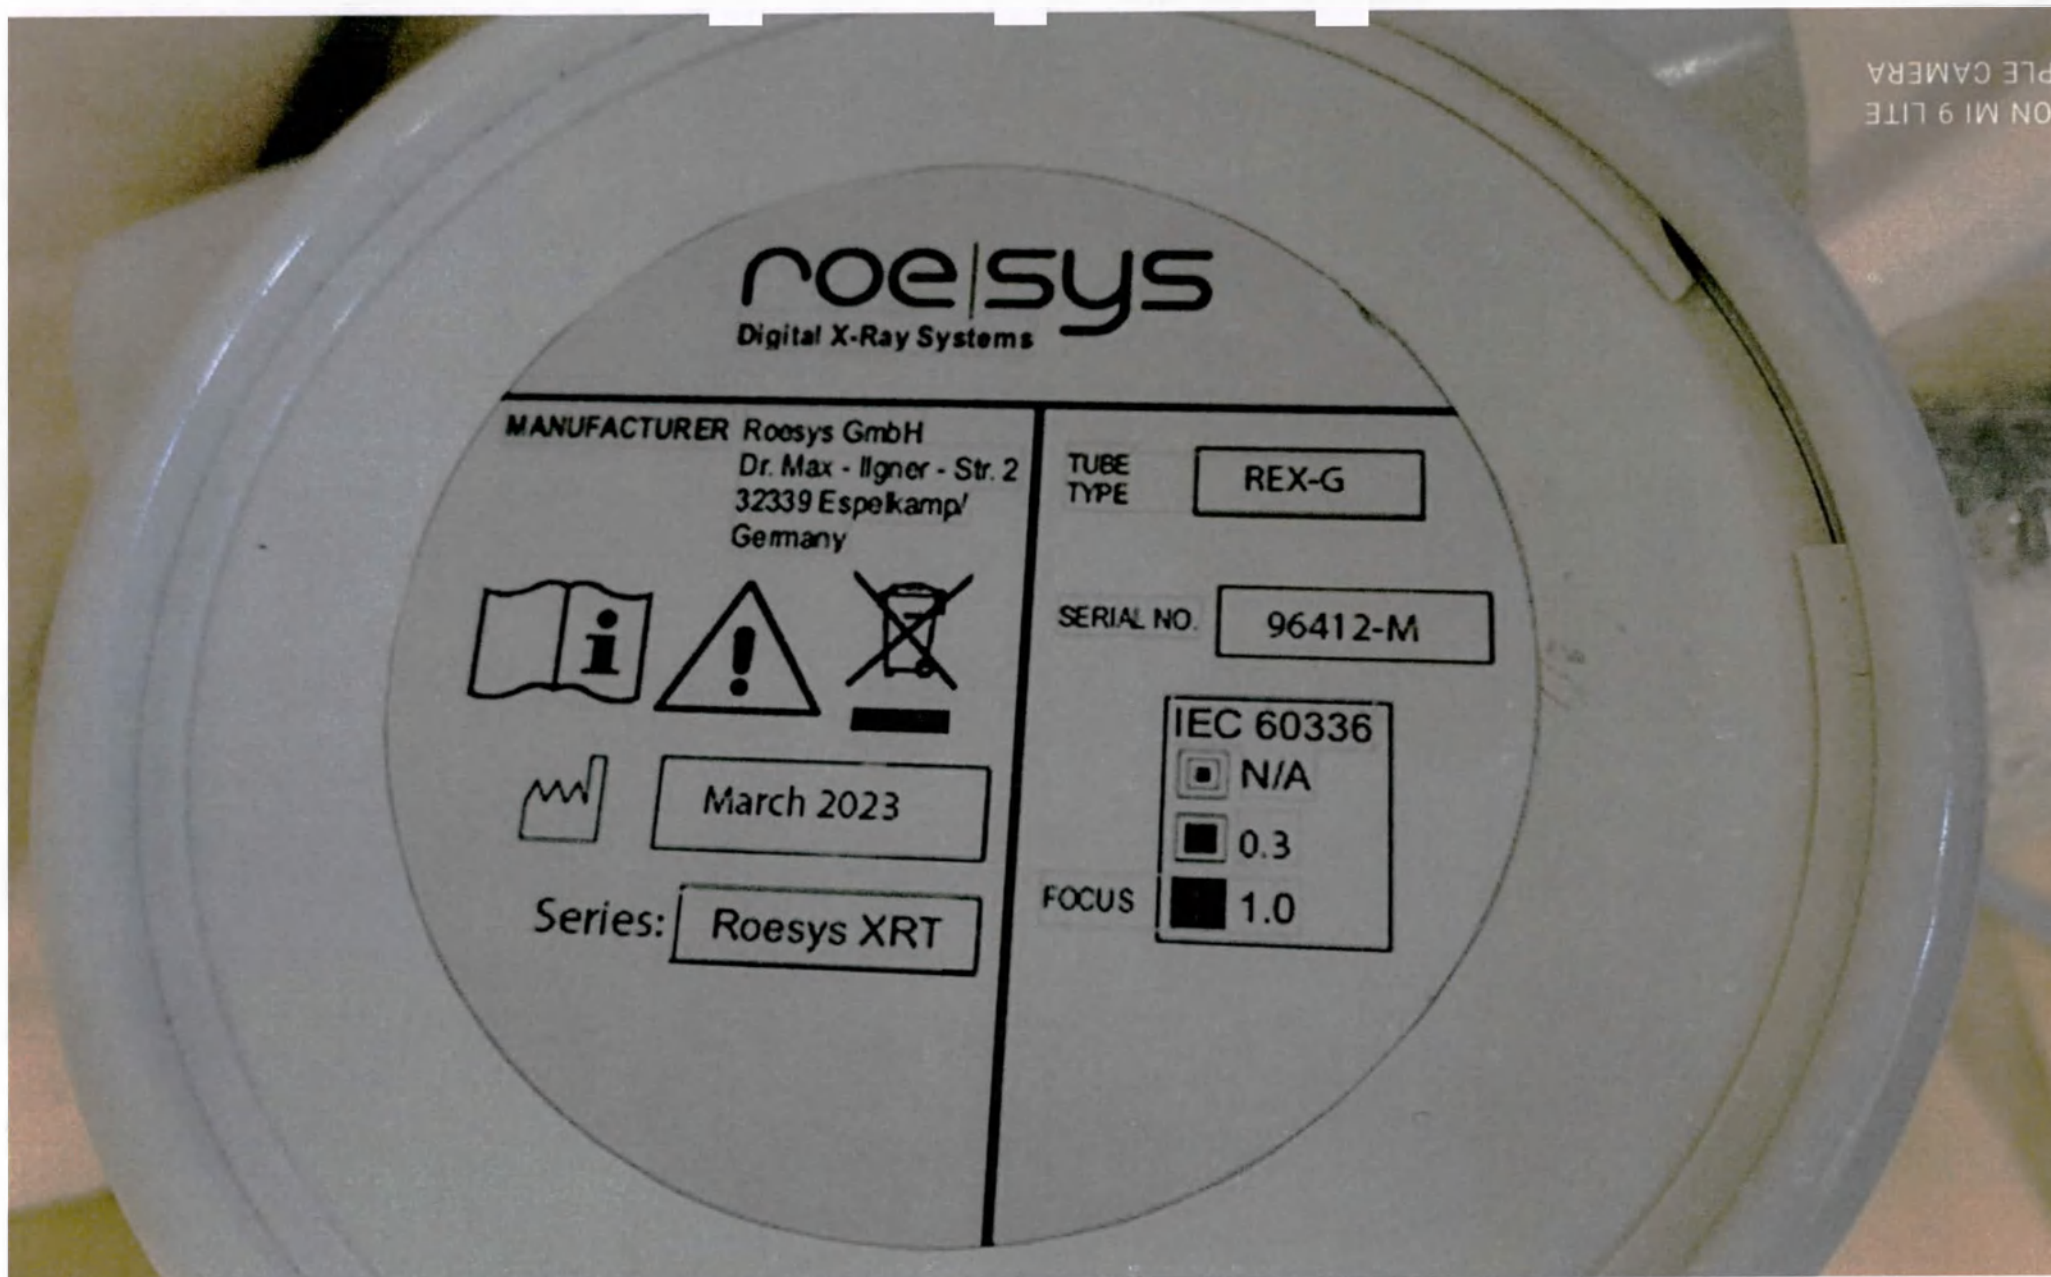

Фотография 29 – Излучатель рентгеновский серии Roesys XRT, Roesys GmbH. Образец внешнего вида варианта маркировки




Фотография 30 – Излучатель рентгеновский MegaLix Cat, Siemens Healthcare GmbH (в условиях эксплуатации излучатель закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

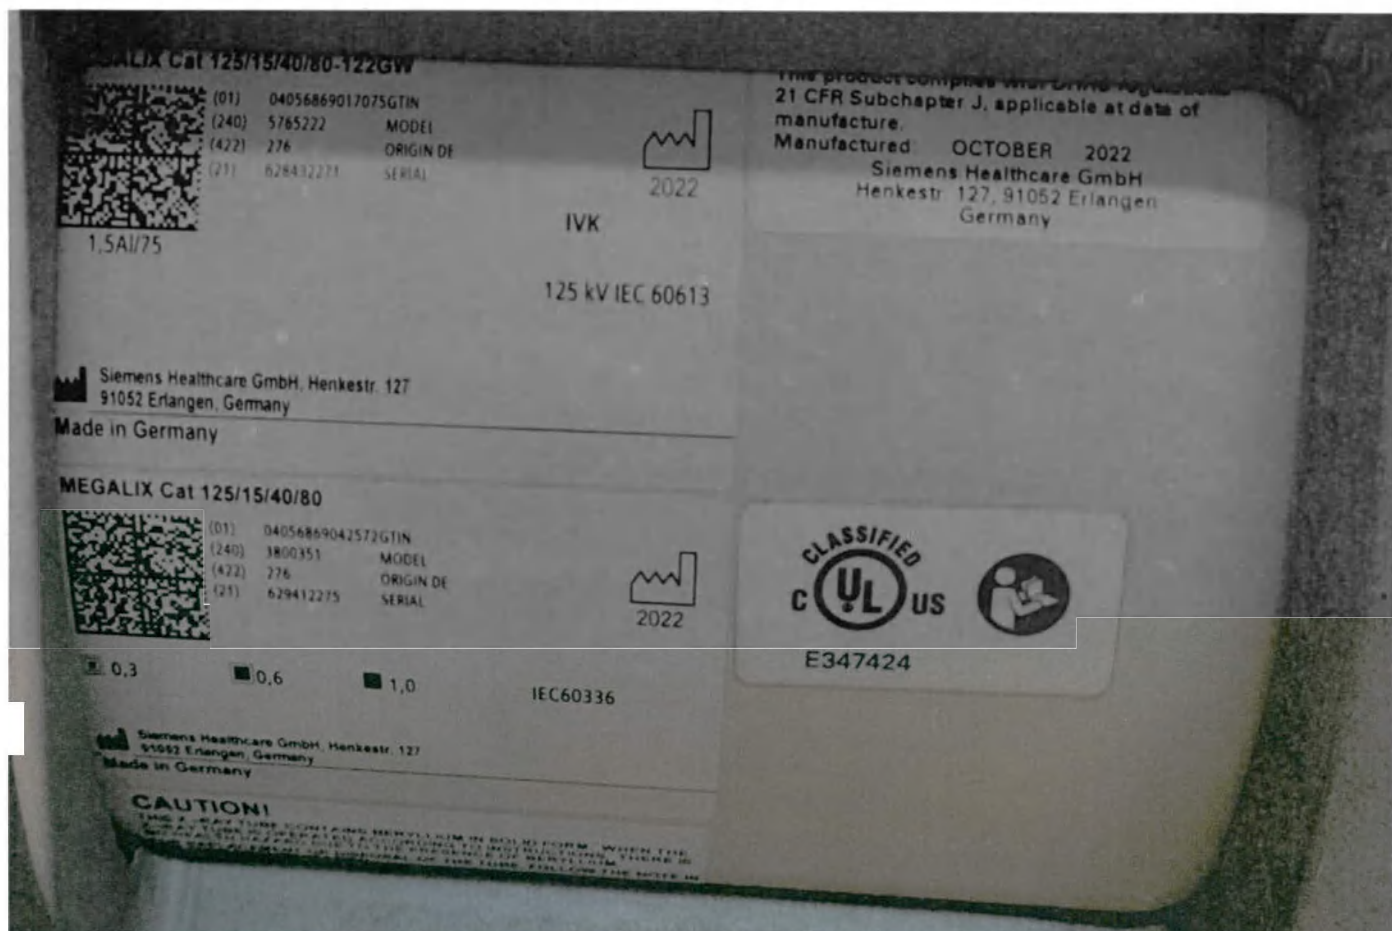


Фотография 31 – Излучатель рентгеновский MegaLix Cat, Siemens Healthcare GmbH. Образец внешнего вида варианта маркировки




Фотография 32 – Система охлаждения излучателя рентгеновского WL 3000 SU, Siemens Healthcare GmbH (в составе рентгеновского излучателя Siemens Healthcare). Вариант внешнего вида

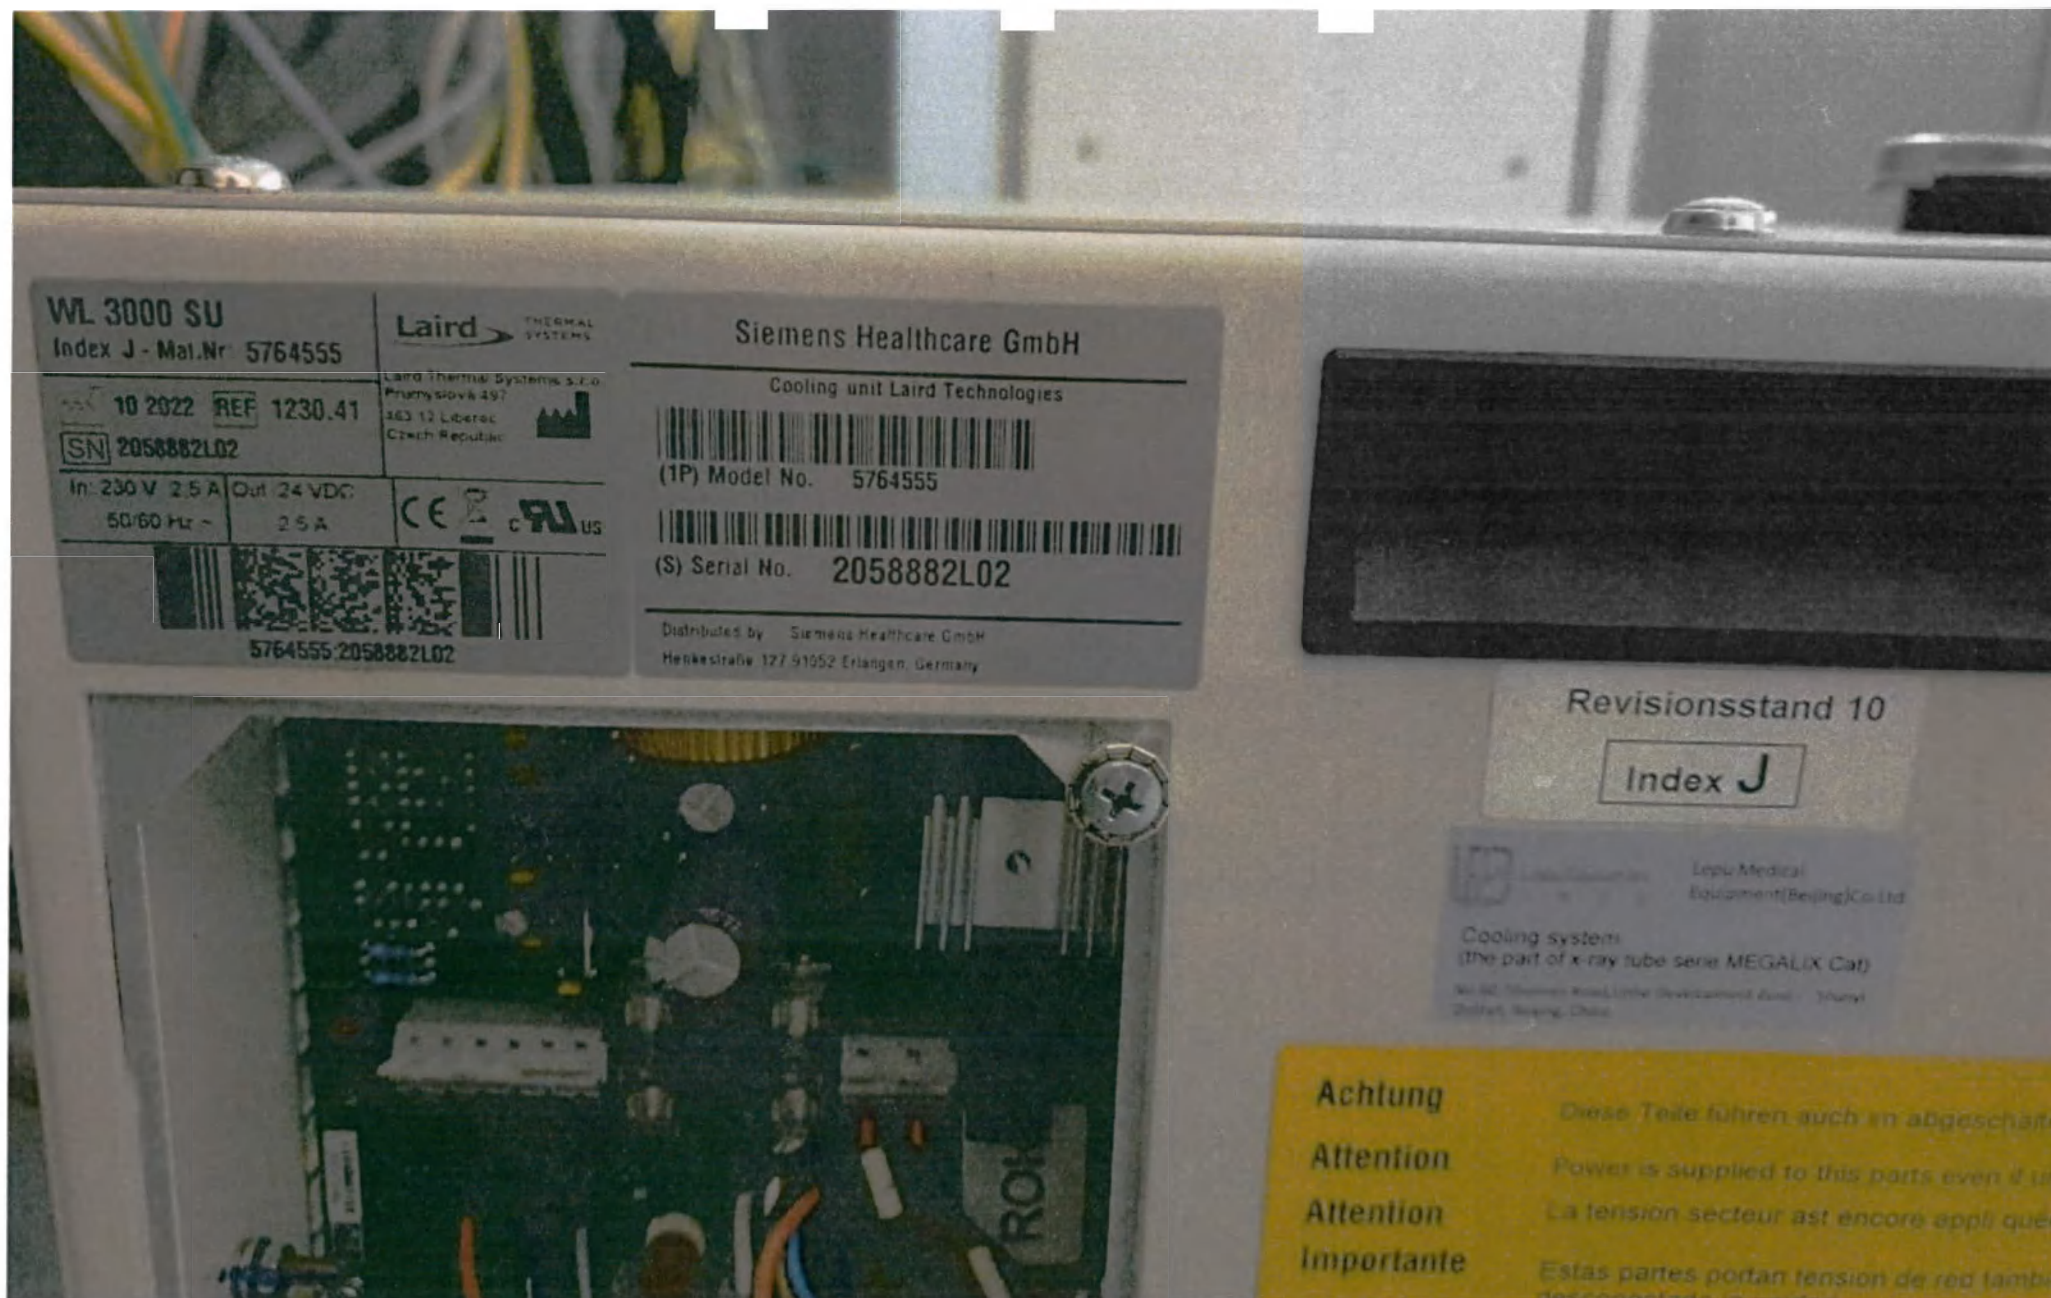


Фотография 33 – Система охлаждения излучателя рентгеновского WL 3000 SU, Siemens Healthcare GmbH (в составе рентгеновского излучателя Siemens Healthcare). Образец внешнего вида варианта маркировки

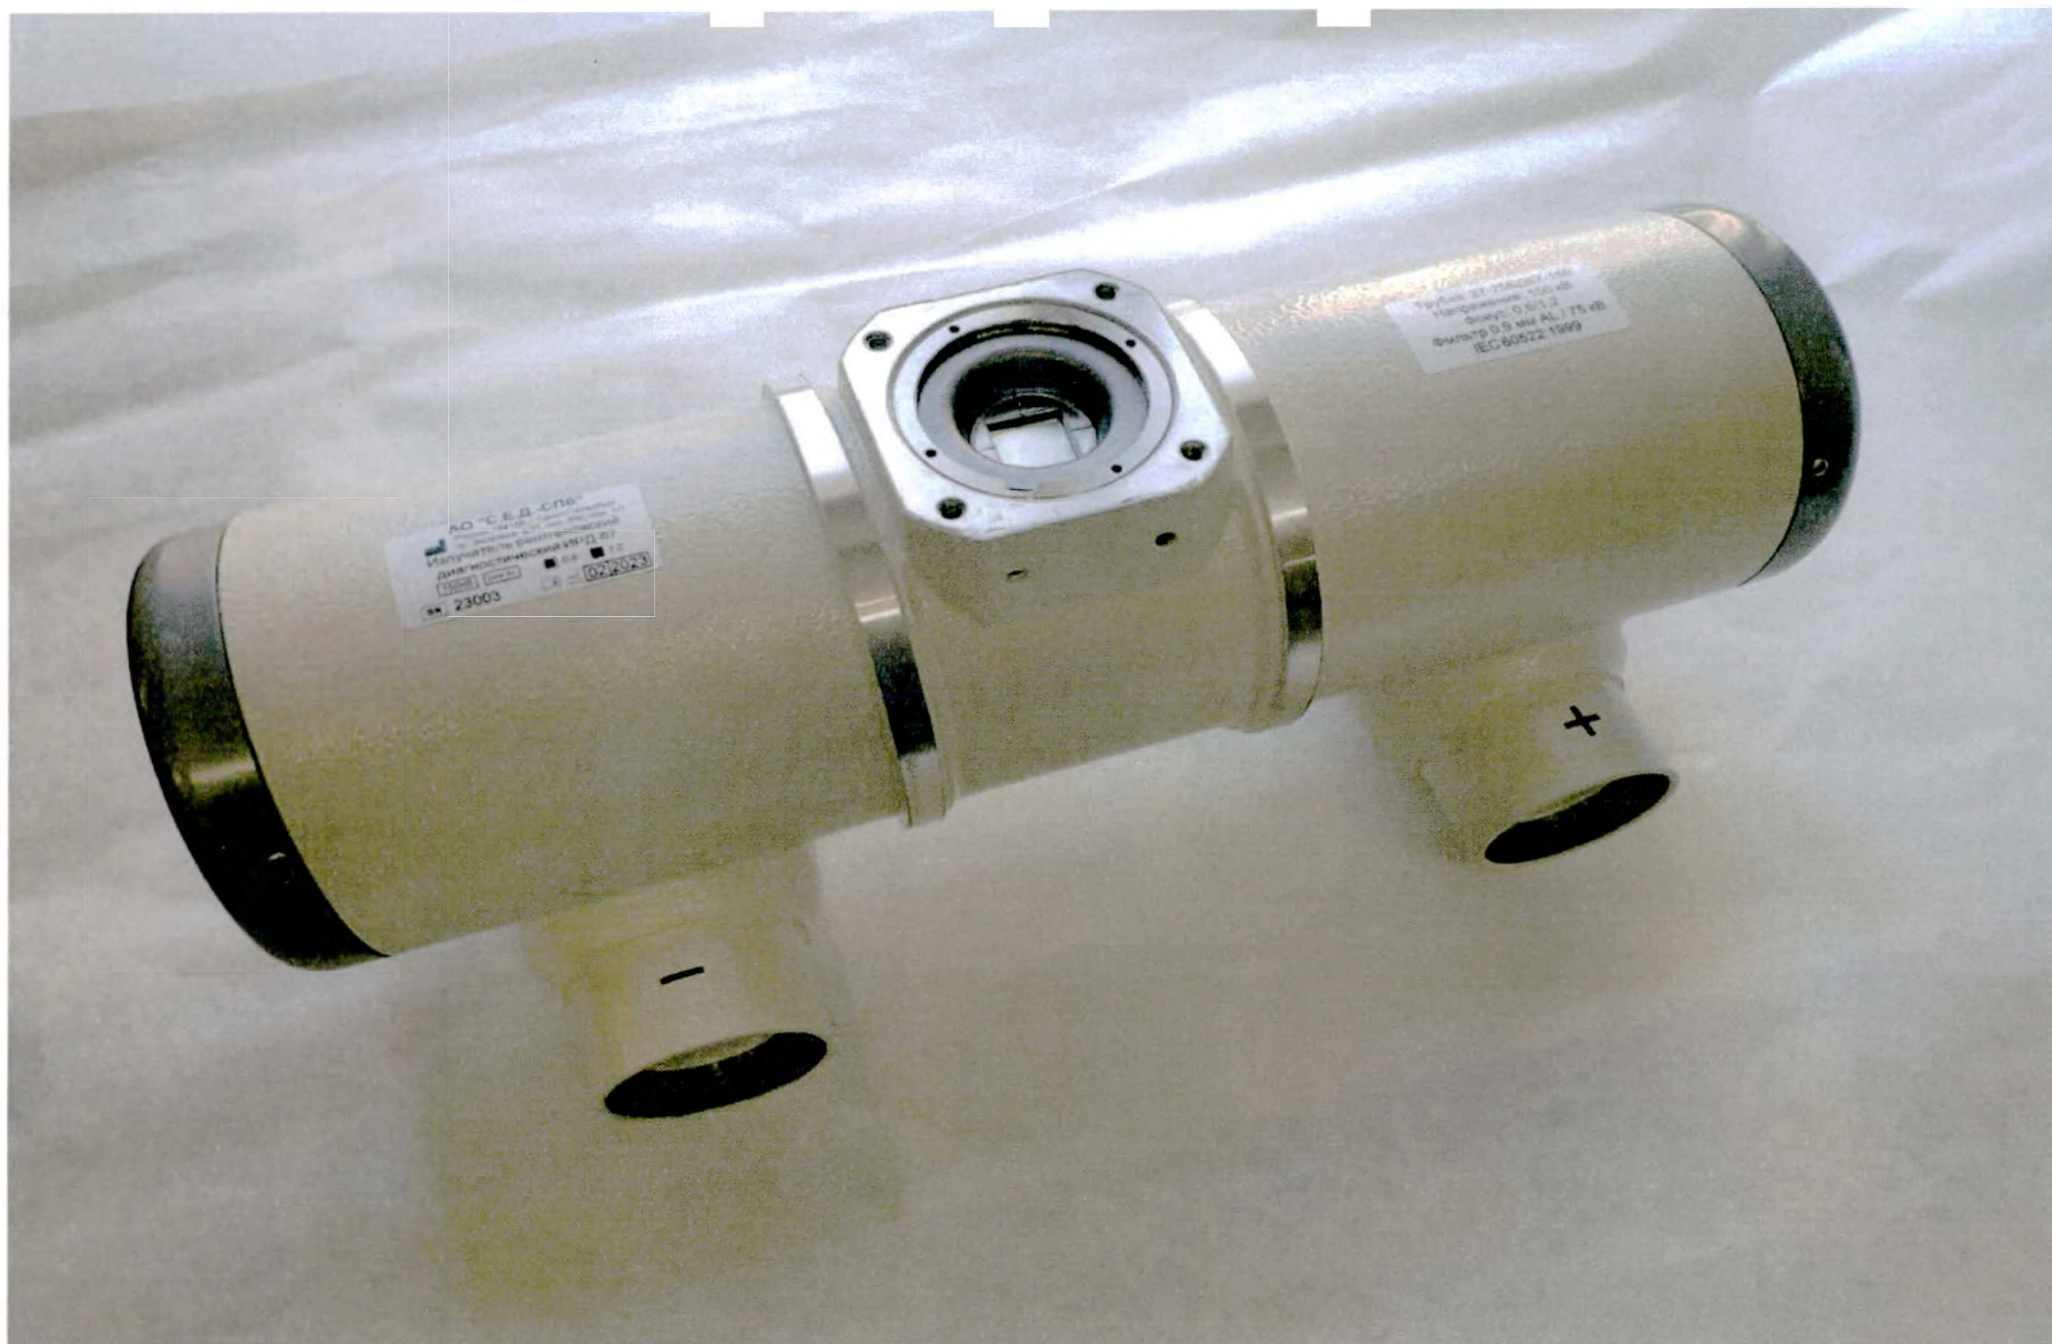


Фотография 34 – Излучатель рентгеновский серии ИРД, АО «С.Е.Д.-СПб» с трубкой рентгеновской серии БД, АО «Светлана-Рентген», Россия. Вариант внешнего вида

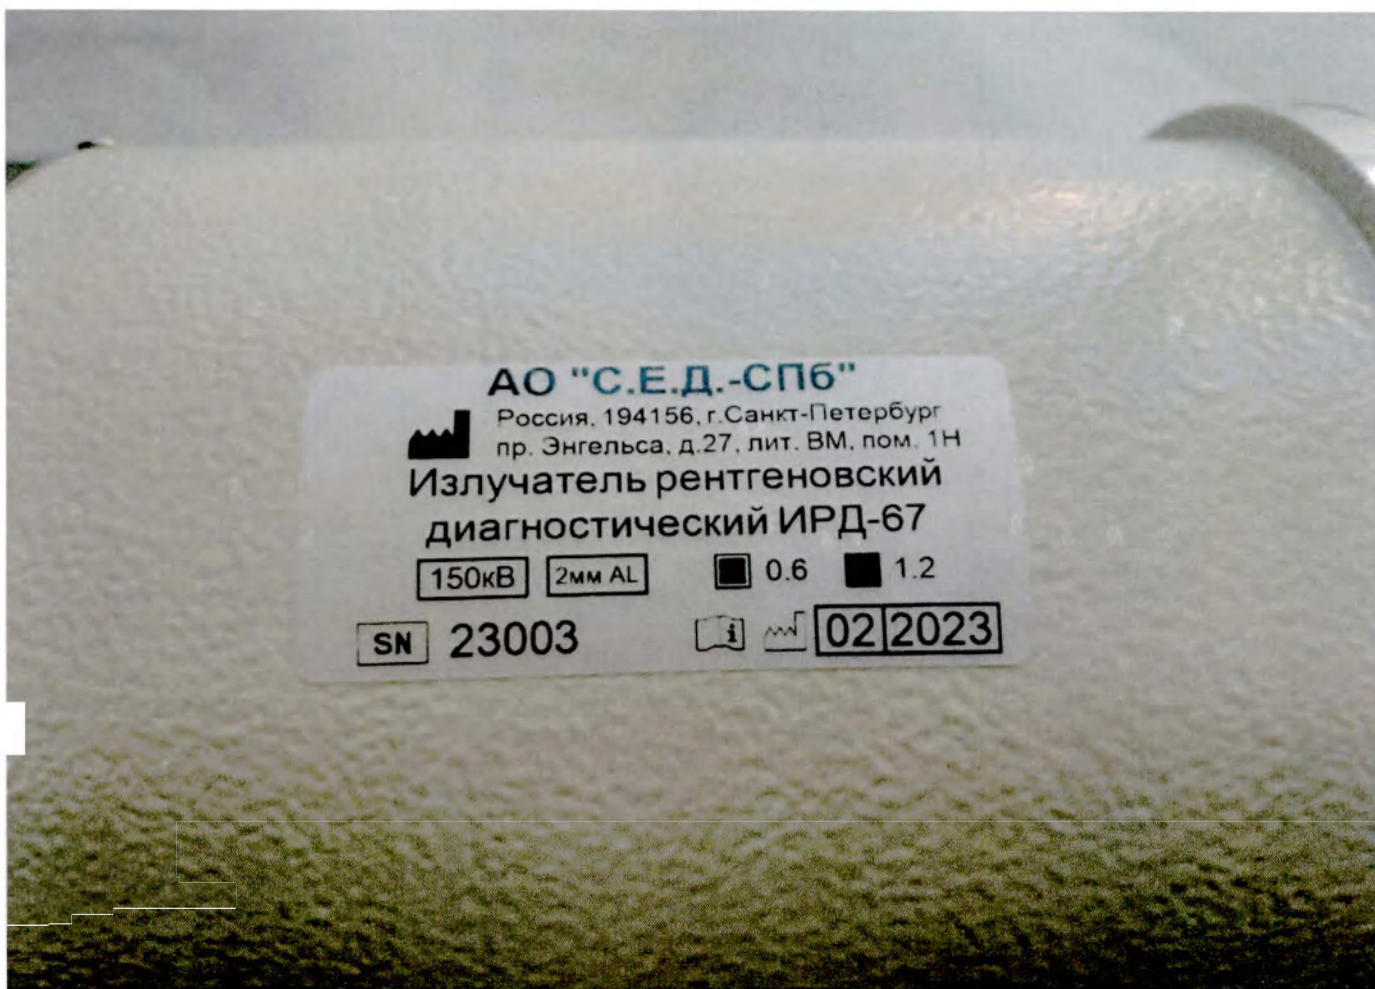

Фотография 35 – Образец внешнего вида варианта маркировки излучателя рентгеновского серии ИРД, АО «С.Е.Д.-СПб».

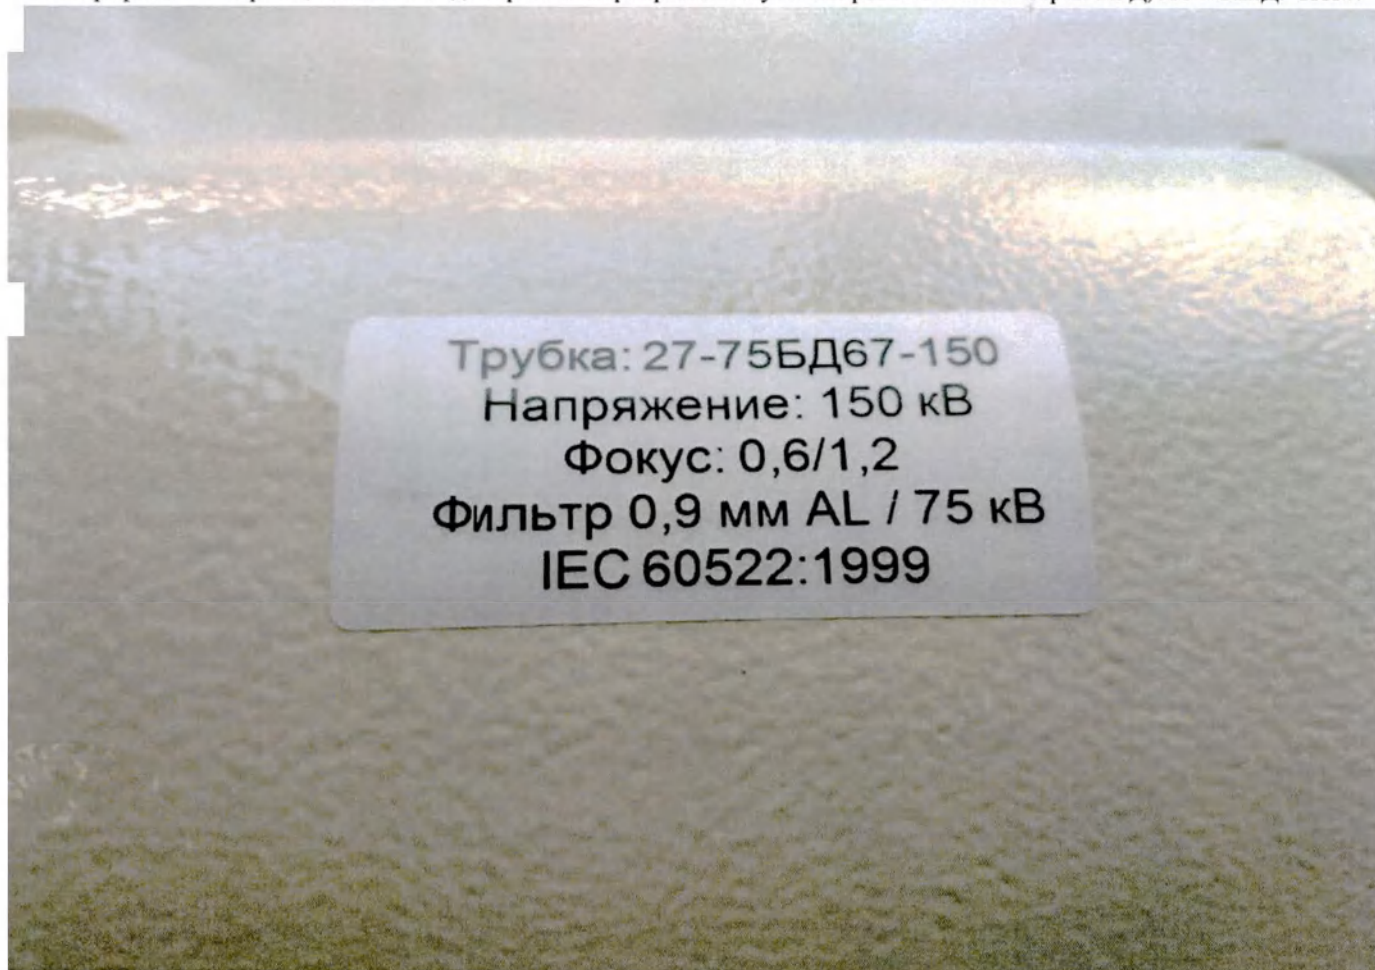

Фотография 36 – Образец внешнего вида варианта маркировки трубки серии БД, АО «Светлана-Рентген»

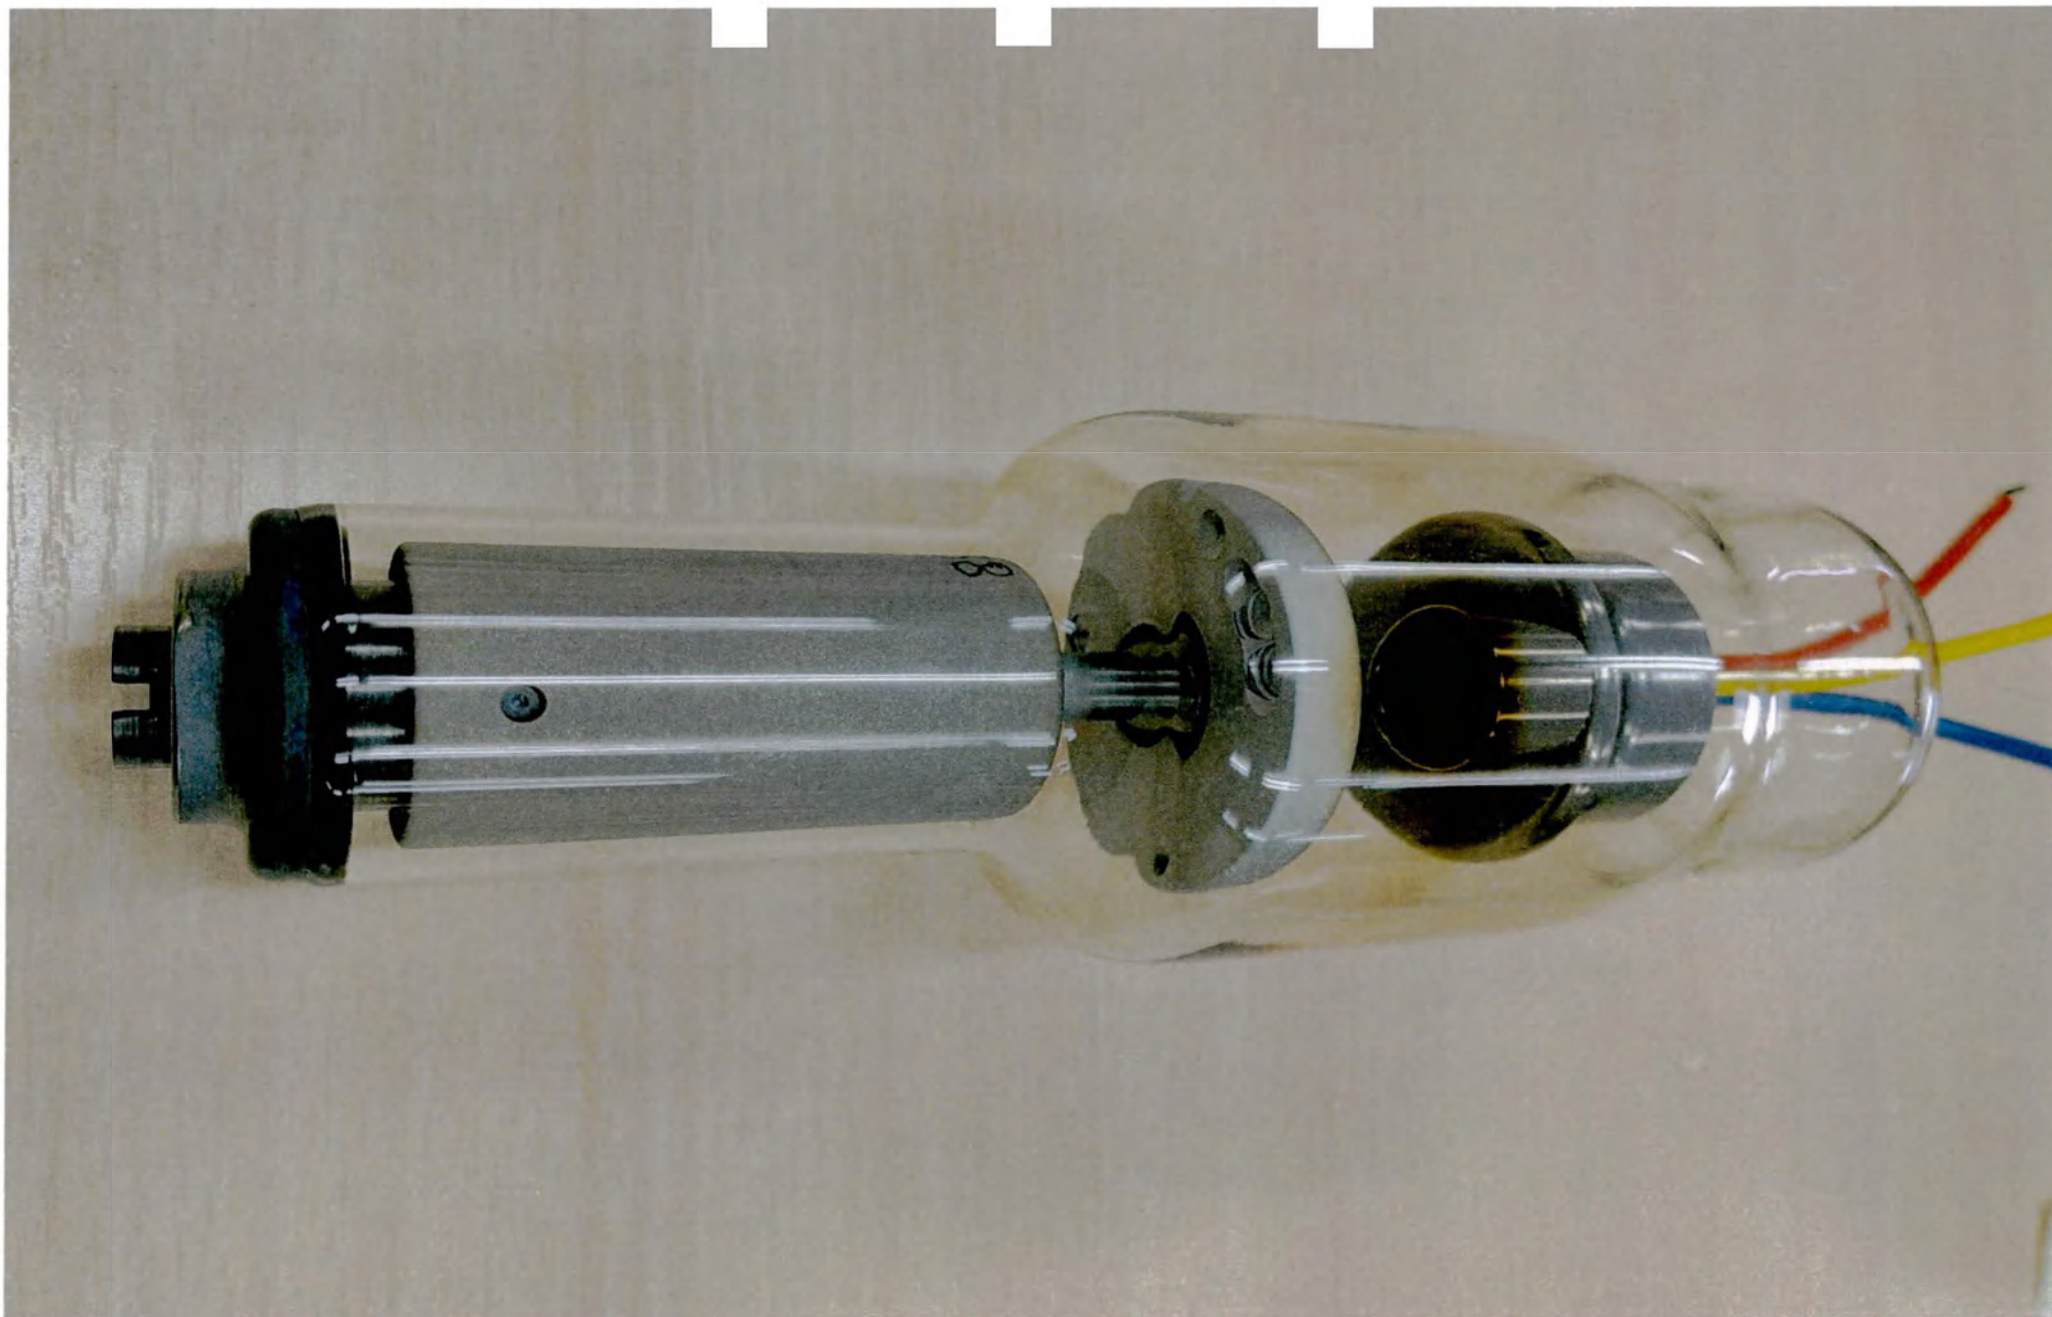

Фотография 37 – Трубка серии БД, АО «Светлана-Рентген». Вариант внешнего вида



Фотография 38 – Излучатель рентгеновский серии RAD, Varex Imaging. Вариант внешнего вида



Фотография 39 – Система охлаждения излучателя рентгеновского Lytron, Varex Imaging (в составе излучателя рентгеновского). Вариант внешнего вида

LYTRON
Total Thermal Solutions

WOBURN, MA 01801
(781) 933-7300

PART NO.: MCS20H03M03

SERIAL NO.: 853946-05

VOLTS: 230V~

AMPS: 1.65

50/60 Hz

1 Phase

VARIAN P/N: 1373 REV AG

CE



TYPE B EQUIPMENT




03/07/13

ETL LISTED
Electrical


Фотография 40 – Система охлаждения излучателя рентгеновского Lytron, Varex Imaging (в составе излучателя рентгеновского). Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 41 – Излучатель, коллиматор и дозиметр, установленные под кожухом штатива (вариант внешнего вида)

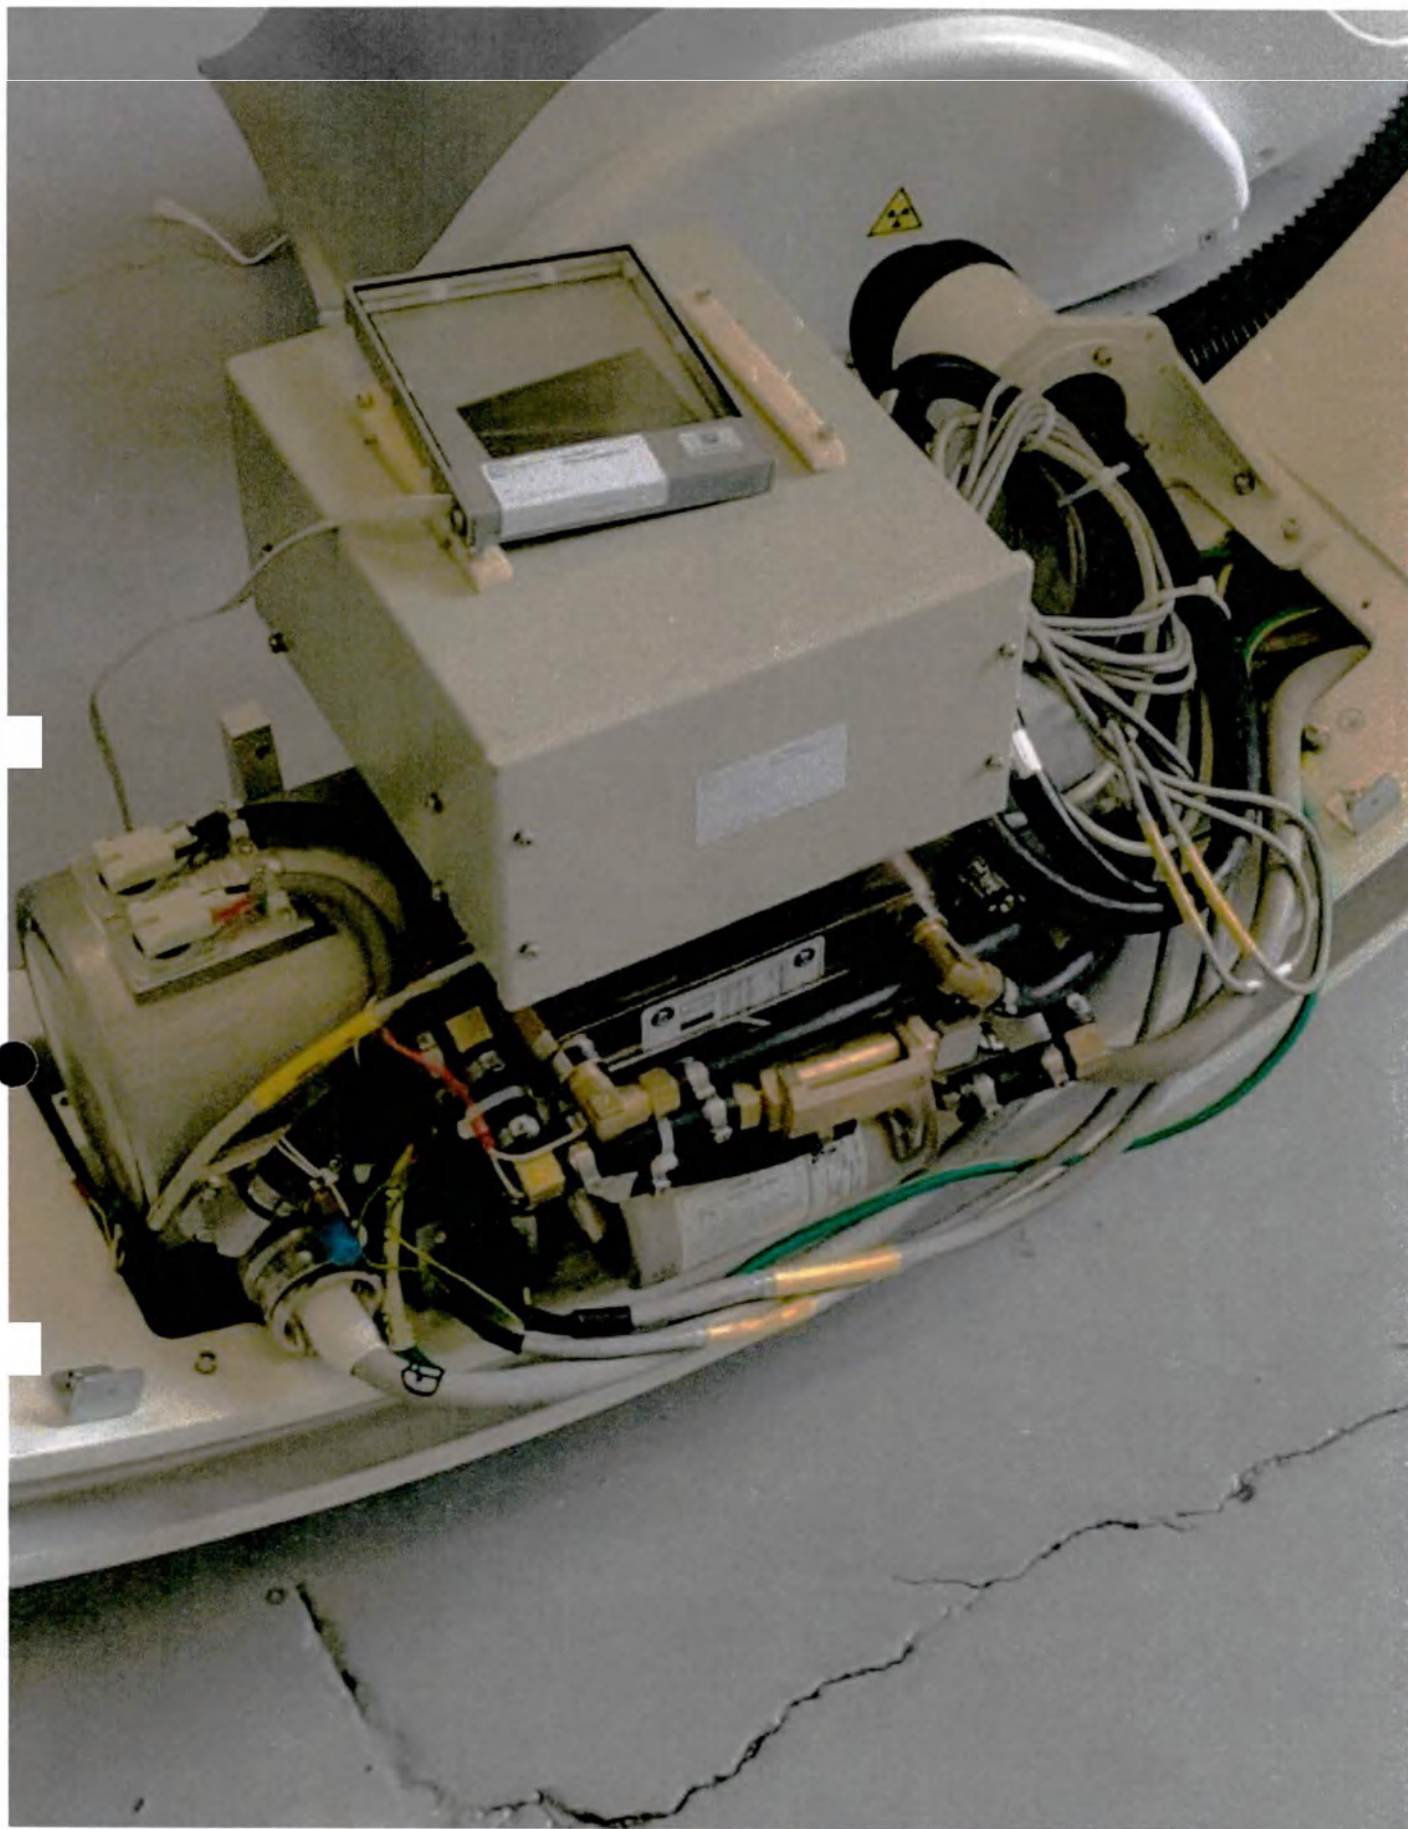

Фотография 42 – Излучатель, коллиматор и дозиметр в сборе, установленные на штатив (без кожуха). Вариант внешнего вида

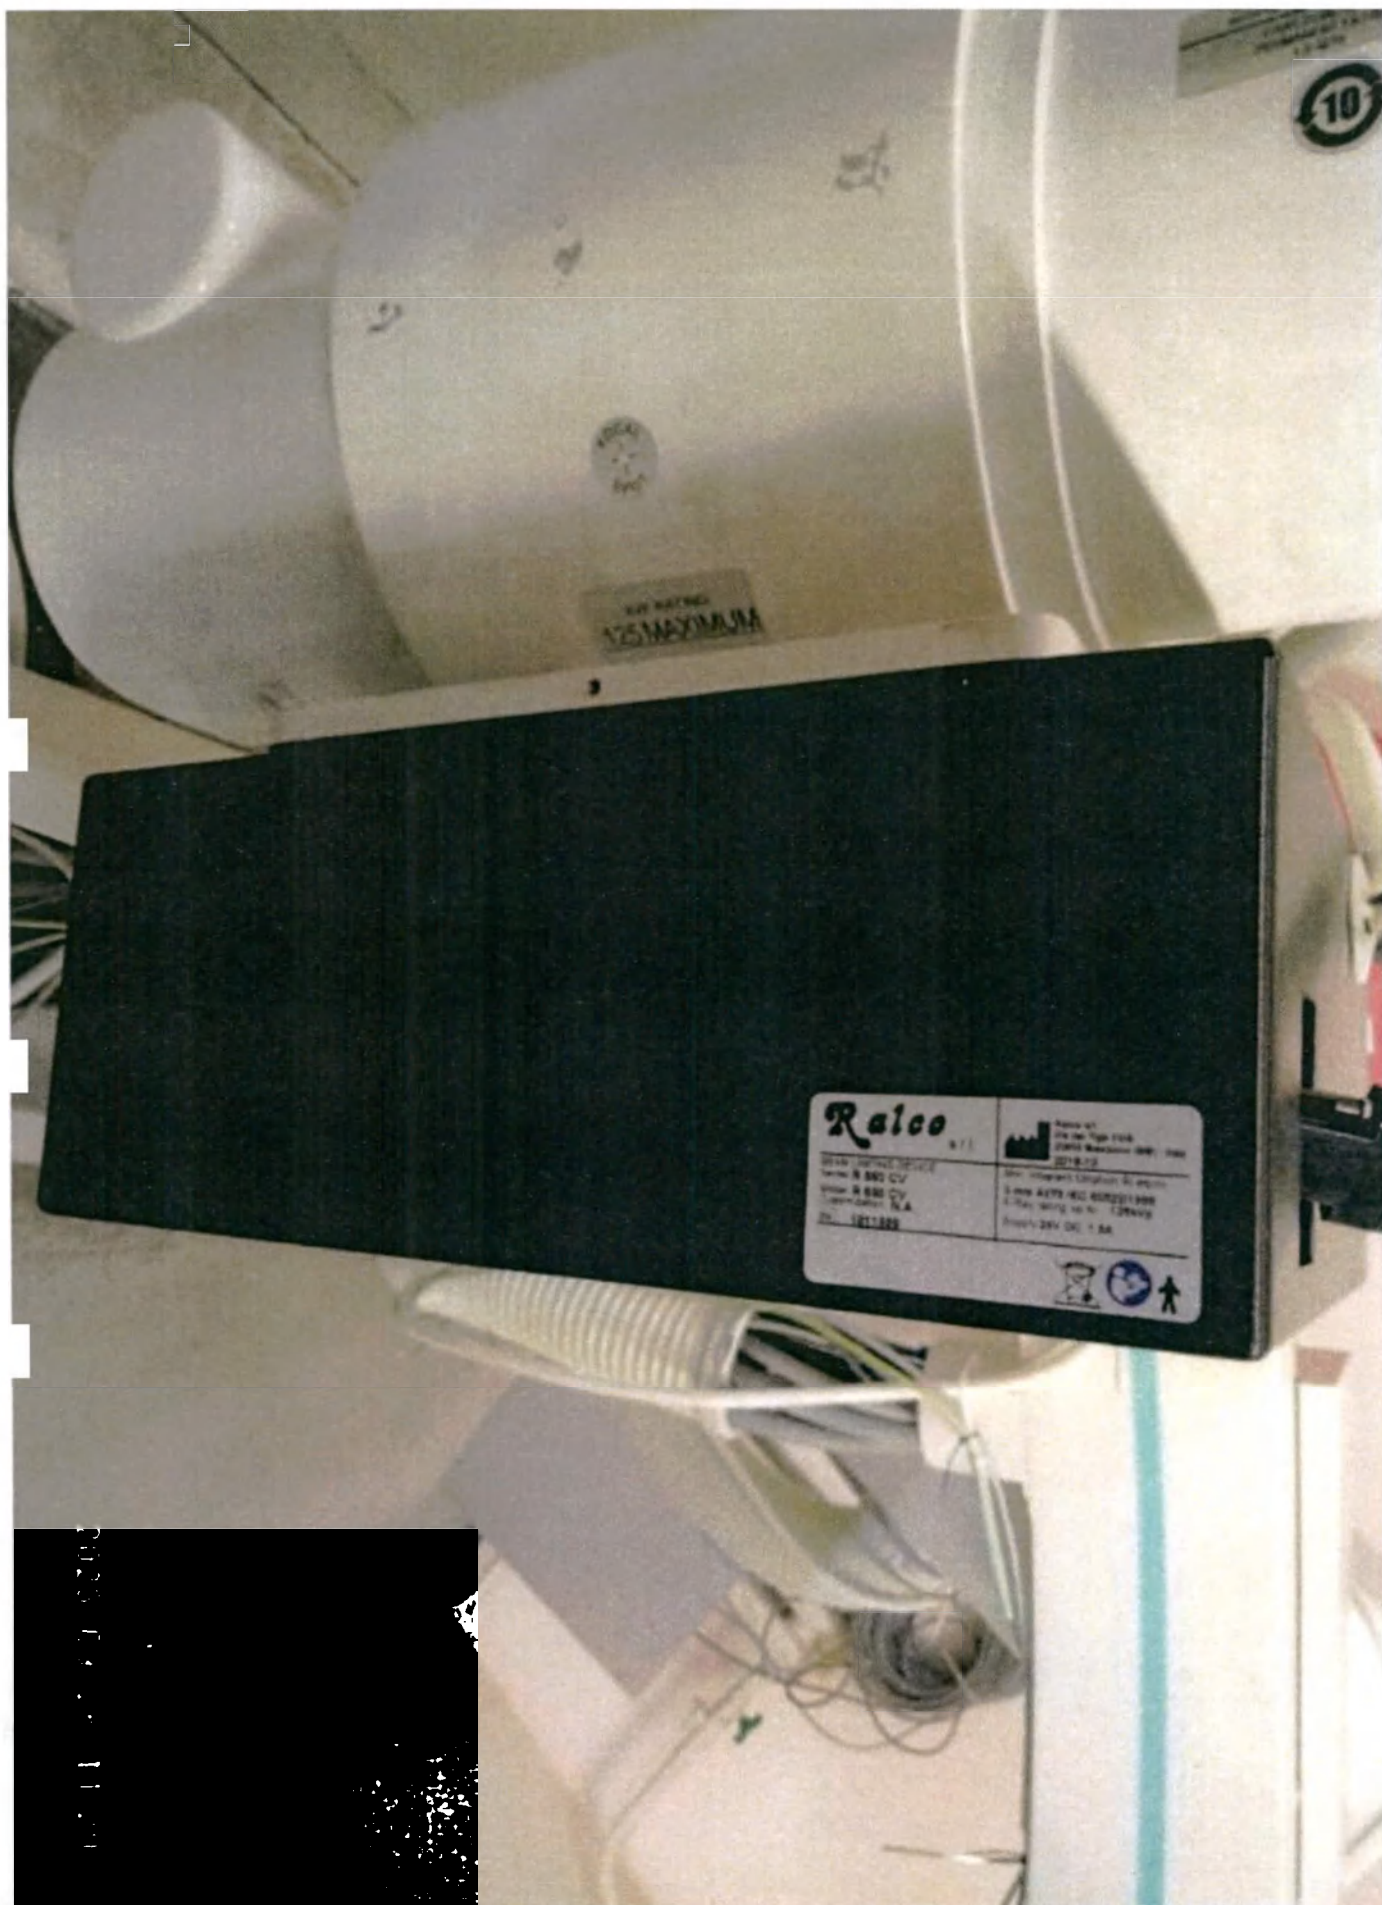

Фотография 43 – Излучатель рентгеновский серии RAD, Varex Imaging и коллиматор (диафрагма) серии R 650CV, Ralco (при эксплуатации излучатель и коллиматор закрыты кожухом штатива). Вариант внешнего вида




Фотография 44 – Коллиматор (диафрагма) серии R 650CV, Ralco. Вариант внешнего вида




Фотография 45 – Коллиматор (диафрагма) серии R650CV, Ralco. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 46 – Коллиматор серии Ralco R 225 ACS DHHS. Образец внешнего вида варианта маркировки

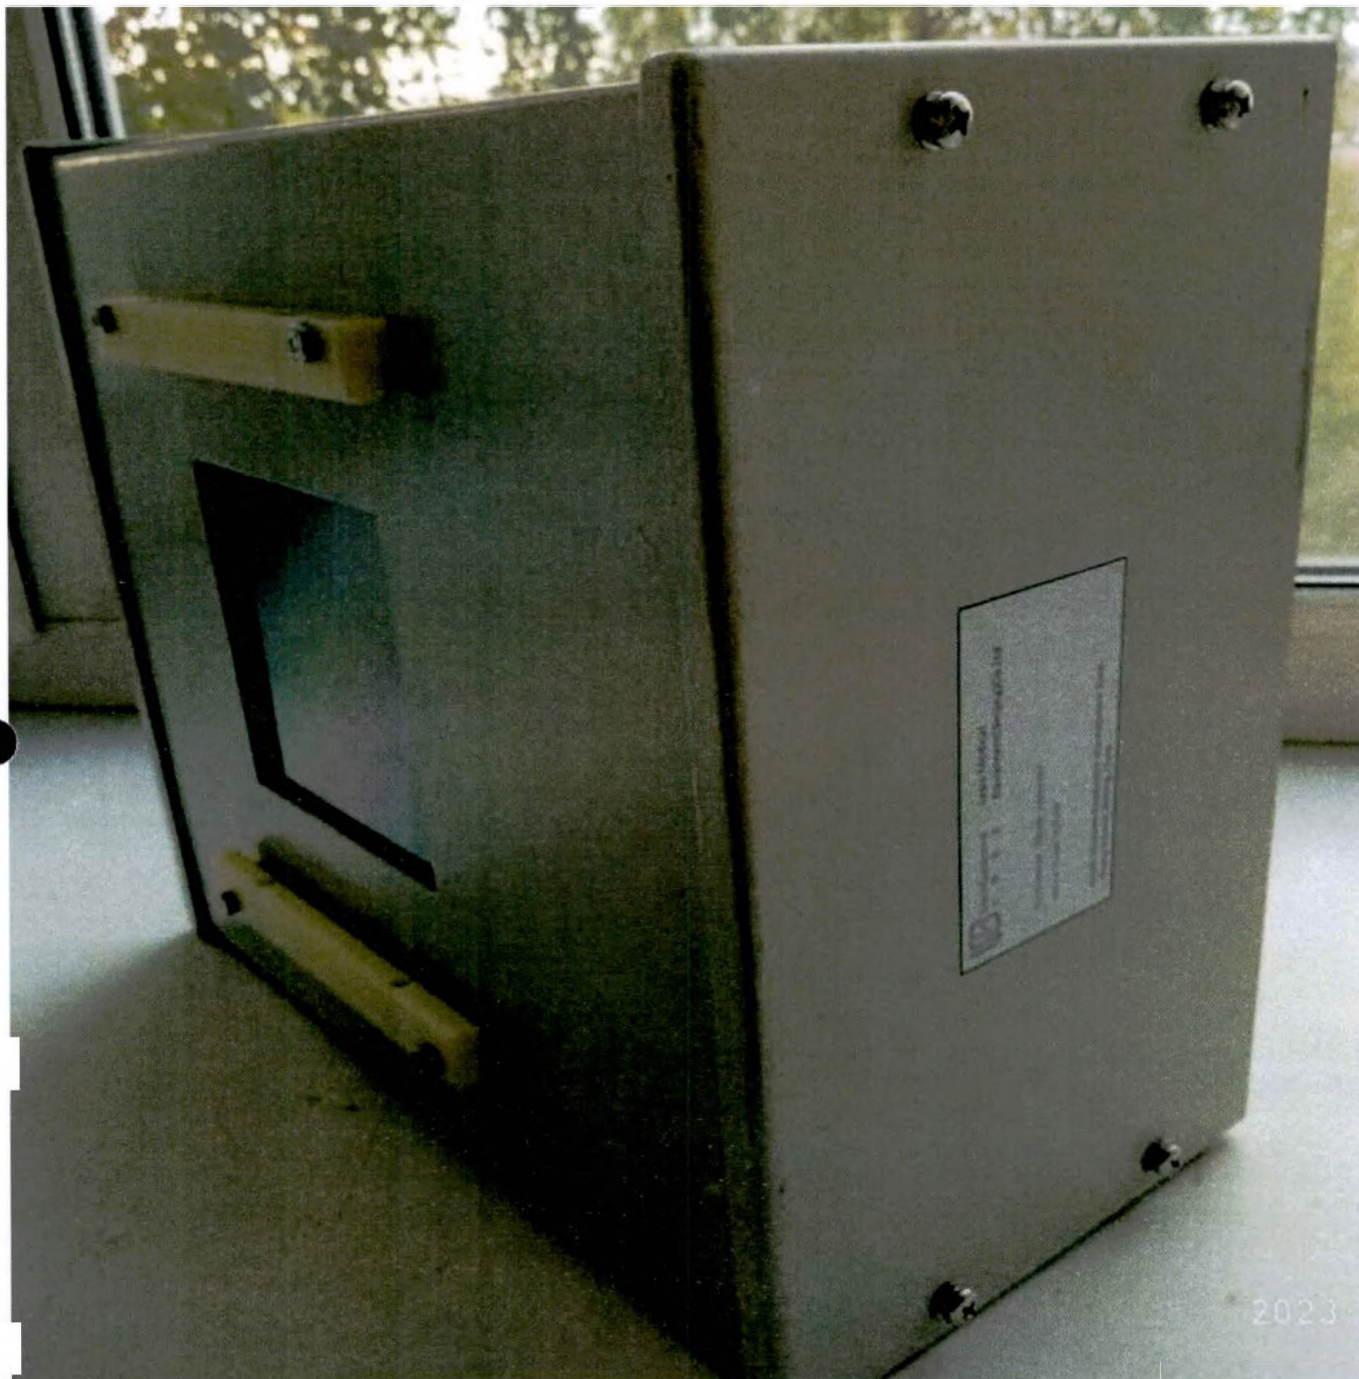

Фотография 47 – Коллиматор (диафрагма) серии Vicor-LD100, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd (при эксплуатации коллиматор закрыт кожухом штатива) и место нанесения маркировки. Вариант внешнего вида

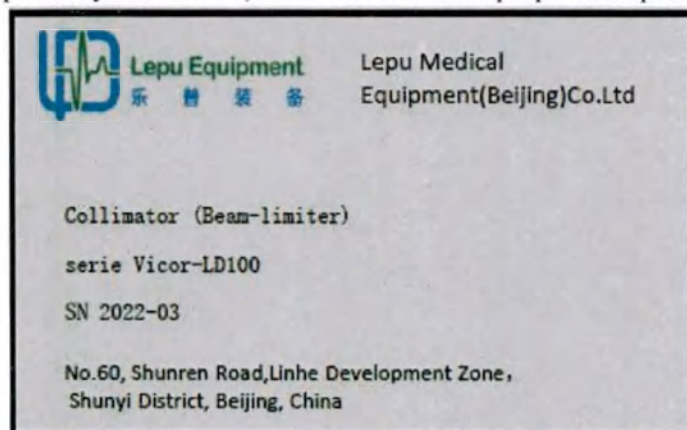

Фотография 48 – Коллиматор (диафрагма) серии Vicor-LD100. Образец внешнего вида варианта маркировки



Стол пациента
AKR-00-4000-01

Серийный номер
Дата изготовления

NN0005313
2023-09

Обозначение МИ

AKR-00-0000-30:0


Серийный номер МИ

GP0006186

Изготовитель

АО «НИПК «Электрон»

NP-20-0200-01



~220 В, 50 Гц, 5 А, IPX4



Фотография 49 – Стол пациента по спецификации AKR-00-4000, АО «НИПК «Электрон». Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 50 – Стол пациента по спецификации AKR-00-4000, АО «НИПК «Электрон» (вариант внешнего вида) в комплектации: Стол для катетеризации серии С, Omega Medical Imaging

Omega Medical Imaging, LLC.

675 Hickman Circle, Sanford, FL 32771

Made in the U.S.A

Configuration: Table for Catheterization
B-200/C300

Series: C

Serial Number: 69-16


Power: 208/220/240 ~ 15A ~ 50/60 Hz



TYPE B
IEC60601-1

Complies with 21 CFR
Subchapter J
at the date of manufacture.


IEC60601-1





Date of Manufacture: August 2016

Label P/N 0310-0041 Rev 2

Фотография 51 – Стол для катетеризации серии C, Omega Medical Imaging. Образец внешнего вида варианта маркировки

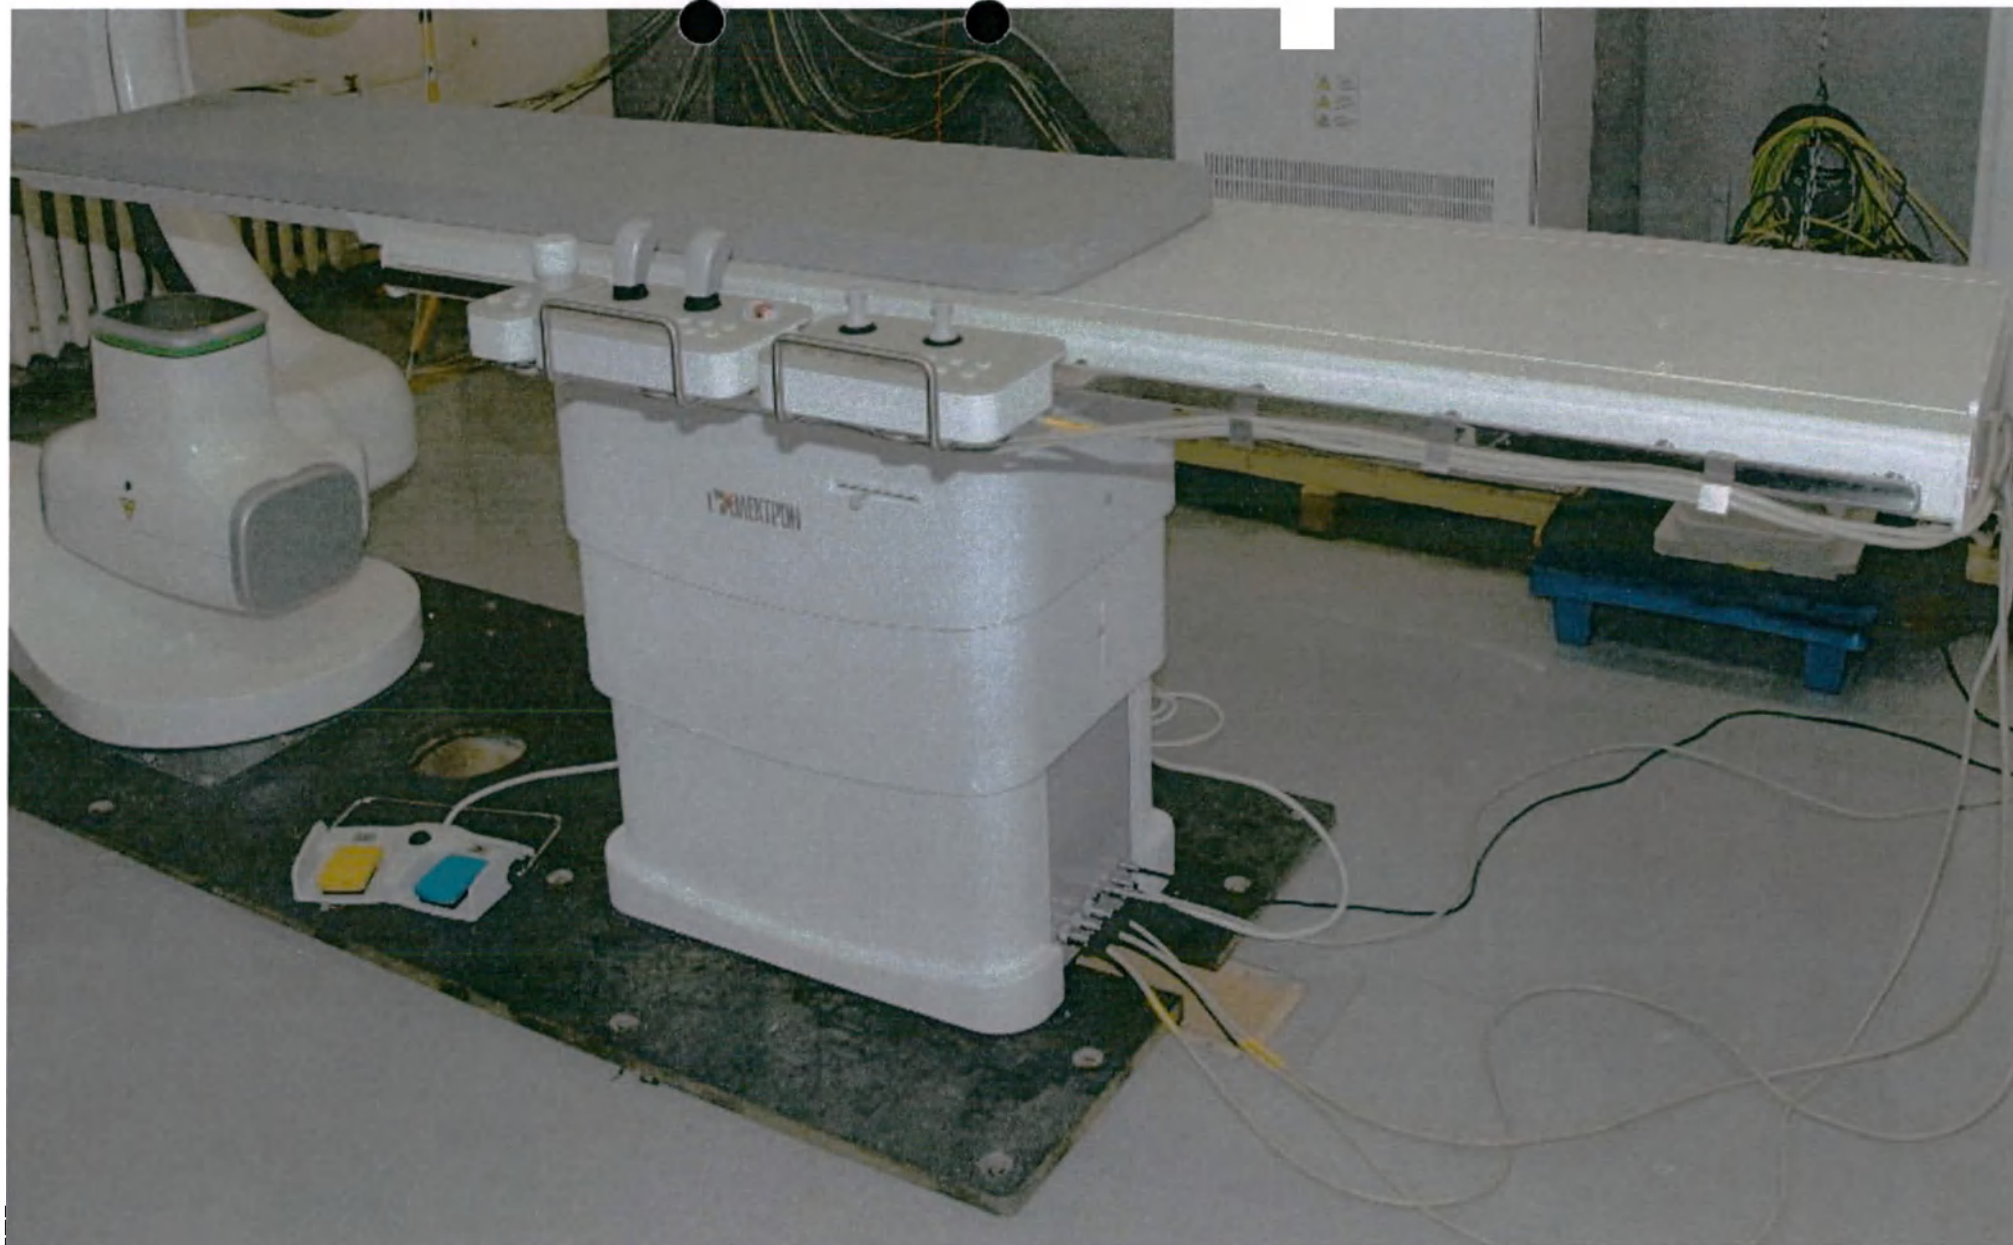

Фотография 52 – Стол пациента по спецификации AKR-00-4000, АО «НИПК «Электрон» (вариант внешнего вида) в комплектации: Стол для катетеризации серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd.

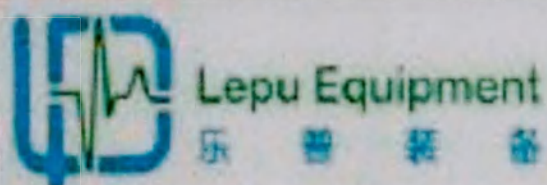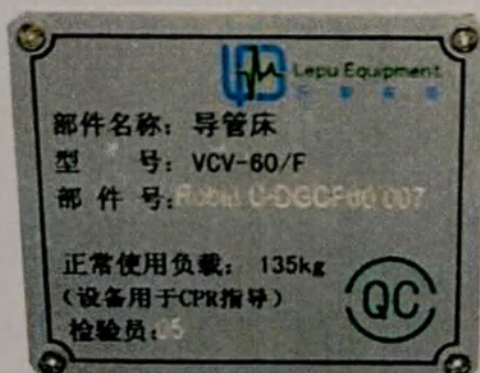

Lepu Medical
Equipment(Beijing)Co.Ltd

Catheter bed
serie VCV-60/S
SN SWIFT PDJ S30 012

No.60, Shunren Road, Linhe Development Zone,
Shunyi District, Beijing, China

Фотография 53 – Стол для катетеризации серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки




Фотография 54 – Система позиционирования рентгеновская серии Roesys XRS, Roesys (образец, вариант внешнего вида)



Фотография 55 – Пульты управления стола пациента серии VCV, VCV-401, VCV-402, VCV-403, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Вариант внешнего вида




Фотография 56 – Пульт управления серии VCV-401, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки

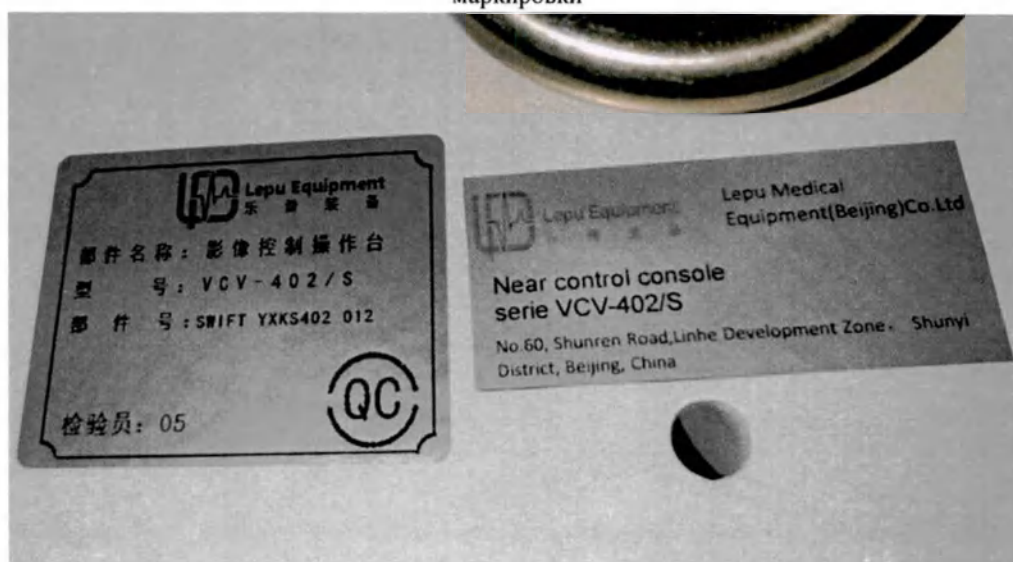

Фотография 57 – Пульт управления серии VCV-402, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки




Фотография 58 – Пульт управления серии VCV-403, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки

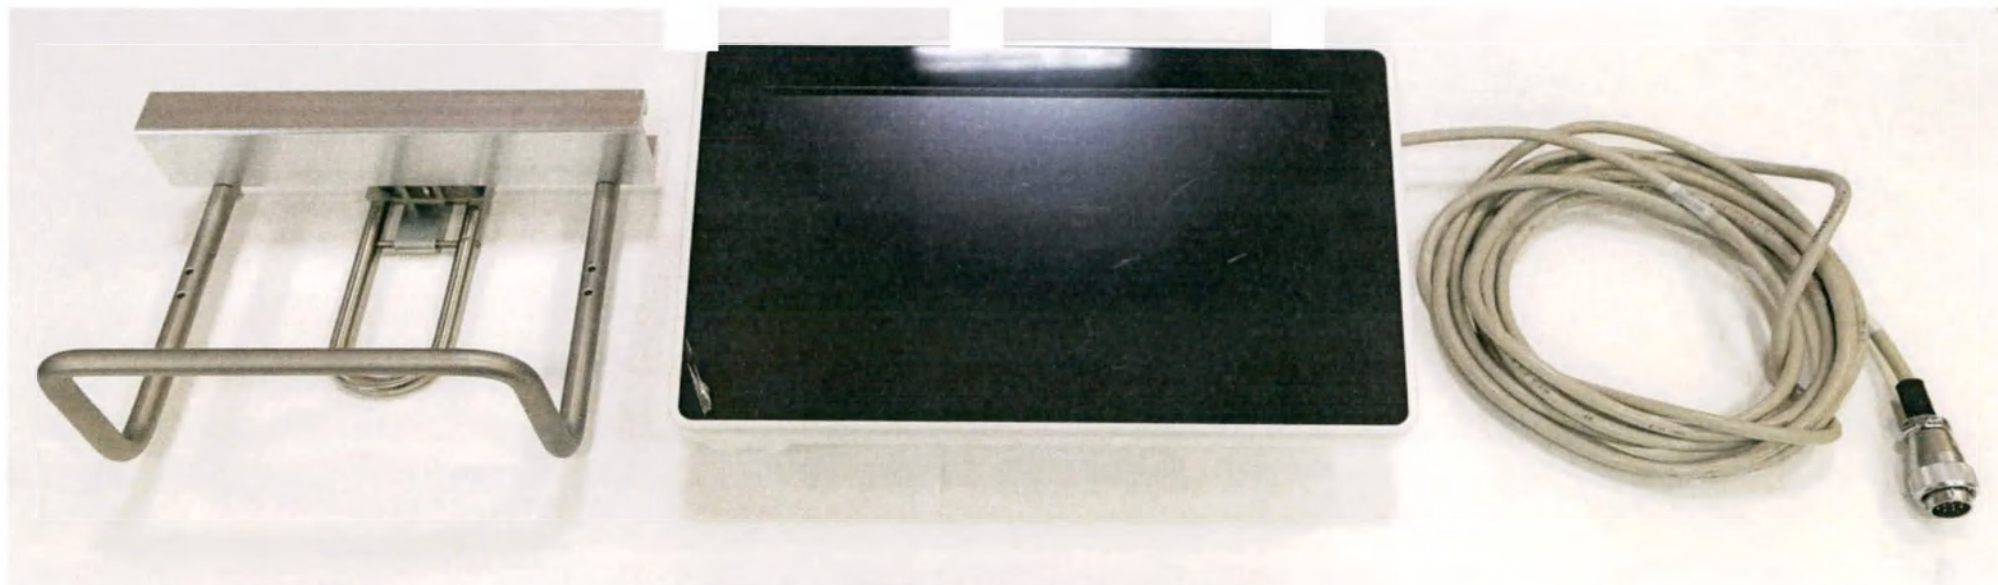

Фотография 59 – Пульт управления серии VCV; VCV 414, Leru Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd, (сенсорный) с креплением. Вариант внешнего вида



Фотография 60 – Пульт управления серии VCV; VCV 414, Leru Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd, (сенсорный) с креплением. Вариант внешнего вида

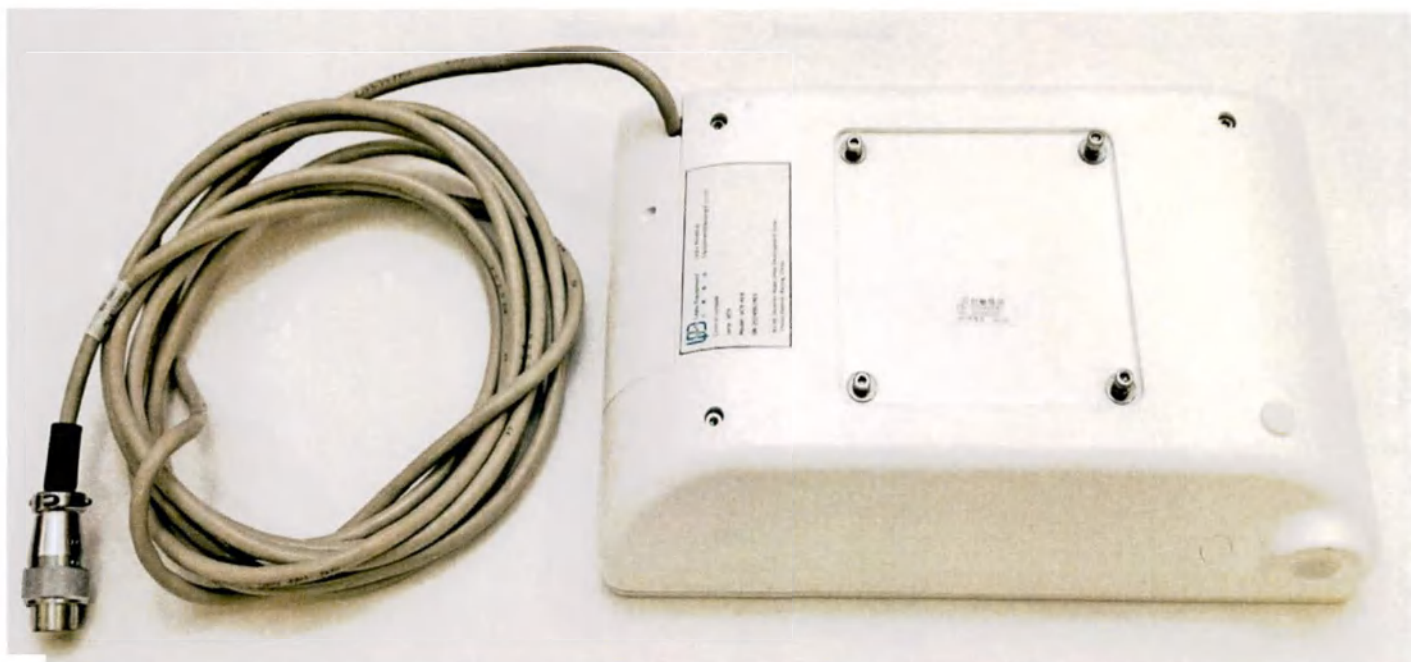

Фотография 61 – Пульт управления серии VCV; VCV 414, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd, (Вариант внешнего вида сзади, место нанесения маркировки).



Фотография 62 – Пульт управления серии VCV; VCV 414, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd, Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 63 – Вариант внешнего вида устройства рентгеновского питающего и место нанесения маркировки

ЭЛЕКТРОН

Устройство рентгеновское
питающее РПУ-"ОКО"
РПУ80Е (RPU80E-00-0000)

ТУ	9442-022-11150760-2006
Серийный номер	NN0005117
Дата изготовления	2023-09

Обозначение МИ АКР-00-0000-30:0

Серийный номер МИ GP0006186

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"

№ 120-0600



3N~380 В, 50 Гц, 100 кВт



Фотография 64 – РПУ-"ОКО" по ТУ 9442-022-11150760-2006, АО «НИПК «Электрон», РУ № ФСР 2010/09310. Образец внешнего вида варианта маркировки

ЭЛЕКТРОН

Пульт управления
7358

Серийный номер NN0005111
Дата изготовления 2023-09

Обозначение МИ AKR-00-0000-30:0


Серийный номер МИ GP0006186

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"


NP-23-0200-01



24 В

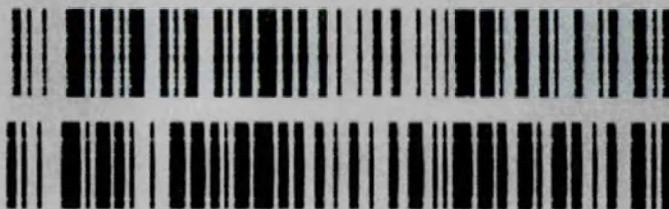

Фотография 65 – Пульт управления (в составе РПУ). Образец внешнего вида варианта маркировки

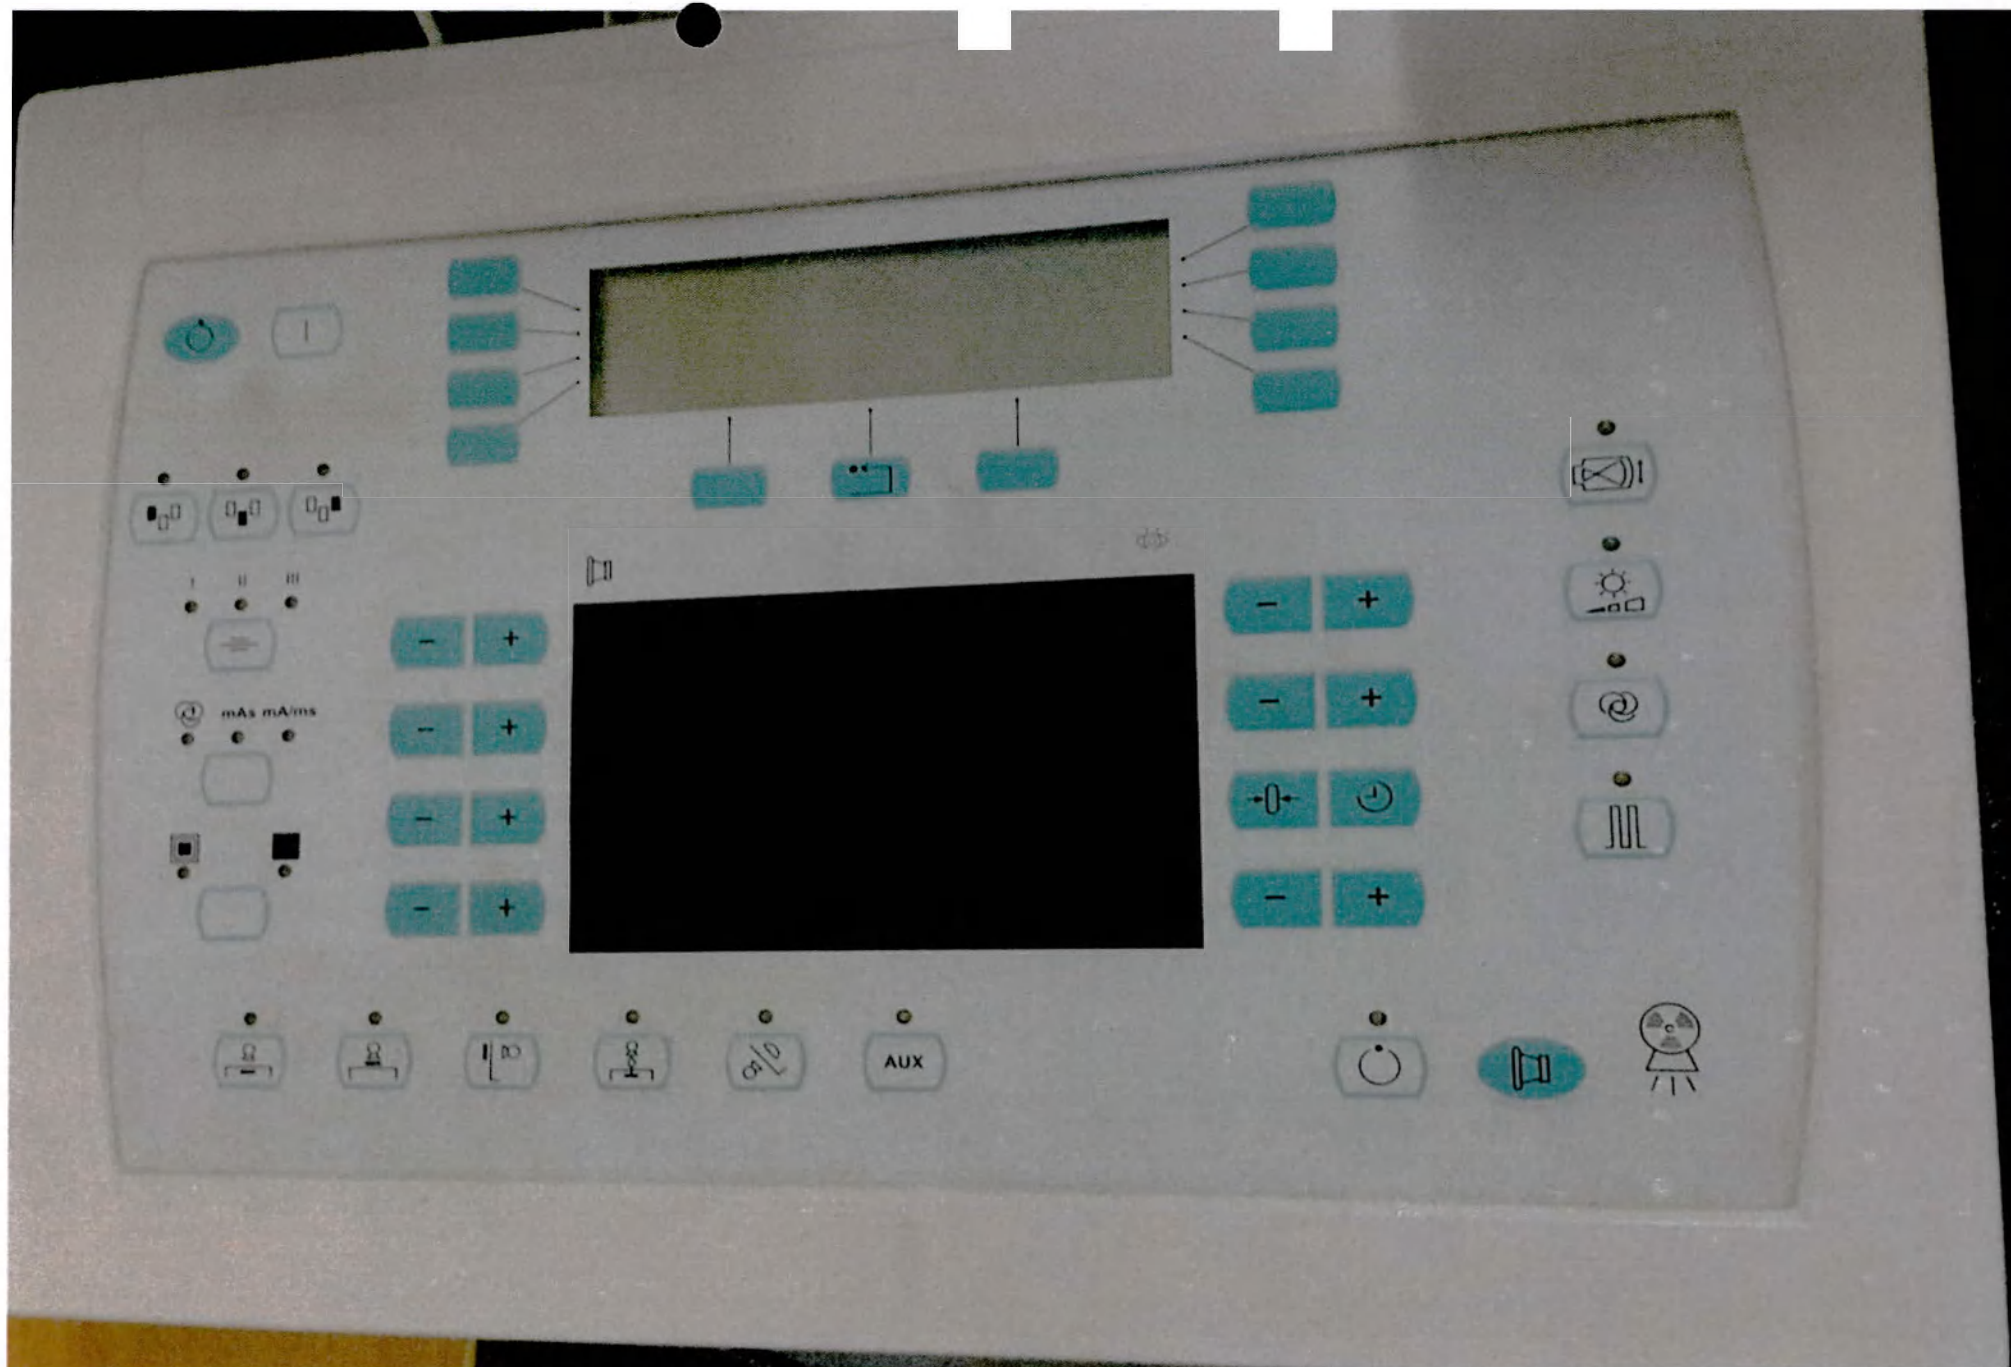

Фотография 66 – Пульт управления РПУ. Вариант внешнего вида

ЭЛЕКТРОН

Устройство рентгеновское
питающее
AKR-00-5000


Серийный номер NN0005118
Дата изготовления 2023-12

Обозначение МИ AKR-00-0000-30:0

Серийный номер МИ GP0006186

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0200-01



3N~380В, 50Гц, 100 кВт



Фотография 67 – Устройство рентгеновское питающее РПУ по спецификации АО «НИПК «Электрон» AKR-00-5000, включающей источник бесперебойного питания мощный. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 68 – Источник бесперебойного питания, Импульс. Вариант внешнего вида



Фотография 69 – Источник бесперебойного питания, модель Боксер, Импульс. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 70 – Источник бесперебойного питания модель Boxer, Makelsan, Турция. Вариант внешнего вида.



Фотография 71 – Источник бесперебойного питания модель Boxer, Makelsan, Турция. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 72 – Кабель высоковольтный с комплектом монтажных частей серии CABLE ASSY, Varex Imaging Corporation. Вариант внешнего вида



Roesys HVC model WBX-Z75-T15

From S/N: BP 2301196197

To S/N: BP 2301196198

Quantity: 2 units

Length in meter: 15M

Фотография 73 – Кабель высоковольтный Roesys HVC. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 74 – Кабель высоковольтный с комплектом монтажных частей серии Wanbo Tianjin Wanbo Wire & Cable CO., LTD., Китай
 Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 75 – Генератор рентгеновский XRPS-10-6380 по спецификации АО «НИПК «Электрон» с пультом управления.
Вариант внешнего вида



Генератор рентгеновский
XRPS-10-6380


Серийный номер NN0030390
Дата изготовления 2023-07

Обозначение МИ РПУ80Е
(RPU80E-00-0000)
Серийный номер МИ GP0006186


Изготовитель АО «НИПК «ЭЛЕКТРОН»

3N~380В, 50Гц, 100 кВА

NP-20.0200-02

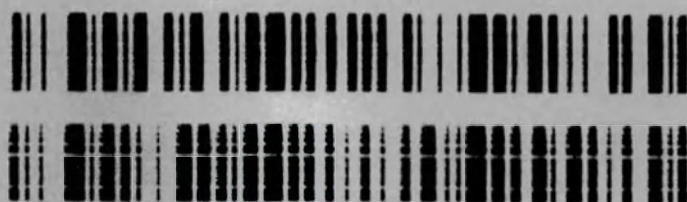

Фотография 76 – Генератор рентгеновский XRPS-10-6380 АО «НИПК «Электрон». Образец внешнего вида варианта маркировки

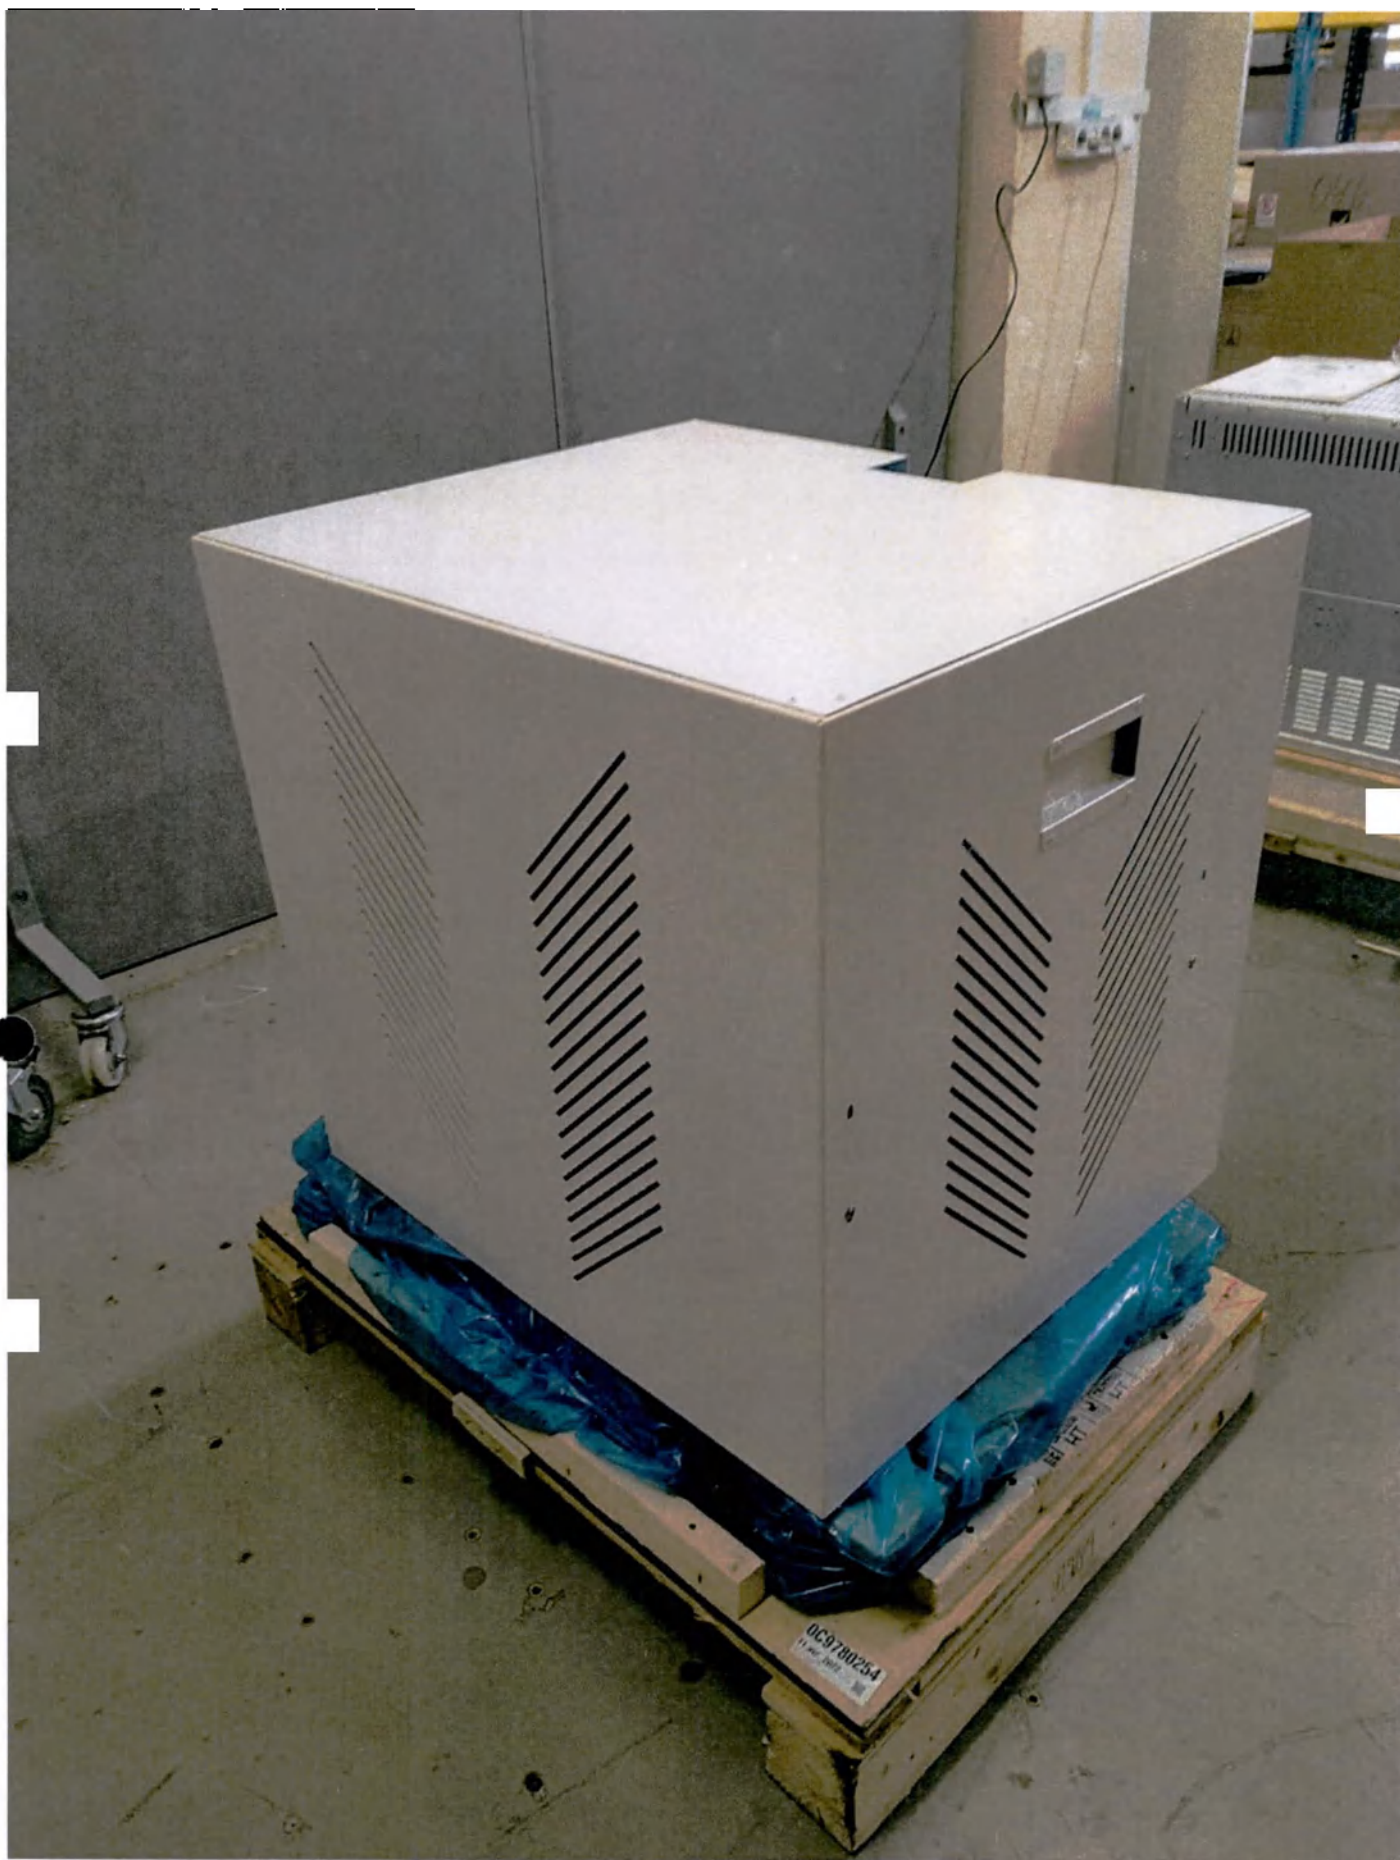

Фотография 77 – Генератор рентгеновский серии EPS, Emd Technologies. Вариант внешнего вида

 **Emd Technologies**
400 du Parc
Saint-Eustache (Quebec)
Canada, J7R 0A1

Epsilon High Voltage X-Ray Generator

REF/Model: EPS 45-80
Configuration: **EPS ETA 50R**


PN: 10000.368
SN: 22-E0077



IEC 60601-1, CLASS I, TYPE B



Manufactured:
May 2022



MADE IN CANADA

9912 00 S8

ETL CLASSIFIED



Intertek
58611

Medical Electrical Equipment

CE
0413




This product complies with DHHS radiation performances of 21 CFR, Sub-chapter J in effect at date of manufacturing.

EMD's High Voltage Generators are protected by one or more claims of EMD's United States Patent Number 7,936,544, 6,738,275, 6,967,559 and 7,375,993 and EMD's European Patent 1 102 388 B1. Additional EMD patent applications pertinent to the product are pending.

9913 04

Фотография 78 – Генератор рентгеновский серии EPS, Emd Technologies. Образец внешнего вида варианта маркировки

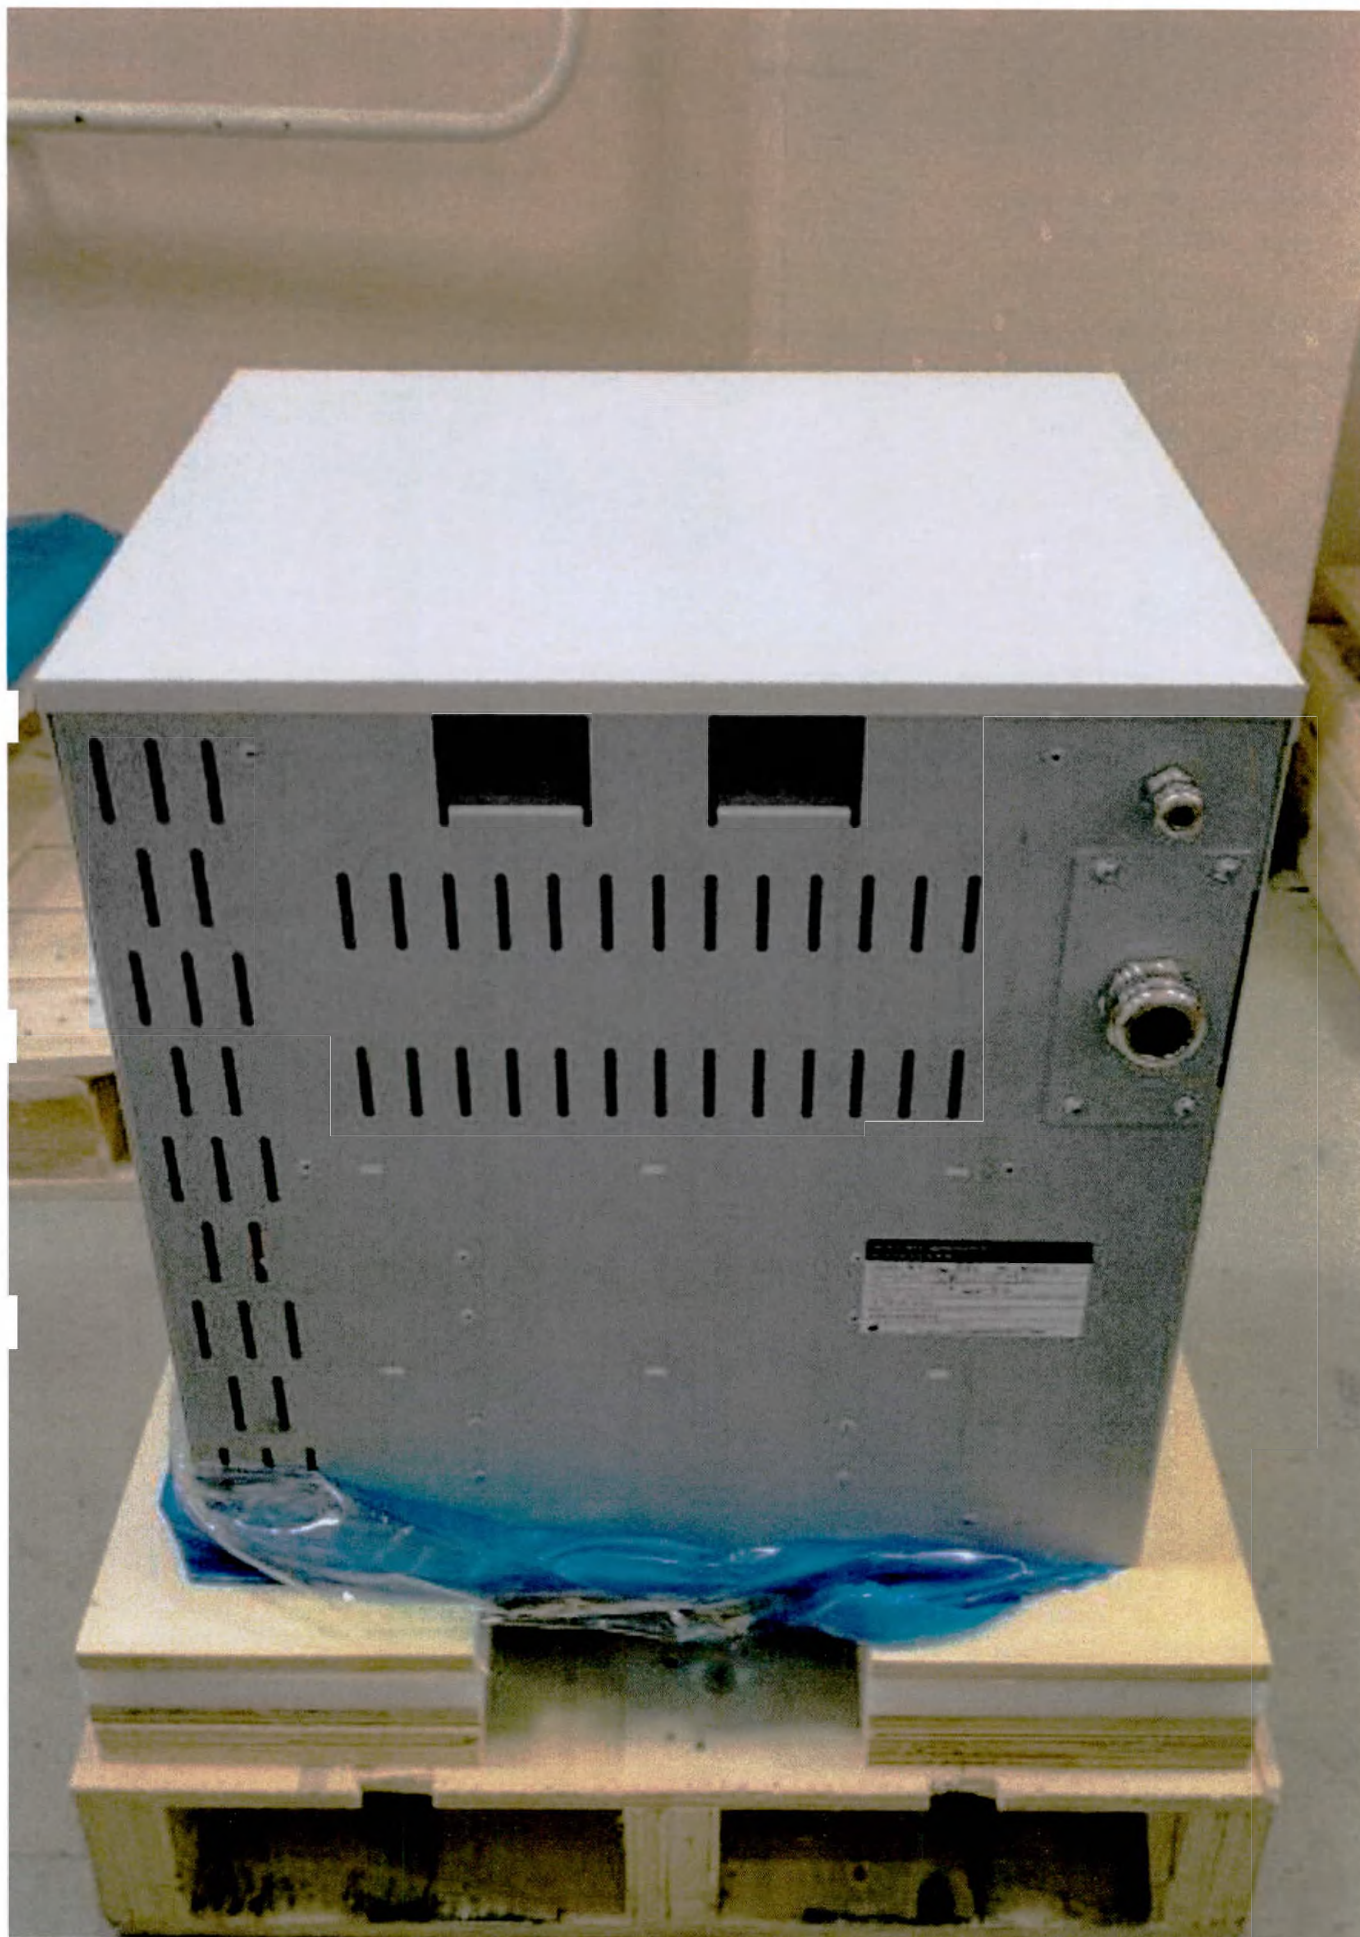

Фотография 79 – Генератор рентгеновский серии Cetus, High Voltage Tech. Вариант внешнего вида

HVT X-RAY GENERATOR

HVT X线高压发生器

MODEL

型号: Cetus 80R01 PN: 03490014

SN

产品序列号: CE0809100831222001



Manufactured: 生产日期: 2022-9-16

CLASS I - CONTINUOUS OPERATION WITH INTERMITTENT LOADING

I类 间歇加载 连续运行

Refer to Service Manual for Power Line Ratings

电源要求请参考服务手册



Made in China by High Voltage Technologies

Room 406, Building 24, No. 588, Xijunhuan Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China

海玮电子科技(上海)有限公司 上海市闵行区新骏环路588号24号楼406室 中国制造

Фотография 80 – Генератор рентгеновский серии Cetus, High Voltage Tech. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 81 – Генератор рентгеновский серии PROGEN, Listem Corporation. Вариант внешнего вида

고전압 발생장치
HIGH-VOLTAGE GENERATOR

LISTEM

모델명 Model	PROGEN-650RH				
제조번호 Serial Number	SN	0076	제조일자 Data		22.09.28
전원전압 Supply Voltage	380	V	3	~	50/60 Hz 80 kVA
정격 Rating	-	mA	-		kVp
	640	mA	100		kVp
	400	mA	150		kVp
제조사 Manufacturer		주식회사 리스탐 LISTEM Corporation			 
주소 Address	26365, 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 94 94, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, 26365, Republic of Korea Tel : +82-1577-8522 / Fax : +82-2-860-9530 www.listem.co.kr				

90 KR



Фотография 82 – Генератор рентгеновский серии PROGEN, Listem Corporation. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 83 – Генератор рентгеновский серии OPERA, Communications & Power Industries Canada Inc. Вариант внешнего вида



UDI

(01)00885310000038

(21)CPD42104M22

SYSTEM PART NO.:

VZW2556RB2-YK

SYSTEM SN.:

CPD42104M22

SYSTEM ACCESSORY LISTING
(per factory configuration)

CONSOLE SN:

HV MODULE SN:

G0440576M22

ADR SYSTEM SN:

SYSTEM CONTAINS

FIRMWARE

PART NO.:

90176400

REVISION:

AM

COMPATIBLE WITH

SYSTEM MODEL :

VZW2556RB2-YK

RoHS

MANUFACTURED FOR

General Medical Merate S.p.A.

24068 SERIATE (BG) - ITALIA

BY

Communications & Power Industries Canada Inc.
45 River Drive, Georgetown, Ontario, Canada, L7G 2J4

MADE IN CANADA

MODEL NO.: VZW2556RB2-YK

SERIES: Opera G500DR

PART NO.: 95113818

SERIAL NO.: CPD42104M22

MFG. DATE: December 2022

VOLTS AC: 400/480

MOMENTARY NOMINAL

AMPS AC: 100/80 5

FREQ: 50/60 Hz PHASE: 3

COMPLIES WITH IEC 60601-2-54: 2009
& CDRH RADIATION PERFORMANCE
STANDARD 21 CFR, SUBCHAPTER J

Фотография 84 – Генератор рентгеновский серии OPERA, Communications & Power Industries Canada Inc. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 85 – Генератор рентгеновский серии Indico IQ, Communications & Power Industries Canada Inc. Вариант внешнего вида

系统所含软件

配件号码:

90940700

版本:

B

兼容系统型号:

VZW2558FJ812

SYSTEM CONTAINS
SOFTWARE

PART NO.:

90940700

REVISION:

B

COMPATIBLE WITH
SYSTEM MODEL :

VZW2558FJ812

RoHS 生产商

CPI Communications & Power Industries
45 River Drive, Georgetown, Ontario, 加拿大, L7G 2J4
加拿大制造

型号: VZW2558FJ812

配置: -05

系列: INDICO IQ X射线诊断高压发生装置

部件号码: VZW2558FJ812-05

序列号: AMQ03375J21

生产日期: 2021 年 09 月

交流电压(V): 400-480

	瞬间值	标称值
交流电流(A):	220-170	4
频率:	50/60 Hz	相数: 3

符合IEC标准 60601-2-54: 2009 以及
CDRH 放射性性能标准
21 CFR, 子章节 J

RoHS MANUFACTURED BY

CPI Communications & Power Industries
45 River Drive, Georgetown, Ontario, Canada, L7G 2J4
MADE IN CANADA

MODEL NO.: VZW2558FJ812

CONFIGURATION: -05

SERIES: INDICO IQ RF 100kW

PART NO.: VZW2558FJ812-05

SERIAL NO.: AMQ03375J21

MFG. DATE: September 2021

VOLTS AC: 400-480

	MOMENTARY	NOMINAL
AMPS AC:	220-170	4
FREQ:	50/60 Hz	PHASE: 3

COMPLIES WITH IEC 60601-2-54: 2009
& CDRH RADIATION PERFORMANCE
STANDARD 21 CFR, SUBCHAPTER J

产品名称 高压发生器

有效期限: 10 年

工作方式: 间歇加载 连续运行

类别: 1 类

其他内容详见说明书

注意高压

查阅随机文件

PRODUCT NAME Diagnostic X-Ray Generator

EXPIRY DATE: 10 Years

MODE OF OPERATION: Continuous operation with intermittent loading


CLASSIFICATION: CLASS I

OTHER CONTENTS REFER TO MANUAL FOR DETAILS

CAUTION HIGH VOLTAGE

REFER TO RELATED FILE

Фотография 86 – Генератор рентгеновский серии Indico IQ, Communications & Power Industries Canada Inc. Образец внешнего вида варианта маркировки

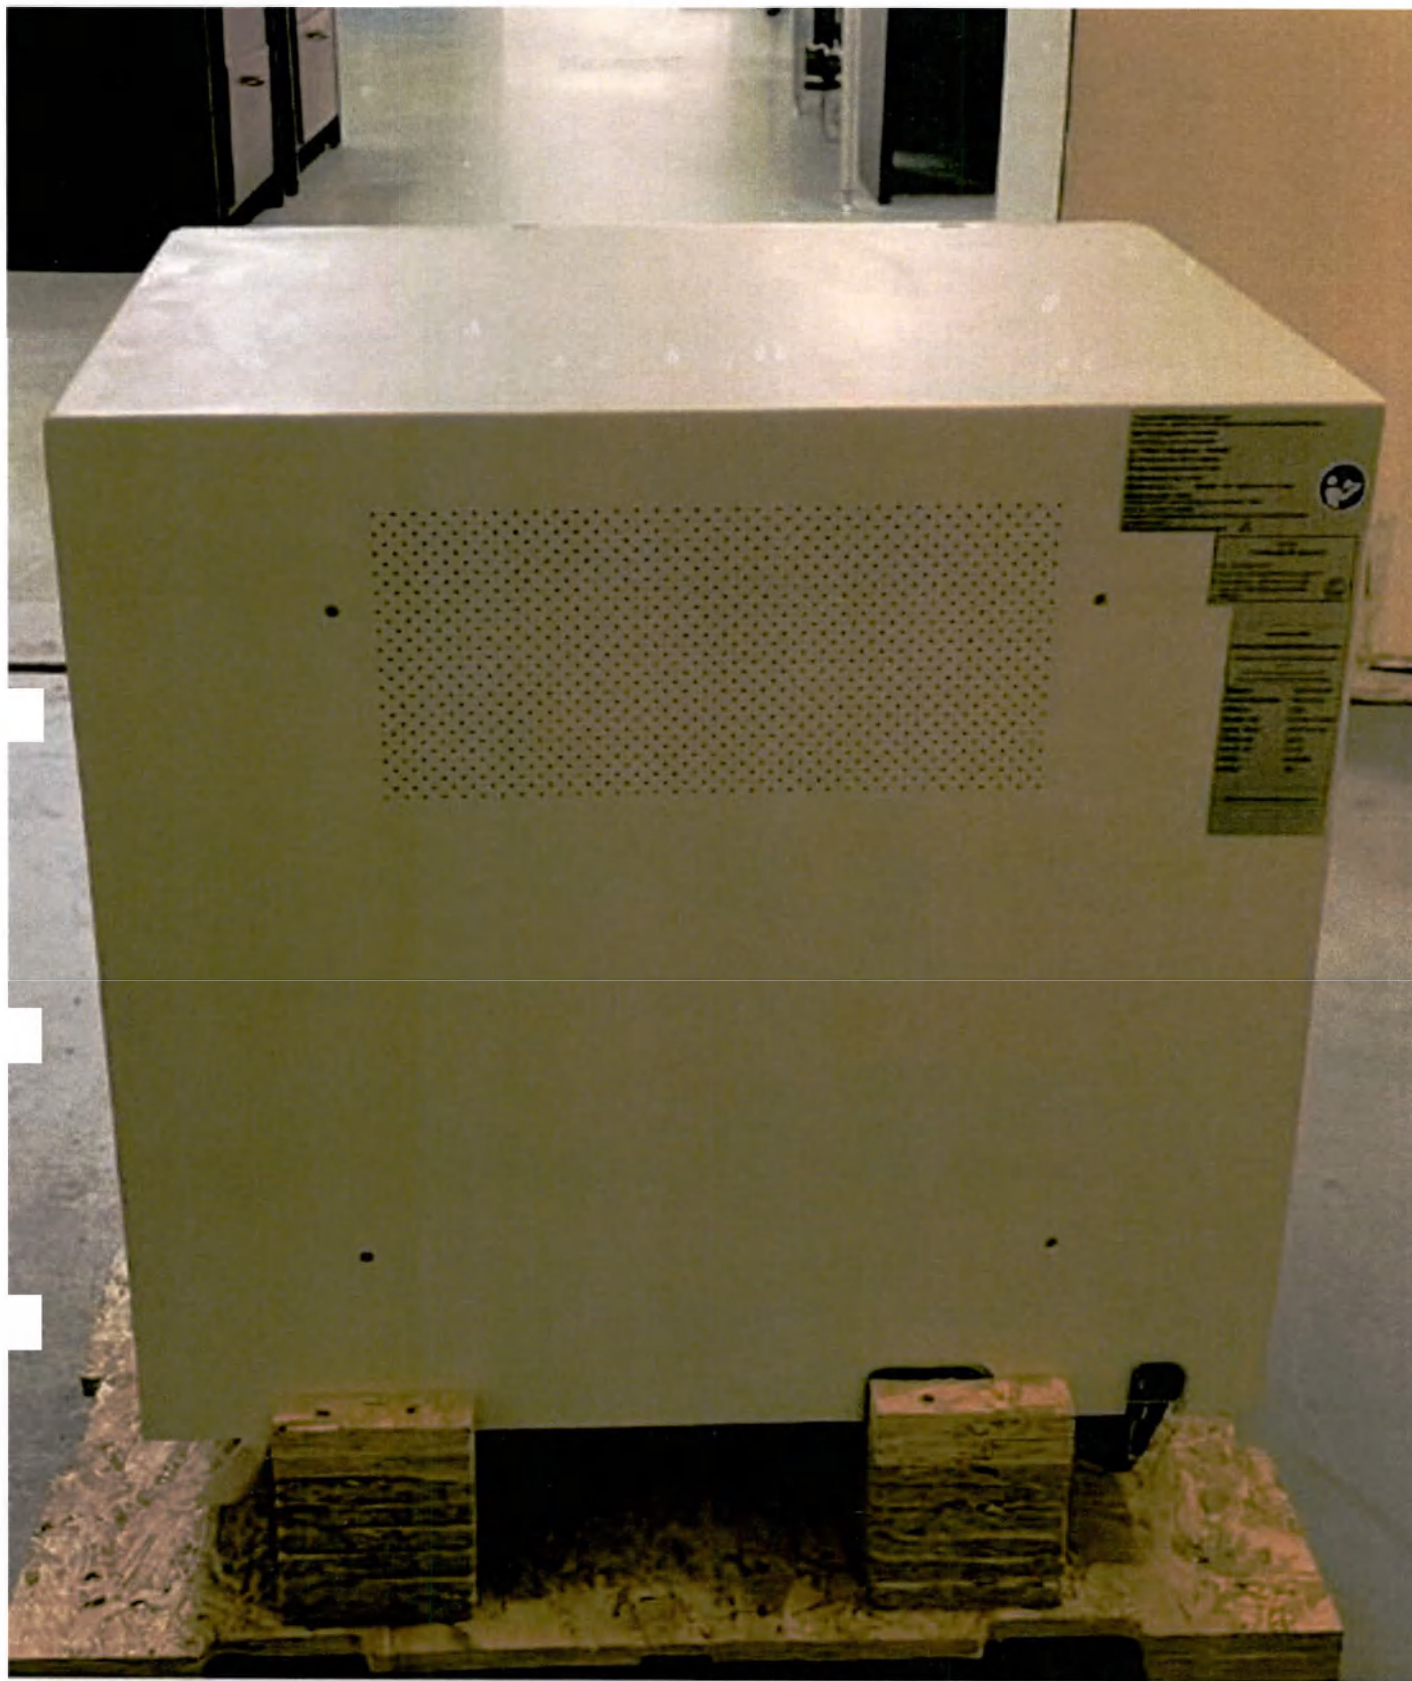

Фотография 87 – Генератор рентгеновский серии PSG, Suzhou Powersite Electric Co., Ltd. Вариант внешнего вида

产品名称: 医用X射线高频高压发生器组件

Product Name: Medical X-ray High Frequency High Voltage Generator Assembly

规格/型号 Configuration: PSG-HR65L

产品序列号 Serial No.: 03102211009

生产日期 Date of Manufacture: 2023/04/27

输入电压 Input Volts: 380V 3N~ 50/60Hz

最大输入功率 Max Input Power: 110kVA

待机功率 Standby Power: 700VA

整机版本 Version: V1.0

使用期限: 10年 Validity Period: 10 Years

按防电击类型分类: I类设备

Classification by Type of Electric Shock Protection: Class I

运行模式: 连续运行间歇加载

Classified by Operation Mode: Continuous operation under intermittent loading

其他内容详见说明书



Refer to instructions for Use for more details.



Фотография 88 – Генератор рентгеновский серии PSG, Suzhou Powersite Electric Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 89 – Генератор рентгеновский серии R, Odel s.r.l. Вариант внешнего вида

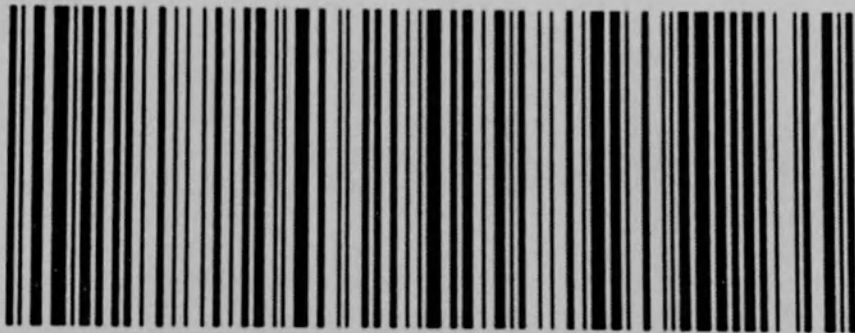		 Odel s.r.l. Via Laboratori Autobianchi, 1 Lotto 24B - 20832 Desio (MB) - ITALY	
H.V. Generator		Program HF US3	
REF		R306.48	
SN		5404-F23	
UDI  (01)08051380400081(21)5404F23			
Continuous power		800 VA	
Intermittent power		150 kVA	
 [2023/06]	400V $\pm$ 10% 50-60Hz 3~		
	 e-IFU indicator (CDROM)		

Фотография 90 – Генератор рентгеновский серии R, Odel s.r.l. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 91 – Генератор рентгеновский серии Polydoros, Siemens Healthcare GmbH. Вариант внешнего вида

3/PE - 380/400/420/440/460/480V (phase to phase)
50/60Hz
MOMENT kVA: 160
LONG-TIME kVA: 8

☐ 380V ☐ 400V ☐ 420V
☐ 440V ☐ 460V ☐ 480V

Bitte Zutreffendes ankreuzen / Please mark the appropriate box

 Polydoros A100 Plus 195cm
(240) 11115702 MODEL
(422) 276 ORIGIN DE
(21) 11108 SERIAL

 CLASSIFIED
C UL US
E347424

SIEMENS

Polydoros A100 Plus
 (01) 04056869019475 GTIN
(240) 10563420 MODEL
(422) 276 ORIGIN DE
(21) 11108 SERIAL

IVK

 Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
Made in Germany

9 LITE
CAMERA

SIEMENS

产品名称: X射线高频高压发生器
产品型号: Polydoros A100 Plus
物料号: 10563420
序列号: 1188
注册证号:
代理人名称:
西门子爱克斯射线真空技术(无锡)有限公司
代理人住所:
中国江苏省无锡市梅育路112号 214028
代理人联系方式: 0510-66662888

类别: I类 GB 9706.11-1997
工作制: 间歇加载连续运行
电源: 三相交流
输入功率: 最大160kVA
使用期限: 见说明书
生产日期: 2022年 其他参照说明书

注册人/生产企业: Siemens Healthcare GmbH
注册人/生产企业住所: Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Germany
生产地址: Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Germany

德国制造

 Lepu Medical
Equipment(Beijing)Co.Ltd

X-Ray generator
serie Polydoros A100 Plus
Hu, 50, Shuangqing Road, Shuangqing Development Zone,
Shuangqing District, Beijing, China

Фотография 92 – Генератор рентгеновский серии Polydoros, Siemens Healthcare GmbH. Образец внешнего вида варианта маркировки

ЭЛЕКТРОН

Система визуализации
рентгеновского изображения
AKR-00-6000

Серийный номер NN0005517

Дата изготовления 2023-09


Обозначение МИ AKR-00-0000-30:0

Серийный номер МИ GP0006186

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"

~220 В, 50 Гц, 60 Вт

NF-20-0200-01



Фотография 93 – Система визуализации рентгеновского изображения (приемник) по спецификации AKR-00-6000 . Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 94 – Усилитель рентгеновского изображения УРИ, АО «НИПК «Электрон», РУ № ФСР 2008/02453 (при эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

ЭЛЕКТРОН

Усилитель рентгеновского
изображения УРИ
УРИ1018-000

ТУ
Серийный номер
Дата изготовления

9442-027-11150760-2007
NN14594100
2022-07

Обозначение МИ

AKR-00-0000-30:0


Серийный номер МИ

GP0006186

Изготовитель

АО "НИПК "Электрон"


№ 20-0650




~220В, 50 Гц, 3 кВА




Фотография 95 – Усилитель рентгеновского изображения УРИ. Образец внешнего вида варианта маркировки

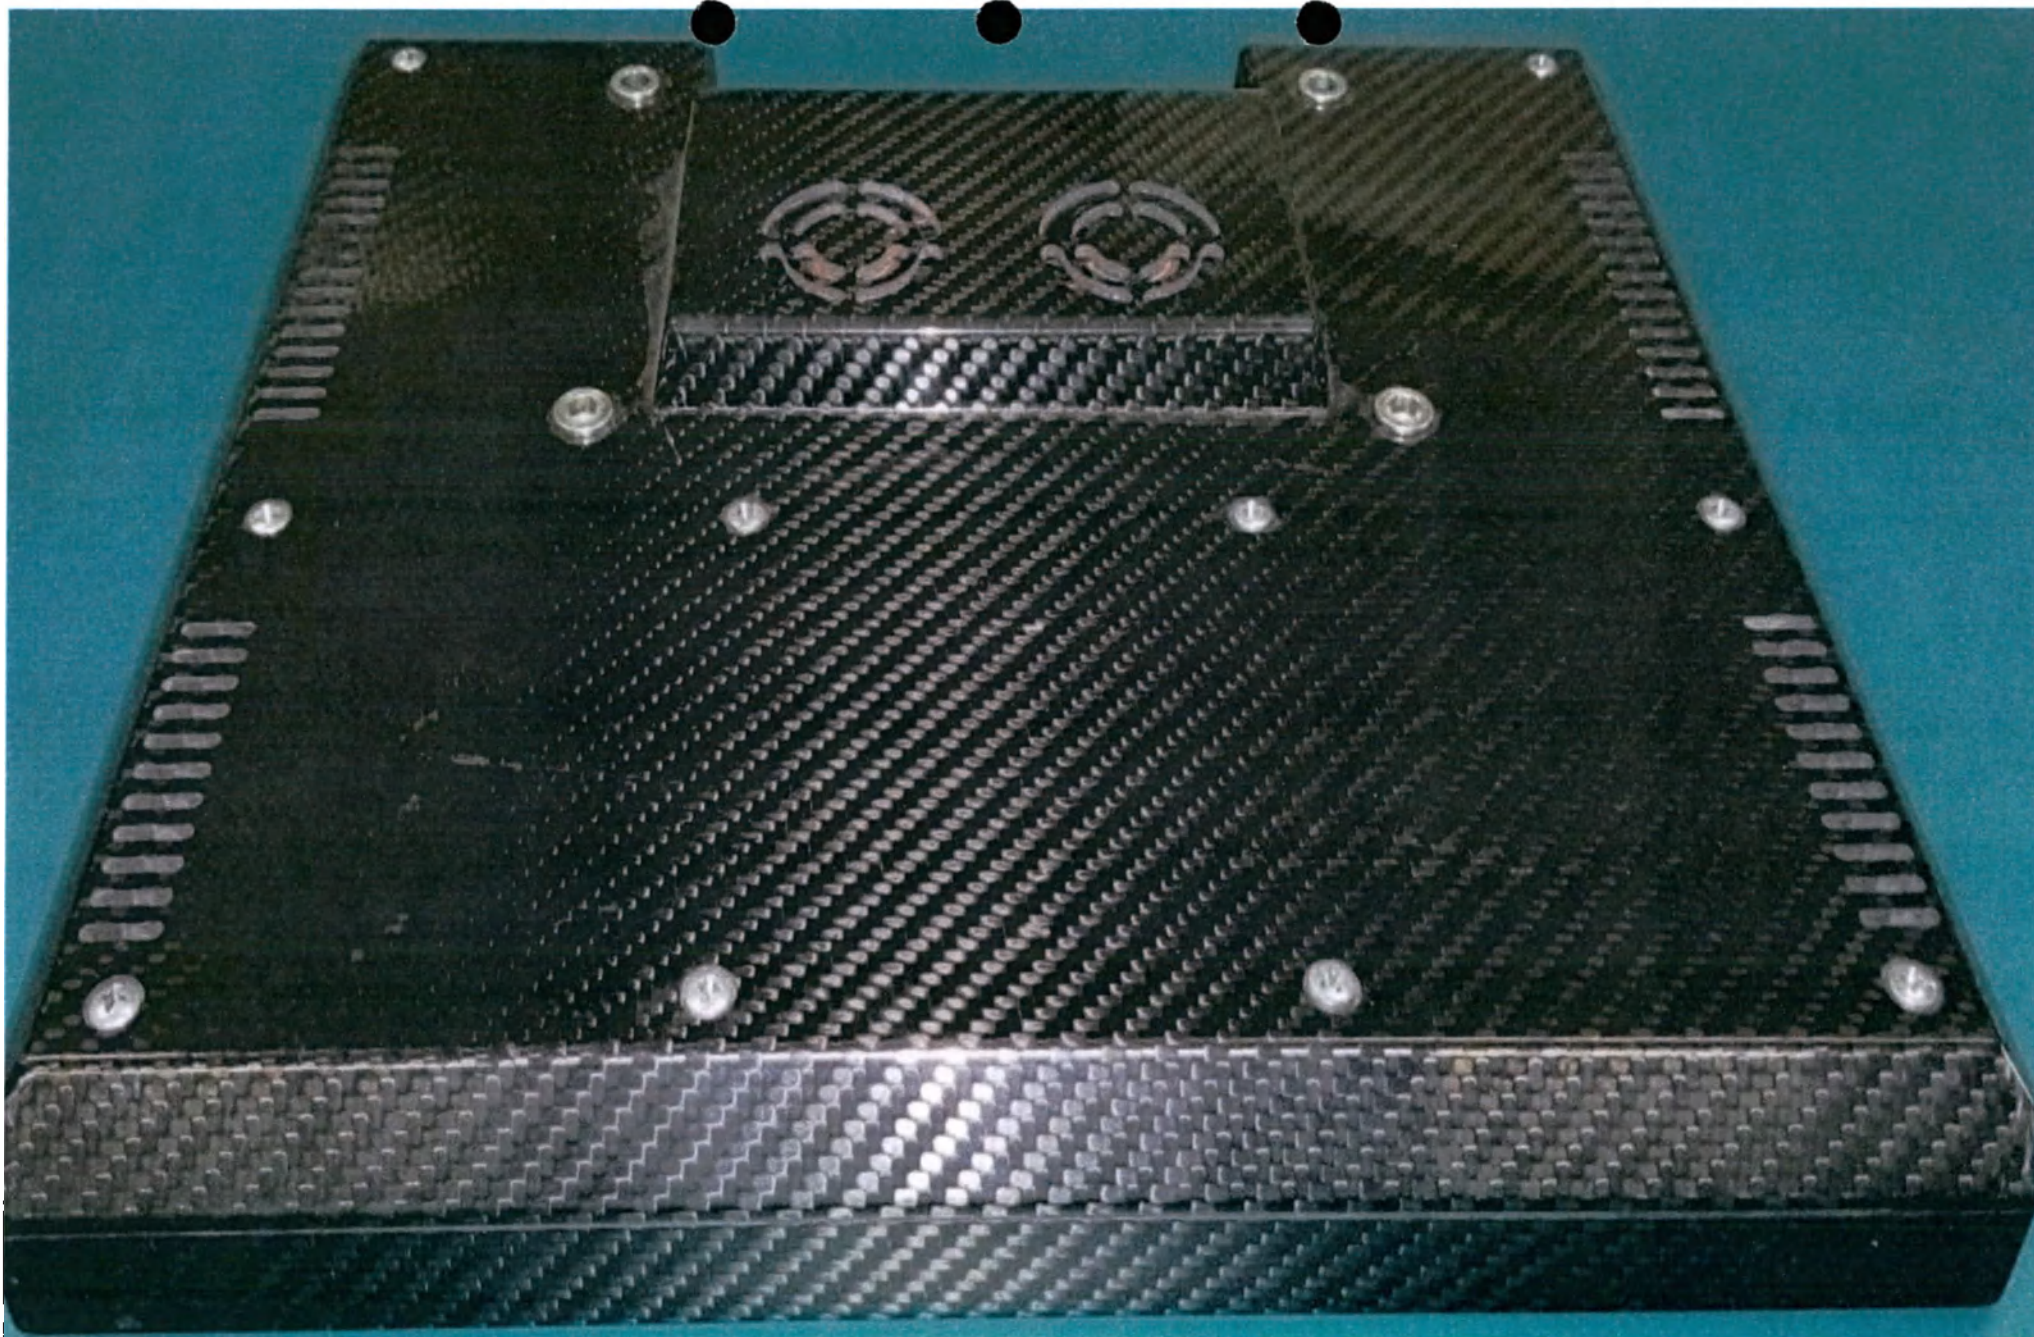


Фотография 96 – Блок датчика серии Roesys KRC1 – 200, Roesys GmbH (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

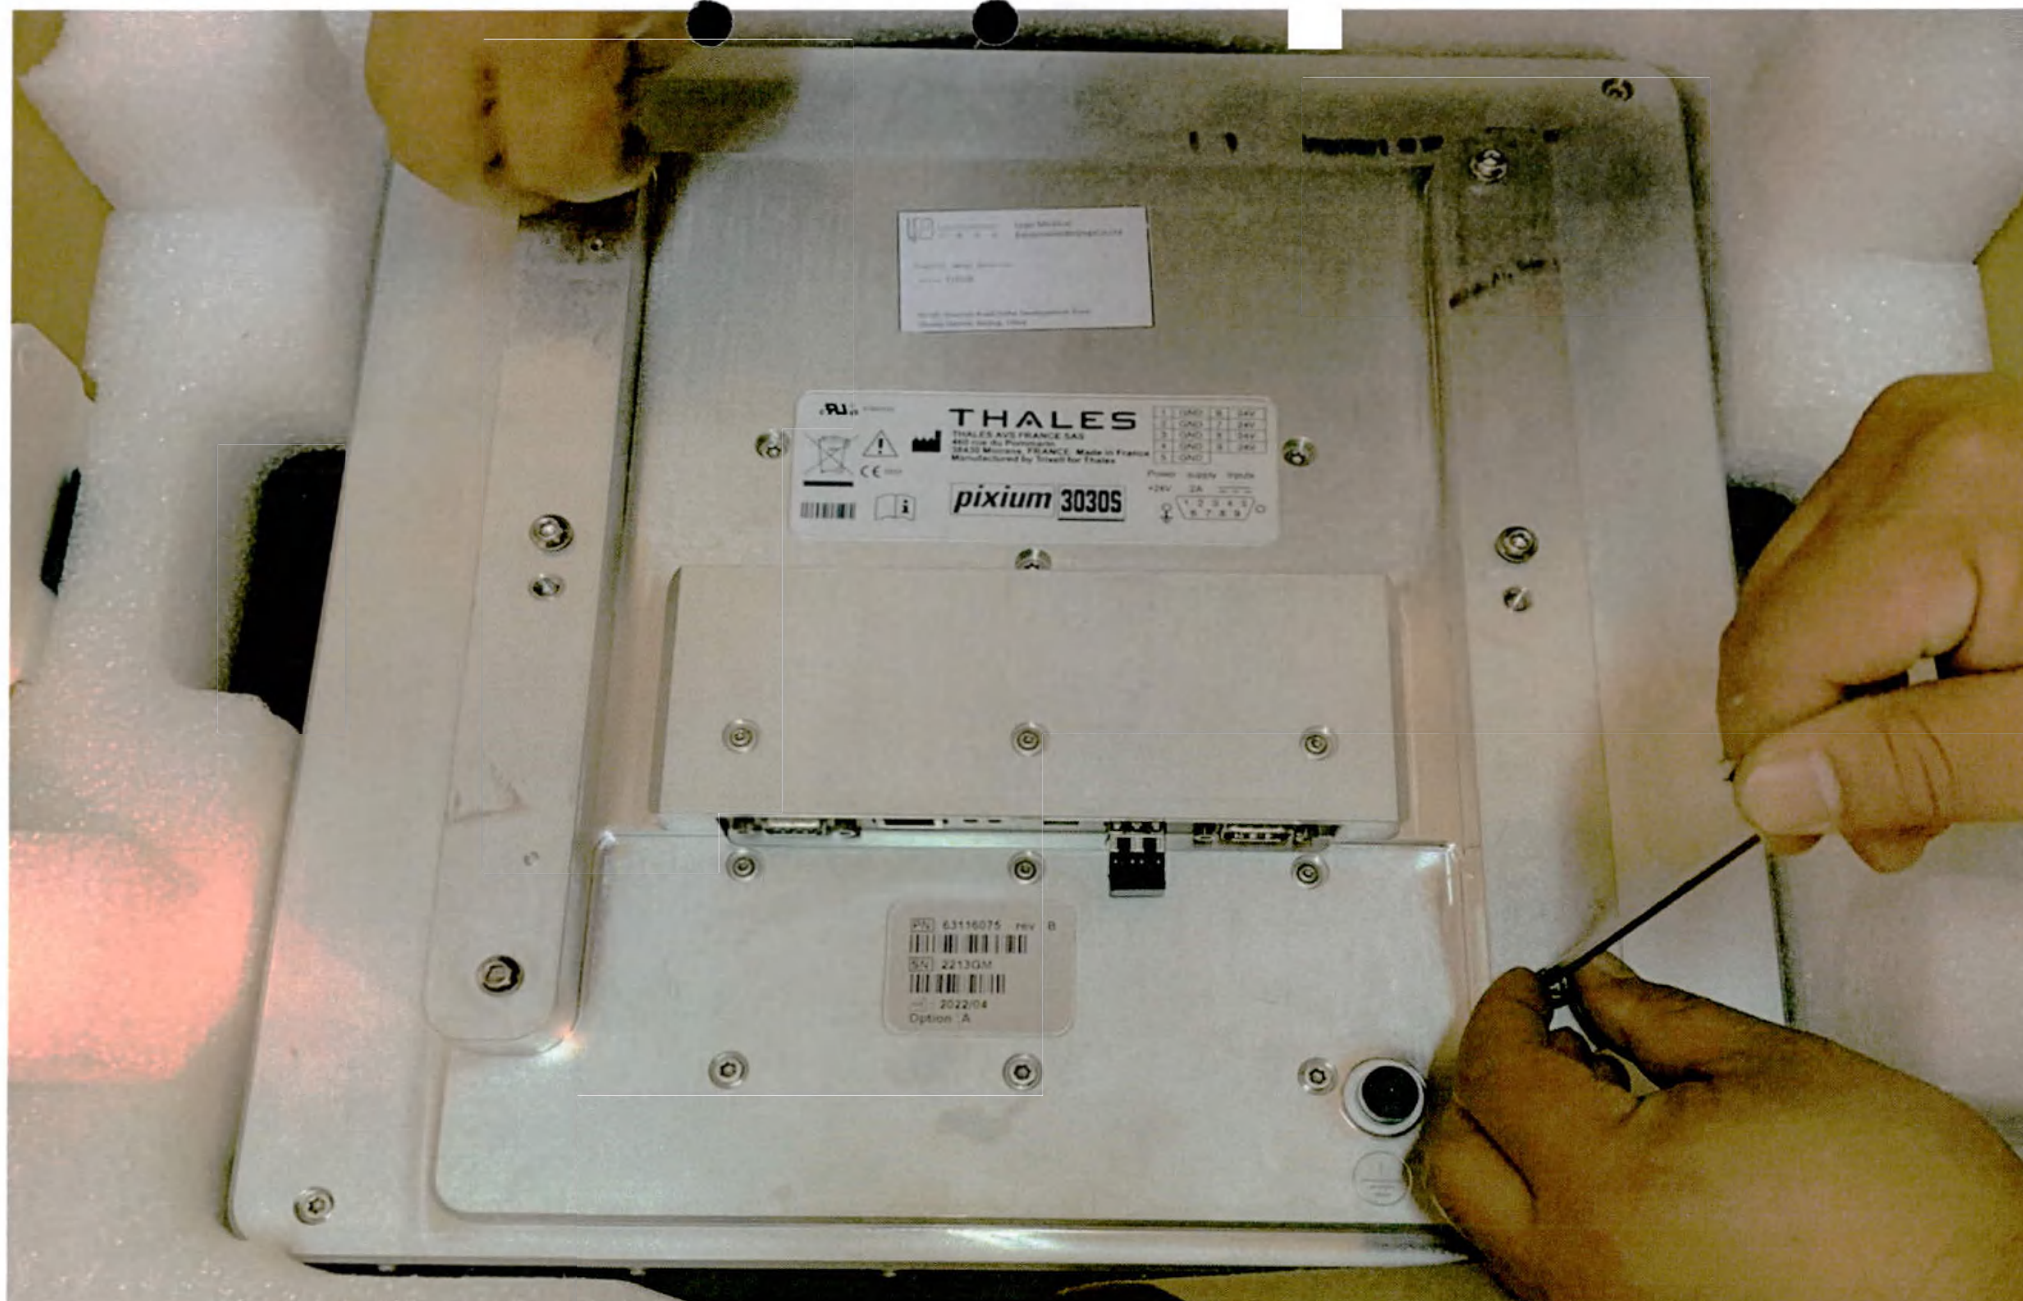


Фотография 97 – Блок датчика серии PIXIUM, Trixel (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива) и Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки

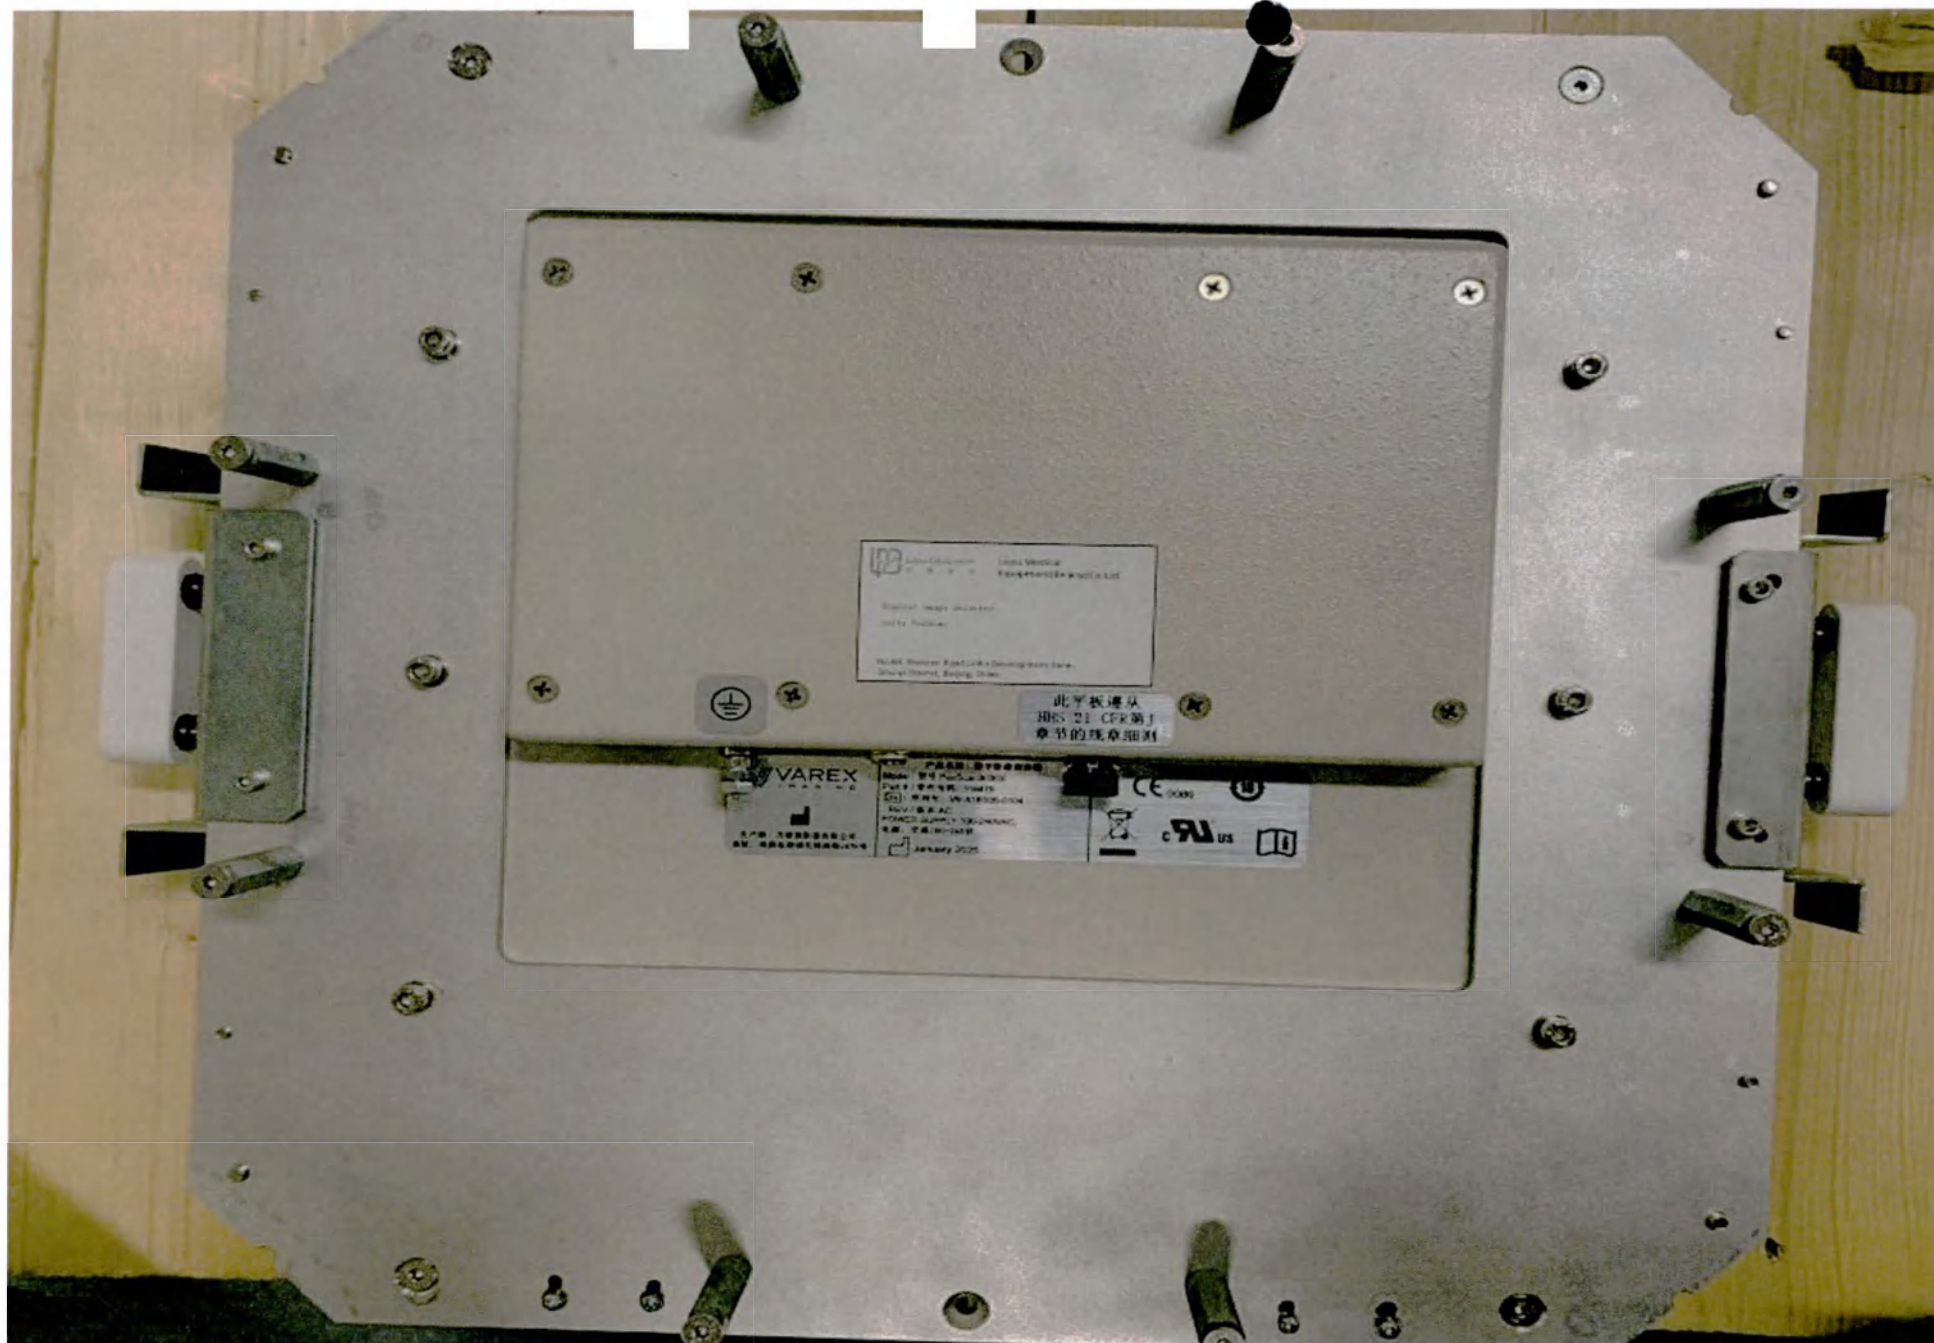


Фотография 98 – Блок датчика серии PaxScan, Varex Imaging (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

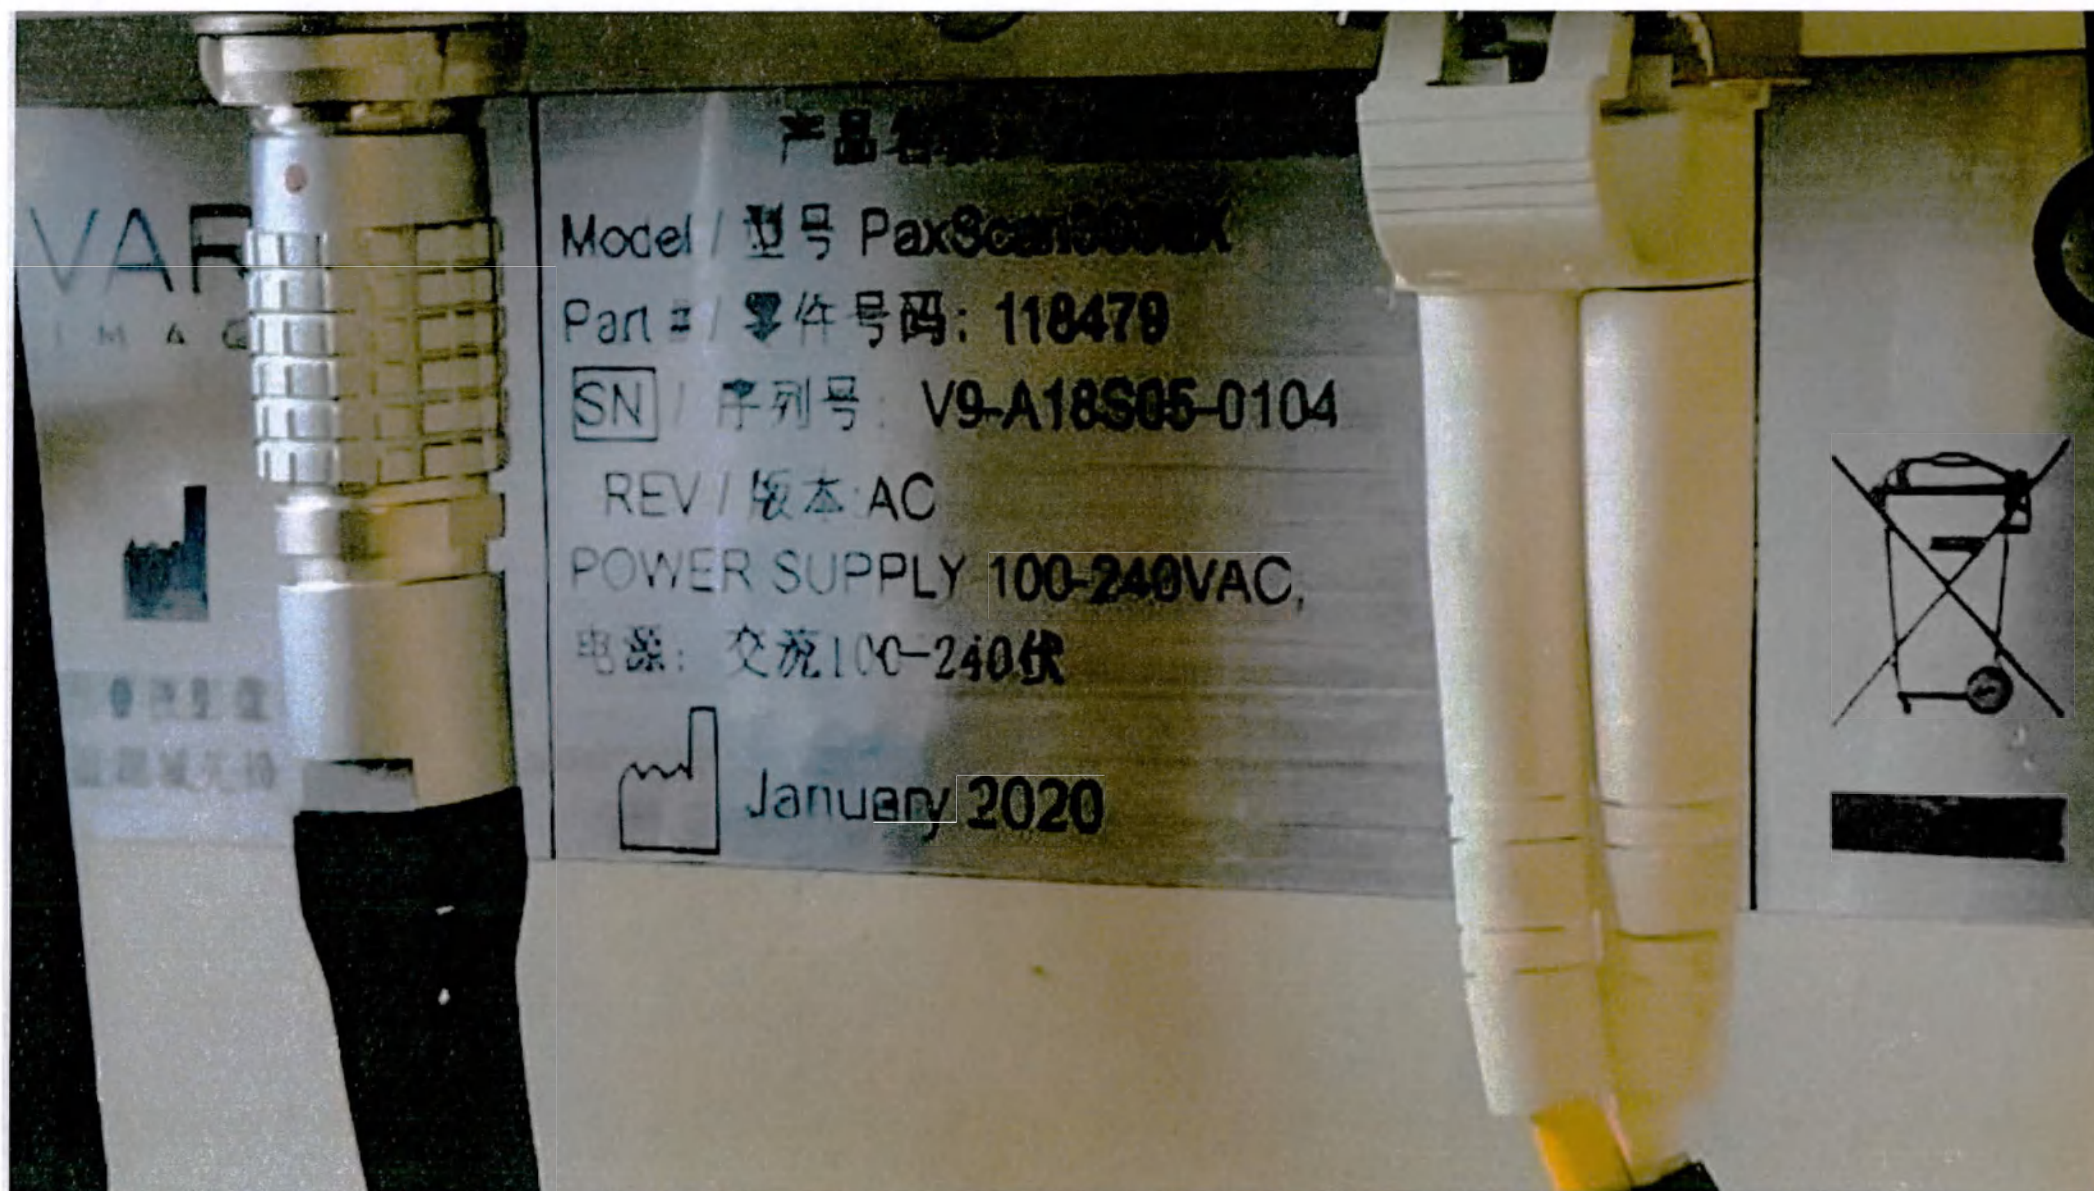

Фотография 99 – Блок датчика серии PaxScan, Varex Imaging. Образец внешнего вида варианта маркировки

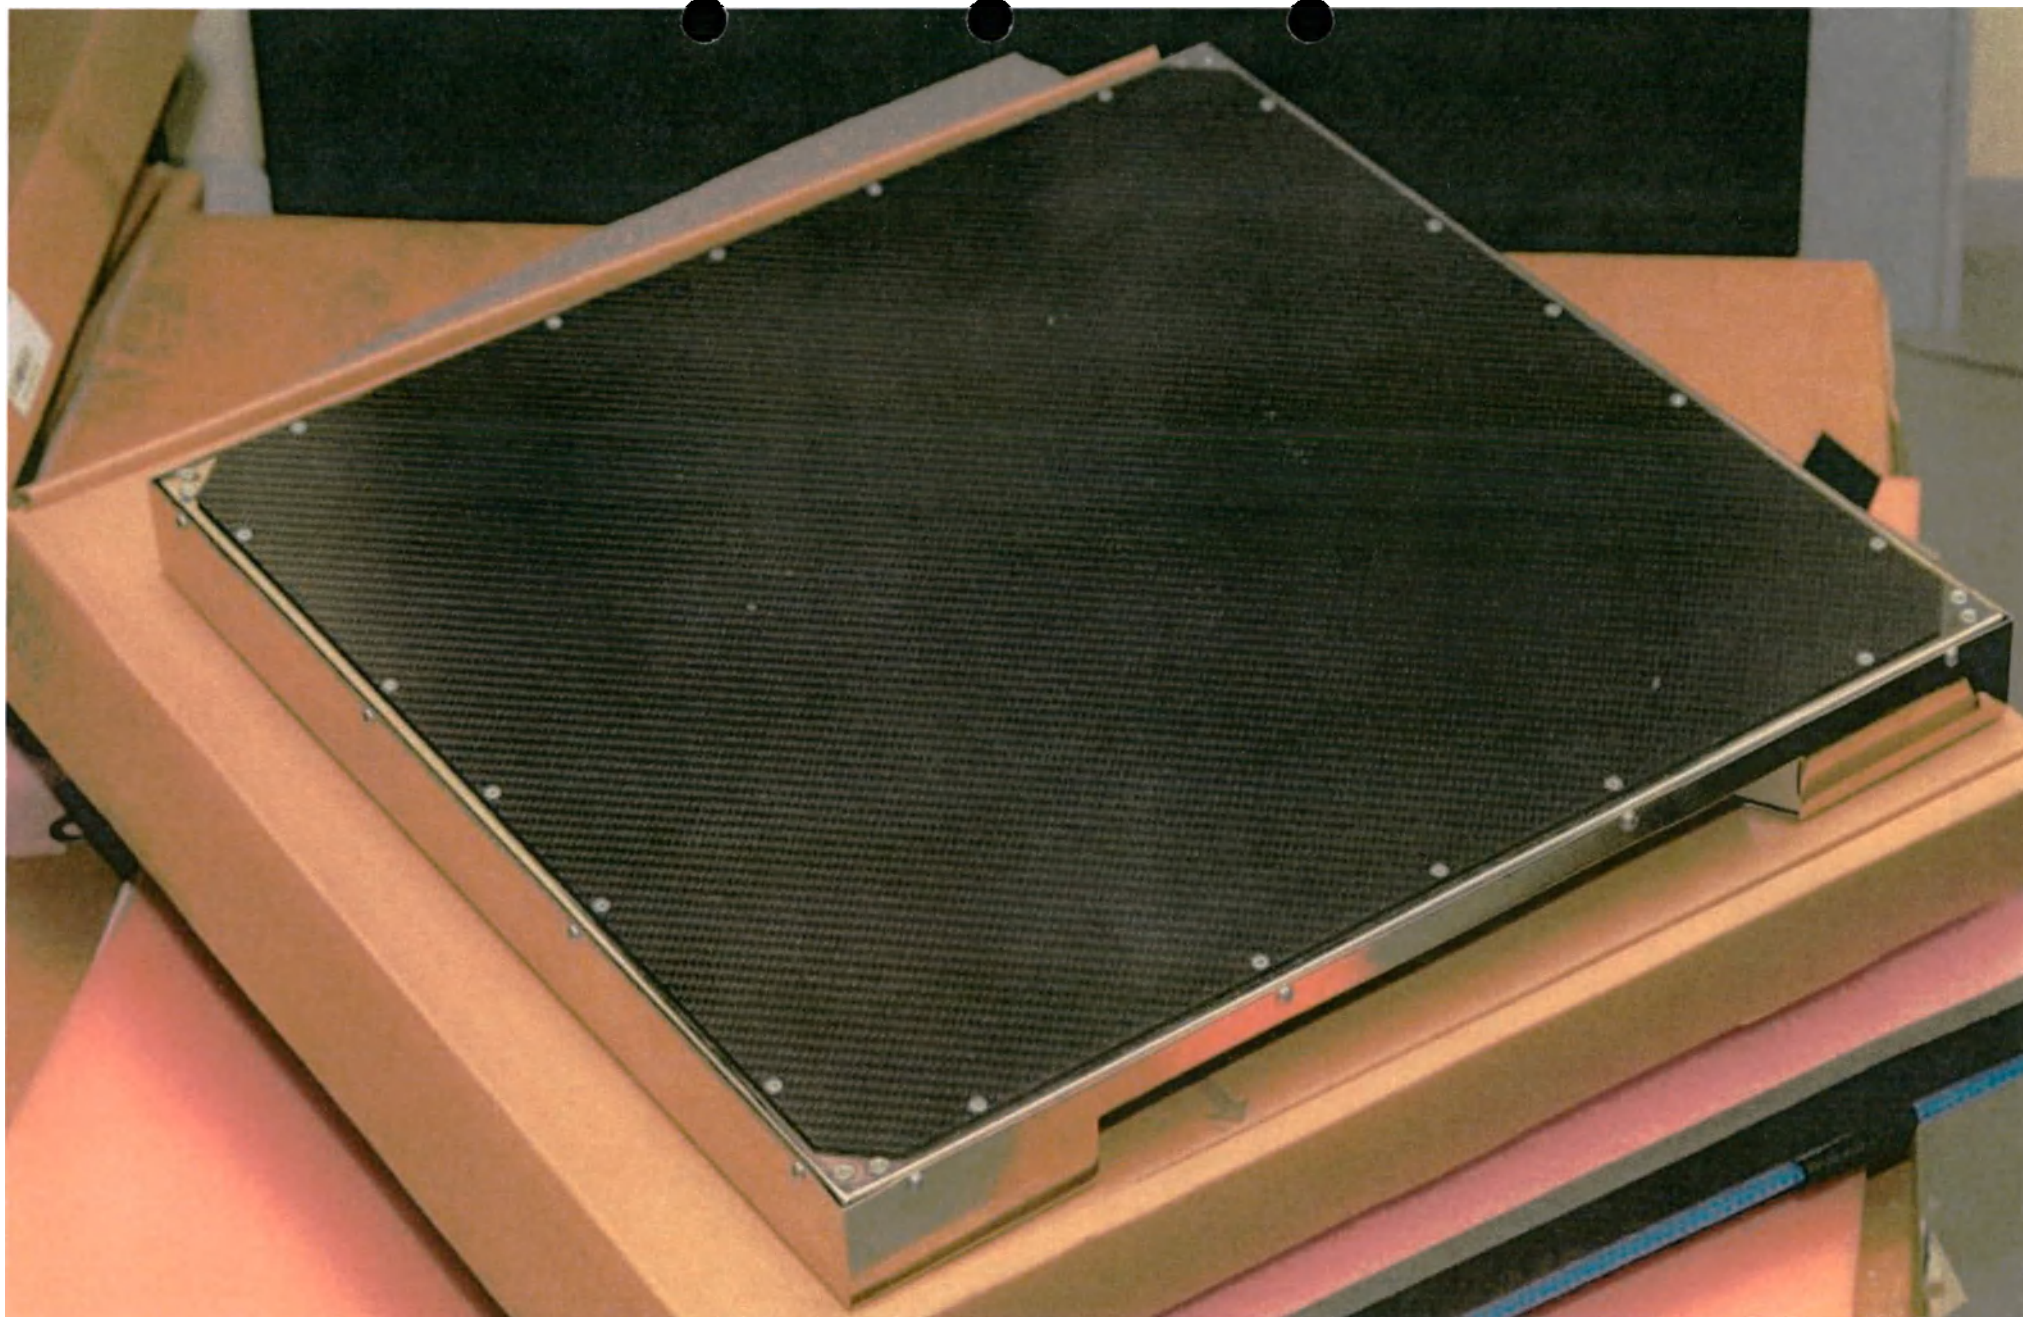

**Фотография 100 – Камера рентгеновская цифровая КРЦ по ТУ 9442-026-11 150760-2007 АО «НИПК «Электрон» (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива)
РУ № ФСР 2008/02452. Вариант внешнего вида**

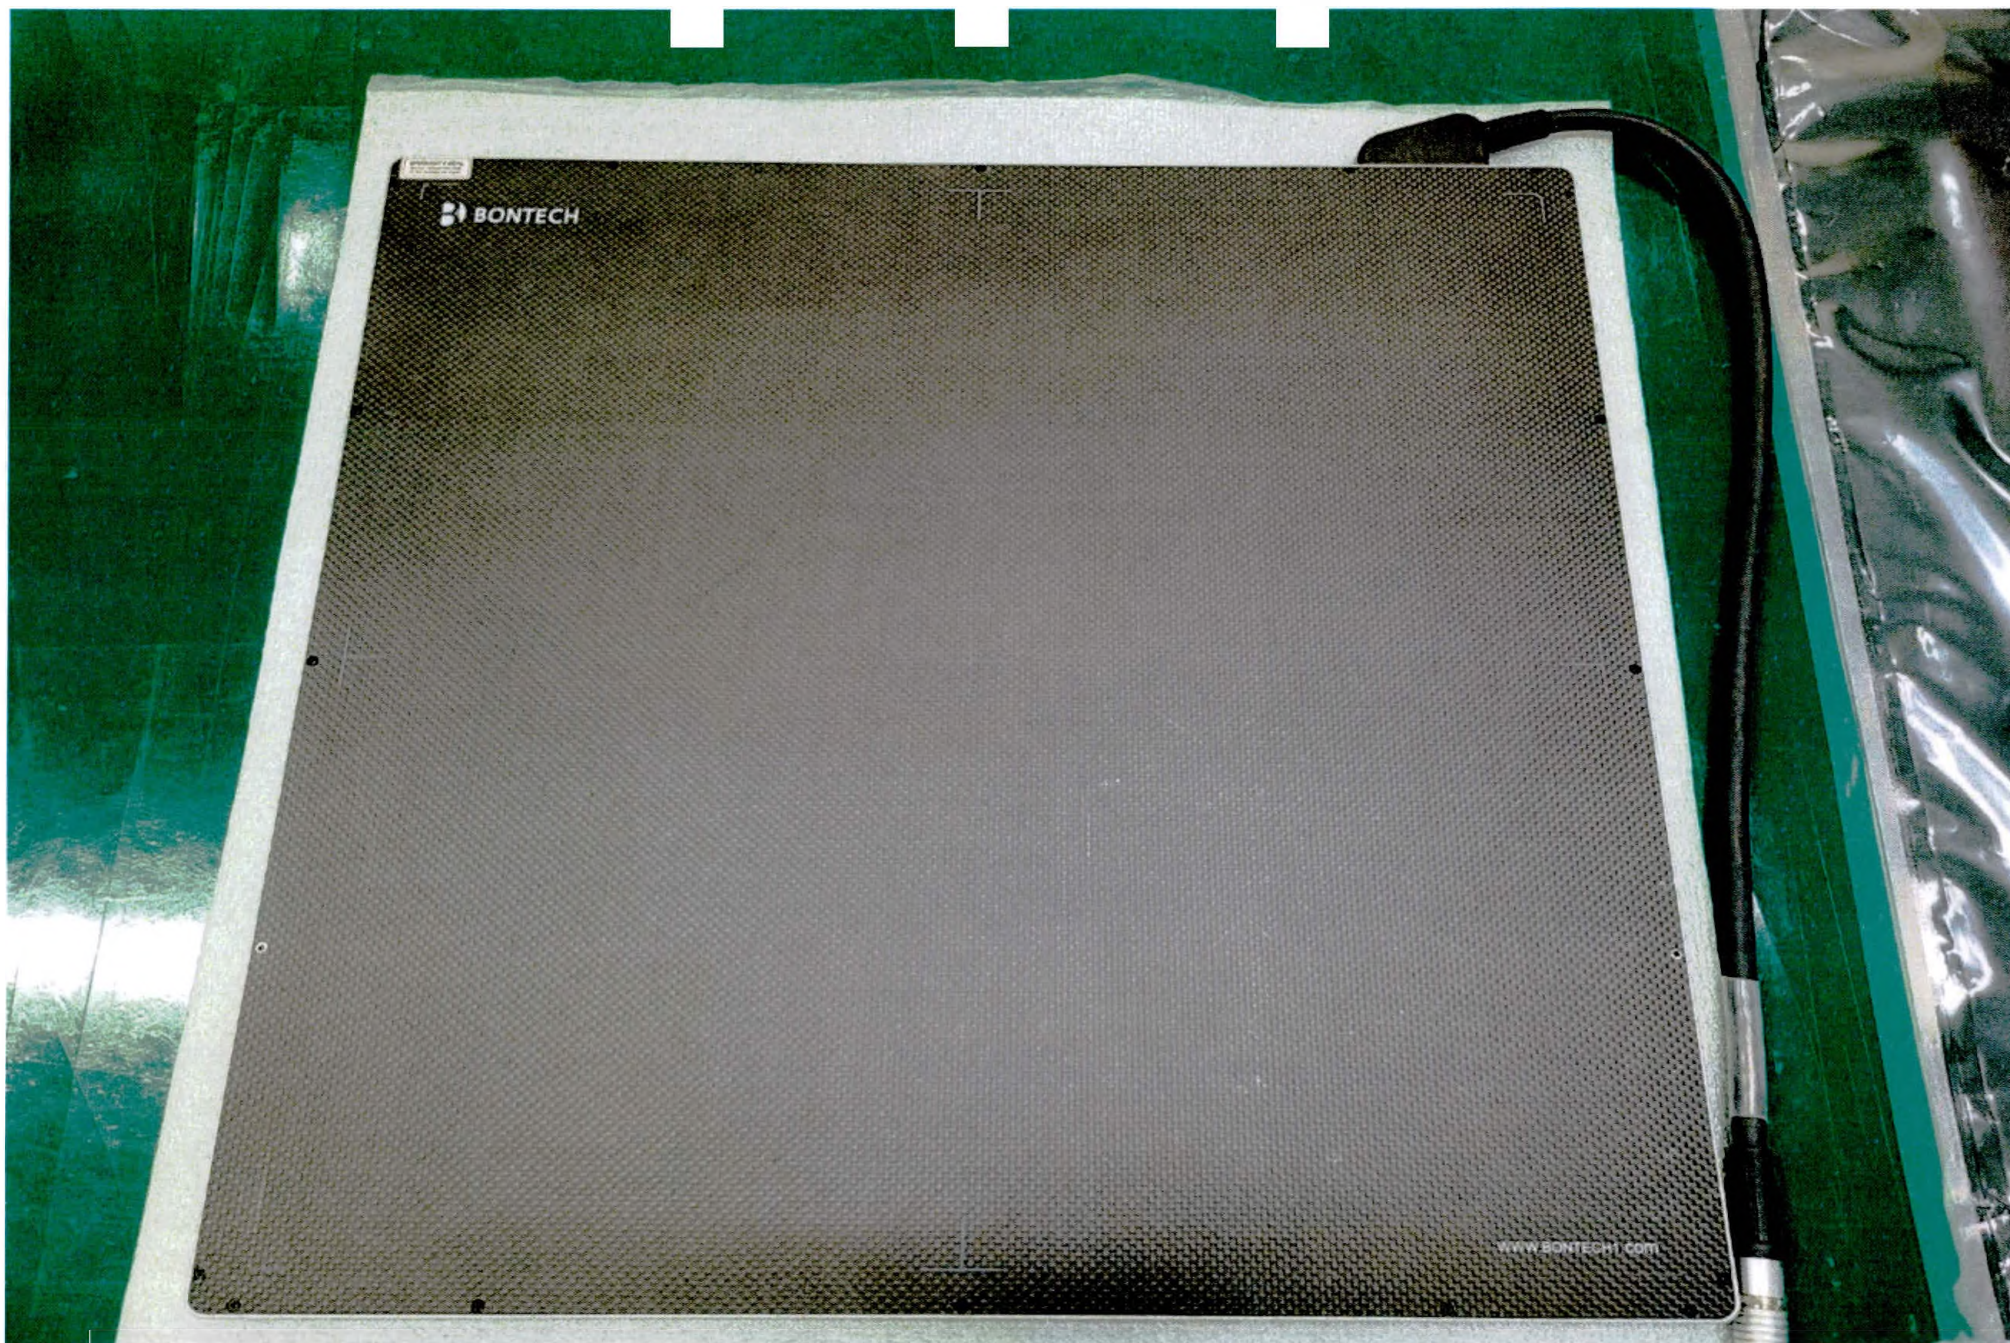

Фотография 101 – Цифровой радиографический детектор серии ВТ, BONTech Co., Ltd (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида

 BONTECH www.bontech1.com		 BONTECH Co., Ltd. Digital Empire D-Building #1201,1202,1203 16. Deogyong-daero 1556 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyunggi-do, Korea TEL : 82-31-303-5253 FAX : 82-31-303-5255	
Product Name : Flat Panel Digital X-ray Detector			
REF BT-DA24-IA		SN BT018B001	
Rating : 12V  2.5A		 2018-11-02 (M1FDS16M1GNR-5)	
CLASSIFIED  US E476455		MEDICAL EQUIPMENT  UL 60501-1, CAN/CSA C22 2 No 601.1 E476455	
"This product complies with 21 CFP. Subchapter J"		   2460   Follow Instruction For Use	
EC REP CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/Horadio Lengo N° 18. CP 29006, Malaga, Spain.		Made in Korea	
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.			

Фотография 102 – Цифровой радиографический детектор серии BT, BONTECH Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



**Фотография 103 ~ Цифровой радиографический детектор серии PIXX и серии PRUDENT, PIXXGEN Corporation (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива).
Вариант внешнего вида**

PIXXGEN

Product Name : Flat Panel Digital X-ray Detector

Model Name : PIXX1717

SN A721229F8

- Manufactured Date :
- Specification : 460 X 461 X 15mm
- Weight : 3.0Kg
- Battery : DC14.8V, 3300mAh
- Manufacturer : PIXXGEN Corporation

[!] Caution : Please refer to the manual enclosed

[*] Performance and Instruction For Use :
Please refer to the manual enclosed

! For use with Charger PIXXGEN Model PICB only

EC REP CMC Medical Device & Drugs S.L.

C/Horacio Lengo N° 18, CP 29006, Málaga, Spain

CE
1370

FC
Tested To comply with
FCC Standards



The equipment can use
regardless of FCC ID and Type No.

PIXXGEN Corporation
MADE IN KOREA

5F, SMART BAY, 123, Beolmal-ro, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do, 14056, Korea

Фотография 104 – Цифровой радиографический детектор серии PIXX, PIXXGEN Corporation. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 105 – Цифровой радиографический детектор серии DRA, ASTEL Inc. (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). Вариант внешнего вида


REF DRA-1417MC

SN D0CMEHD2001

RATING 15V $\equiv$ Max. 4.2A



Caution : For use with Power & Control box, RFA-PCON only



Apr. 2023



Made In Korea




ASTEL Inc.

26-79, Gajeongbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea, 34113

Tel. +82-42-360-2100 / Fax. +82-42-360-2113



Фотография 106 – Цифровой радиографический детектор серии DRA, ASTEL Inc. Образец внешнего вида варианта маркировки

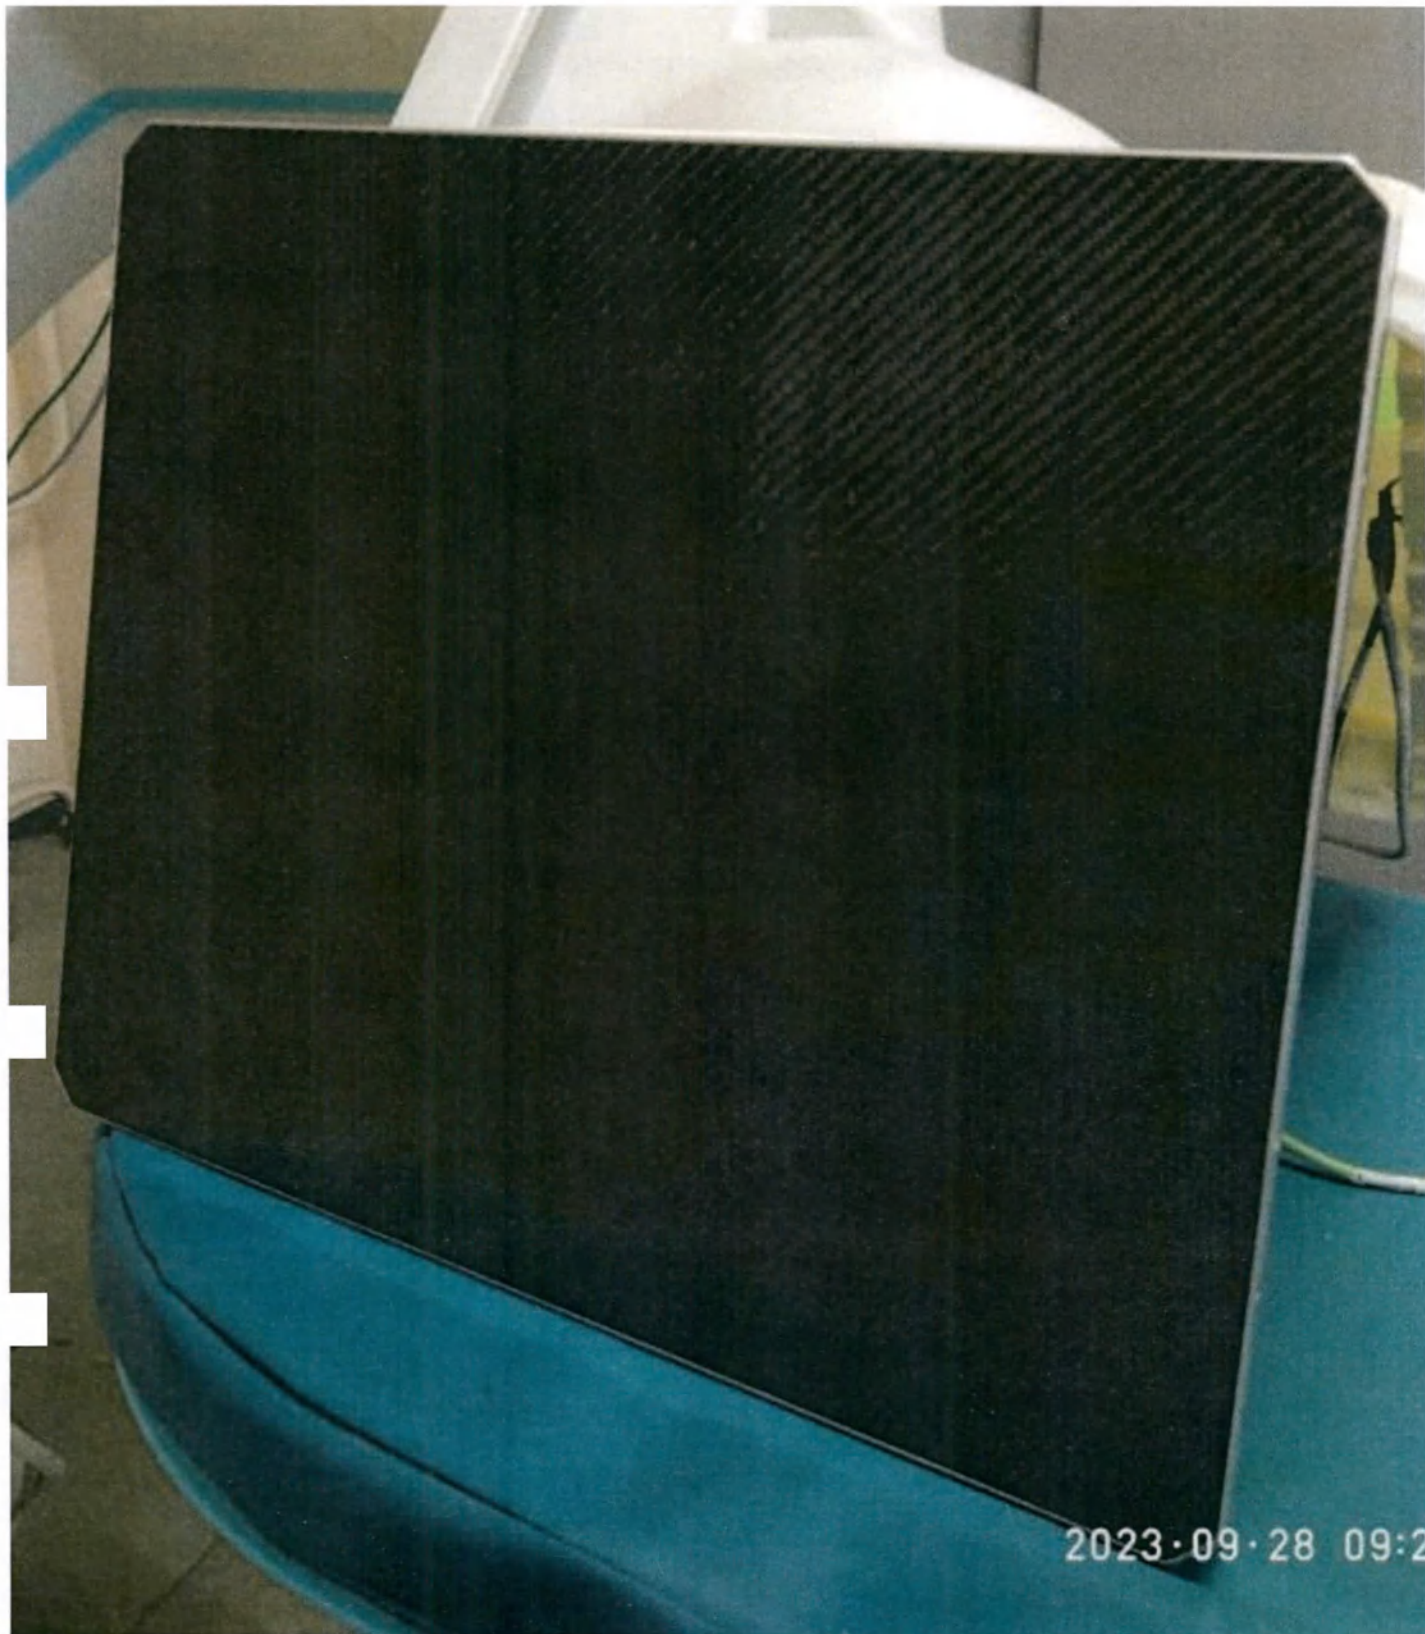

Фотография 107 – Система визуализации рентгеновских изображений СВР по ТУ 9442-039-11150760-2015, АО «НИПК «Электрон» (в условиях эксплуатации приемник закрыт кожухом штатива). РУ № РЗН 2016/5112. Вариант внешнего вида



Система визуализации
рентгеновских изображений
СВР (СВРЗ)
ВРАЕ.941211.001-05


ТУ	9442-039-11150760-2015
Серийный номер	NN0005548
Дата изготовления	2023-09

Обозначение МИ	AKR-00-0000-30:0
----------------	------------------

Серийный номер МИ	GP0006186
-------------------	-----------

Изготовитель	АО «НИПК «Электрон»
--------------	---------------------

NP 20-0600



~220 В, 50 Гц, 60 Вт



Фотография 108 – Система визуализации рентгеновских изображений СВР, АО «НИПК «Электрон» РУ № РЗН 2016/5112.
Образец внешнего вида варианта маркировки



Рентгенодиагностический
программно-аппаратный
комплекс РПАК
CWS-00-0000-02

Серийный номер
Дата изготовления

NN001566
2023-09

Обозначение МИ

AKR-00-0000-30:0

Серийный номер МИ

GP0006186

Изготовитель

АО "НИПК "Электрон"

INF-20-C200-01



~220 В, 50 Гц, 20 А



Фотография 109 – Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс РПАК. Образец внешнего вида варианта маркировки



Комплекс программно-
аппаратный ПАК
PACS-00-0000

ТУ
Серийный номер
Дата изготовления

9442-030-11150760-2009
PF1461266
2023-01

Обозначение МИ

AKR-00-0000-30:0


Серийный номер МИ

GP0006186

Изготовитель

АО «НИПК «Электрон»


ИР-20-0000



~220 В, 50 Гц, 3 кВА



Фотография 110 – Комплекс программно-аппаратный ПАК ТУ 9442-030-11150760-2009 АО «НИПК «Электрон»,
РУ № ФСР 2009/05504. Образец внешнего вида варианта маркировки

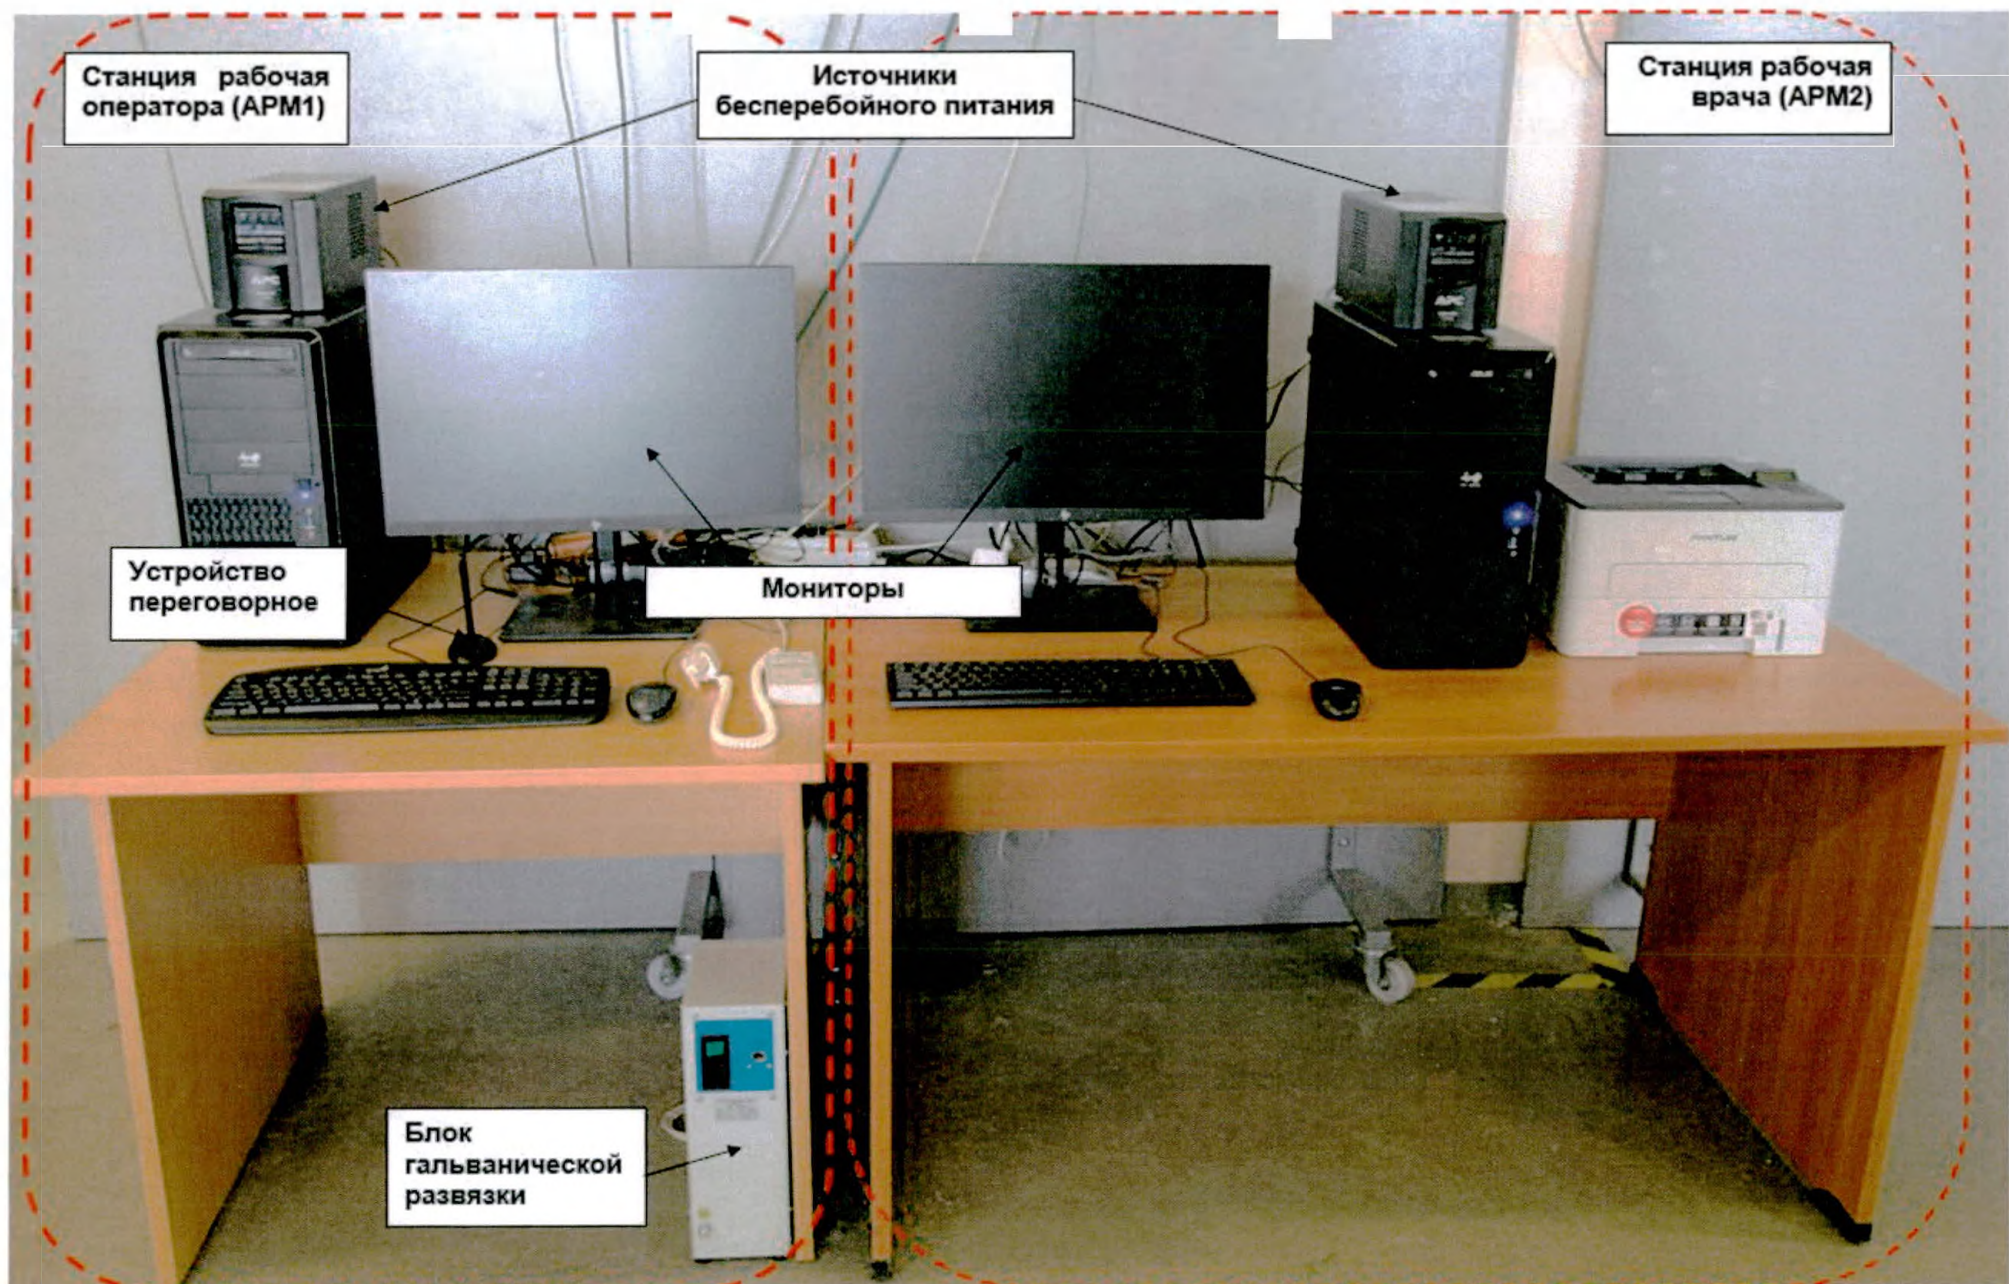

Фотография 111 – Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс (РПАК) в составе СWS по спецификации АО «НИПК «Электрон». Вариант общего внешнего вида



Фотография 112 – Станция рабочая оператора/рентген-лаборанта (АРМ1). Вариант внешнего вида.



Станция
рабочая оператора/
рентген-лаборанта (APM1)
WST1-00-5400


Серийный номер NN0006135
Дата изготовления 2023-09

Обозначение МИ AKR-00-0000-30:0

Серийный номер МИ GP0006186

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"

NP-0-C200-01



~220 В, 50 Гц, 6 А



Фотография 113 – Станция рабочая оператора / рентген - лаборанта (APM1). Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 114 – Станция рабочая оператора / рентген - лаборанта серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing). Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 115 – Станция рабочая врача (АРМ2). Вариант внешнего вида



Станция рабочая
врача-рентгенолога
(АРМ2)
WST2-00-1400

Серийный номер NN0006137
Дата изготовления 2023-09

Обозначение МИ AKR-00-0000-30:0

Серийный номер МИ GP0006186

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"


NP-20-0200-01



~220 В, 50 Гц, 6 А



Фотография 116 – Станция рабочая врача-рентгенолога (АРМ2). Образец внешнего вида варианта маркировки

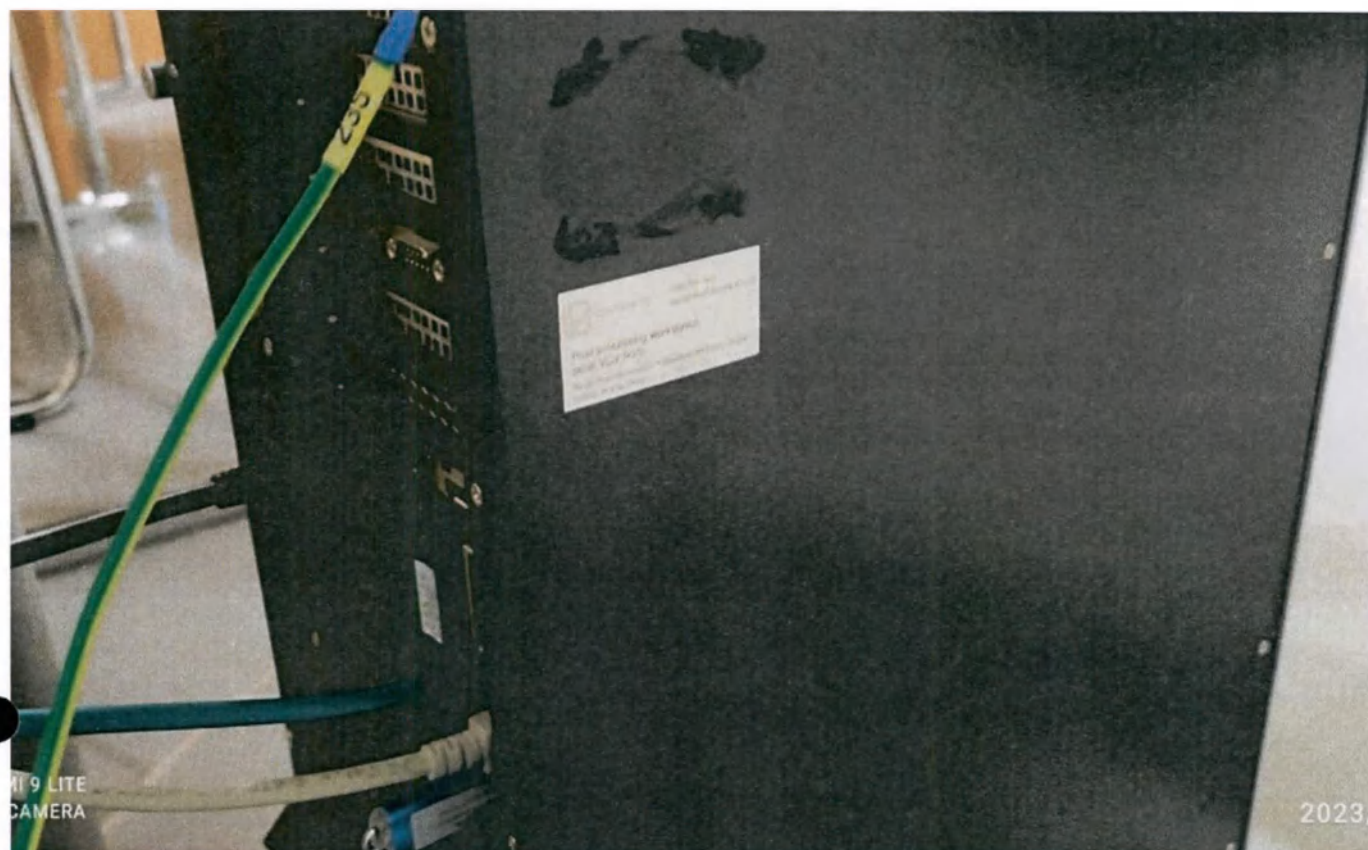

Фотография 117 – Станция рабочая врача серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing). Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 118 – Станция рабочая регистратора (АРМ3). Вариант внешнего вида

ЭЛЕКТРОН

Сервер SRV-00-1500

Серийный номер NN0005214
Дата изготовления 2023-09

Обозначение МИ AKR-00-0000-30:0

Серийный номер МИ GP0006186

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"

№ П-20-02000-01



~220 В, 50 Гц, 16 А



Фотография 119 – Сервер SVR-00-1500. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 120 – Сервер SVR-00-1500, АО НИПК «Электрон» (вариант внешнего вида)



Фотография 121 – Монитор серии CCL (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки),
JVCKENWOOD Corporation, Япония



Фотография 122 – Монитор серии IF (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки), WIDE Corporation, Республика Корея



Фотография 123 – Монитор серии NEC (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки), NEC Display Solutions, Япония, США, Китай или Sharp NEC Display Solutions, Ltd, Япония, США, Китай



Фотография 124 – Монитор серии EndoVue (вариант внешнего вида), National Display Systems Inc., США РУ № РЗН 2013/998. Вариант внешнего вида




Фотография 125 – Мониторы iiyama International Co серии Prolite, Нидерланды или Китай и Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 126 – Монитор серии RadiForce (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки) EIZO NANAO CORPORATION, РУ № РЗН 2022/17113



Фотография 127 – Монитор серии G, Shenzhen Beacon Display Technology Co. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки. РУ РЗН 2022/17702

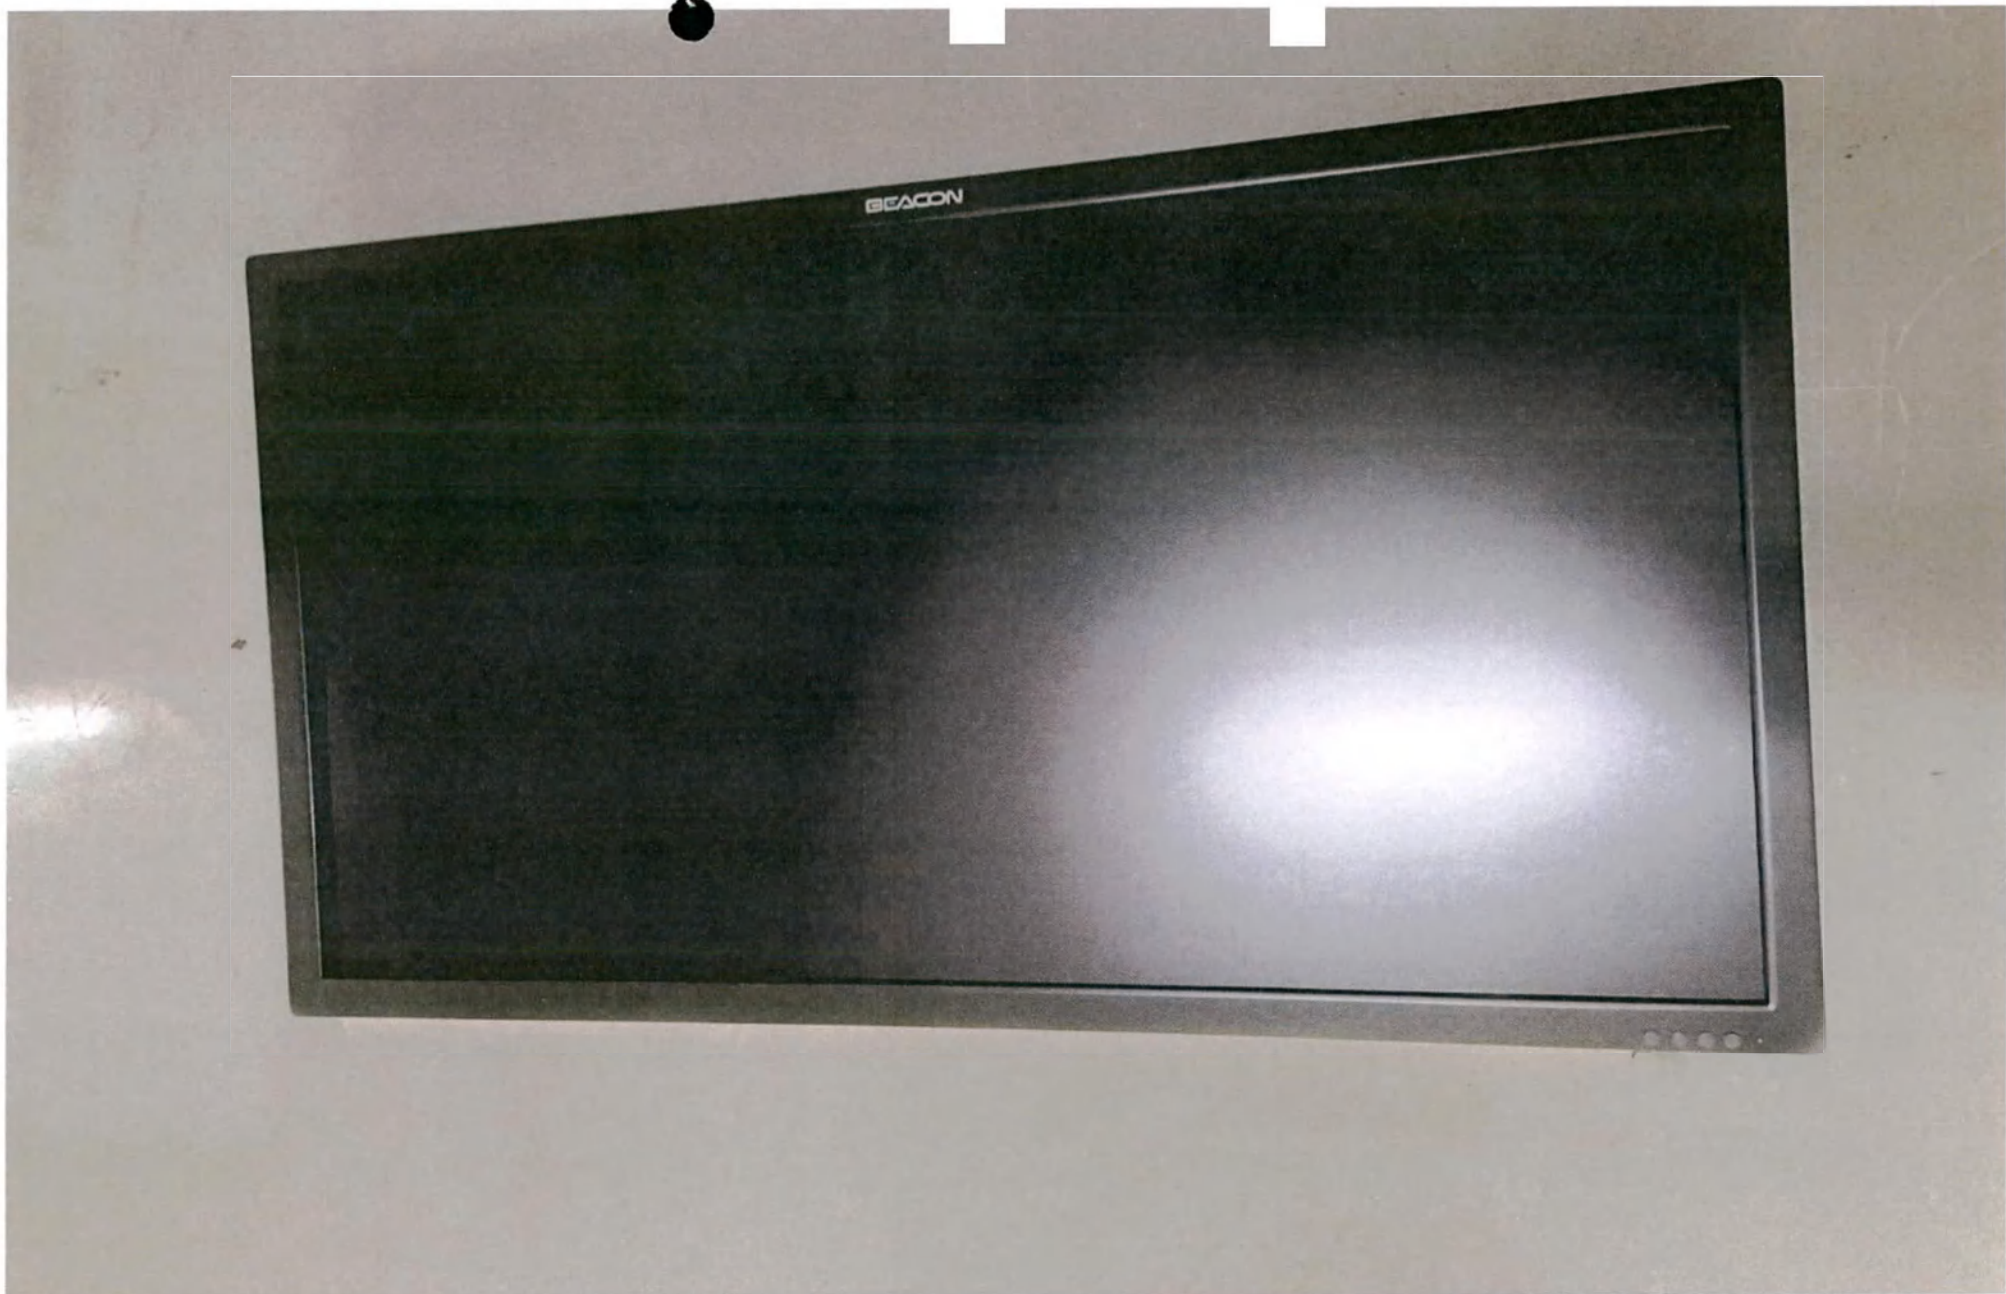


Фотография 128 – Монитор 55" Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd., ПУ РЗН 2022/17702. Вариант внешнего вида

120

LCD Monitor 液晶显示器

Model 型号: S556





SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam, Netherlands

Power Supply 电源: 100-240V~ 50/60Hz 3.5-1.5A

REF S556A01

SN A0003

 2023-08-11



RoHS



S556A23320003



制造商: 深圳市巨烽显示科技有限公司

Manufacturer: Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd.

Web: www.beacon-display.cn

中国制造 MADE IN CHINA

地址: 深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁
恒大时尚慧谷大厦(东区)6栋15层

Address: 15F, Building 6, Hengda Shishang Huigu(East),
Fulong Road, Dalang Subdistrict, Longhua,
Shenzhen, 518109, P.R. China


Фотография 129 – Монитор Монитор 55" Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd., РУ РЗН 2022/17702. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 130 – Монитор модель серии С (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки), Nanjing Jusha Display Technology Co
РУ № P3H 2020/12645



Фотография 131 – Монитор Барко серии MDRC (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки).
 РУ № РЗН 2019/9134

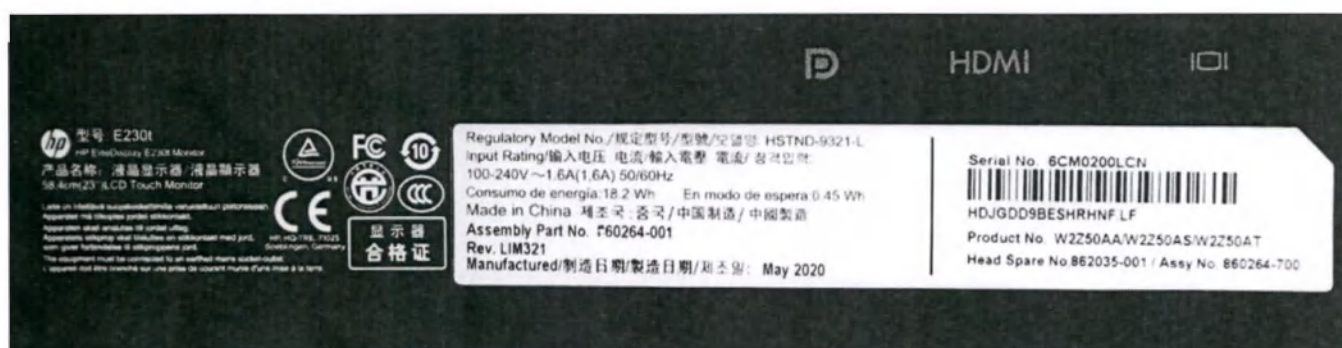

Фотография 132 – Монитор серии E (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки), производства HP Inc




Фотография 133 – Монитор серии Dell (вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки), производства Dell Inc



Фотография 134 – Мониторы модели серии GW и BL, BenQ, Китай, Тайвань. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 135 – Монитор модель серии S1 и серии B1, производства Philips. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки

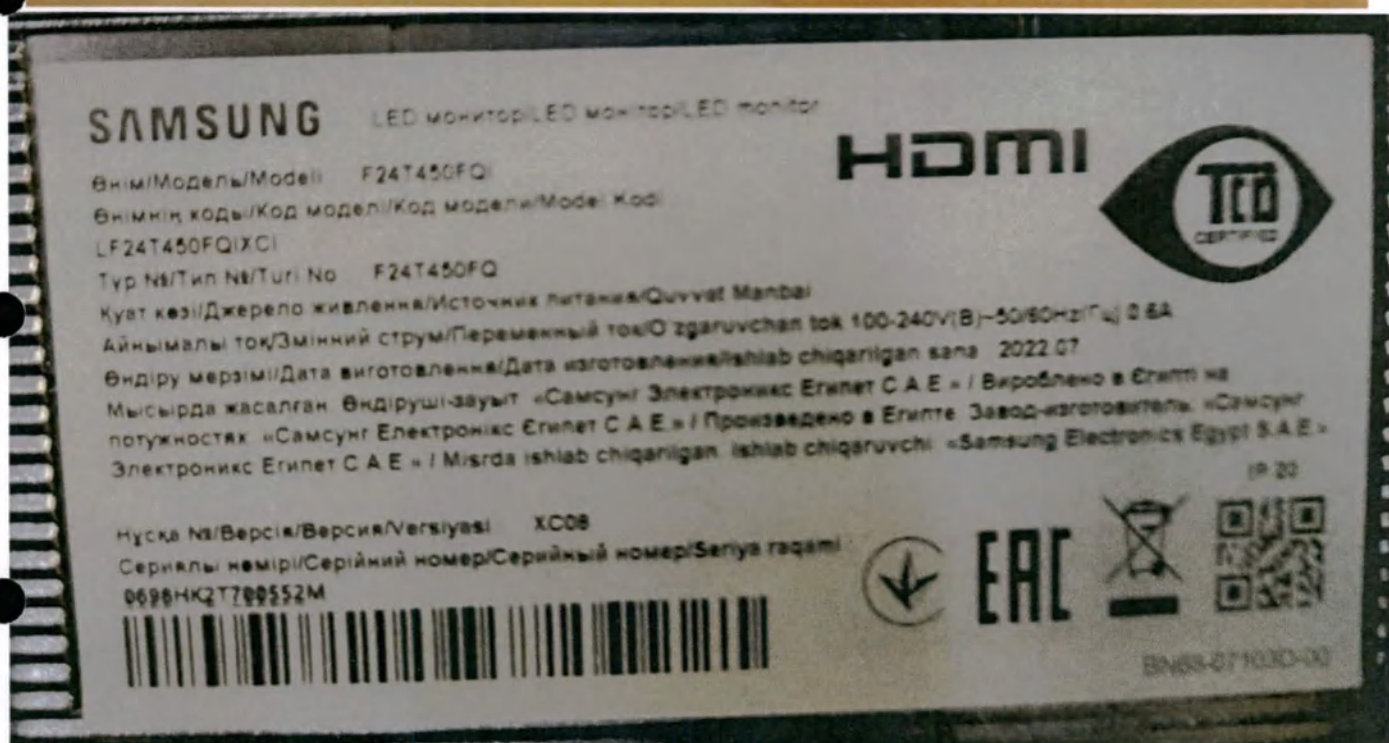

Фотография 136 – Монитор модель серии F, Samsung. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 137 – Монитор модель серии Professional X24P1, AOC. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 138 – Монитор серии VA, производства ASUS. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 139 – Монитор модель серии G, Gigabyte. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 142 – Стойка приборная. Вариант исполнения по спецификации СП-815 (вариант внешнего вида)



а) Вариант исполнения по спецификации СП-815



б) Вариант исполнения по спецификации СП-815

Фотография 143 – Стойка приборная. Вариант исполнения по спецификации СП-815 (вариант внешнего вида)



Фотография 144 – Камера медицинская термографическая мультформатная серии DRYPIX. Fujifilm Corporation, РУ № РЗН 2013/911. Вариант внешнего вида



Фотография 145 – Устройство для печати медицинских изображений, серии UP Sony Corporation РУ № ФСЗ 2007/00084. Вариант внешнего вида



Фотография 146 – Камера мультиформатная термографическая серии Drystar Agfa N.V., РУ № ФСЗ 2008/02792. Вариант внешнего вида



Фотография 147 – Камера лазерная мультиформатная серии DRYVIEW для печати медицинских изображений. Carestream Health, Inc., РУ № ФСЗ 2011/10352. Вариант внешнего вида



**Фотография 148 – Камера лазерная мультиматная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями Konica Minolta, Inc.,
РУ № РЗН 2012/12920. Вариант внешнего вида**




Фотография 149 – Источник бесперебойного питания APC (в составе АРМ). Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки




EATON			EAC	CE	
Catalog Nb: 5E850iUSB MFG ID: 9C00-53219 Rev:F0P S/N: P463M41514	INPUT: 220-240V~50/60Hz 5.6A Ph+N+PE				
	OUTPUT: 220V-240V~50/60Hz 3.8A Ph+N+PE				
CE compliance contact: Eaton I.F. SAS- 110 rue Blaise Pascal 38330 Montbonnot St Martin- France	850VA/480W Protective Class I Icc:3KA Made in Philippines				


Фотография 150 – Источник бесперебойного питания Eaton (в составе АРМ). Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки

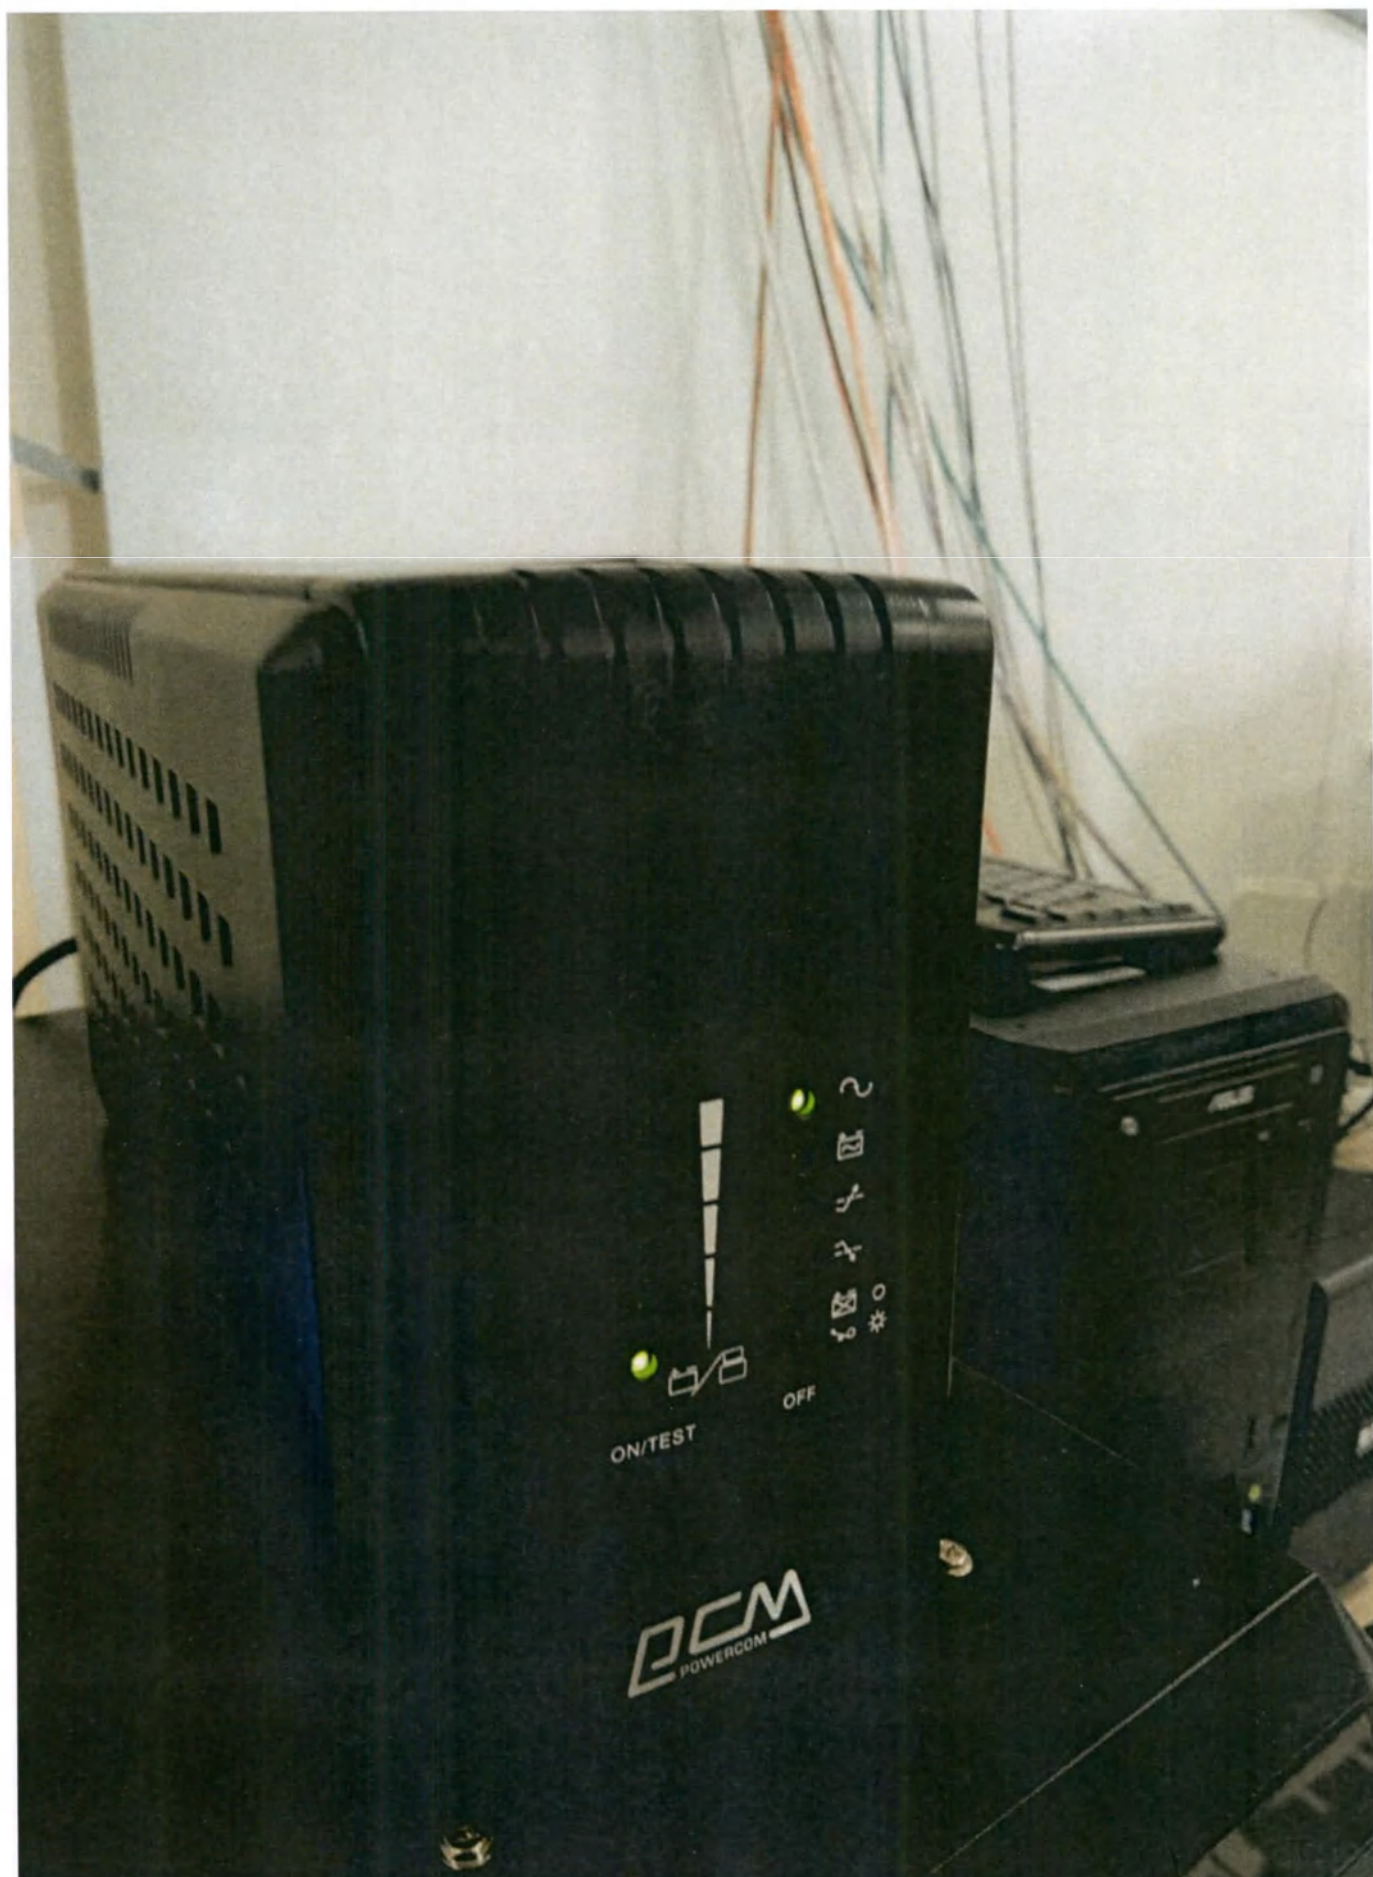

Фотография 151 – Источник бесперебойного питания (в составе АРМ) серии SPT, POWERCOM CO., Ltd Тайвань.
Вариант внешнего вида

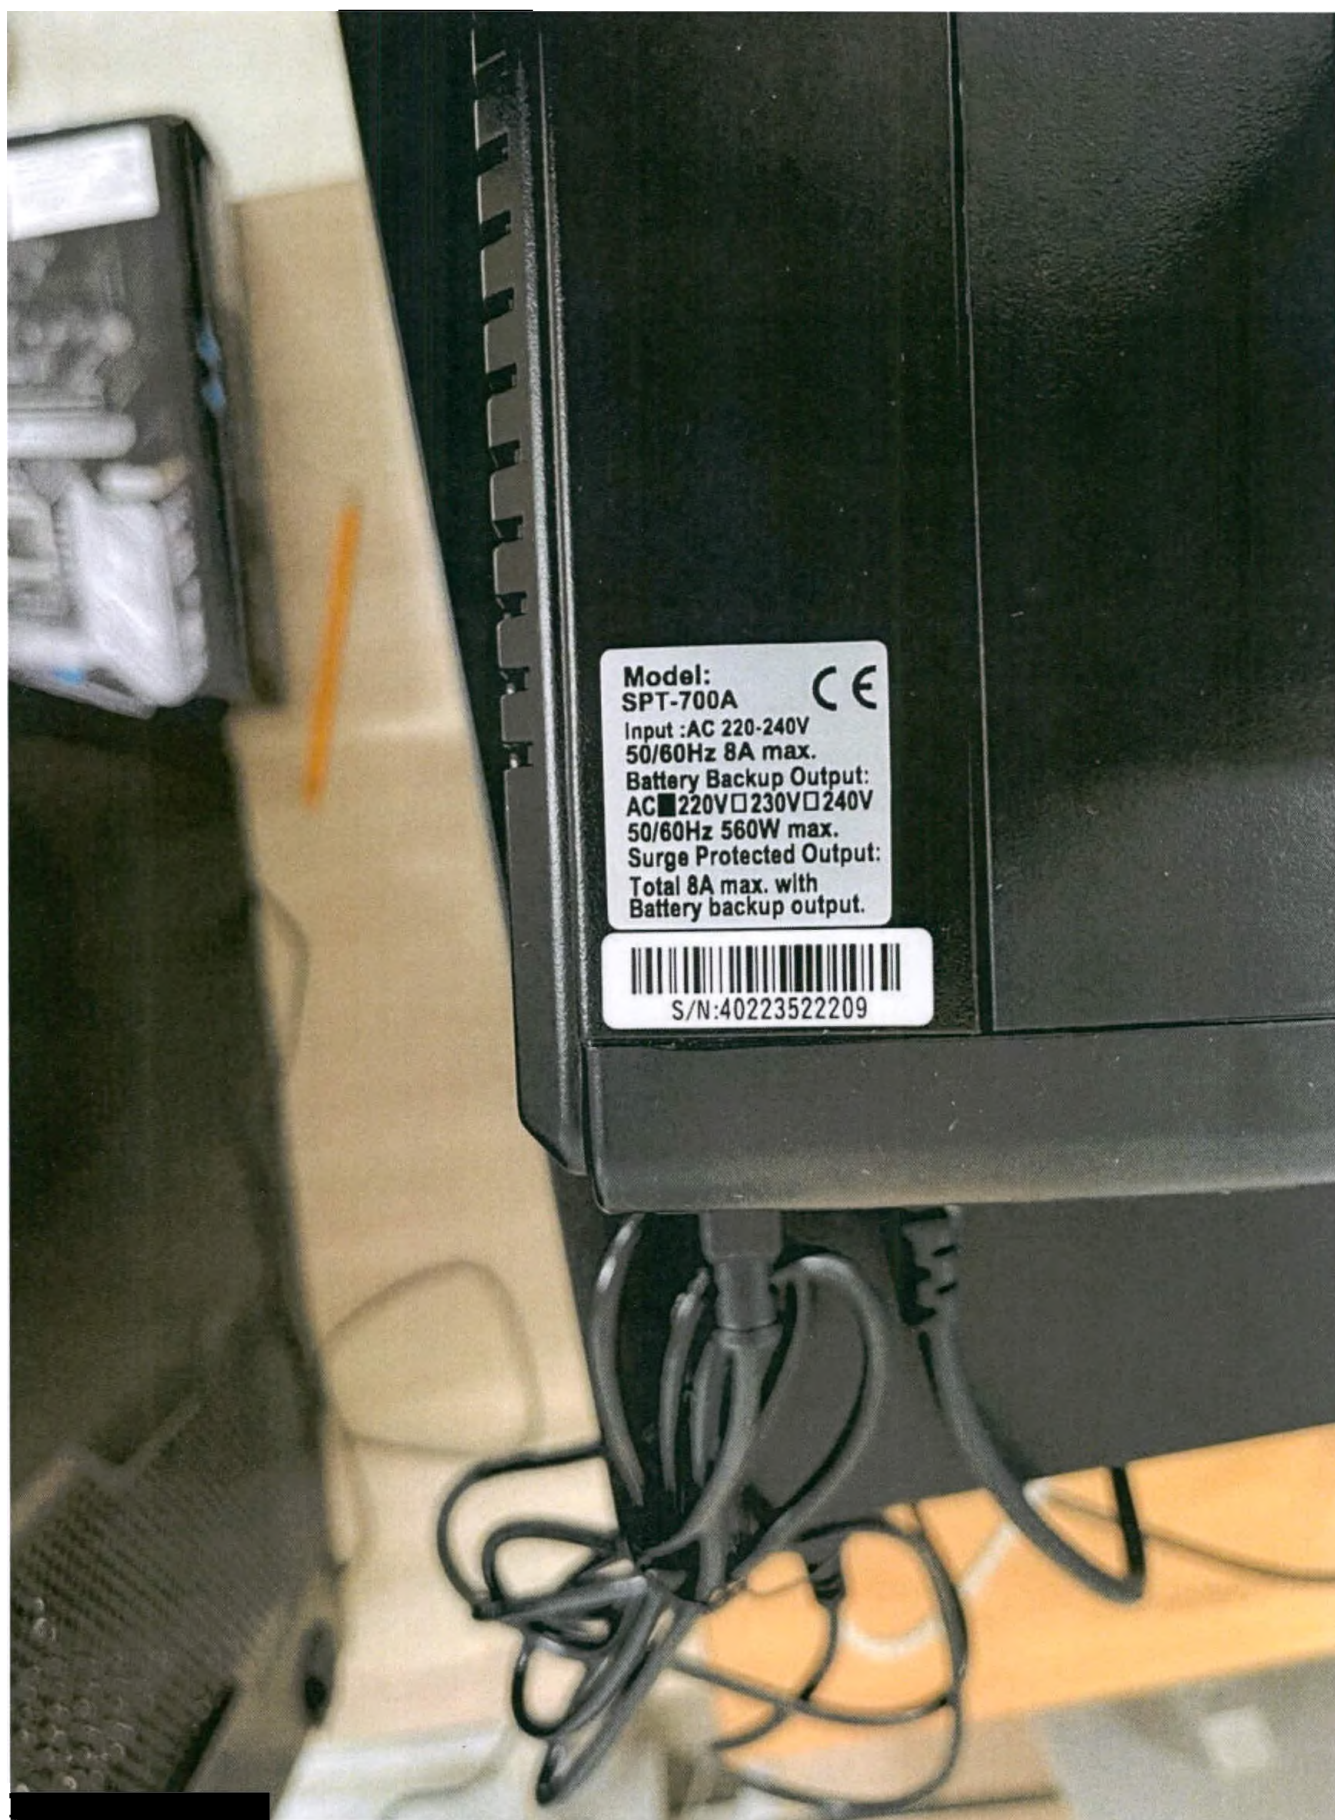


Фотография 152 – Источник бесперебойного питания (в составе АРМ) серии SPT, POWERCOM CO., Образец внешнего вида варианта маркировки

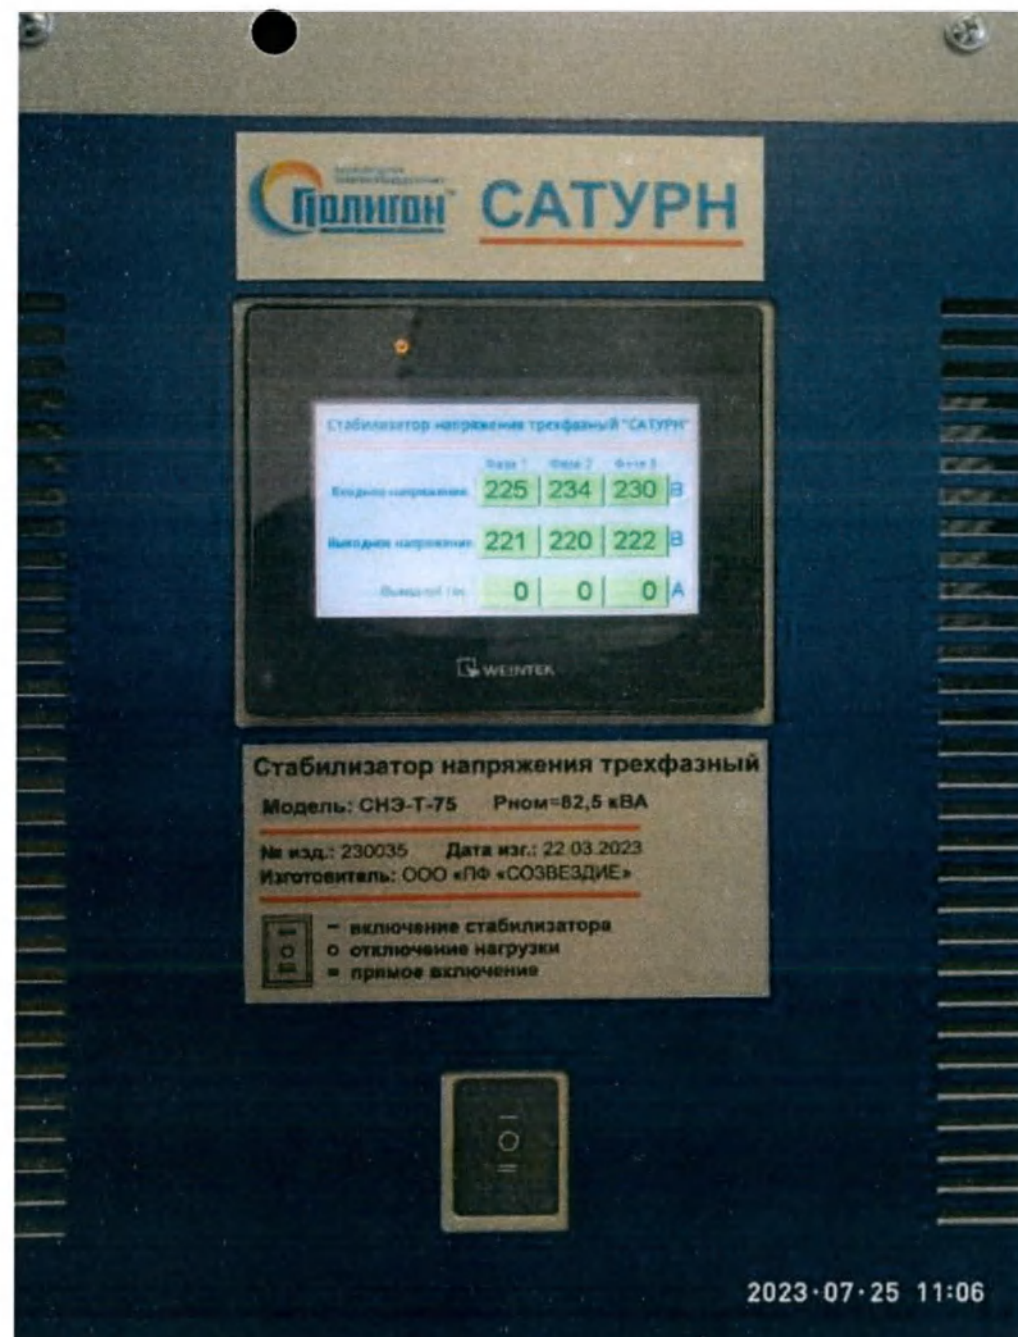


Фотография 153 – Стабилизатор серии СНЭ (вариант внешнего вида) в составе спецификации АРМ WST1-00, АО «НИПК «Электрон»



Фотография 154 – Стабилизатор серии АСН (вариант внешнего вида) в составе спецификации АРМ WST1-00, АО «НИПК «Электрон»

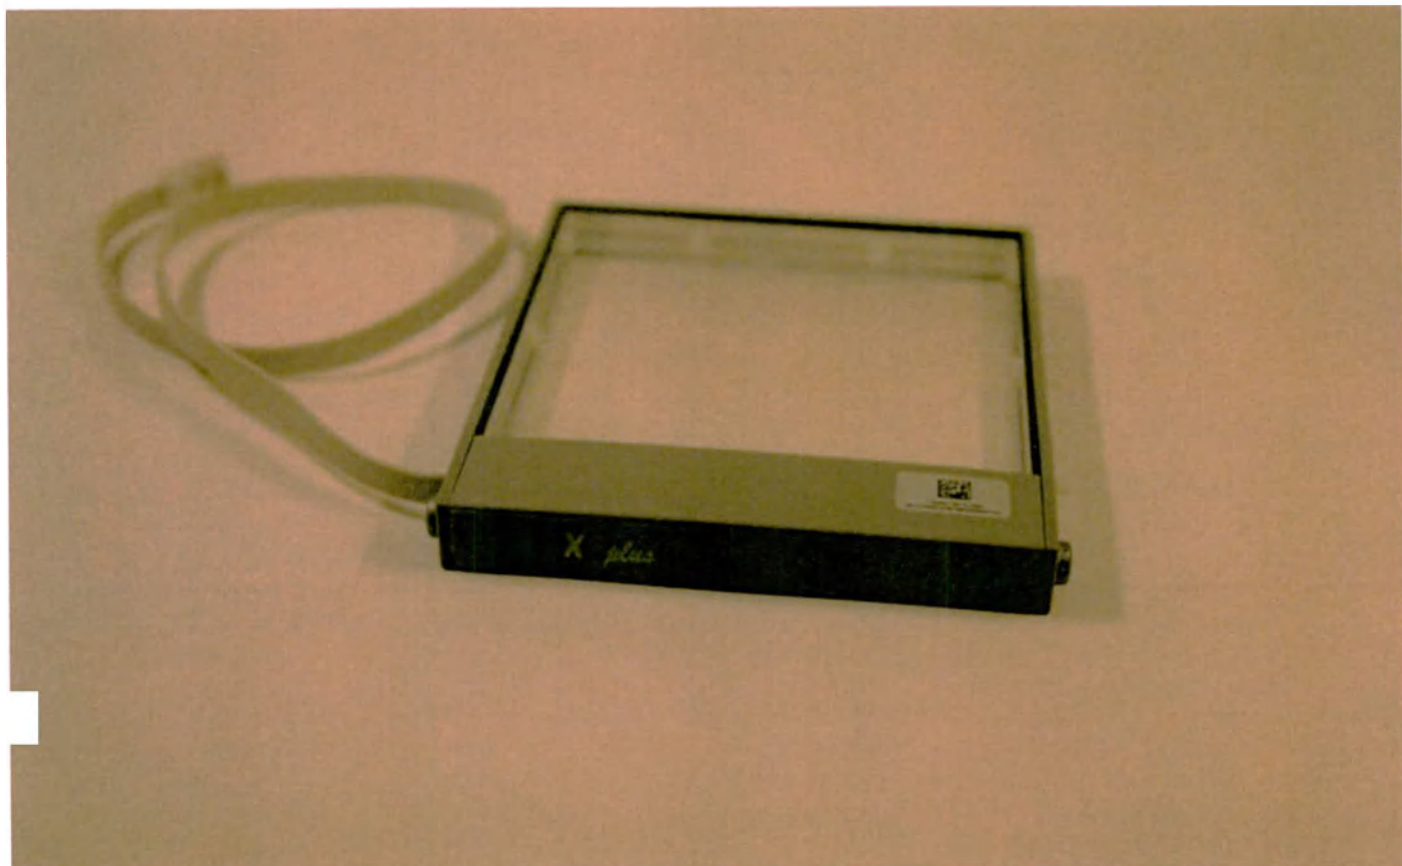


Фотография 155 – Дозиметр серии KermaX, IBA Dosimetry GmbH. Вариант внешнего вида

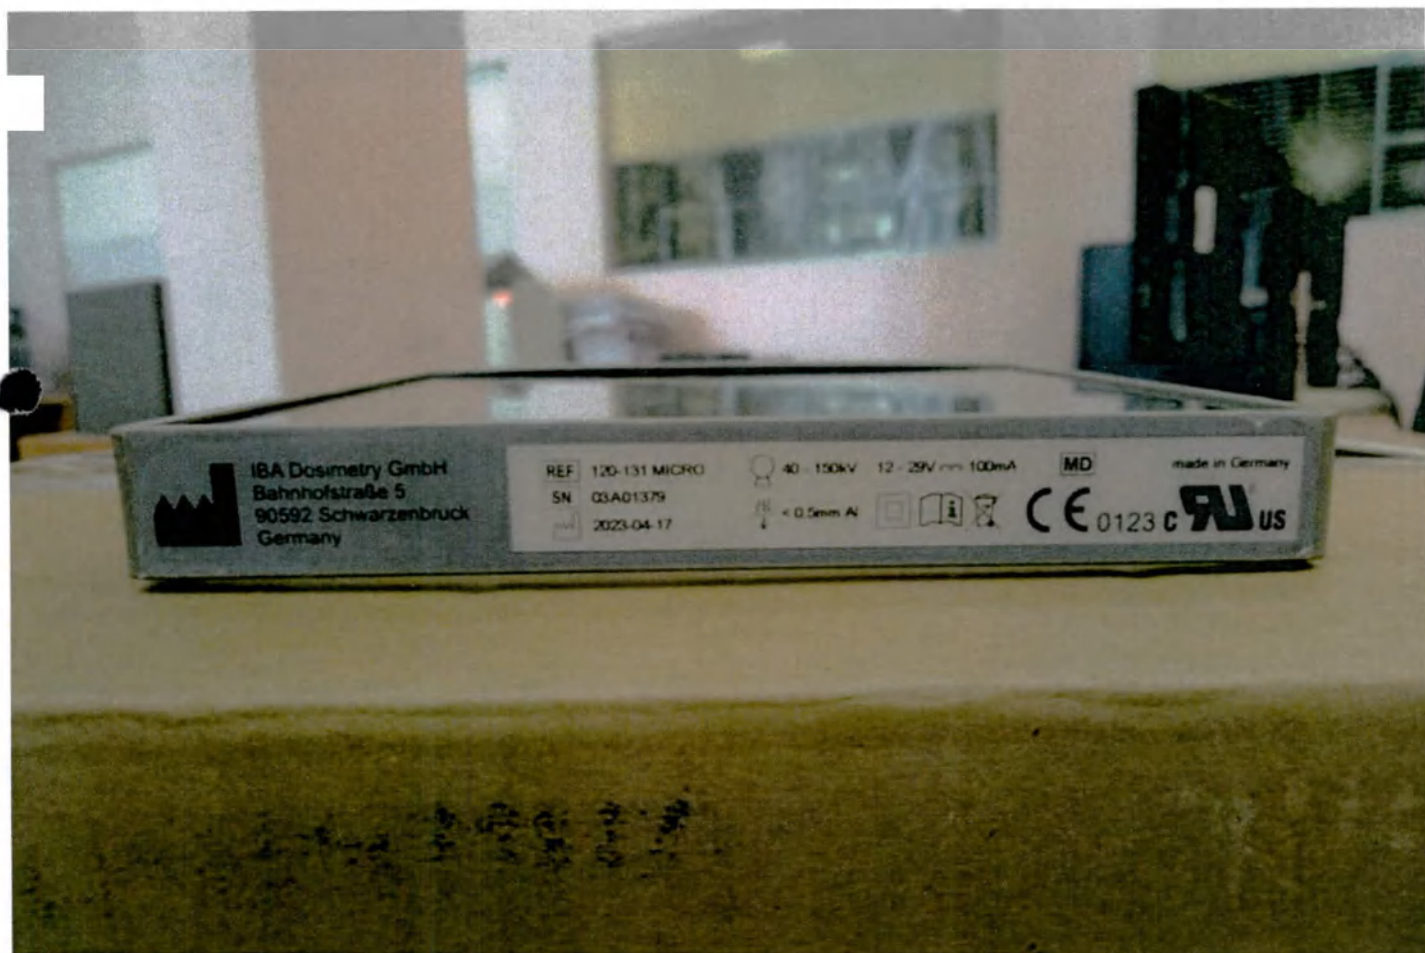

Фотография 156 – Дозиметр серии MICRO IBA Dosimetry GmbH. Вариант внешнего вида и образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 157 – Дозиметр ДРК-1 с упаковкой и документацией. Вариант внешнего вида

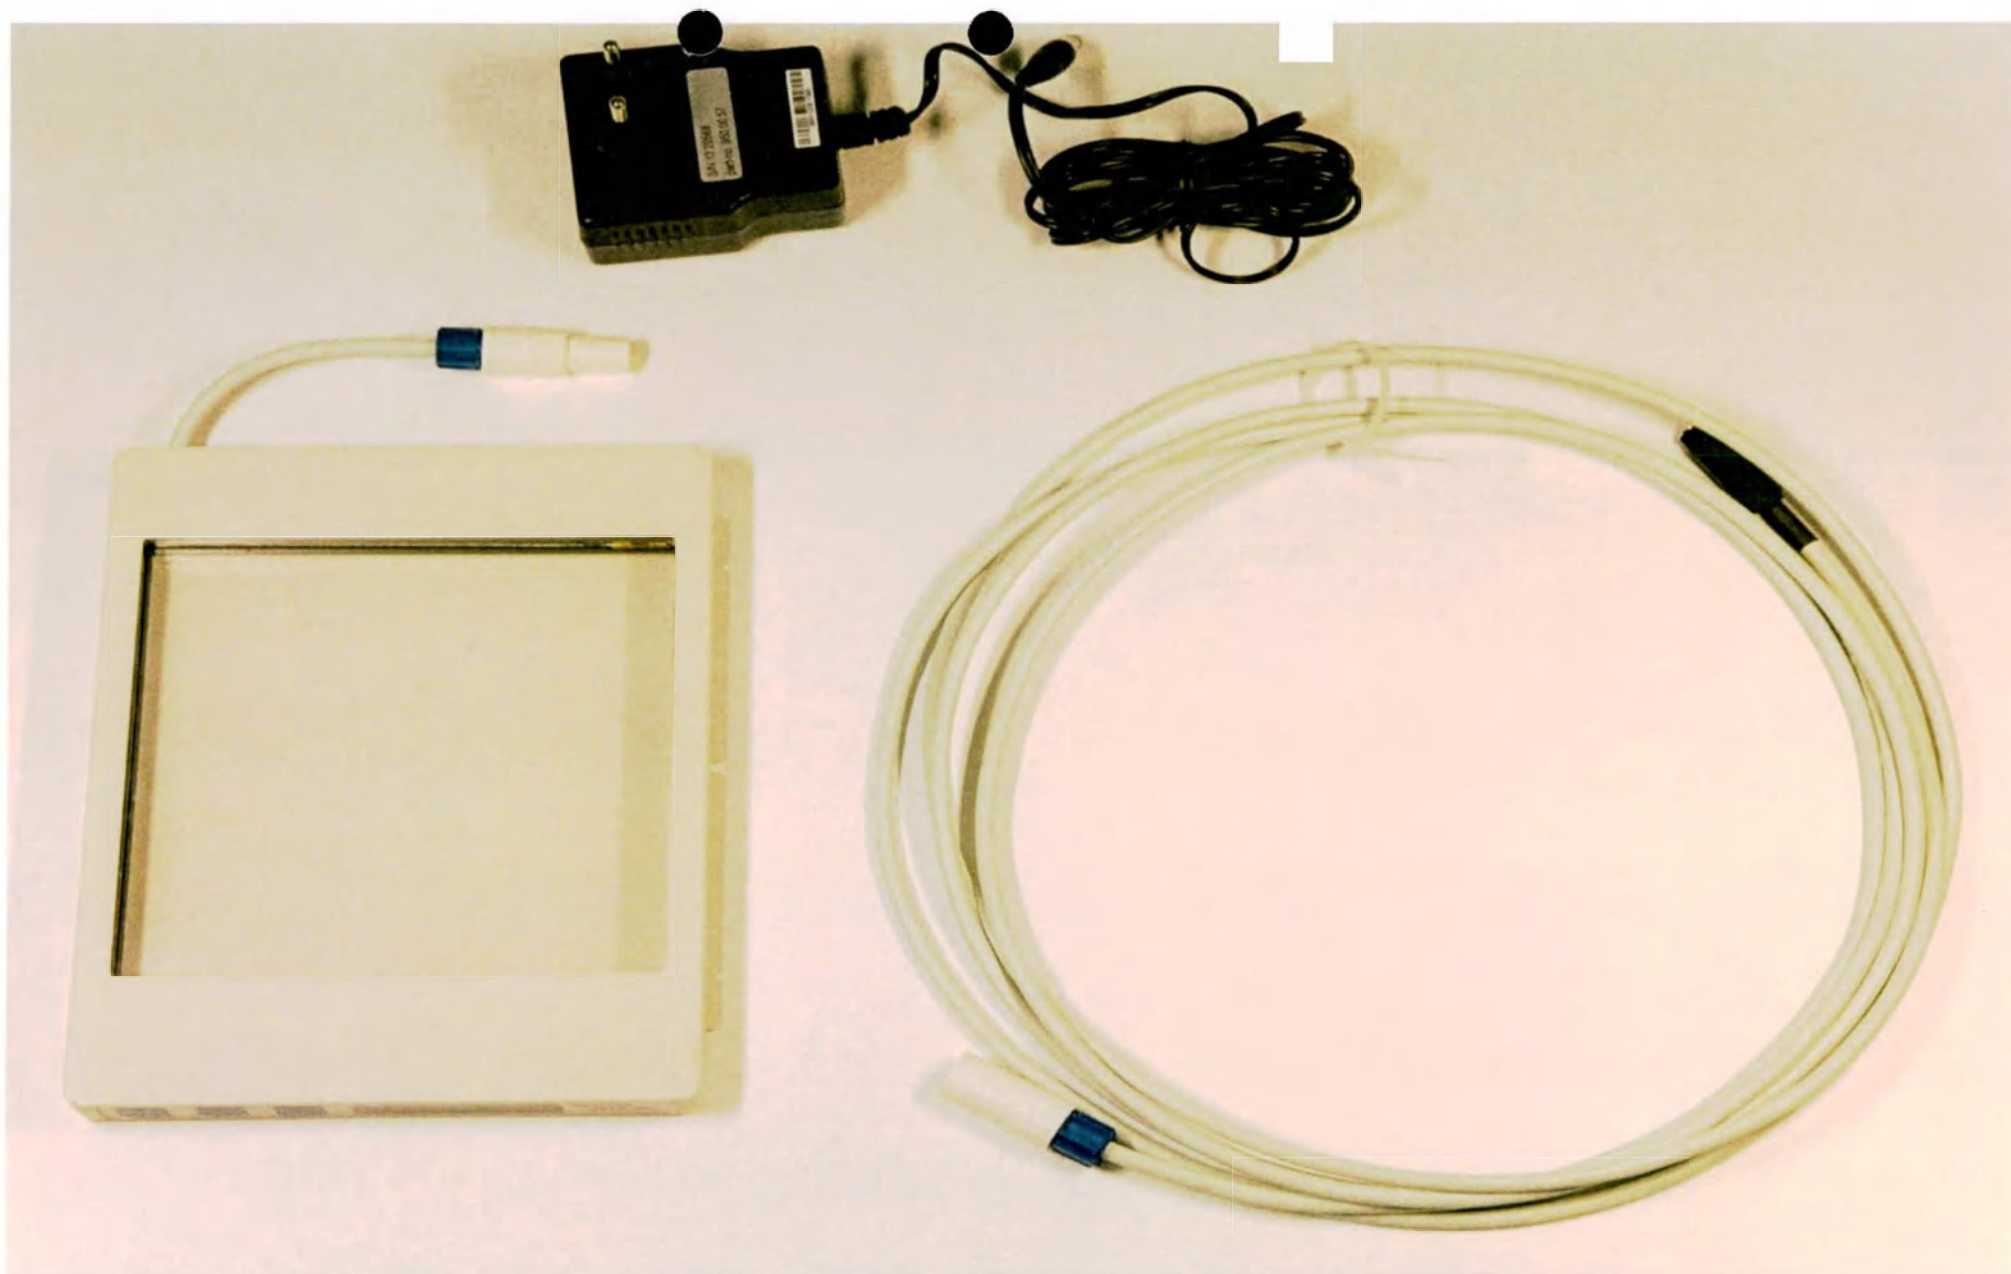

Фотография 158 – Дозиметр серии VacuDAP, VacuTec, Meßtechnik GmbH, ФРГ/РУ № ФСЗ 2012/11816. Вариант внешнего вида




Фотография 159 – Устройство переговорное KRT-10-0910. Вариант внешнего вида

НАИМЕНОВАНИЕ	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ	KRT-10-0910
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
+7,5В 0,23А	

Фотография 160 – Устройство переговорное KRT-10-0910. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 161 – Инъектор автоматический серии Visor-HI Angio, Lery Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Вариант внешнего вида

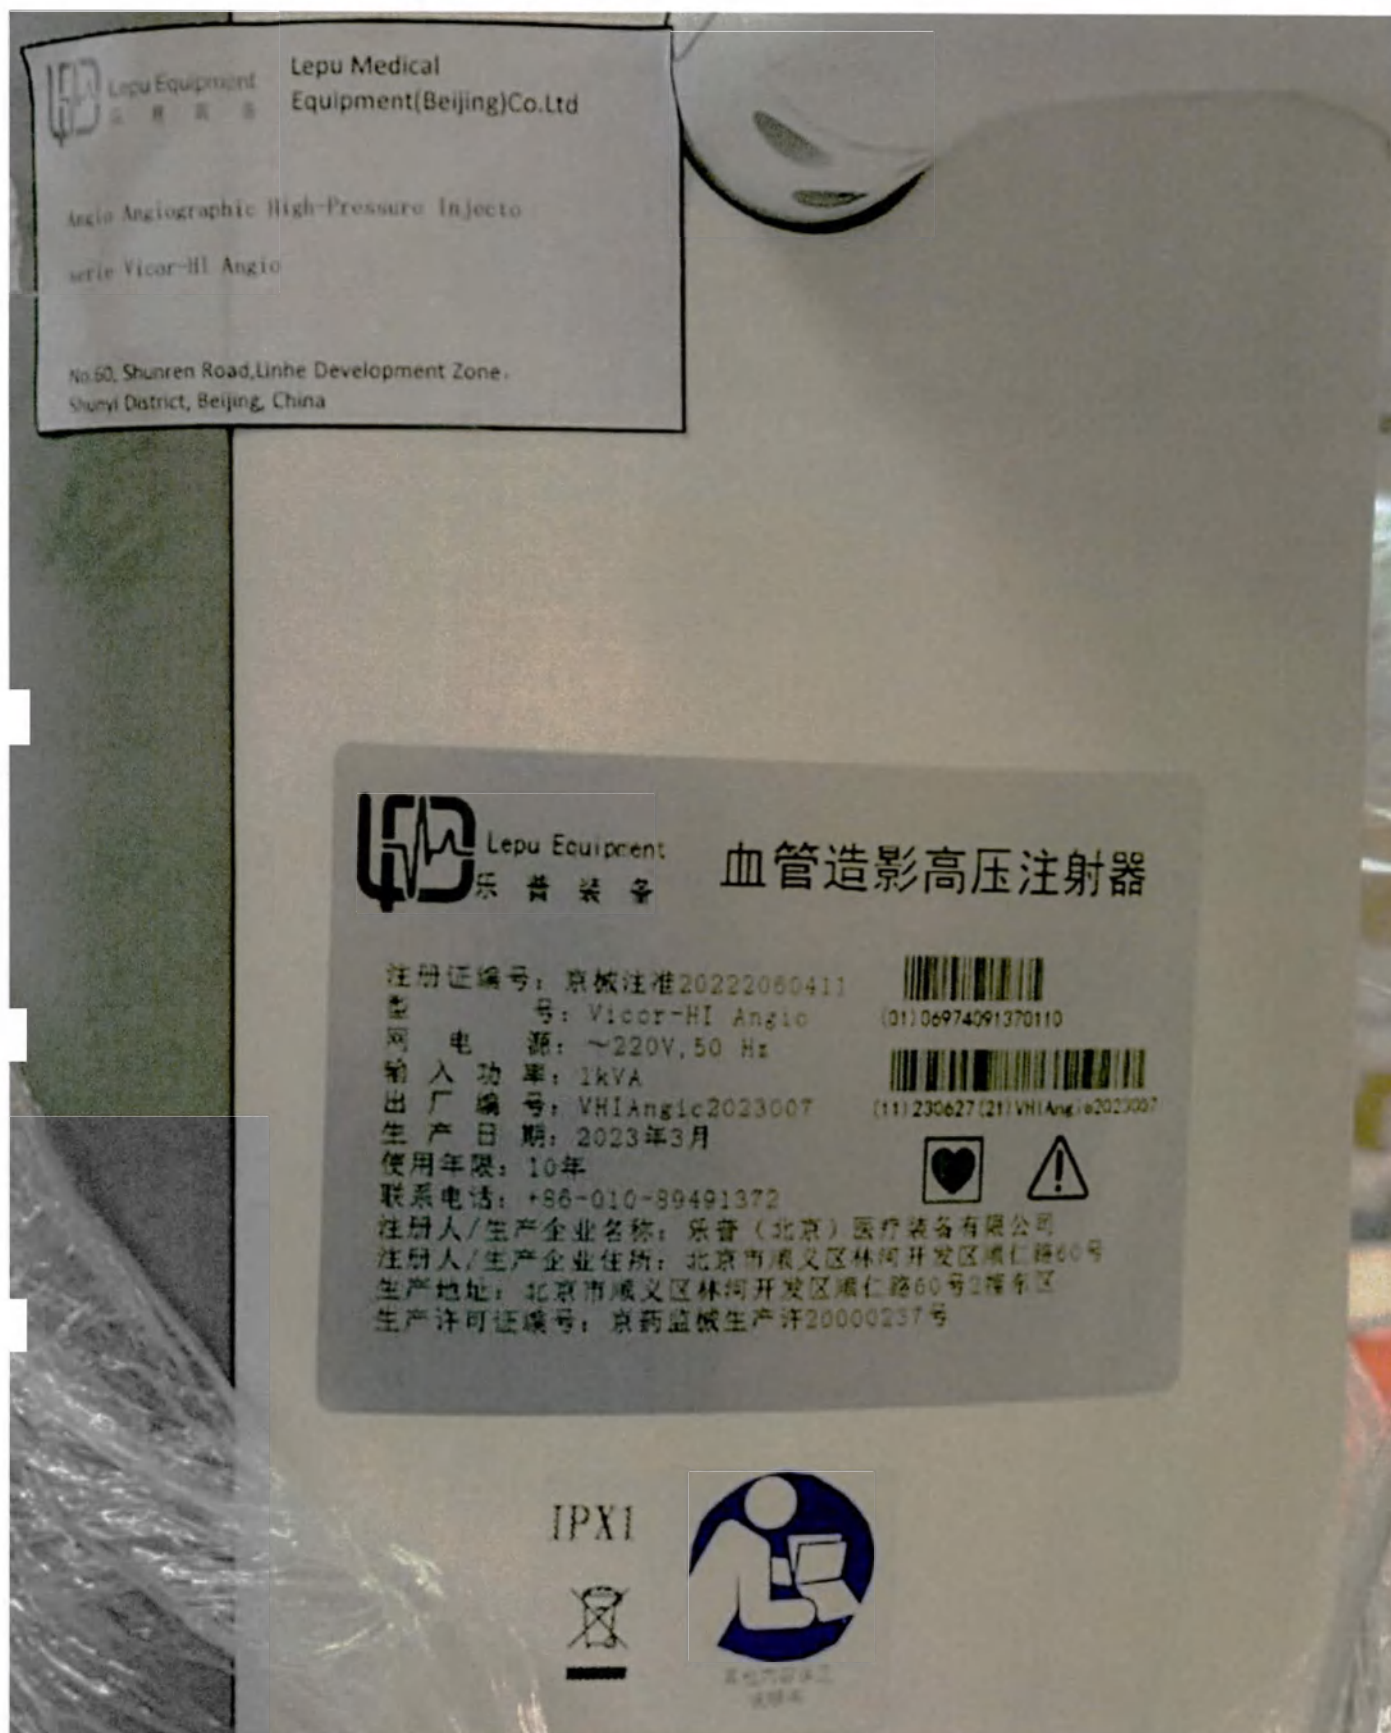

Фотография 162 – Инъектор автоматический серии Vicor-HI Angio, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 163 – Инъектор автоматический серии Mark MEDRAD Inc. Вариант внешнего вида

Mark V ProVis INJECTOR SYSTEM 注射系统

Model No. 型号	PPD 220 50 207	Date Mfd. 	FEB 2016
Serial No. 序号	107927	MEDRAD 	
Voltage 电压	220 V ~	One Medrad Drive Indianola, PA 16061 USA C US	
Current 电流	5 Amps	Made in USA 美国制造 U.S. Pat. No. 4,864,324	
Frequency 频率	50 Hz	 CLASS 1	

SFDA 注册号: 国食药监械(进)字 2004 第 3641838 号

30411-T-139 REV C

Фотография 164 – Инъектор автоматический серии Mark MEDRAD Inc. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 165 – Система инъекционная для ангиографии MEDRAD Avanta с принадлежностями, Bayer Medical Care Inc., США, РУ № РЗН 2016/4162. Вариант внешнего вида



Фотография 166 – Инъектор автоматический для введения контрастного вещества Accutron с принадлежностями, MEDTRON AG, Германия, РУ № ФСЗ 2011/09220. Вариант внешнего вида



Фотография 167 – Инжекторы автоматические для введения контрастного вещества исполнения Optivantage DH с принадлежностями, Liebel-Flarsheim Company LLC, РУ № ФСЗ 2012/13277. Вариант внешнего вида



Фотография 168 – Система подачи контрастного вещества с принадлежностями SmartShot Alpha и/или Dual Shot Alpha 7, Nemoto Kyorindo Co Ltd, Япония, РУ № РЗН 2016/4501 , РУ № РЗН 2016/4368. Вариант внешнего вида



Фотография 169 – Окно рентгенозащитное серии MACO, Hans O.Mahn & Co. KG. Вариант внешнего вида



Фотография 170 – Окно рентгенозащитное, ЗАО «Ренекс». Вариант внешнего вида



Фотография 171 – Окно рентгенозащитное серии Roesys XPW, Roesys GmbH, Германия. Вариант внешнего вида

roesys
Digital X-Ray Systems

**Roesys GmbH Dr. Max-Ilgner Str.2
32339 Espelkamp / Germany**

Protective glass
Series: Roesys XPW
Model: 1000x800
Lead equivalent: 2,5 mm

Produced by Roesys GmbH, Germany

Фотография 172 – Окно рентгенозащитное серии Roesys XPW, Roesys GmbH, Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 173 – Окно ОАРЗ по ТУ 6968-002-91065324-2016 ООО «ПКФ «Промет-Урал», Россия. Вариант внешнего вида




Фотография 174 – Монитор для анестезиологии и интенсивной терапии МАИТ, ООО «Медицинские системы»,
РУ ФСР 2009/04980. Вариант внешнего вида



Фотография 175 – Монитор для анестезиологии и интенсивной терапии МАИТ, ООО «Медицинские системы». Образец
внешнего вида варианта маркировки. РУ ФСР 2009/04980



Фотография 176 – Средства отображения состояния пациента: Монитор серии K, Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. Вариант внешнего вида

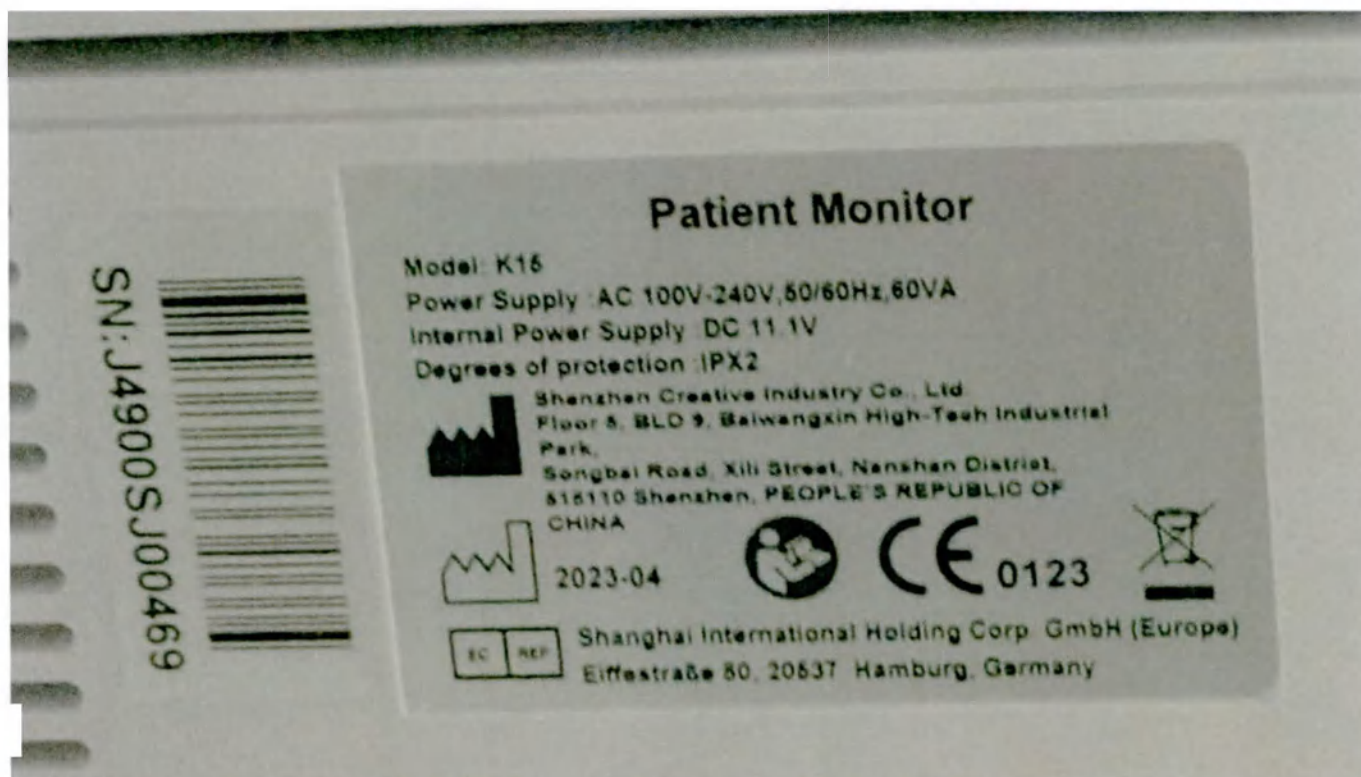

Фотография 178 – Средства отображения состояния пациента: монитор серии K. Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 179 – Монитор пациента с принадлежностями серии BeneView T9, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., РУ № РЗН 2018/6916. Вариант внешнего вида



Фотография 180 – Монитор пациента серии BeneView T5 RUS, ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», РУ № РЗН 2018/6952. Вариант внешнего вида




Фотография 181 – система мониторинга физиологических показателей пациентов с принадлежностями исполнения BeneVision N22, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., РУ № РЗН 2019/9516. Вариант внешнего вида



Фотография 182 – Монитор пациента с принадлежностями система мониторинга физиологических показателей с принадлежностями серии BeneVision, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., РУ № РЗН 2020/9549. Вариант внешнего вида



Фотография 183 – центральная система мониторинга серии BeneVision. Вариант внешнего вида

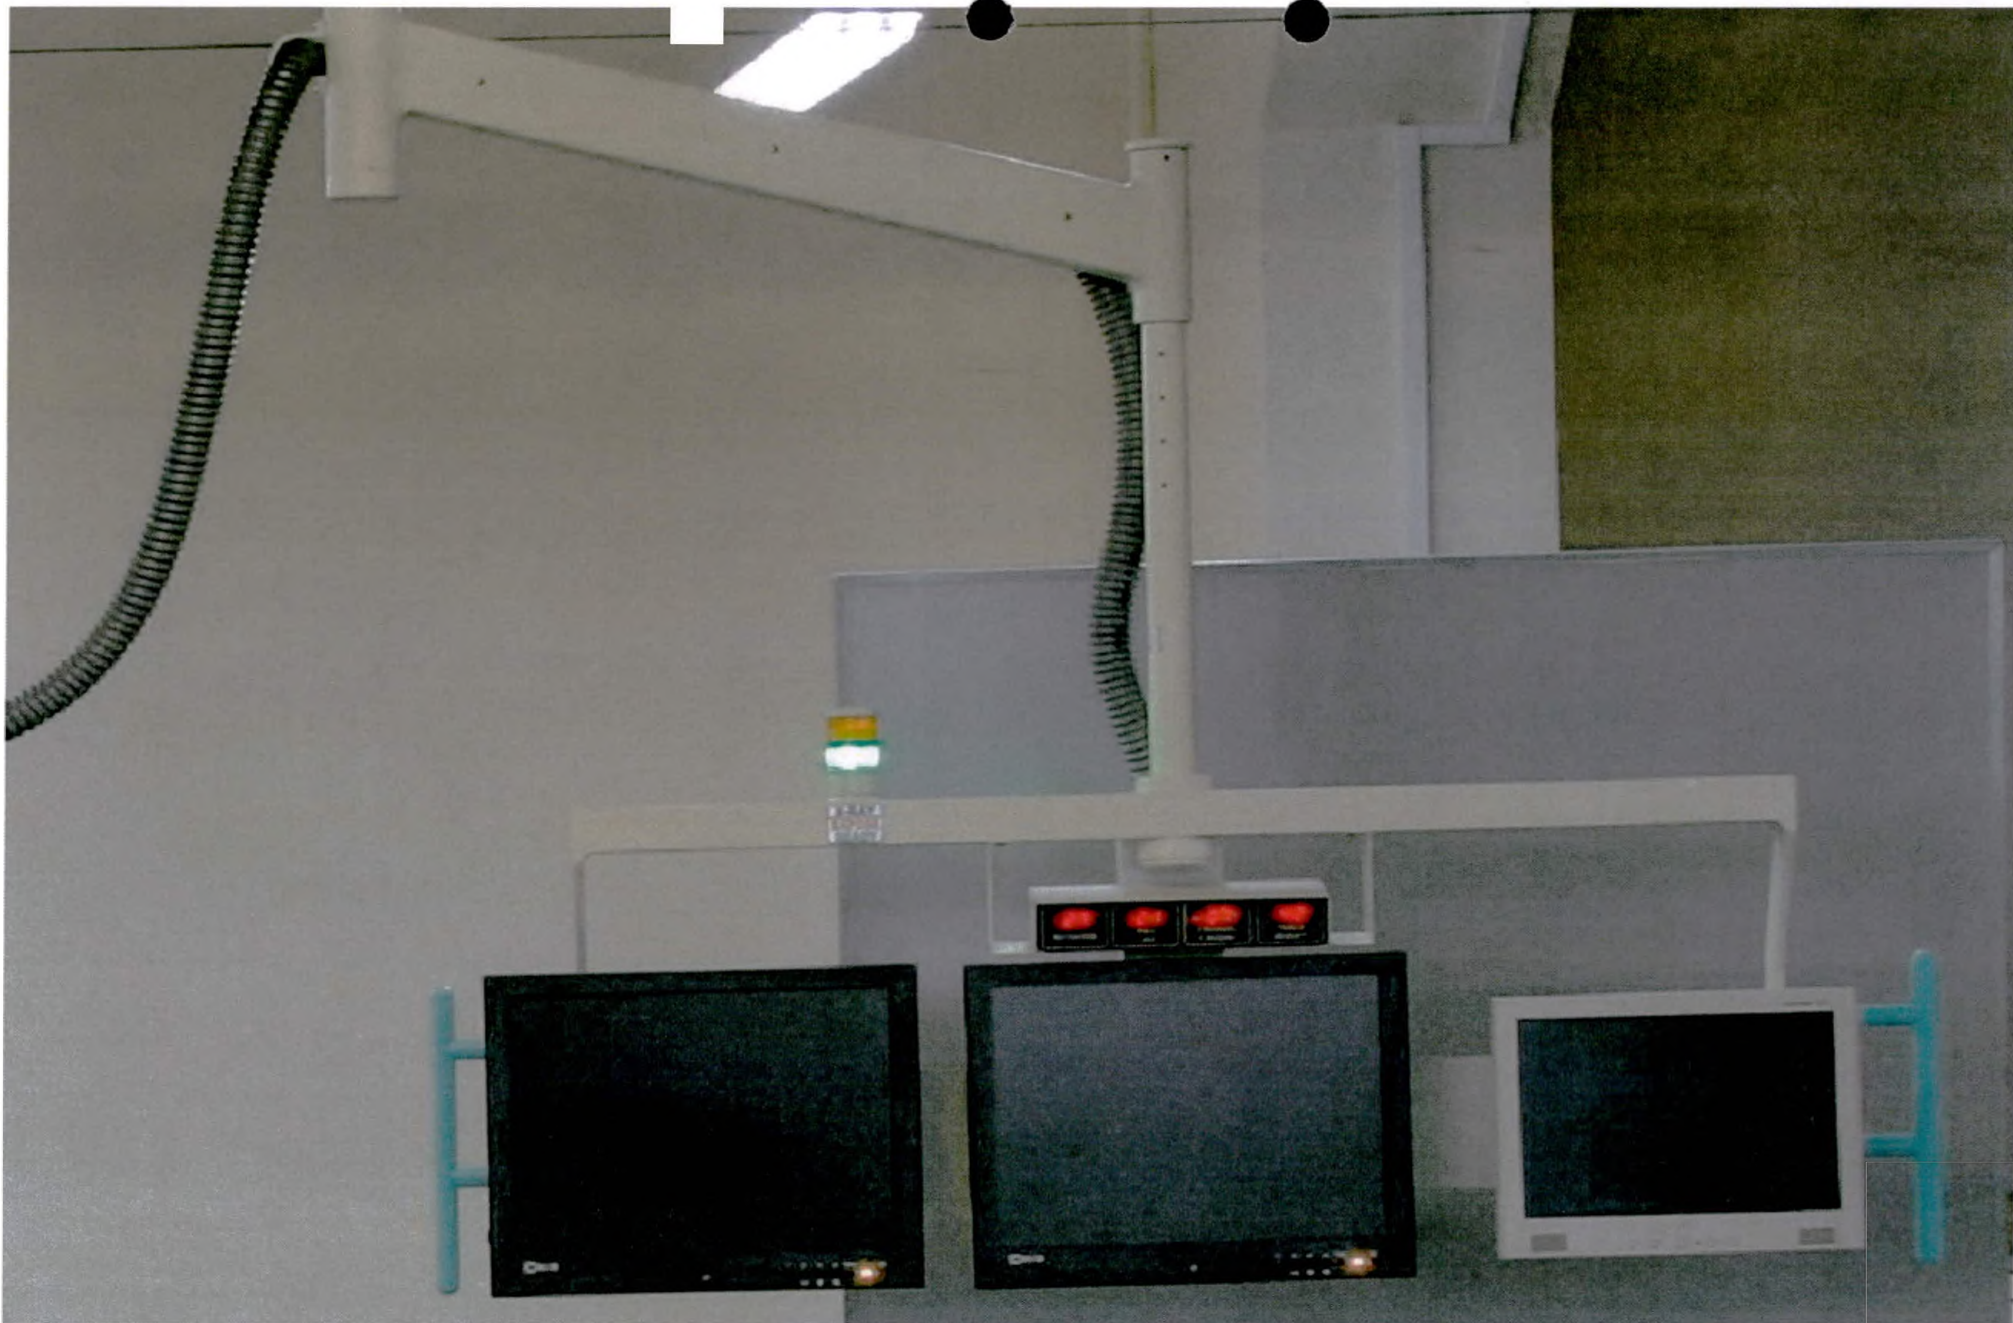

Фотография 184 – Подвес мониторов серии D, Omega Medical Imaging. Вариант внешнего вида

Omega Medical Imaging, LLC.

675 Hickman Circle, Sanford, FL 32771
Made in the U.S.A

Configuration: Monitor Suspension
B-200/C-300 (Lower Section)

Series: D

Serial Number: 6026

Power: 208/220/240 ~ 15A ~ 50/60 Hz



TYPE B
IEC60601-1

Complies with 21 CFR
Subchapter J
at the date of manufacture.


IEC60601-1



Date of Manufacture: August 2016

Label P/N 0310-0041 Rev 2

Фотография 185 – Подвес мониторов серии D, Omega Medical Imaging. Образец внешнего вида варианта маркировки

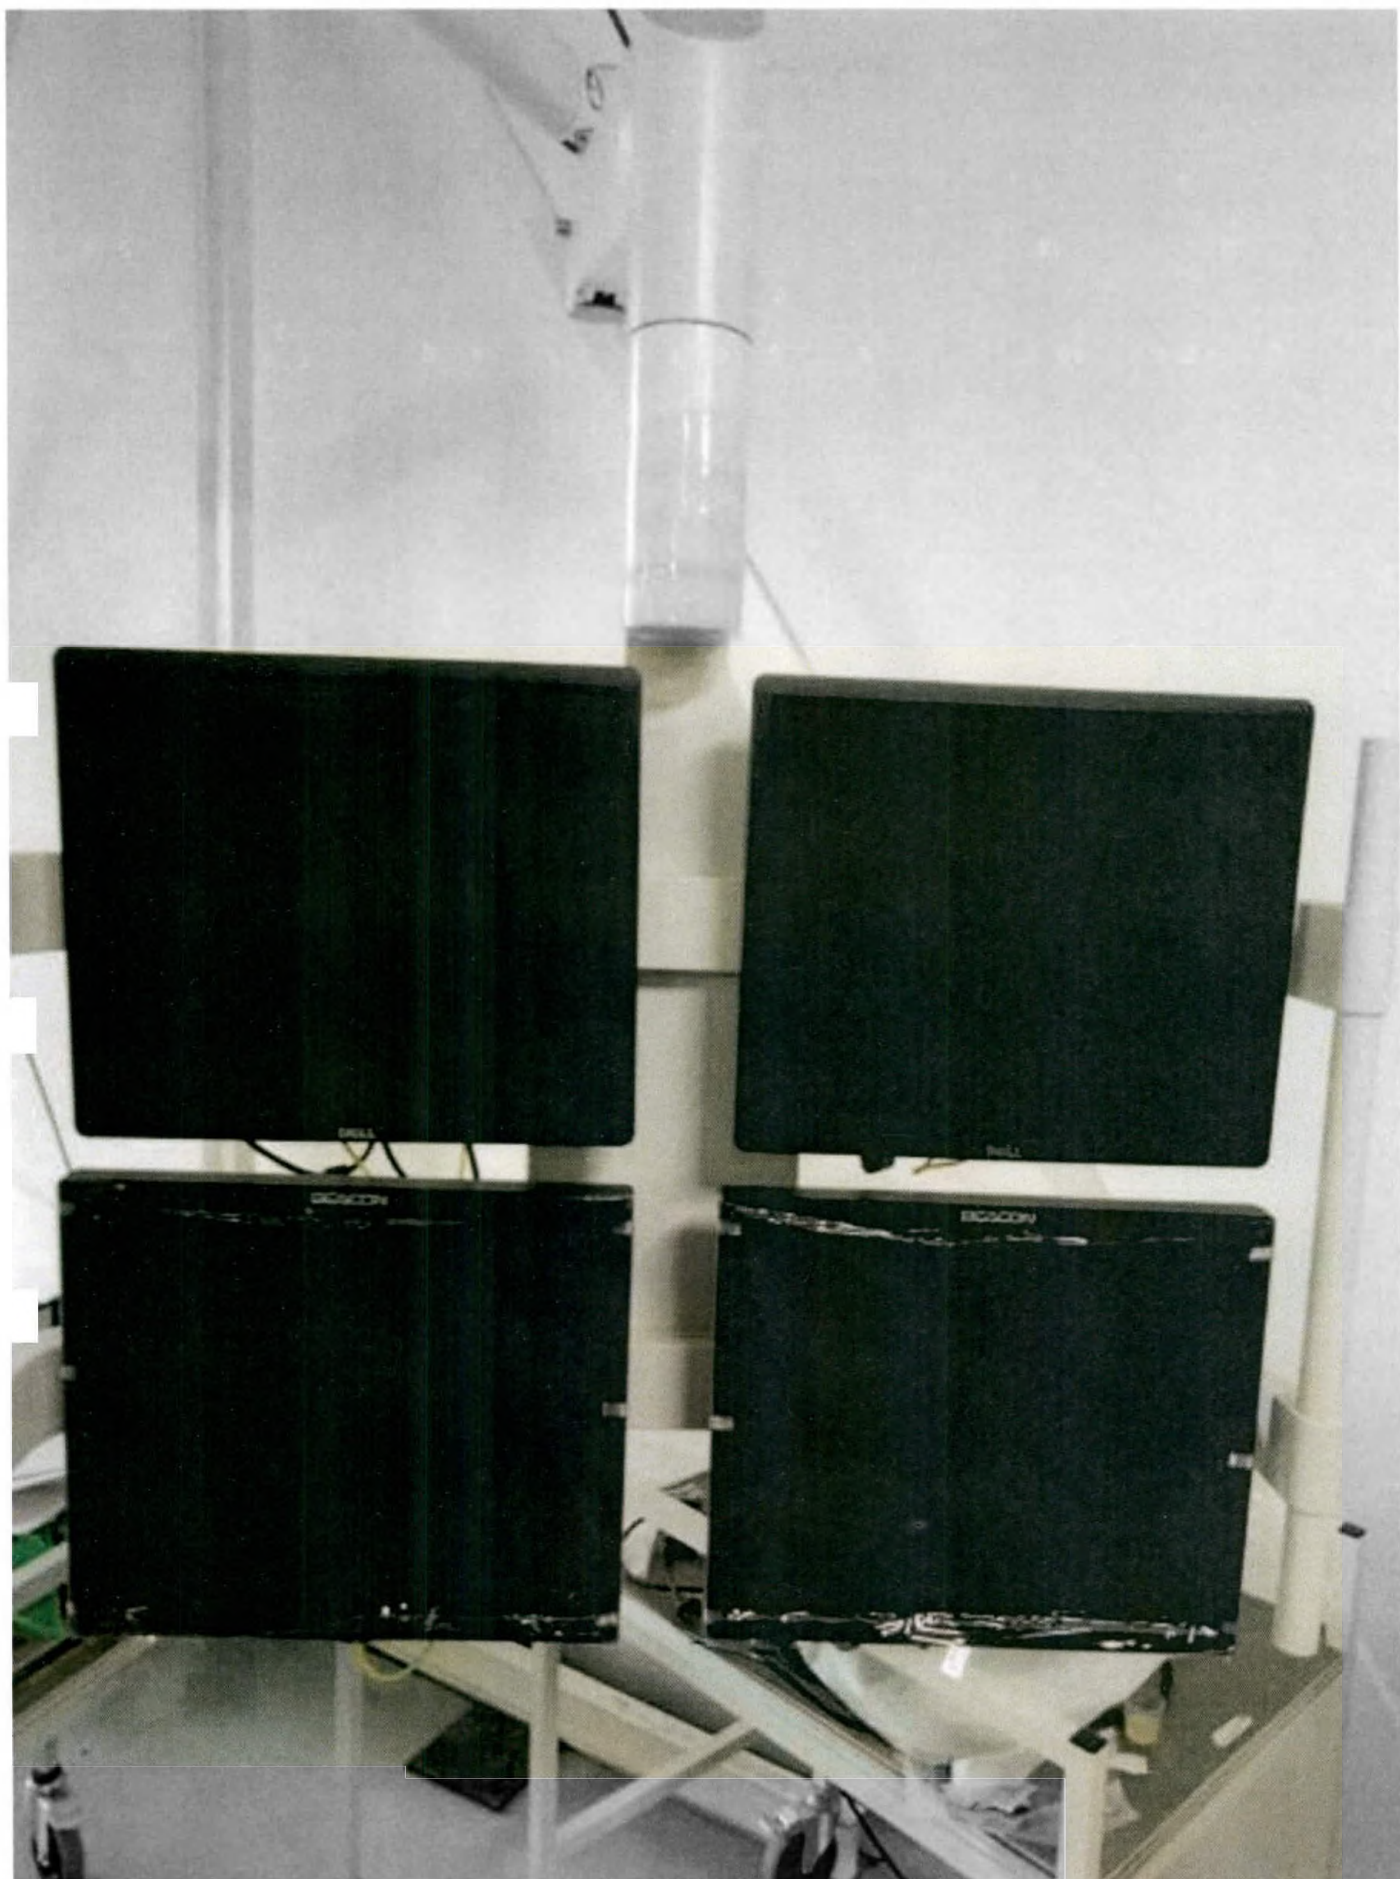

Фотография 186 – Подвес мониторов серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Вариант внешнего вида



Фотография 187 – Подвес мониторов серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd (Вариант внешнего вида сзади, место нанесения маркировки)



Фотография 188 – Подвес мониторов серии VCV, Lepu Medical Equipment (Beijing) Co., Ltd. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 189 – Светильники хирургические настенные и потолочные ЭМАЛЕД (образец) Завод ЭМА, РУ № ФСР 2010/07446. Вариант внешнего вида



Фотография 190 – Светильники медицинские хирургические Armed (образец), Shanghai Medical Instrument Co Ltd, РУ № РЗН ФСЗ 2012/12303. Вариант внешнего вида



а) - образец серии HyLED серии 8.



б) - образец серии HyLED X

Фотография 191 – Светильник хирургический светодиодный с принадлежностями серии HyLED и/или HyLED серии 8 и/или серии HyLED X 8, Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd, РУ № РЗН 2014/2265, РУ № РЗН 2021/16155, РУ № РЗН 2021/13450. Вариант внешнего вида



Фотография 192 – КИС3-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004 (образец из состава комплекта). Вариант внешнего вида



а) – образец жилета рентгенозащитного из комплекта



б) – образец набора рентгенозащитных пластин из комплекта

Фотография 193 – Комплект индивидуальных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«ПРОМЕТ» по ТУ 14.12.30-001-39575739-2019, ООО «ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЕКШН». Вариант внешнего вида



Комплекс ангиографический рентгеновский АКР

№GP*****

МЕСТО № 1/X

Контракт №

Заказчик

Поставщик

Грузополучатель

Пункт назначения

БРУТТО *** Кг

Грузоотправитель:

НЕТТО *** Кг

АО «НППК «Электрон»,
197758, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.
Г. Поселок Песочный, ул. Садовая, д. 88,
стр. 1, помещ. 8Н

*** х *** х *** СМ

ВНИМАНИЕ!

Вскрывать только в присутствии представителя поставщика



Фотография 194 – Фотография варианта внешнего вида изделия в упаковке и макет образца внешнего вида варианта маркировки

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 144
(сего сальдесет лист(ов)
сего)

Руководитель отдела
Сертификации
Денисова О.А.
по доверенности № 59

