

Серия №
Рег. до
Дата
нахождения
503010
09 2016
03 2015



751


каталожный номер

ХРОМОТЕХ- ПЛАЗМИНОГЕН

Набор реагентов
для определения
плазминогена
на автоматическом
коагулометре АК

100 определений

Только для автоматического коагулометра АК

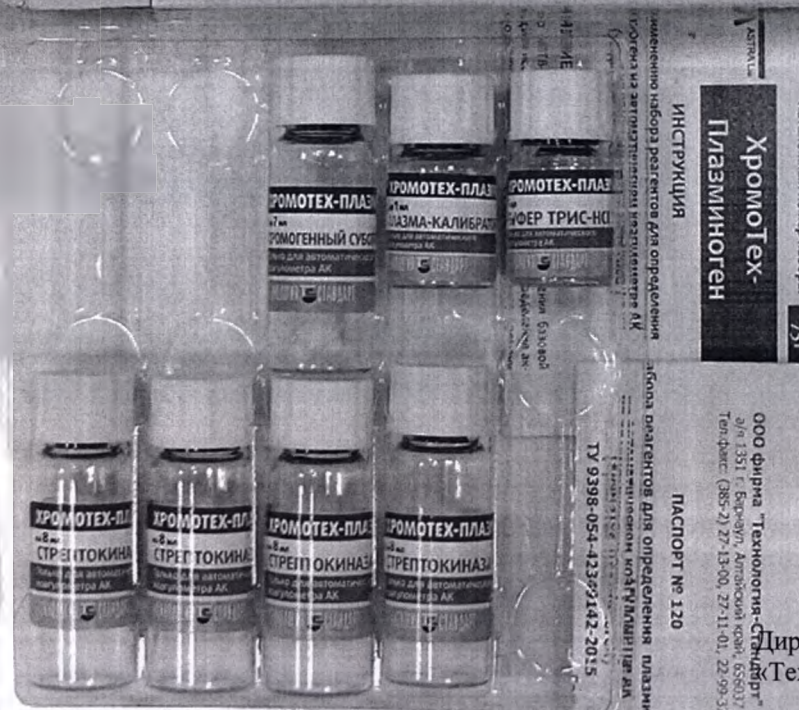

Каталожный номер набора:

751

Хромотех-
Плазминоген

ИНСТРУКЦИЯ

Изменение набора реагентов для определения
плазмина на автоматическом коагулометре АК

ПАСПОРТ № 120

ООО фирма «Технология-Стандарт»
ул. 1351 г. Барнаул, Алтайский край, 656017
Телефон: (385-2) 27-13-00, 27-11-01, 22-99-37
ТУ 9398-054-42349142-2015



Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»


А.П. Момот

Макет этикеток медицинского изделия «Набор реагентов для определения плазминогена на автоматическом коагулометре АК (ХромоТех-Плазминоген) по ТУ 9398-054-42349142-2015».


Этикетка реагента «Хромогенный субстрат»




Этикетка реагента «Буфер трис-НСl»

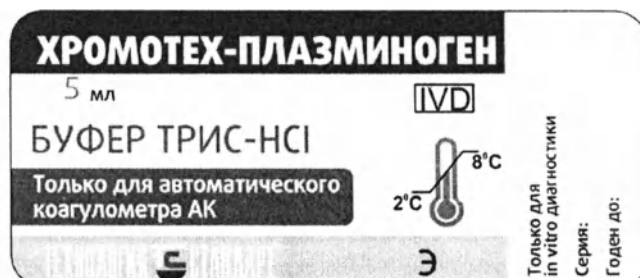

Этикетка реагента «Стрептокиназа»

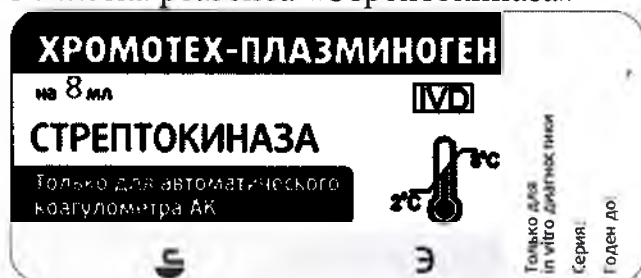

Этикетка реагента «Плазма-калибратор»

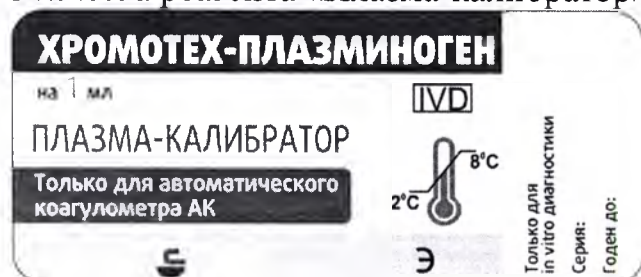

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

[Signature]

А.П. Момот

