

Внешний вид «Реагент для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре АК (Техпластин-тест) по ТУ 9398-053-42349142-2015». Комплектация № 1

Серия №
Годен до
Дата
на изготовления

501022
12 2016
01 2015

Хранить
при +2...+8°C



каталожный номер

728

ТЕХПЛАСТИН-ТЕСТ

Реагент для определения
протромбинового времени
на автоматическом
коагулометре АК

250

определений

Только для автоматического коагулометра АК



Каталожный номер: 728

Техпластин-тест

ИНСТРУКЦИЯ

по применению реагента для определения
протромбинового времени на автоматическом
коагулометре АК

ПАСПОРТ № 320

для определения протромбинового времени
на коагулометре АК (Техпластин-тест)

ООО фирма "Технология-Стандарт"
г/а 1351 г. Барнаул, Алтайский край, 656037
Тел/факс: (385-2) 22-13-00/22-13-01, 22-59-37



Директор ООО фирмы
"Технология-Стандарт" А.П. Момот

Внешний вид «Реагент для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре АК (Техпластин-тест) по ТУ 9398-053-42349142-2015». Комплектация № 2

Серия №
Партия №
Дата
изготовления

501025
08 2016
01 2015

Хранить
при +2... +8°C



каталожный номер

754


ТЕХПЛАСТИН-ТЕСТ

Реагент для определения
протромбинового времени
на автоматическом
коагулометре АК

250

определений

Только для автоматического коагулометра АК

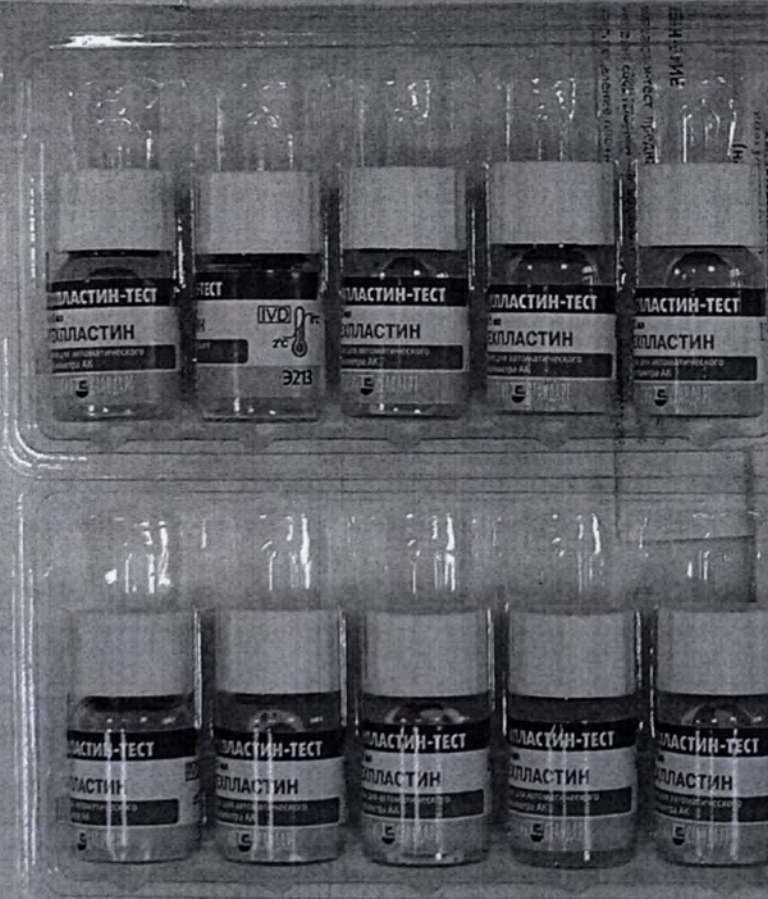

ИНСТРУКЦИЯ

Техпластин-тест

Каталожный номер:

754

ПАСПОРТ № 223

ООО фирма «Технология-Стандарт»
г. Б. 1351, г. Барнаул, Алтайский край
Тел/факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-11

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2166 листов
Руководитель В.В. Ветер
И.И. Илья 20.10.16 г.

