

Серия № 501011
 Годен до 03 2017
 Дата изготовления 01 2015

Хранить
 при +2 ... +8 °C



каталожный номер

729


ТРОМБО-ТЕСТ

Реагент для определения
 тромбинового времени
 на автоматическом
 коагулометре АК

250

определений

Только для автоматического коагулометра АК

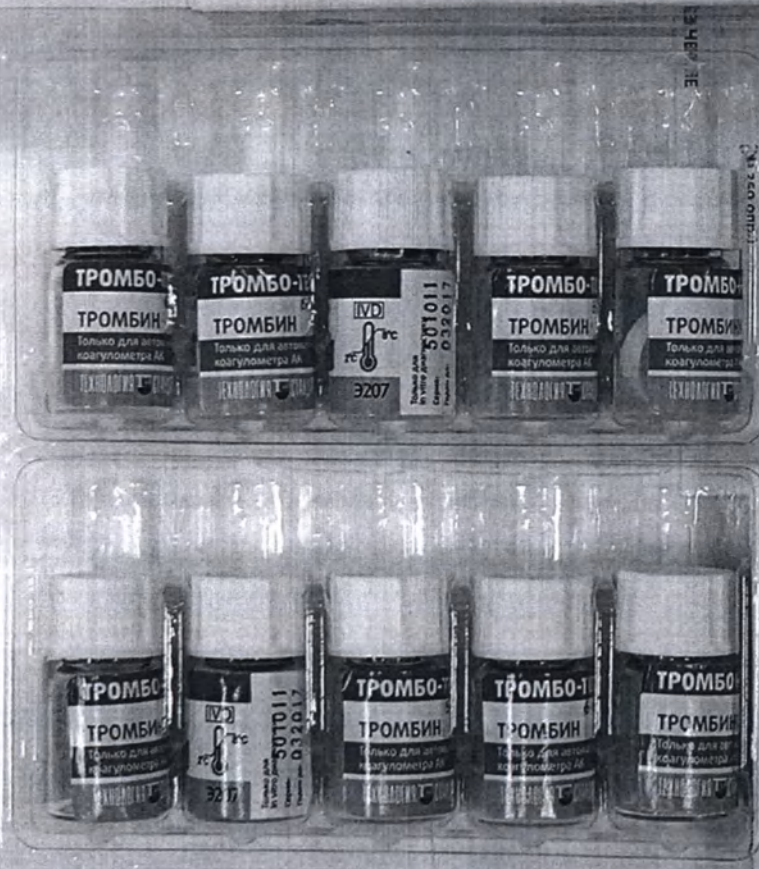

Тромбо-тест

Каталожный номер: 729

ИНСТРУКЦИЯ

Применение реагента для определения
 тромбинового времени на автоматическом
 коагулометре АК

ПАСПОРТ № 727

ООО фирма "Технология-Стандарт"
 д/а 1351 г. Барнаул, Алтайский край, 656037
 Тел./факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-01, 22-99-37

реагент для определения
 тромбинового времени на автоматическом коагулометре
 (Тромбо-тест)
 ТУ 0398-050-00000000-2015



Директор ООО фирмы
 «Технология-Стандарт»

А.П. Момот

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 214/а листов
Руководитель И.И. Мещеряков
И.И. Мещеряков 20.16 г.

