

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО фирмы

«Технология-Стандарт»


А.П. Момот

2021 г.




**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор контрольных плазм для количественного определения D-димера в
плазме крови на автоматическом коагулометре АК (D-димер контроль)»
по ТУ 21.20.23-101-42349142-2021**


Внешний вид «Набор контрольных плазм для количественного определения D-димера в плазме крови на автоматическом коагулометре АК (D-димер контроль)» по ТУ 21.20.23-101-42349142-2021.
Лицевая сторона изделия

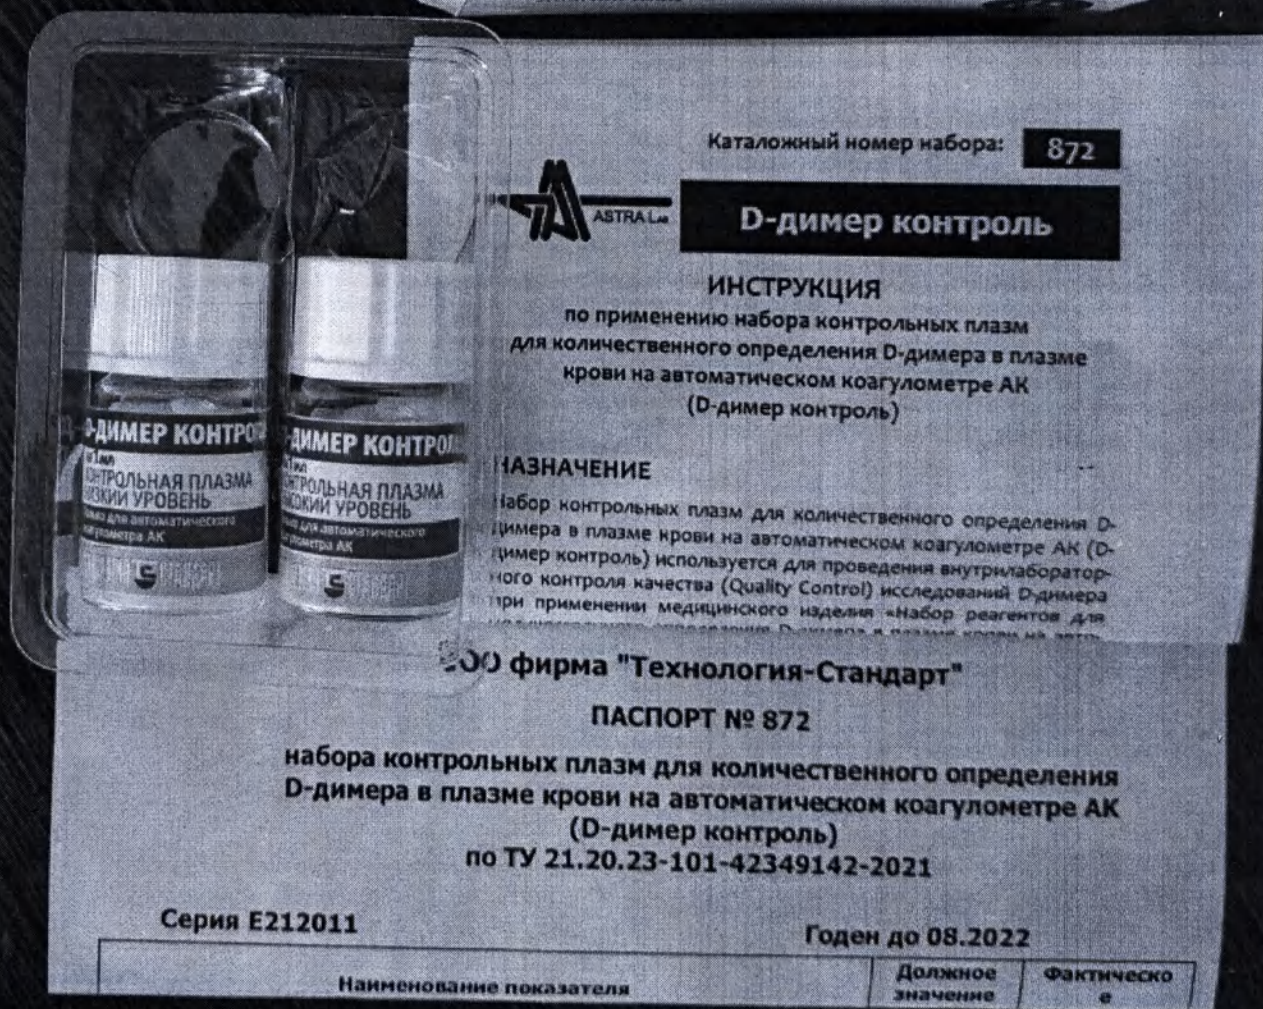

Внешний вид «Набор контрольных плазм для количественного определения D-димера в плазме крови на автоматическом коагулометре АК (D-димер контроль)» по ТУ 21.20.23-101-42349142-2021. Тыльная сторона изделия

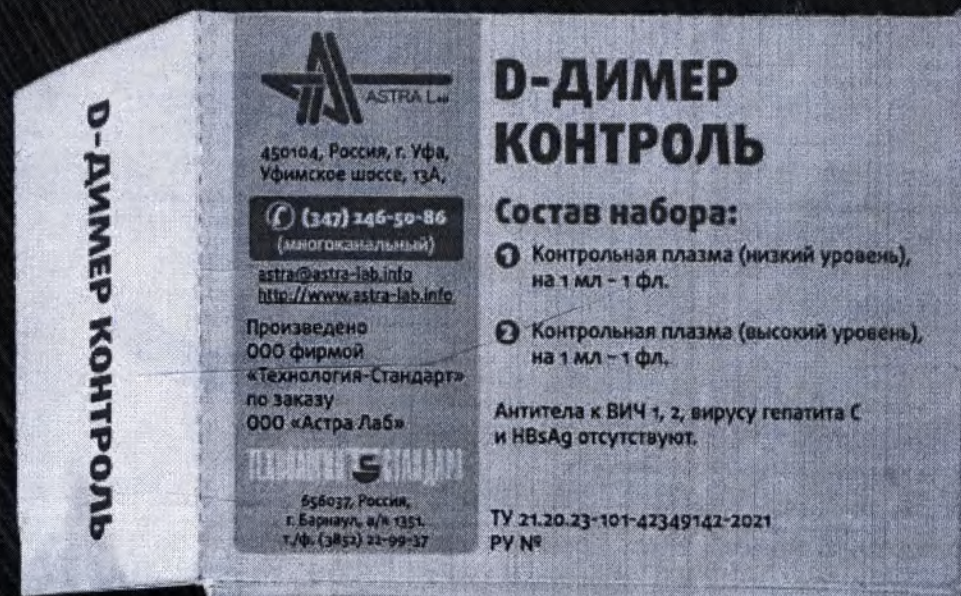

Макет упаковки медицинского изделия «Набор контрольных плазм для количественного определения D-димера в плазме крови на автоматическом коагулометре АК (D-димер контроль)» по ТУ 21.20.23-101-42349142-2021.

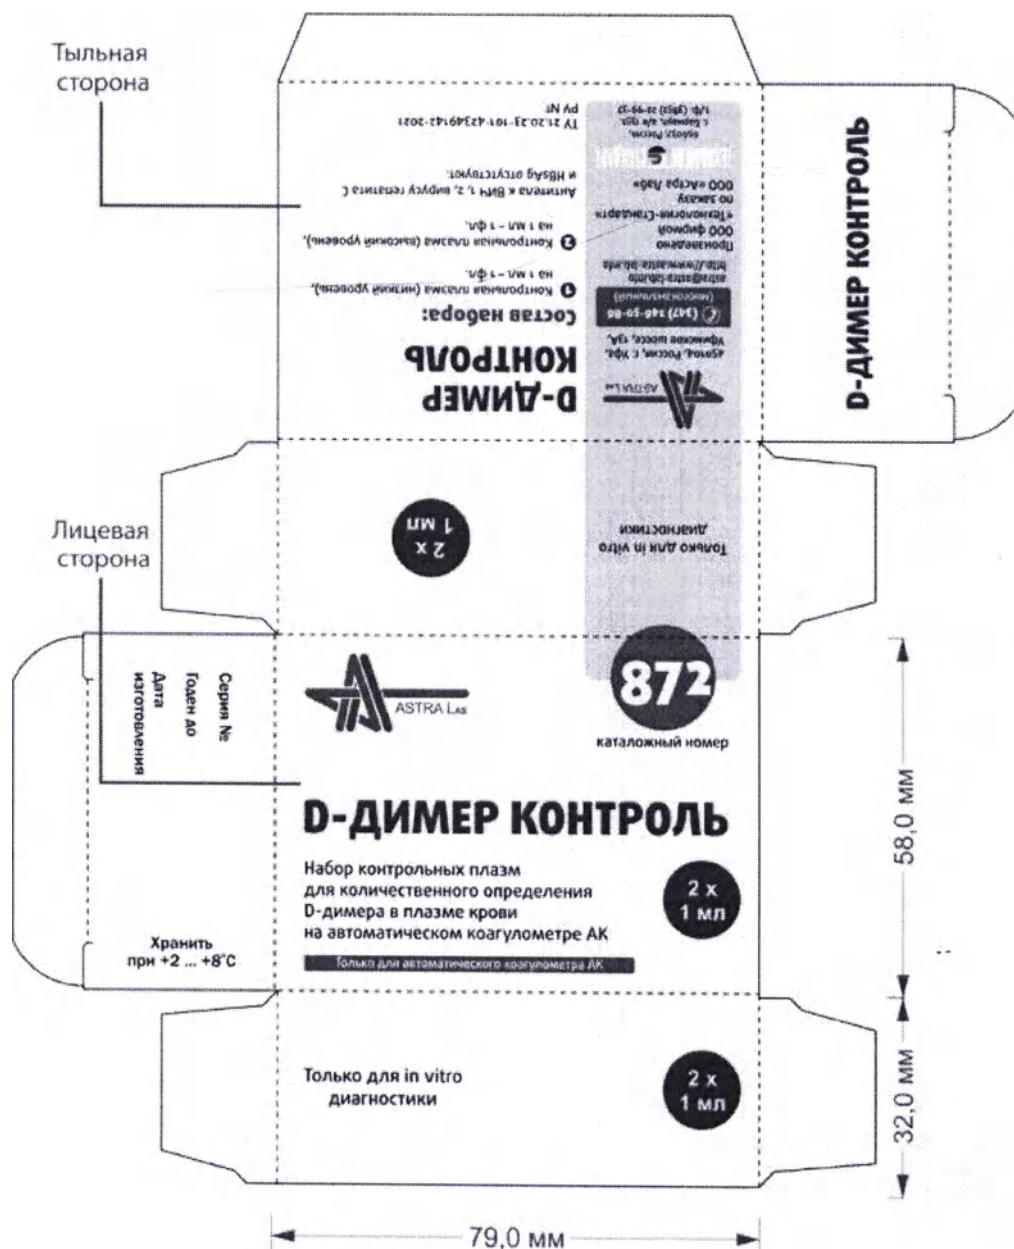

Красочная группа: СМУК

Размер коробки в готовом виде: 79*58*32


**Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»**




А.П. Момот

Макет этикеток медицинского изделия «Набор контрольных плазм для количественного определения D-димера в плазме крови на автоматическом коагулометре АК (D-димер контроль)» по ТУ 21.20.23-101-42349142-2021.

Макет этикетки реагента «Контрольная плазма (низкий уровень)»

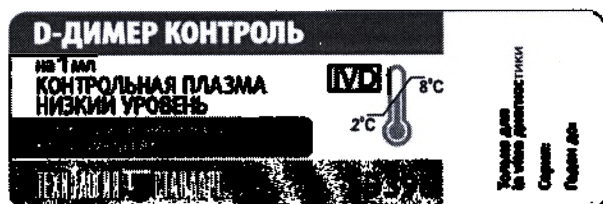

Макет этикетки реагента «Контрольная плазма (высокий уровень)»

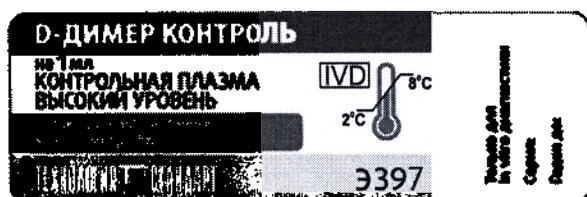

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот