

Серия № 606016
Годен до 12 2017
Дата изготовления 06 2016

Хранить
при +2 ... +8°C



784


каталожный номер

АК ПЛАЗМА П

Контрольная плазма
с патологическим диапазоном значений
для автоматического коагулометра АК

2 x
1 мл

Только для автоматического коагулометра АК

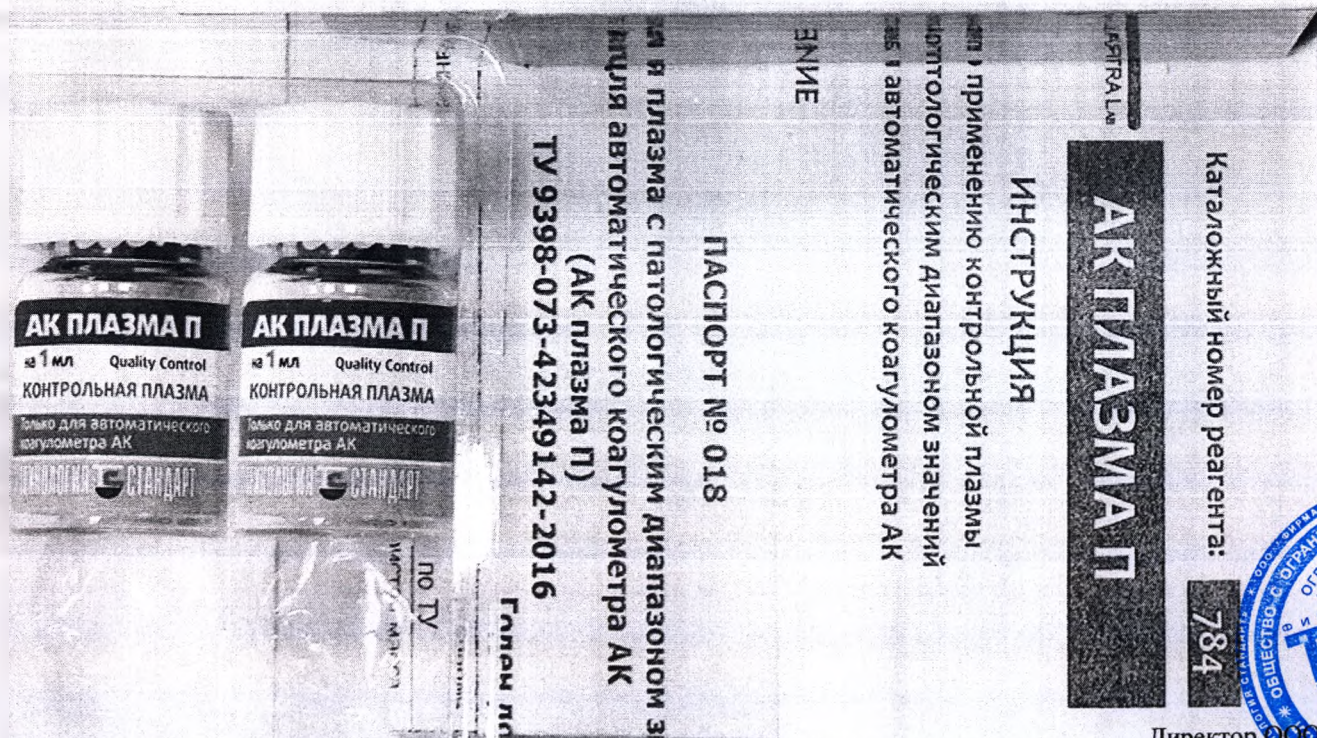

АК ПЛАЗМА П

Каталожный номер реагента:

784

ИНСТРУКЦИЯ

для применения контрольной плазмы
с патологическим диапазоном значений
для автоматического коагулометра АК

ВВЕДЕНИЕ

ПАСПОРТ № 018

АК плазма с патологическим диапазоном значений
для автоматического коагулометра АК
(АК плазма П)
ТУ 9398-073-42349142-2016

Годен до



Директор ООО «Фирма
«Технология Стандарт»

А.П. Момот



Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

