


Фотографические изображения медицинского изделия

Анализатор автоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для in vitro диагностики в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе

ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»


 Данилов П. А.


«10» декабря 2024 г.





Анализатор автоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для in vitro диагностики DL-96A. Основной блок. Вид спереди.

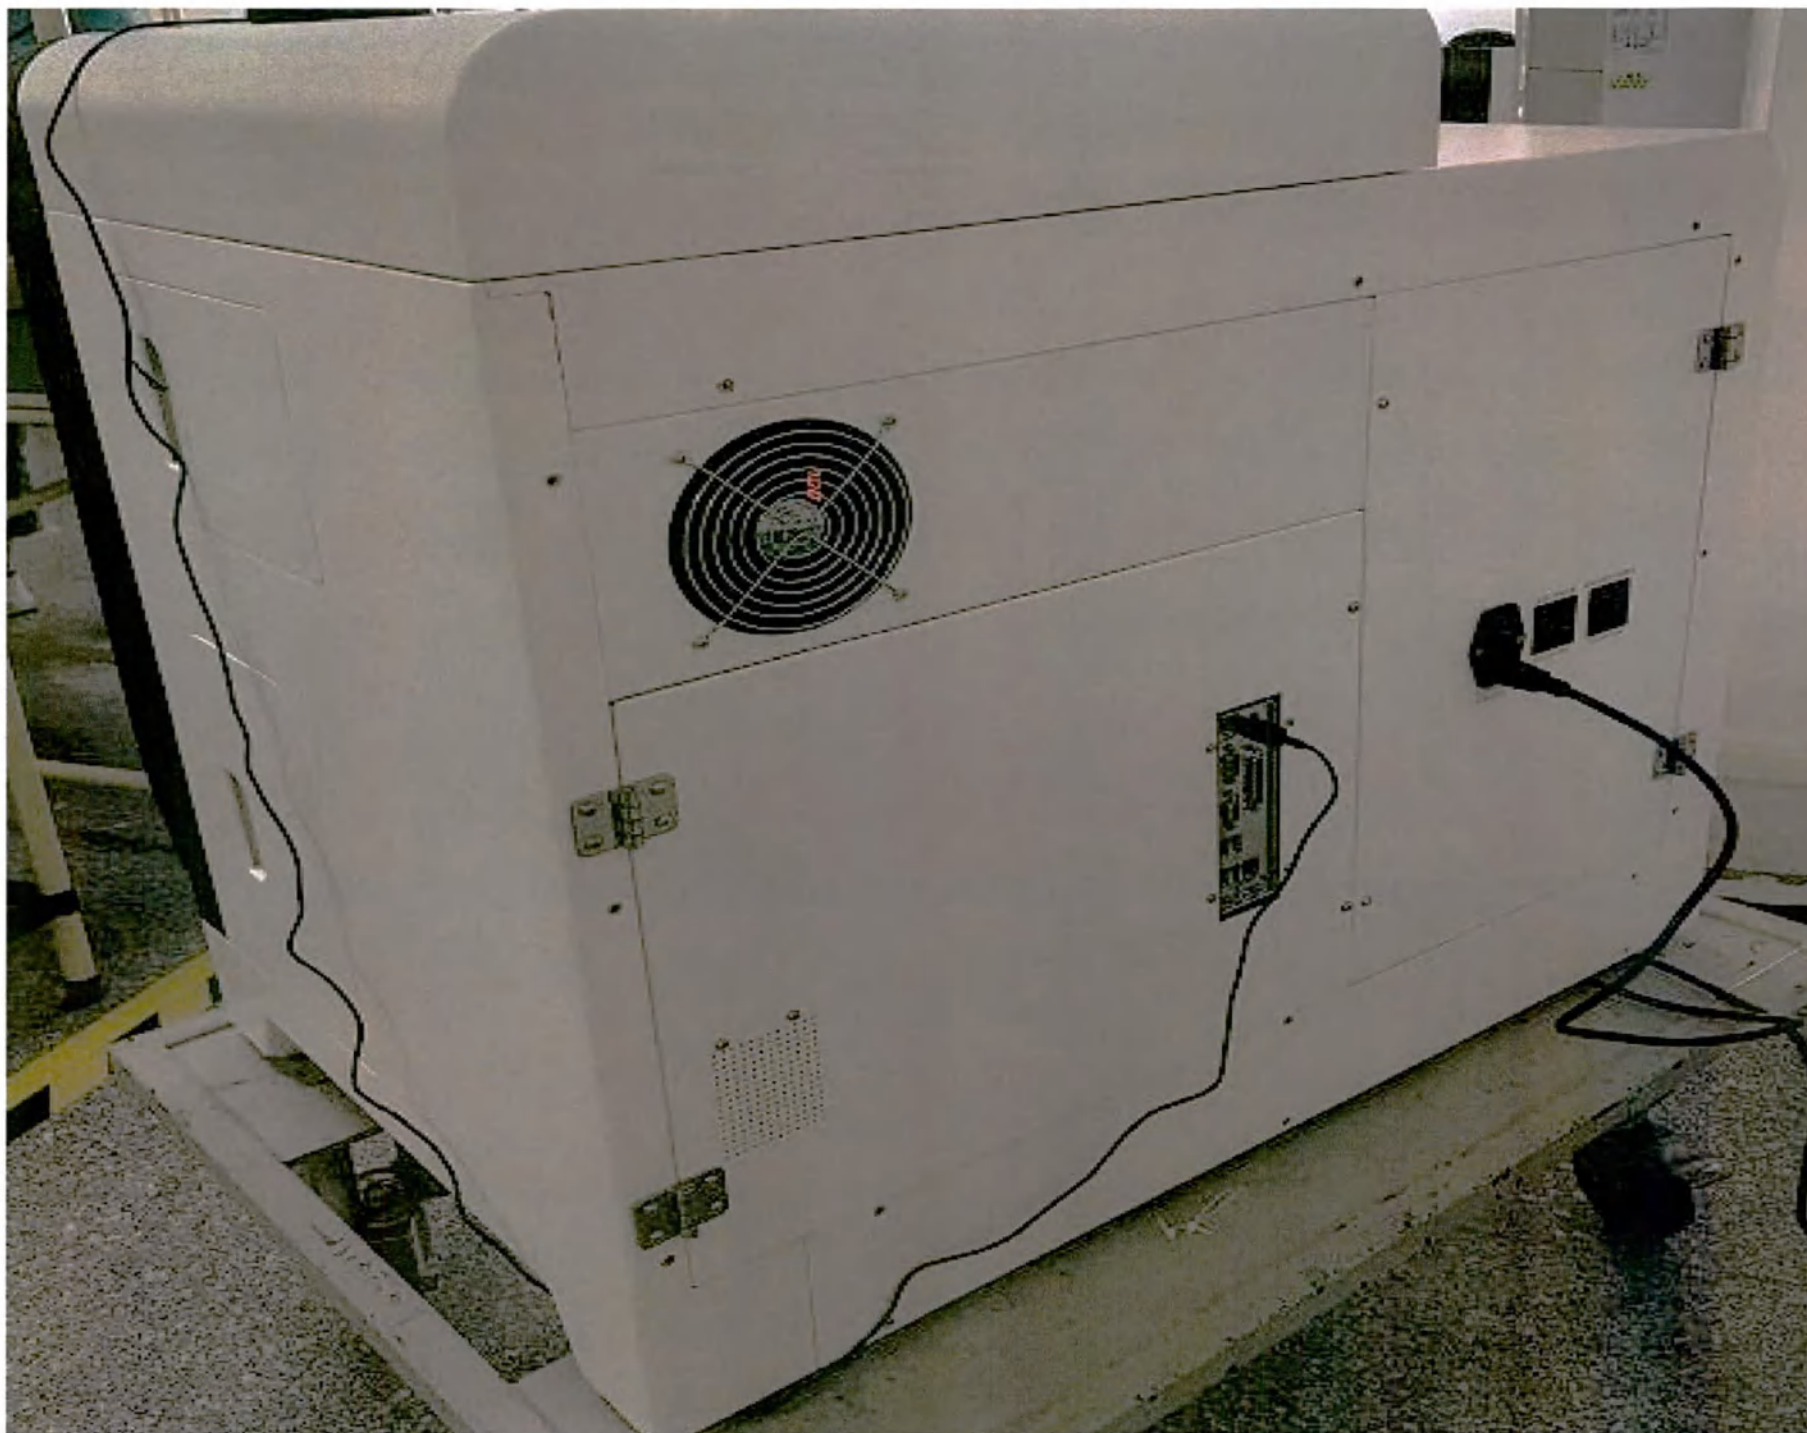

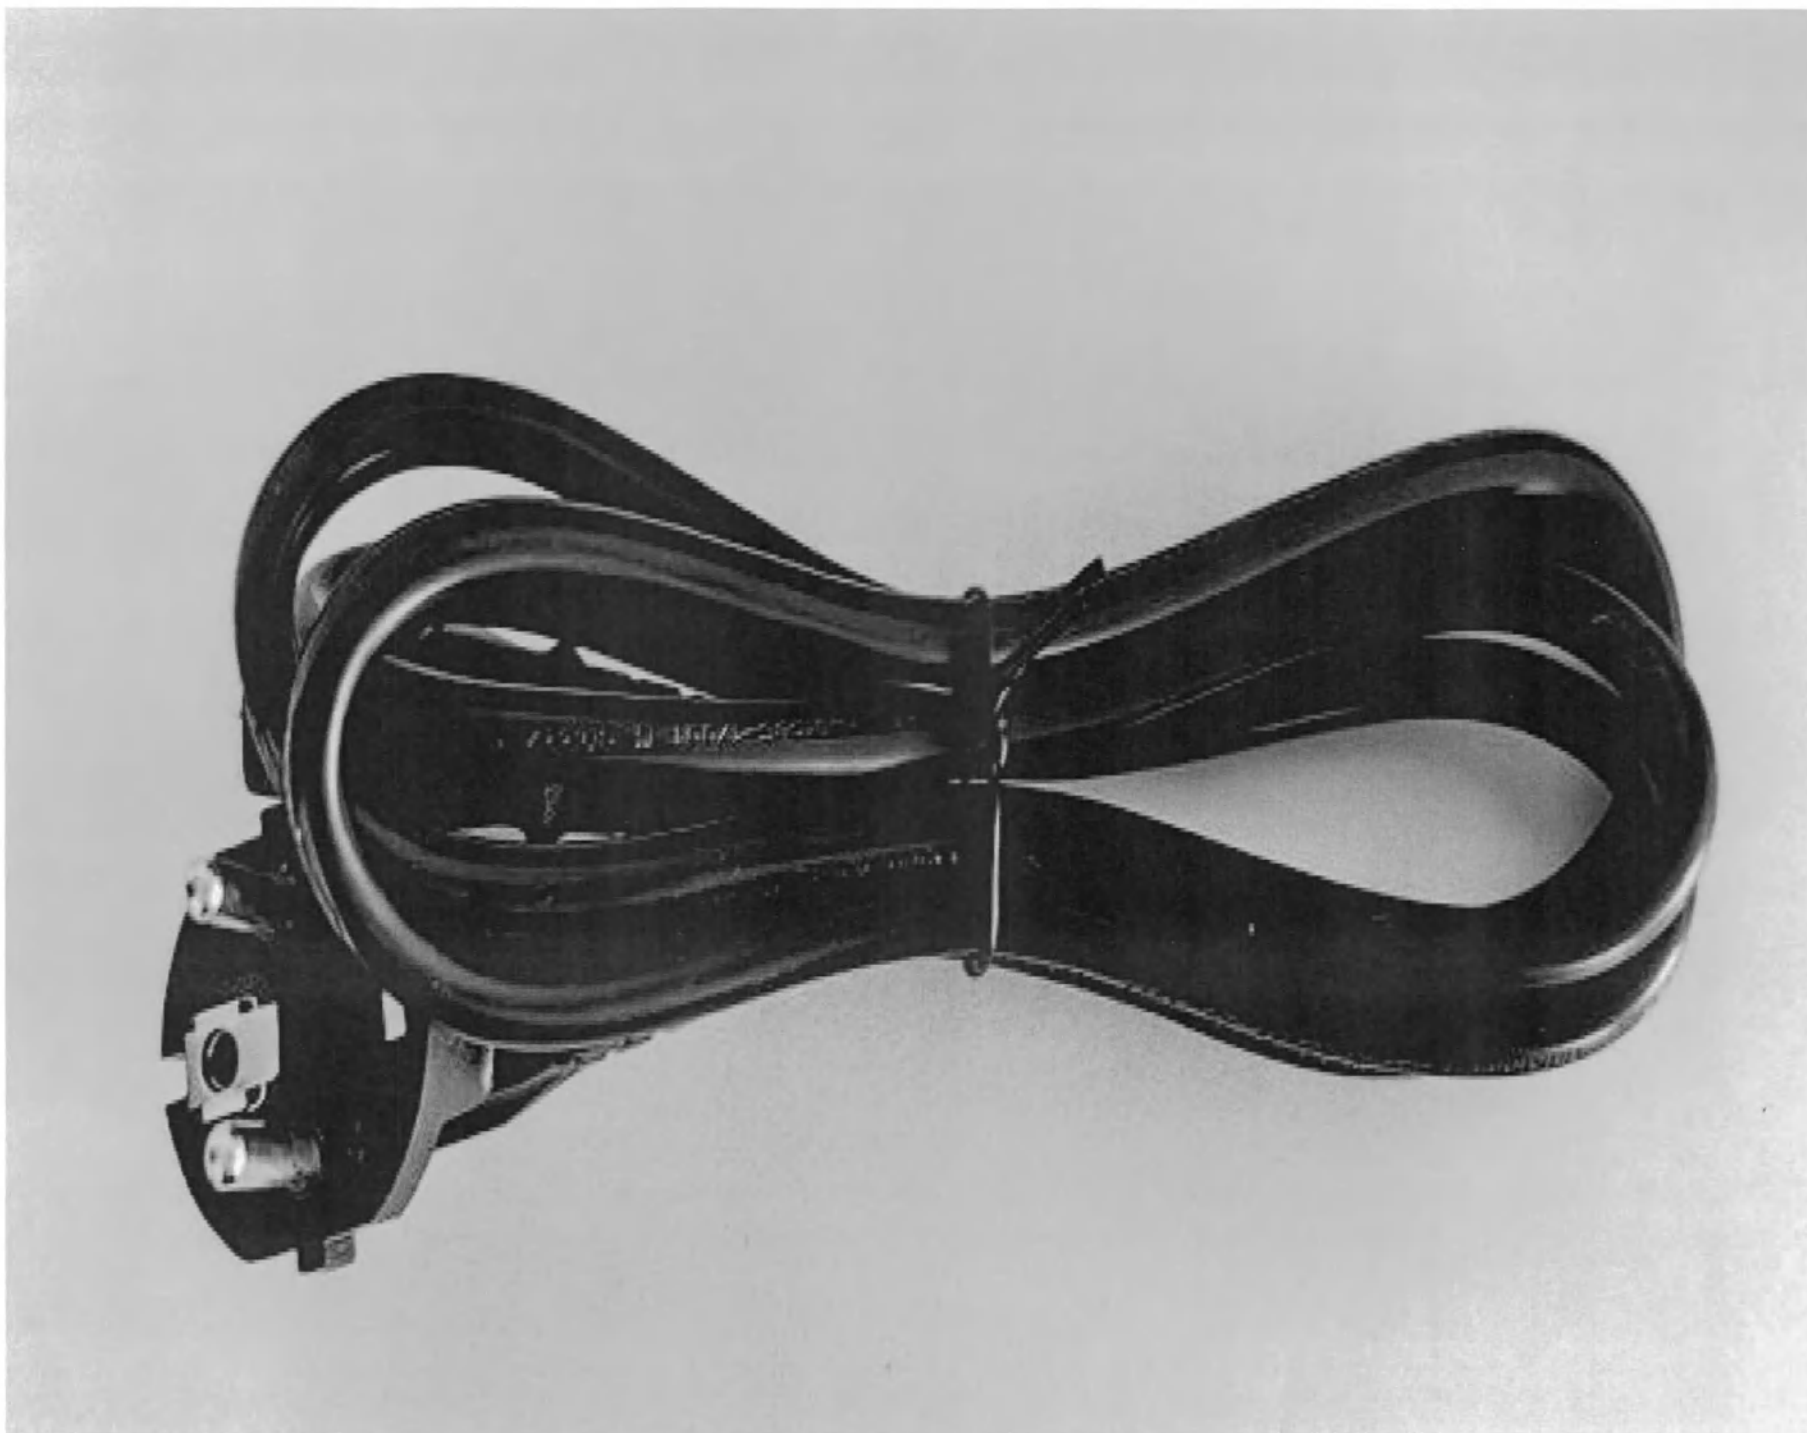



DL

REF 1502040005


Fully Auto Microbial identification and
antimicrobial susceptibility testing system

Model: DL-96A

SN 20230800296A

2023-11-03

100-240V~ 50/60Hz 1100VA




IVD



ZHUHAI DL BIOTECH.CO.,LTD.

19 Jinhaian Rd, Sanzao Town, Jinwan, Zhuhai, Guangdong, 519041, P.R China



Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Анализатор автоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для in vitro диагностики DL-96A



«Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.» («Чжухай ДиЭль Биотех Ко. Лтд.»)

No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai, Guangdong Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Место производства:

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd., No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai,
Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Параметры электропитания:

Напряжение питающей сети переменного тока -

100-240 В переменного тока

Частота питающей сети – 50/60 Гц

Номинальная мощность – 1100 ВА



РУ № РЗН _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «МИРУС МЕДИКАЛ» (ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»)

115114, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Кожевническая, д. 10 стр. 1

Тел.: +7 499 579 3303

E-mail: info@mirus-medical.com

Серийный номер, дата производства и каталожный номер указаны на оригинальной маркировке

Анализатор автоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для in vitro диагностики DL-96A



«Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.» («Чжухай ДиЭль Биотех Ко. Лтд.»)

No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai, Guangdong Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Место производства:

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd., No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai,
Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Количество изделий в упаковке – 1 шт.

Габаритные размеры упаковки: 970 x 720 x 1065 мм

Масса (брутто): 153 кг

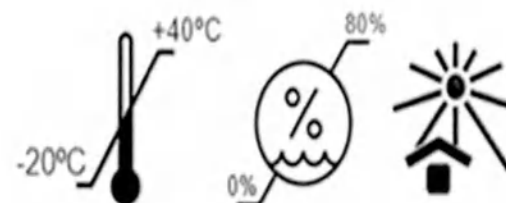

РУ № РЗН _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «МИРУС МЕДИКАЛ» (ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»)


115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Кожевническая, д. 10 стр. 1

Тел.: +7 499 579 3303

E-mail: info@mirus-medical.com

Серийный номер, дата производства и каталожный номер указаны на оригинальной маркировке



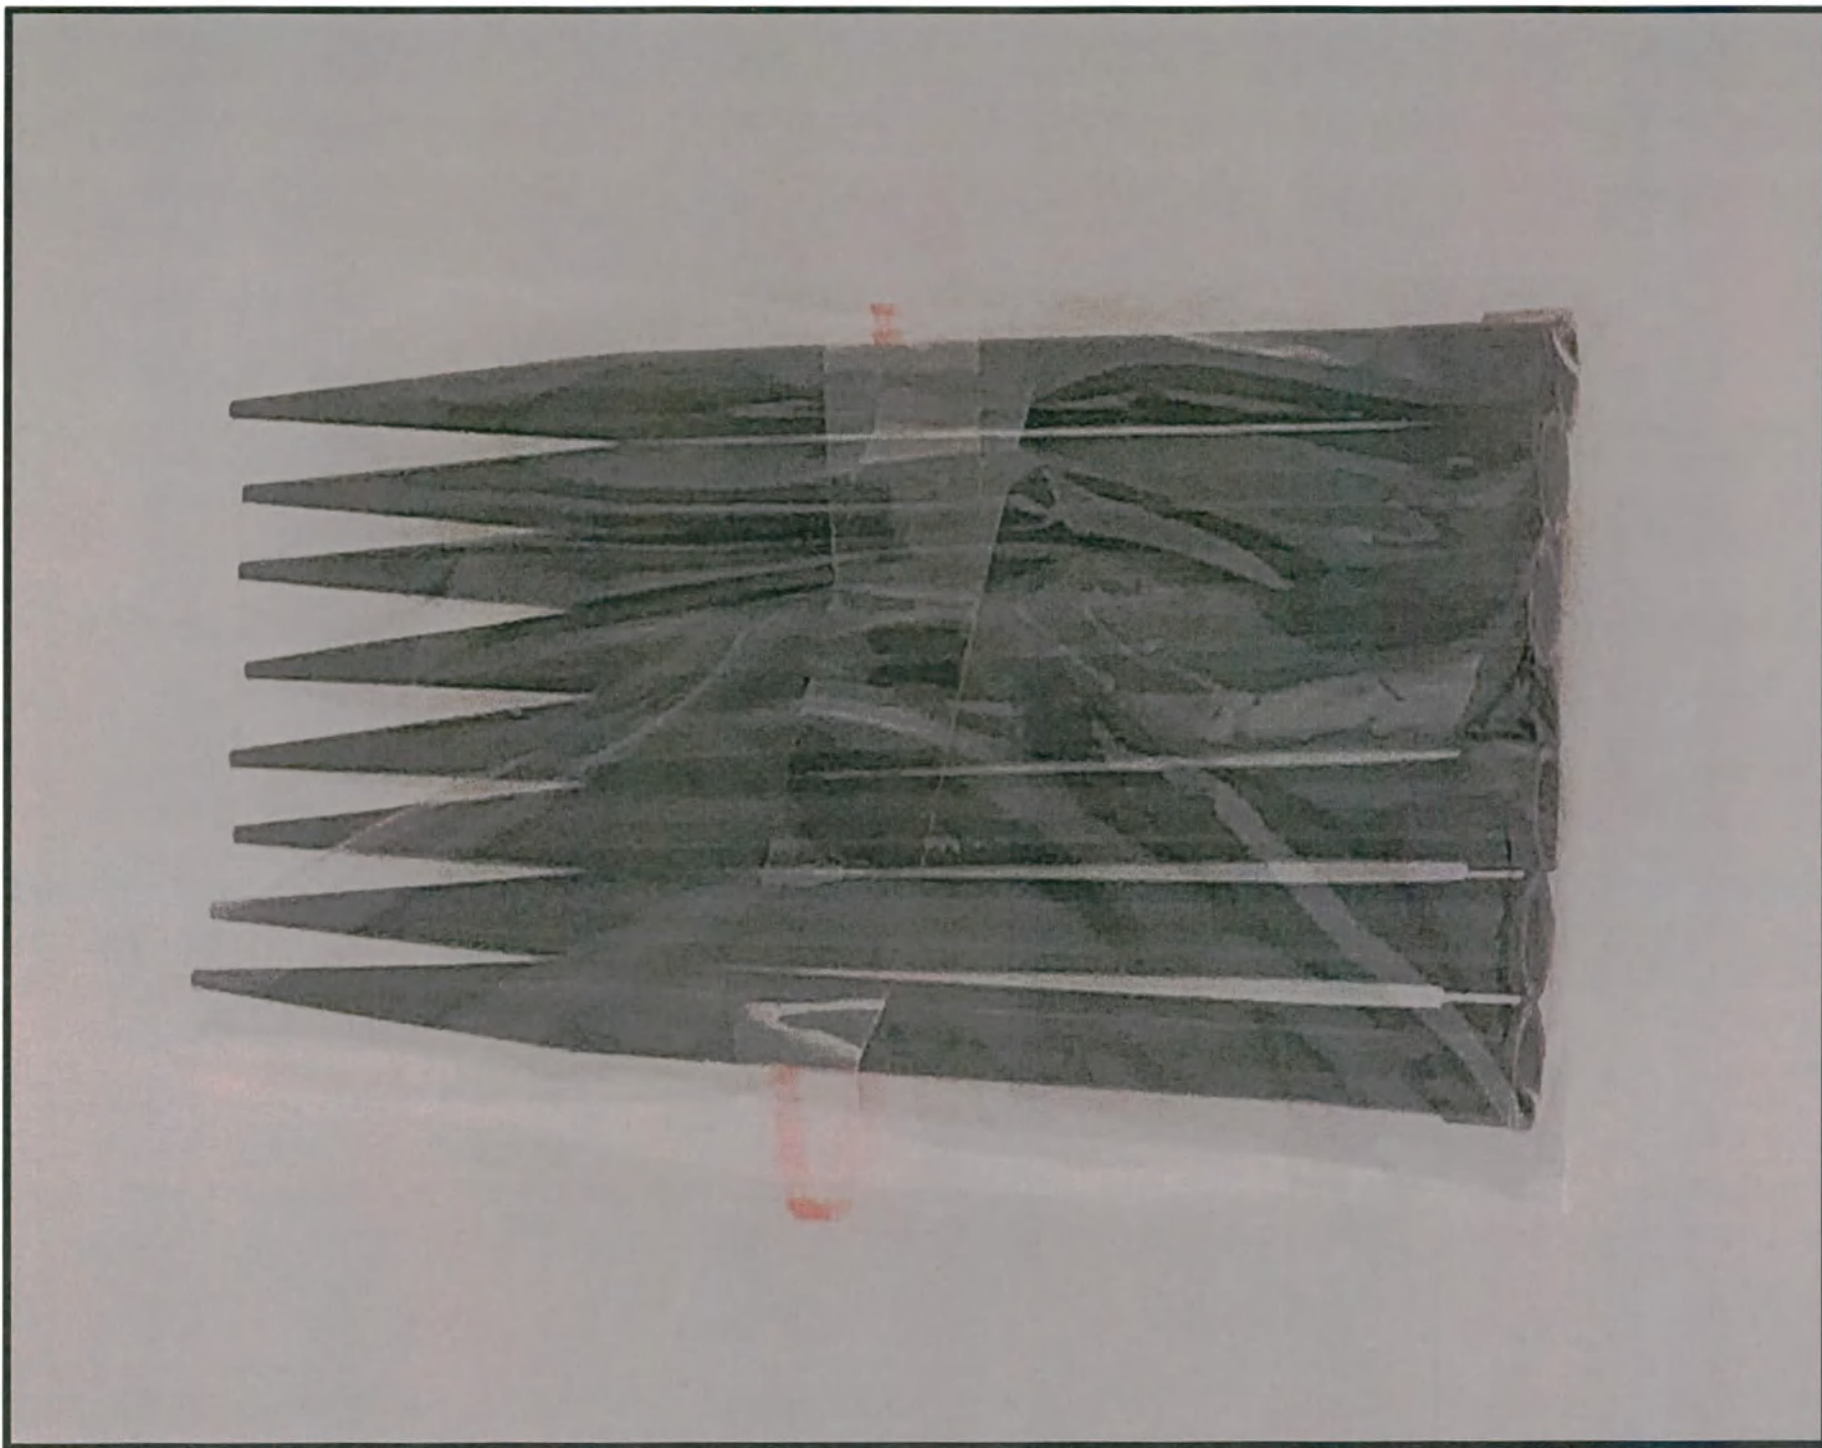




Анализатор полуавтоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для in vitro диагностики D2mini. Основной блок.



Анализатор полуавтоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для in vitro диагностики D2mini. Кабель питания.

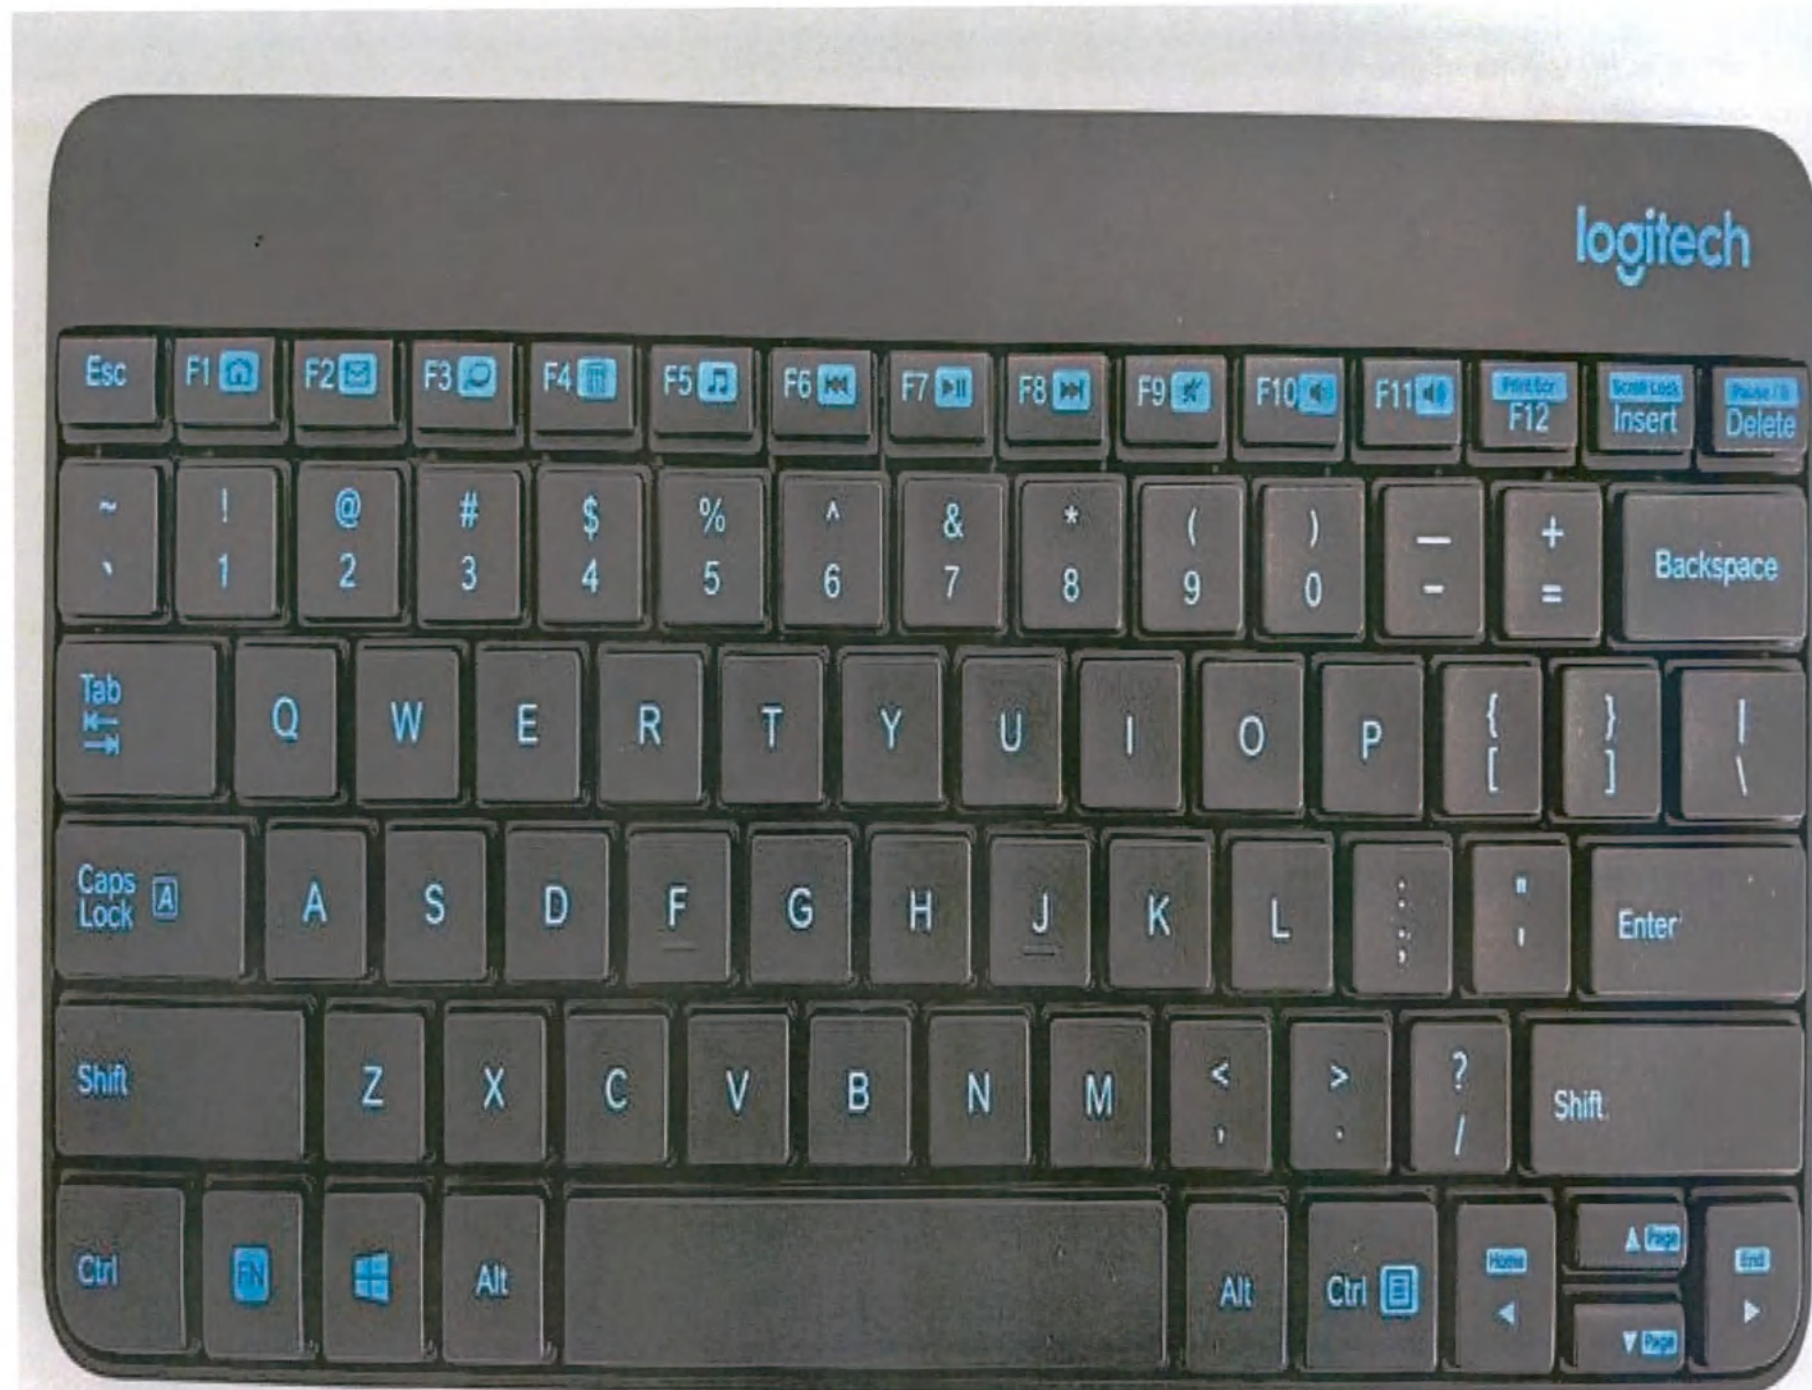

Анализатор полуавтоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для *in vitro* диагностики D2mini.
Клавиатура.



Анализатор полуавтоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для in vitro диагностики D2mini. Мышь.

DL

REF 1403001011

Auto microbial identification and
antimicrobial susceptibility testing system

Model: D2Mini

SN 202310001Mini

2023-11-06

100-240V~ 50/60Hz 120VA



IVD



ZHUHAI DL BIOTECH.CO.,LTD.

19 Jinhaian Rd, Sanzao Town, Jinwan, Zhuhai, Guangdong, 519041, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

IVD

Анализатор автоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для in vitro диагностики D2mini



«Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.» («Чжухай ДиЭль Биотех Ко. Лтд.»)

No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai, Guangdong Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Место производства:

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd., No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai,
Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Параметры электропитания:

Напряжение питающей сети переменного тока -

100-240 В переменного тока

Частота питающей сети – 50/60 Гц

Номинальная мощность – 120 ВА



РУ № РЗН _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «МИРУС МЕДИКАЛ» (ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»)

115114, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Кожевническая, д. 10 стр. 1

Тел.: +7 499 579 3303

E-mail: info@mirus-medical.com

Серийный номер, дата производства и каталожный номер указаны на оригинальной маркировке

Анализатор автоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для in vitro диагностики D2mini



«Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.» («Чжухай ДиЭль Биотех Ко. Лтд.»)

No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai, Guangdong Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Место производства:

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd., No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai,
Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Габаритные размеры упаковки: 375 x 335 x 395 мм

Масса (брутто): 6,2 кг

Количество изделий в упаковке – 1 шт.

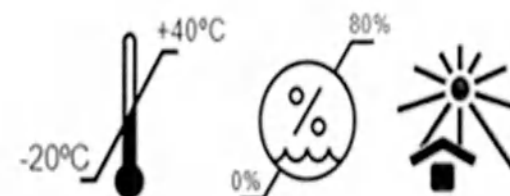

РУ № РЗН _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «МИРУС МЕДИКАЛ» (ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»)

115114, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Кожевническая, д. 10 стр. 1

Тел.: +7 499 579 3303

E-mail: info@mirus-medical.com

Серийный номер, дата производства и каталожный номер указаны на оригинальной маркировке




Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

OPERATING MANUAL

/ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Automatic analyzer for identification of microorganisms and determination of sensitivity to antimicrobial drugs for in vitro diagnostics in various versions/
Анализатор автоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для in vitro диагностики в вариантах исполнения

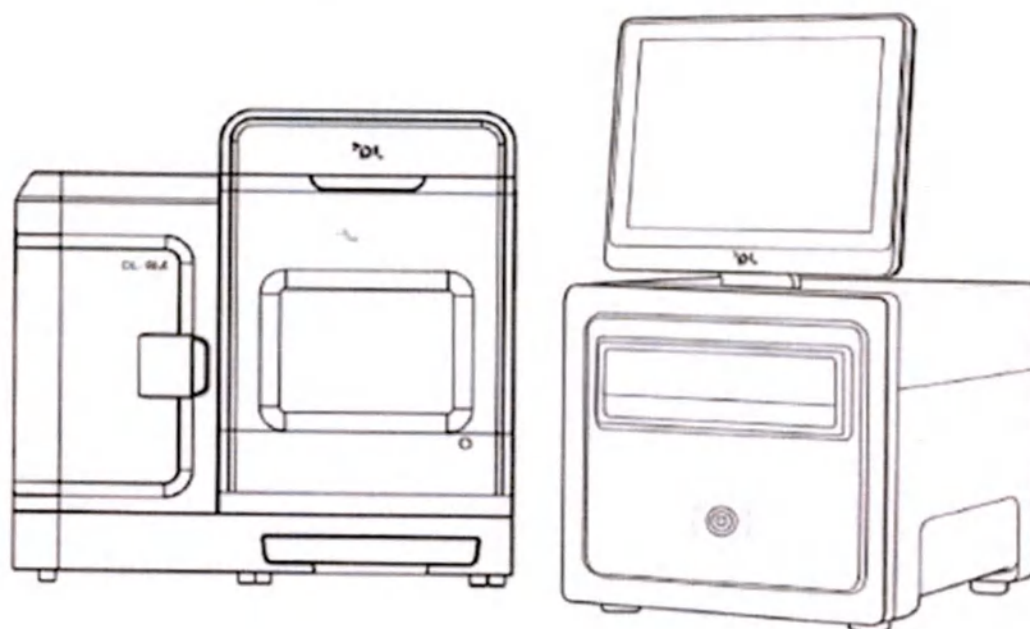

Manufacturer/ Производитель

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd., No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong Province, 519040, P.R. China

«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ»
CEO / Исполнительный Директор
Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

Lin Huaqing

Stamp/печать



Date: 03-03-2024

Rev. 1.0, 03-2024 / Ред. 1.0, 03-2024



Транспортная упаковка меллипинского изделия. Анализатор автоматический для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам для in vitro диагностики DL-96A



Прошито, пронумеровано

20 (двадцать) листа(ов)

ООО «Мирус Медикал»

Данилов П.А. 

