
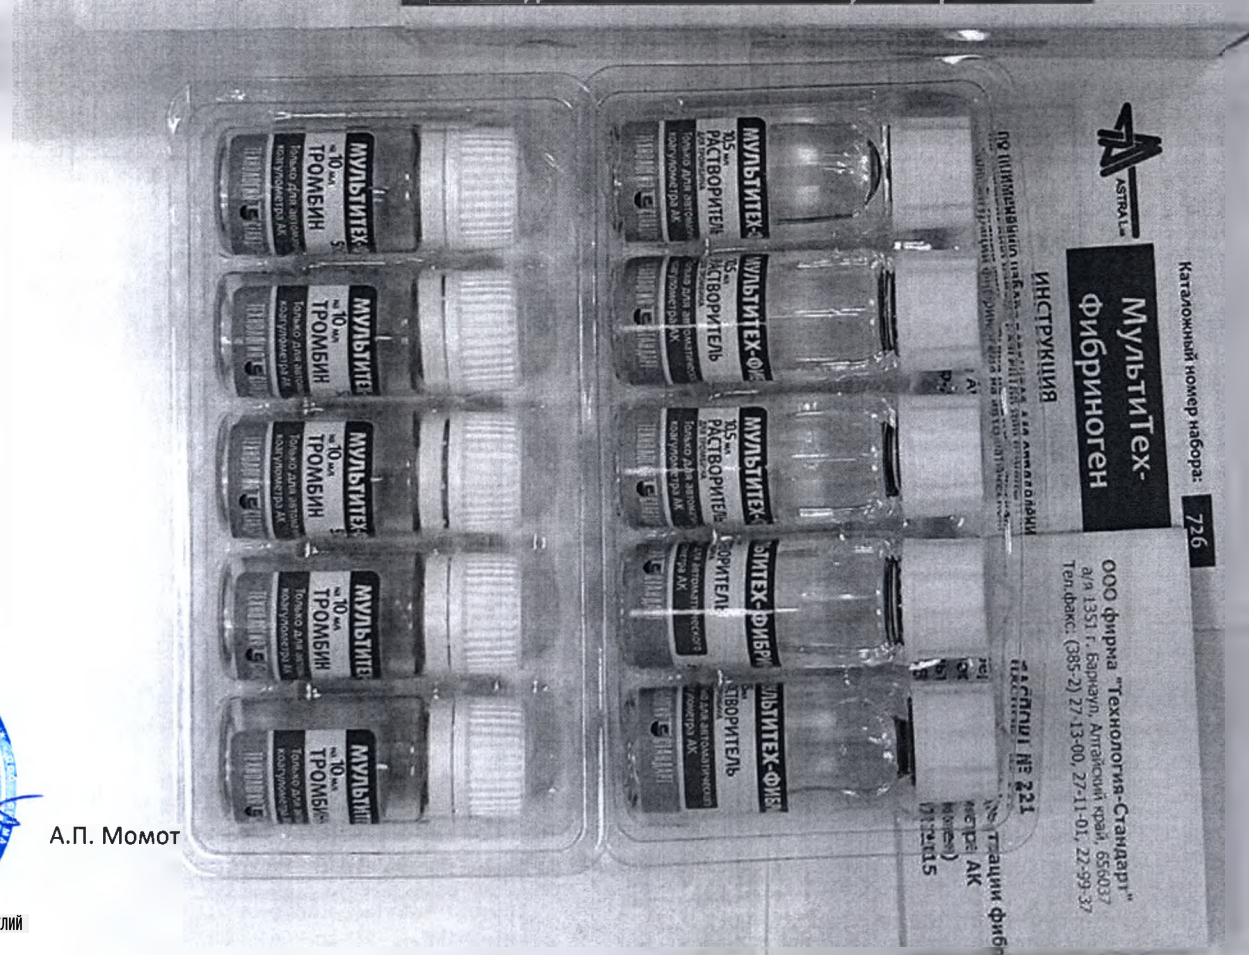


Внешний вид «Набор реагентов для определения концентрации фибриногена на автоматическом коагулометре АК (МультиТех-Фибриноген) по ТУ 9398-051-42349142-2015». Комплектация № 1

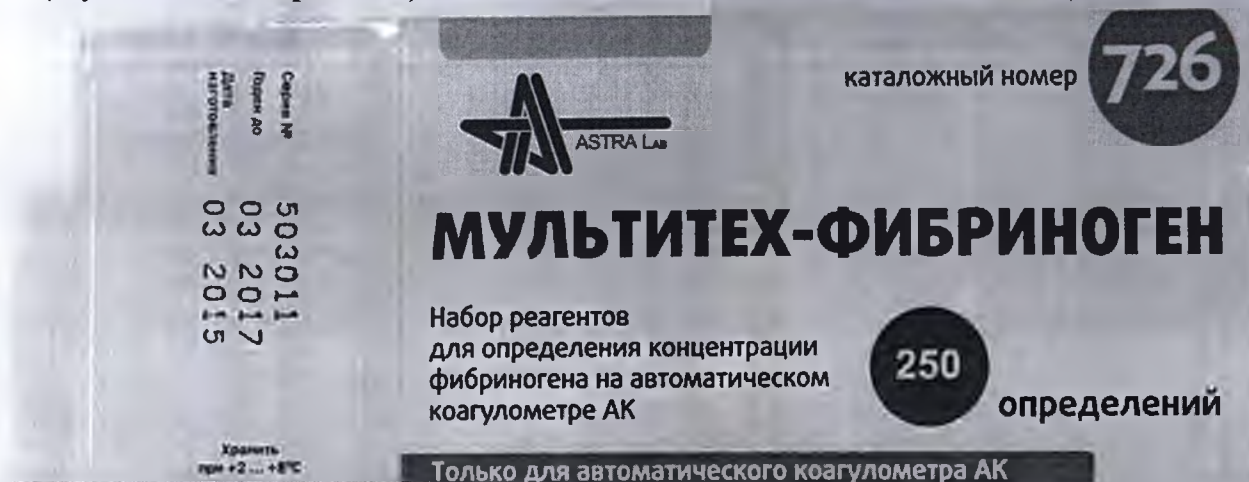

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

Внешний вид «Набор реагентов для определения концентрации фибриногена на автоматическом коагулометре АК
(МультиТех-Фибриноген) по ТУ 9398-051-42349142-2015». Комплектация № 2

Серия №
Годен до
Дата
изготовления

503014
08 2016
03 2015

Хранить
при +2...+8°C



каталожный номер

756

МУЛЬТИТЕХ-ФИБРИНОГЕН

Набор реагентов
для определения концентрации
фибриногена на автоматическом
коагулометре АК

250

определений

Только для автоматического коагулометра АК



Директор ООО фирмы

«Технология-Стандарт»

А.П. Мом...

НАЧЕНИЕ

Используется для определения
концентрации фибриногена на автоматическом
коагулометре АК
(на 250 опр.)

МультиТех-
фибриноген

Каталожный номер набора: 756

ПАСПОРТ № 231

для определения концентрации фиб-
риногена на автоматическом коагулометре АК
(МультиТех-Фибриноген)
ТУ 9398-051-42349142-2015

Внешний вид «Набор реагентов для определения концентрации фибриногена на автоматическом коагулометре АК (МультиТех-Фибриноген) по ТУ 9398-051-42349142-2015». Комплектация № 3

Серия №
Code до
Готов

503023
8 5016
03 2015

Хранить
при +2...+8°C



каталожный номер

МУЛЬТИТЕХ-ФИБРИНОГЕН

Набор реагентов
для определения концентрации
фибриногена на автоматическом
коагулометре АК

125

определений

Только для автоматического коагулометра АК



ООО фирма "Технология-Стандарт"
а/я 1351 г. Барнаул, Алтайский край,
тел. факс: (385-2) 27-13-00, 27-11-01,

Каталожный номер набора:

ПАСПОРТ № 231

реагентов для определения концентрации
автоматическом коагулометре АК
(МультиТех-Фибриноген)
ТУ 9398-051-42349142-2015

ASTRA Lab

**МультиТех-
Фибриноген**

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения
концентрации фибриногена на автоматическом
коагулометре АК
(на 125 опр.)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор МультиТех-Фибриноген предназначен для количествен-

директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3/14/11 листов
Руководитель В.И. Мещеряков
27.04.2016 20/16 г.

