

*Фотографические изображения медицинского изделия*

**Набор реагентов IST Card (DL-96STAPH) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам стафилококков и грамположительных кокков с положительным тестом на каталазу на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики**

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе

ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»



Данилов П. А.

«10» декабря

2024 г.



# IST Card (DL-96 STAPH)

OPEN

10 tests/box

**Composition:** 10 DL-96 STAPH test cards

10 vials of broth

10 vials of diluent

6 vials of auxiliary reagent

LOT: 2024022501  
P.D: 20240225  
EXP: 20250224

**Intended use:** For identification and antimicrobial MIC of Staphylococcus catalase-test-positive Gram-positive coccus.

**For use with DL microbial ID/AST system**

IVD

EU

See the Lot number, Production Date and Expiry Date on the seal.

Model: DL-96 STAPH CE



In vitro diagnostic reagent

REF 2601003007

# DLIST Card

Набор реагентов IST Card (DL-96STAPH) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам стафилококков и грамположительных кокков с положительным тестом на каталазу на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сверху)




Набор реагентов IST Card (DL-96STAPH) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам стафилококков и грамположительных кокков с положительным тестом на каталазу на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сбоку)




Набор реагентов IST Card (DL-96STAPH) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам стафилококков и грамположительных кокков с положительным тестом на каталазу на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сзади)





Общий вид медицинского изделия.

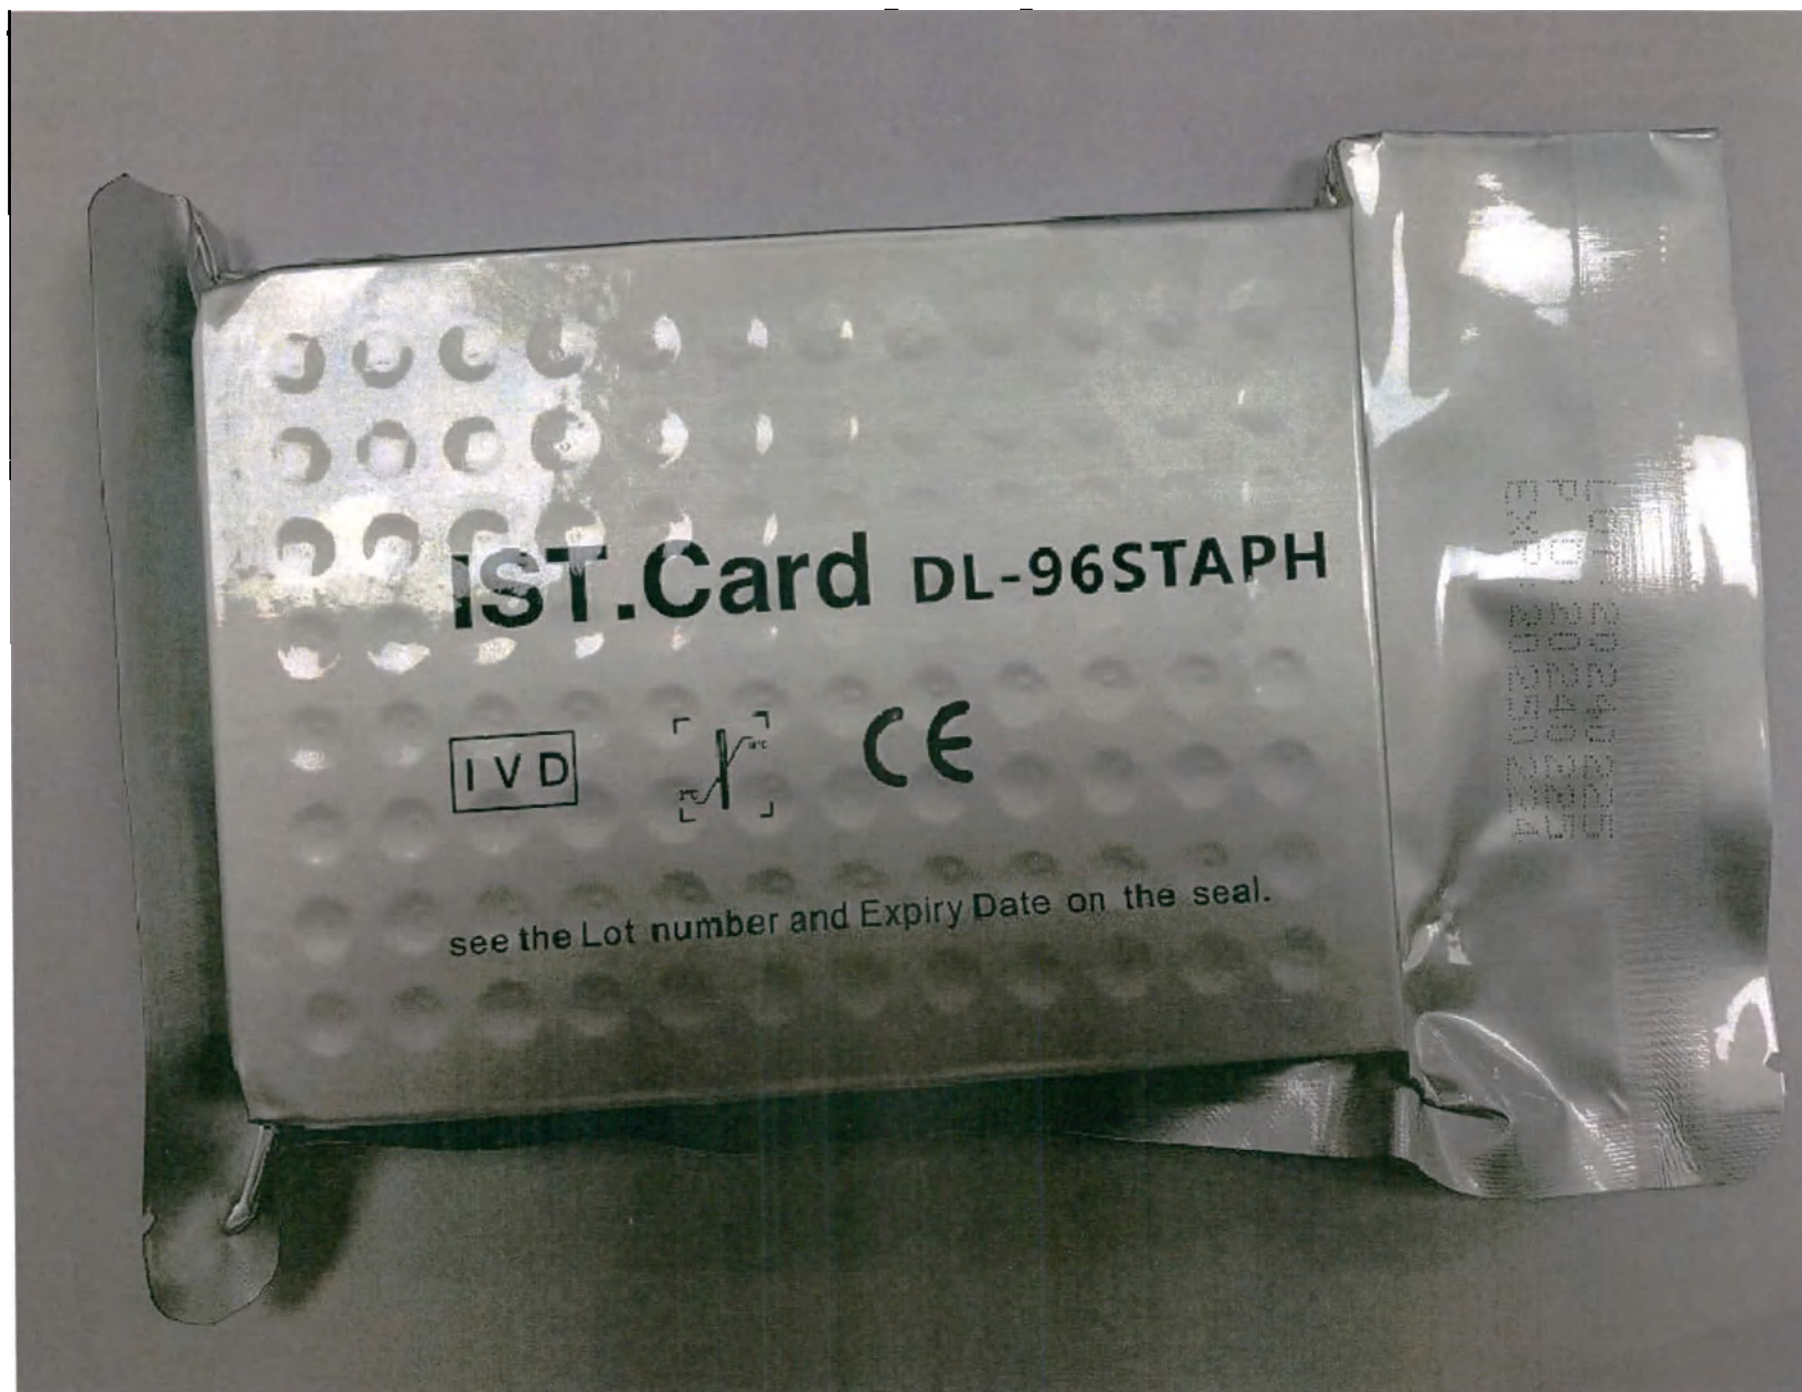

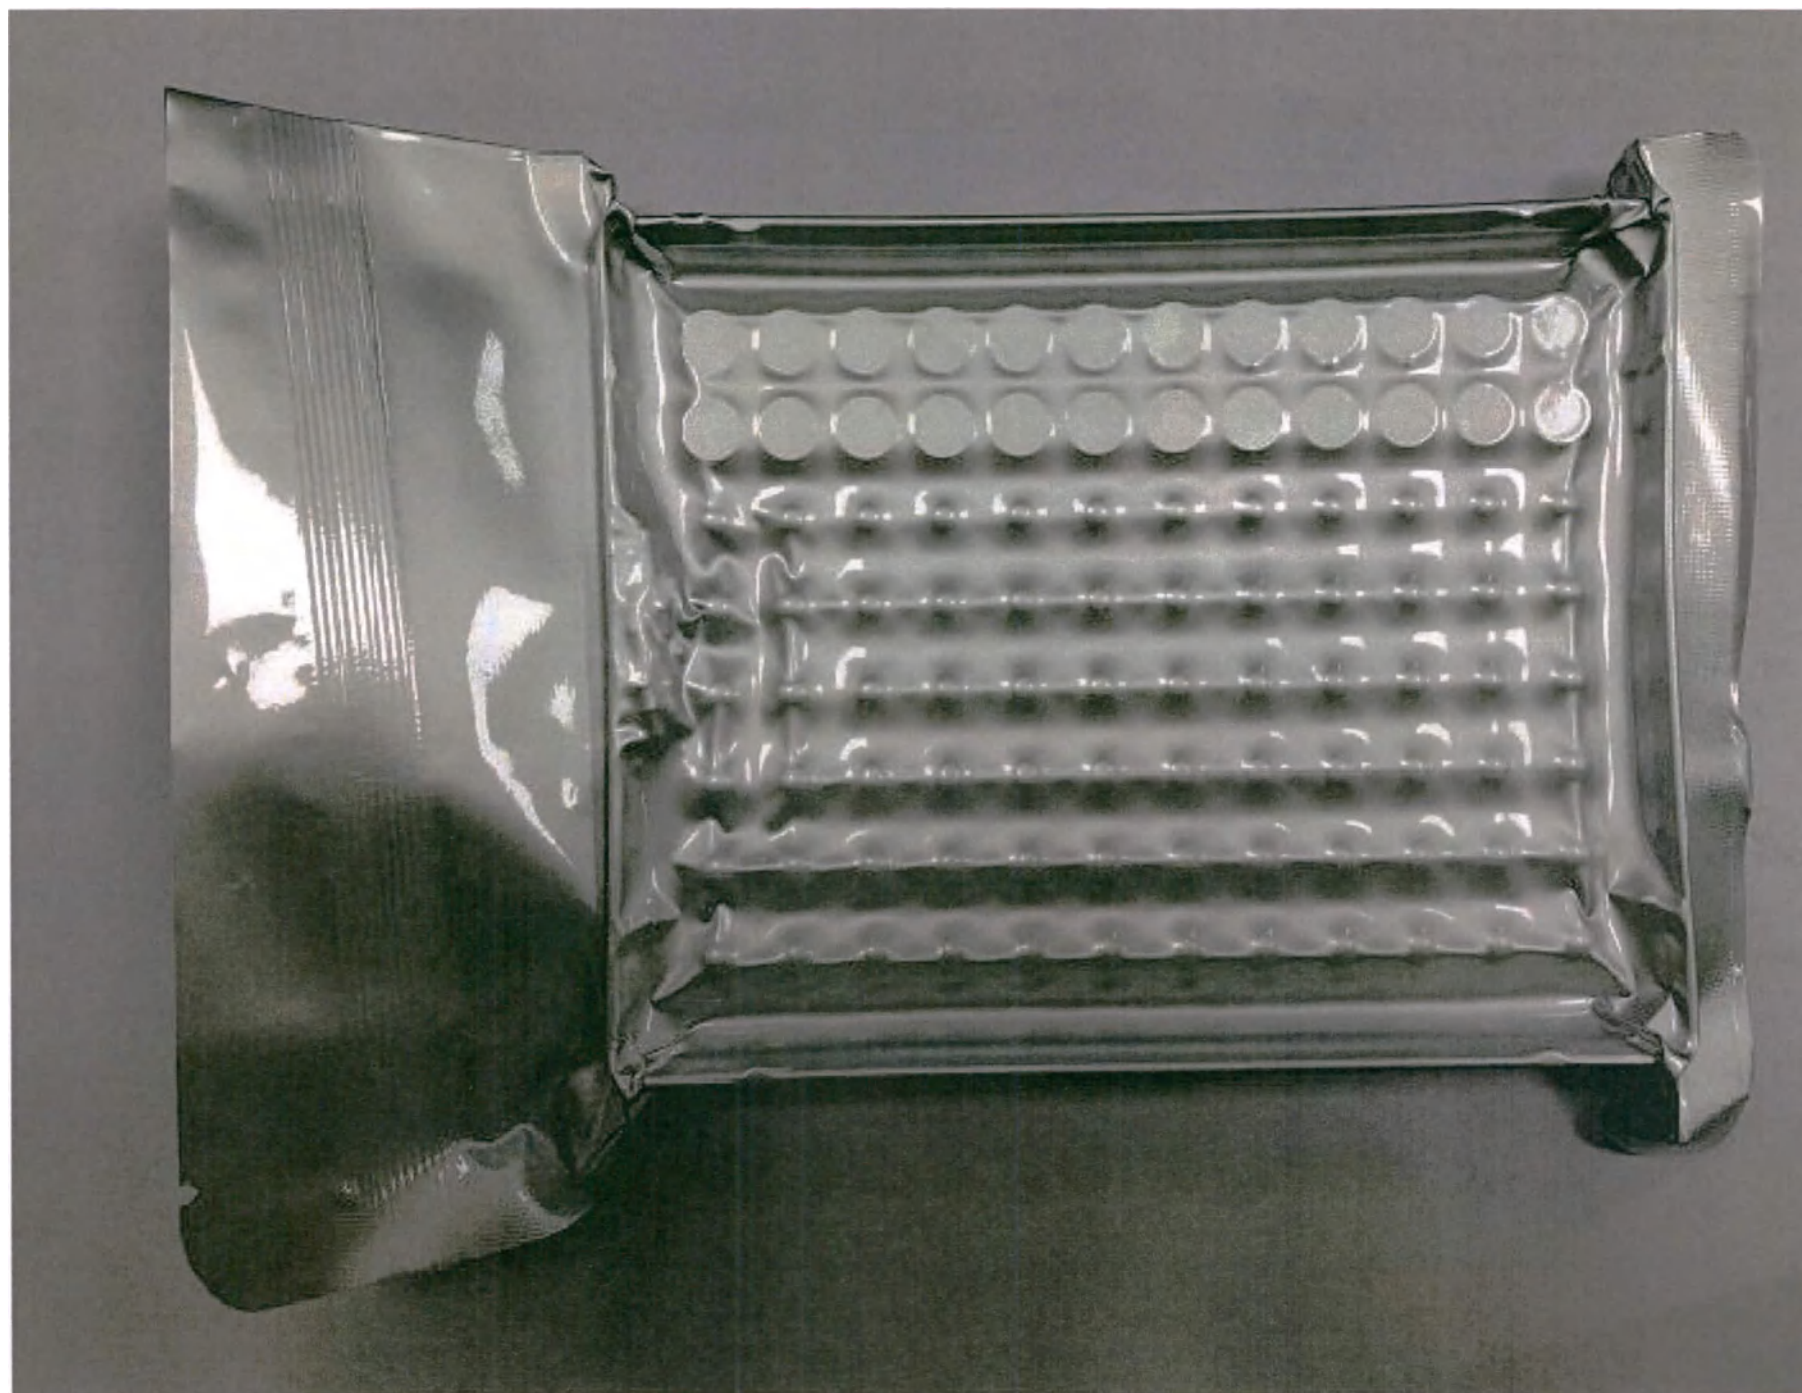

Тестовая карта IST Card (DL-96STAPH) (вид снизу)

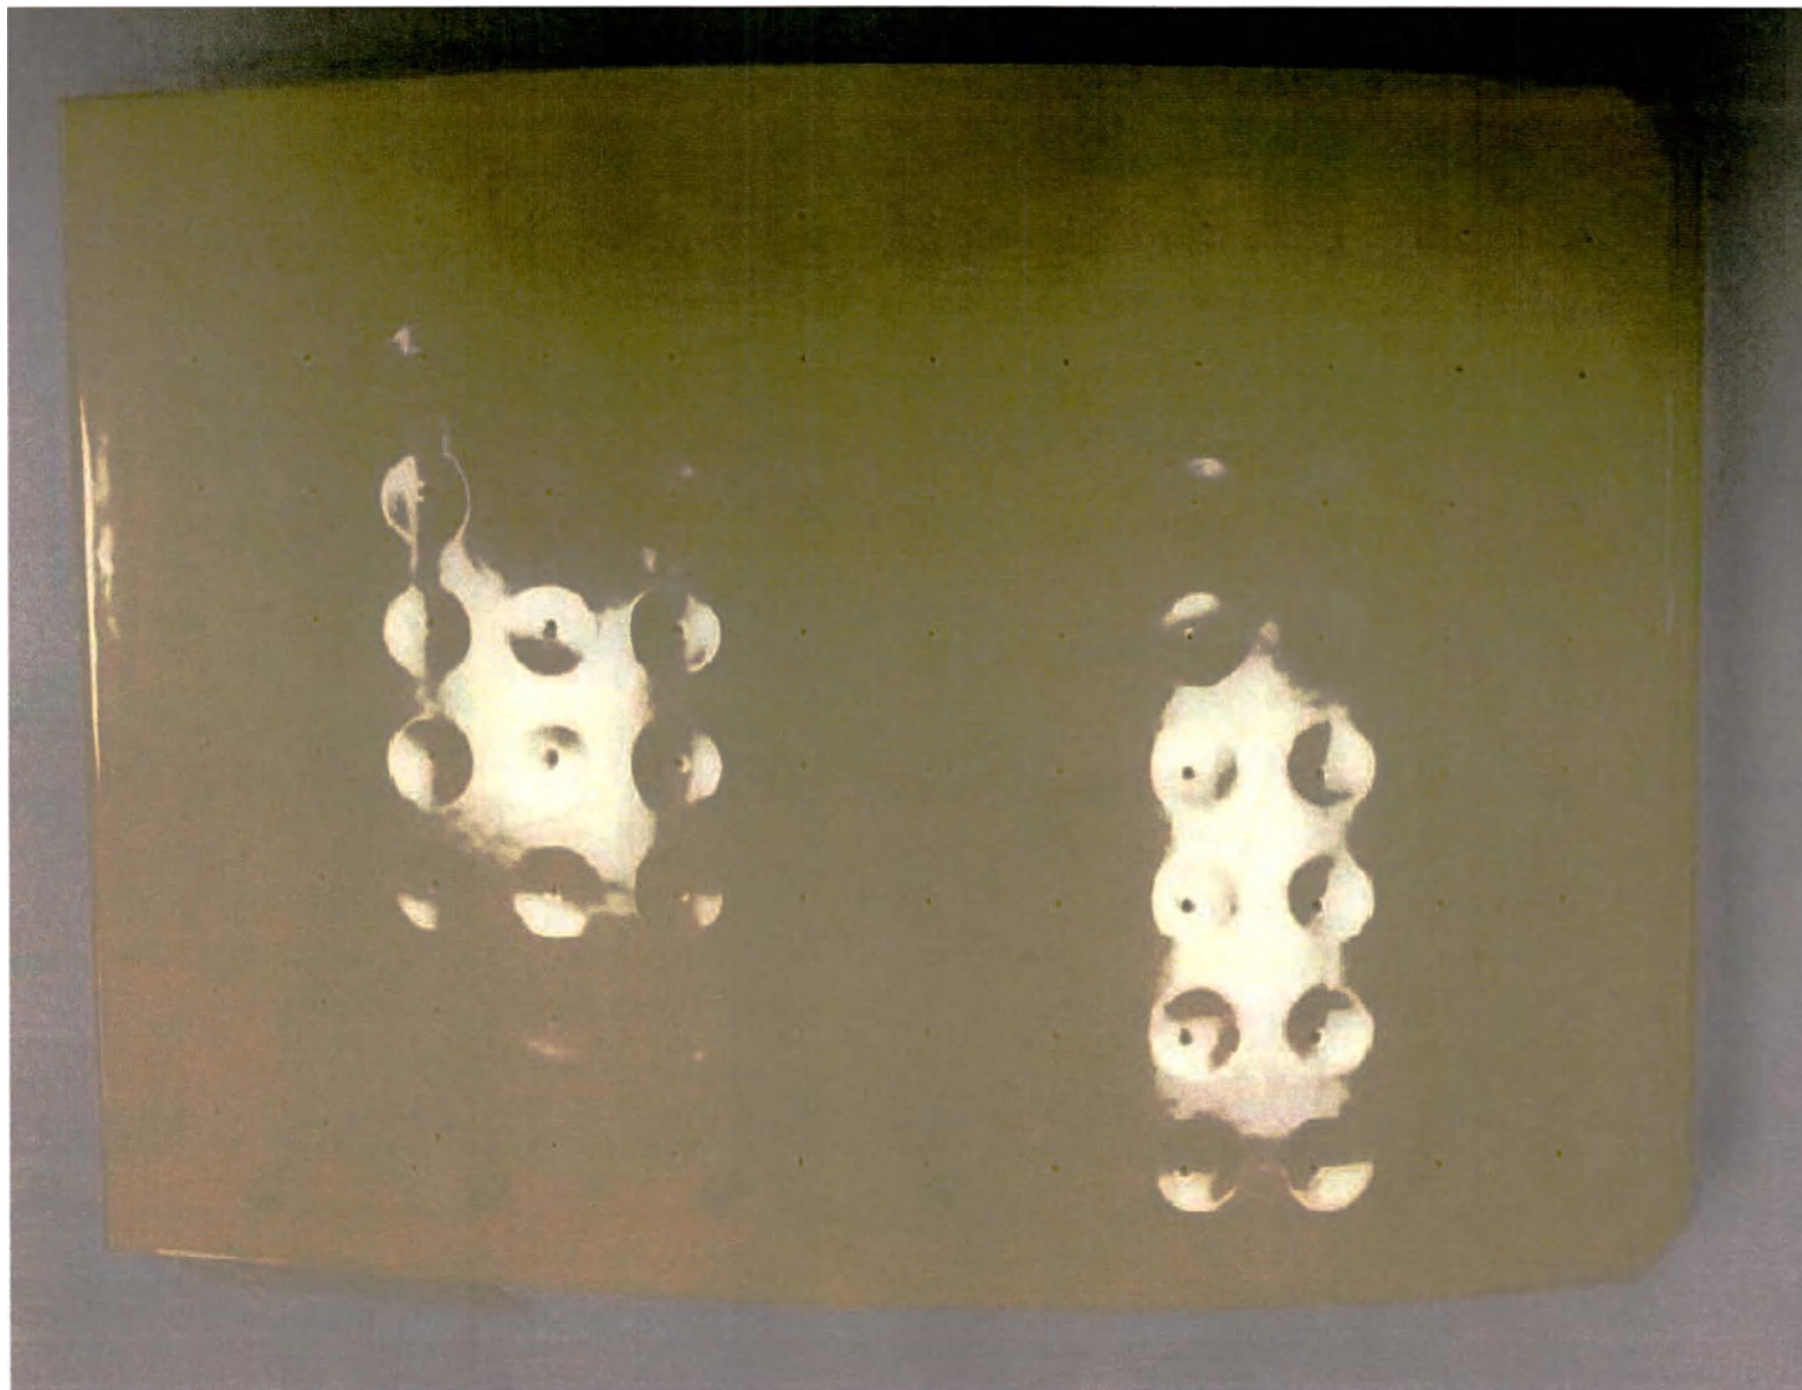

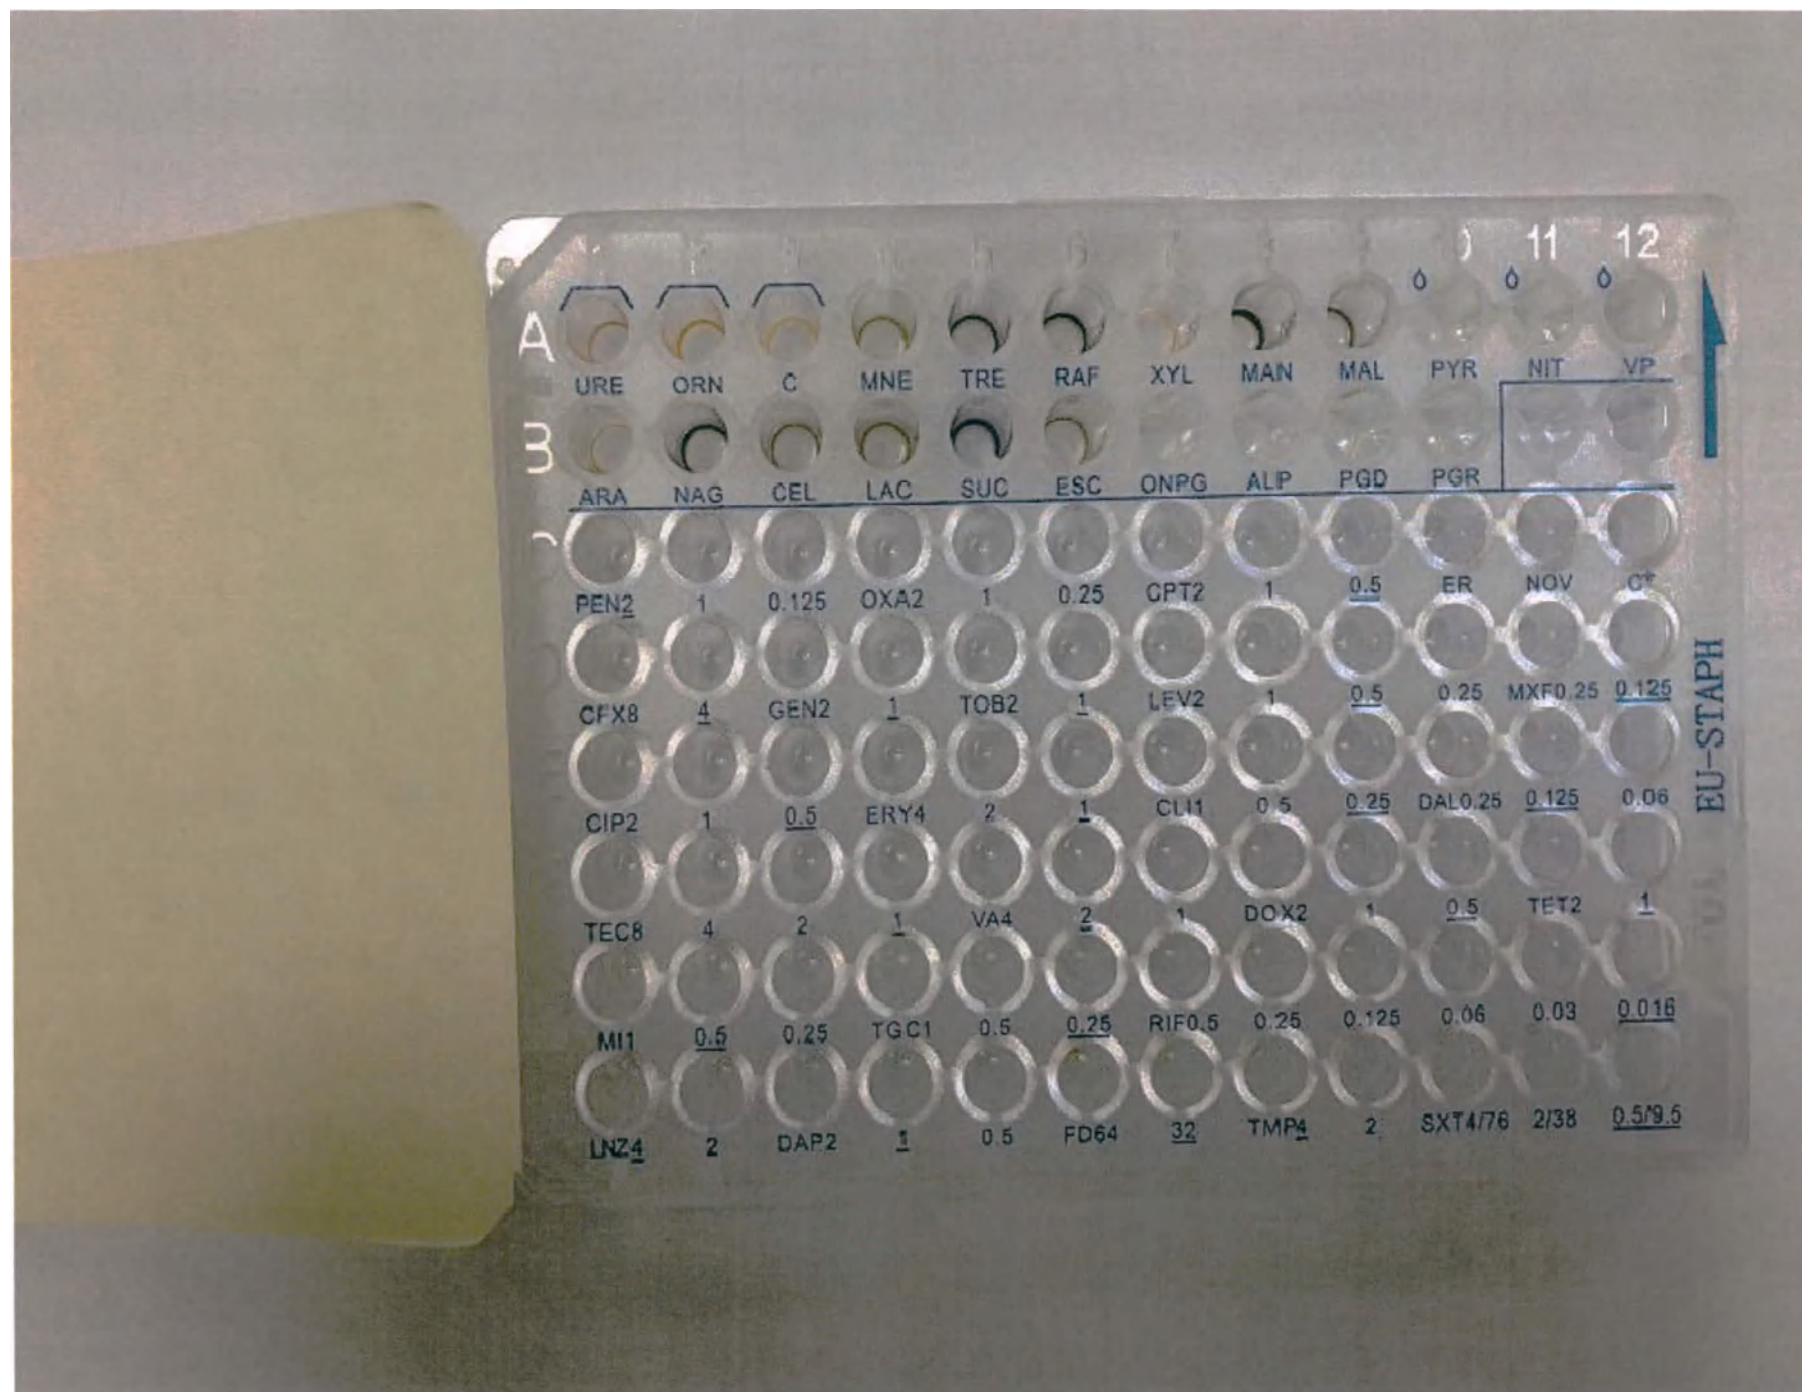


Тестовая карта IST Card (DL-96STAPH) (вид сверху)





Дилуэнт (4,5 мл)

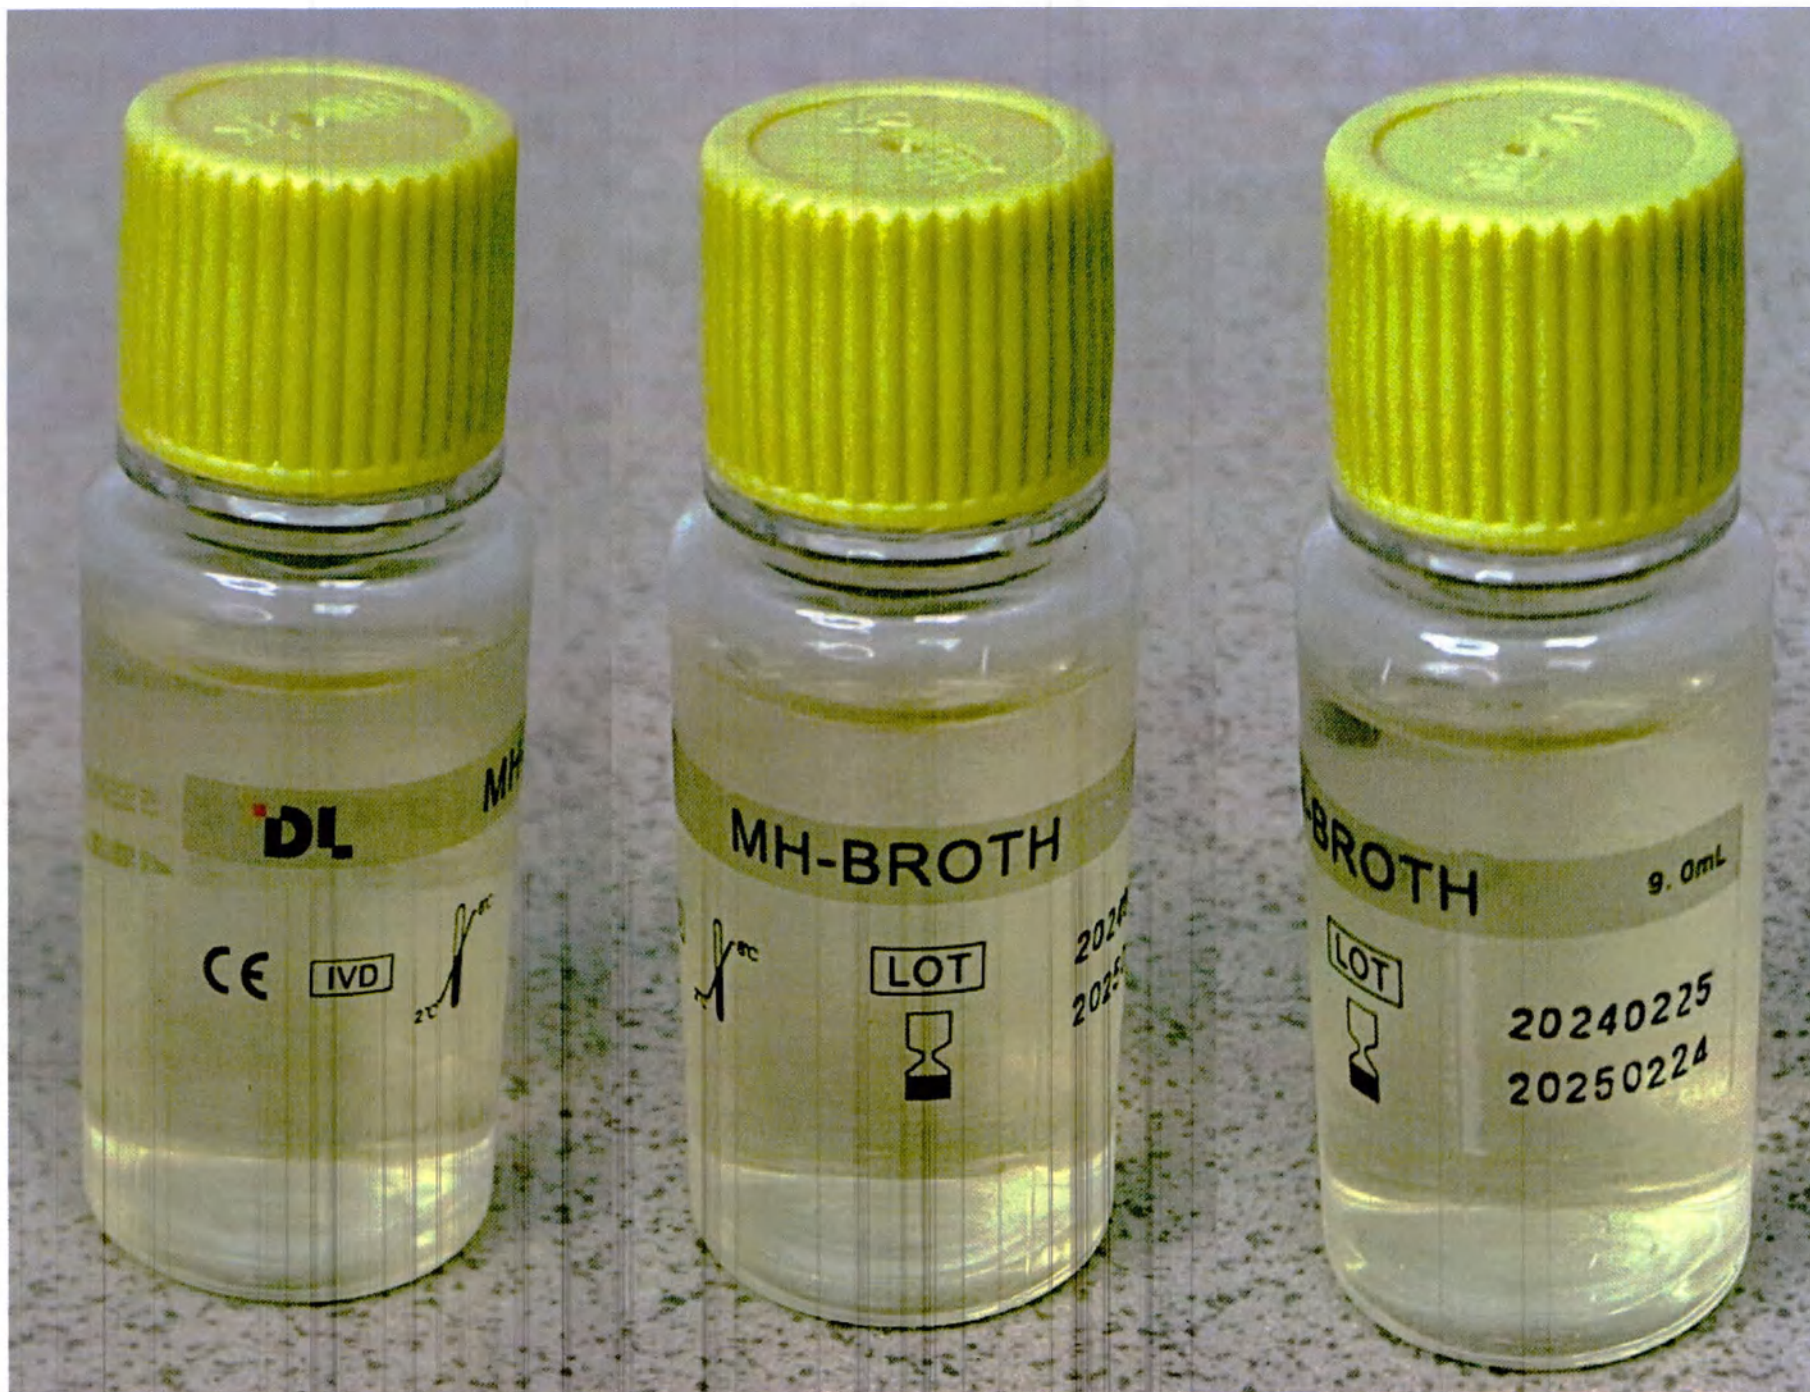

МН-бульона (9,0 мл)



Вспомогательный реагент VP A (2,0 мл)



Вспомогательный реагент VP B (2,0 мл)



Вспомогательный реагент NIT A (2,0 мл)



Вспомогательный реагент NIT B (2,0 мл)



Вспомогательный реагент PYR (1,5 мл)



Парафиновое масло стерильное (7,0 мл)

**Набор реагентов IST Card (DL-96STAPH) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам стафилококков и грамположительных кокков с положительным тестом на каталазу на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики, в составе:**

1. → Тестовая карта IST Card (DL-96STAPH) — 10 шт.
2. → Дилуэнт (4,5 мл) — 10 флаконов
3. → МН-бульон (9,0 мл) — 10 флаконов
4. → Вспомогательный реагент VP-A (2,0 мл) — 1 флакон
5. → Вспомогательный реагент VP-B (2,0 мл) — 1 флакон
6. → Вспомогательный реагент NIT-A (2,0 мл) — 1 флакон
7. → Вспомогательный реагент NIT-B (2,0 мл) — 1 флакон
8. → Вспомогательный реагент PYR (1,5 мл) — 1 флакон
9. → Парафиновое масло стерильное (7,0 мл) — 1 флакон
10. Инструкция по применению — 1 шт.

**Уполномоченный представитель производителя в РФ:**

Общество с ограниченной ответственностью «МИРУС МЕДИКАЛ» (ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»)

Адрес: 115114, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ. КОЖЕВНИЧЕСКАЯ, Д. 10-СТР. 1

Тел.: +7 499 579 3303

E-mail: [info@mirus-medical.com](mailto:info@mirus-medical.com)

**Производитель:**

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd. (Чжухай ДиЭль Биотех Ко. Лтд)

Адрес: No. 59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам стафилококков и грамположительных кокков с положительным тестом на каталазу.**

**Для применения с автоматическими анализаторами для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам**

**Реагенты для диагностики in vitro.**

**Хранить при температуре от +2°C до +8°C**

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.



Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

## INSTRUCTION FOR USE / ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Reagent Kit IST Card (DL-96STAPH) for identification and determination of antimicrobial sensitivity of staphylococci and gram-positive cocci with a positive catalase test on DL-96A and D2mini analyzers for in vitro diagnostics**

**/ Набор реагентов IST Card (DL-96STAPH) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам стафилококков и грамположительных кокков с положительным тестом на каталазу на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики**

**Manufacturer/ Производитель**

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd., No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong Province, 519040, P.R. China

«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ»

CEO / Исполнительный Директор  
Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

Lin Huaqing

Stamp/печать



Date: 03-03-2024

Rev. 1.0, 03-2024 / Ред. 1.0, 03-2024



Прошито, пронумеровано

21 двадцать один листа(ов)

ООО «Мирус Медиал»

Данилов П.А.

