

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов DL-96FUNGUS IST Card для идентификации грибов и определения чувствительности к противогрибковым препаратам на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики

«УТВЕРЖДАЮ»


Заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе

ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»



Данилов П. А.

«10» декабря

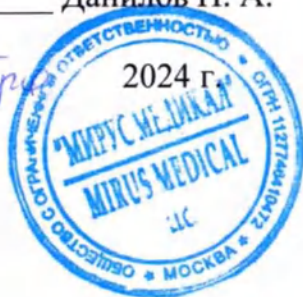

DL-96FUNGUS IST Card

For biochemical identification and susceptibility test of clinical yeast-like fungi

LOT



see the seal

IVD

REF 2601005008

Composition:

- 10 DL-96FUNGUS test cards
- 10 vials of diluent
- 10 vials of assimilation diluent
- 10 vials of AST diluent

For use with DL microbial ID/AST system




ZHUHAI DL BIOTECH CO., LTD.


19 Jinkai Rd, Sanzao Town, Liwan, Zhuhai, Guangdong, 519041, P.R. China

EC

REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Effestraße 83, 20837 Hamburg, Germany



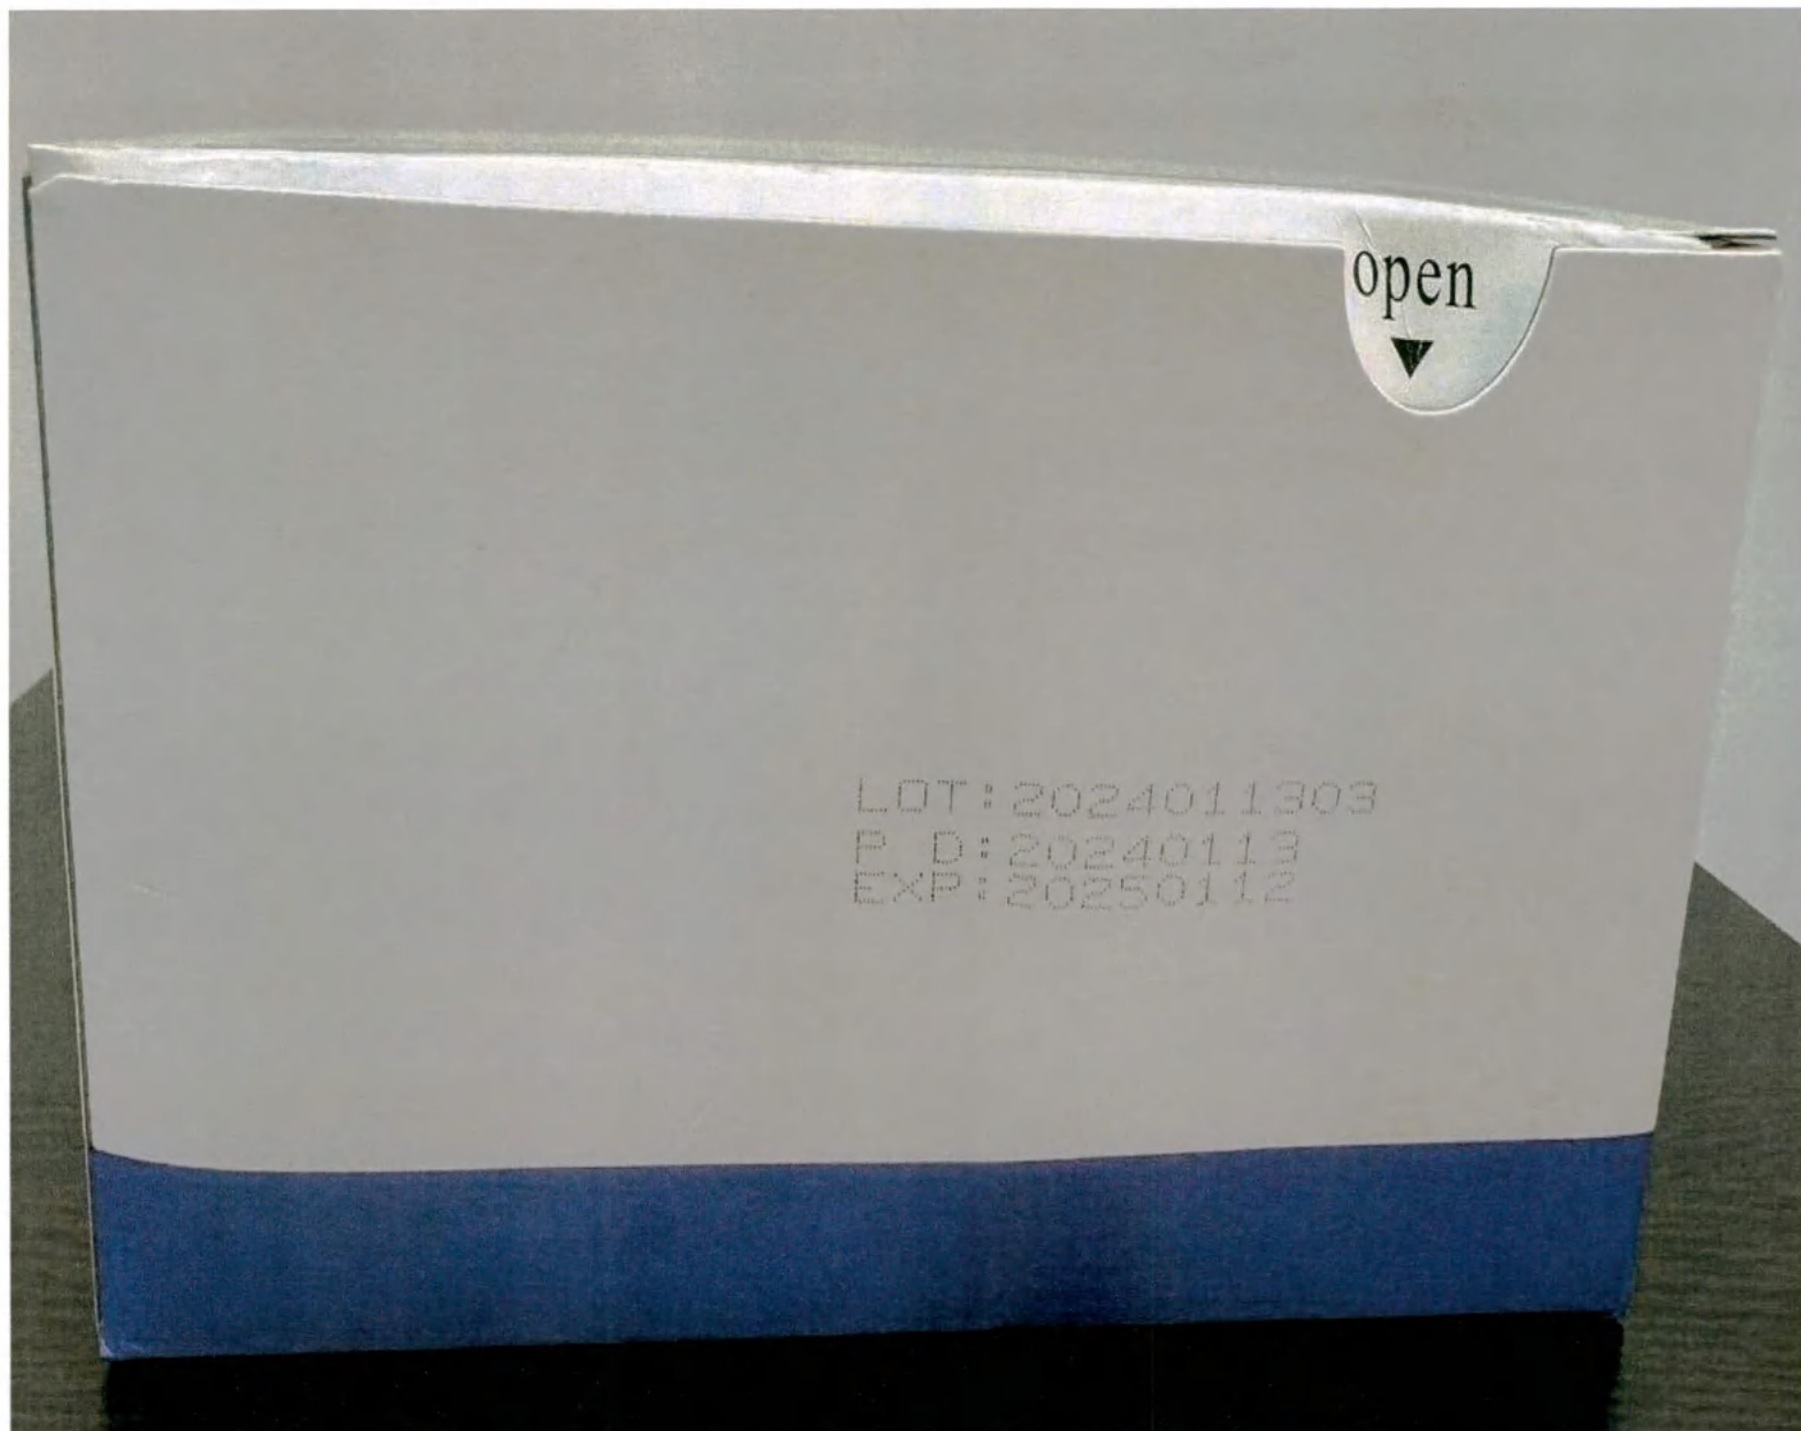


Набор реагентов DL-96FUNGUS IST Card для идентификации грибов и определения чувствительности к противогрибковым препаратам на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сбоку)




Общий вид медицинского изделия.




Тестовая карта DL-96FUNGUS IST Card в упаковке (вид сверху)

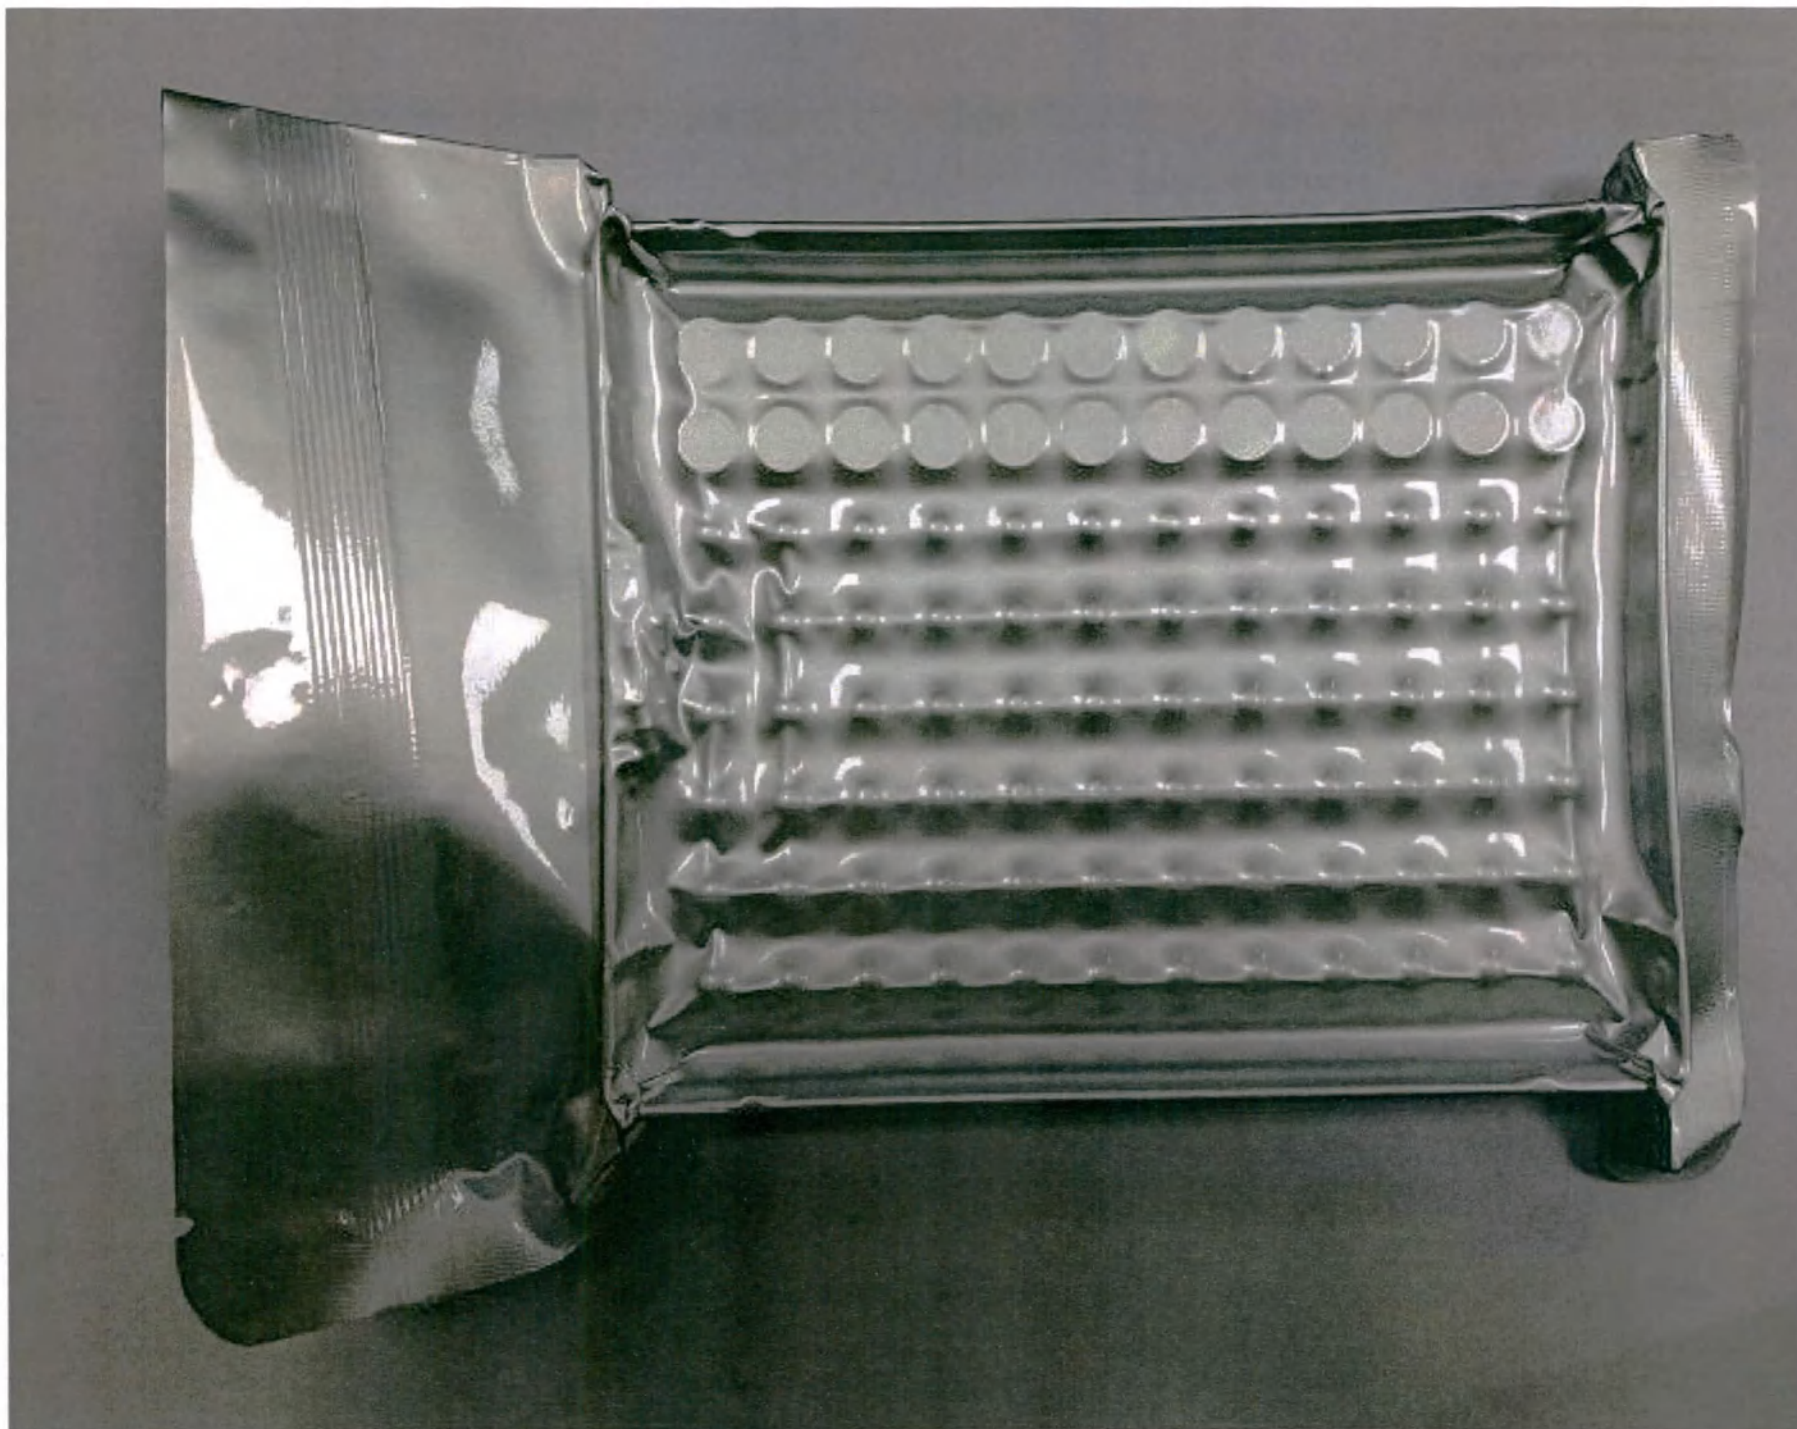

Тестовая карта DL-96FUNGUS IST Card в упаковке (вид снизу)

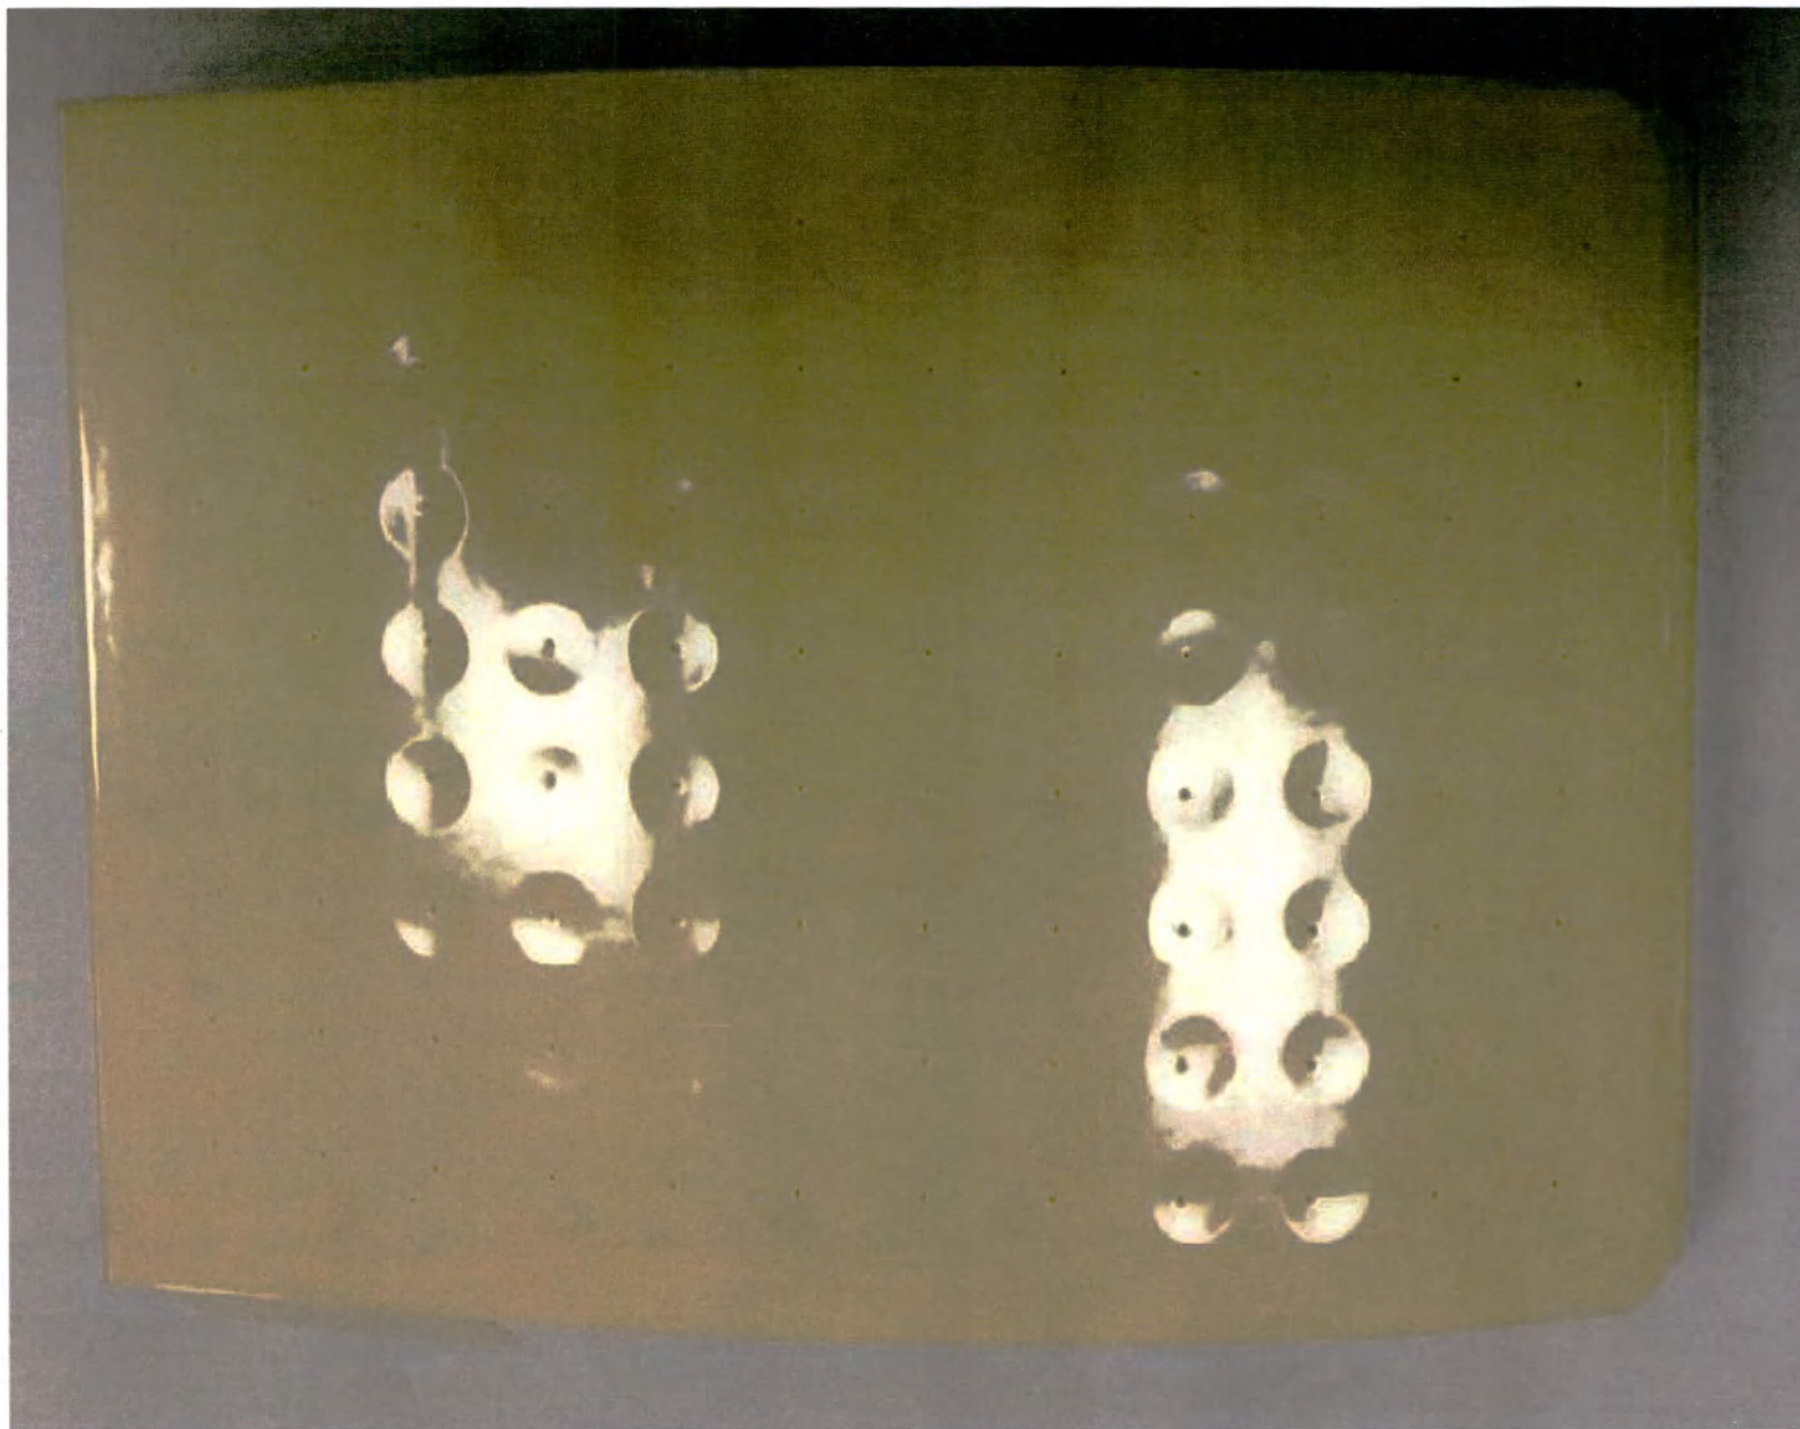

Тестовая карта DL-96FUNGUS IST Card

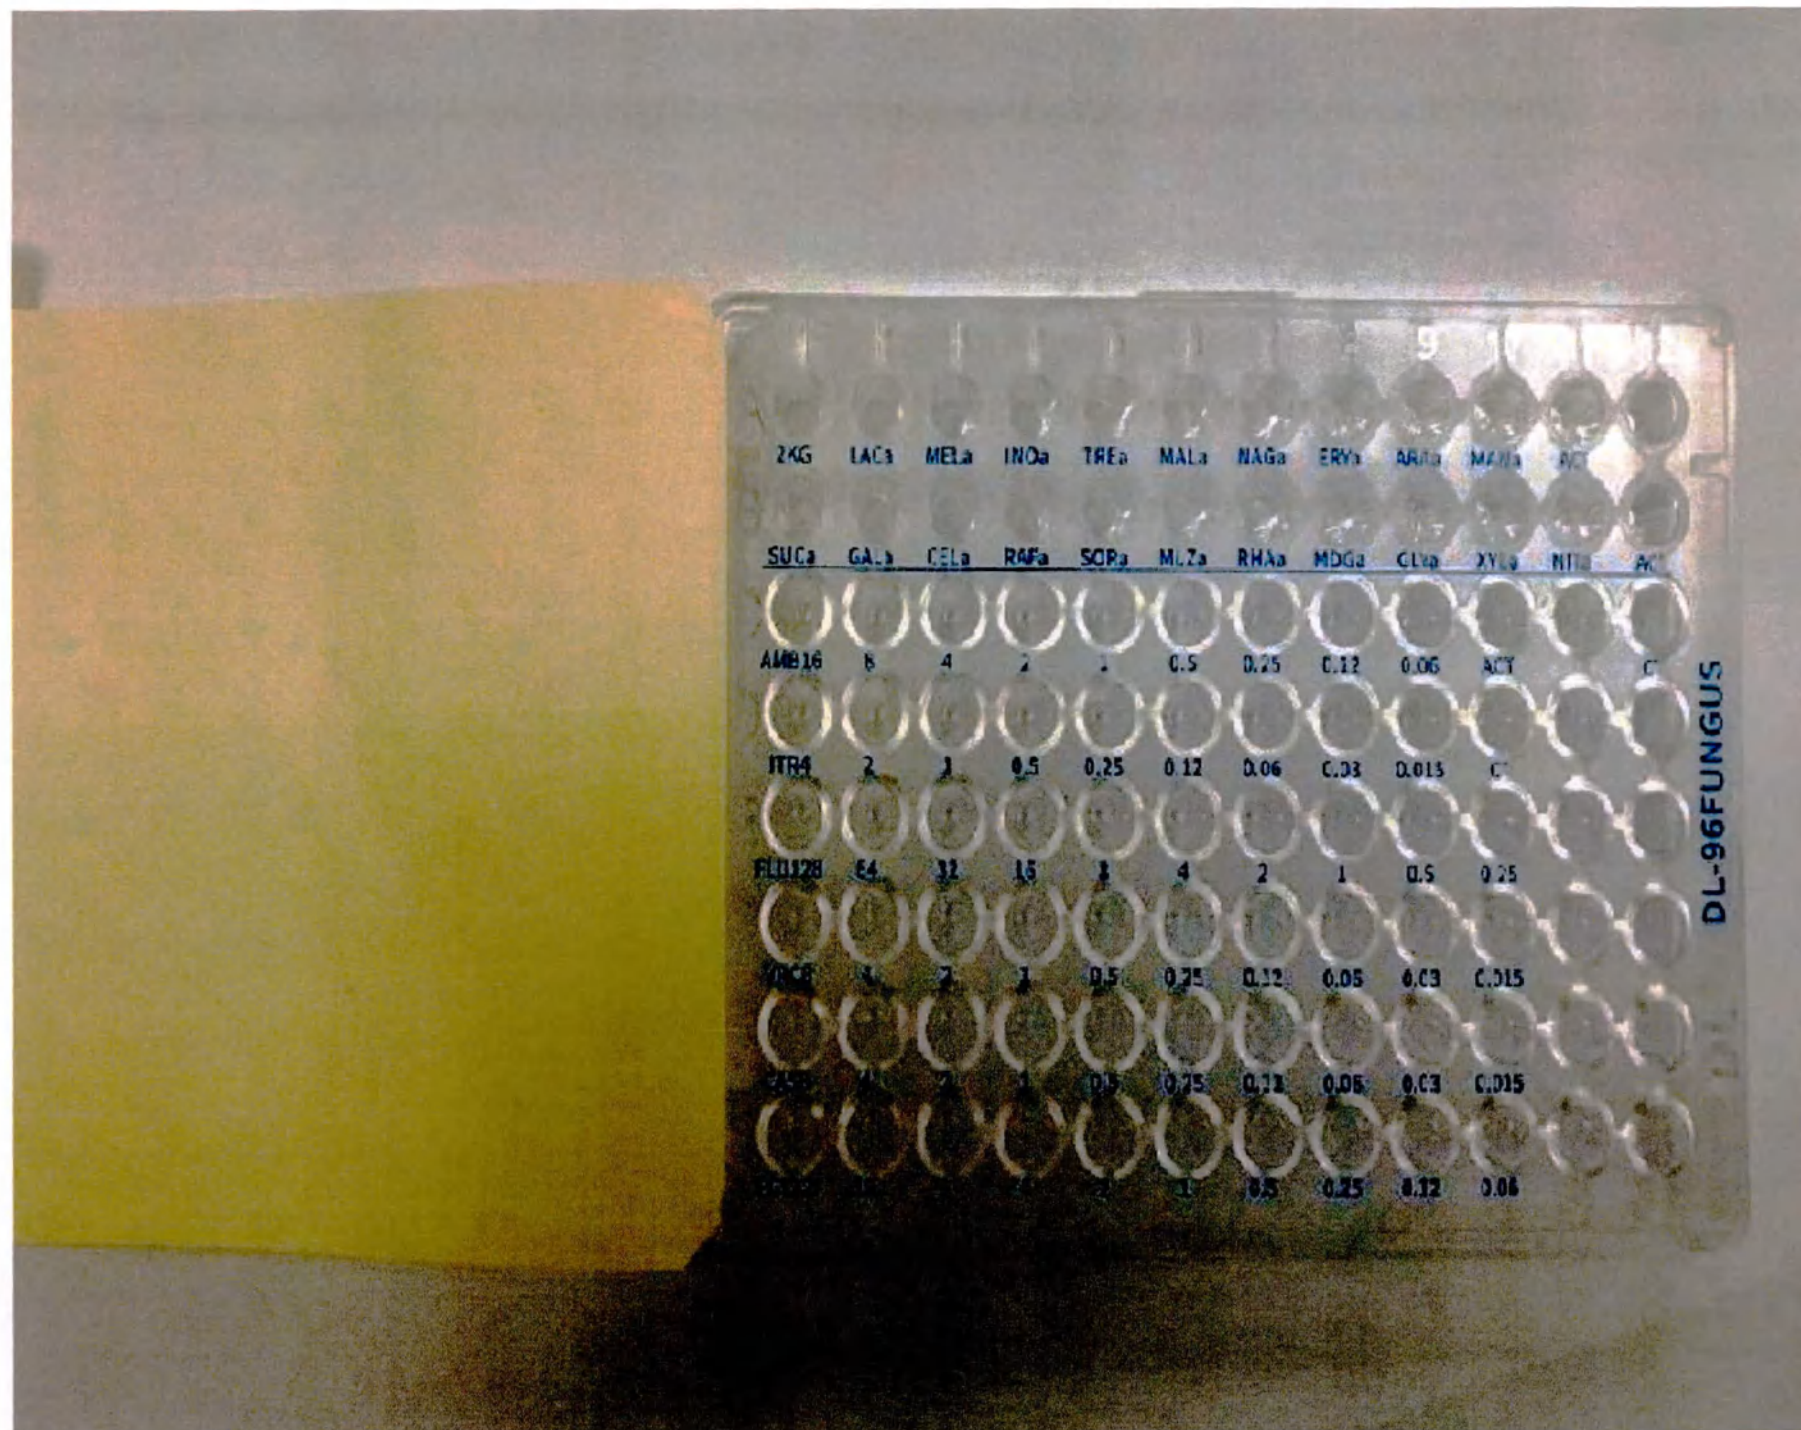


Тестовая карта DL-96FUNGUS IST Card (вид сверху)



Тестовая карта DL-96FUNGUS IST Card (вид сбоку)



Дилуэнт (3,0 мл)

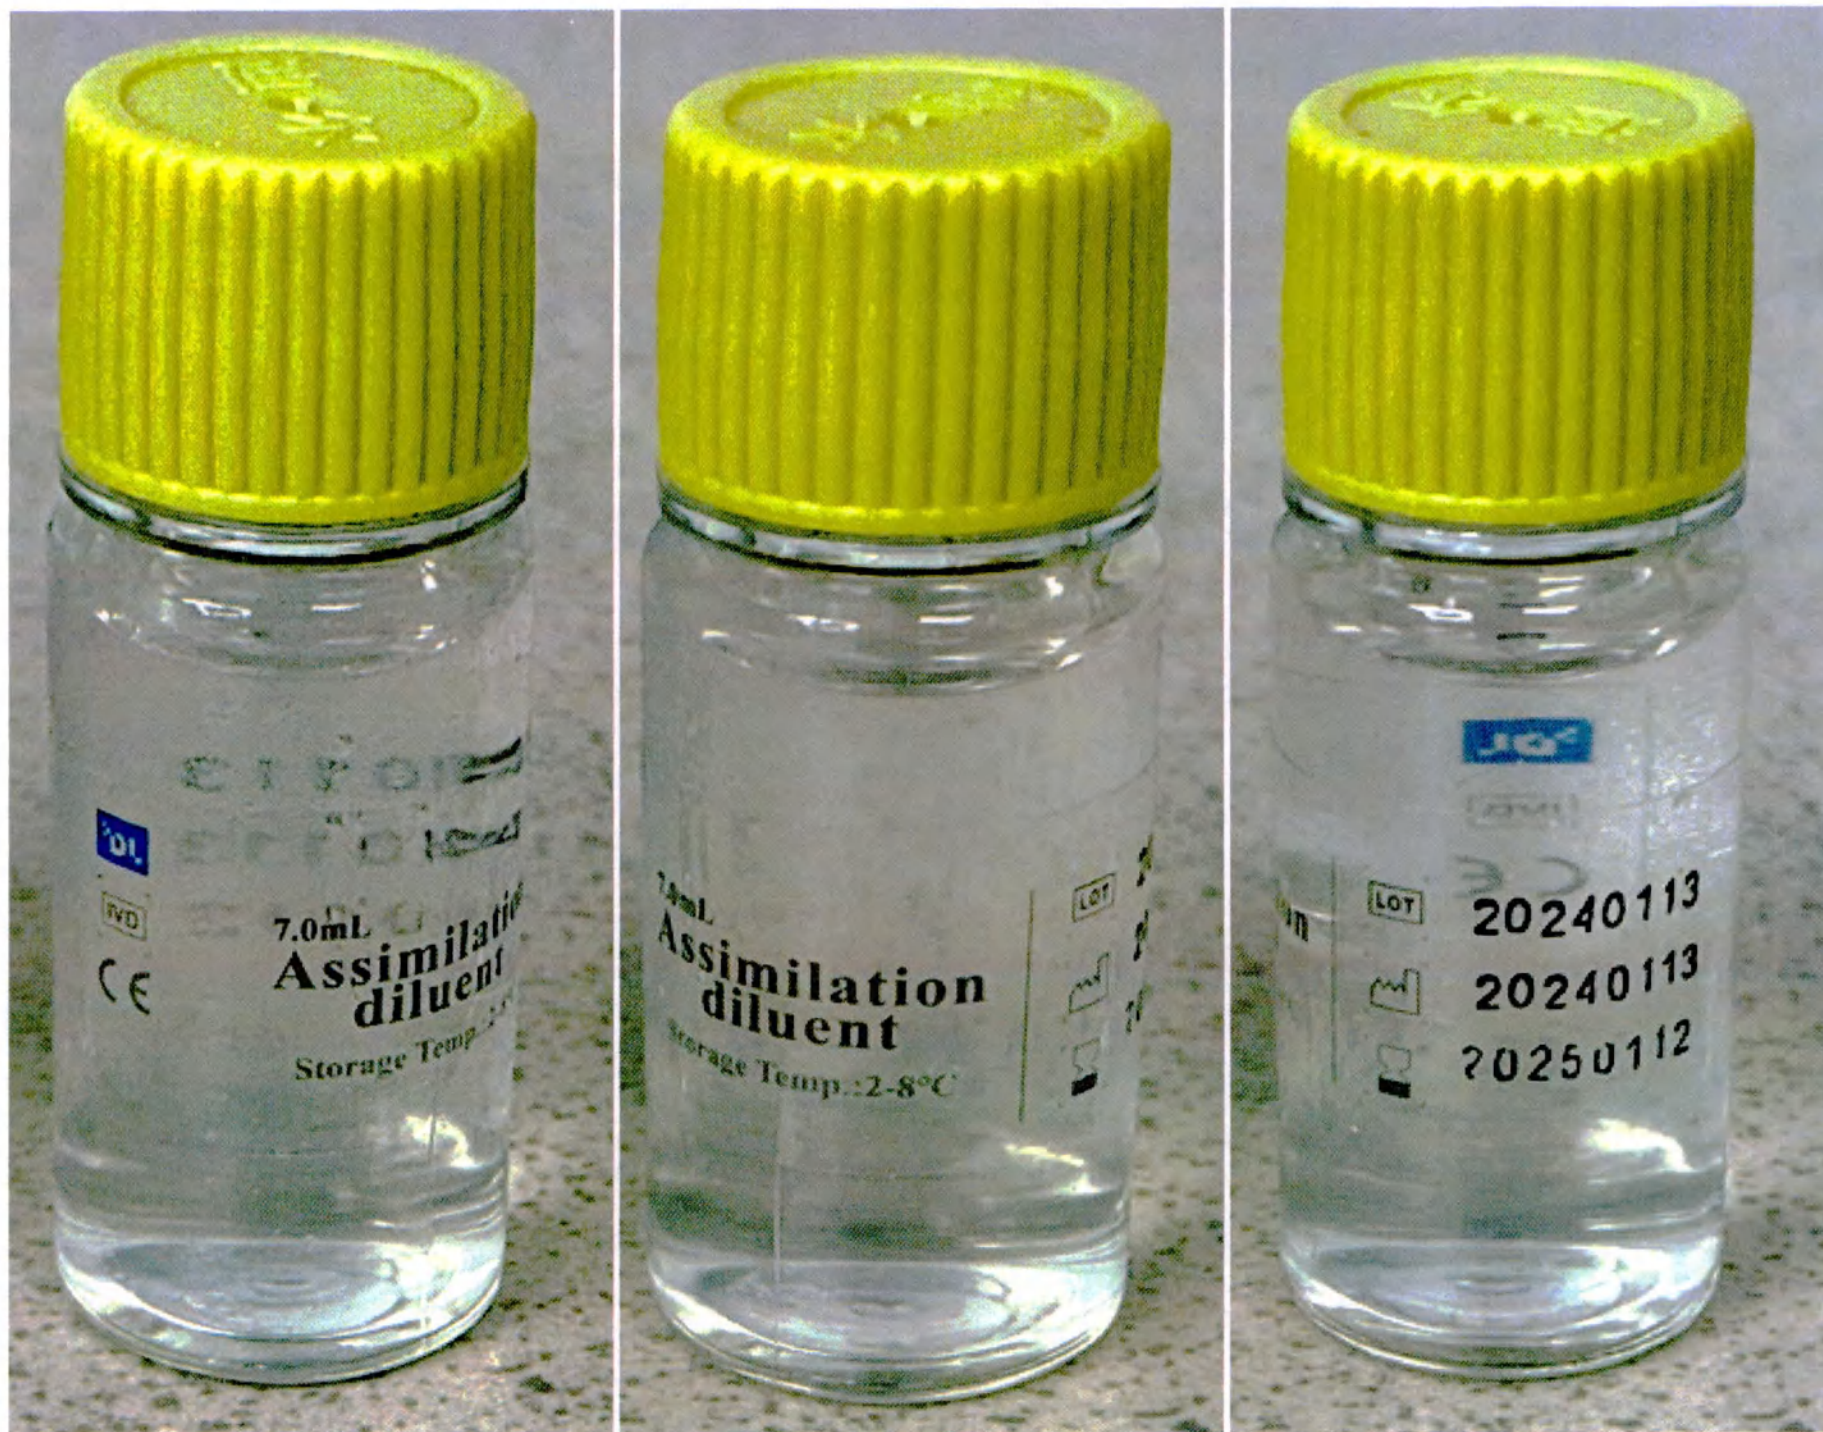

Ассимиляционная жидкая среда (7,0 мл)



Дилуэнт AST (7,0 мл)

Набор реагентов DL-96FUNGUS IST Card для идентификации грибов и определения чувствительности к противогрибковым препаратам на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики, в составе:

1. Тестовая карта DL-96FUNGUS IST Card – 10 шт.;
2. Дилуэнт (3,0 мл) – 10 флаконов;
3. Ассимиляционная жидкая среда (7,0 мл) – 10 флаконов;
4. Дилуэнт AST (7,0 мл) – 10 флаконов;
5. Инструкция по применению – 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «МИРУС МЕДИКАЛ» (ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»)

Адрес: 115114, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ КОЖЕВНИЧЕСКАЯ, Д. 10 СТР. 1

Тел.: +7 499 579 3303

E-mail: info@mirus-medical.com

Производитель:

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd. (Чжухай ДиЭль Биотех Ко. Лтд)

Адрес: No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Для идентификации и определения чувствительности к противогрибковым препаратам грибов.

Для применения с автоматическими анализаторами для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам

Реагенты для диагностики in vitro.

Хранить при температуре от +2°C до +8°C



Регистрационное удостоверение № _____ от _____. ____ г.



Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

INSTRUCTION FOR USE
/ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Reagent kit DL-96FUNGUS IST Card for identification of fungi and determination of sensitivity to antifungal drugs on DL-96A and D2mini analyzers for in vitro diagnostics / Набор реагентов DL-96FUNGUS IST Card для идентификации грибов и определения чувствительности к противогрибковым препаратам на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики



Manufacturer/ Производитель

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd., No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong Province, 519040, P.R. China

«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ»
CEO / Исполнительный Директор
Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

Lin Huaqing

Stamp/печать



Date: 03-03-2024

Rev. 1.0, 03-2024 / Ред. 1.0, 03-2024



Прошито, пронумеровано

14 (четырнадцать) листа(ов)

ООО «Мирус Медикал»

Данилов П.А.

