

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов IST Card (DL-96STREP) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам отрицательных по тесту на каталазу и грамположительных кокков на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе

ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»



Данилов П. А.

«10» декабря



IST Card (DL-96 STREP)

OPEN

Composition: 10 DL-96 STREP test cards

10 tests/box

20 vials of broth

10 vials of diluent

5 vials of auxiliary reagent

LOT: 2024022701


EXP: 20250226

EXP: 20250226

Intended use: For identification and antimicrobial MIC determinations of Catalase-test-negative and Gram-positive coccus.

For use with DL microbial ID/AST system


IVD



EU

See the Lot number, Production Date and Expiry Date on the seal.

Model: DL-96 STREP




In vitro diagnostic reagent

REF 2601004006

DLIST Card

Набор реагентов IST Card (DL-96STREP) для идентификации и определения антимикробных свойств чувствительности к антимикробным препаратам отрицательных по тесту на каталазу и грамположительных кокков на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сверху)

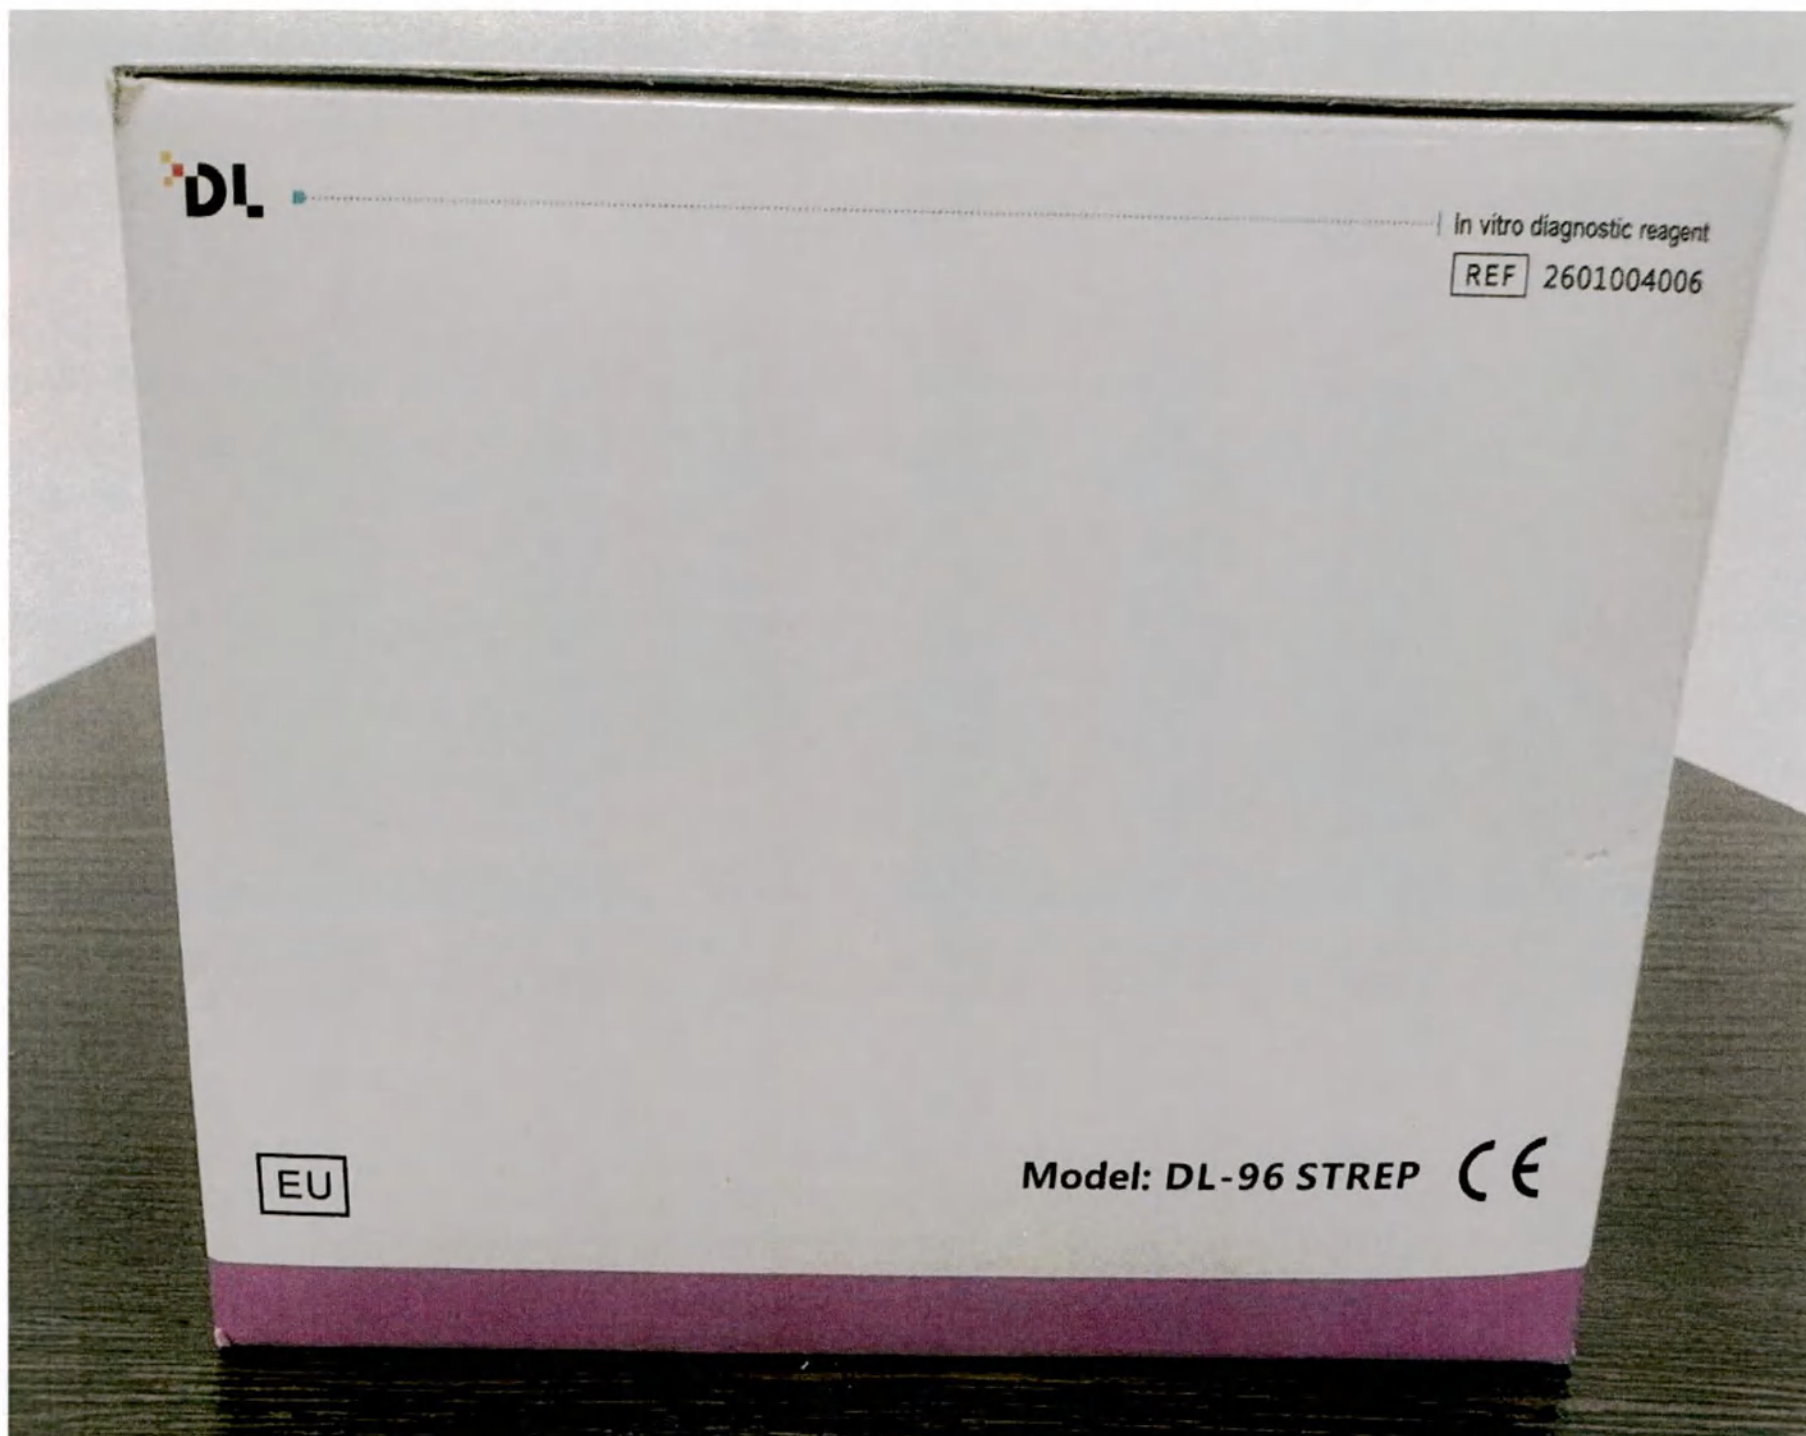

Набор реагентов IST Card (DL-96STREP) для идентификации и определения антимикробных свойств чувствительности к антимикробным препаратам отрицательных по тесту на каталазу и грамположительных кокков на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сбоку)





Набор реагентов IST Card (DL-96STREP) для идентификации и определения антимикробных свойств чувствительности к антимикробным препаратам отрицательных по тесту на каталазу и грамположительных кокков на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сзади)





Общий вид медицинского изделия.




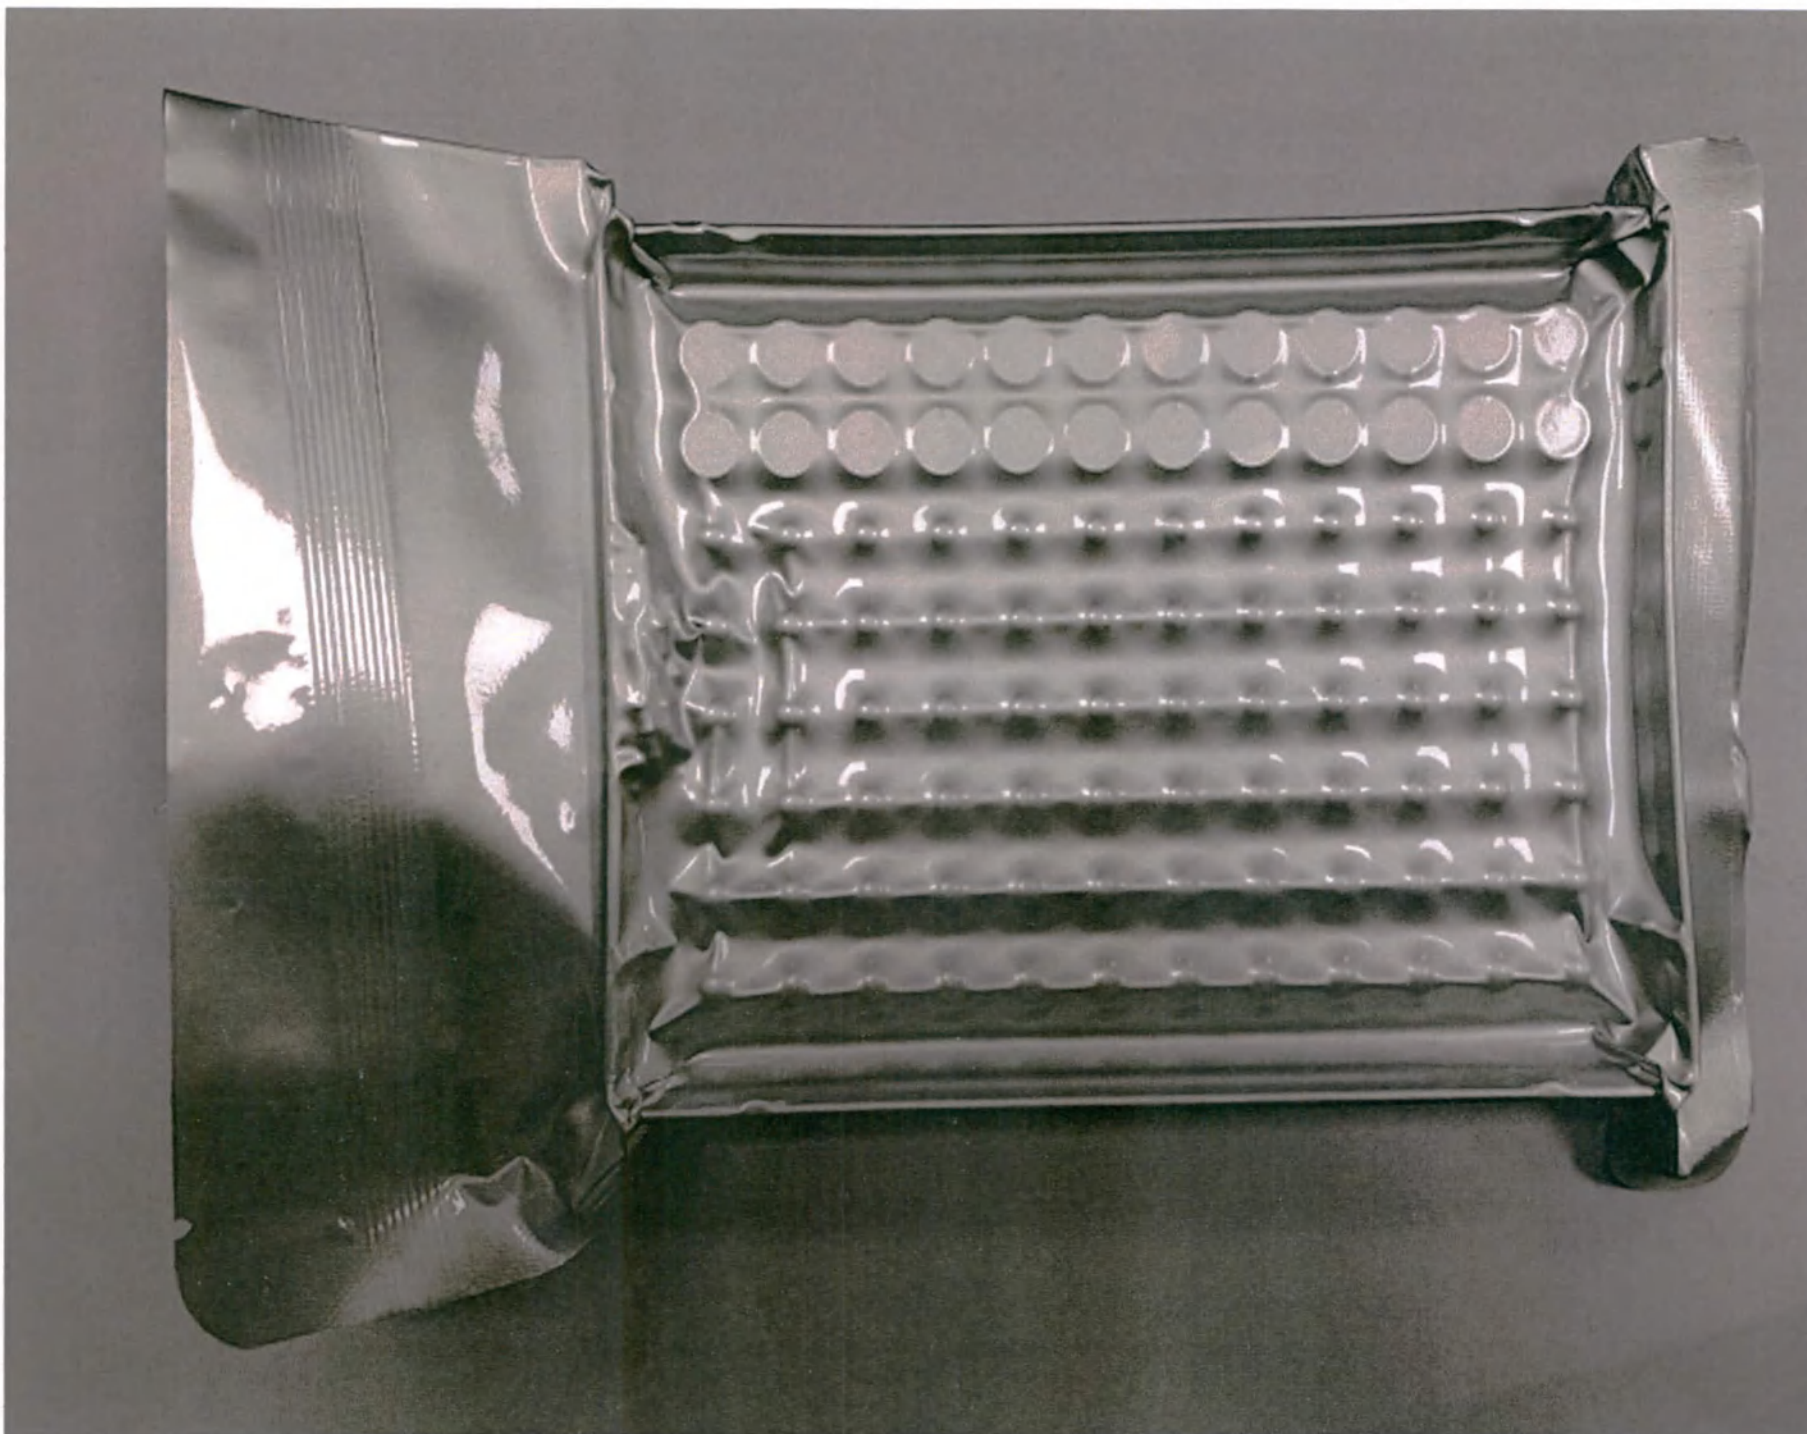

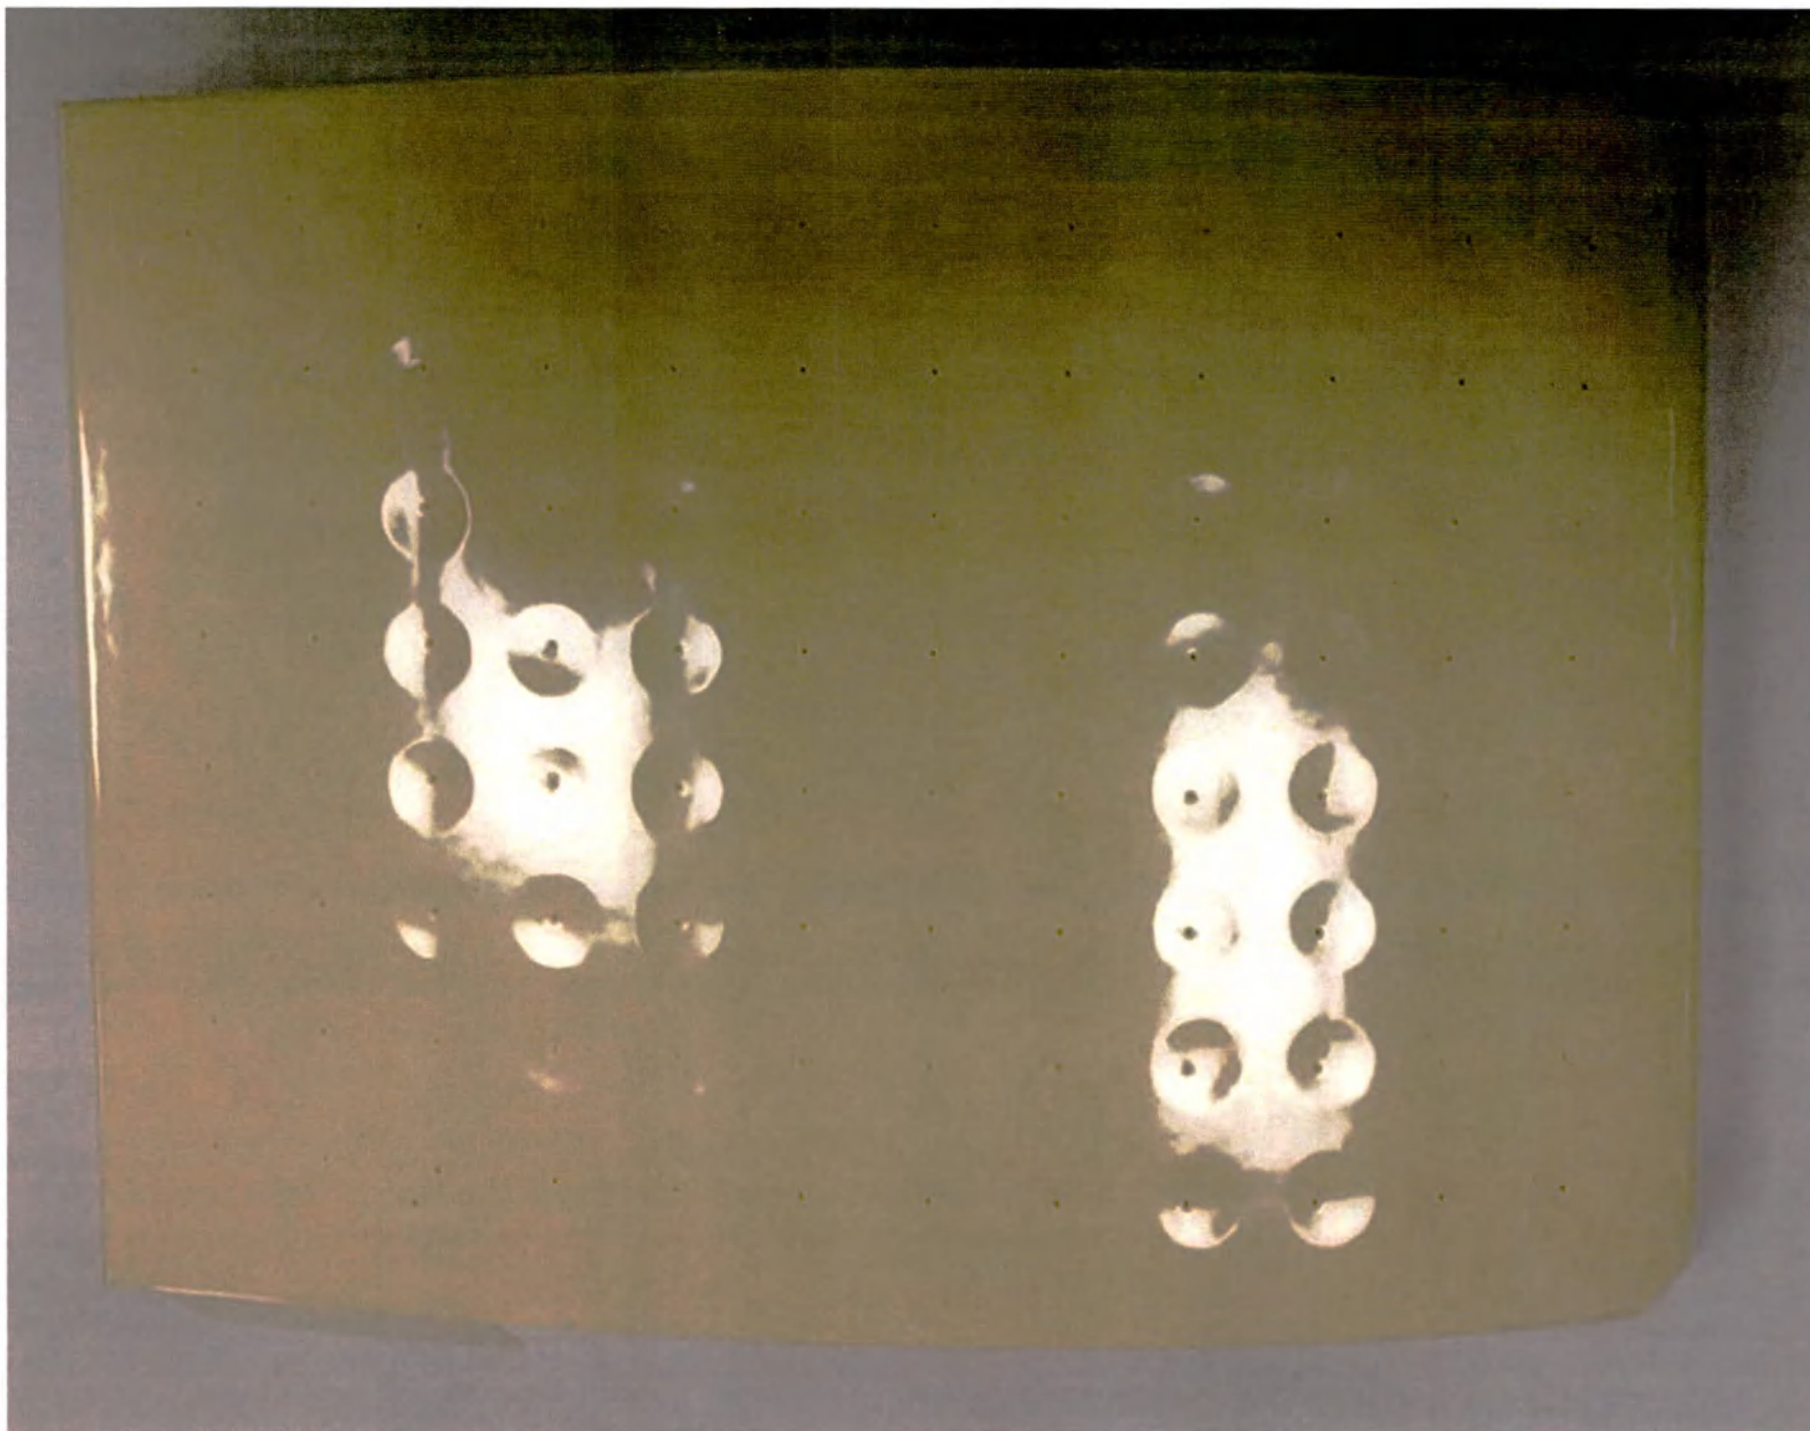


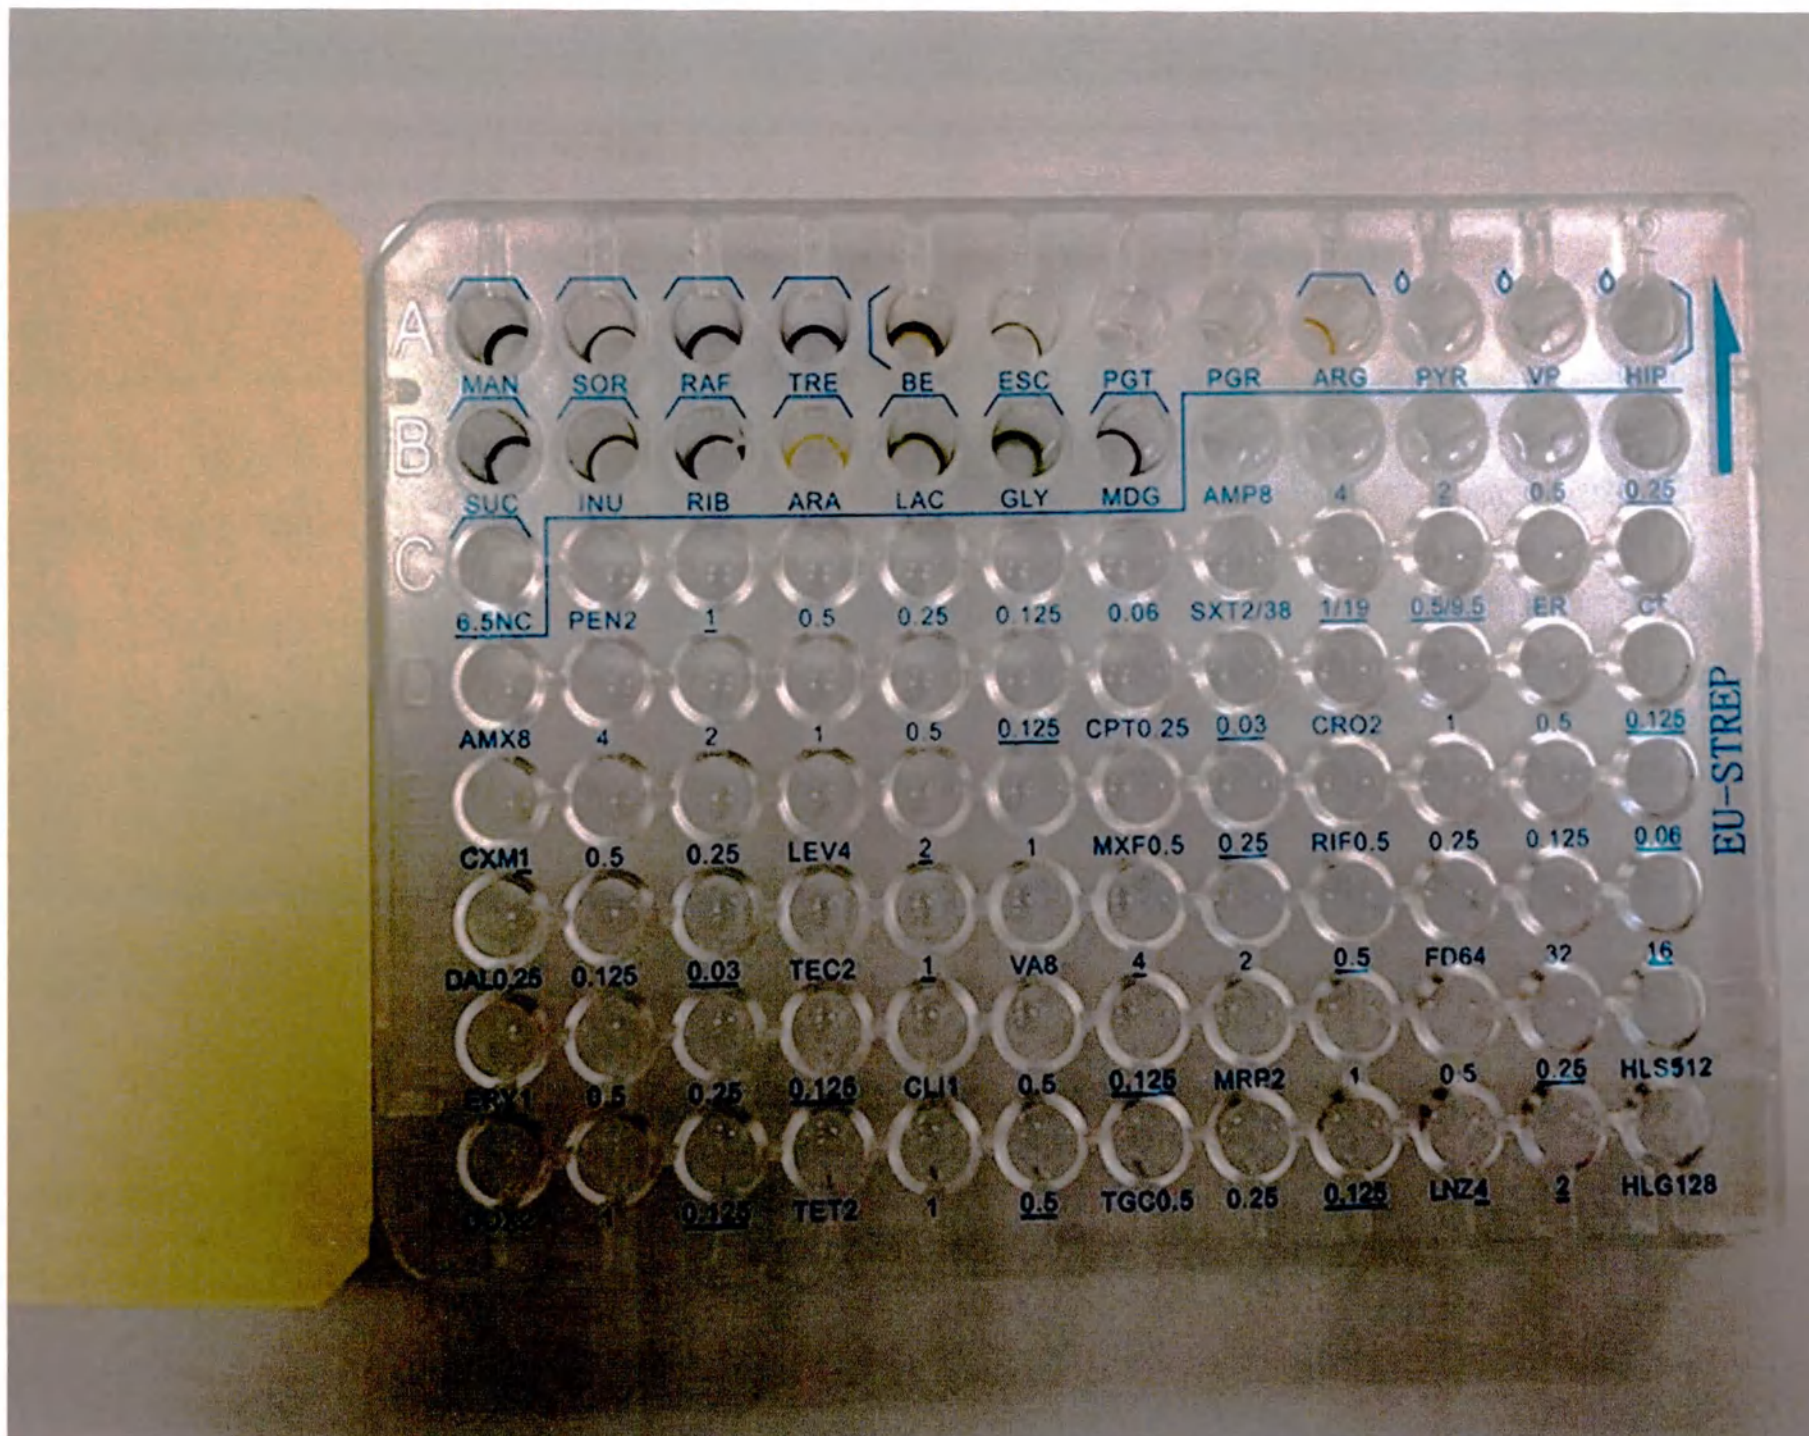

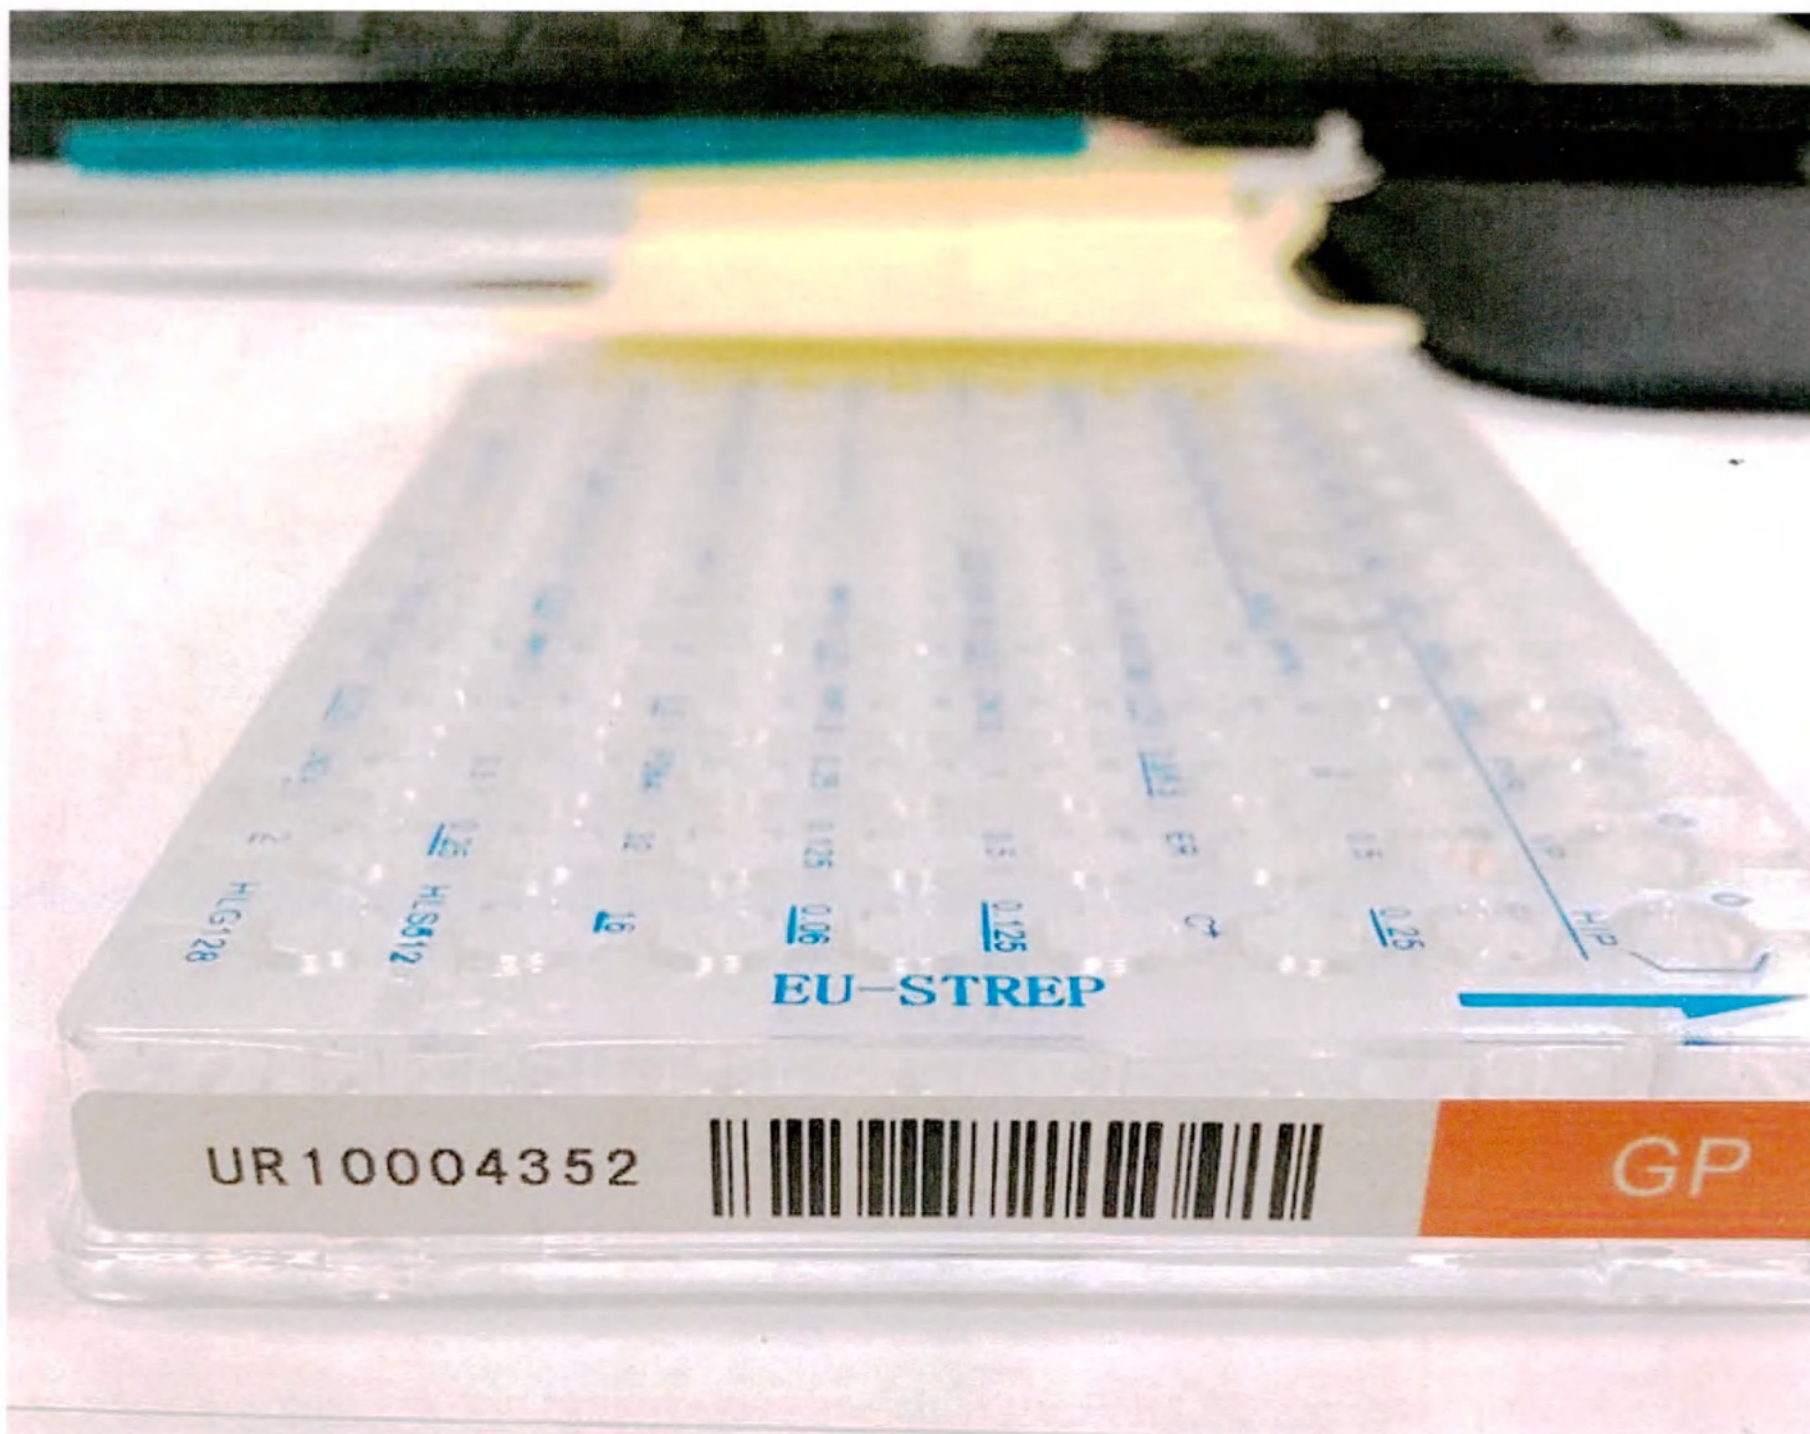

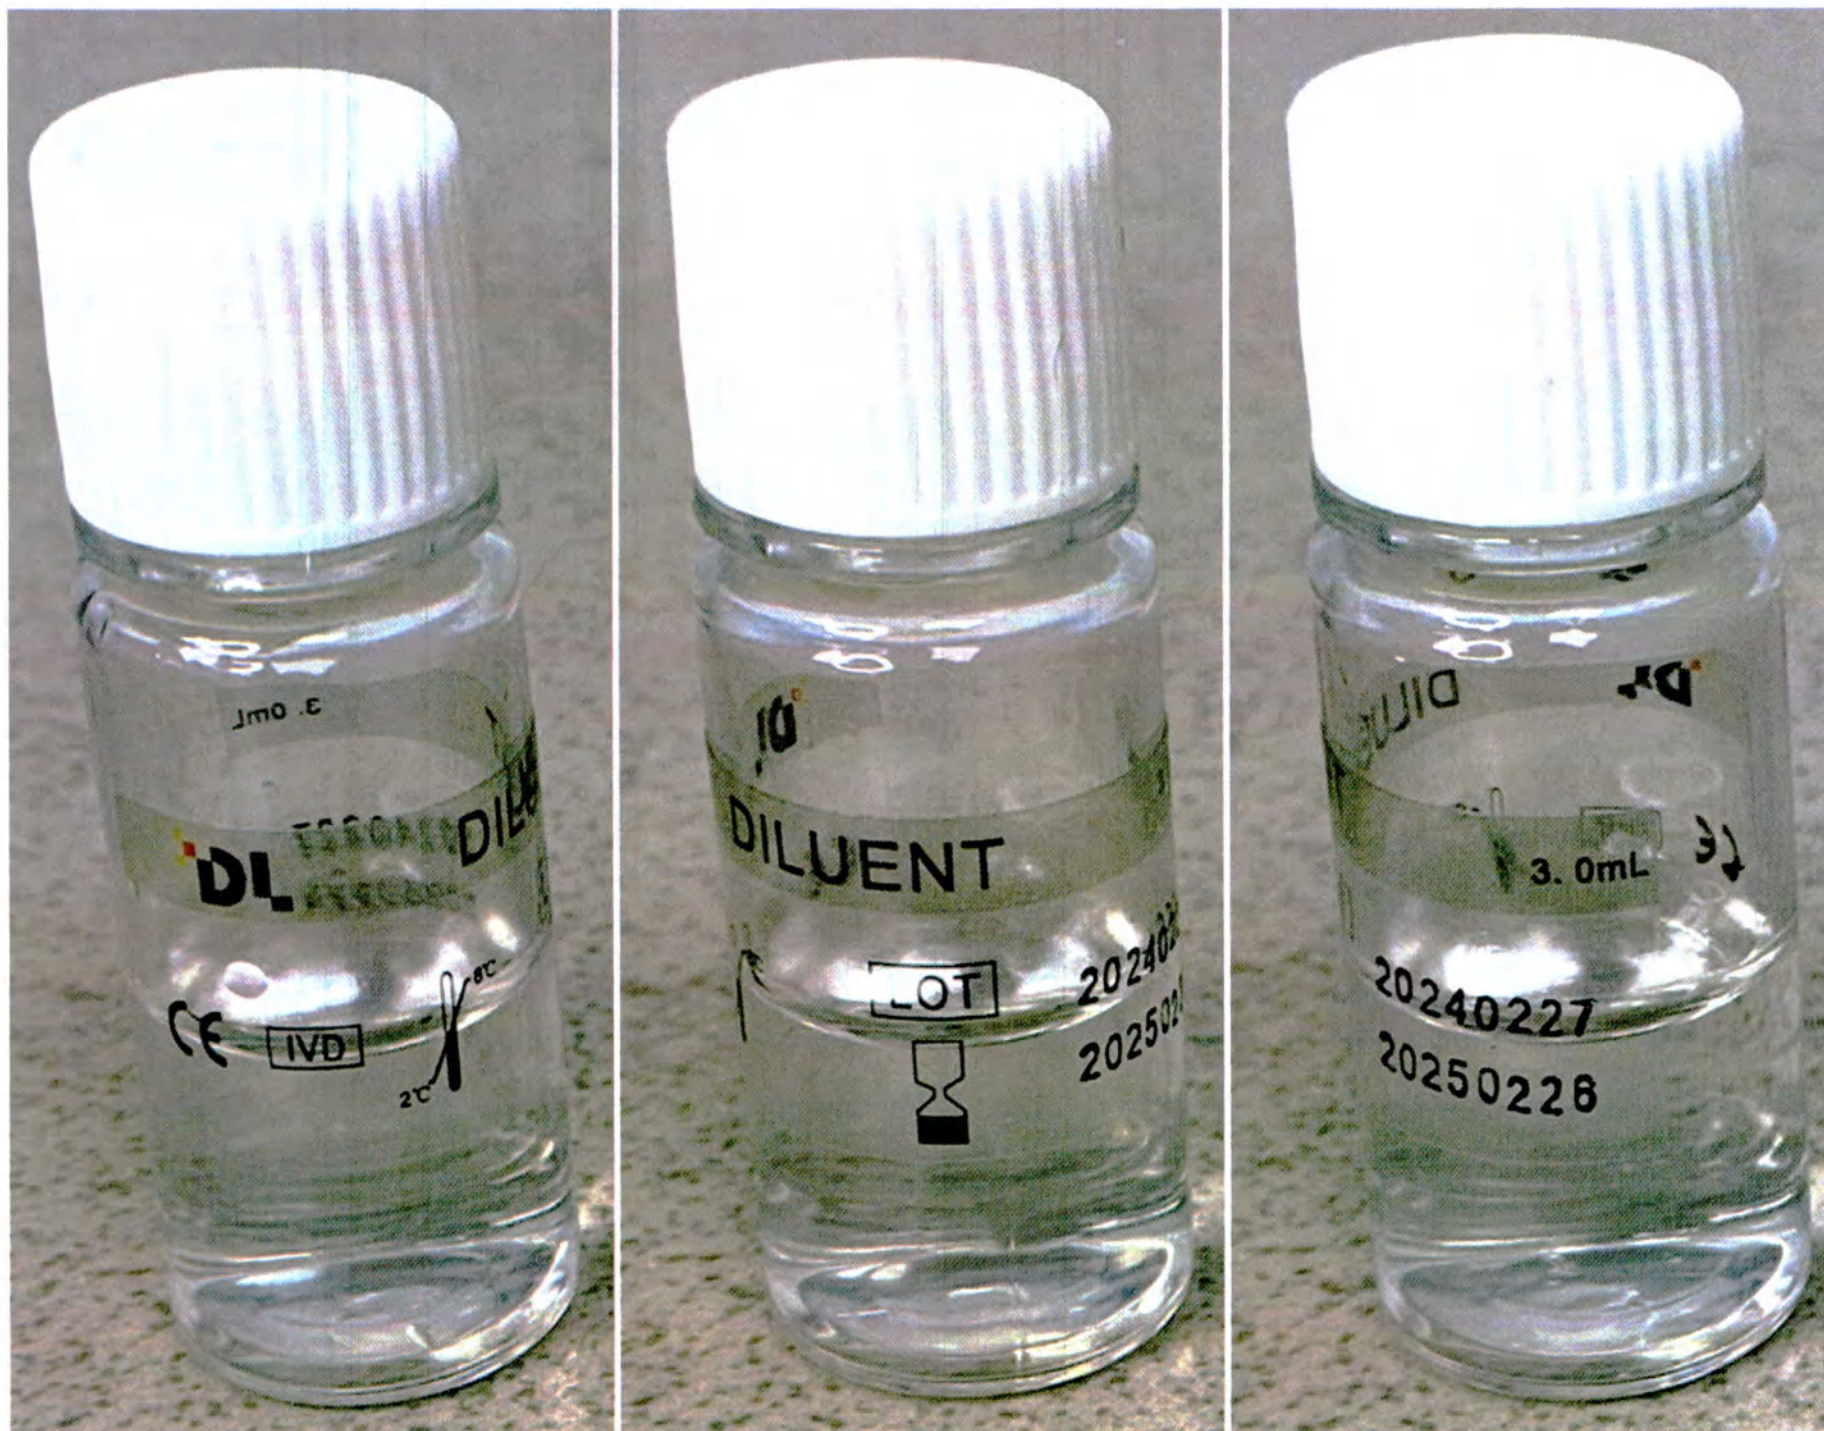

Дилуэнт (3,0 мл)

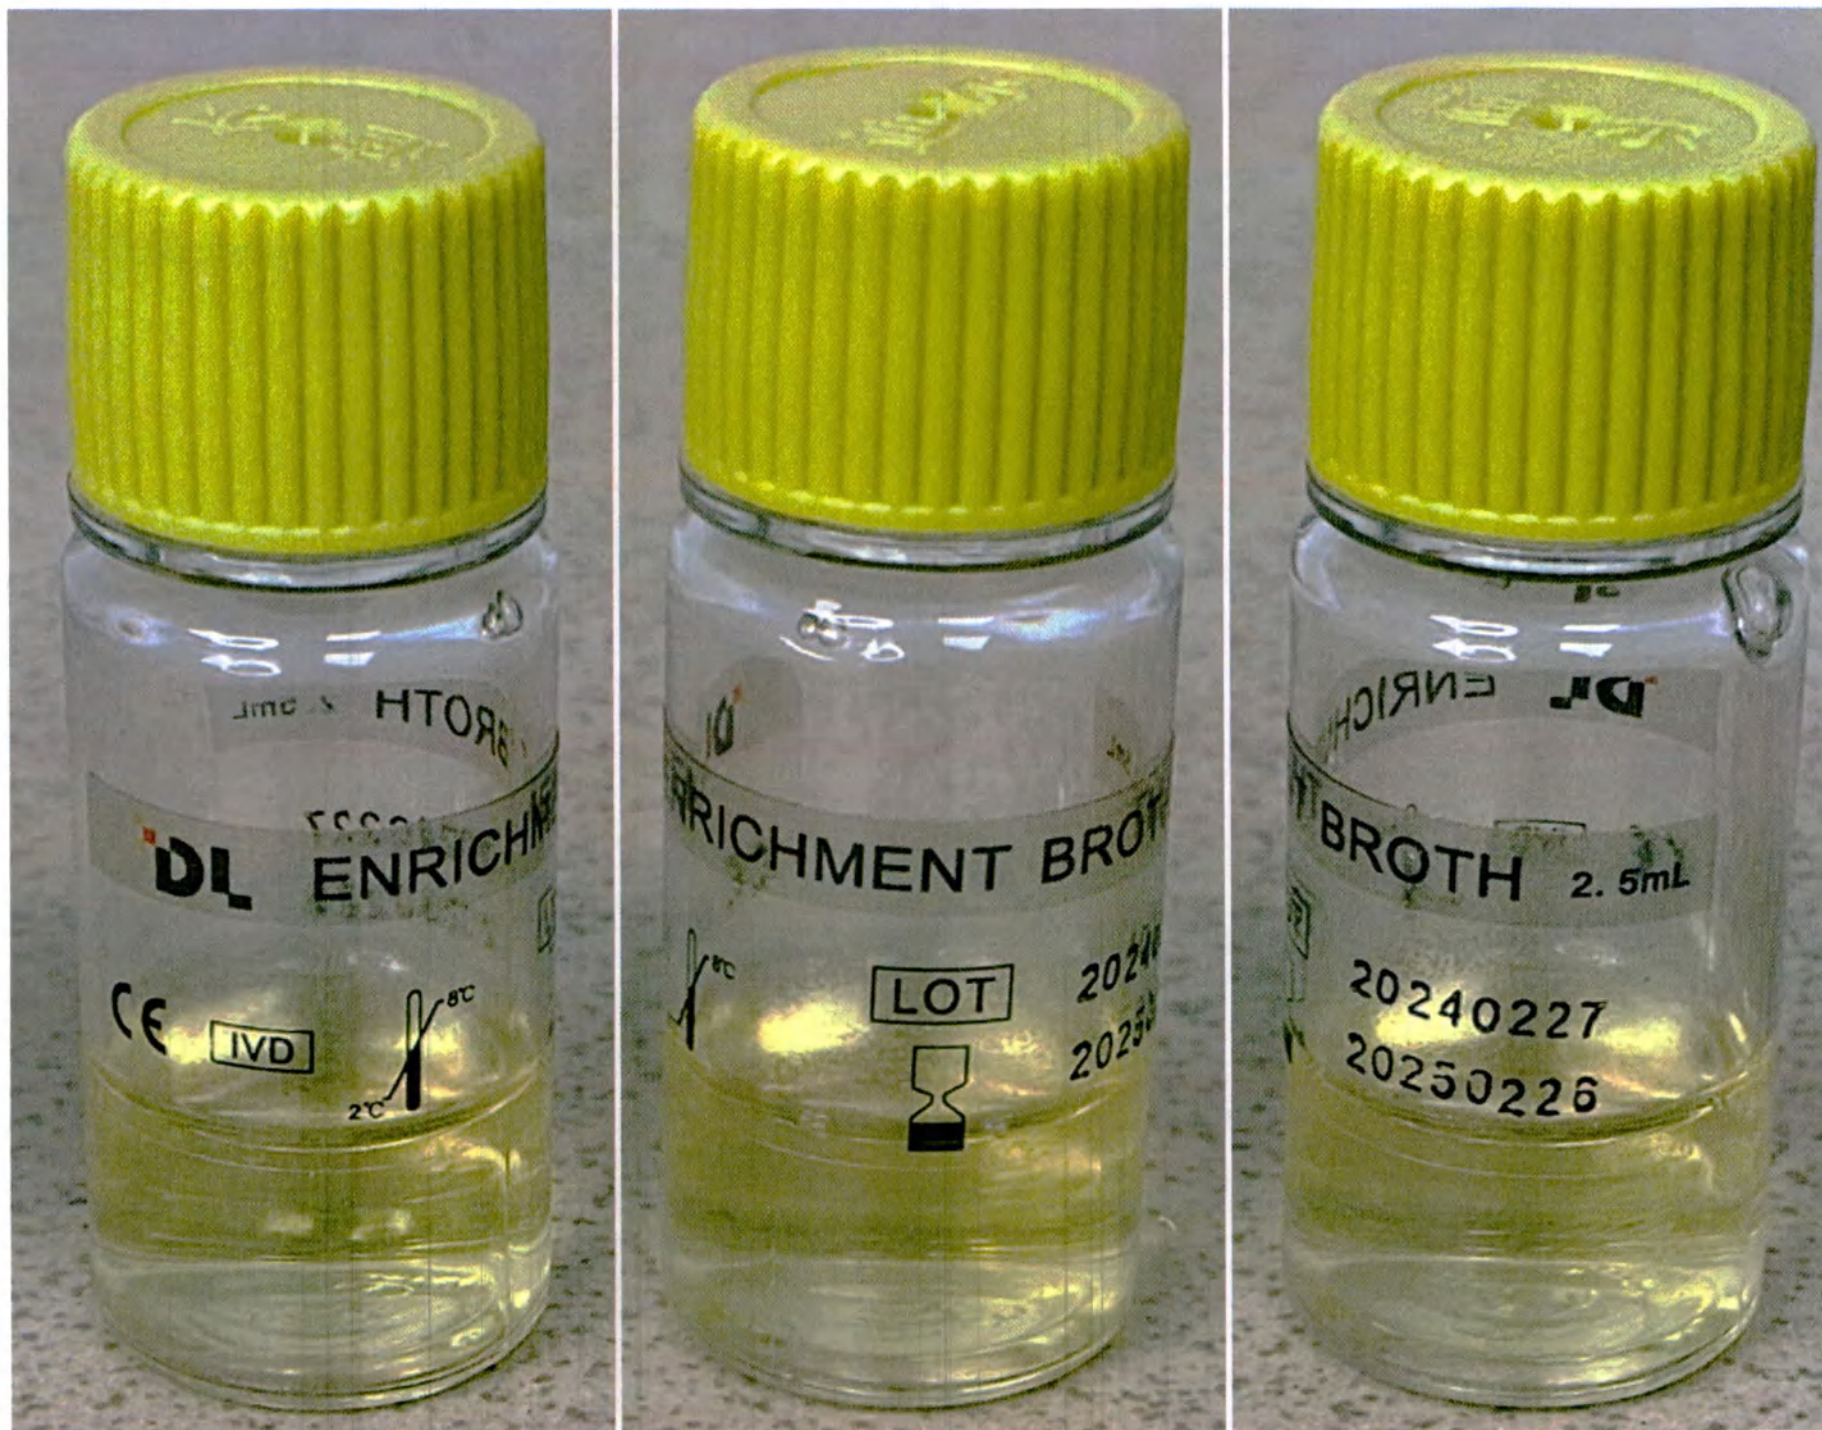


Бульона для обогащения (2,5 мл)



Бульон IST (9,5 мл)



Вспомогательный реагент VP A (2,0 мл)

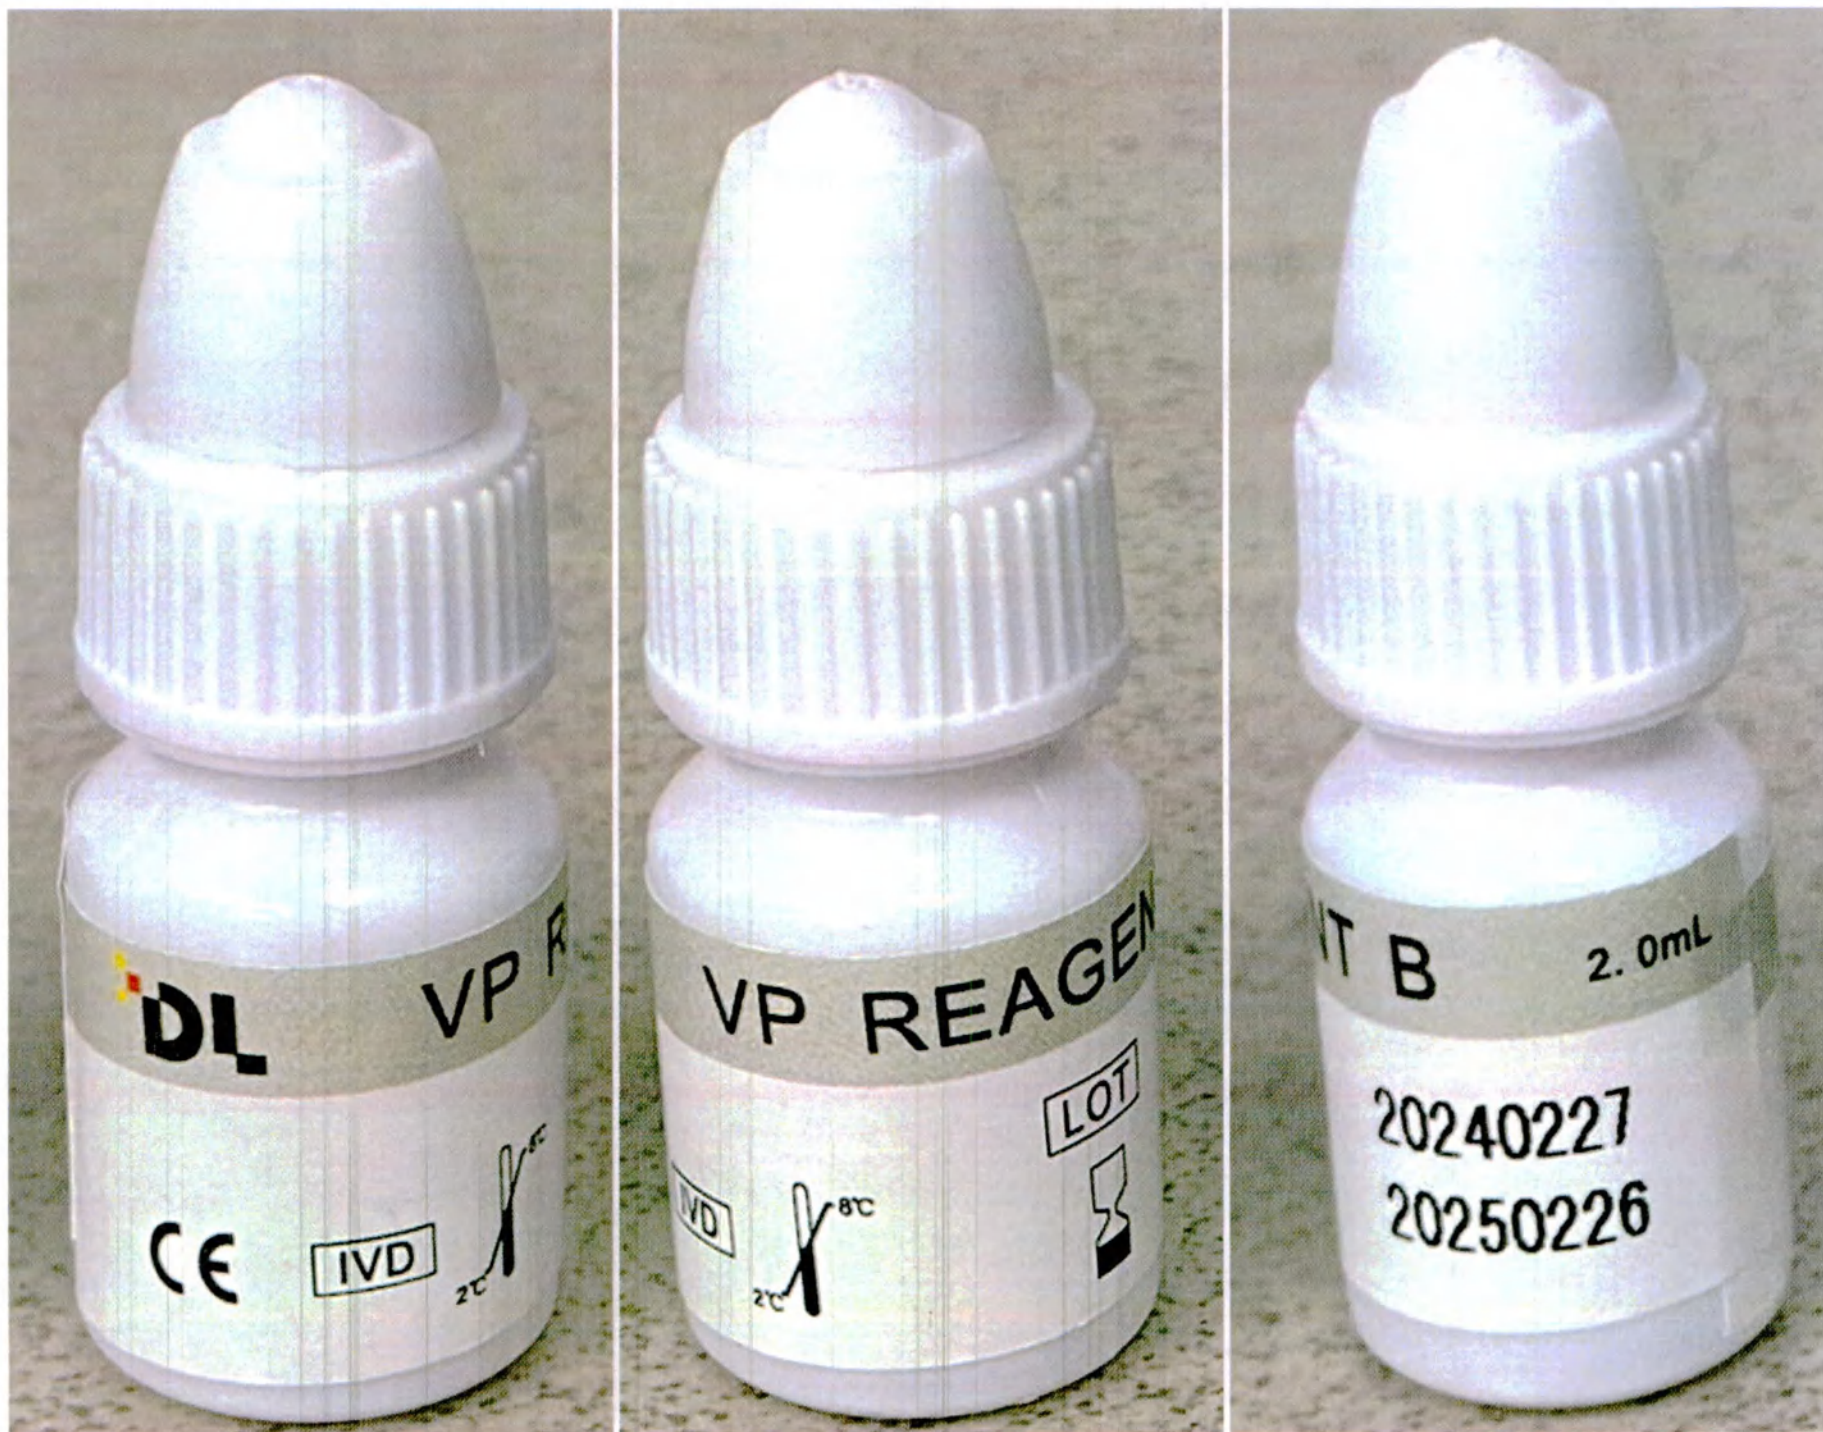

Вспомогательный реагент VP B (2,0 мл)



Вспомогательный реагент PYR (1,5 мл)



Вспомогательный реагент HIP (1,5 мл)



Набор реагентов IST Card (DL-96STREP) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам отрицательных по тесту на каталазу и грамположительных кокков на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики, в составе:

1. → Тестовая карта IST Card (DL-96STREP) — 10 шт.
2. → Дилуэнт (3,0 мл) — 10 флаконов.
3. → Бульон для обогащения (2,5 мл) — 10 флаконов.
4. → Бульон IST (9,5 мл) — 10 флаконов.
5. → Вспомогательный реагент VP-A (2,0 мл) — 1 флакон.
6. → Вспомогательный реагент VP-B (2,0 мл) — 1 флакон.
7. → Вспомогательный реагент PYR (1,5 мл) — 1 флакон.
8. → Вспомогательный реагент HIP (1,5 мл) — 1 флакон.
9. → Парафиновое масло стерильное (7,0 мл) — 1 флакон.
10. → Инструкция по применению — 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «МИРУС МЕДИКАЛ» (ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»)

Адрес: 115114, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ. КОЖЕВНИЧЕСКАЯ, Д. 10-СТР. 1

Тел.: +7-499-579-3303

E-mail: info@mirus-medical.com

Производитель:

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd. (Чжухай ДиЭль Биотех Ко. Лтд)

Адрес: No. 59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам отрицательных по тесту на каталазу и грамположительных кокков.

Для применения с автоматическими анализаторами для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам

Реагенты для диагностики in vitro.

Хранить при температуре от +2°C до +8°C

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.



Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

INSTRUCTION FOR USE /ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Reagent Kit IST Card (DL-96STREP) for identification and determination of antimicrobial sensitivity of catalase negative and gram-positive cocci on DL-96A and D2mini analyzers for in vitro diagnostics / Набор реагентов IST Card (DL-96STREP) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам отрицательных по тесту на каталазу и грамположительных кокков на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики



Manufacturer/ Производитель

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd., No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong Province, 519040, P.R. China

«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ»
CEO / Исполнительный Директор
Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

Lin Huaqing

Stamp/печать



Date: 03-03-2024

Rev. 1.0, 03-2024 / Ред. 1.0, 03-2024

Прошито, пронумеровано

21 (двадцать один) листа(ов)

ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»

Данилов П.А.

