

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов IST Card (DL-96NE) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам неферментирующих бактерий и положительных по тесту на оксидазу грамотрицательных палочек на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе

ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»

 Данилов П. А.

«10» сентября 2024 г.



IST Card (DL-96 NE)

OPEN

Composition: 10 DL-96 NE test cards

10 tests/box

10 vials of broth

10 vials of diluent

5 vials of auxiliary reagent

LDT: 2024022201


P.D: 20240222

EXP: 20250221

Intended use: For identification and antimicrobial MIC determinations of Non-fermentation bacteria and Oxidase-test-positive, Gram-negative bacillus.

For use with DL microbial ID/AST system


IVD



EU

See the Lot number, Production Date and Expiry Date on the seal.

Model: DL-96 NE 




In vitro diagnostic reagent


REF 2601002008

DLIST Card

Набор реагентов IST Card (DL-96NE) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам неферментирующих бактерий и положительных по тесту на оксидазу грамотрицательных палочек на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сверху)



Набор реагентов IST Card (DL-96NE) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам неферментирующих бактерий и положительных по тесту на оксидазу грамотрицательных палочек на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сбоку)



6 971025 210085 >

DL ZHUHAI DL BIOTECH CO., LTD.

ZHUHAI DL BIOTECH CO., LTD.
 19 Jinhai Rd. Sanzao Town, Jinwan, Zhuhai, Guangdong, 519041, P.R. China
 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
 Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

Tel: +86-756-3391888 6292000
<http://www.medicaldl.com>


Fax: +86-756-3391389
 E-mail: dl@medicaldl.com

Набор реагентов IST Card (DL-96NE) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам неферментирующих бактерий и положительных по тесту на оксидазу грамотрицательных палочек на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сзади)





Общий вид медицинского изделия.



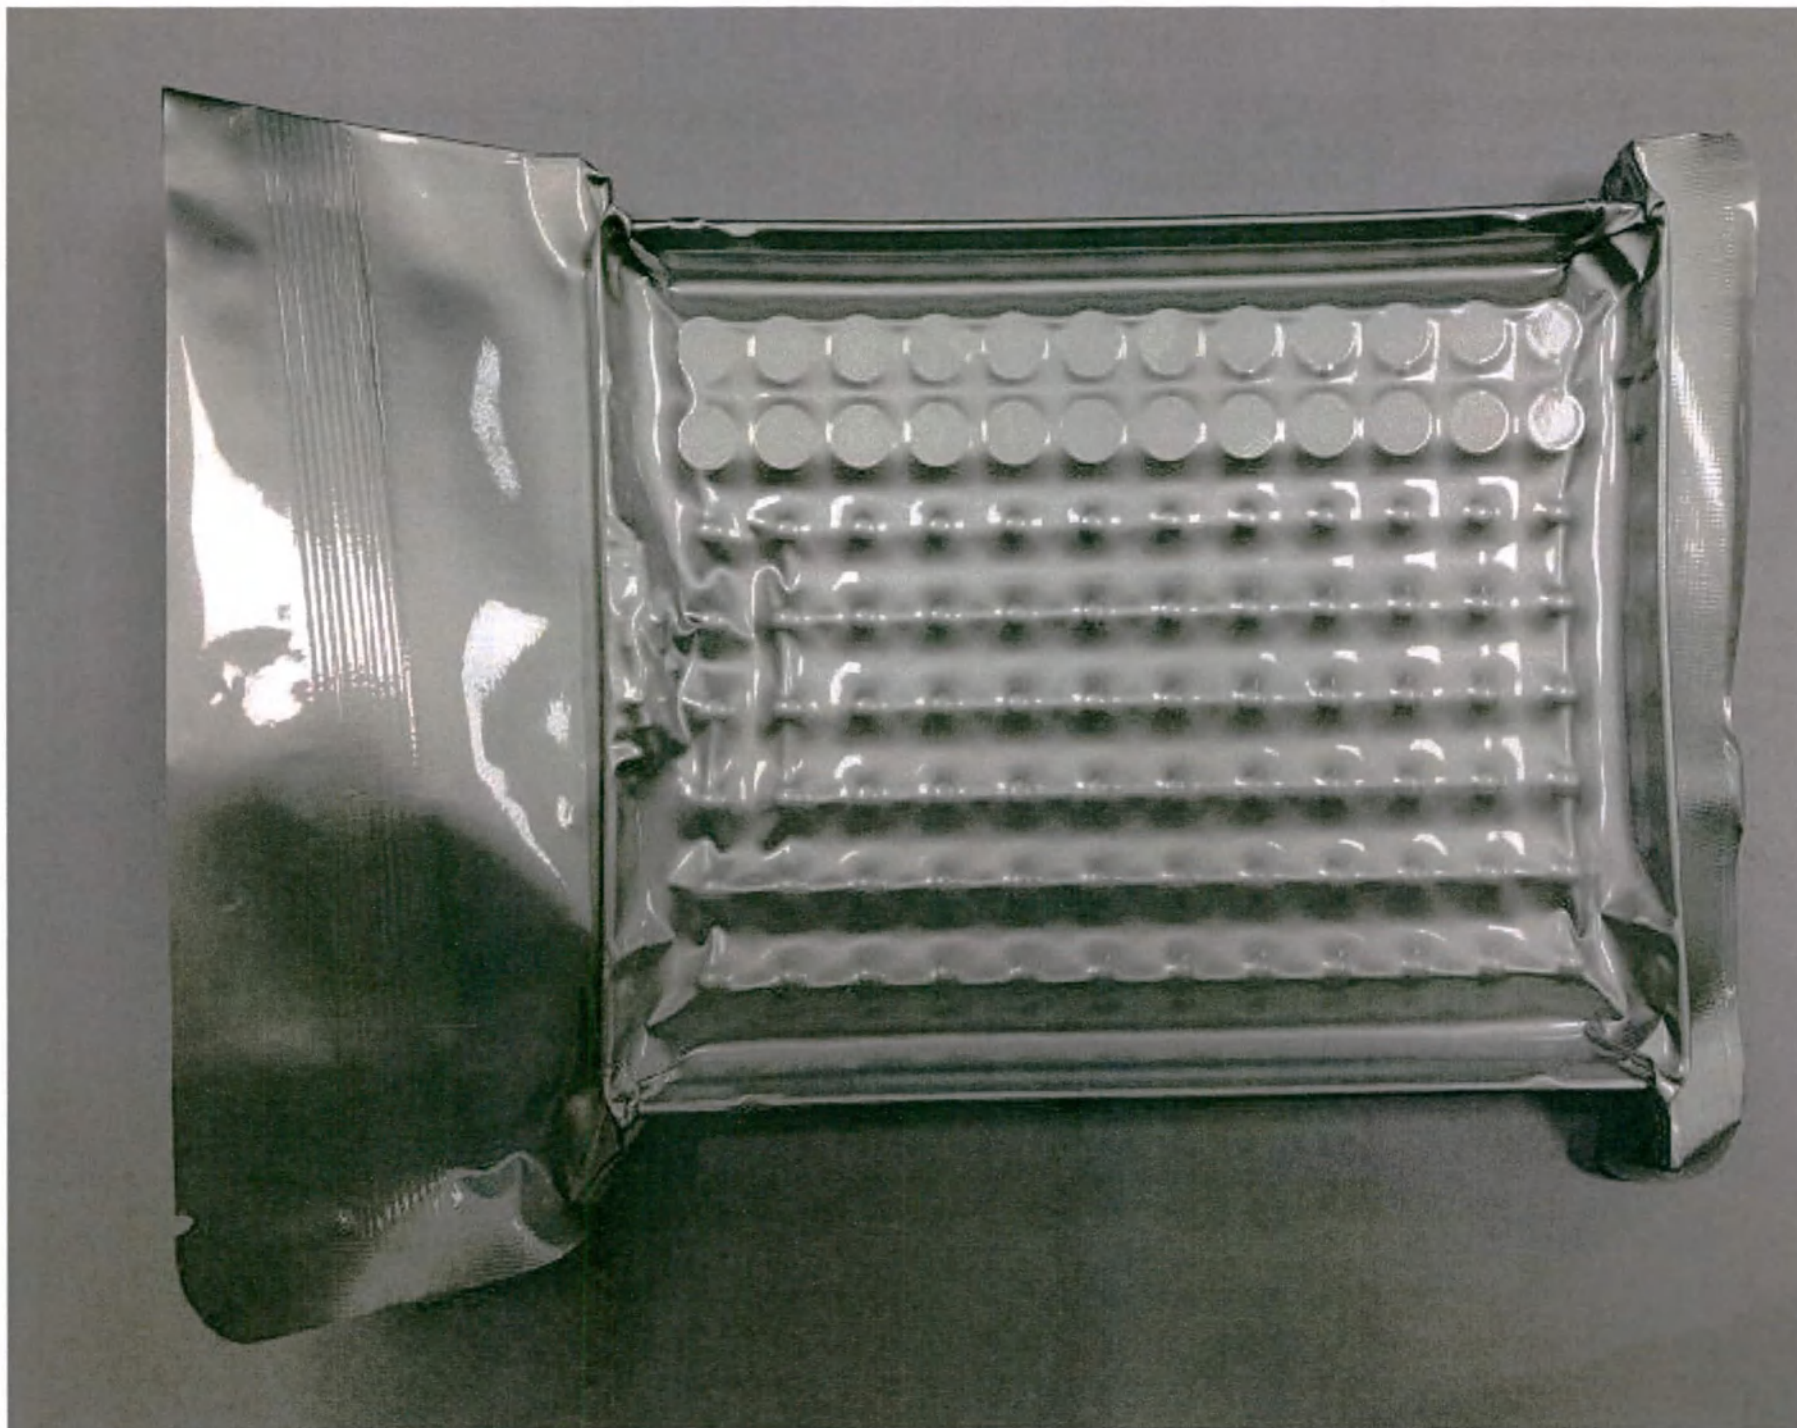


Тестовая карта IST Card (DL-96NE) (вид снизу)



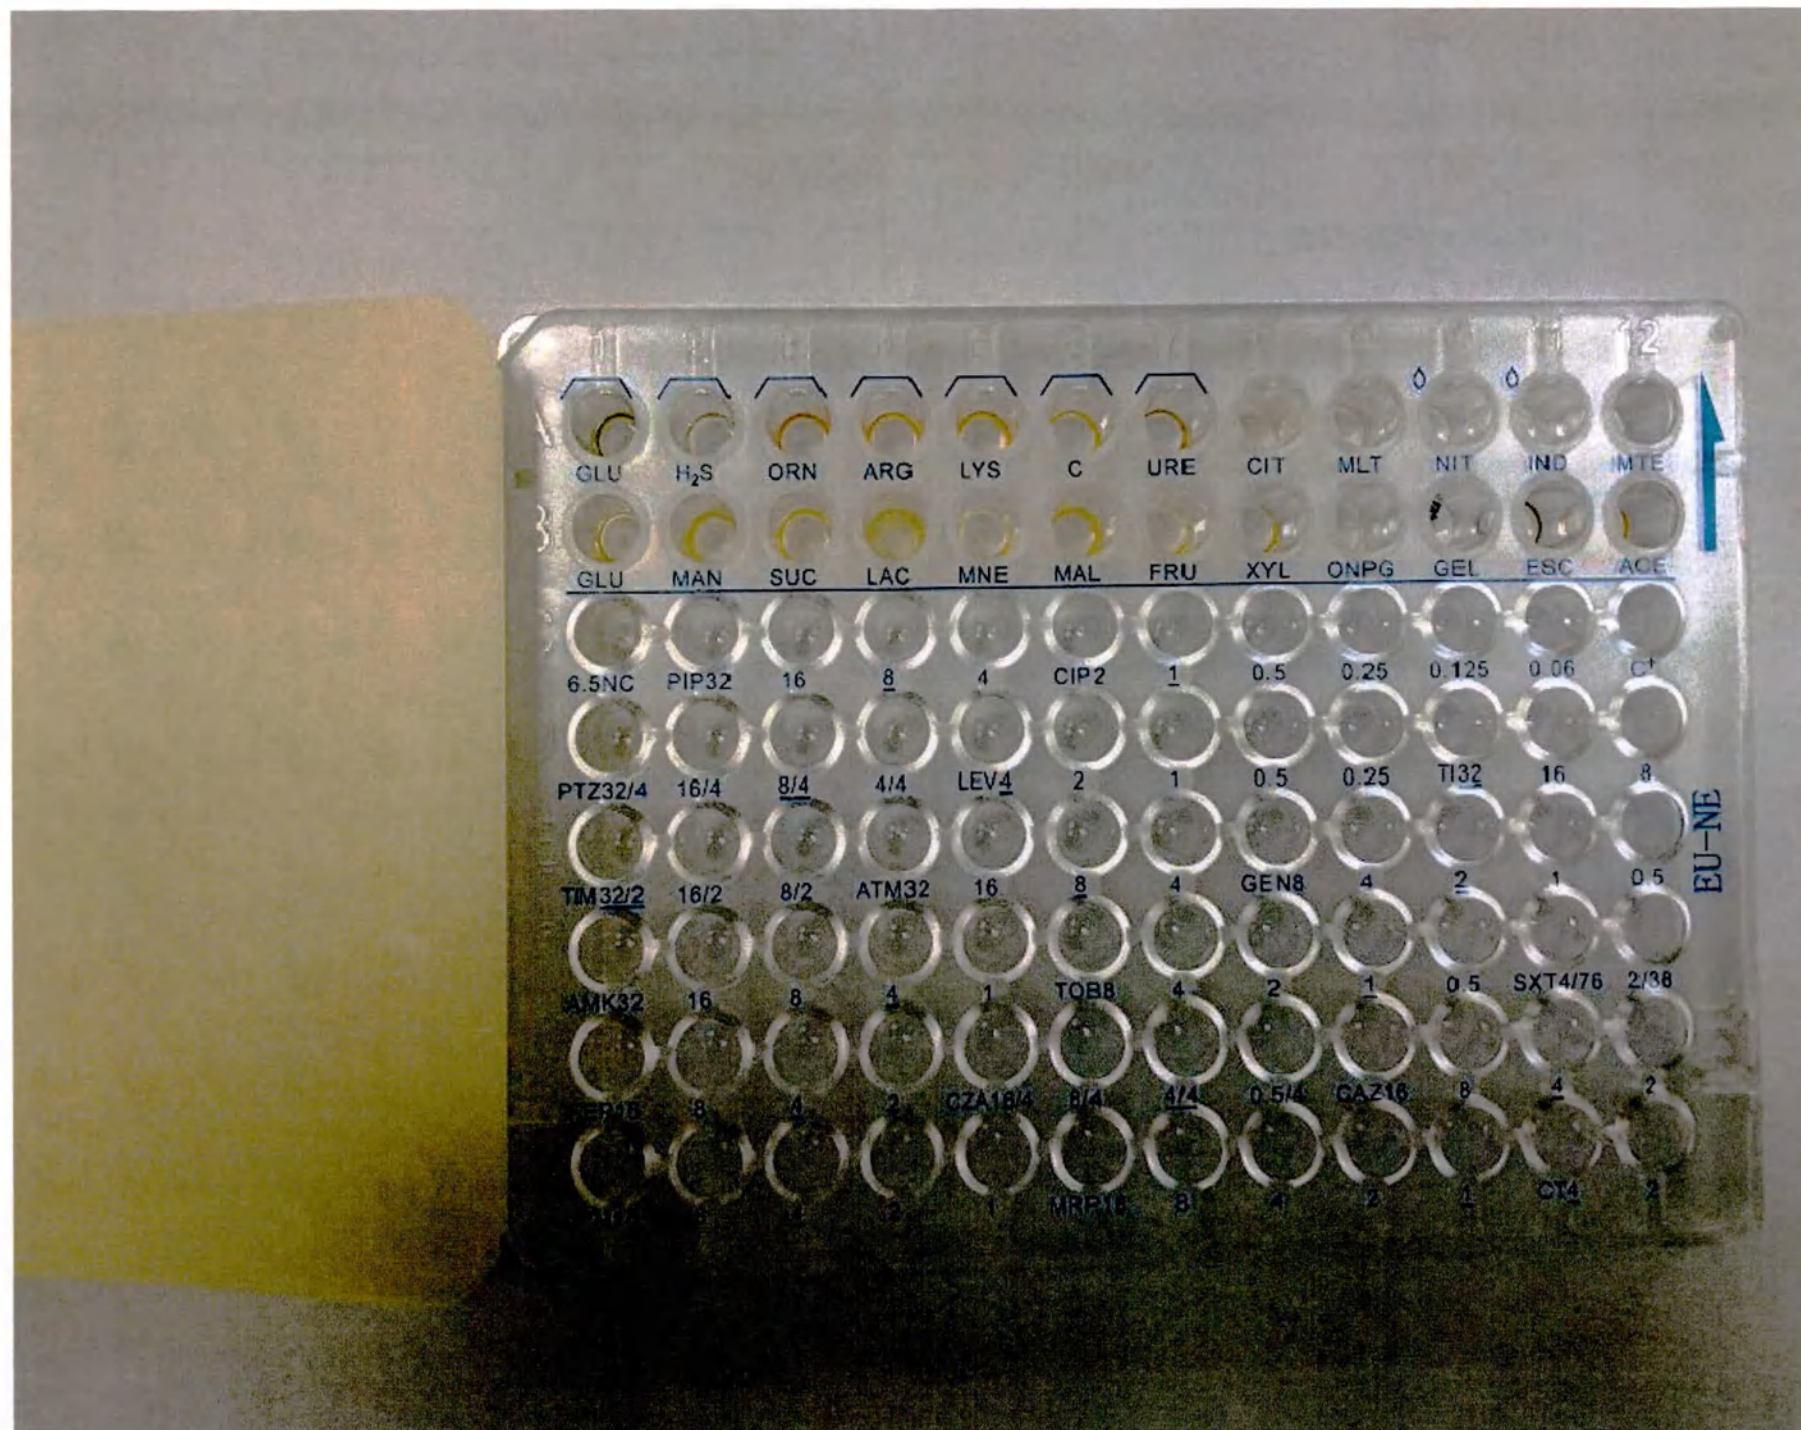


Тестовая карта IST Card (DL-96NE) (вид сверху)





Дилуэнт (4,5 мл)



МН-бульона (9,0 мл)



Вспомогательный реагент NIT A (2,0 мл)



Вспомогательный реагент NIT B (2,0 мл)



Вспомогательный реагент IND (2,0 мл)



Оксидазный реагент (1,0 мл)



Парафиновое масло стерильное (9,0 мл)

Набор реагентов IST Card (DL-96NE) для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам неферментирующих бактерий и положительных по тесту на оксидазу грамотрицательных палочек на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики, в составе:

1. Тестовая карта IST Card (DL-96NE) – 10 шт.
2. Дилуэнт (4,5 мл) – 10 флаконов.
3. МН-бульон (9,0 мл) – 10 флаконов.
4. Вспомогательный реагент NIT A (2,0 мл) – 1 флакон.
5. Вспомогательный реагент NIT B (2,0 мл) – 1 флакон.
6. Вспомогательный реагент IND (2,0 мл) – 1 флакон.
7. Оксидазный реагент (1,0 мл) – 1 флакон.
8. Парафиновое масло стерильное (9,0 мл) – 1 флакон.
9. Инструкция по применению – 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «МИРУС МЕДИКАЛ» (ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»)

Адрес: 115114, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ КОЖЕВНИЧЕСКАЯ, Д. 10 СТР. 1

Тел.: +7 499 579 3303

E-mail: info@mirus-medical.com

Производитель:

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd. (Чжухай ДиЭль Биотех Ко. Лтд)

Адрес: No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам неферментирующих бактерий и положительных по тесту на оксидазу грамотрицательных палочек.

Для применения с автоматическими анализаторами для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам

Реагенты для диагностики in vitro.

Хранить при температуре от +2°C до +8°C

Регистрационное удостоверение № _____ от _____. ____ г



Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

INSTRUCTION FOR USE/ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Reagent Kit IST Card (DL-96NE) for identification and
determination of antimicrobial sensitivity of non-fermenting
bacteria and positive for oxidase of gram-negative bacillus on DL-
96A and D2mini analyzers for in vitro diagnostics**

**/ Набор реагентов IST Card (DL-96NE) для идентификации и
определения чувствительности к антимикробным препаратам
неферментирующих бактерий и положительных по тесту на
оксидазу грамотрицательных палочек на анализаторах DL-96A
и D2mini для in vitro диагностики**

Manufacturer/ Производитель

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd., No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong Province, 519040,
P.R. China

«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ»
CEO / Исполнительный Директор
Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

Lin Huaqing

Stamp/печать



Date: 03-03-2024

Rev. 1.0, 03-2024 / Ред. 1.0, 03-2024



Прошито, пронумеровано

20 (двадцать) листа(ов)

ООО «Мирус Медикал»

Данилов П.А.

