

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»





Перцева Н. Н.


«10» декабря 2024 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов для количественного определения концентрации миоглобина в сыворотке и плазме крови человека (MYO CLIA Microparticles (MYO)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

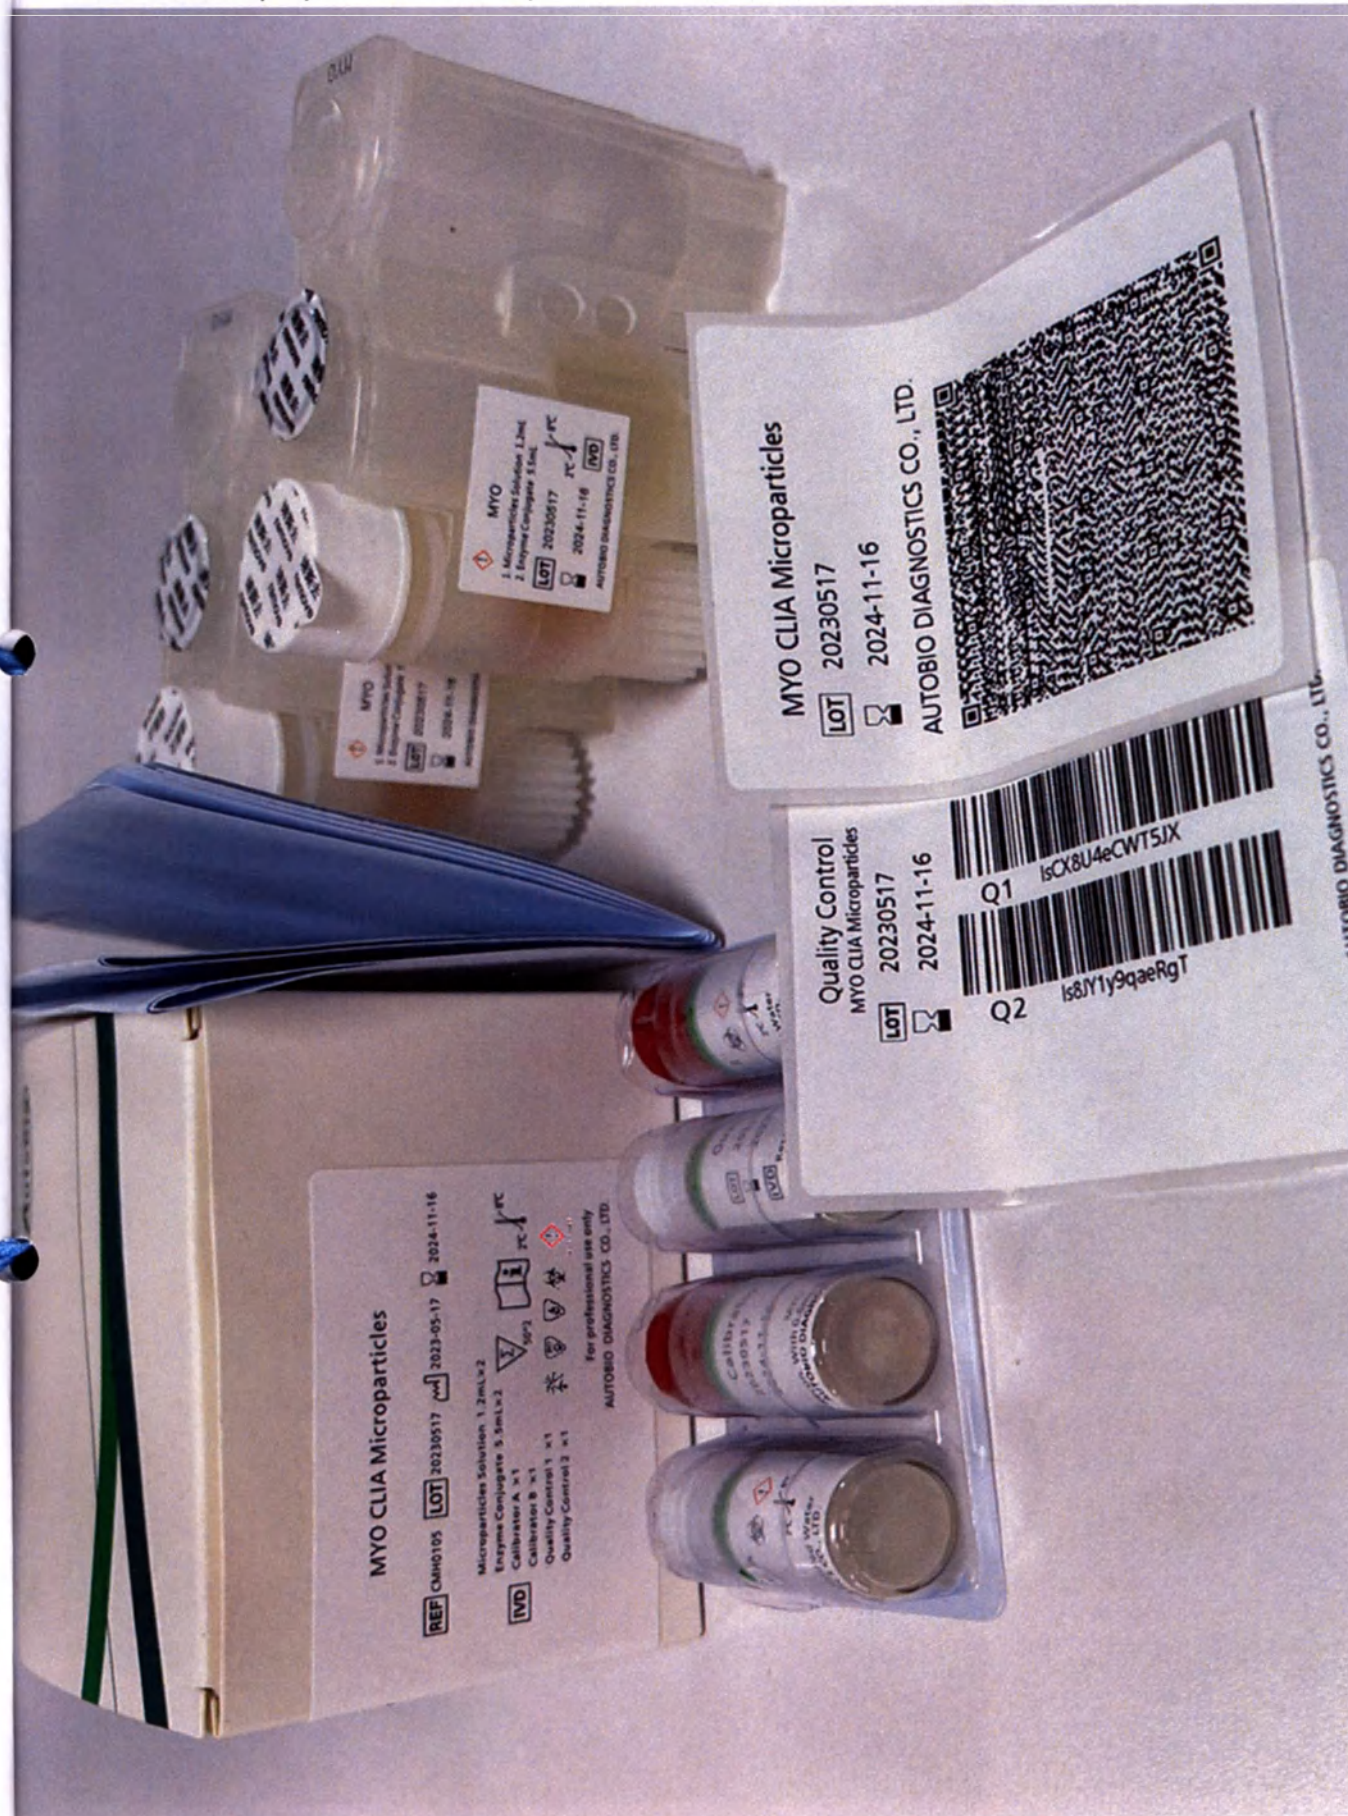

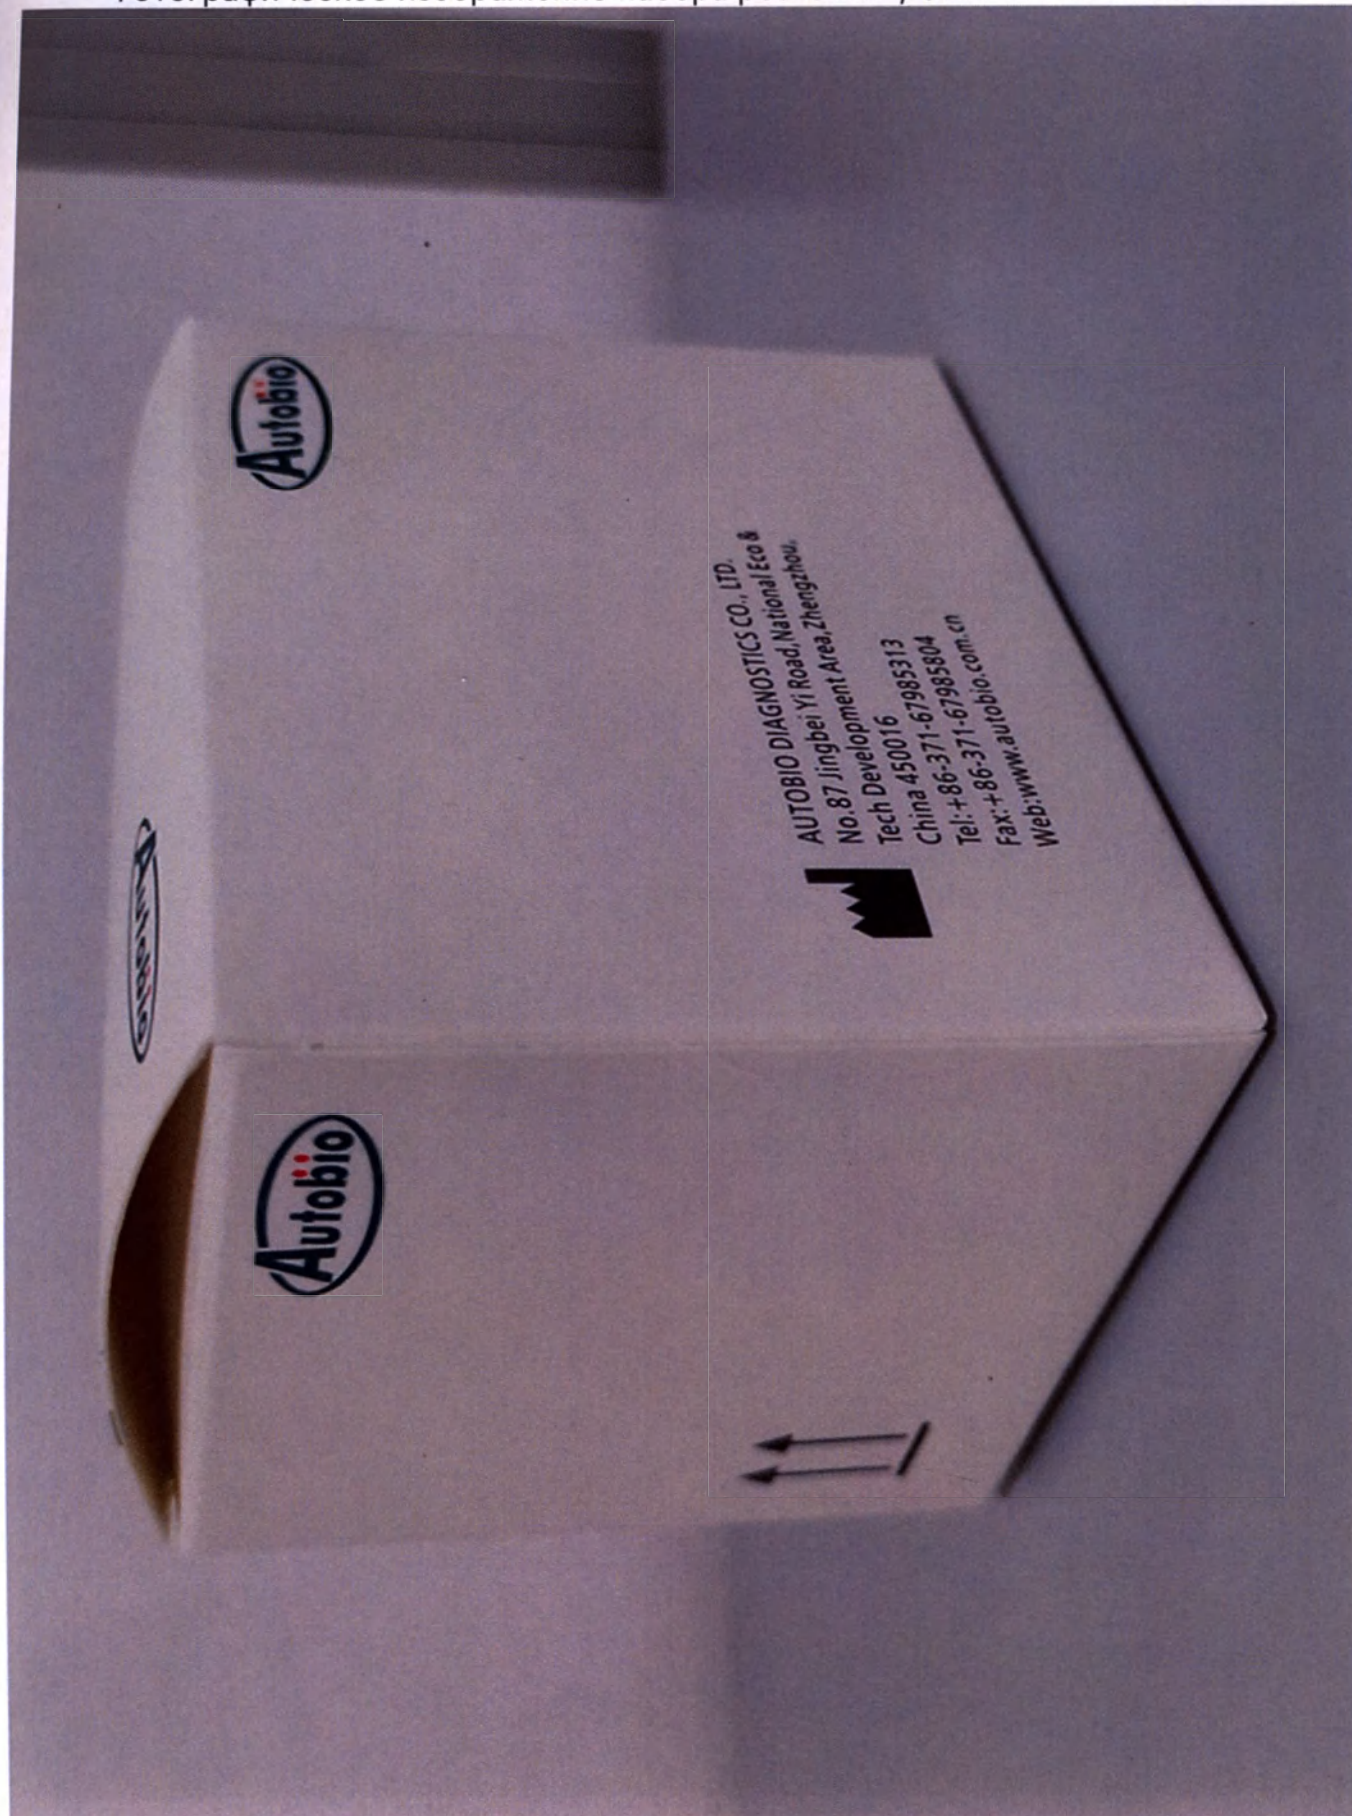

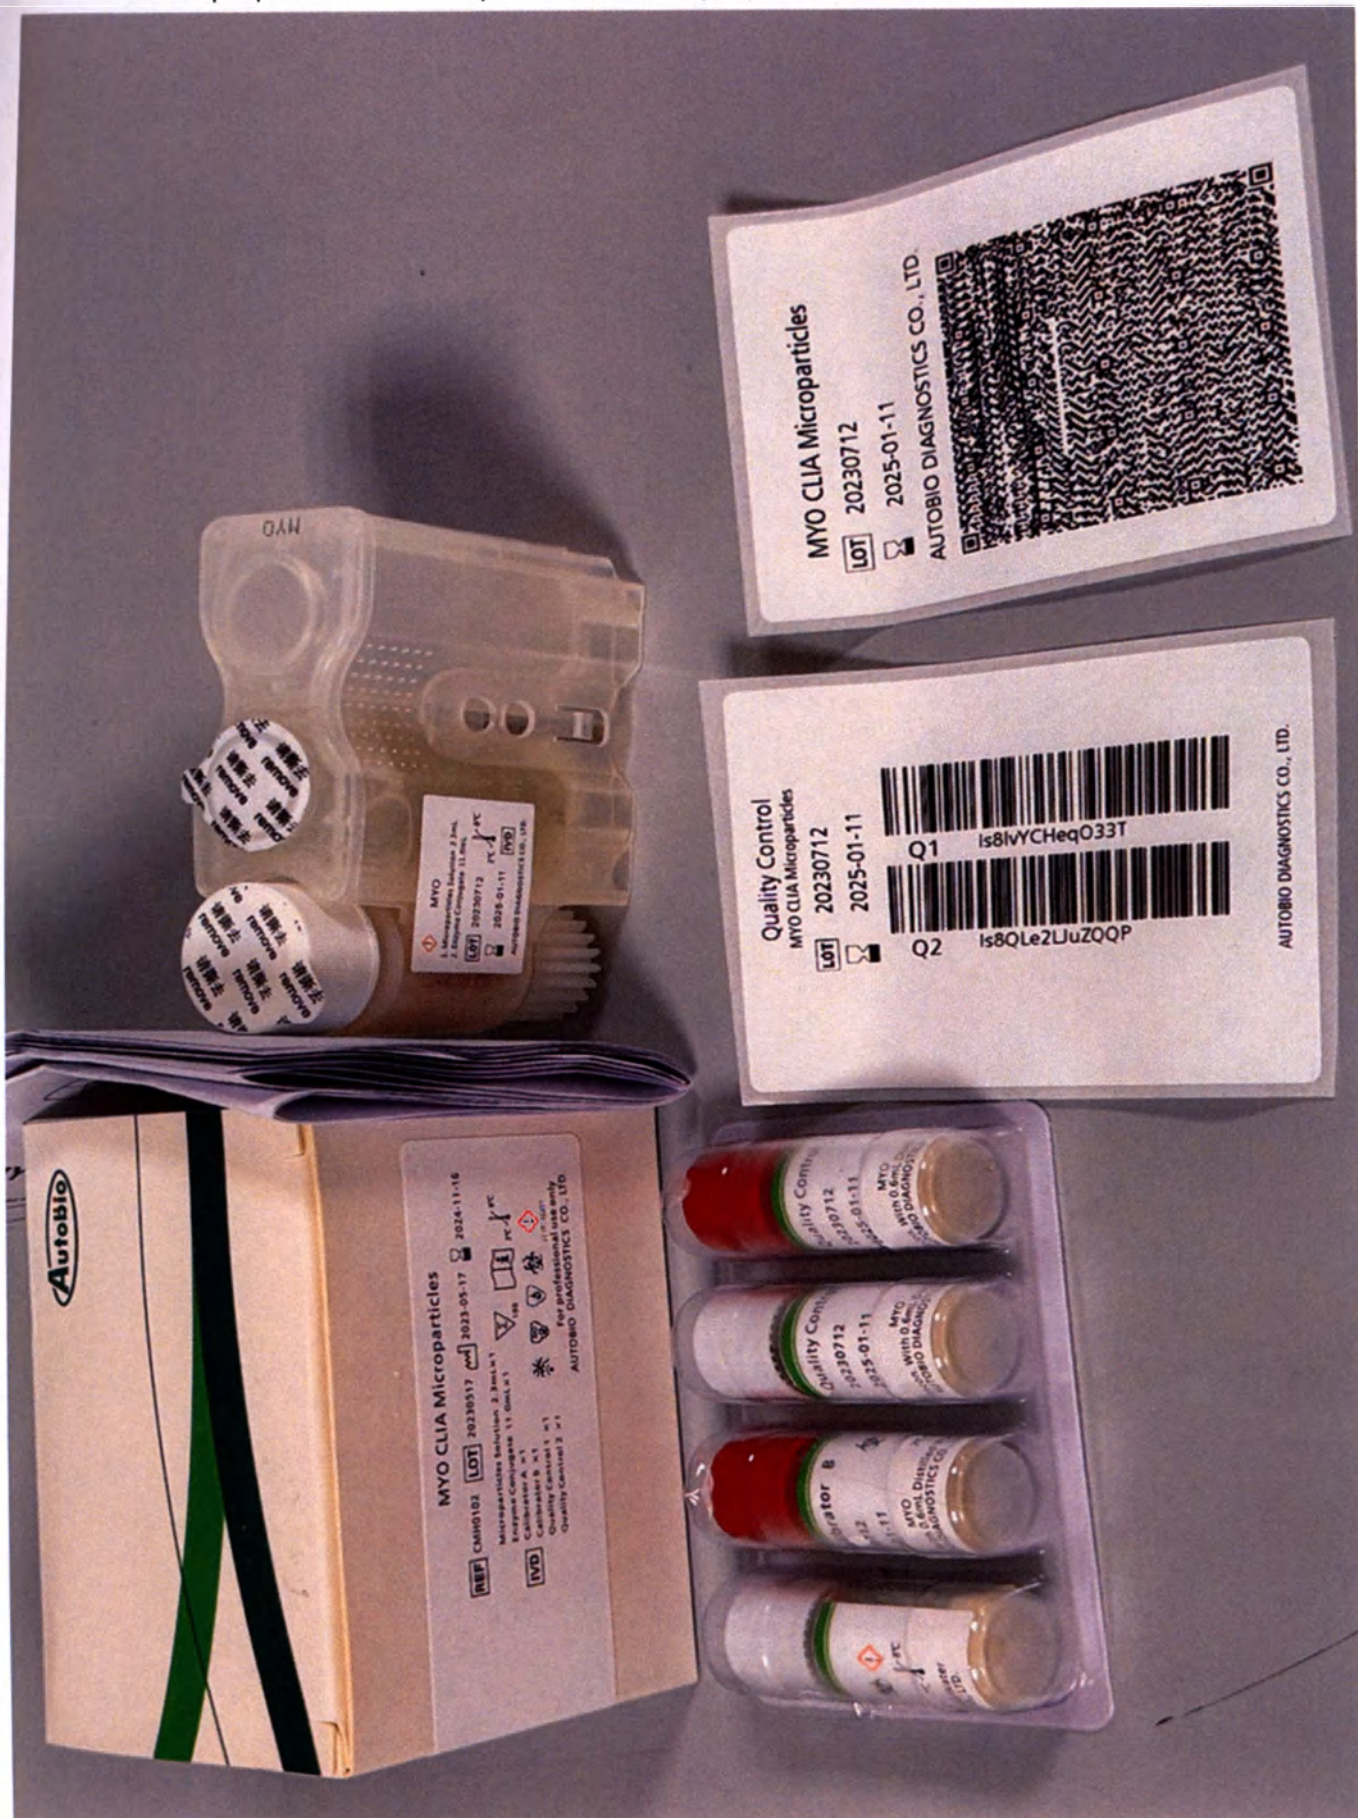

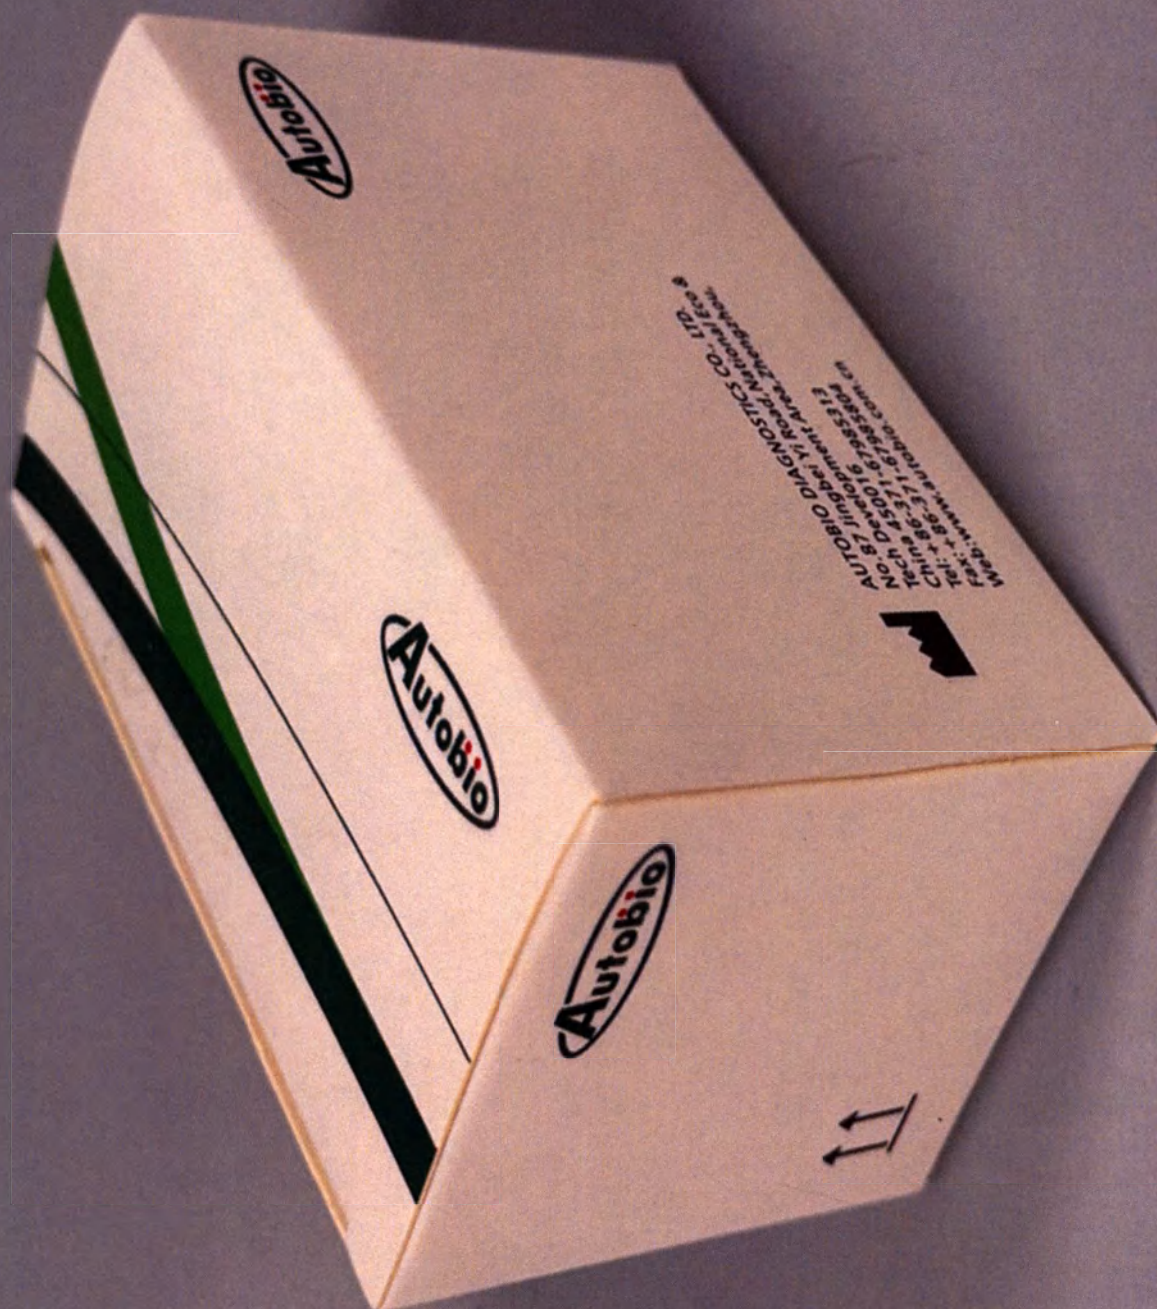






фотографическое изображение калибраторов: Калибратор А (Calibrator A) и Калибратор В (Calibrator B)



фотографическое изображение контролей низкого уровня (Quality control 1) и высокого уровня (Quality control 2)

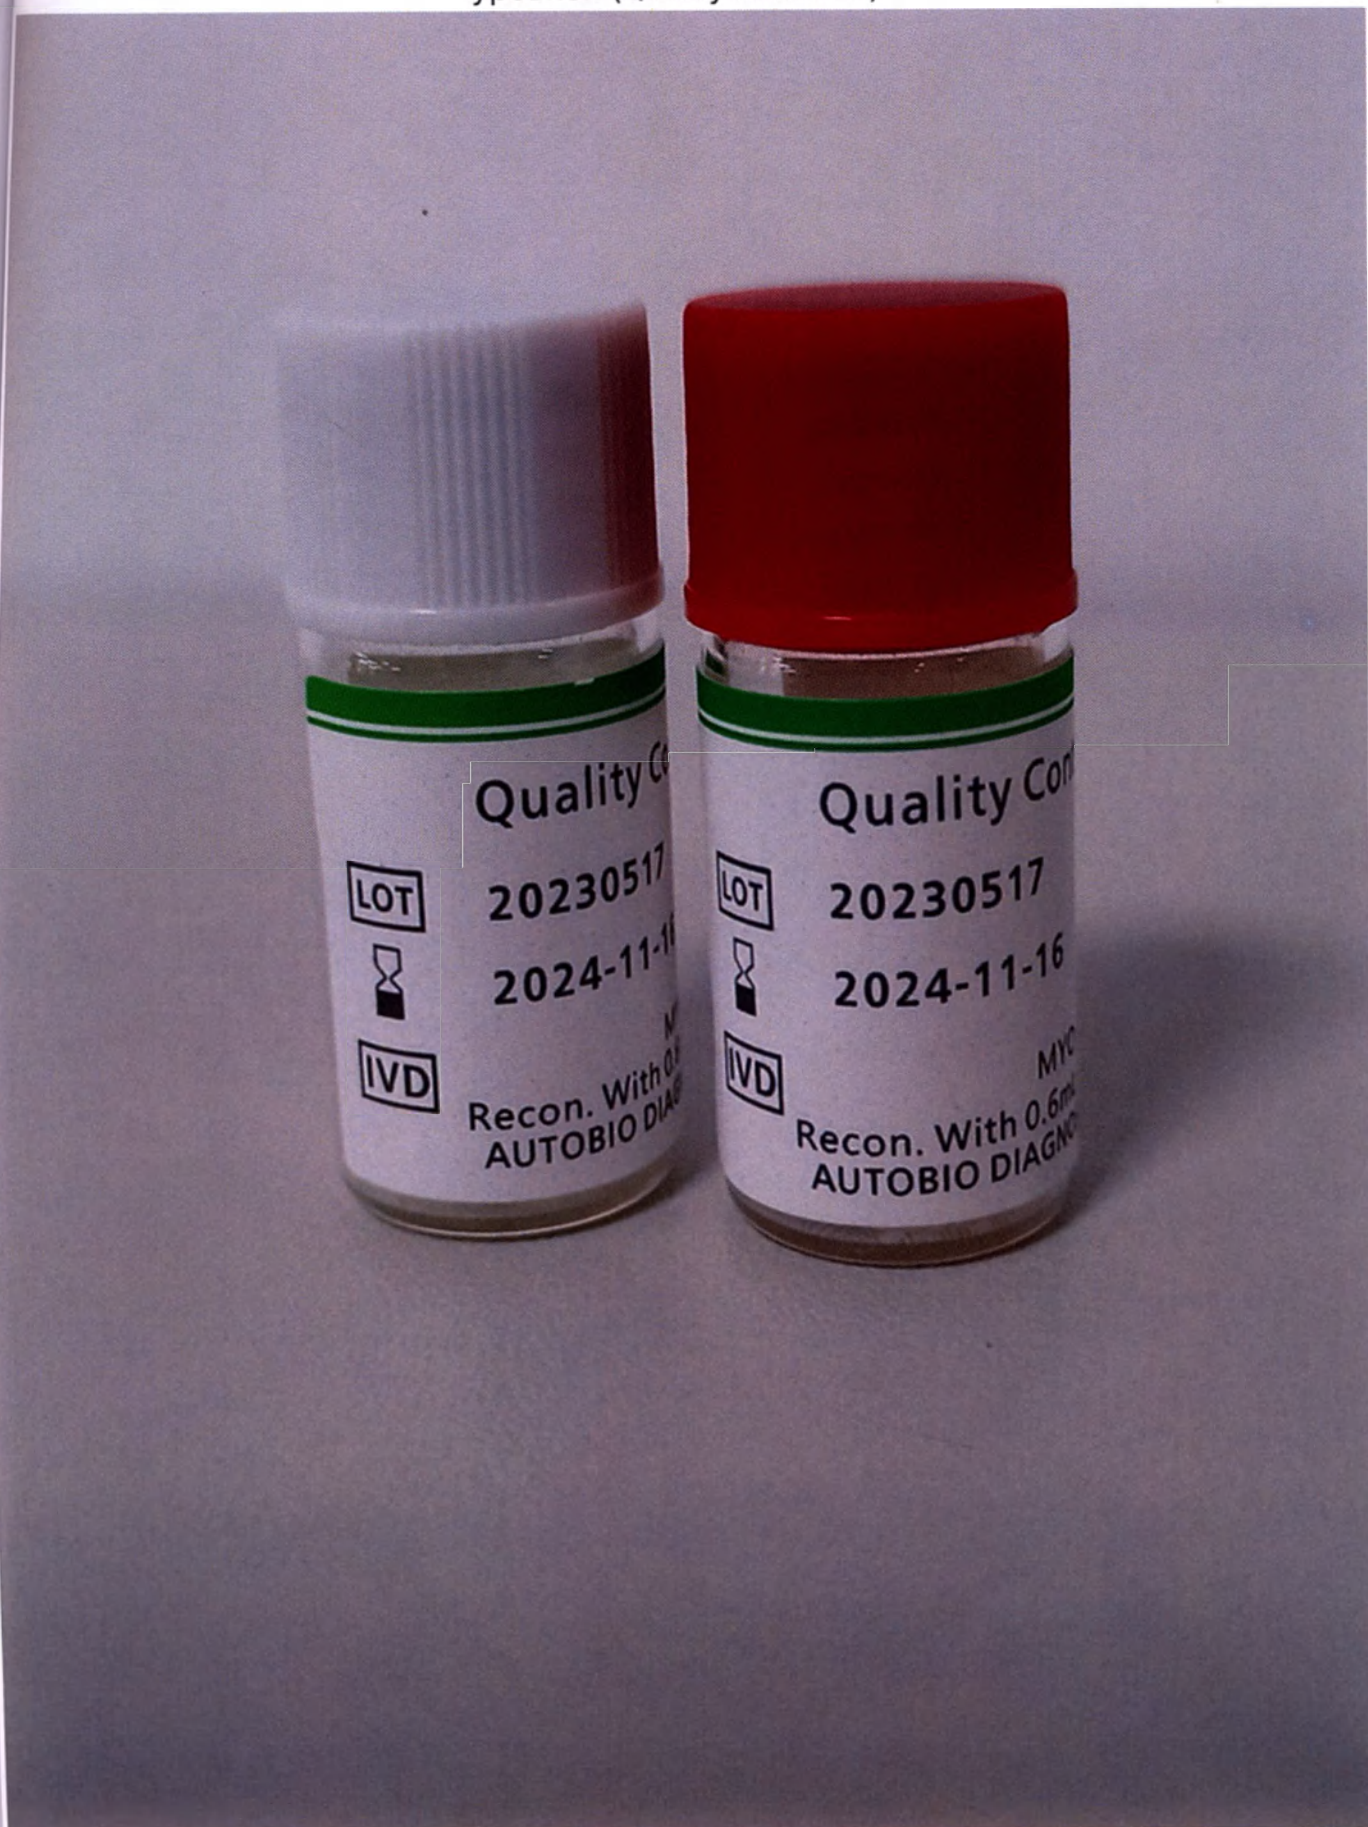






Фотографическое изображение картриджей
Вариант картриджа № 1



Фотографическое изображение картриджей
Вариант картриджа № 2

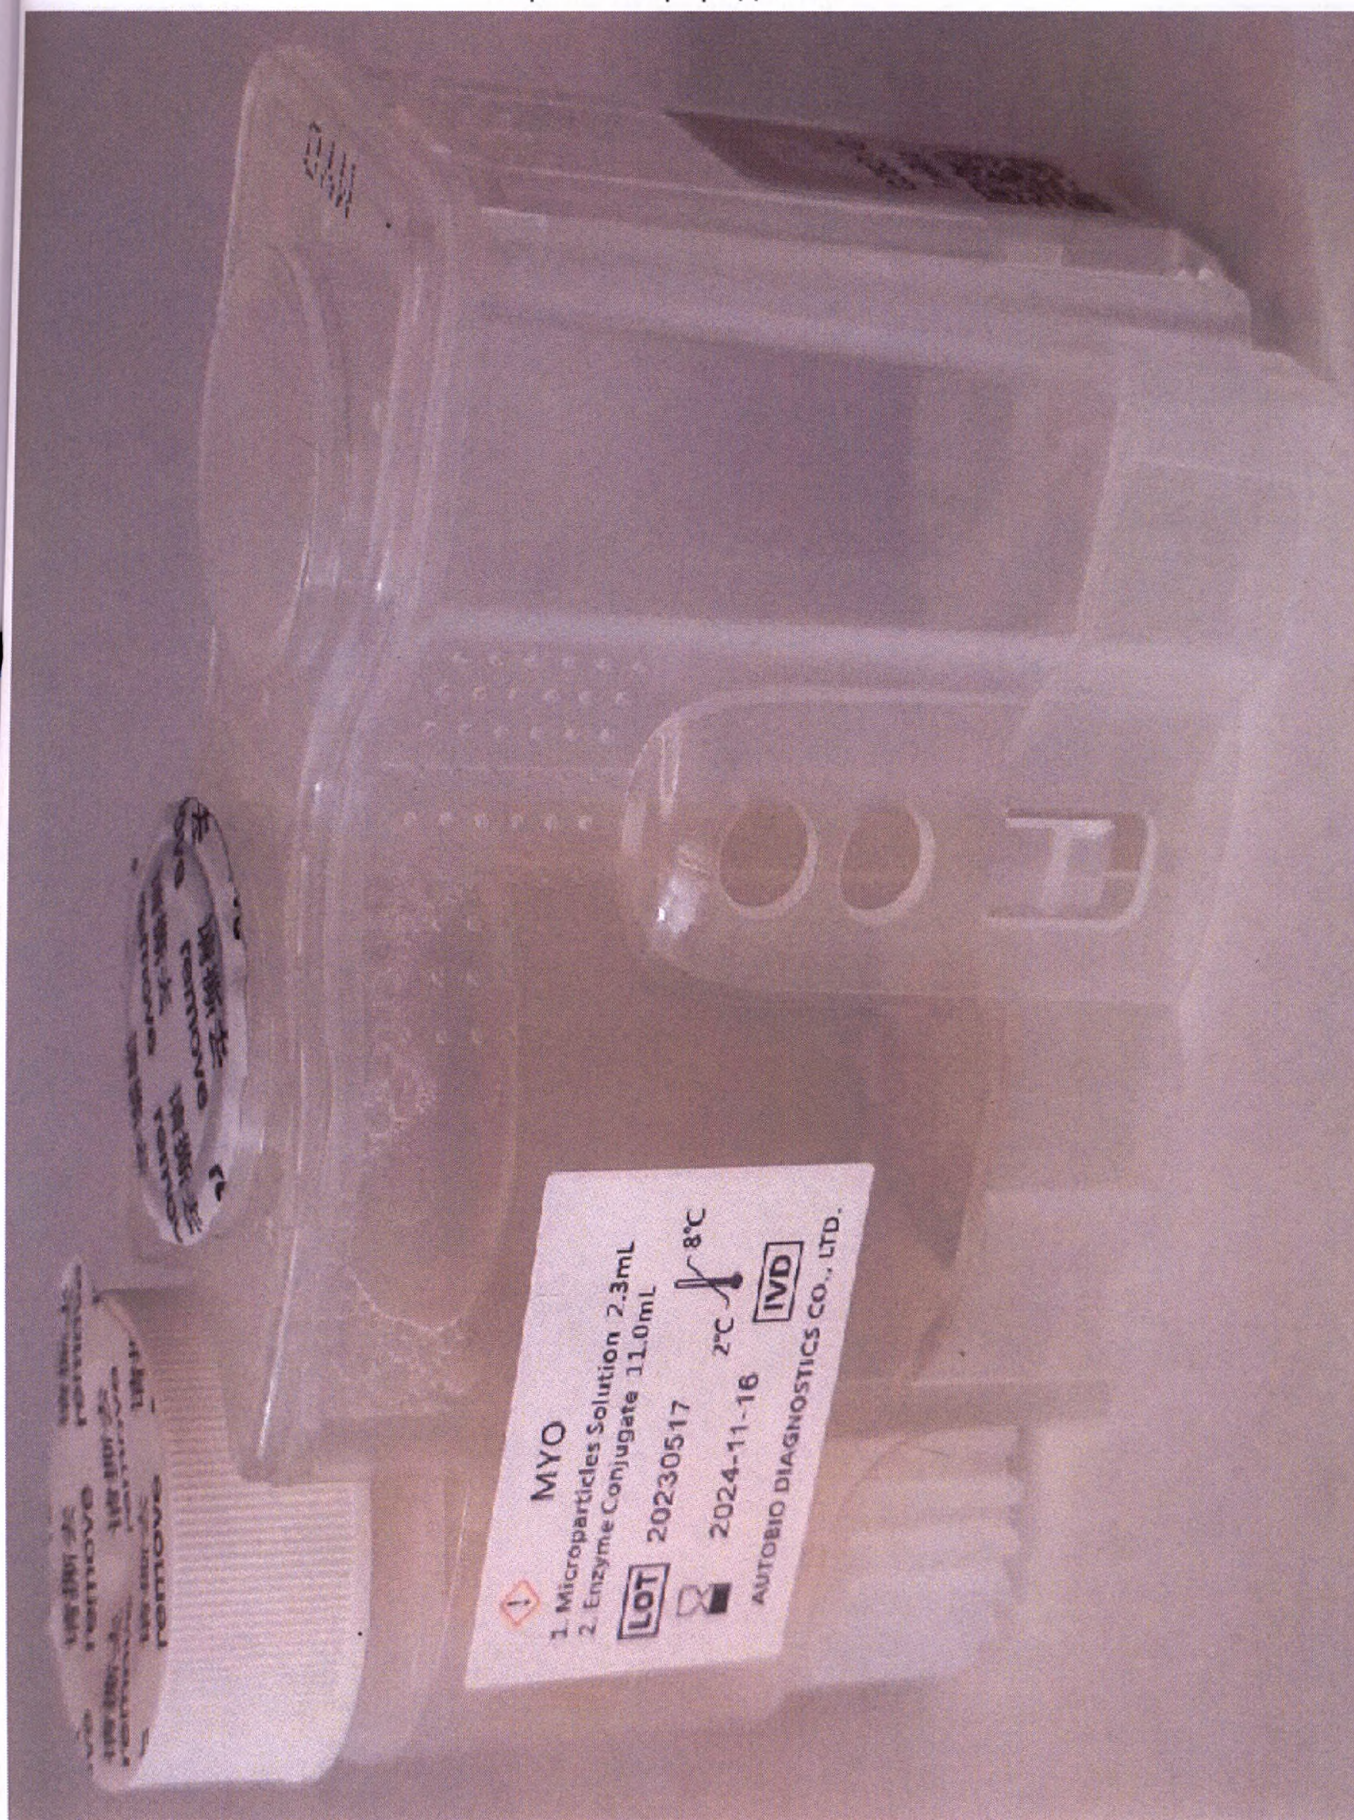

1 MYO
1. Microparticles Solution 2.3ml
2. Enzyme Conjugate 11.0ml
LOT 20230517
2024-11-16
2°C / 8°C
IVD
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

фотографическое изображение примера транспортной упаковки медицинского изделия:



MYO CLIA Microparticles

REF CMH0102

LOT



Microparticles Solution 2.3mL x 1
Enzyme Conjugate 11.0mL x 1
Calibrator A x 1
Calibrator B x 1
Quality Control 1 x 1
Quality Control 2 x 1

IVD



For professional use only
H317, H412
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения концентрации миоглобина в сыворотке и плазме крови человека (MYO CLIA Microparticles (MYO)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серий AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Набор реагентов для количественного определения концентрации миоглобина в сыворотке и плазме крови человека (MYO CLIA Microparticles (MYO)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серий AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

MYO CLIA Microparticles


REF CMH0105

LOT



Microparticles Solution 1.2mL x 2
Enzyme Conjugate 5.5mL x 2
Calibrator A x 1
Calibrator B x 1
Quality Control 1 x 1
Quality Control 2 x 1

IVD



For professional use only
H317, H412
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Calibrator A

LOT



IVD



MYO
Recon. With 0.6mL Distilled Water
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C

 8°C

Calibrator B

LOT



IVD



MYO
Recon. With 0.6mL Distilled Water
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C

 8°C

Маркет маркировки контроля (Quality Control 1 и Quality Control 2)

Quality Control 1

LOT



IVD



MYO
Recon. With 0.6mL Distilled Water
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C

 8°C

Quality Control 2

LOT



IVD



MYO
Recon. With 0.6mL Distilled Water
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C

 8°C




MYO

1. Microparticles Solution 1.2mL
2. Enzyme Conjugate 5.5mL

LOT

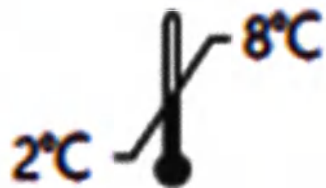

**2°C**
8°C

IVD

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.




MYO

1. Microparticles Solution 2.3mL
2. Enzyme Conjugate 11.0mL

LOT

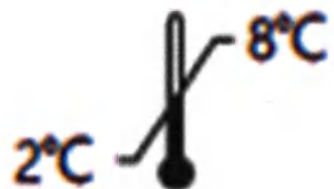

**2°C**
8°C

IVD

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

(сценарий)

листах

