





1. Электронный блок (исполнение А)

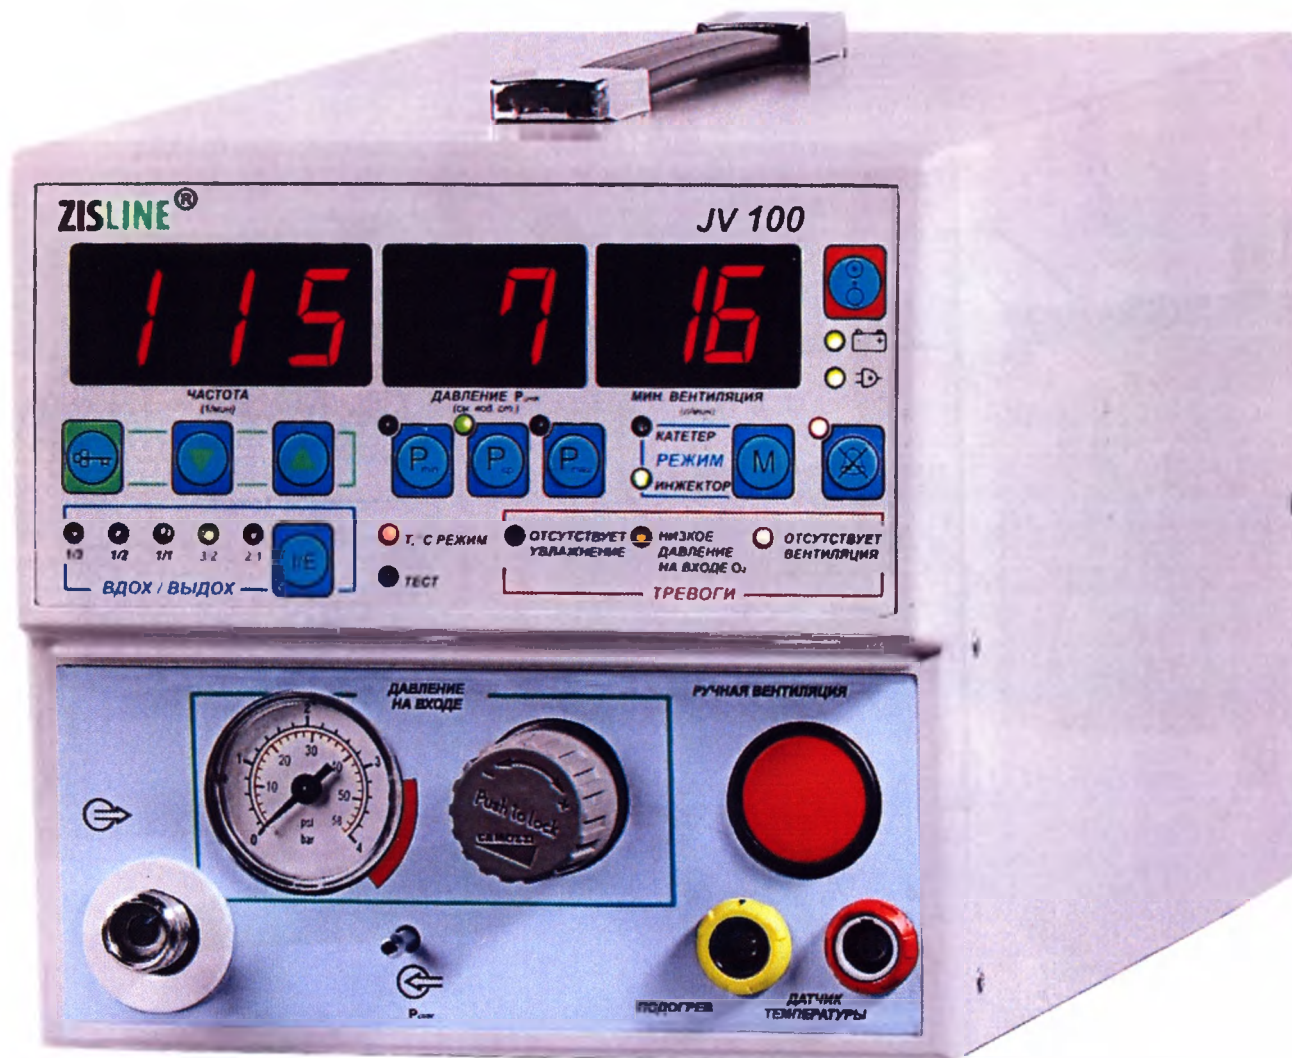

1. Электронный блок (исполнение Б)

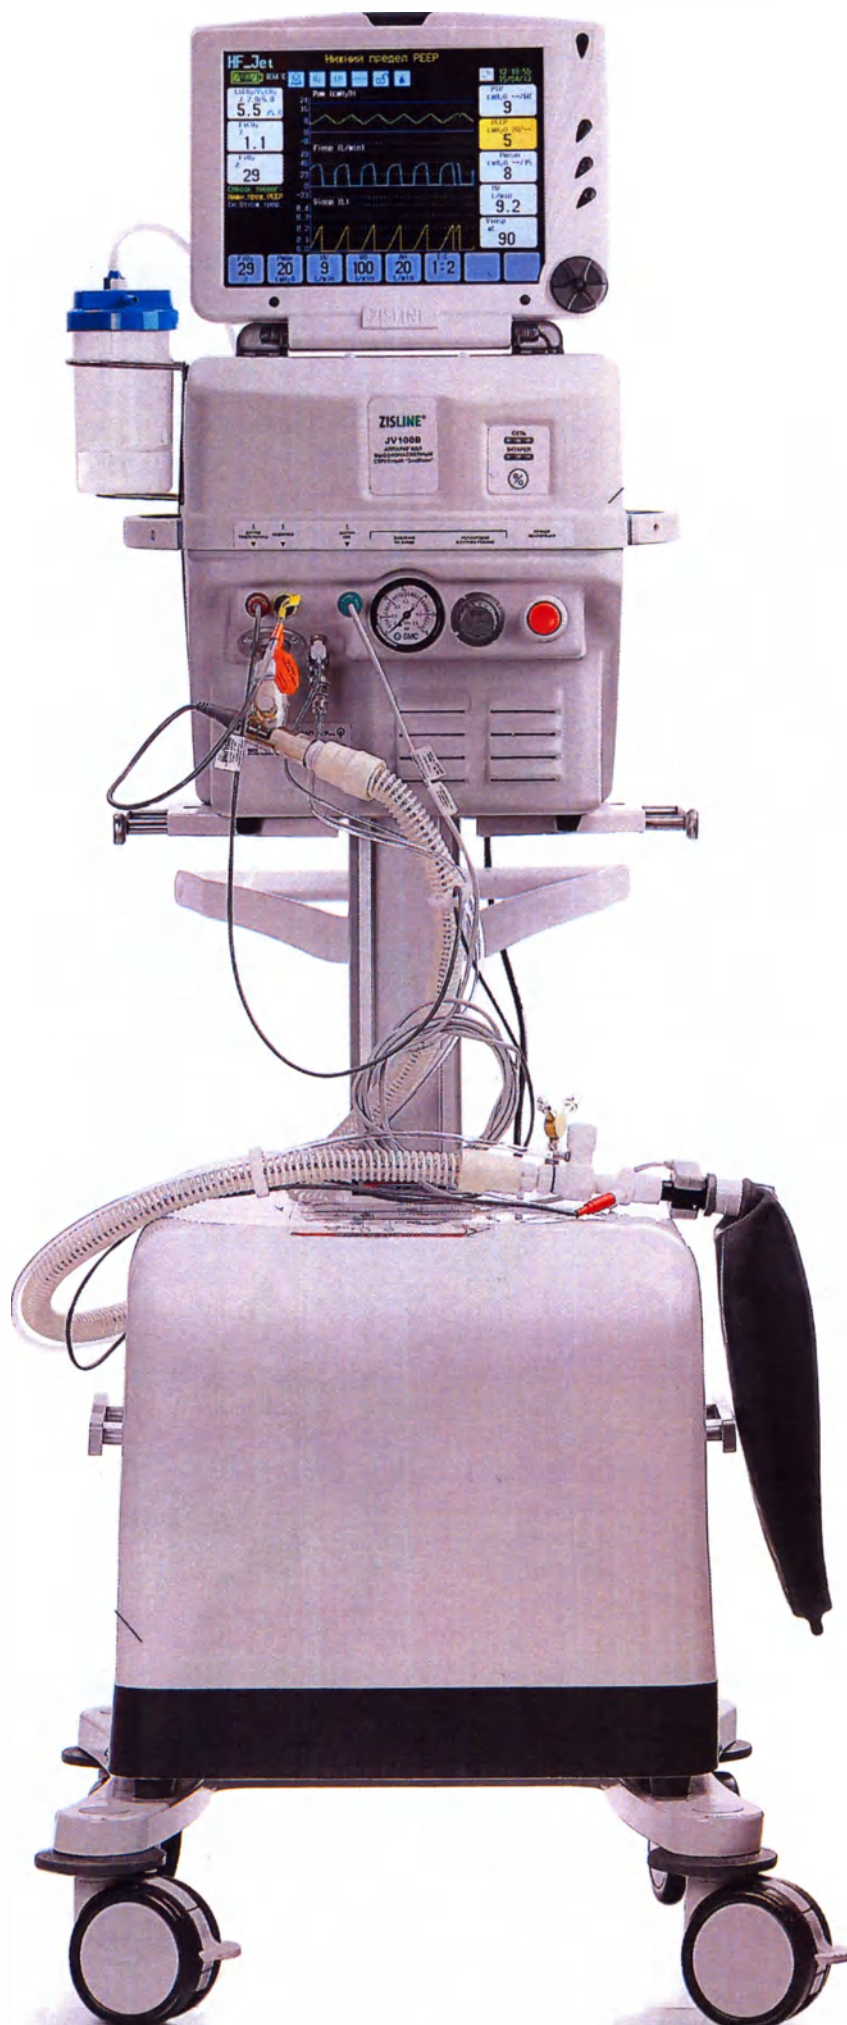

2. Кабель питания

3. Шланг пациента с подогревом



4. Шланг кислородный



5. Шланг воздушный





6. Держатель емкости для дистиллированной воды



7. Держатель мешка



8. Переходник (для катетерной вентиляции)

9. Переходник (для инъекционной вентиляции)





10. Переходник (для безинжекционной вентиляции)

11. Адаптер (для эндотрахеальных трубок)






12. Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры,
производства "Intersurgical Ltd", Великобритания



12. Тепловлагообменник с фильтрующим элементом, производства «Teleflex Medical»



12. Фильтры, производства "Flexicare Medical Limited"

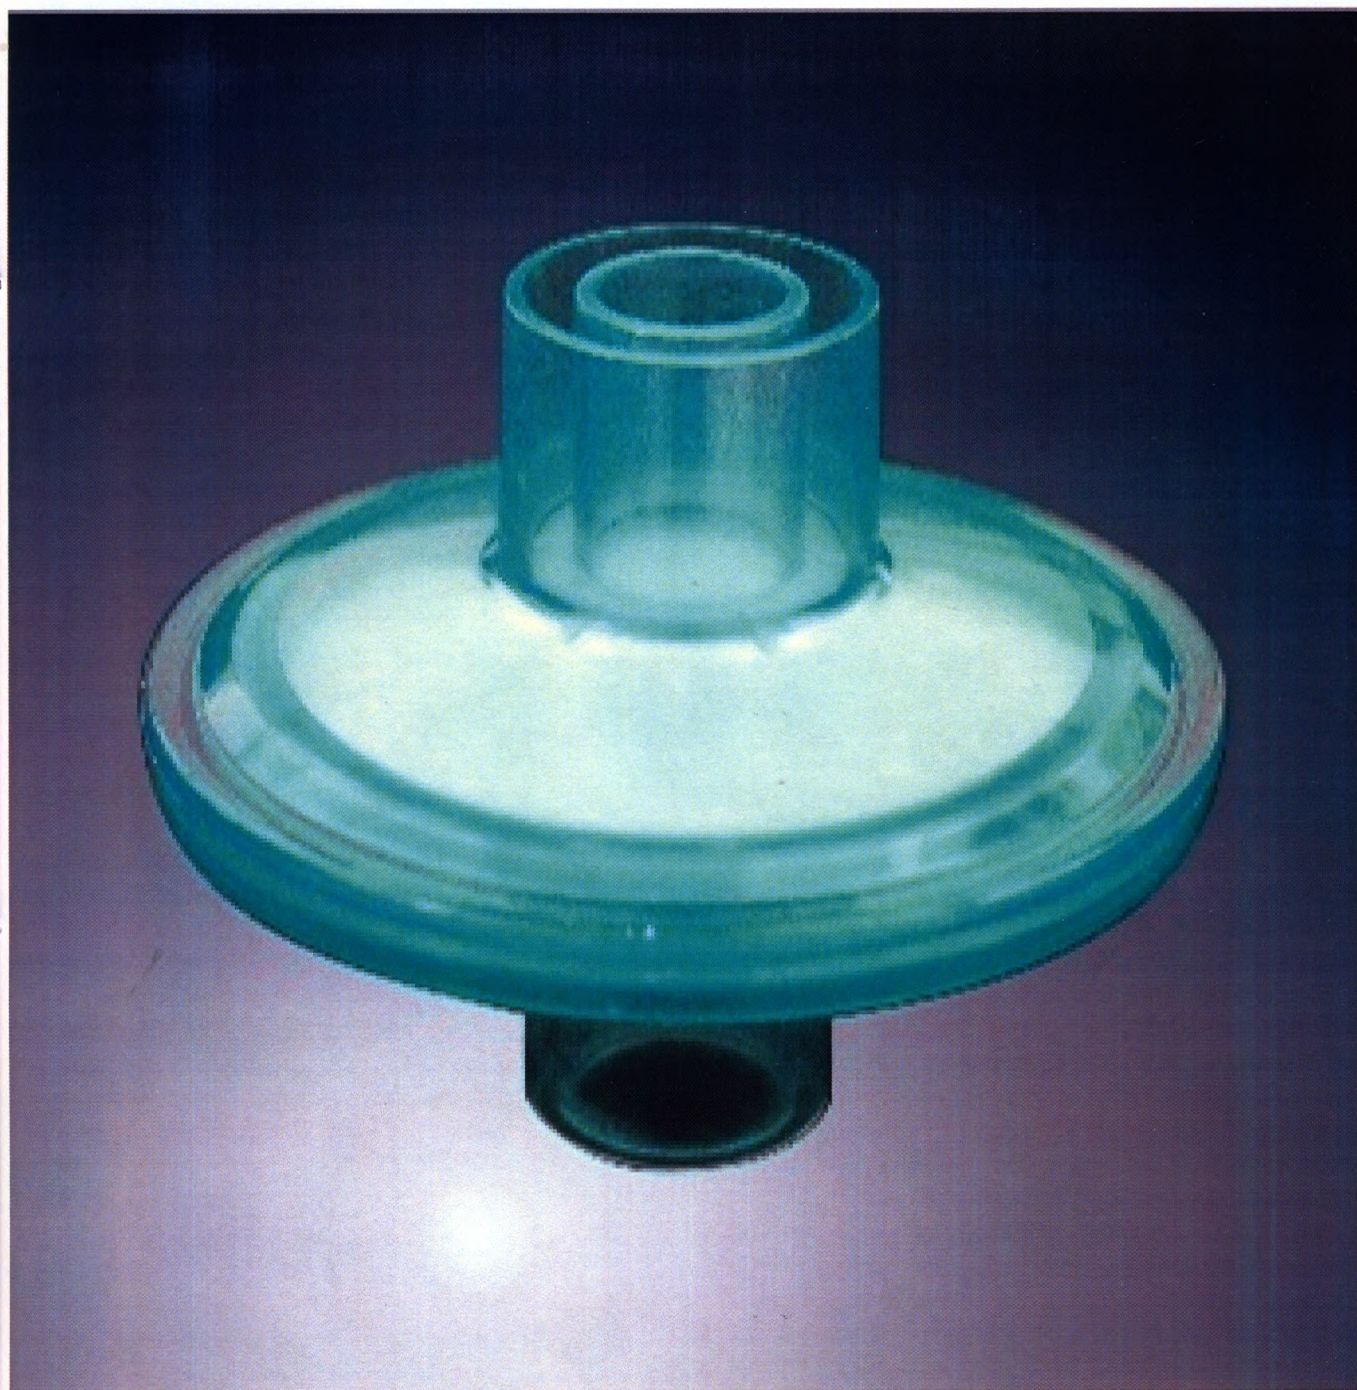

12. Фильтр, производства
«VADI Medical Technology
Co.,Ltd»




2. Фильтры воздушные, производства «Covidien Llc»



13. Емкость для дистиллированной воды

14. Штанга

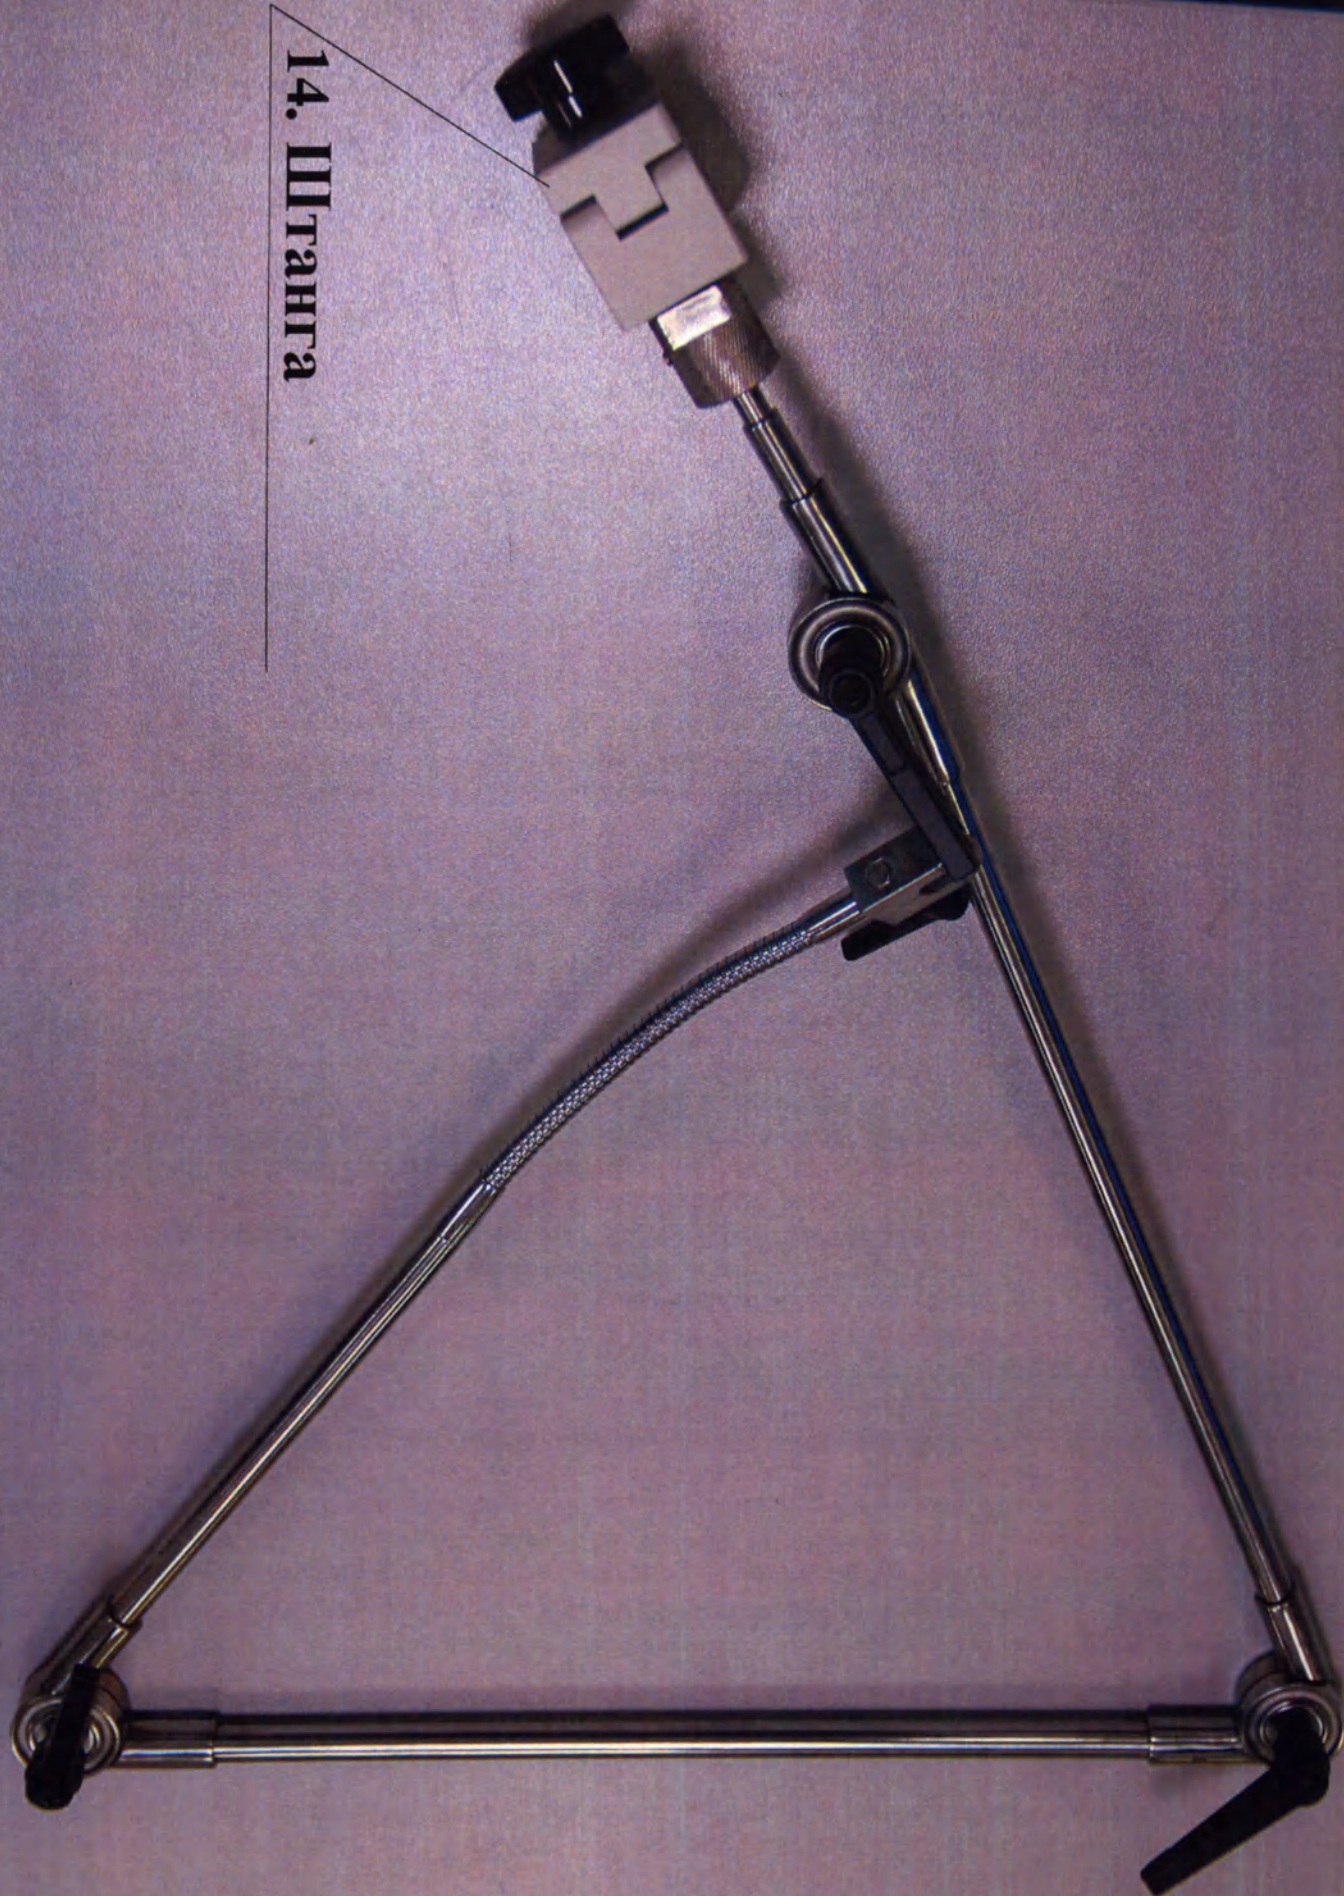

15. Струна для протяжки гибкого нагревателя






16. Дыхательные мешки, производства «Intersurgical Ltd»




**16. Мешок дыхательный для вентиляции,
производства «Teleflex Medical»**



16. Тестовое легкое, производства «VADI Medical Technology Co.,Ltd»

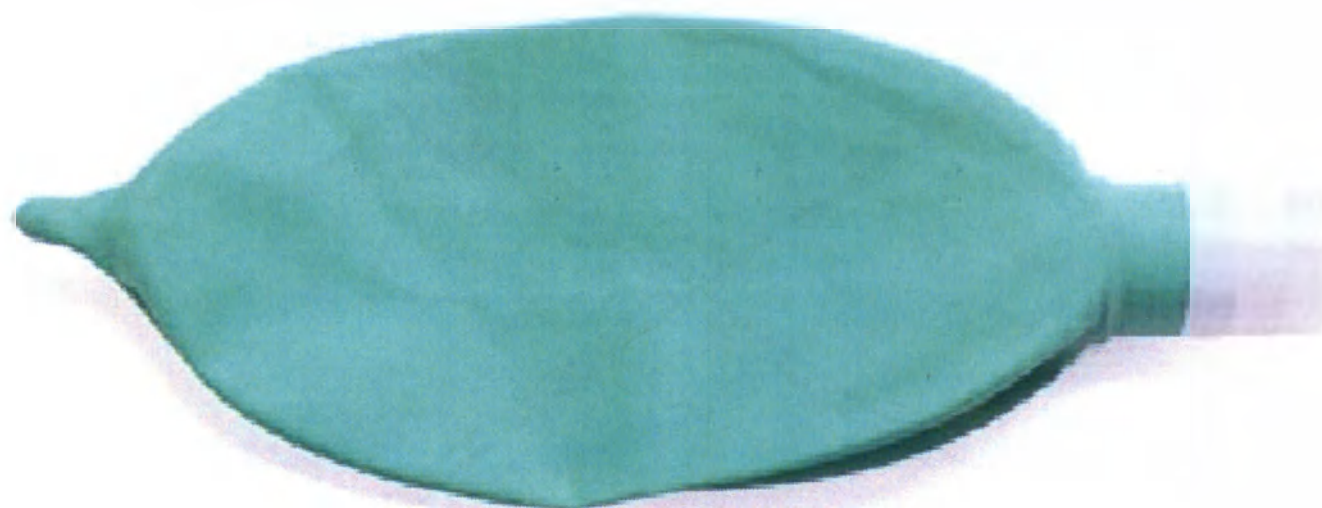


16. Мешки, производства «Flexicare Medical Limited»

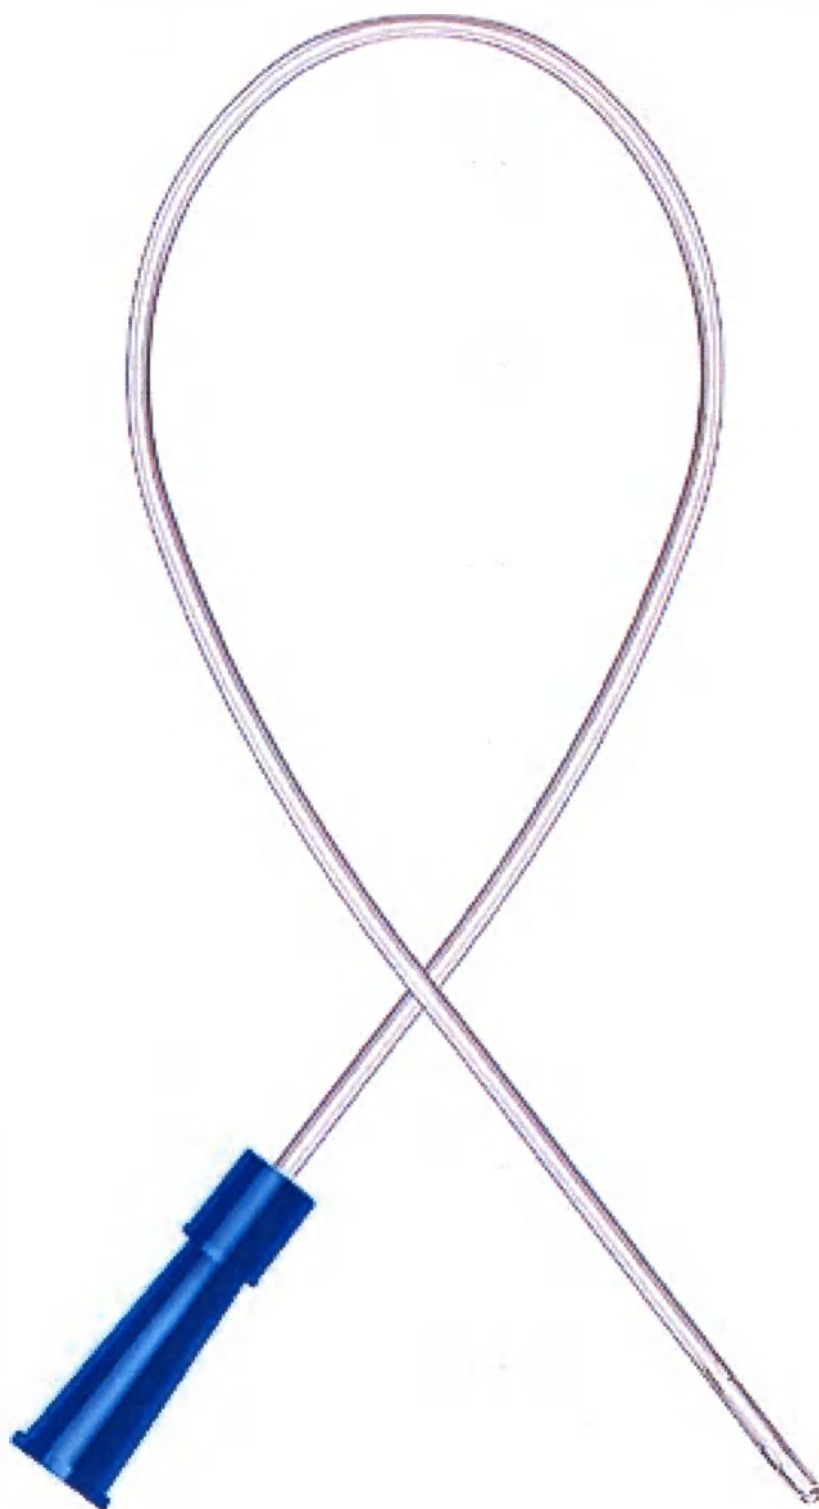


17. Катетер

18. Вода дистиллированная стерильная в полимерных пакетах 500 мл

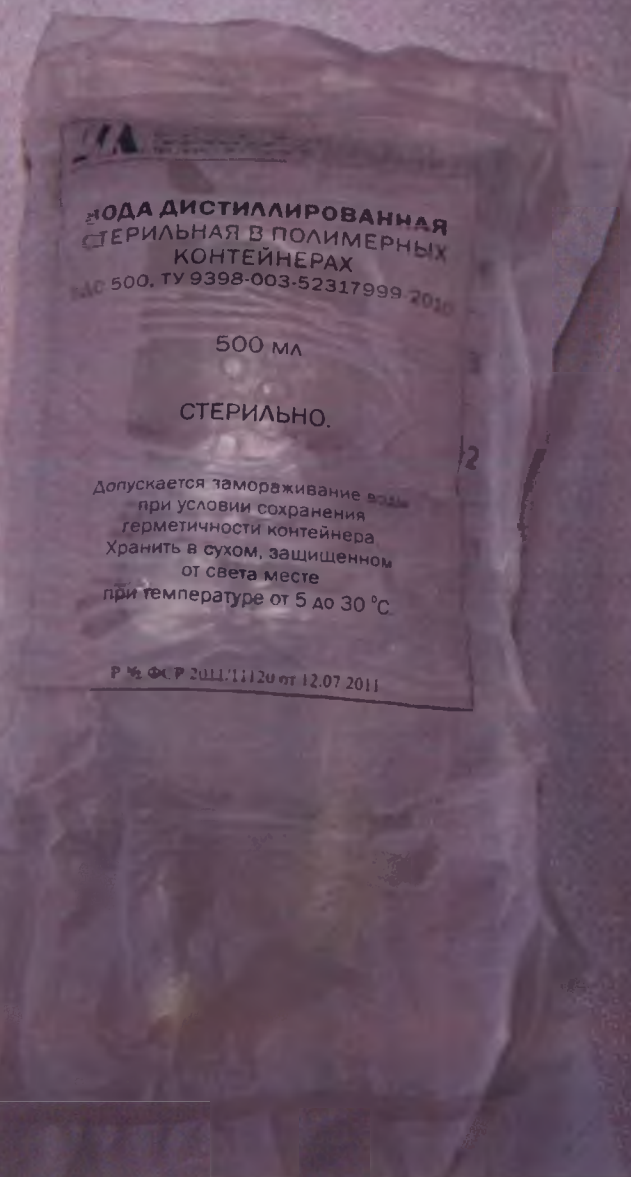


19. Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы)


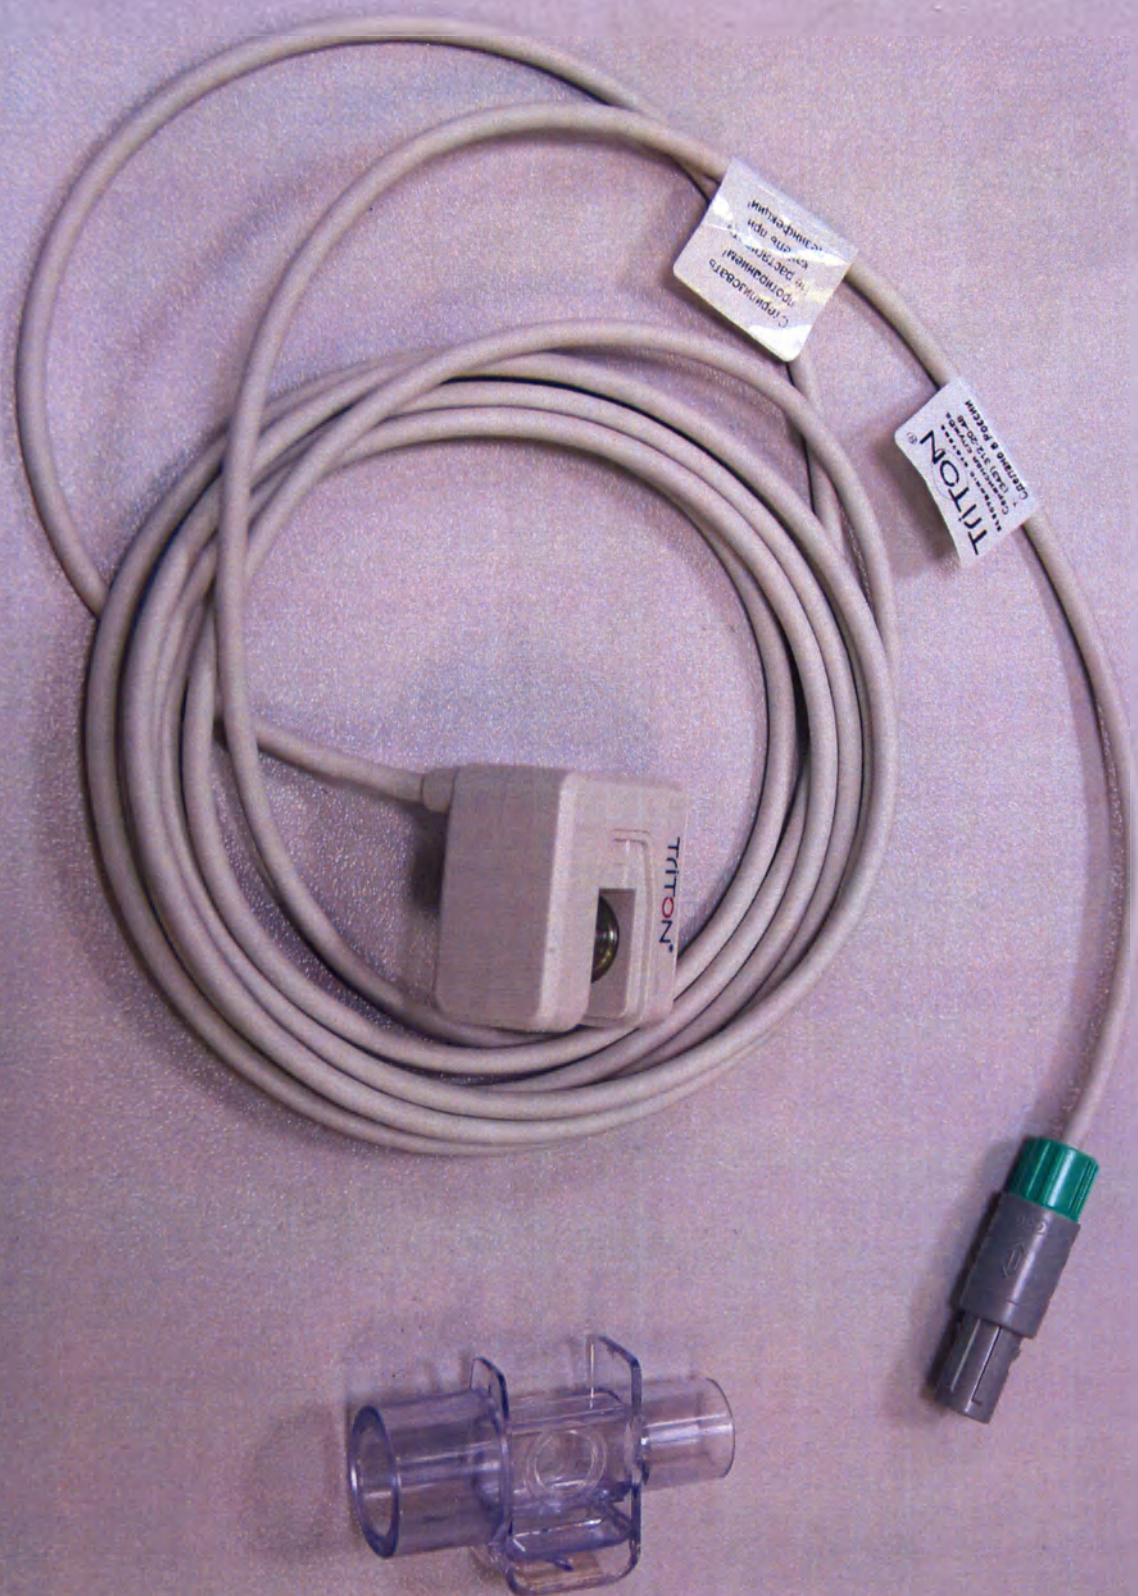


20. Тележка транспортная



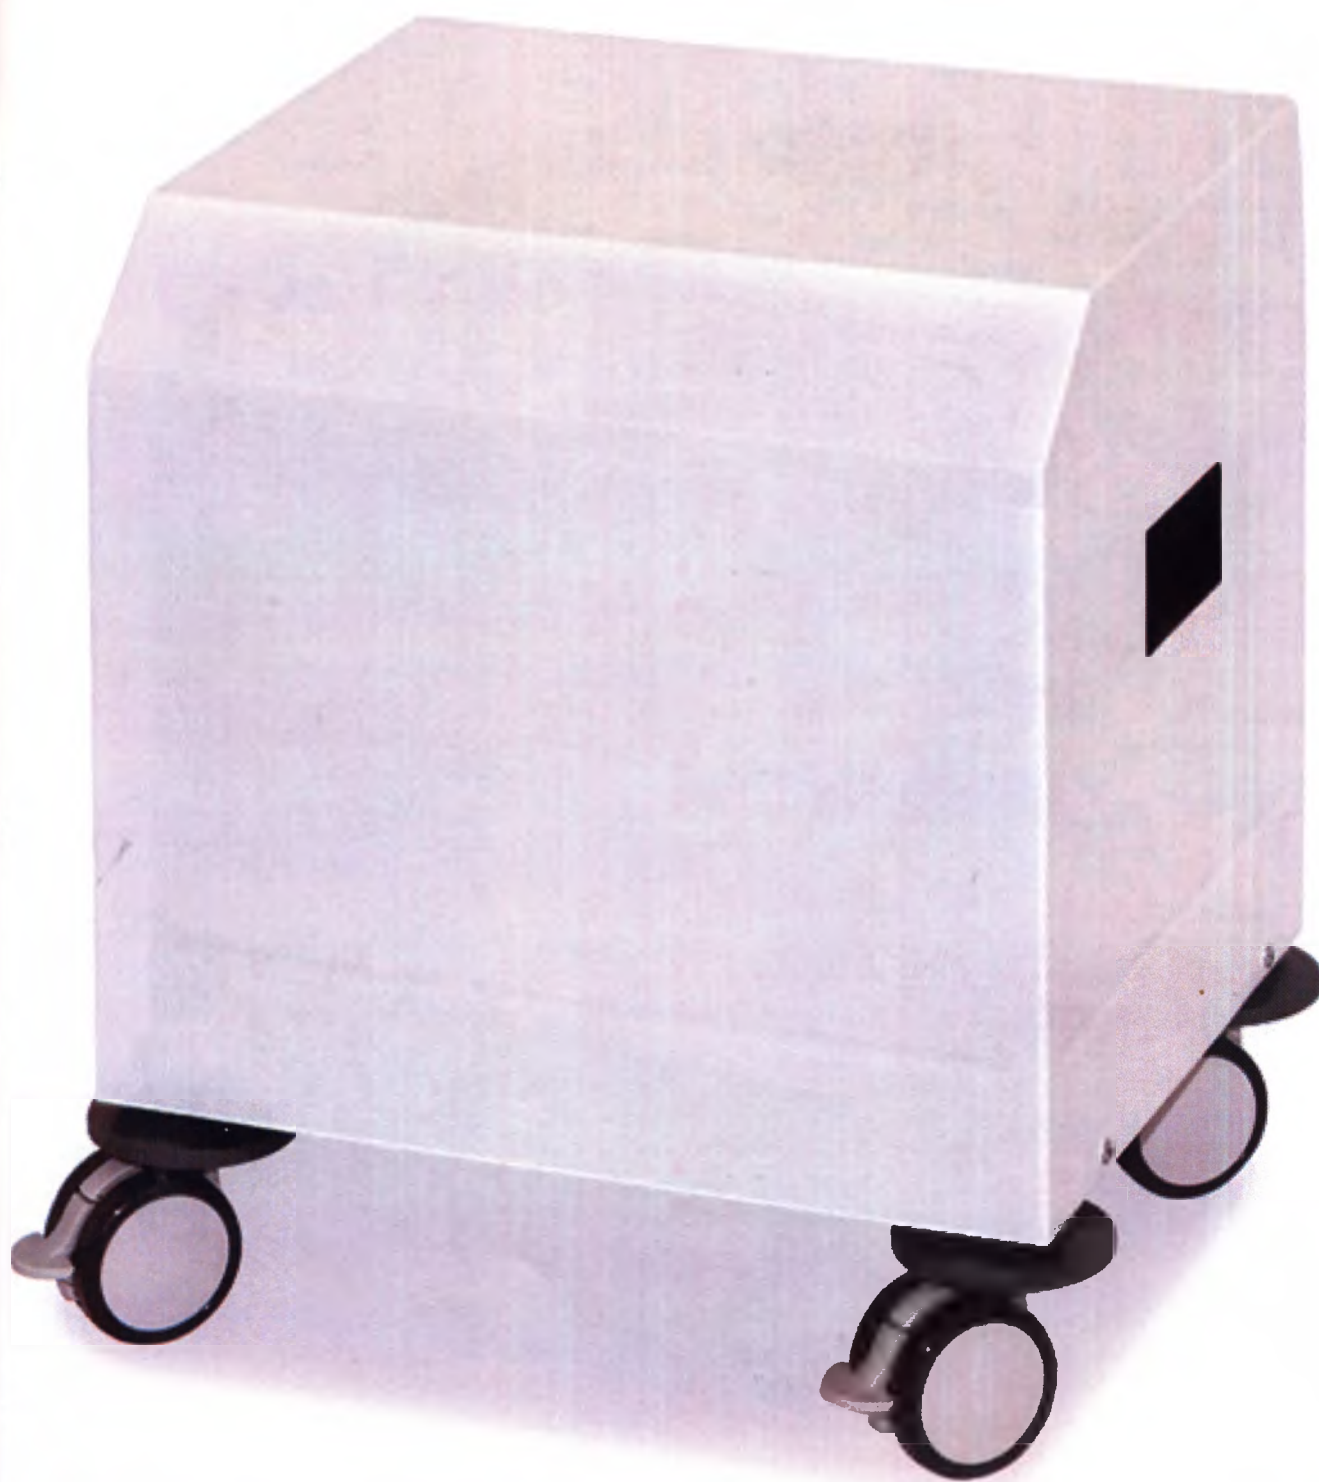

1. Компрессор медицинский стоматологический
OK50

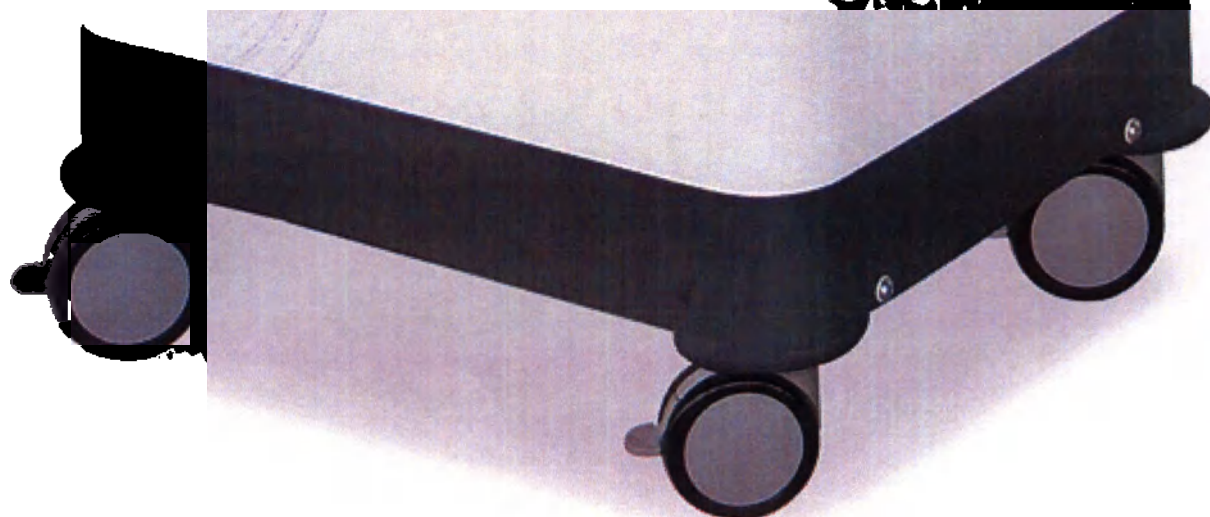

1. Компрессор медицинский DK50

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 30 листов

Директор по качеству
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

А.Р. Овчинников

« 11 »

декабря

2017 г.

