



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «БиоХимМак Диагностика»



Пичугина Л.В.

«10» декабря 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов AESKUSLIDES rLKS (separated) для полуколичественного определения IgG-антител к митохондриям (AMA), гладкомышечным клеткам (ASMA), микросомам клеток печени/почки (LKM) и циркулирующим париетальным клеткам (APCA) в сыворотке крови человека методом непрямой иммунофлуоресценции

Набор реагентов AESKUSLIDES rLKS (separated) для полуколичественного определения IgG-антител к митохондриям (AMA), гладкомышечным клеткам (ASMA), микросомам клеток печени/почки (LKM) и циркулирующим париетальным клеткам (APCA) в сыворотке крови человека методом непрямой иммунофлуоресценции в составе:

1. 10-луночный субстратный слайд, 10 шт.;
2. Положительный контроль (AMA POSITIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл;
3. Отрицательный контроль (IFA NEGATIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл;
4. IgG Конъюгат (FITC-меченные антитела к IgG-антителам человека) (CONJ IgG), 2 флакона х 3,5 мл;
5. Монтирующая среда (SEAL), 1 флакон х 12,0 мл;
6. Буфер для разведения образца (1х) (SB 1х), 1 флакон х 70 мл;
7. Концентрат промывочного буфера (10х) (WASHB (10х)), 1 флакон х 100 мл;
8. Инструкция по применению, 1 шт.;
9. Сертификат качества, 1 шт.

Набор реагентов AESKUSLIDES rLKS (separated) для полуколичественного определения IgG-антител к митохондриям (AMA), гладкомышечным клеткам (ASMA), микросомам клеток печени/почки (LKM) и циркулирующим париетальным клеткам (APCA) в сыворотке крови человека методом непрямой иммунофлуоресценции в составе:



AESKU DIAGNOSTICS
AESKU DIAGNOSTICS
 GmbH & Co. KG
 Mikrofórum Ring 2
 55234 Wendelsheim, Germany
 phone: +49-6734-9622-0
 fax: +49-6734-9622-2222
 www.aesku.com

AESKUSLIDES[®] rLKS (separated)
 IF for determination of IgG antibodies against rLKS

REF 817.100



CONTROL 1 x 0.5 ml

CONJ FITC IgG 2 x 3.5 ml

CONTROL 1 x 0.5 ml

MECHANISATION 1 x 100 ml

SEAL 1 x 12.0 ml

SD 1x 1 x 70 ml

10 x 10 wells



LOT 220611




2025-01

IMMUNOASSAY FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE

WWW.AESKU.COM



AESKU DIAGNOSTICS GMBH & CO. KG • MIKROFORUM RING 2 • 55234 WENDELSHEIM • GERMANY
 PHONE: +49-6734-9622-0 • FAX: +49-6734-9622-2222 • INFO@AESKU.COM

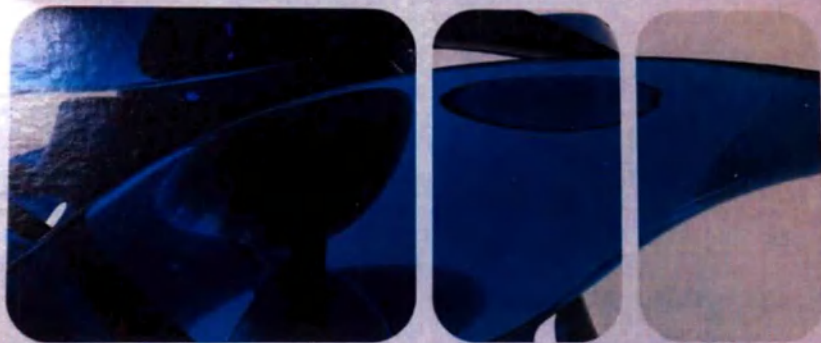

STORE. AT 2-8° C

DO NOT FREEZE • USE ACCORDING TO PROTOCOL
FOR PROFESSIONAL USE ONLY





AESKUSLIDES


THE DIAGNOSTIC TOOL THAT WORKS

IMMUNOASSAY FOR
IN VITRO DIAGNOSTIC USE

 **AESKU, DIAGNOSTICS**
THE ACCURACY THAT YOU NEED


EF		Control-certificate 
100		
2025-01		

Quantity	LOT	
10 well	22061	2025-01
0.5 ml	PC 23180	2025-04
0.5 ml	NC 23210	2025-04
3.5 ml	23150	2025-03
12.0 ml	SE 23261	2025-05
x 70 ml	SB 23290	2026-07

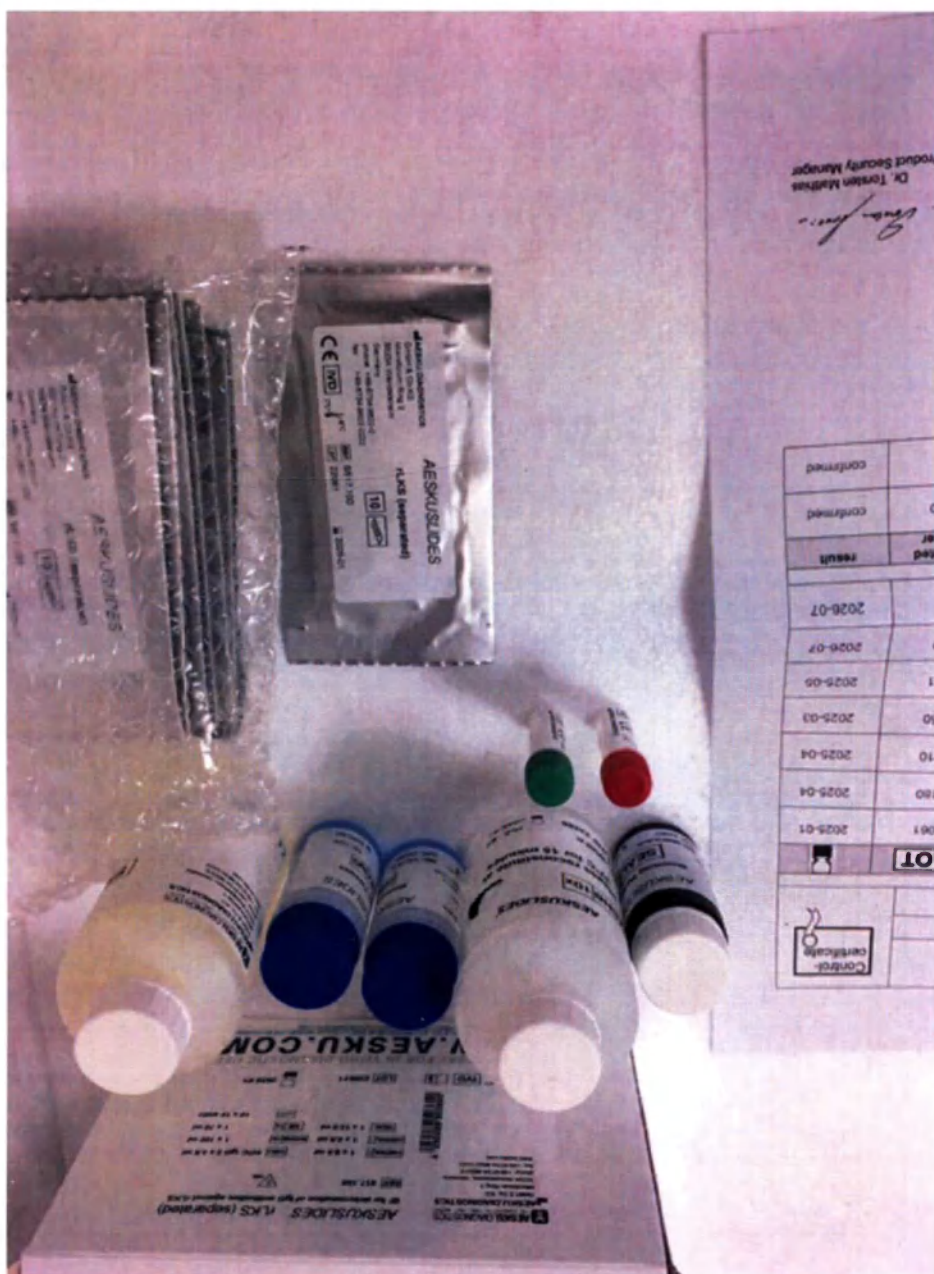


1. 10-луночный субстратный слайд, 10 шт.




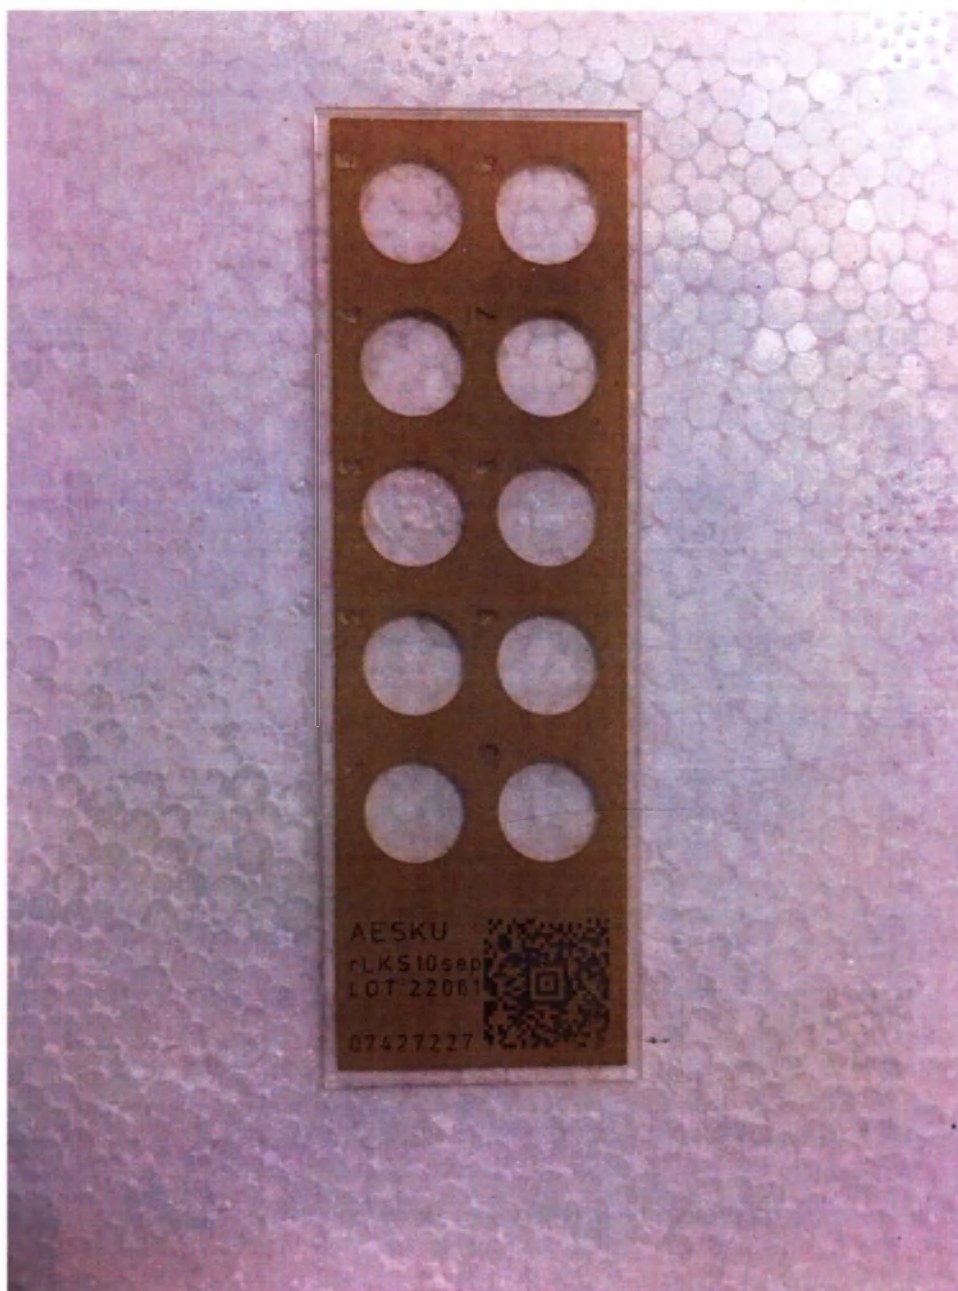




2. Положительный контроль (AMA POSITIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл

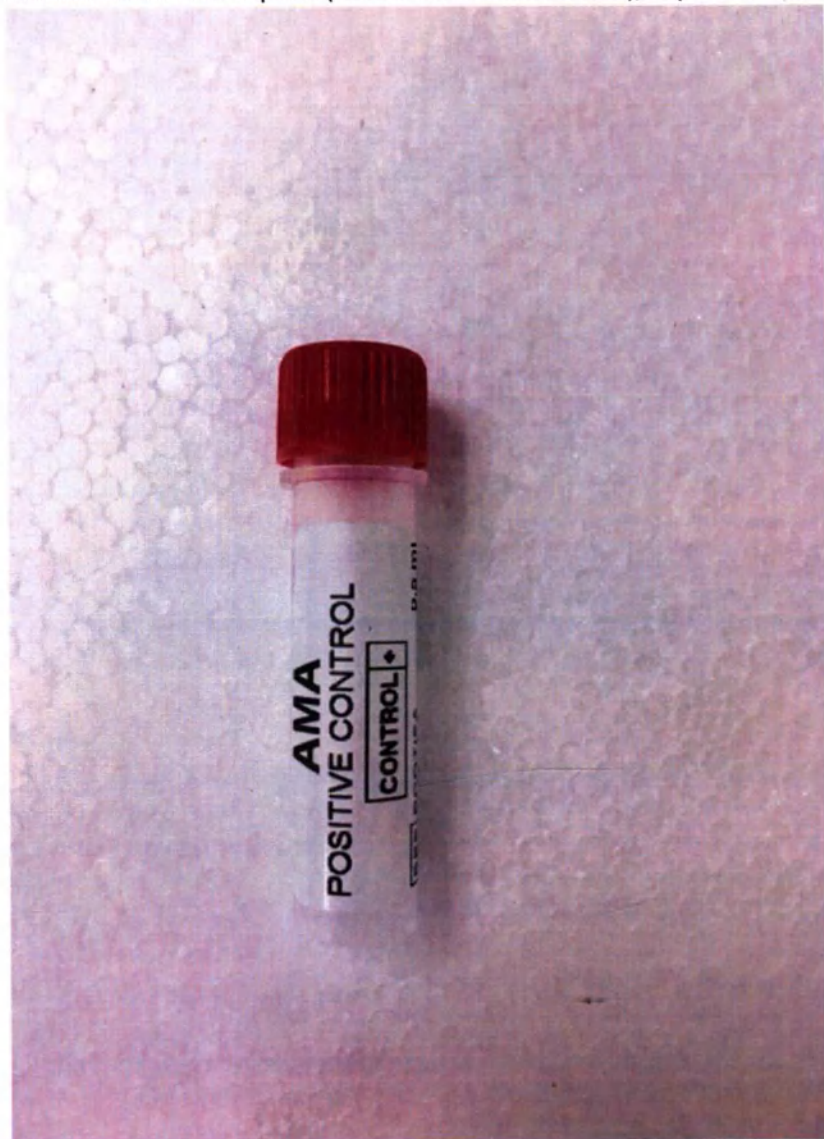


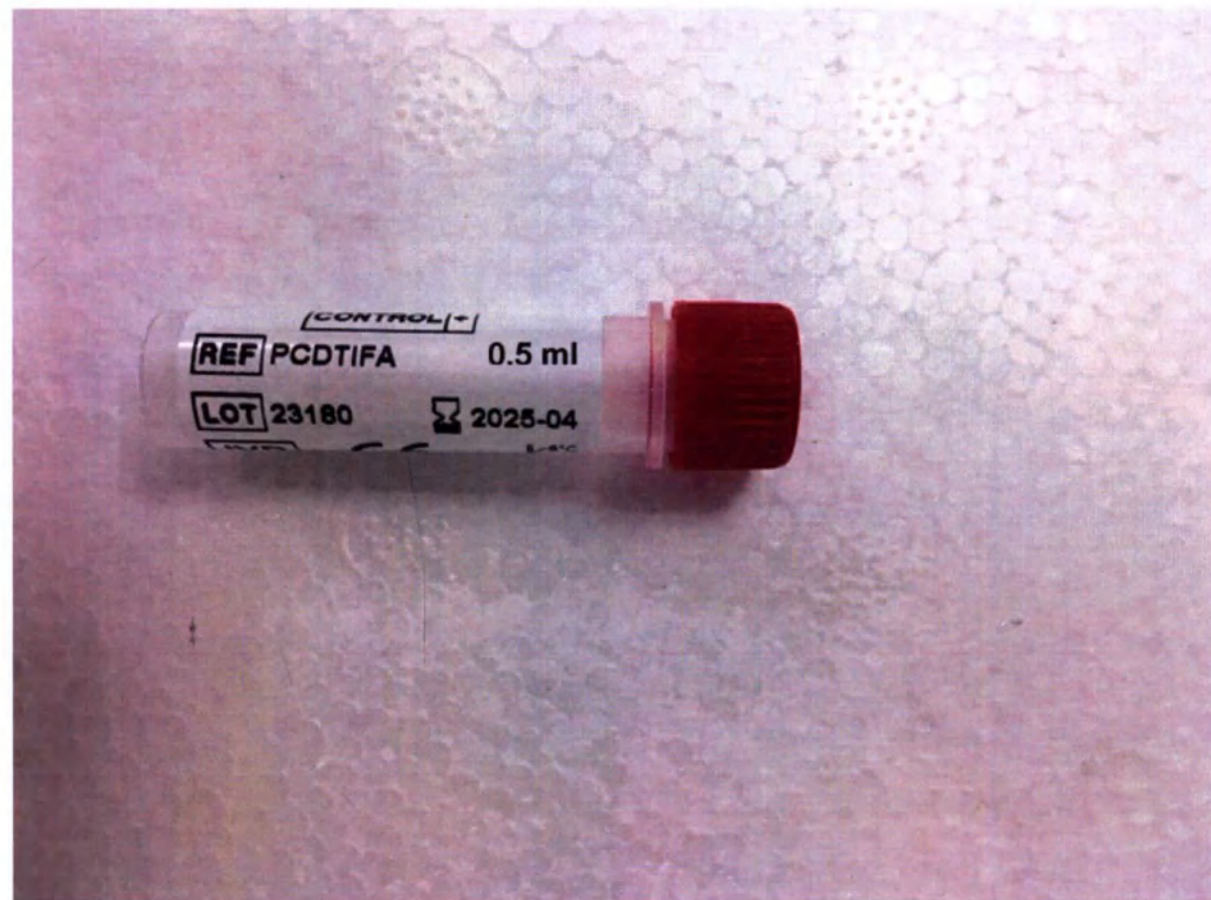


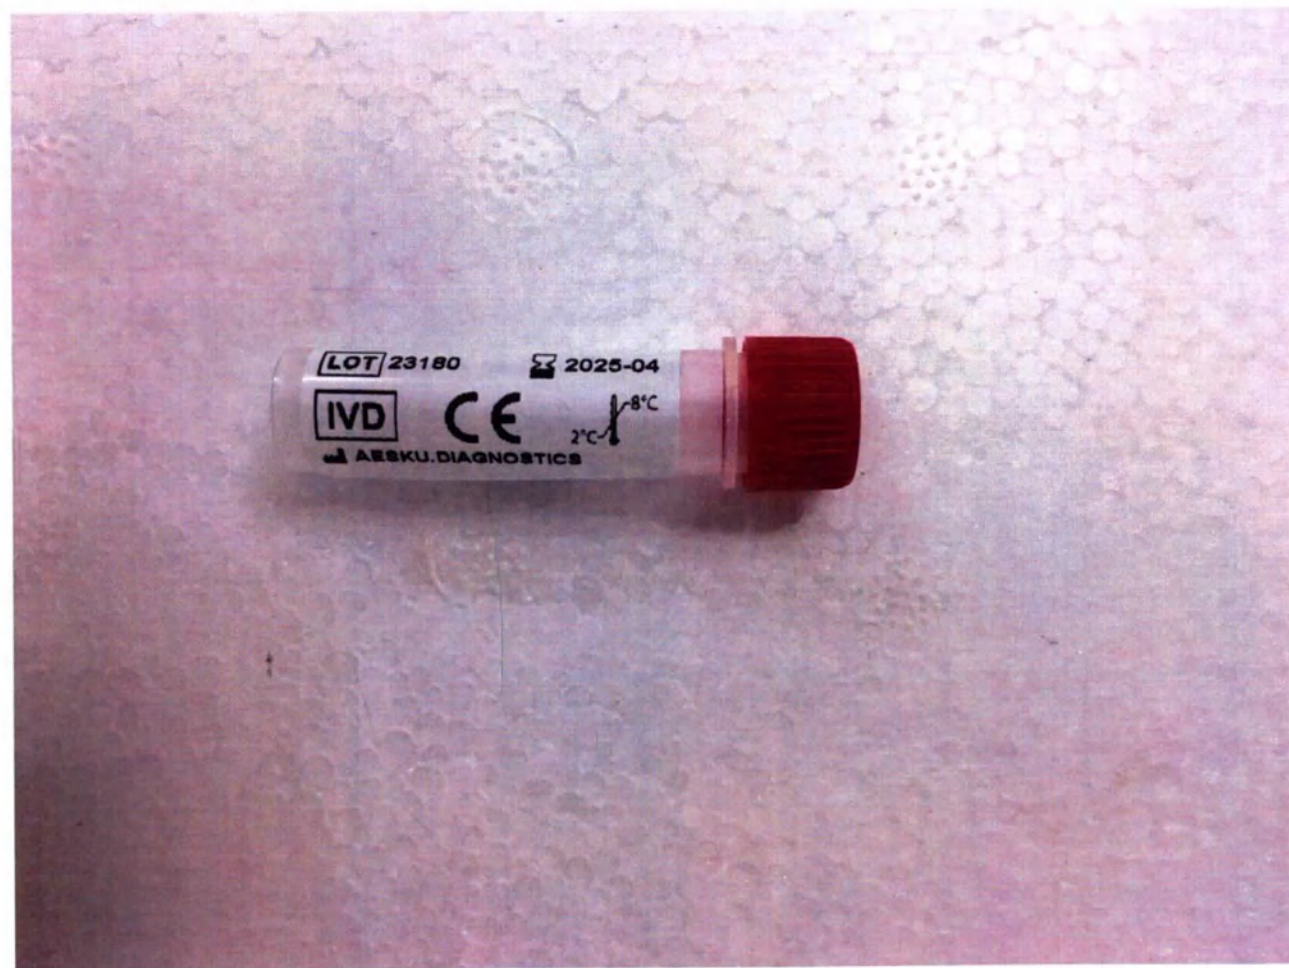


3. Отрицательный контроль (IFA NEGATIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл



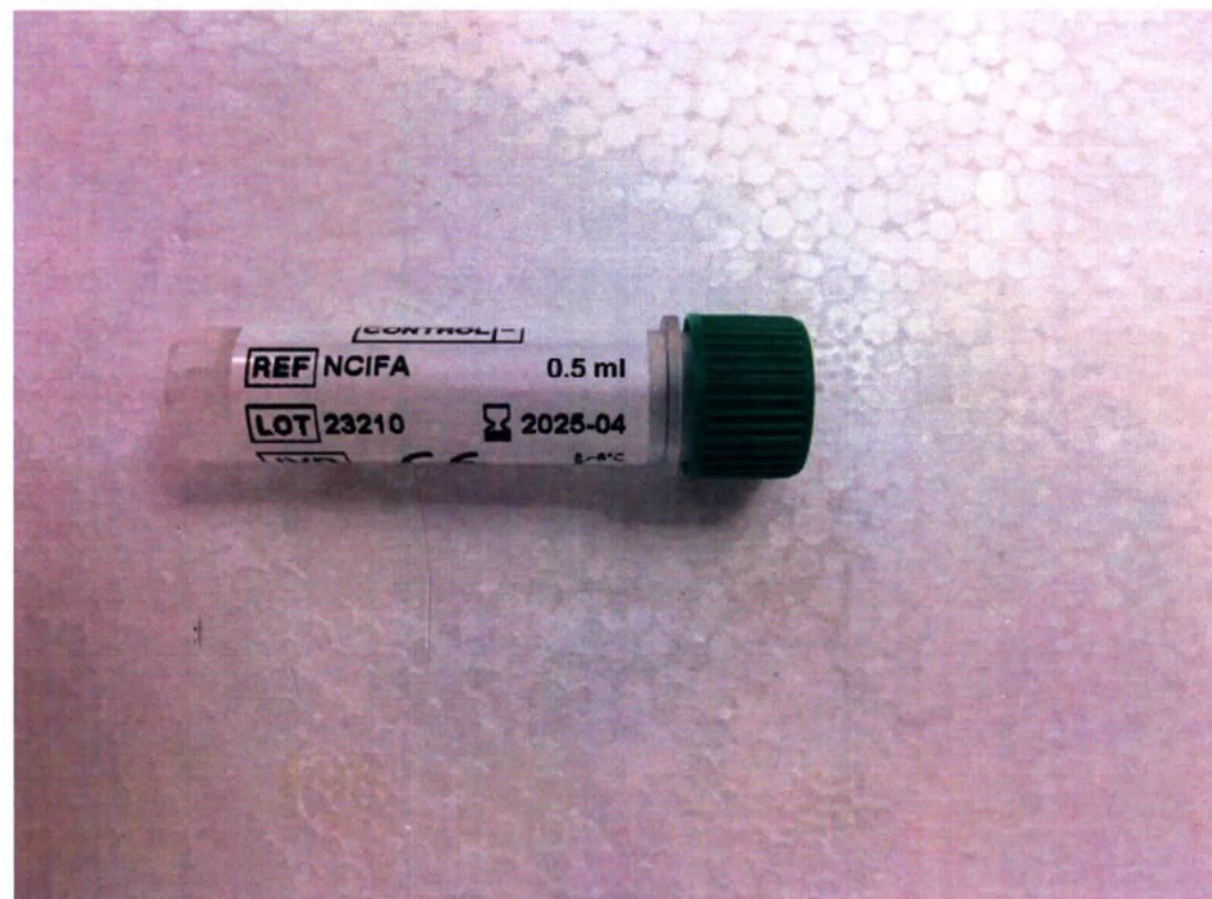


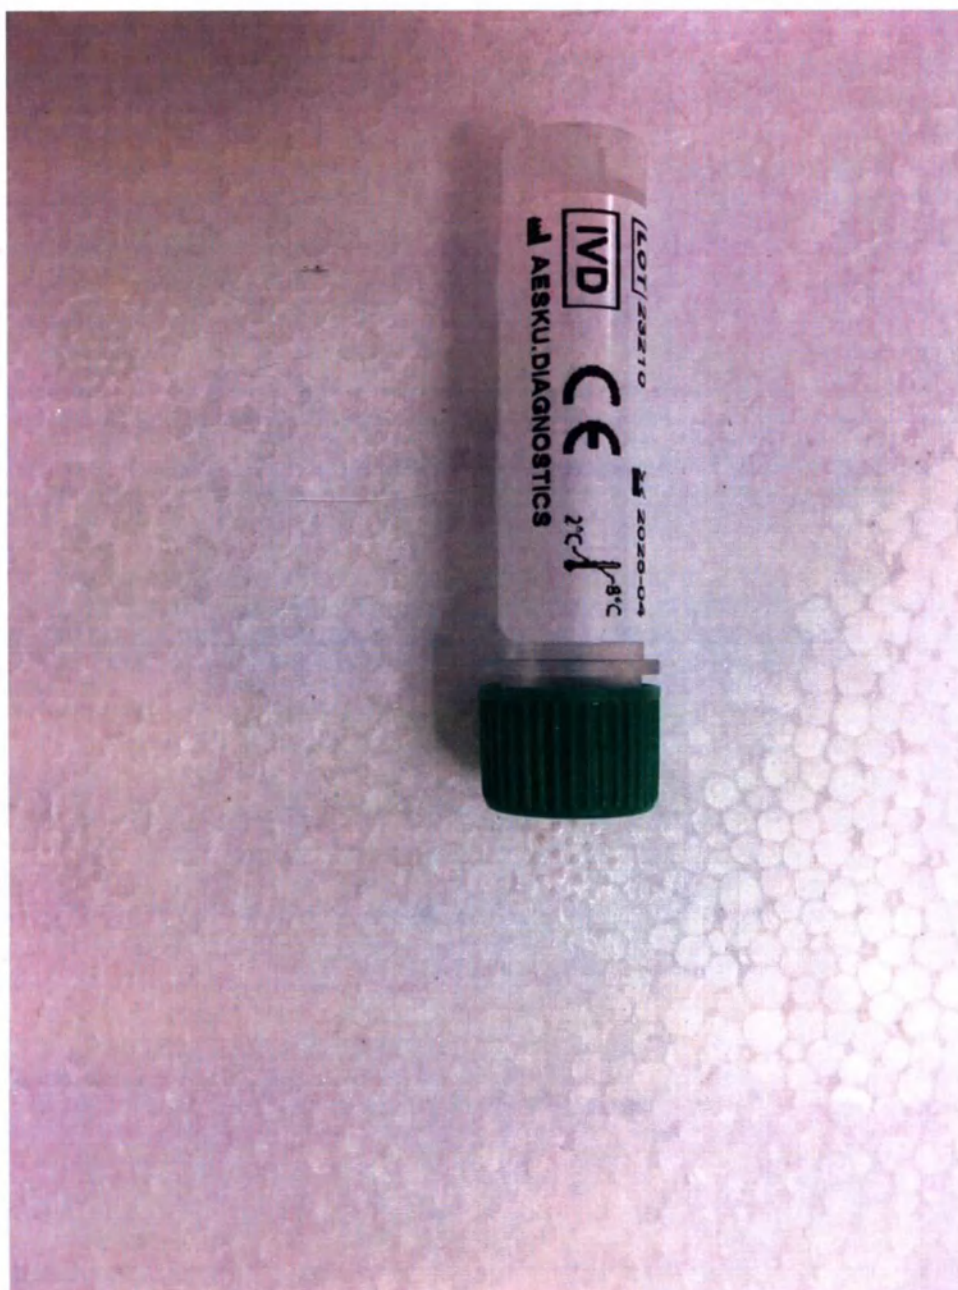

4. IgG Конъюгат (FITC-меченные антитела к IgG-антителам человека) (CONJ IgG), 2 флакона х 3,5 мл

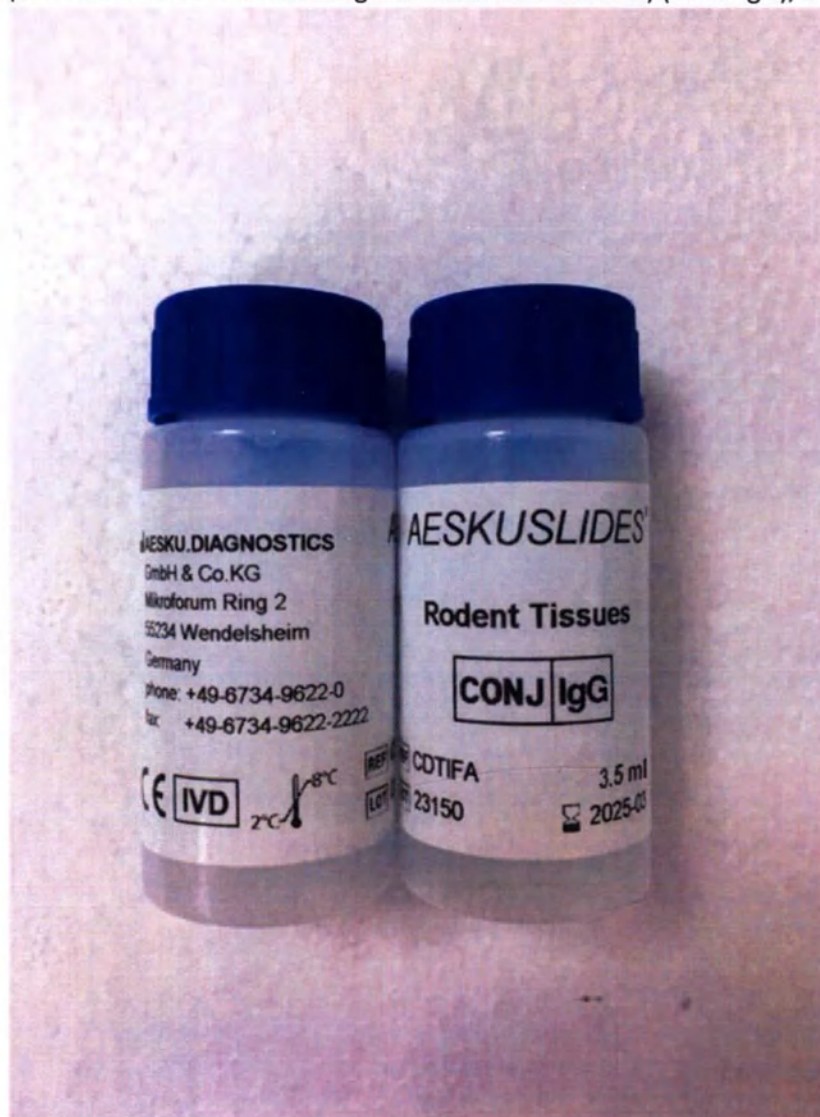

5. Монтирующая среда (SEAL), 1 флакон х 12,0 мл

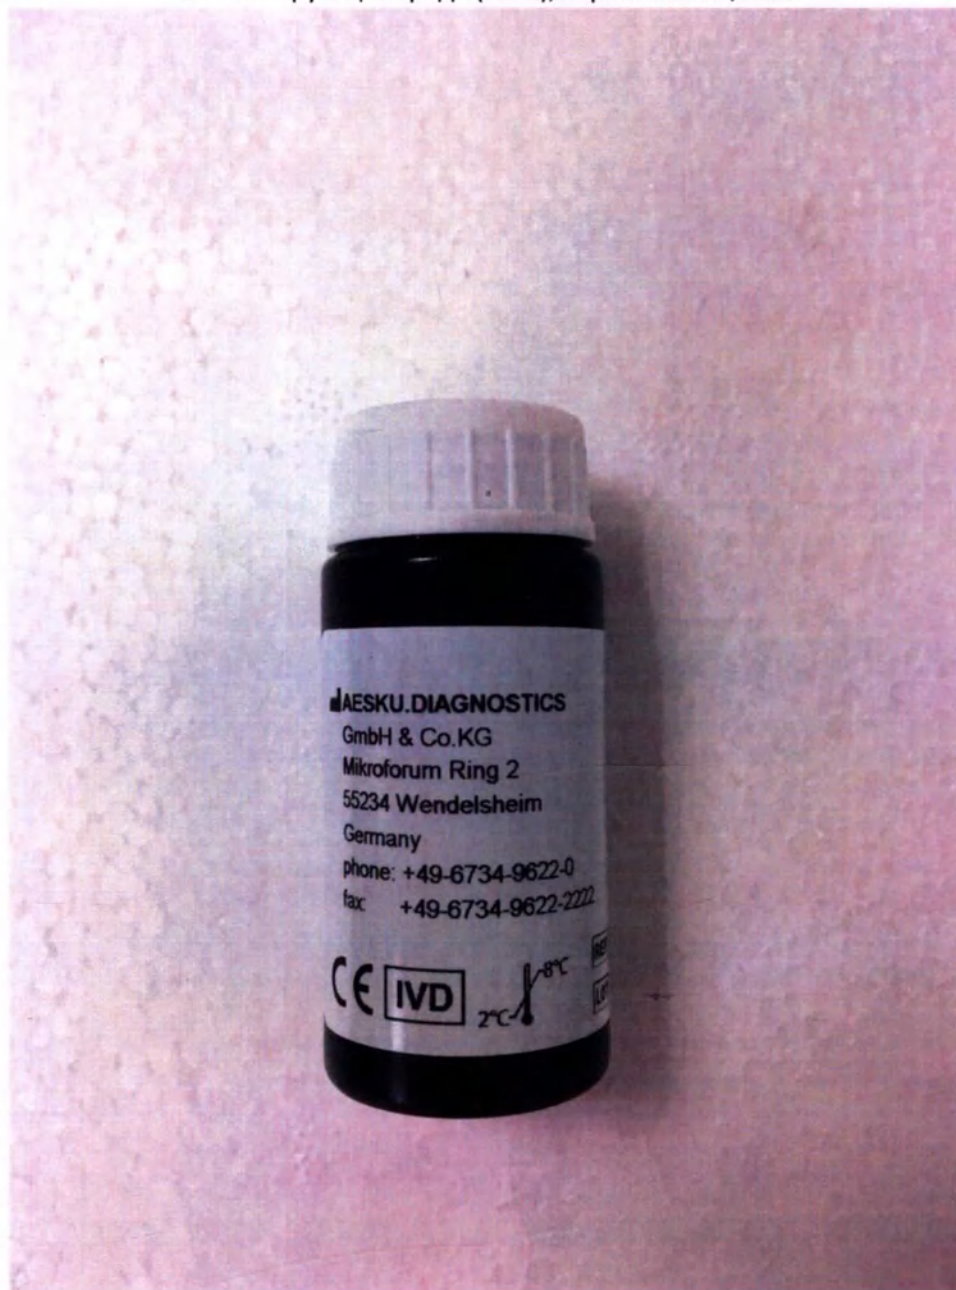




6. Буфер для разведения образца (1x) (SB 1x), 1 флакон х 70 мл






7. Концентрат промывочного буфера (10x) (WASHB (10x)), 1 флакон х 100 мл



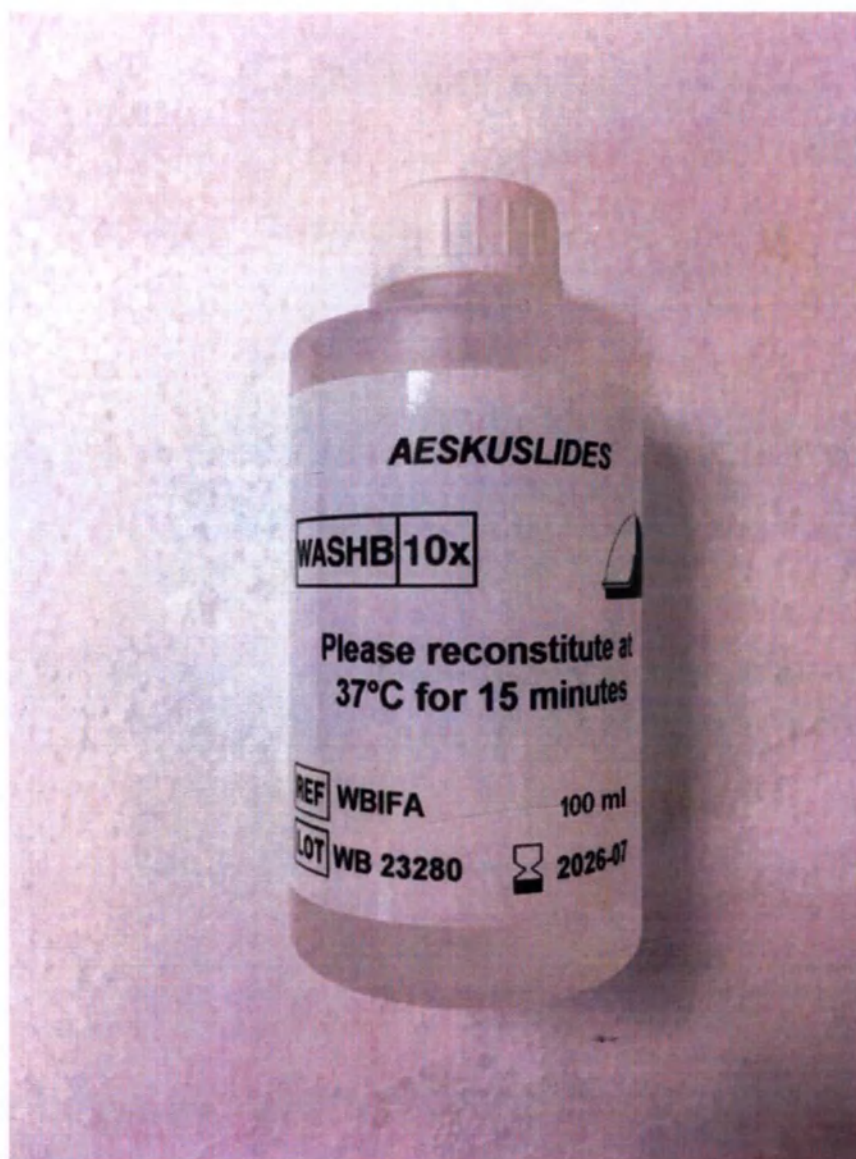

8. Инструкция по применению, 1 шт.

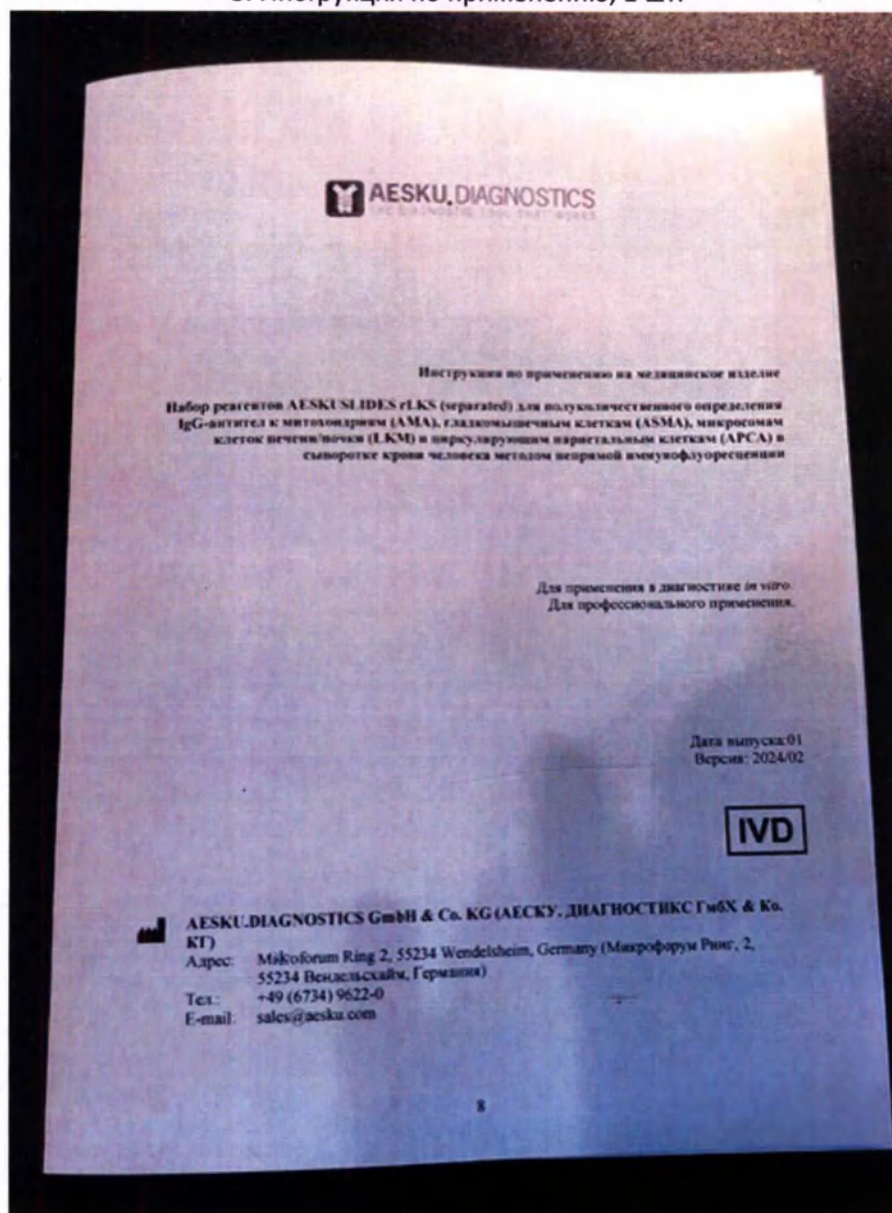

9. Сертификат качества, 1 шт.

AESKUSLIDES rLKS (separated)		REF 517.100		Control-certificate	
LOT		220611		2023-08 2025-01	
Symbol	REF	Quantity	LOT		
	s517.100	10 x 10 well	22061	2025-01	
CONTROL +	PCDTIFA	1 x 0.5 ml	PC 23180	2025-04	
CONTROL -	NCIFA	1 x 0.5 ml	NC 23210	2025-04	
CONJ IgG	CDTIFA	2 x 3.5 ml	23150	2025-03	
SEAL	MMIFA	1 x 12.0 ml	SE 23261	2025-05	
SB 1x	SBIFA	1 x 70 ml	SB 23290	2026-07	
WASHB 10x	WBIFA	1 x 100 ml	WB 23280	2026-07	
Test	REF	Pattern	F.I.	Calculated Endtiter	result
CONTROL +	PCDTIFA	AMA	3	1.640	confirmed
CONTROL -	NCIFA	negative	0	-	confirmed

The ready to use positive control conforms to a 1:20 dilution.



AESKU DIAGNOSTICS GmbH & Co. KG
Mikroforum Ring 2
55234 Wendelsheim, GERMANY

Dr. Torsten Matthias

Dr. Torsten Matthias
Product Security Manager

V005:2021-10-12

Макет русскоязычного стикера для медицинского изделия

Набор реагентов AESKUSLIDES rLKS (separated) для полуколичественного определения IgG-антител к митохондриям (AMA), гладкомышечным клеткам (ASMA); микросомам клеток печени/почки (LKM) и циркулирующим париетальным клеткам (APCA) в сыворотке крови человека методом непрямой иммунофлуоресценции в составе:

1. 10-луночный субстратный слайд, 10 шт.;
2. Положительный контроль (AMA POSITIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл;
3. Отрицательный контроль (IFA NEGATIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл;
4. IgG Конъюгат (FITC-меченные антитела к IgG-антителам человека) (CONJ IgG), 2 флакона х 3,5 мл;
5. Монтирующая среда (SEAL), 1 флакон х 12,0 мл;
6. Буфер для разведения образца (1x) (SB 1x), 1 флакон х 70 мл;
7. Концентрат промывочного буфера (10x) (WASHB (10x)), 1 флакон х 100 мл;
8. Инструкция по применению, 1 шт.;
9. Сертификат качества, 1 шт.

Только для профессионального применения!

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Инактивировано! Для диагностики in vitro!

Производитель: *AESKU.DIAGNOSTICS GmbH & Co. KG (АЕСКУ. ДИАГНОСТИКС ГмбХ & Ко. КГ)
Mikroforum Ring 2, 55234 Wendelsheim, Germany (Микрофорум Ринг, 2, 55234 Вендельсхайм, Германия)
Тел. +49 (6734) 9622-0, E-mail: sales@aesku.com*

Уполномоченный представитель в РФ: *Акционерное общество «БиоХимМак Диагностика», 119311, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел.: +7 (495) 647-27-40;
E-mail: info@biochemmack.ru
Веб-сайт: www.biochemmack.ru*

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Символы, применяемые при маркировке медицинского изделия, указаны на оригинальной упаковке. Наименование изделия на настоящем стикере считается приоритетным на территории Российской Федерации



Прошито, пронумер
скреплено печатью
Генеральный директ
АО «БиохимМак Ди
Пичугина Л.В.