

ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 2L-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 2L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист 2
Генеральный Руденко В
директор



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 2L-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 2L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Пропнуковано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист

Генеральный
директор

Руденко А.В.

КЛИНИПАК

ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 2R-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 2R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор _____ Руденко А.В.



ПАСПОРТ

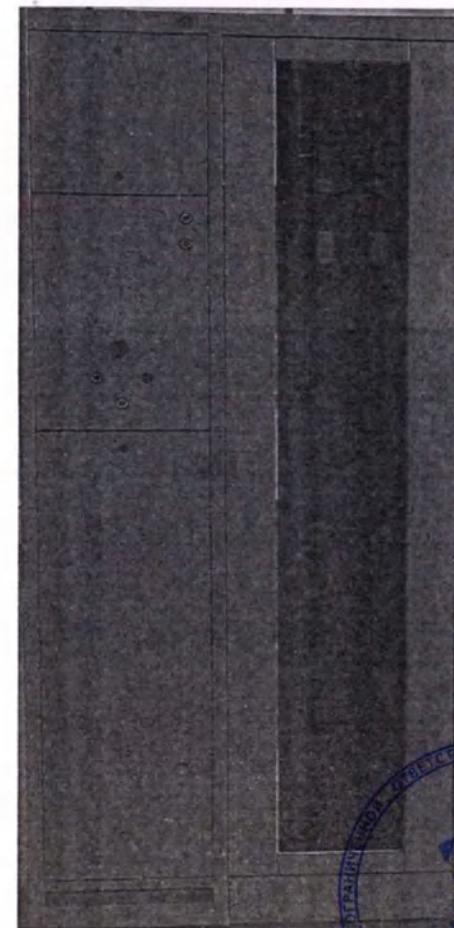

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принудительной вентиляцией

Вариант исполнения: 2R-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 2R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 3L-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 3L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Простуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а

Генеральный
директор

Руденко А.В



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 3L-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 3L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XXIV, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) листа
Генеральный
директор _____ Руденко А.В.



ПАСПОРТ

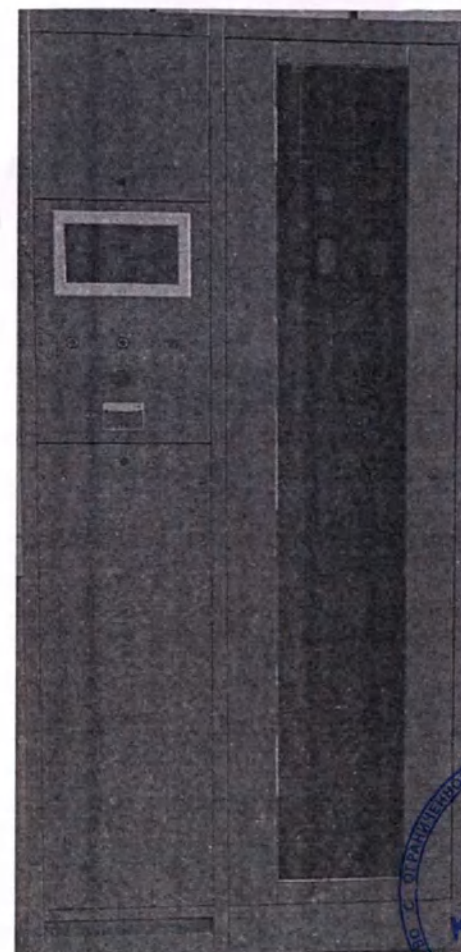

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 3R-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 3R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью


2 (два) лист а

Генеральный
директор

Руденко А.В.



ПАСПОРТ

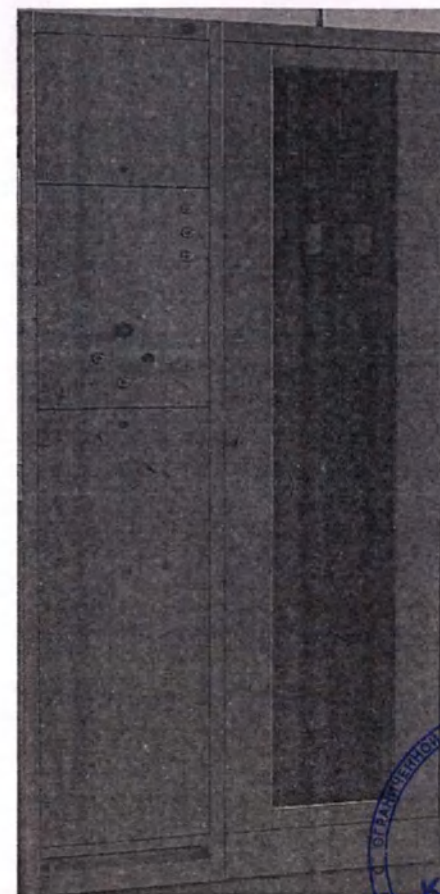

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 3R-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 3R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212 г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два)
Генеральный
директор

лист а

Руденко А.В



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 4L-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 4L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212 г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а

Генеральный
директор

Руденко А.В.



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 4L-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 4L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два)


лист

Генеральный
директор

Рябенко А.В.



ПАСПОРТ

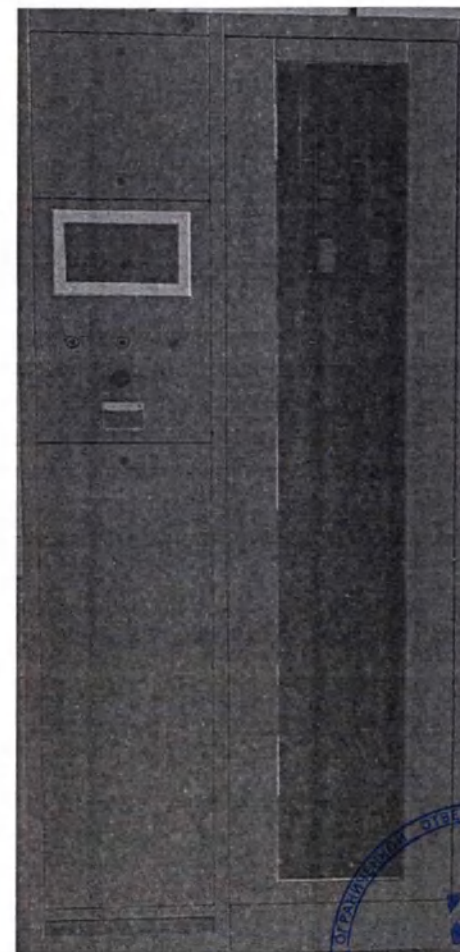

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 4R-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 4R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 21.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор _____ Руденко А.В.



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 4R-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	910x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 4R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 21

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор _____



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 5L-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1020x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 5L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP 20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVE комн. 3

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью


2 (два) лист

Генеральный
директор

Владенко А.В.



ПАСПОРТ

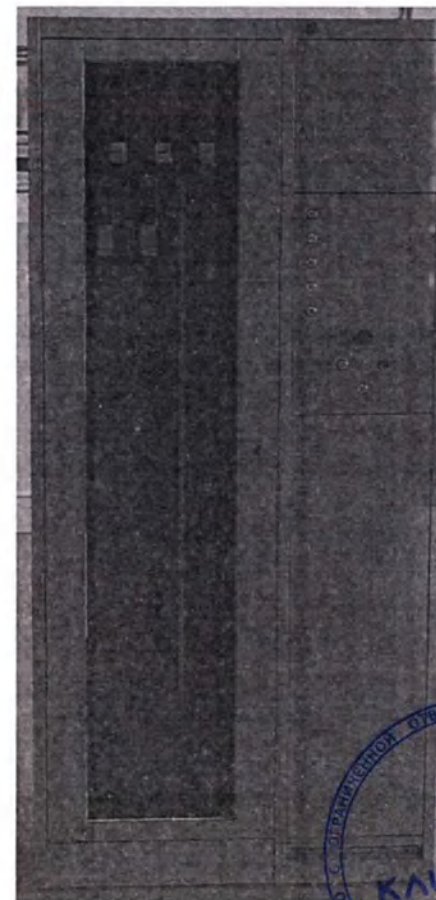

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 5L-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1020x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 5L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист 2
Генеральный
директор _____



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 5R-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1020x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 5R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. Х/1, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) *два*
Генеральный
директор



Руденко А.В.

ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 5R-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1020x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 5R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. ХУ, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Пропнуковано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два)
Генеральный
директор Руденко А.В.



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 6L-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 6L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист 2
Генеральный директор Руденко А.В.



ПАСПОРТ

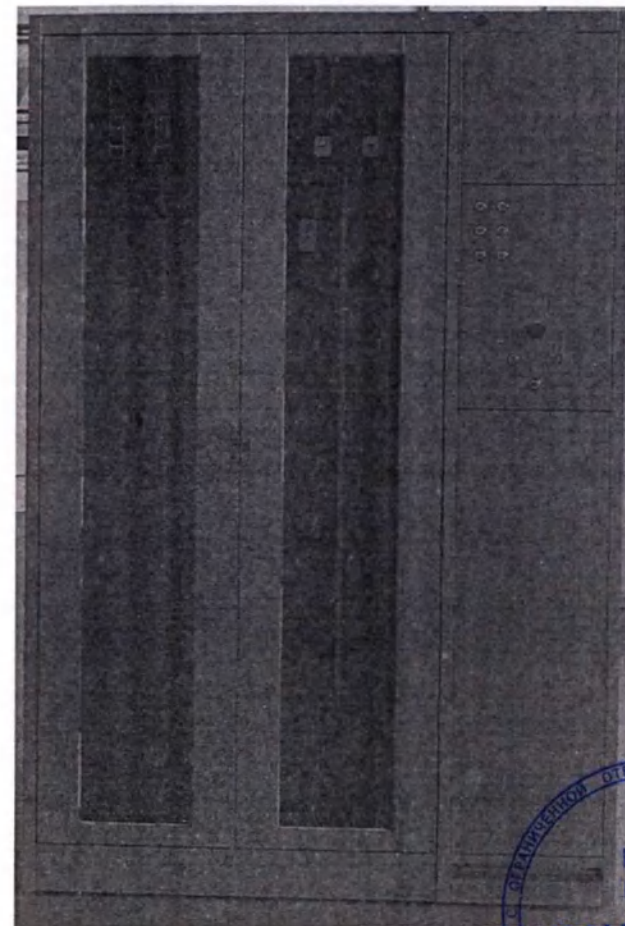

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 6L-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 6L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVII, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) листа
Генеральный
директор

Руководитель



ПАСПОРТ

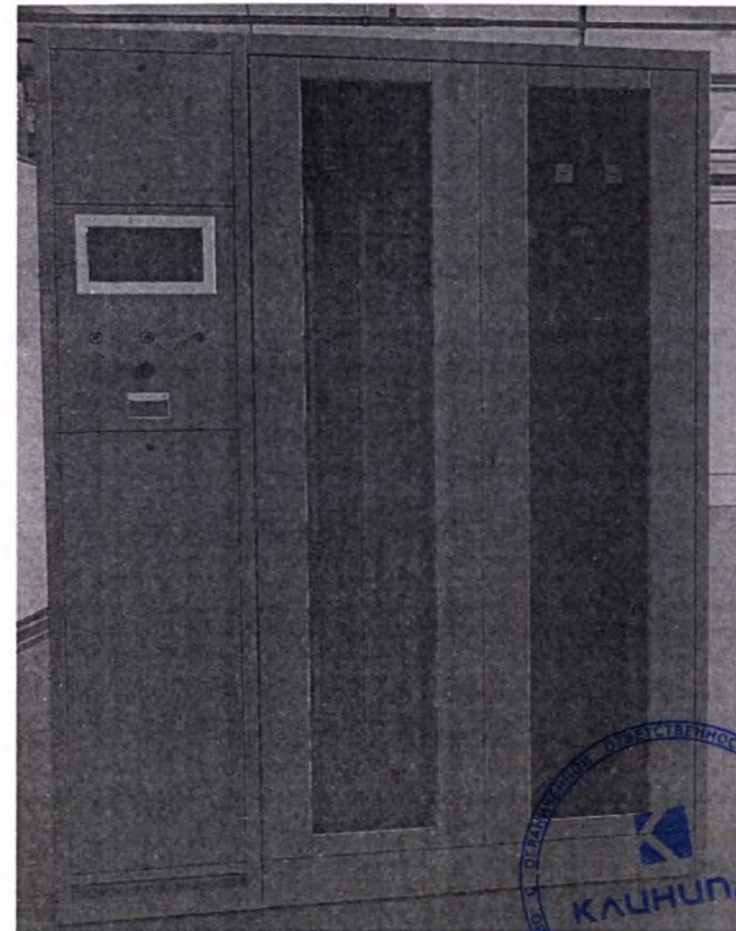

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 6R-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 6R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два)
Генеральный
директор



ПАСПОРТ

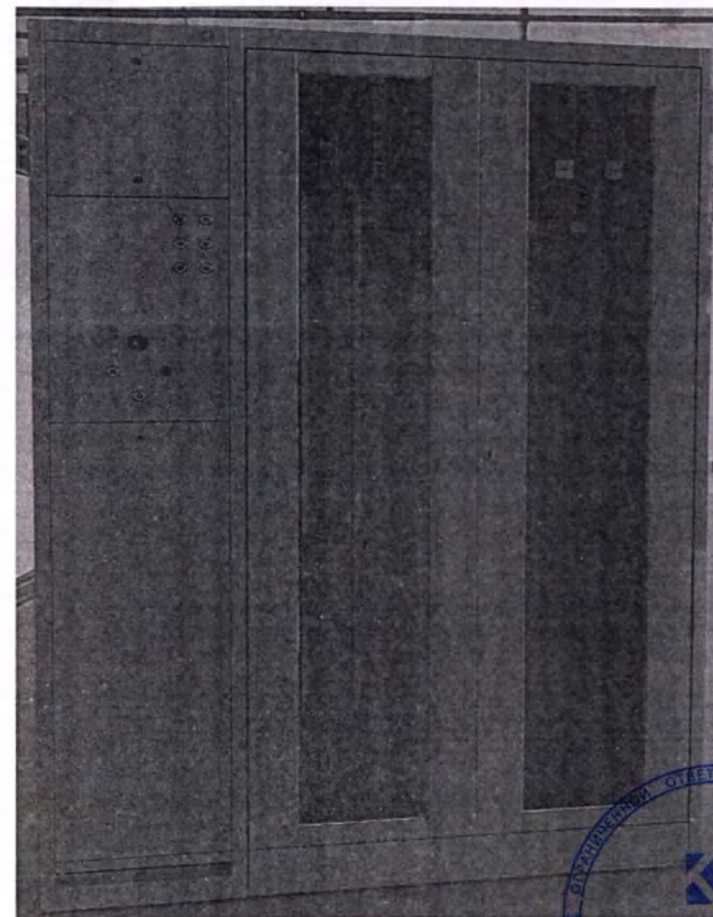

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 6R-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 6R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования: IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 3

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист 2
Генеральный
директор



ПАСПОРТ

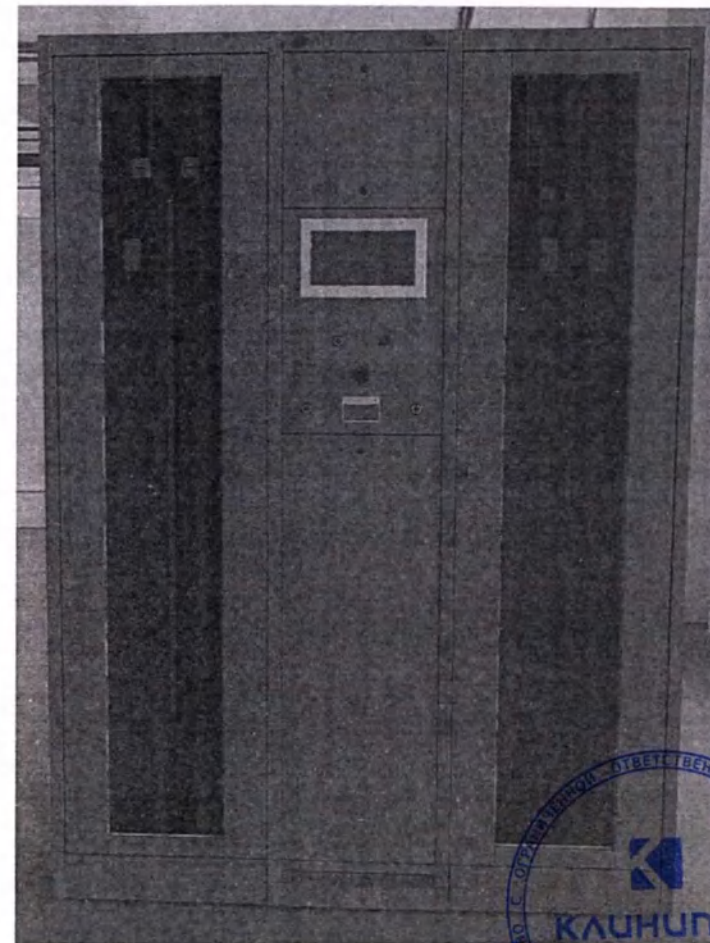

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 6С-С

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1380x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 6С-С

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью


2 (два) лист

Генеральный
директор



Руденко А.В.

ПАСПОРТ

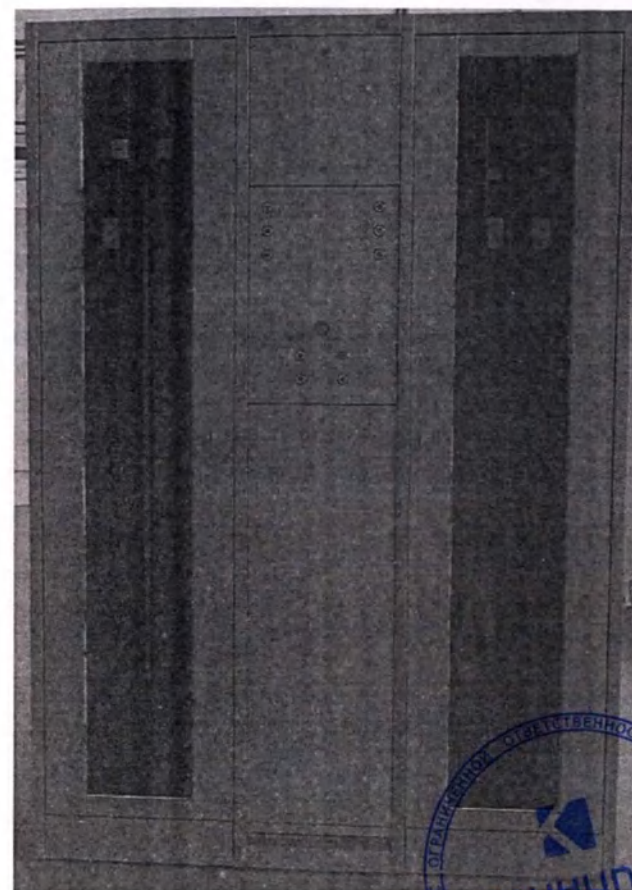

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 6C-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1380x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 6С-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИКАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист 8
Генеральный
директор _____ Руденко А.В.



ПАСПОРТ

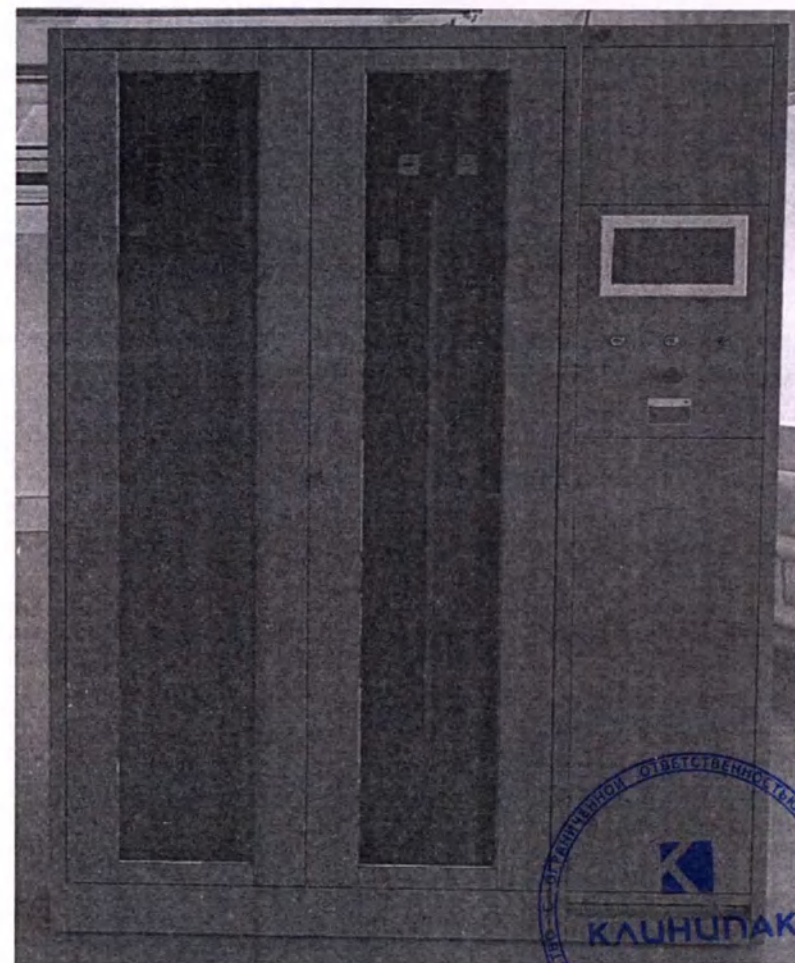

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 7L-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 7L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования: IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор _____



ПАСПОРТ

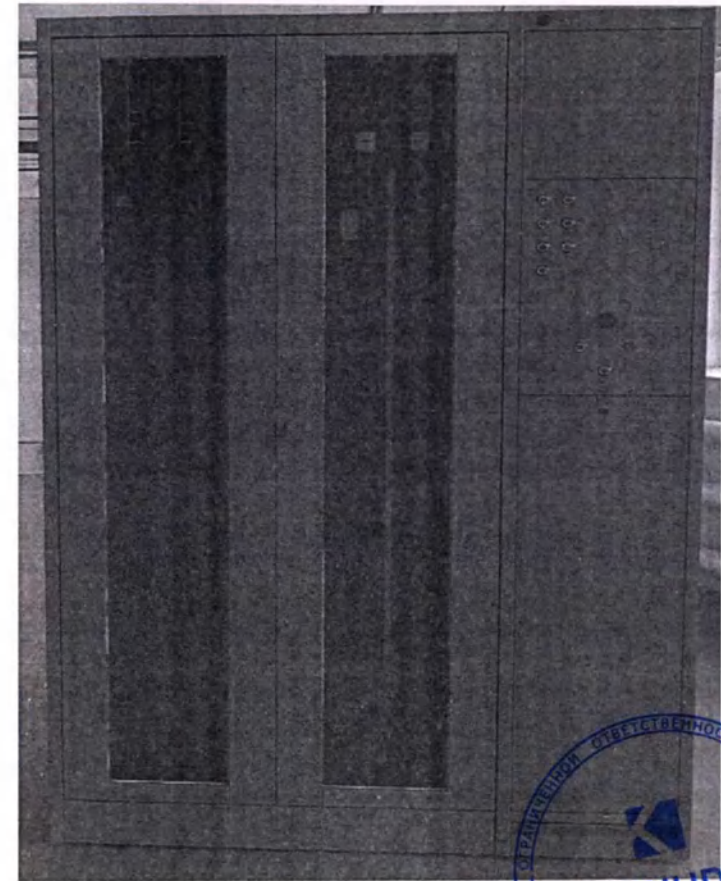

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 7L-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 7L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию _____

Штамп ОТК _____




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор К.И.И.И.И.И.И.



ПАСПОРТ

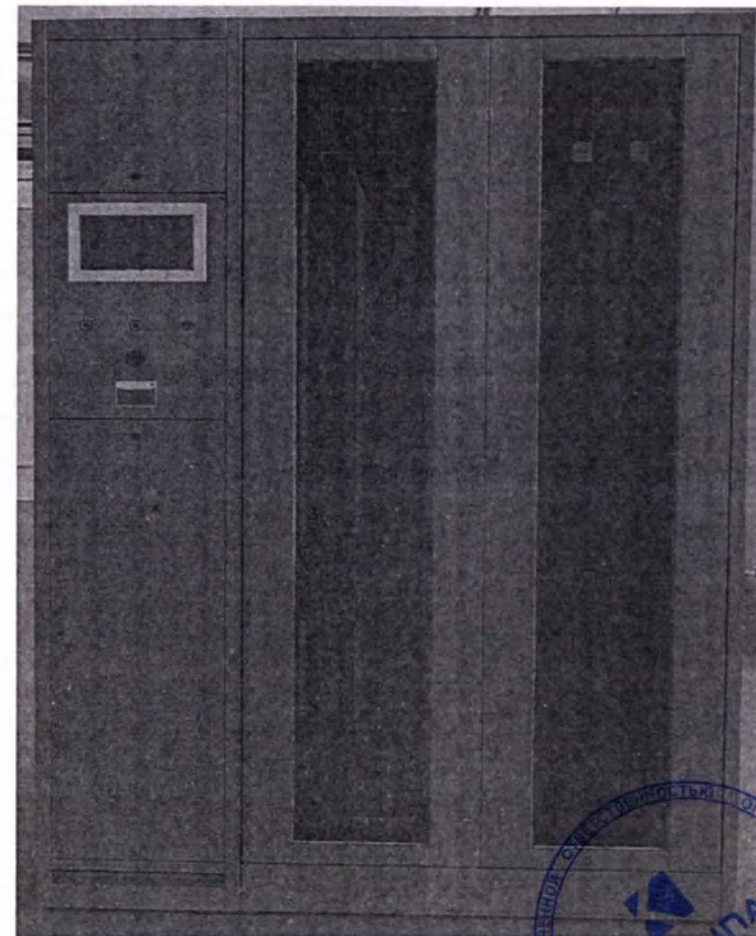

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 7R-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 7R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК» Россия, 125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию


Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист
Генеральный директор Гуденко А.В.


ПАСПОРТ

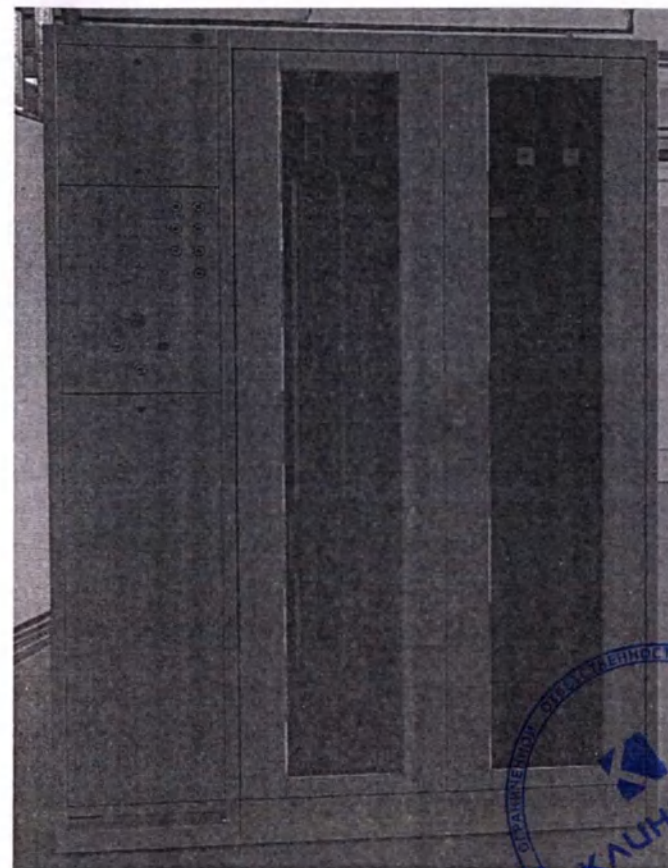

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 7R-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 7R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования: IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

Генеральный
директор

Руденко А.В



ПАСПОРТ

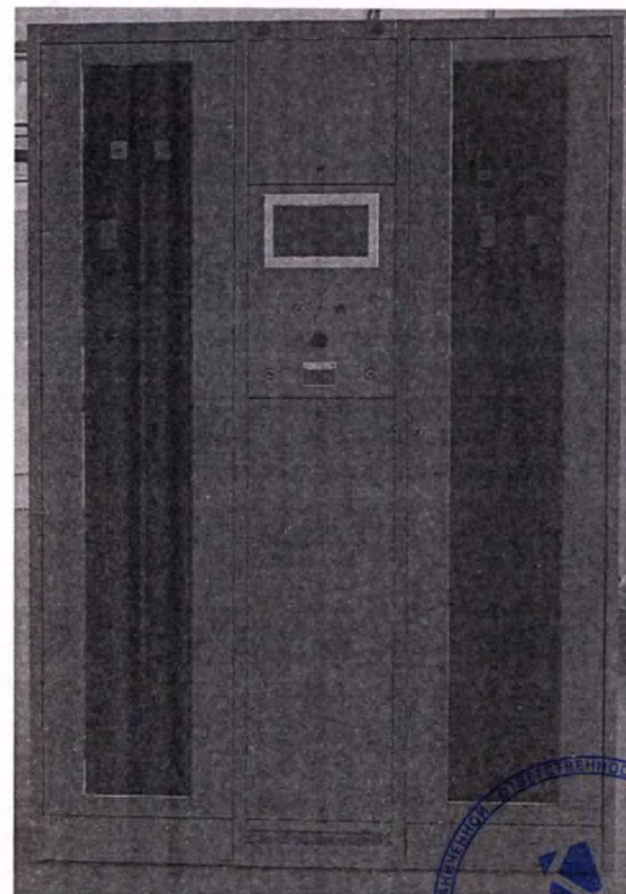

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 7С-С



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1380x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 7С-С

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК» Россия, 125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI комн. 5.

Дата ввода в эксплуатацию _____

Штамп ОТК _____



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью


2 (два) лист 2

Генеральный
директор

Руденко А.В.



ПАСПОРТ

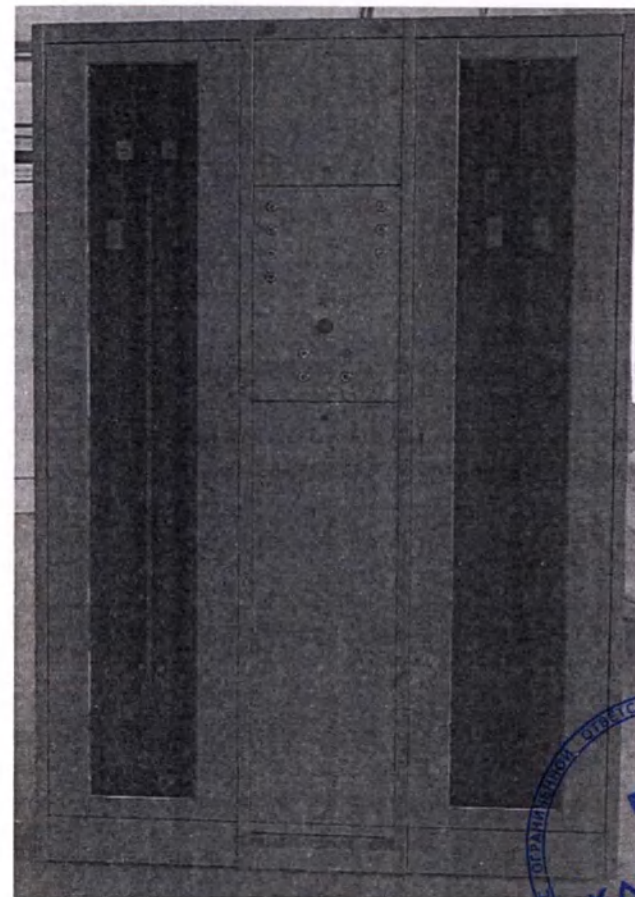

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 7C-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1380x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 7С-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования: IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212 г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. X, комн. 314

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист
Генеральный
директор



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 8L-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 8L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) ответствен
Генеральный
директор Руденко А.В



ПАСПОРТ

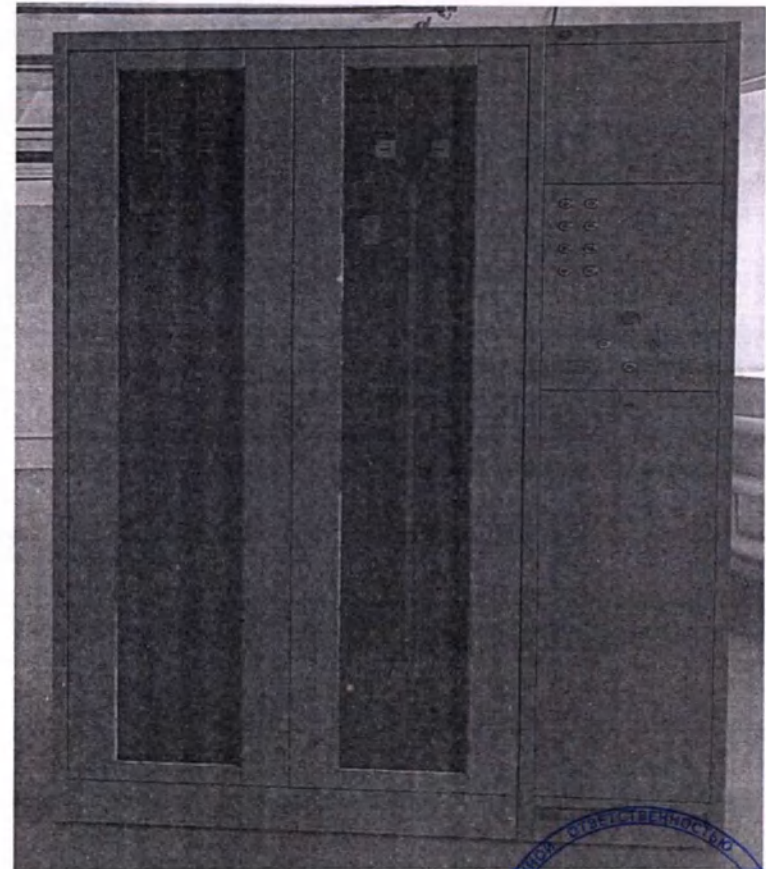

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 81 S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 8L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 311

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (*два*)
Генеральный
директор


лист

Руденко А.В.

КЛИНИПАК

МОСКВА

ПАСПОРТ

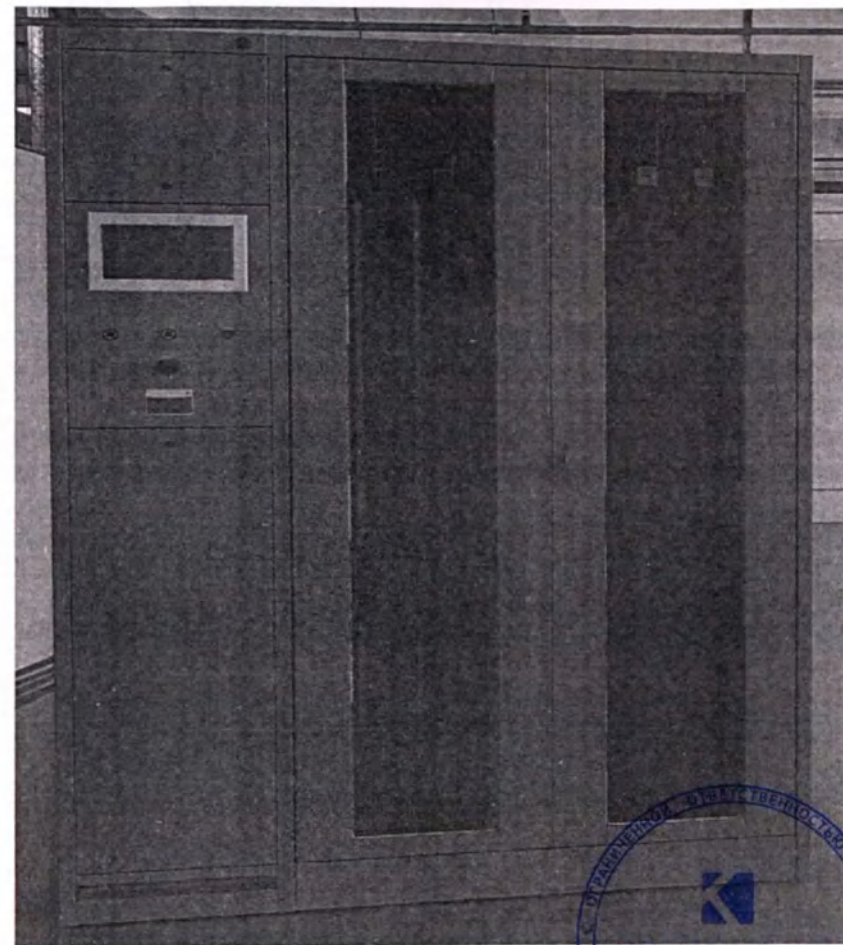

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 8R-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 8R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью


Генеральный
директор

2 (два) лист

Руденко А.В.



ПАСПОРТ

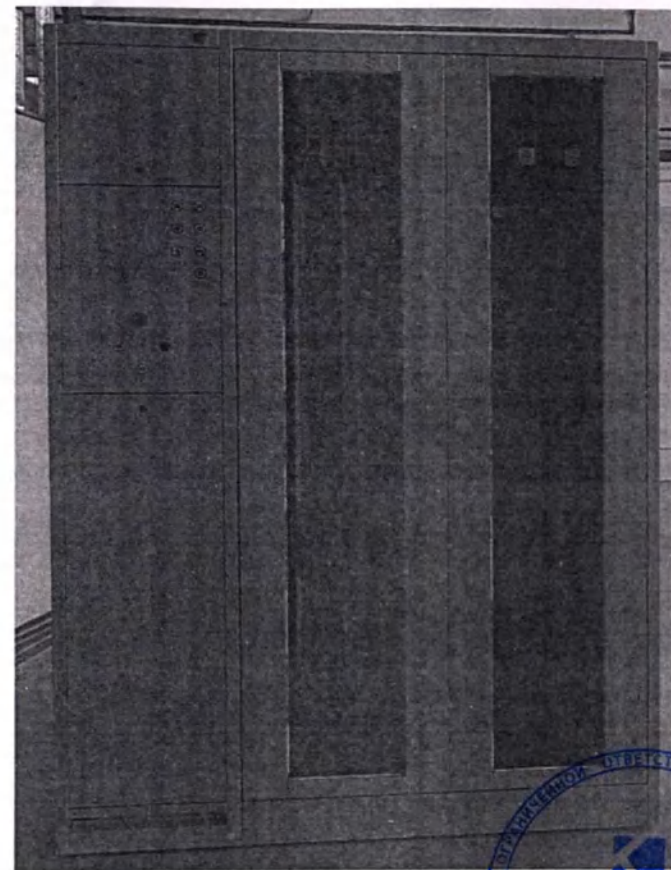

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов АЧОС по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 8R-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1410x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 8R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (26) листа
Генеральный директор Руденко А.В.



ПАСПОРТ

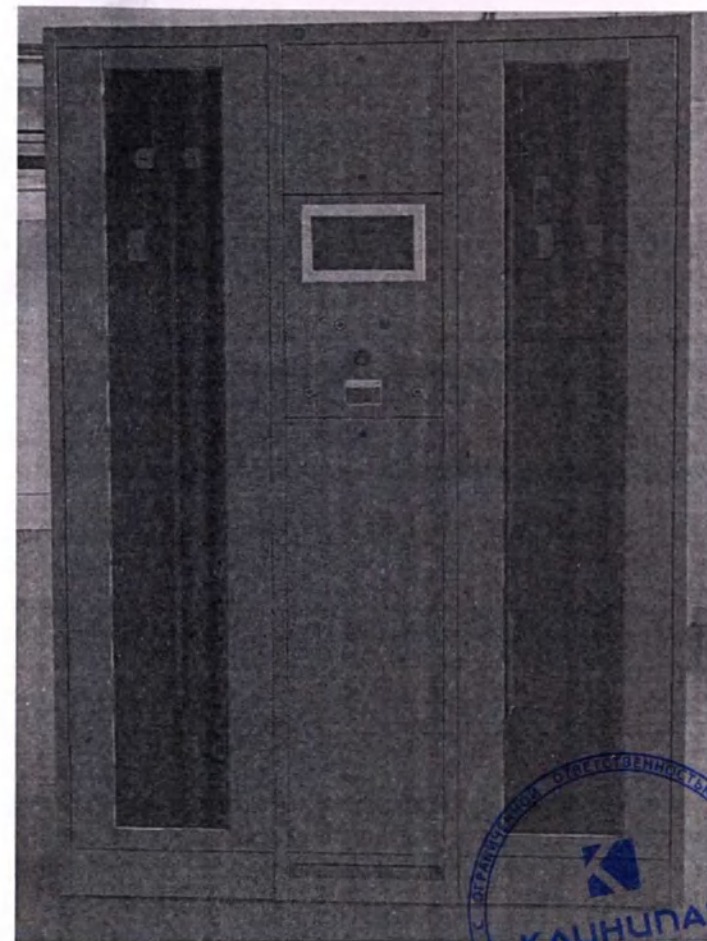

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 8С-С

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1380x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 8С-С

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист 9
Генеральный
директор



ПАСПОРТ

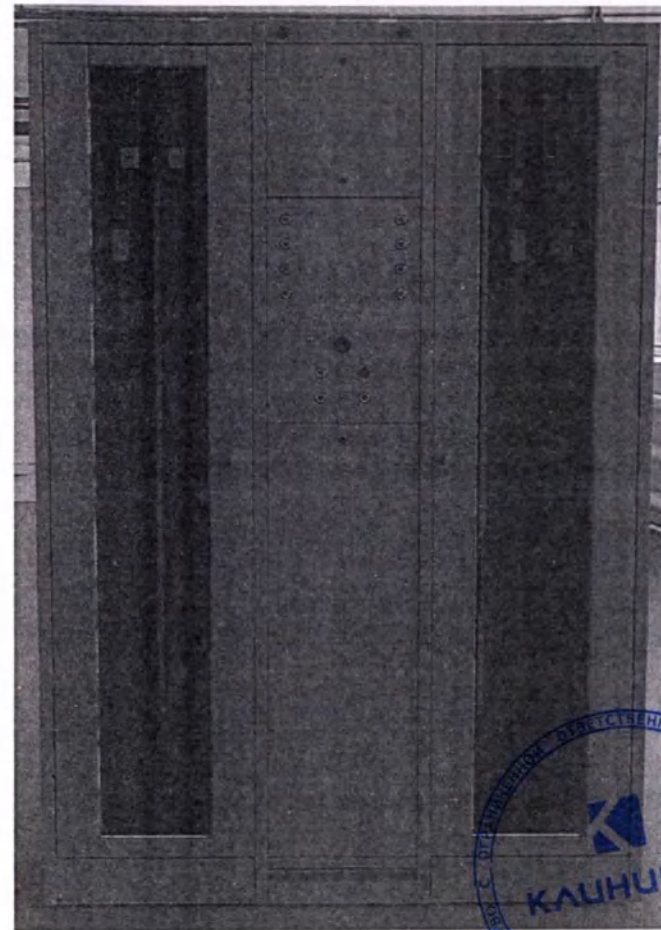

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 8С-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1380x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,5
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 8С-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XV, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два)

Генеральный
директор

Лист 2

Руденко А.В.



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 9L-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1600x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 9L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. ХХ, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист 6
Генеральный
директор _____ Руденко А.В.



ПАСПОРТ

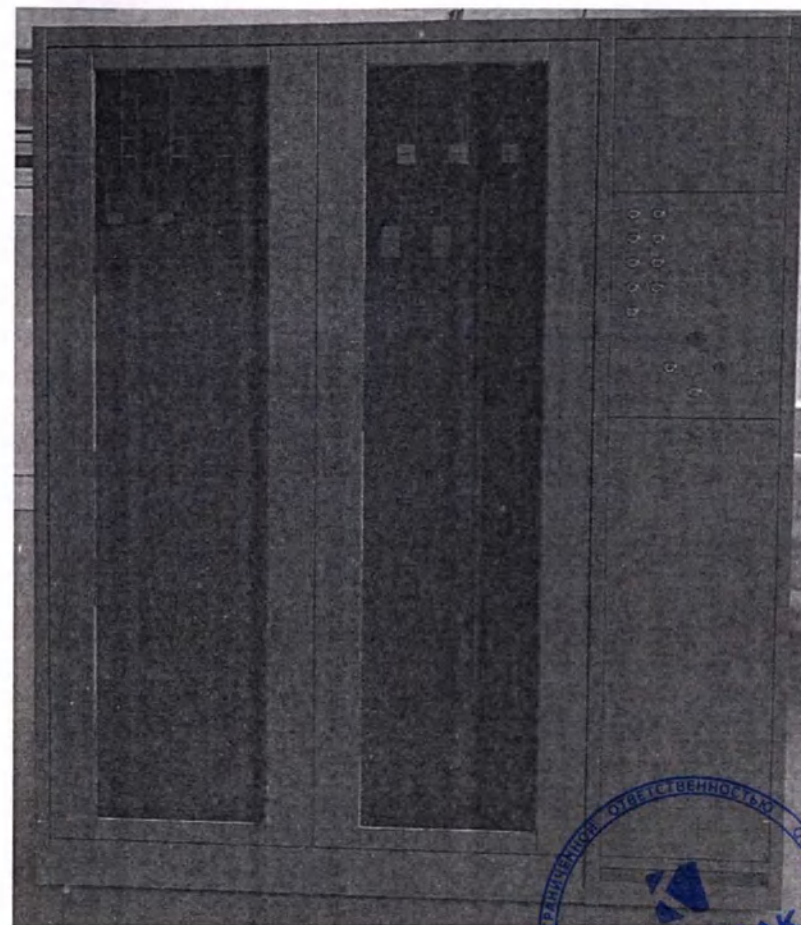

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 9L-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1600x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 9L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования: IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два)
Генеральный
директор



ПАСПОРТ

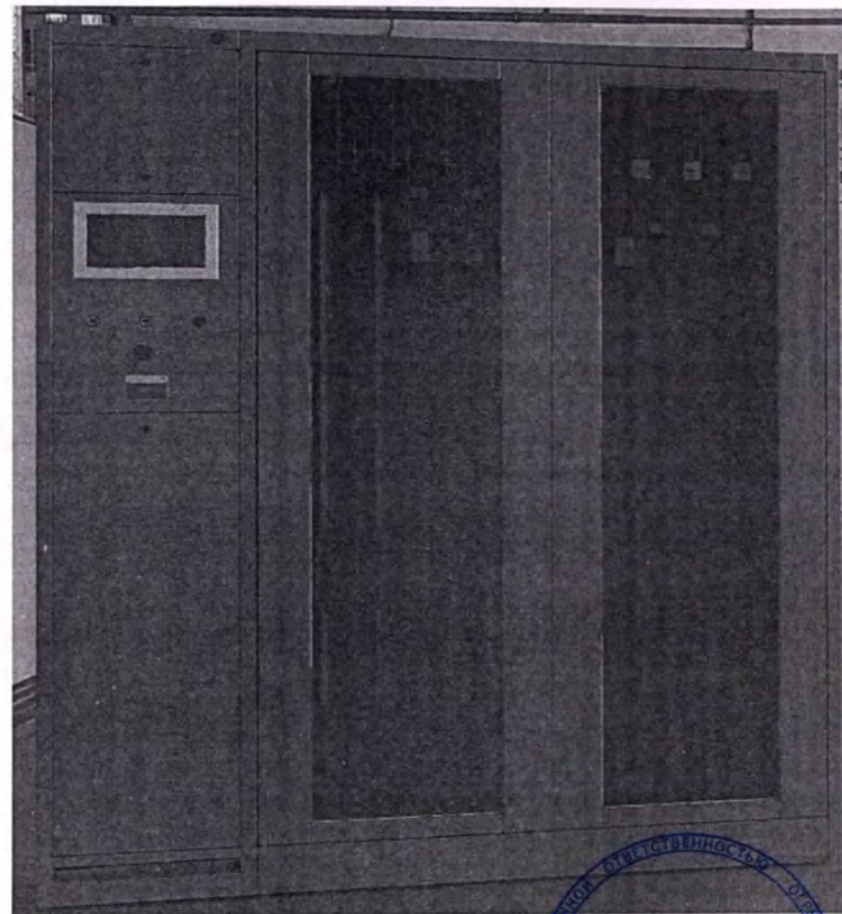

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «НЛОС» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 9R-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1600x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 9R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. ХУ, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор Руденко А.В.



ПАСПОРТ

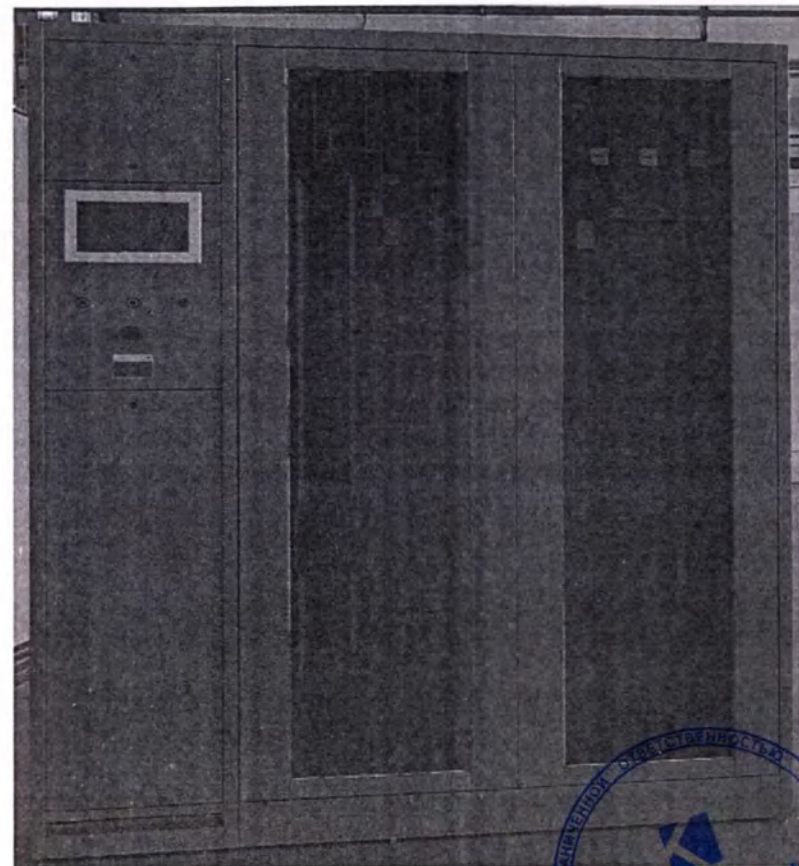

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 9R-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1600x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 9R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) листа
Генеральный директор Руденко А.В.



ПАСПОРТ

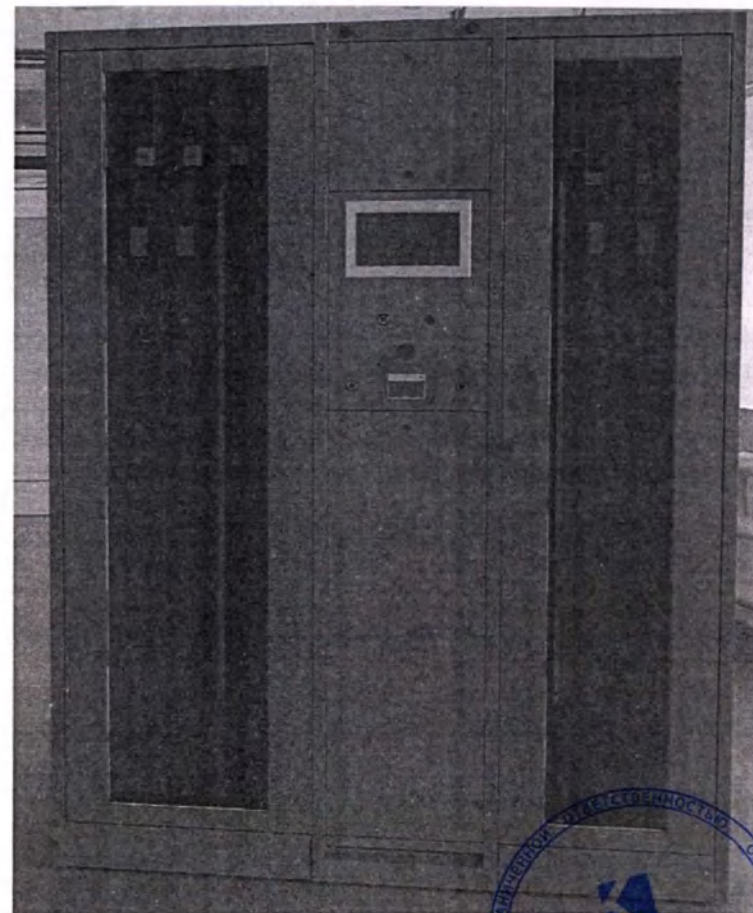

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 9С-С



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1630x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 9С-С

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31 Москва,

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор Руденко А.В.



ПАСПОРТ

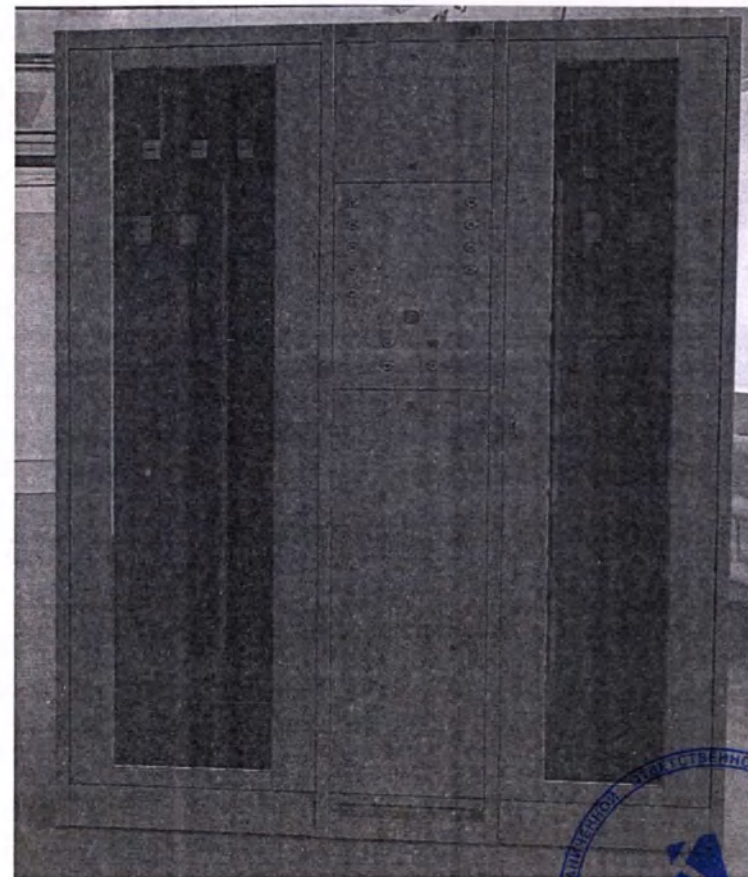

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 9С-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1630x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 9C-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, помн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию


Штамп ОТК



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

Генеральный
директор

Руденко А.В.

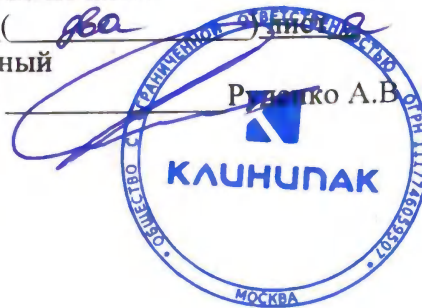

ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 10L-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1600x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 10L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125012, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию _____

Штамп ОТК _____




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

Генеральный
директор

Руденко А.В



ПАСПОРТ

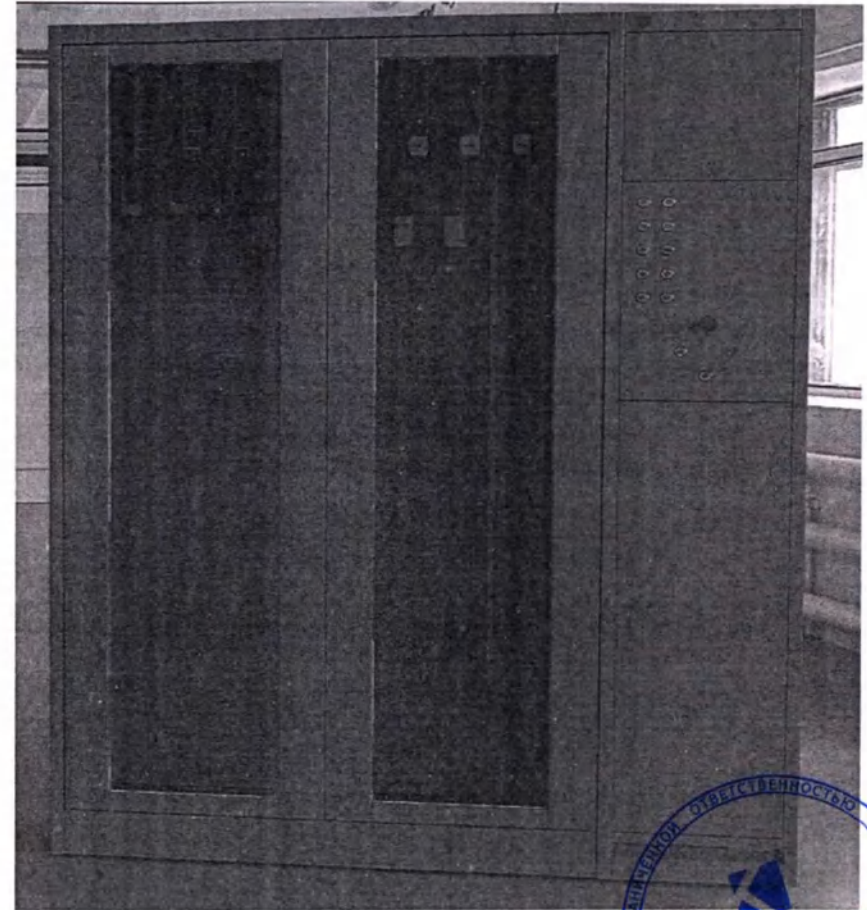

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 10L-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1600x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 10L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный директор _____ Руденко А.В.



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 10R-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1600x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 10R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а


Генеральный
директор

Руденко А.В

КЛИНИПАК



ПАСПОРТ

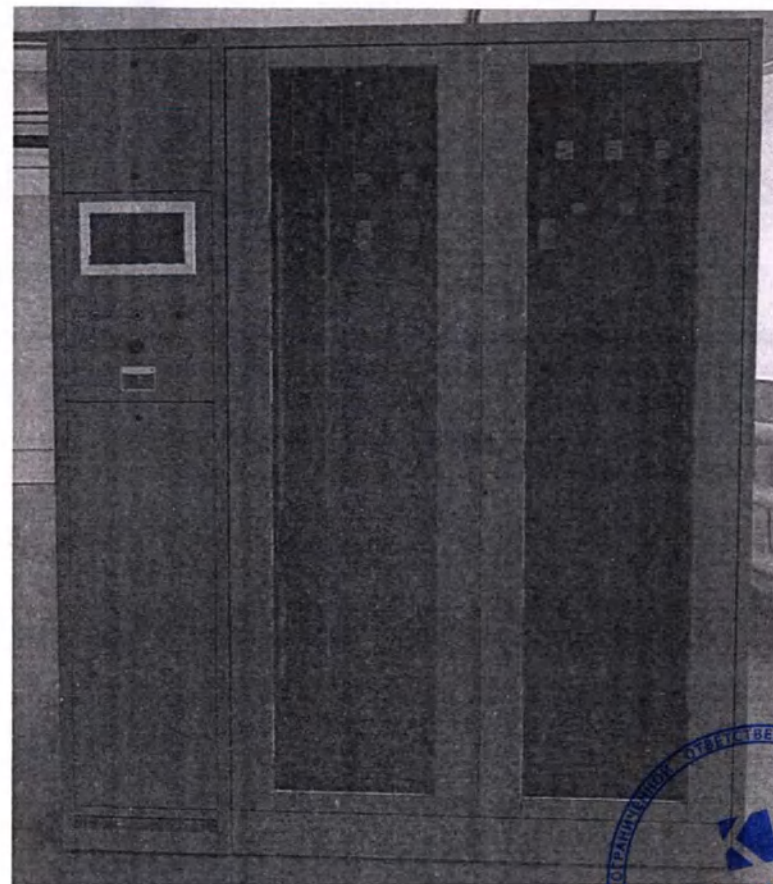

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «КЛИНИПАК» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 10R-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1600x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 10R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. Х/1, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

21 два) лист
Генеральный
директор _____



ПАСПОРТ

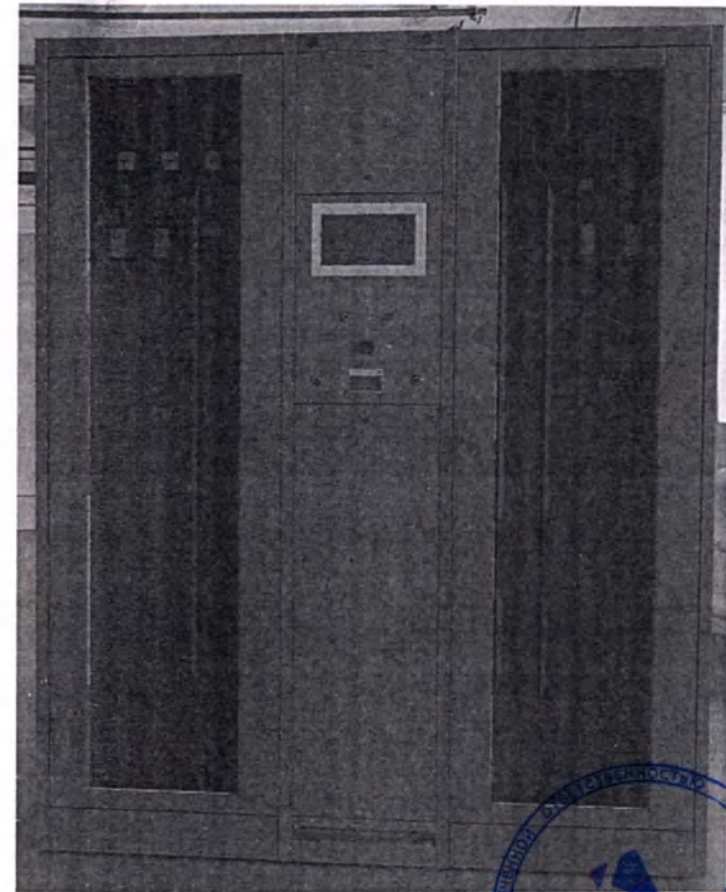

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NROS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 10C-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1630x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 10С-С

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист(ов)
Генеральный
директор _____



ПАСПОРТ

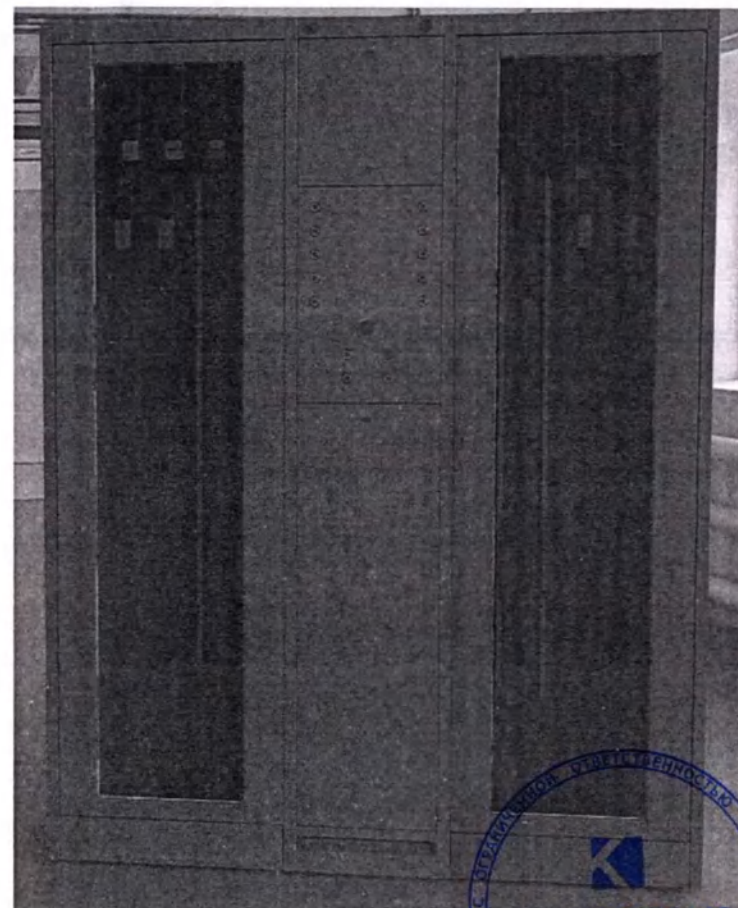

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 10С-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1630x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	250
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 10C-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор



ПАСПОРТ



Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 12L-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1880x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 12L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию _____

Штамп ОТК _____




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист 2
Генеральный
директор _____ Руденко А.В.



ПАСПОРТ

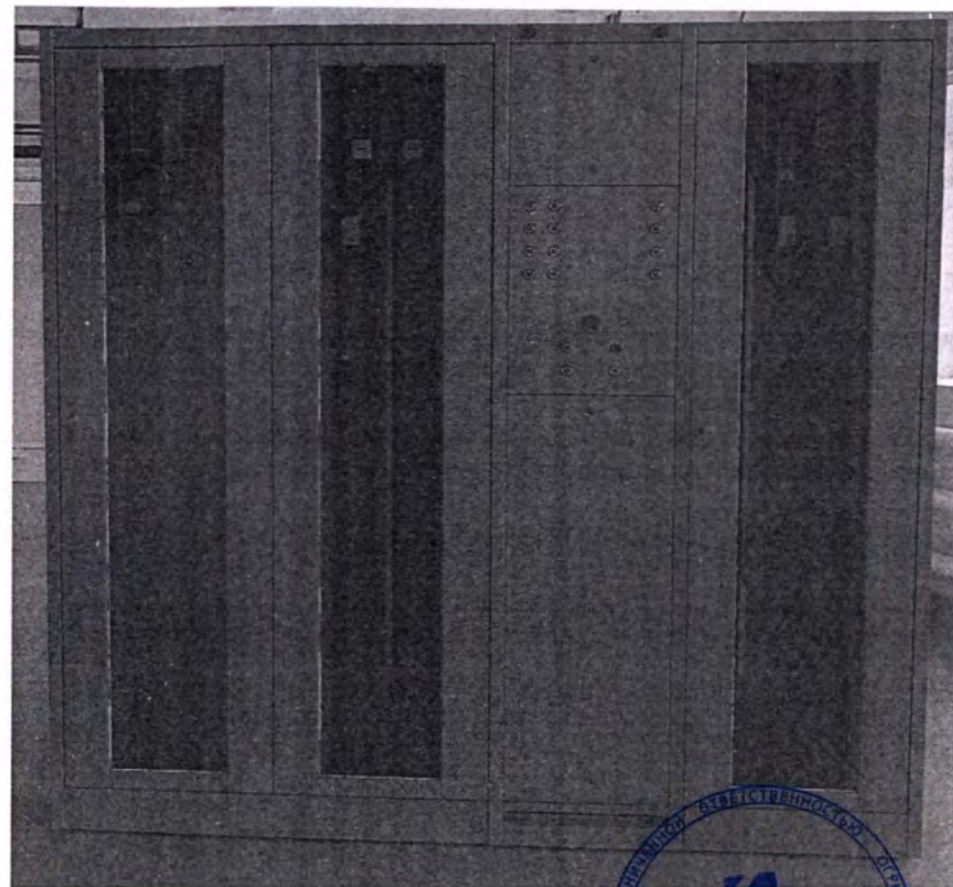

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 12L-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1880x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 12L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный директор Руденко А.В.



ПАСПОРТ

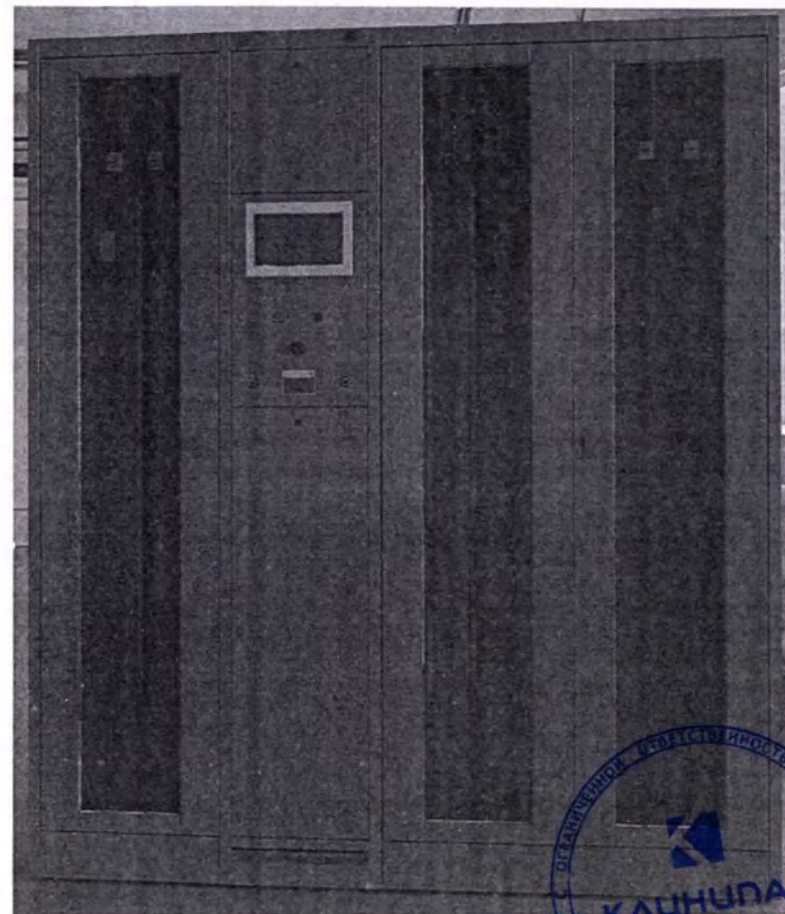

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 12R-C

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1880x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 12R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования: IP 20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125211, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью


2 (два) лист

Генеральный
директор

Руденко А.В.

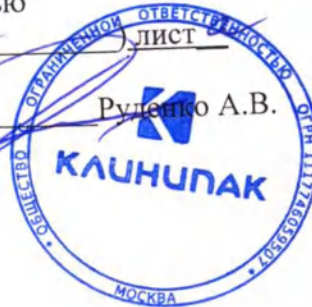

ПАСПОРТ

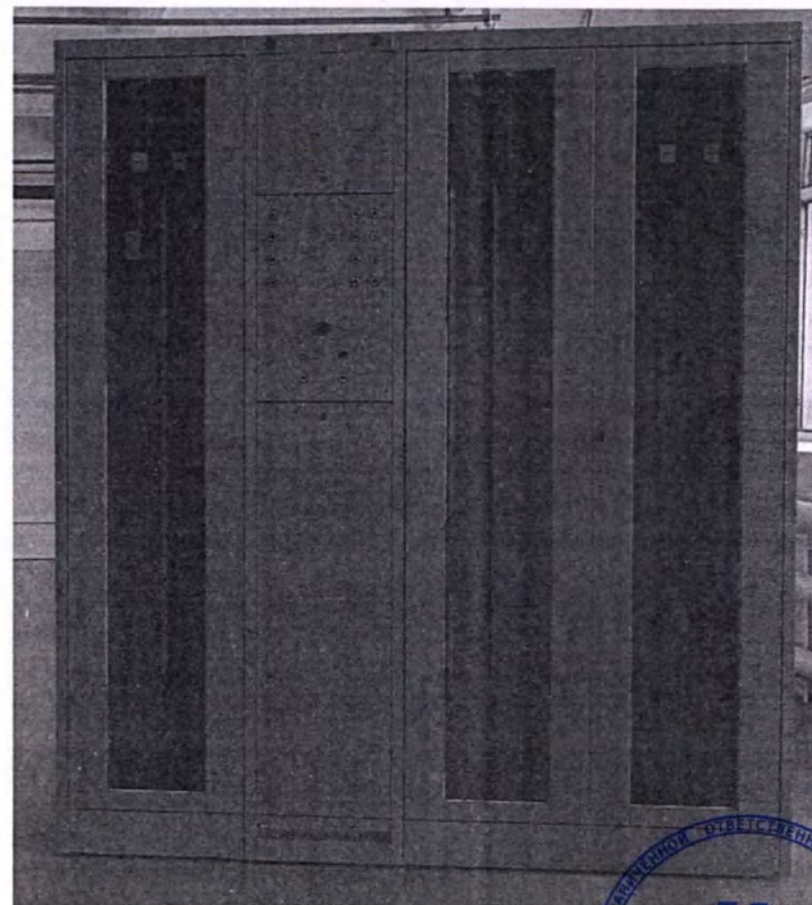

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 12R-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	1880x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 12R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 51.


Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор _____ Руденко А.В.

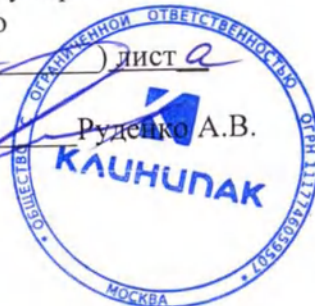

ПАСПОРТ

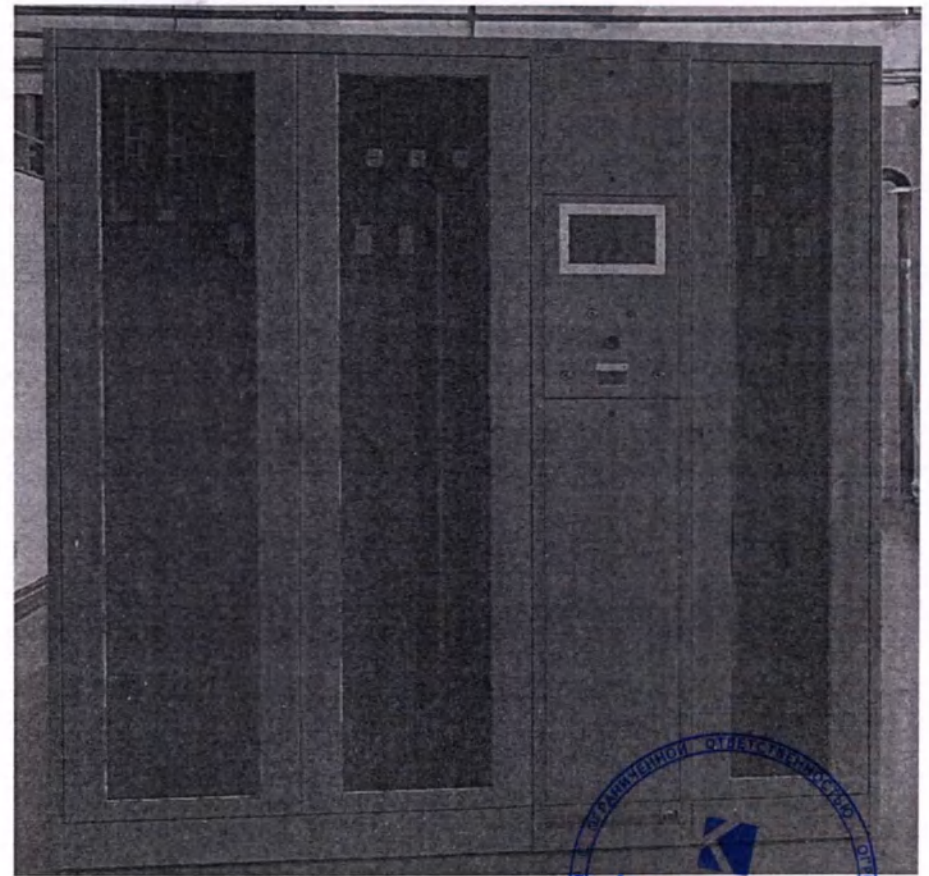

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 14L-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	2100x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 14L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31. Москва,

Дата ввода в эксплуатацию _____

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью


2 (два)

Генеральный
директор

Руденко А.В



ПАСПОРТ

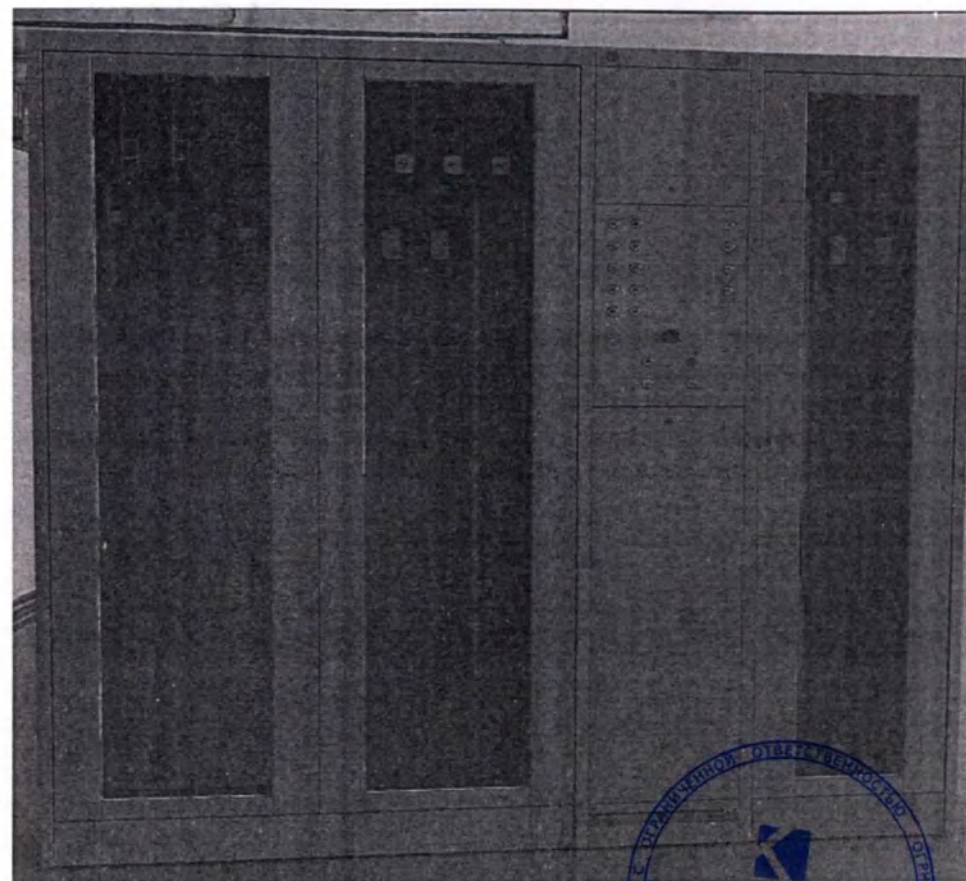

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 14L-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	2100x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 14L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию _____

Штамп ОТК _____




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный директор _____ Руденко А.В.



ПАСПОРТ

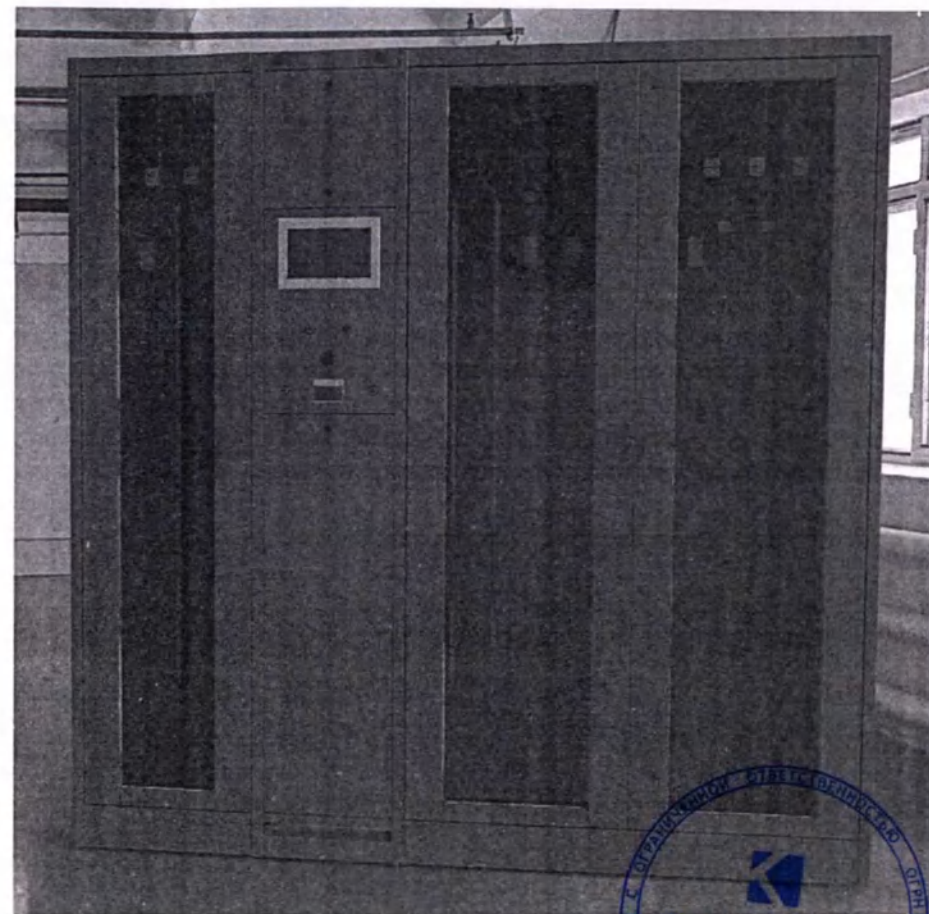

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 14R-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	2100x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 14R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP 20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31

Москва,

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью


2 (два) ЛИСТ

Генеральный
директор

Руденко А.В.



ПАСПОРТ

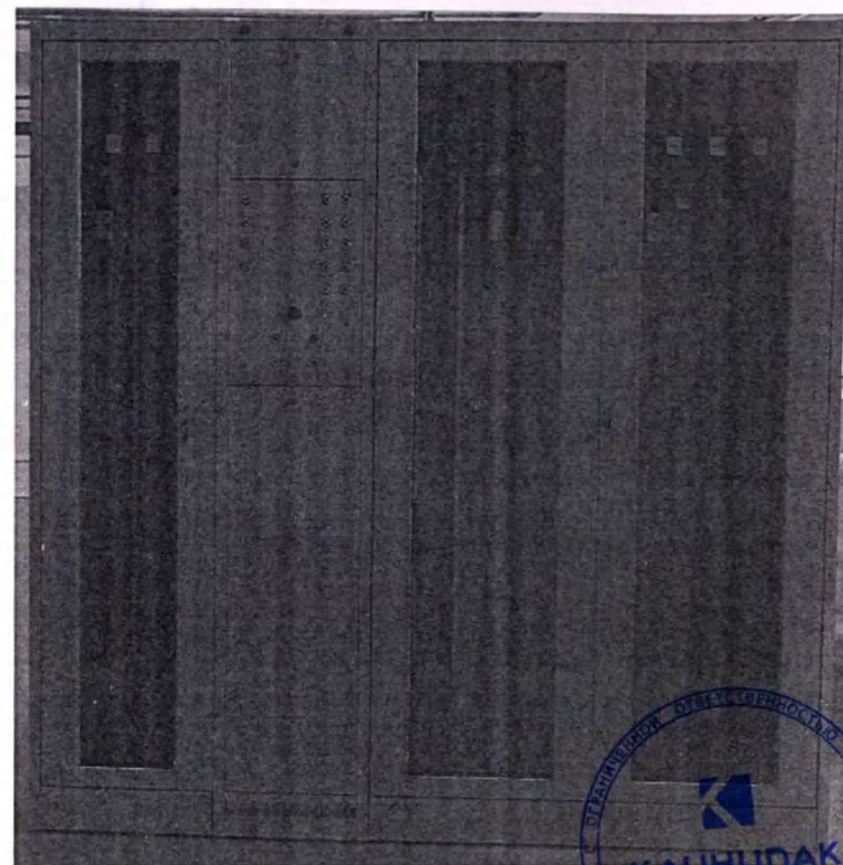

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 14R-S

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	2100x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 14R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (дво) лист 2
Генеральный директор Руденко А.В.



ПАСПОРТ

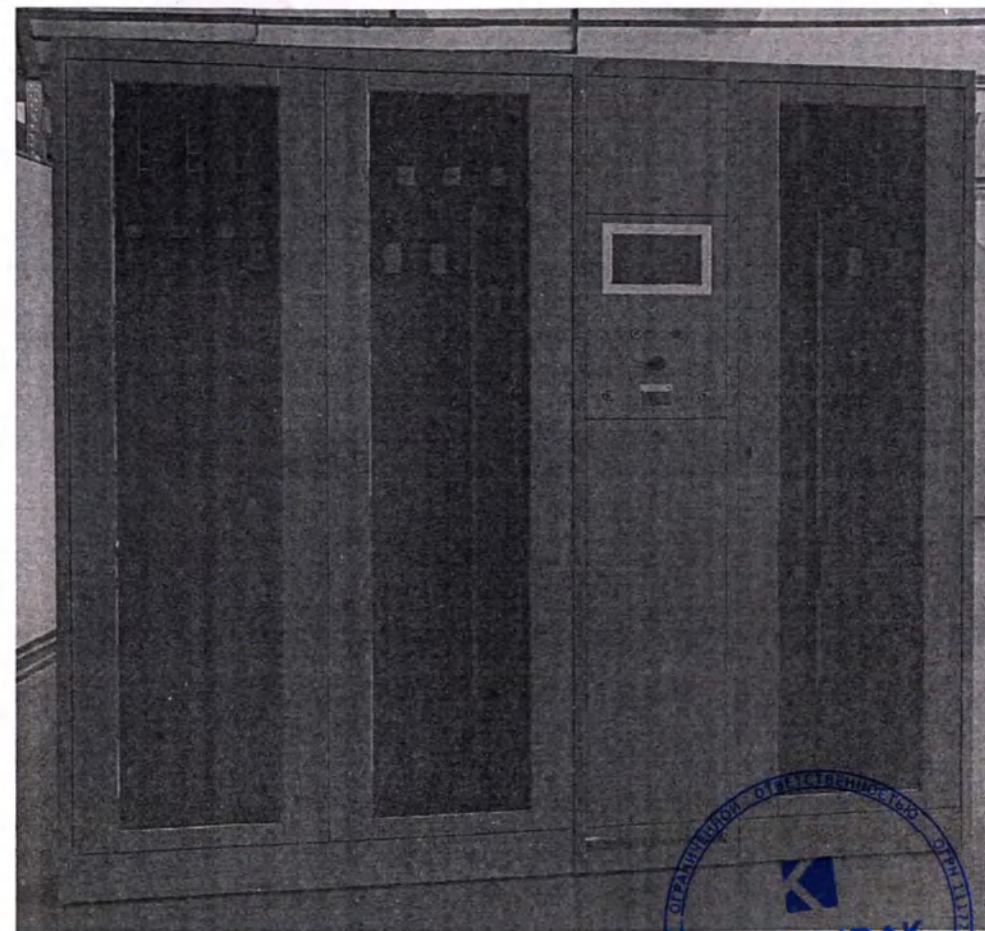

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 15L-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	2210x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 15L-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор Руденко А.В.



ПАСПОРТ

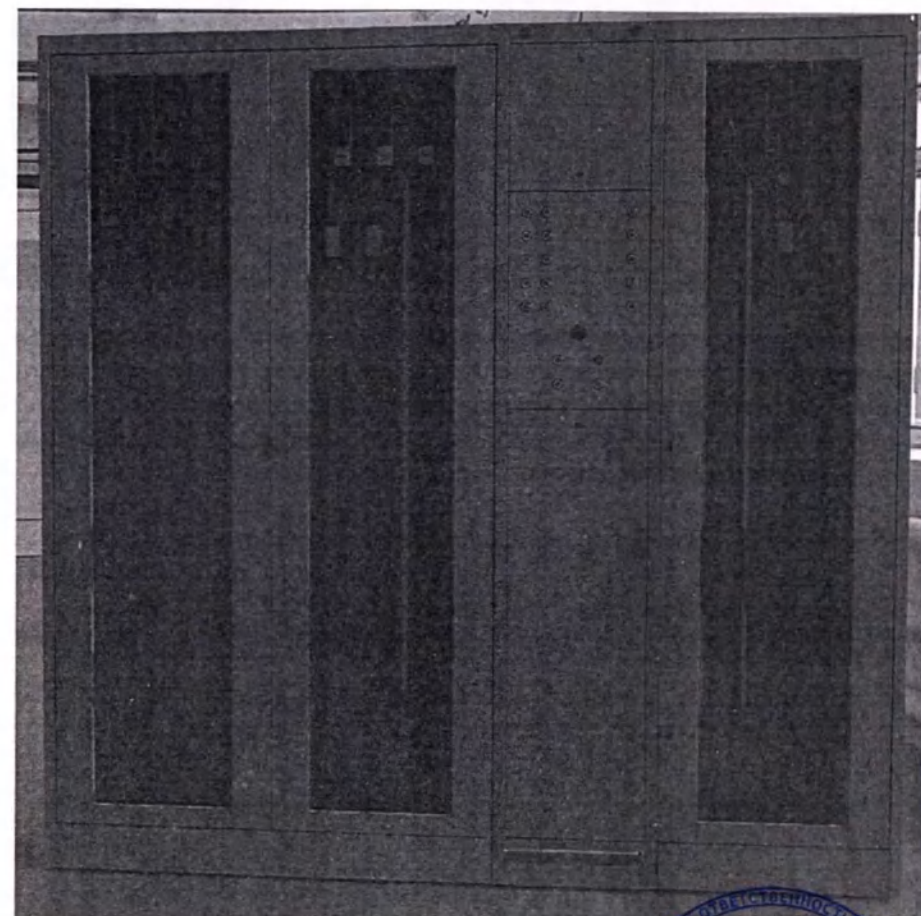

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 151-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	2210x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 15L-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 701.

Дата ввода в эксплуатацию _____

Штамп ОТК _____



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью


Генеральный
директор

2 (два) ЛИСТ

Руденко А. В.



ПАСПОРТ

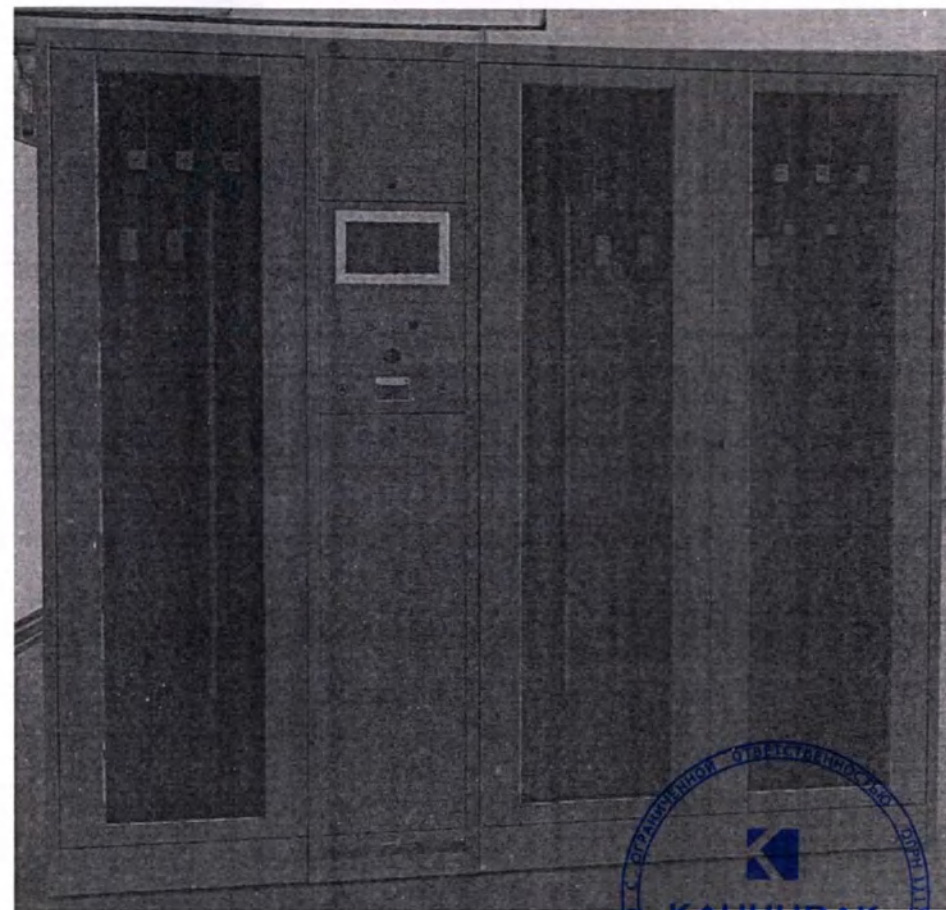

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 15R-C



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	2210x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 15R-C

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XV, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два)
Генеральный
директор

Руденко А.В.



ПАСПОРТ

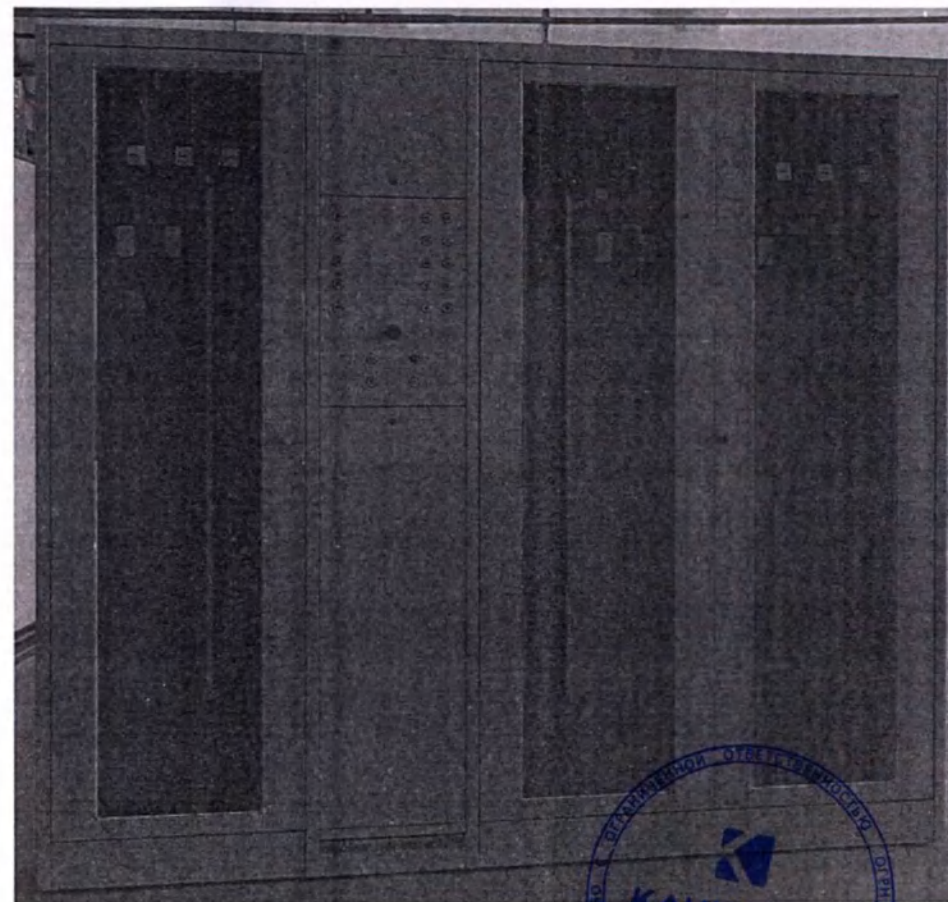

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 15R-S



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	2210x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 15R-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИКАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Генеральный
директор _____



ПАСПОРТ

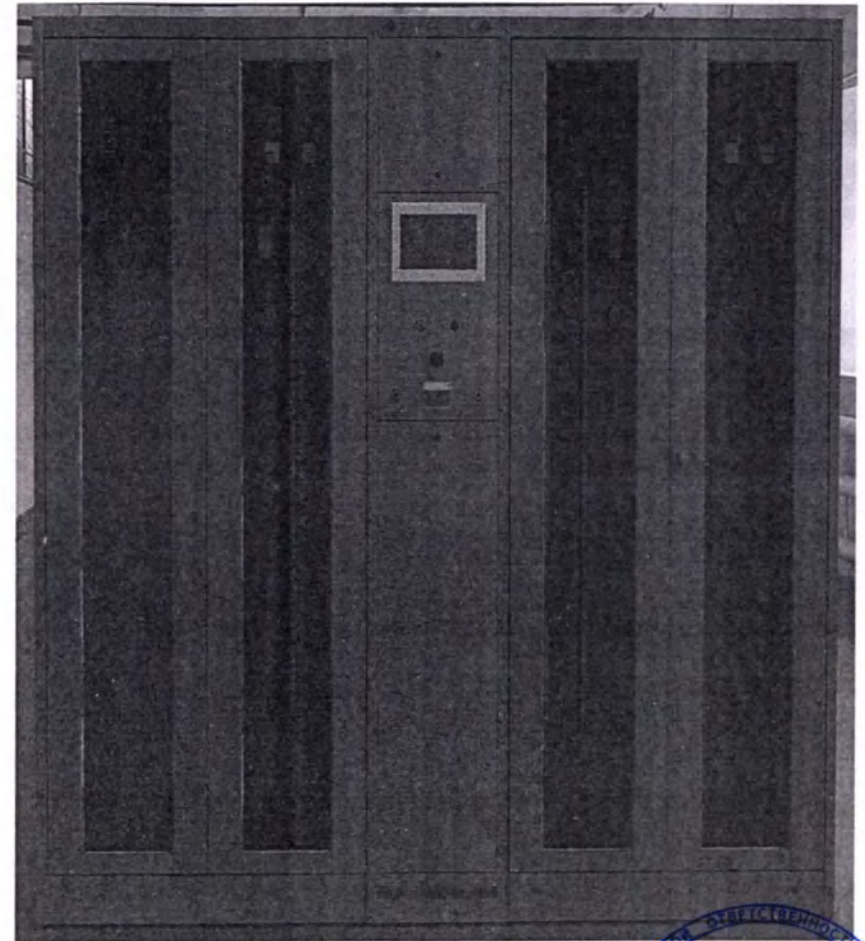

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 16С-



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	2350x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 16С-С

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31.

Дата ввода в эксплуатацию

Штамп ОТК




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) листа
Генеральный директор _____



Руденко А.В.

ПАСПОРТ

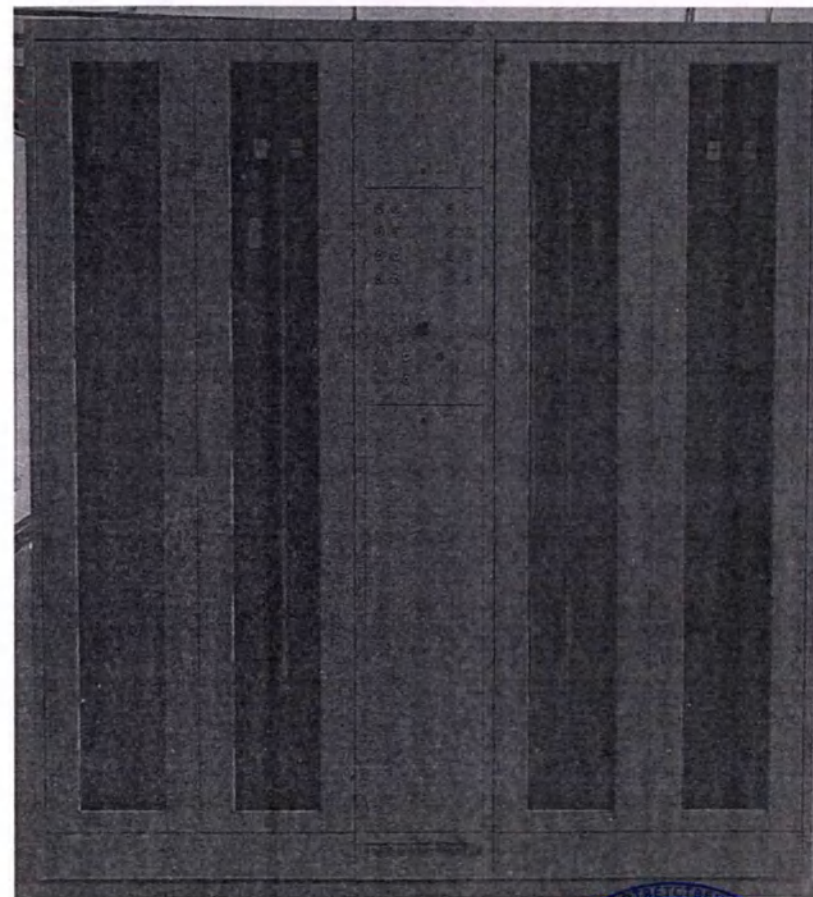

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по
ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Вариант исполнения: 160-8



1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с Руководством пользователя данного изделия.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием и храниться у лица, ответственного за это изделие.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, $\pm 5\%$	2350x360x2200
2	Масса конструктивная, кг, не более	420
3	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
4	Количество режимов работы	1
5	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
6	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
7	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
8	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
9	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
10	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный по ГОСТ Р ИСО 8573-1
11	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
12	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
13	Потребляемая мощность, кВт, не более	1,0
14	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
15	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
16	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000
17	Размеры держателя эндоскопа, ВхШхГ, мм, $\pm 5\%$ - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55

№	Наименование параметра	Значение
18	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, $\pm 5\%$	2080
19	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
20	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
21	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7

3. Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафов предприятие-изготовитель обеспечивает их замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы медицинского изделия – не менее 5 лет с возможностью продления.

Наименование изделия: Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50–008–69745848–2019 с принадлежностями.

Вариант исполнения: 16С-S

Серийный номер: XXXX

Дата производства: XX.XXXX

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254

Производитель: ООО «КЛИНИПАК», Россия, 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31

Дата ввода в эксплуатацию _____

Штамп ОТК _____



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист
Генеральный
директор _____



Руденко А.В.


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Шкафы для сушки и хранения эндоскопов «NEOS»
по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Варианты исполнения:

2L-S, 2R-S, 3L-S, 3R-S, 4L-S, 4R-S, 5L-S, 5R-S, 6L-S, 6C-S, 6R-S, 7L-S, 7C-S, 7R-S, 8L-S, 8C-S, 8R-S, 9L-S, 9C-S, 9R-S, 10L-S, 10C-S, 10R-S, 12L-S, 12R-S, 14L-S, 14R-S, 15L-S, 15R-S, 16C-S.

2L-C, 2R-C, 3L-C, 3R-C, 4L-C, 4R-C, 5L-C, 5R-C, 6L-C, 6C-C, 6R-C, 7L-C, 7C-C, 7R-C, 8L-C, 8C-C, 8R-C, 9L-C, 9C-C, 9R-C, 10L-C, 10C-C, 10R-C, 12L-C, 12R-C, 14L-C, 14R-C, 15L-C, 15R-C, 16C-C.

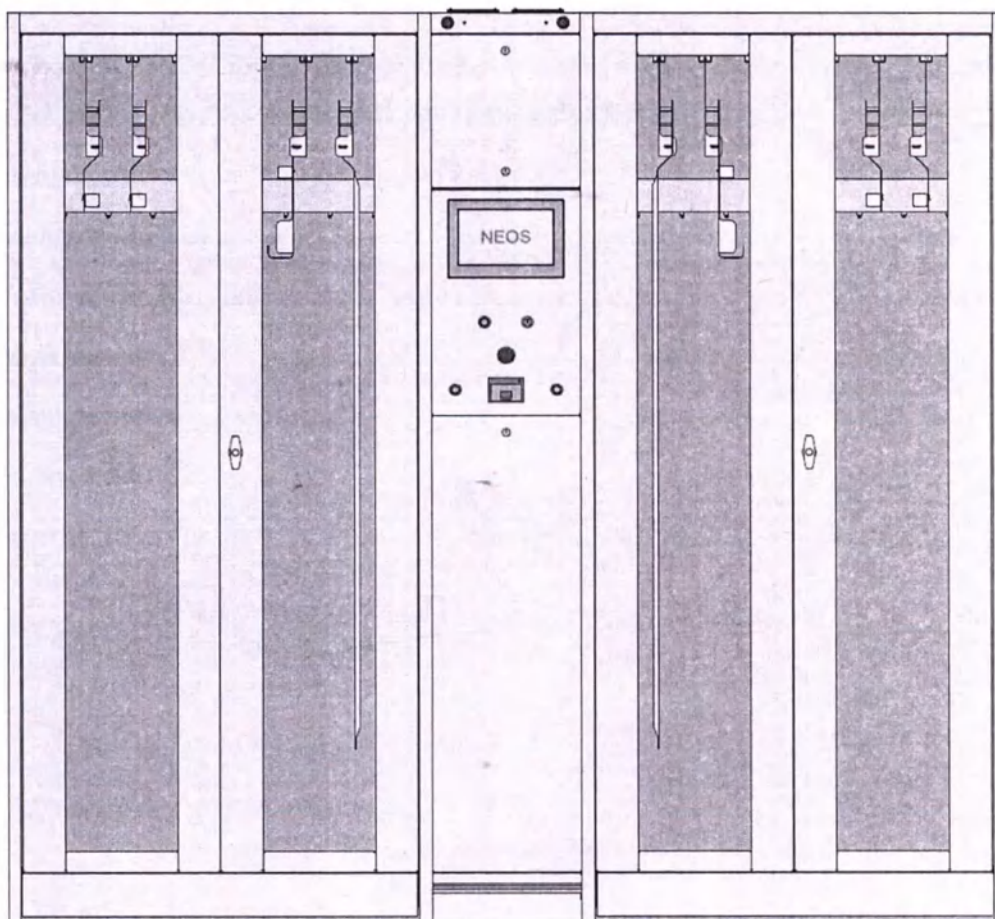

Версия Руководства пользователя 06.2024

125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31, тел. (495) 510-29-82
www.klinipak.ru, e-mail: info@klinipak.ru

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАФА.....	10
5. ОБЩИЙ ВИД, ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ШКАФА.....	11
6. УПРАВЛЕНИЕ NEOS.....	14
7. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИ NEOS в комплектации С (Complex).....	26
8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	33
9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	37
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	38
11. АДРЕС ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	47
Приложение I:.....	48
Приложение II:.....	49
Приложение III:	50
Приложение IV:.....	52
Приложение V:	52
Приложение VI:	57
Приложение VII:.....	58

1. ВВЕДЕНИЕ

Компания ООО «КЛИНИПАК» благодарит вас за то, что вы полагаетесь на нас, выбирая нашу продукцию, и выражает надежду, что она полностью удовлетворит вашим требованиям.

Обращайте особое внимание на разделы, обозначенные символом.



Опасно!

Инструкции, позволяющие избежать травм пациентов, медицинского и технического персонала, работающего со шкафом для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями и проводящего его обслуживание.



Внимание

Информация о правильном функционировании и использовании шкафа для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями.



Примечание

Специальная информация и рекомендации по эксплуатации, установке и техническому обслуживанию шкафа для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями.



Важное замечание об использовании шкафа для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Прочитайте данное руководство пользователя!

Перед первым использованием шкафа для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями (**далее по тексту - шкаф или NEOS**), ознакомьтесь с функциями и режимами работы шкафа.

Невыполнение требований руководства пользователя может привести к травмам пациентов, медицинского и технического персонала, пользующегося шкафом и проводящего его обслуживание, а также может привести к поломке шкафа.

Блок пользовательской информации

Мы рекомендуем организовать Блок пользовательской информации, в состав которого войдут:

- Инструкция по эксплуатации;
- Записи об инструктаже и вводе в эксплуатацию;
- Записи о техническом обслуживании.

2. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

NEOS - медицинское изделие, предназначенное для сушки и хранения гибких эндоскопов после дезинфекции и стерилизации. Эндоскопы хранятся в обеззараженном потоке воздуха без разрушающего воздействия ультрафиолетового излучения.

Предназначено для применения в условиях лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских институтах и других медицинских учреждений.

Показания к применению

Сушка и хранение гибких эндоскопов после дезинфекции высокого уровня или стерилизации.

Потенциальный пользователь:

Квалифицированный персонал медицинских организаций любого профиля.

Противопоказания

Не применимо к данному изделию.

Возможное побочное действие

При соблюдении условий хранения, транспортировки, а также требований руководства пользователя побочные действия отсутствуют.

Принцип действия шкафа основан на принудительной циркуляции очищенного, обеззараженного воздуха через отсек сушки и хранения эндоскопов и каналы эндоскопов.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Освобождение от ответственности

ООО «КЛИНИПАК» не отвечает за ущерб, прямой или косвенный, возникший при следующих обстоятельствах:

1. Первое вскрытие транспортной упаковки **NEOS** было произведено неуполномоченными лицами.
2. Монтаж и ввод в эксплуатацию был произведен неуполномоченными лицами.
3. **NEOS** неправильно эксплуатировался или хранился.
4. Неправильное проведение технического обслуживания.
5. Не соблюдались установленные интервалы между проверками или техническим обслуживанием.
6. Не соблюдались инструкции, приведенные в данном руководстве.
7. Ремонт и регулировка **NEOS** проводились неуполномоченными лицами.

Уполномоченные специалисты по обслуживанию оборудования

Внимание



Только специалисты по обслуживанию оборудования, имеющие сертификаты ООО «КЛИНИПАК», уполномочены проводить ремонт, регулировку и обслуживание шкафа. Подготовка и сертификация уполномоченных специалистов проводится только компанией ООО «КЛИНИПАК».

Целевое использование NEOS

Внимание



NEOS должен использоваться исключительно по прямому назначению в полном соответствии с данным руководством.

Требования по размещению



Примечание

Убедитесь в том, что есть достаточная площадь для установки шкафа и что все требуемые источники электрического питания находятся в месте предполагаемой установки шкафа.

Убедитесь, что **NEOS** установлен в помещении, удовлетворяющем требованиям:

- относительная влажность воздуха должна быть не более 70%;
- температура окружающего воздуха находится в пределах от 10°C до 30°C.

NEOS должен быть установлен на гладкой ровной поверхности в условно чистой зоне, предназначенной для дезинфекции высокого уровня или стерилизации, сушки и хранения эндоскопов. Рекомендуется размещать шкаф около стены, при необходимости возможно закрепить шкаф к стене. Руководство пользователя должно храниться вблизи шкафа.

Установка

При установке шкафа соблюдайте требования по безопасности и подключению электропитания.



Инструктаж

Инструктаж персонала на месте производится специалистом (инженером) ООО «КЛИНИПАК» или уполномоченным консультантом по медицинскому оборудованию.

Проверка функционирования



Внимание

Перед началом использования проверьте шкаф, убедитесь, что все его компоненты находятся на своих местах и работают. Перед первым использованием шкафа и после проведения ремонтных работ обязательно проверьте правильность установки шкафа.



Опасно! (общие моменты)

• Несанкционированное открытие NEOS

При открытии отсека управления шкафом открывается доступ к компонентам под напряжением - они могут вызывать удар током при прикосновении. Отсек управления шкафом нельзя открывать самостоятельно, он может быть открыт только уполномоченным компанией ООО «КЛИНИПАК» специалистом (инженером) по обслуживанию.

• Проникновение жидкостей

Следует избегать попадания жидкостей в отсек управления шкафа, так как это может помешать работе шкафа и/или вызвать короткое замыкание (удар током). Избегайте размещения жидкостей вблизи от электрических компонентов.

Если жидкость попала внутрь отсека управления шкафа, не включайте шкаф.

• Работа во взрывобезопасных областях

Работа в помещениях, содержащих емкости со взрывоопасными газами, может вызвать серьезные повреждения и привести к травмам.

- **Использование дополнительного оборудования, не входящего в состав NEOS**

Использование неподходящего дополнительного оборудования может привести к некорректной работе шкафа, что может вызвать травмы пациентов, медицинского и технического персонала. Используйте только оборудование, рекомендуемое для эксплуатации с NEOS.

- **Неисправный шкаф**

Эксплуатация неисправного шкафа представляет опасность. Не включайте шкаф, если вы подозреваете наличие неисправности или точно знаете о ней. Убедитесь, что шкаф не будет использоваться до проверки его уполномоченным специалистом.

Дополнительные инструкции техники безопасности, относящиеся к **NEOS**, описаны в других разделах данного руководства.

Поставка



Внимание

- С учетом массы шкафа попытка поднять его самостоятельно сопряжена с риском травмы. Шкаф должен транспортироваться с помощью вилочного погрузчика или грузоподъемной тележки.
- При транспортировке и монтаже шкафа возможно травмирование рук и ног. Работайте в защитных рукавицах и рабочей обуви.
- Шкаф может упасть и вызвать тяжелые травмы. Никогда не опрокидывайте шкаф и транспортируйте его только в вертикальном положении.

Шкаф отправляется с завода в полимерной упаковке, в картонной гофре на деревянном поддоне.

Транспортировка



Внимание

NEOS подлежит транспортированию – по ГОСТ 23216 и ГОСТ Р 51908.

Транспортирование шкафа осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия перевозки шкафа в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 2 (С) ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов – группе Ж ГОСТ 23216.

В процессе транспортировки резкие ускорения в любом из направлений не должны превышать значения 10 g.

Шкаф разрешено перемещать двумя способами:

- вилочным погрузчиком, при этом вилы должны быть полностью задвинуты под поддон;
- на грузоподъемной тележке.

Извлечение из упаковки



Внимание

Для предотвращения повреждений не рекомендуется извлекать шкаф из упаковки до момента его транспортировки на место установки. Снимите упаковку из картона или осторожно разрежьте ее по одной стороне.

Проверка комплектности и отсутствия повреждений, вызванных транспортировкой

- Проверьте комплектность поставки по накладной.
- Проверьте отсутствие повреждений шкафа.
- При обнаружении отклонений от необходимой комплектности, повреждений или несоответствий не начинайте эксплуатацию шкафа, а известите о случившемся перевозчика и ООО «КЛИНИПАК».

Утилизация упаковочного материала

Утилизируйте упаковочный материал (картон, дерево, полимер) в соответствии с правилами утилизации соответствующего материала.

Хранение и утилизация

Хранение

Разрешается хранить **NEOS** только в следующих условиях:

Условия хранения – по группе 2 (С) ГОСТ 15150, при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 50 °С, относительной влажности не более 95% при плюс 25 °С и атмосферном давлении от 50,0 до 106,7 кПа.

Шкаф хранят в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

Не допускается хранение шкафа вблизи мест хранения химических реагентов, аммиака и других газообразных веществ, вызывающих коррозию металла.

Условия эксплуатации

Шкаф пригоден для работы в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Допускаемые температура окружающей среды при эксплуатации: от плюс 10 до плюс 35°С, влажность: не выше 70% при плюс 25°С, атмосферное давление: от 86,0 до 106,7 кПа.

Атмосфера – типа I по ГОСТ 15150.

Характеристики окружающей среды и содержащихся в ней аэрозолей: нетоксичная, не взрывопожароопасная по ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.19, 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007, не радиоактивная согласно СанПиН 2.6.1.2523-09.

Шкаф должен быть стойким при воздействии механических факторов по группе 1 ГОСТ Р 50444.

Рабочий газ – сжатый воздух, не содержащий масел и воды.

Утилизация

Шкаф относится к отходам класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям технических условий ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

При наличии обоснованных претензий к качеству шкафа предприятие-изготовитель обеспечивает его замену или бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации.

Не принимаются претензии по шкафу, имеющим внешние повреждения.

Средний срок службы **NEOS** – не менее 5 лет с возможностью продления.

Срок хранения набора для подключения, фильтра компрессора, фильтра соединительных трубок – 5 лет с даты изготовления.

Срок действия консервации шкафа - 2 года, по истечении указанного срока шкаф подвергается переконсервации силами и средствами потребителя в соответствии с руководством предприятия-изготовителя.

Риски применения NEOS

В рамках процесса разработки **NEOS** проводится Управление рисками для определения критических конструктивных элементов. Система Управления рисками охватывает сырье, изготовление, транспортировку и использование. Система Управления разработана на основе различных действий, связанных с использованием шкафа. На стадии проектирования шкафа определяется возможное предсказуемое неправильное использование, виды неисправностей и воздействие, оценивается критичность и определяются профилактические меры. Данная система соответствует требованиям ГОСТ Р 56275.

Более подробная информация содержится в документе ФМР.006. 68428554.21

Анализ риска для шкафа проводится согласно ГОСТ ISO 14971. Совокупный остаточный риск, создаваемый шкафом, классифицирован как приемлемый.

График распределения зависимости вероятности нанесения ущерба и последствий нанесенного ущерба после принятия мер по Анализу видов и последствий потенциальных несоответствий процесса (PFMEA).

Вероятность нанесения ущерба	Категория	Рейтинг вероятности	Приоритетный номер риска (область)				
	P7	Очень высокий					
	P6	Высокий					
	P5	Умеренно высокий					
	P4	Средний					
	P3	Низкий			11	3	5
	P2	Очень низкий		2	25	25	3
	P1	Отдаленный			3	1	
Ранг тяжести			Ничтожное	Малое	Серьезное	Критическое	Катастрофическое
Категория			S1	S2	S3	S4	S5
Тяжесть ущерба							



- Область недопустимых значений (необходимость введения защитных мероприятий)
- Пограничная зона (мероприятия по снижению рисков желательны)
- Область приемлемых значений (здесь риски приемлемы)

После того, как все меры по управлению риском были выполнены, все идентифицированные риски находятся в зоне «Приемлемо». В этом случае остаточный риск признан приемлемым и сообщение о наличии остаточного риска не потребуется. Распознанные риски были снижены настолько, что остаточный риск является приемлемым. Действенность мероприятий по снижению рисков доказана проведенными испытаниями и задокументирована.

Распределение и интенсивность электромагнитного излучения и ультрафиолетового вокруг медицинского изделия и средства защиты от него.

Основными видами средств коллективной защиты оператора от воздействия электрического поля токов промышленной частоты являются экранирующие устройства.

В Шкафу для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями (далее - медицинское изделие) такими источниками являются электродвигатели компрессоров, электромагнитные клапаны, электронный контроллер и вторичные источники электропитания. Все эти компоненты имеют металлические экранирующие корпуса, а также металлический корпус всего медицинского изделия также является общим экраном.

Таким образом, двойное экранирование медицинского изделия приводит напряженности электрических и магнитных полей к уровню естественного фона.

В шкафу расположена лампа бактерицидная Philips TUV 8W G5 (УФ-излучатель) обеззараживающая циркулирующий в объеме воздух.

Основными способами защиты оператора от воздействия УФ-излучения является экранирование рабочего места.

Отсутствие воздействия УФ-излучения обусловлено закрытой конструкцией лампы бактерицидной, в которой излучение полностью сконцентрировано во внутреннем его объеме и не имеет выхода за его пределы. Данная лампа бактерицидная закрыта экранирующим кожухом и смонтирована внутри отсека управления медицинского изделия, образующего дополнительный защитный экран.

Таким образом, выход УФ-излучения за пределы закрытого отсека управления полностью исключен и внешнее распределение УФ-излучения медицинского изделия отсутствует.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАФА

Проверка комплектности

Извлеките шкаф из транспортной тары. Проверьте шкаф сразу после доставки и убедитесь в том, что в наличии все компоненты и отсутствуют видимые внешние и внутренние повреждения.

Если шкаф подвергался консервации, то законсервированные поверхности протереть марлевым тампоном, смоченным 70% этиловым спиртом.

После транспортирования шкафа в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 24 часов.

Таблица комплектности

Наименование	Кол-во
Шкаф для сушки и хранения эндоскопов (указанного варианта исполнения)	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Сетевой кабель	1 шт.
Набор для подключения: - трубка соединительная воздушного/водного канала (с меткой синего цвета); - трубка соединительная вытяжного канала (с меткой красного цвета); - трубка соединительная биопсийного канала (с меткой зеленого цвета); - трубка соединительная струйного канала (с меткой белого цвета); - трубка разделительная; - трубка удлинительная - 2 шт.; - коннектор для подключения биопсийного канала (при необходимости); - коннектор для подключения воздушного/водного канала (при необходимости); - коннектор для подключения газового (CO ₂) канала (при необходимости); - заглушка для каналов - 2 шт. (при необходимости); - клапан канальный (при необходимости)	Не более 16 шт.
Фильтр компрессора	не более 4 шт.
Фильтр соединительных трубок	не более 16 шт.
Компрессор	не более 4 шт.
Принтер (при необходимости)	1 шт.
Лампа бактерицидная Philips TUV 8W G5	не более 4 шт.
Паспорт	1 шт.
Принадлежности	
Бумага для принтера	1 рулон


Примечание



В случае возврата шкафа ООО «КЛИНИПАК» не несет ответственности за повреждения шкафа, причиненные при транспортировке в результате неправильной упаковки.

5. ОБЩИЙ ВИД, ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ШКАФА

Общий вид шкафа

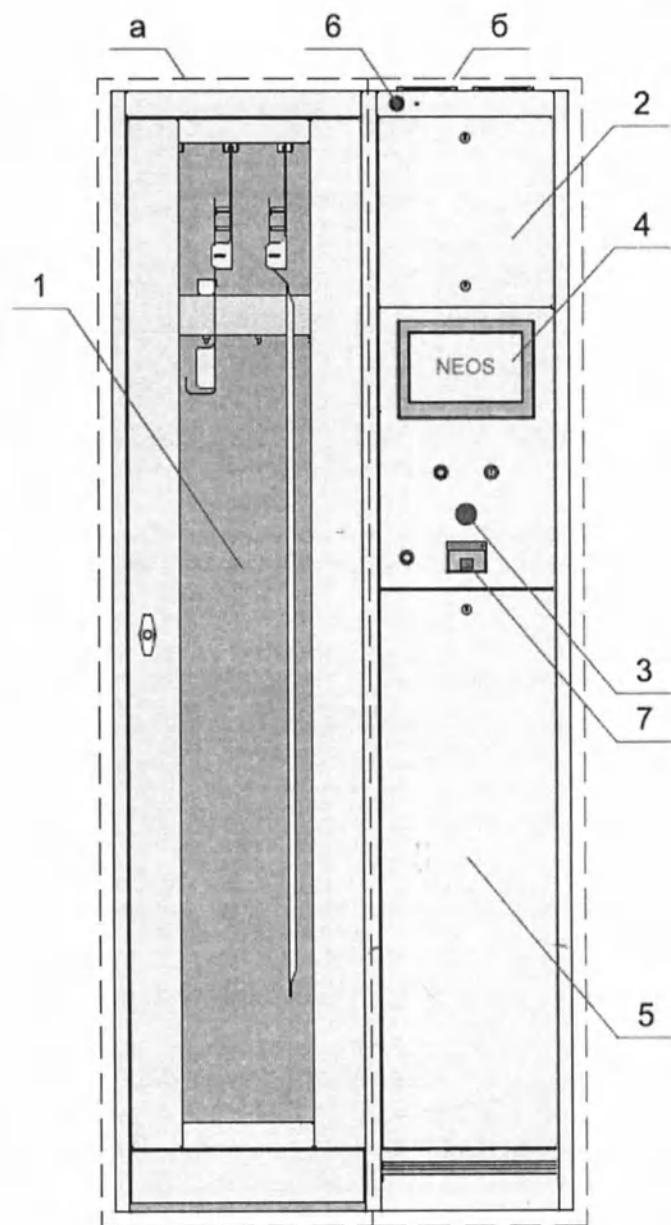

а - отсек сушки и хранения эндоскопов

б - отсек управления шкафом

1. Основная камера: Камера сушки и хранения эндоскопов

2. Блок расположения клапанов: Расположение клапанов и компонентов пневматической системы

3. Аварийная остановка: Выключатель аварийной остановки


4. Блок управления: Сенсорный экран с дисплеем и панелью управления

5. Компрессорный блок: Расположение компрессоров и ламп бактерицидных Philips TUV 8W G5

6. Лампа сигнализации открытия двери основной камеры: информирует о продолжительном открытии двери в камеру хранения и сушки эндоскопов

7. Принтер

рис. 1. Общий вид шкафа (на примере модели 4L-C).

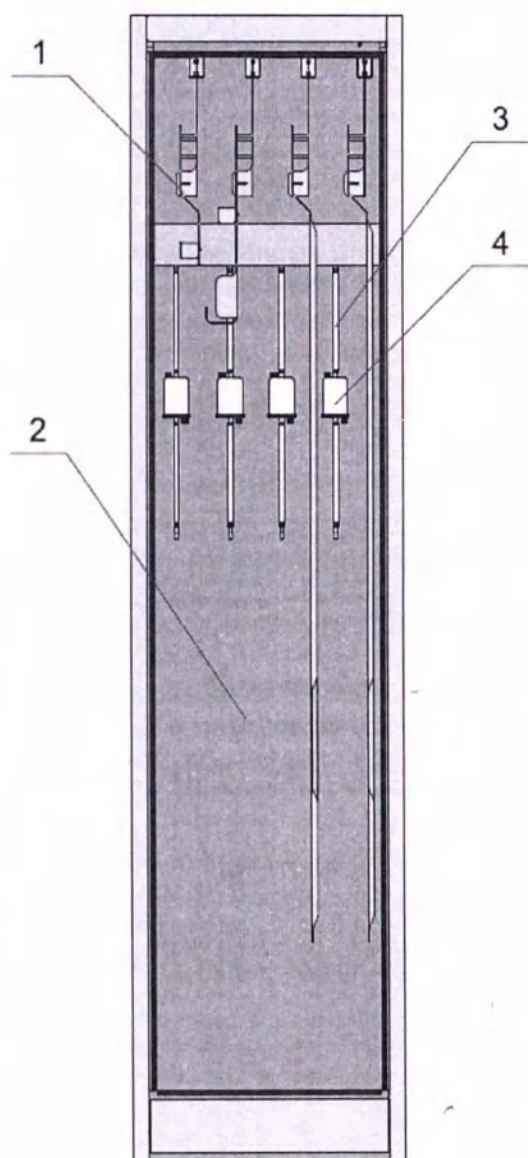

- 1. **Держатель:** Держатель эндоскопов
- 2. **Основная камера:** Камера сушки и хранения эндоскопов
- 3. **Трубки:** Соединительные трубки
- 4. **Фильтр:** Фильтр соединительных трубок

рис. 2. Отсек сушки и хранения эндоскопов (на примере модели 4L-C).

Маркировка (фирменная табличка)

На фирменной табличке (рис. 3) указаны модель устройства, изготовитель и технические данные. Она находится на передней стороне устройства.

		ООО «КЛИНИПАК» 125212, Россия, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, пом. XVI, комн. 31 Телефон: +7 (495) 510-29-82, E-mail: info@klinipak.ru	
Шкаф для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» с принадлежностями			
Технические условия ТУ 32.50.50-008-69745848-2019			
Модель	_____	Проверено:	_____
Макс. потребление, кВт	_____		Сделано в России
Электропитание, В/Гц/А	_____		
Серийный номер	_____		
Год изготовления	_____		
Масса, не более, кг	_____		
Техническая поддержка	+7(495)933-31-63		
Регистрационное удостоверение _____			

рис. 3. Фирменная табличка (пример).

Загрузка **NEOS** проводится в асептических условиях. Допускается хранить эндоскопы в шкафах не более 30 суток (720 часов). По истечению 30 суток эксплуатации шкаф должен быть подвергнут обработке, а оставшиеся внутри эндоскопы должны быть вновь обработаны одним из разрешенных для этого методом.

Дезинфекция шкафа производится в соответствии с «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения, утв. 30.12.98 г. (№ МУ-287-113)».

Перед подключением предварительно проводят дезинфекцию наружных поверхностей шкафа. Наружные поверхности шкафа обрабатывают дезинфицирующим средством на основе четвертичных аммонийных соединений, третичных аминов, гуанидинов разрешенным для обеззараживания поверхностей приборов (например, АВАНСЕПТ АКТИВ, МИСТРАЛЬ, МИСТРАЛЬ ПЛЮС, ТОТУС и др.) в соответствии с инструкцией по применению конкретного средства по режиму, эффективному в отношении бактерий.

Внутренние поверхности основной камеры, держатели, воздуховоды тщательно промывают с помощью средств, разрешенных для проведения предстерилизационной очистки медицинских изделий на основе четвертичных аммонийных соединений, третичных аминов, гуанидинов разрешенным для обеззараживания поверхностей приборов (например, АВАНСЕПТ АКТИВ, МИСТРАЛЬ, МИСТРАЛЬ ПЛЮС, ТОТУС и др.).

Остатки моющих средств смывают кипяченой питьевой водой, после чего внутренние поверхности, держатели, воздуховоды двукратно (с выдержкой в течение одного часа после каждой обработки) протирают ветошью, смоченной раствором дезинфицирующего средства по режиму, эффективному в отношении бактерий.

Во время процесса обеззараживания шкаф должен быть обязательно отключен от сети питания.

Электрическое соединение

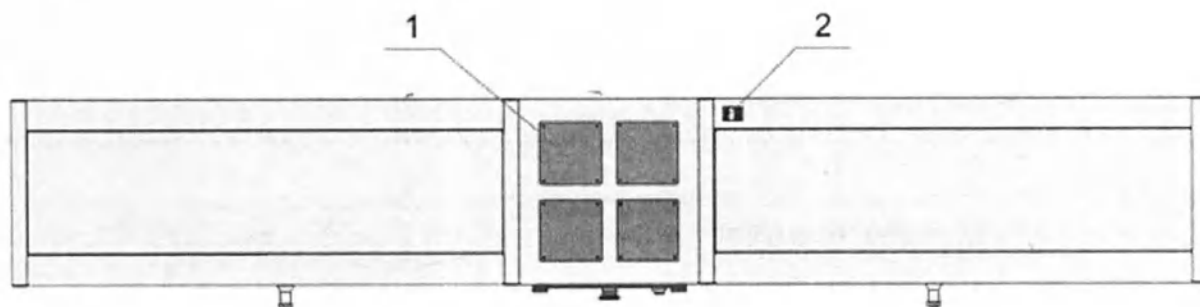


рис. 4. Верхняя часть шкафа с вентиляцией и разъемом питания (внешний вид может незначительно отличаться в зависимости от модели).

- 1. Вентиляция:** Вентиляционные отверстия с фильтром вентилятора. При эксплуатации запрещается накрывать вентиляционные отверстия с фильтрами во избежание перегрева шкафа.
- 2. Подключение к сети:** Разъем подключения сетевого кабеля (~220 В).

NEOS подключается к источнику электропитания через входящий в состав электрический сетевой кабель.



Внимание

Проверьте наклейку (около разъема питания), убедитесь, что напряжение в сети подходит для **NEOS**. Если в сети другое напряжение, **NEOS** может работать некорректно или будет поврежден.



Опасно!

NEOS должен включаться в сеть через розетку имеющую контакт заземления («евро-розетка»).

6. УПРАВЛЕНИЕ NEOS

Комплектация S (Simplex)

1. Включение питания шкафа

- Убедитесь, что сетевой кабель правильно подключен.
- Включите шкаф при помощи сетевого выключателя на верхней крышке шкафа (рис. 5).
- Поверните ключ питания шкафа на панели управления (рис. 6).




рис. 5. Разъем питания с сетевым выключателем.

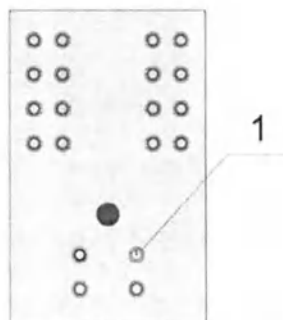


рис. 6. Панель управления на верхней крышке шкафа (на примере модели 16C-S UV).

2. Порядок работы

Загрузку шкафа проводят в асептических условиях. Предварительно обработанный шкаф должен быть включен не менее чем на 10 мин перед загрузкой медицинских изделий.

При загрузке шкафа следует соблюдать общепринятые меры предосторожности. Персонал, проводящий загрузку, должен использовать при этом стерильную спецодежду, маски или щитки для лица и резиновые перчатки. Перед надеванием перчаток проводят гигиеническую обработку рук с использованием спиртосодержащего или водного кожного антисептика, разрешенного к применению в установленном порядке.

- Откройте основную камеру и выдвиньте на себя держатель эндоскопов (рис. 7, 8).

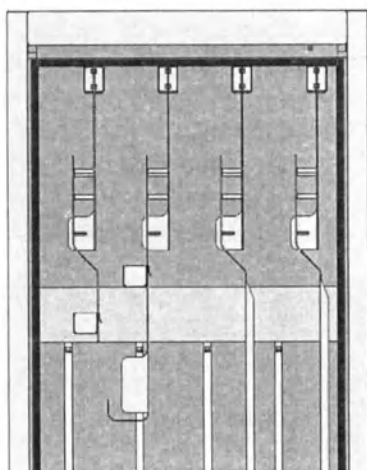


рис. 7. Держатели эндоскопов.

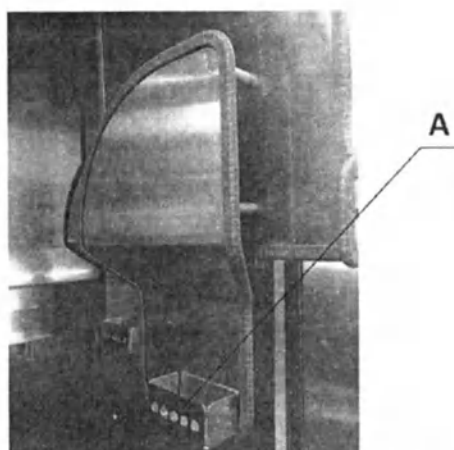


рис. 8. Держатель эндоскопов. А - отсек для съемных деталей

- Извлеките эндоскоп из транспортировочного контейнера.
- Повесьте эндоскоп на соответствующий выдвижной держатель эндоскопа внутри NEOS (рис. 9).

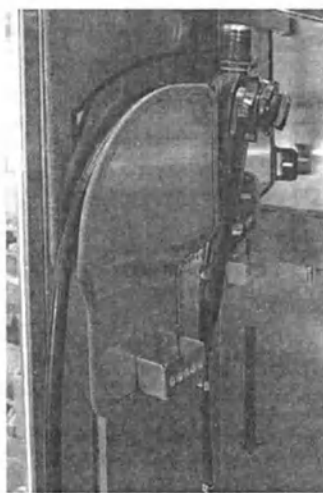


рис. 9. Последовательность крепления эндоскопа на держатель.

- Съемные детали (клапаны и другие отдельные детали) выложите в соответствующий отсек для съемных деталей держателя эндоскопа (рис. 8).
- Присоедините конец трубки соединительной к одному из каналов сушики (рис. 10).



рис. 10. Соединительная трубка с фильтром соединительных трубок.

- Соедините концы четырех трубок соединительных с соответствующими каналами на эндоскопе (рис. 11).
- Прочитайте инструкцию к эндоскопу. Обратите внимание на цветовую кодировку:

Синий: Воздушный/водный канал
Красный: Вытяжной канал
Зеленый: Биопсийный канал
Белый: Струйный канал

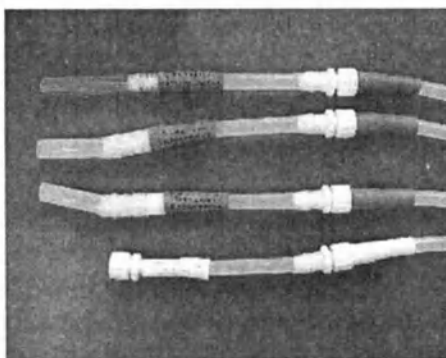


рис. 11. Маркировка соединительных трубок.

- Все неподсоединенные соединительные трубки должны быть закрыты соответствующими колпачками.

- Задвиньте держатель эндоскопа вместе с эндоскопом, к которому теперь присоединены соединительные трубки, обратно внутрь основной камеры.
- Убедитесь в том, что соединительные трубки висят свободно и без перегибов, а соседние эндоскопы не касаются друг друга или дна шкафа.

Время загрузки шкафа не должно превышать 10 минут. Если дверь была открыта более 10 минут, все хранящиеся эндоскопы и изделия к ним вновь подлежат стерилизации или дезинфекции высокого уровня, а шкаф повторной обработке.

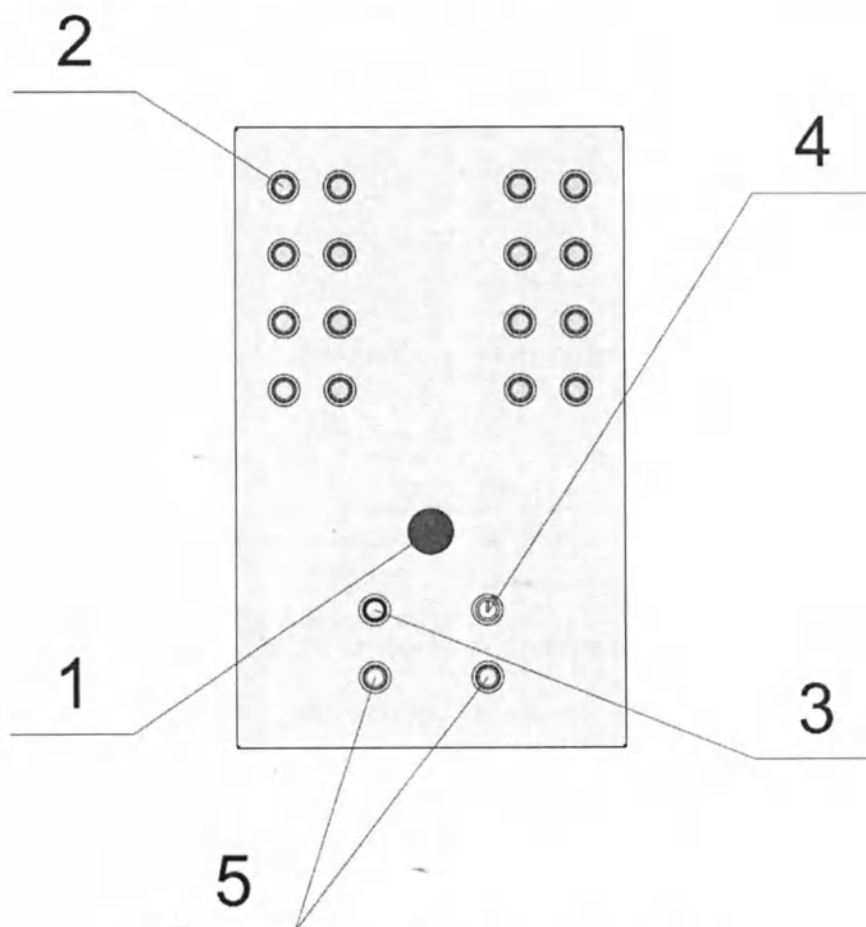


рис. 12. Панель управления (на 16 эндоскопов)

1. **Аварийная остановка:** Выключатель аварийной остановки (аварийная кнопка)
2. **Кнопки управления:** Кнопки Вкл/Выкл отдельных каналов
3. **Кнопка подсветки:** Кнопка включения подсветки отсека сушки и хранения эндоскопов
4. **Ключ:** Ключ включения/выключения шкафа
5. **Кнопки ламп бактерицидных:** Кнопки Вкл/Выкл ламп бактерицидных

NEOS может использоваться сразу после установки (если установка проведена правильно).

Работа с панелью управления (рис. 13):



- Нажмите кнопку для запуска соответствующего канала.
- Очищенный воздух будет пропускаться через каналы эндоскопа для сушки, пока повторно не будет нажата соответствующая кнопка.
- Вы можете определить, какой из каналов сушки включен по включенной подсветке на кнопке.

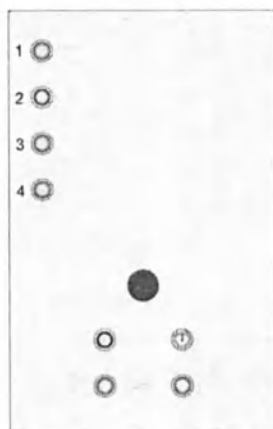


рис. 13. Панель управления (на примере модели 4L-S UV).

Номер кнопки включения соответствует номеру канала сушки, к которому подключен эндоскоп (рис. 14).

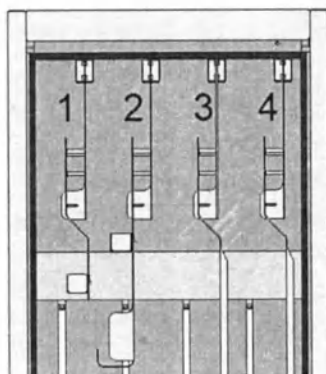


рис. 14. Маркировка каналов.

- После завершения процесса сушки откройте дверцу шкафа и извлеките (при необходимости) эндоскоп, не отключая шкаф.

Комплектация С (Complex)

1. Включение питания шкафа

- Убедитесь, что сетевой кабель правильно включен.
- Включите шкаф при помощи сетевого выключателя. (рис. 15).
- Поверните ключ питания шкафа на панели управления (рис. 16).




рис. 15. Разъем питания с сетевым выключателем.



рис. 16. Панель управления на верхней крышке шкафа (на примере модели 4L-C).

NEOS, находясь в режиме ожидания, выводит на сенсорный экран "Главное меню 1" (рис. 17).



рис. 17. Главное меню, комплектация С (Complex).

2. Порядок работы

Загрузку шкафа проводят в асептических условиях. Предварительно обработанный шкаф должен быть включен не менее чем на 10 мин перед загрузкой медицинских изделий.

При загрузке шкафа следует соблюдать общепринятые меры предосторожности. Персонал, проводящий загрузку, должен использовать при этом стерильную спецодежду, маски или щитки для лица и резиновые перчатки. Перед надеванием перчаток проводят гигиеническую обработку рук с использованием спиртосодержащего или водного кожного антисептика, разрешенного к применению в установленном порядке.

- Откройте основную камеру и выдвиньте на себя держатель эндоскопов (рис. 18, 19).

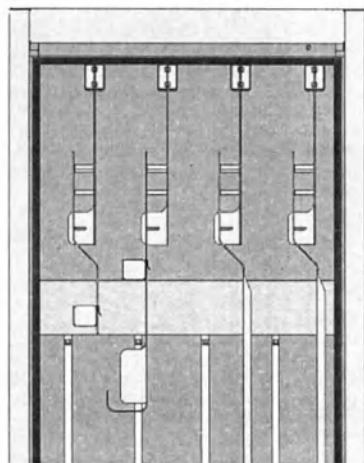


Рис. 18. Держатели эндоскопов.

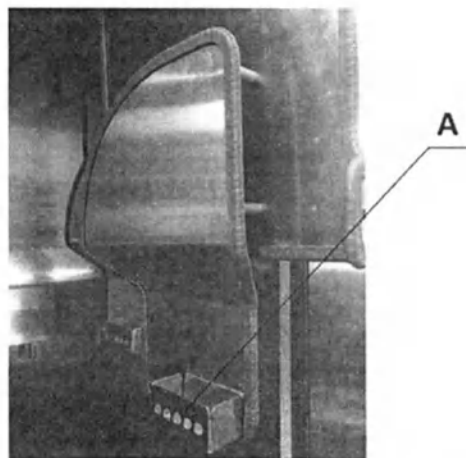


Рис. 19. Держатель эндоскопов. А - отсек для съемных деталей.

- Извлеките эндоскоп из транспортировочного контейнера.
- Повесьте эндоскоп на соответствующий выдвижной держатель внутри NEOS (рис. 20).

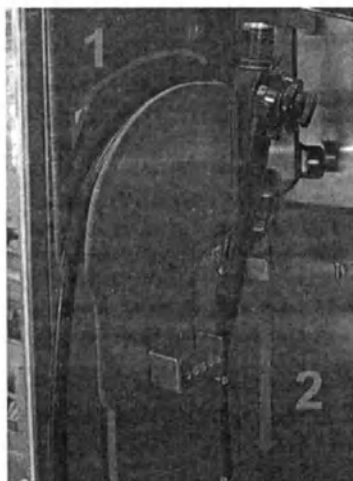


рис. 20. Последовательность крепления эндоскопа на держатель.

- Съемные детали (клапаны и другие отдельные детали) выложите в соответствующий отсек для съемных деталей держателя эндоскопа (рис. 19).
- Присоедините конец соединительной трубки к одному из каналов сушки (рис. 21).

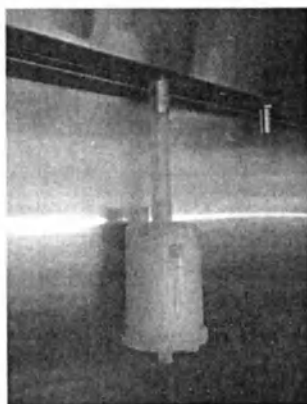


рис. 21. Соединительная трубка с фильтром соединительных трубок.

- Соедините концы четырех соединительных трубок с соответствующими каналами на эндоскопе (рис. 22).
- Прочитайте инструкцию к эндоскопу. Обратите внимание на цветовую кодировку:

Синий: Воздушный/водный канал
Красный: Вытяжной канал
Зеленый: Биопсийный канал
Белый: Струйный канал

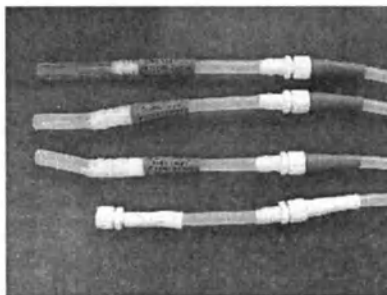


рис. 22. Маркировка соединительных трубок.

- Все не подсоединенные соединительные трубки должны быть закрыты соответствующими колпачками.
- Задвиньте держатель эндоскопа вместе с эндоскопом, к которому теперь присоединены соединительные трубки, обратно внутрь основной камеры.
- Убедитесь в том, что соединительные трубки висят свободно и без перегибов, а соседние эндоскопы не касаются друг друга или дна шкафа.

Время загрузки шкафа не должно превышать 10 минут. Если дверь была открыта более 10 минут, все хранящиеся эндоскопы и изделия к ним вновь подлежат стерилизации или дезинфекции высокого уровня, а шкаф повторной обработке.

- Включите канал сушки, к которому Вы подключили эндоскоп (рис. 23).

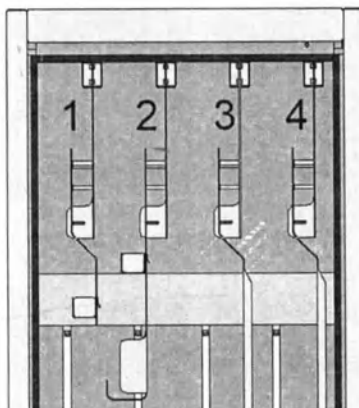


рис. 23. Маркировка каналов.

Работа с Главным меню в комплектации С (Complex):

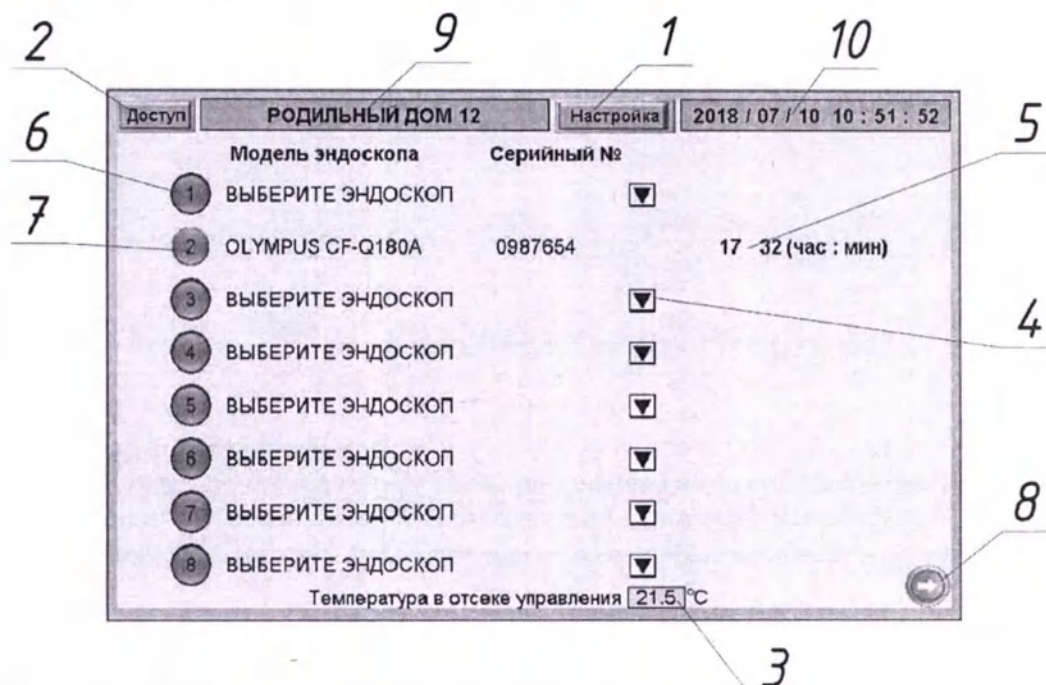


рис. 24. Главное меню 1 страница (на примере модели 16С-С).

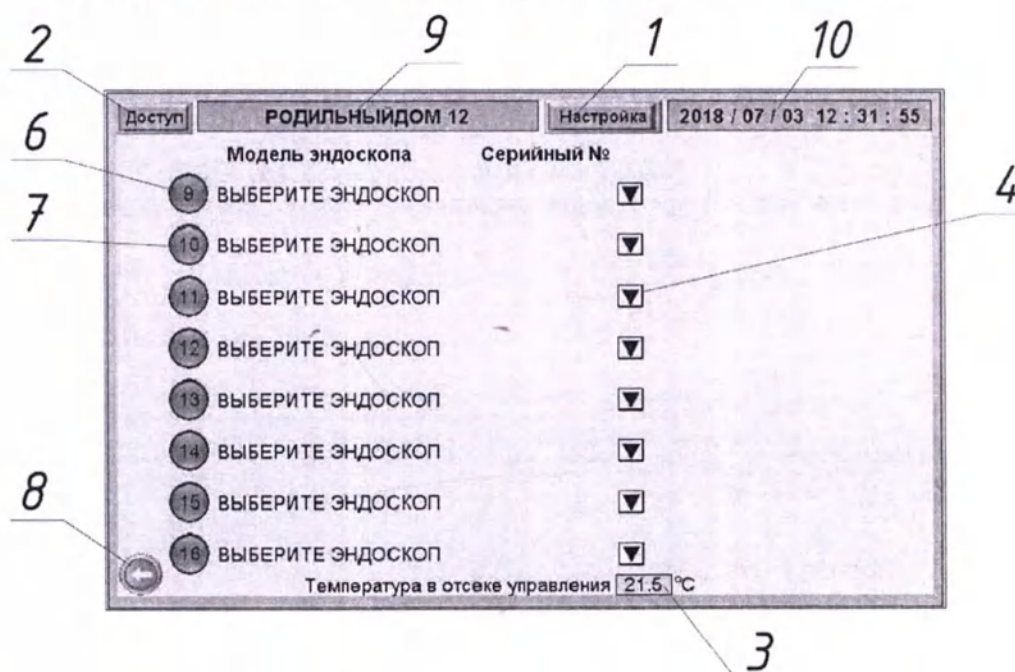


рис. 25. Главное меню 2 страница (на примере модели 16С-С).

1. Кнопка задания параметров: Нажатие на значок «настройка» позволяет войти в меню параметров
2. Кнопка доступа: кнопка получения доступа прав к управлению шкафом
3. Температура воздуха в отсеке управления шкафом
4. Кнопка выбора эндоскопа: меню выбора эндоскопа
5. Таймер сушки: оставшееся время сушки в часах и минутах
6. Кнопка включения/выключения: Кнопка включения/выключения
7. Номер канала: Номер соответствующего канала сушки
8. Кнопка-переключатель: Доступ к каналам 1-8 / 9-16
9. Название организации: название организации, где установлен шкаф
10. Текущие дата и время

Доступ: РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 12 Настройка: 2018 / 07 / 10 10 : 51 : 52

Модель эндоскопа	Серийный №
1 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
2 OLYMPUS CF-Q180A	0987654 17 32 (час : мин)
3 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
4 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
5 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
6 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
7 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
8 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼

Температура в отсеке управления 21.5 °C

Доступ: РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 12 Настройка: 2018 / 07 / 03 12 : 31 : 55

Модель эндоскопа	Серийный №
9 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
10 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
11 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
12 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
13 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
14 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
15 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼
16 ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼

Температура в отсеке управления 21.5 °C

- Нажмите кнопку запуска  соответствующего канала в Главном меню «1» либо в Главном меню «2».

- Запуск в автоматическом режиме:

Очищенный воздух будет пропускаться через эндоскоп для сушки до истечения установленного времени. Оставшееся время отображается справа от названия эндоскопа.

- Можно переключаться между Главными меню «1» и «2», используя кнопки-переключатели



которые обеспечивают доступ к каналам 9 – 16 и 1 – 8 соответственно.

Для принудительной остановки сушки необходимо нажать кнопку остановки соответствующего канала 



Примечание

Чтобы задать время сушки См. Главу 5 «Программирование».

- Перед началом сушки надо выбрать название эндоскопа для документирования нажав кнопку



В появившемся окне выбора эндоскопа

№ эндоскопа	Название эндоскопа	Серийный № эндоскопа
1	OLYMPUS BF-160	12345
2	OLYMPUS GIF-Q180	567890
3	OLYMPUS CF-Q180A	0987654
4	PENTAX EG27-I10	1234567890
5	PENTAX EG-2990K	098765TYU
6	PENTAX FB-10V	A123DF
7	FUJIFILM EB-530XT	D1234F
8	FUJIFILM EC-590WM4	Q1W2E3R4
9	FUJIFILM EG-600WR	654RTY
10	KARL STORZ 13823 PKS	123EWQ
11	KARL STORZ 13925PKSK	65345
12	PENTAX EC-3890TFK	WQERT
13	PENTAX EC38-I10F	R4326YT
14		
15		
16		

Выберите номер эндоскопа

1

Название эндоскопа

Серийный номер эндоскопа

Ок

- Введите номер соответствующего эндоскопа из списка при помощи цифровой клавиатуры:



подтвердив выбор кнопкой ENT.

№ эндоскопа	Название эндоскопа	Серийный № эндоскопа
1	OLYMPUS BF-160	12345
2	OLYMPUS GIF-Q180	567890
3	OLYMPUS CF-Q180A	0987654
4	PENTAX EG27-I10	1234567890
5	PENTAX EG-2990K	098765TYU
6	PENTAX FB-10V	A123DF
7	FUJIFILM EB-530XT	D1234F
8	FUJIFILM EC-590WM4	Q1W2E3R4
9	FUJIFILM EG-600WR	654RTY
10	KARL STORZ 13823 PKS	123EWQ
11	KARL STORZ 13925PKSK	65345
12	PENTAX EC-3890TFK	WQERT
13	PENTAX EC38-I10F	R4326YT
14		
15		
16		

Выберите номер эндоскопа

3

Название эндоскопа

OLYMPUS CF-Q180A

Серийный номер эндоскопа

0987654

Ок

- Проверьте, что название и серийный номер эндоскопа совпадают с выбранным и нажмите кнопку **Ок**.
- Если вы ошиблись в выборе, то повторите выбор.

Доступ	РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 12		Настройка	2018 / 07 / 10 10 : 25 : 19
Модель эндоскопа		Серийный №		
1	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
2	OLYMPUS CF-Q180A	0987654	▼	
3	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
4	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
5	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
6	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
7	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
8	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
Температура в отсеке управления				21.5 °C

- Нажмите кнопку **2** для запуска сушки выбранного эндоскопа.

Доступ	РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 12		Настройка	2018 / 07 / 10 10 : 51 : 52
Модель эндоскопа		Серийный №		
1	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
2	OLYMPUS CF-Q180A	0987654	17 32 (час : мин)	
3	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
4	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
5	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
6	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
7	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
8	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП		▼	
Температура в отсеке управления				21.5 °C

- Очищенный сжатый воздух будет пропускаться через эндоскоп для сушки, пока не будет

нажата кнопка **2** или пока не пройдет заданное время.

- Вы можете определить, какой из каналов сушки включен по тому, какая кнопка имеет синий

цвет **2** таймер будет работать, а номер канала отображается на кнопке.

- В любой момент можно прервать процесс сушки эндоскопа нажатием соответствующей

кнопки

По окончании сушки будет выведено окно

Доступ	РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 12	Настройка	2018 / 07 / 10 12 : 26 : 33
Сушка эндоскопа №2 завершена			
Эндоскоп	OLYMPUS CF-Q180A	Выбор	▼
Серийный №	0987654	54	▼
Начало сушки	10 -07 -2018 10 :26 :00		▼
Окончание сушки	10 -07 -2018 12 :26 :00		▼
Время сушки	2ч00м		▼
Печать		Выйти	
6 ВЫБЕРИТЕ ЭНДосКОП		▼	
7 ВЫБЕРИТЕ ЭНДосКОП		▼	
8 ВЫБЕРИТЕ ЭНДосКОП		▼	
Температура в отсеке управления			21.5 °C

В окне отображается информация о том, в каком канале закончилась сушка, модель и серийный номер подключенного эндоскопа, дата и время начала сушки, дата и время окончания сушки, общее время сушки.

Нажав кнопку «Печать» можно распечатать эту информацию на принтере.

Нажав кнопку «выйти» вы закроете это окно.

- После завершения процесса сушки откройте дверцу шкафа и извлеките (при необходимости) эндоскоп, не отключая шкаф.

7. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИ NEOS в комплектации С (Complex)

- Убедитесь, что сетевой кабель правильно включен.
- Включите шкаф при помощи сетевого выключателя.
- Когда шкаф находится в режиме ожидания, на панели управления NEOS отображается «Главное меню 1».
- Нажмите кнопку «Доступ» для получения прав на редактирование параметров.



Примечание

- Существует 3 уровня доступа:

Уровень 1 – простой пользователь. Пароль не требуется. Позволяет выбирать эндоскопы, включать/выключать каналы сушки.

Уровень 2 – продвинутый пользователь. Требуется ввод пароля. Позволяет редактировать список эндоскопов, устанавливать время сушки, корректировать дату-время, редактировать название организации. Так же имеет права простого пользователя.

Уровень 3 – техник. Требуется ввод пароля. Может проводить техническое обслуживание. Так же имеет права продвинутого пользователя.



- Если вы случайно нажали на кнопку «Доступ», то нажмите кнопку «Отклонить». В этом случае вы вернетесь на Главное меню 1 и процесс сушки эндоскопов будет продолжен.
- Если вы действительно хотите изменить права доступа, то нажмите кнопку «Подтвердить». В этом случае сушка во всех каналах будет прекращена.
- В меню Авторизации нажмите кнопку «Открыть доступ».



- На появившейся цифровой клавиатуре:



введите пароль и нажмите кнопку «ENT».

Если пароль введён верно, то вы увидите сообщение, что доступ открыт.



Подтвердите последовательным нажатием на кнопки «ОК» и «Выход».

Если введён не корректный пароль, то вы увидите сообщение, что пароль неверный.



Нажмите кнопку «ОК» и попробуйте повторить ввод пароля или нажмите кнопку «Выход».

После нажатия кнопки «Выход» вы вернётесь в «Главное меню».

Доступ	РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 12	Настройка	2018 / 07 / 10 10 : 25 : 19
Модель эндоскопа		Серийный №	
1	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼	
2	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼	
3	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼	
4	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼	
5	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼	
6	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼	
7	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼	
8	ВЫБЕРИТЕ ЭНДОСКОП	▼	
Температура в отсеке управления		21.5 °C	

- Нажмите кнопку «Настройка» на открывшемся экране предупреждения.

Внимание!!!

При переходе на экран настроек
сушильного шкафа
процесс сушки всех эндоскопов
будет остановлен.

Подтвердить

Отклонить

нажмите кнопку «Подтвердить».

Название организации
 РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 12

Время сушки эндоскопов
 1 Дней 5 Часов 30 Минут **Ок**

ЗВУК
 ВКЛ

Дата проведения ТО
 2019-01-01 **Провести ТО**

Дата следующего ТО
 2020-01-01

Модель шкафа
 NEOS 16C-C

Серийный №
 18001

Выход

Редактирование списка эндоскопов

Настройка системного времени

Смена пароля

Меню настроек:

Название организации: данные об организации, в которой эксплуатируется шкаф (можно изменить).

Время сушки: время сушки эндоскопов. Вводится в формате Дни-Часы-Минуты. Ввод времени сушки обязательно подтвердить нажатием кнопки «ОК».

Кнопка «Звук»: включает/отключает звук нажатия на экран.

Кнопка «Редактирование списка эндоскопов»: открывает меню создания/редактирования списка эндоскопов.

Смена пароля: позволяет сменить пароль для пользователей (доступна только для техника).

Кнопка провести ТО: после проведения планового технического обслуживания позволяет технику установить «Дату проведенного ТО» и «Дату следующего ТО».

Кнопка «Настройка системного времени»: позволяет изменить текущие дату и время.

Модель шкафа: отображает модель шкафа (изменить нельзя).

Серийный №: отображает серийный номер шкафа (изменить нельзя).

Кнопка «Выход»: Закрывает меню настроек.

При нажатии на поле «Название организации» можно изменить название организации при помощи буквенно-цифровой клавиатуры.

Название организации
 РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 12

Вр
 1 Дн

ЗВУК
 ВКЛ

Модель
 NEOS 16C-C

Серийный №
 18001

Выход

Редактирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	.	<-
Й	Ц	У	К	Е	Н	Г	Ш	Щ	З	Х	Ъ
Ф	Ы	В	А	П	Р	О	Л	Д	Ж	Э	Ent
Я	Ч	С	М			И	Т	Ь	Б	Ю	

После ввода названия организации нажмите кнопку «Ent».

Название организации
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 12

Время сушки эндоскопов
1 Дней **5** Часов **30** Минут **Ок**

ЗВУК
 ВЫКЛ

Max: 30
 Min: 0

Модел
 N

Сери

7 8 9 +/-
 4 5 6 CLR
 1 2 3 ESC
 0 . ENT

Дата проведения ТО
 2019-01-01 **Провести ТО**

Дата следующего ТО
 2020-01-01

Выход

Редактирование списка эндоскопов

Настройка системного времени

Смена пароля

Время сушки вводится в формате день-час-минута.

В каждом поле вводится значение при помощи цифровой клавиатуры.

По окончании настройки необходимо нажать кнопку «Ок» для сохранения изменения времени сушки.



При помощи кнопок **ЗВУК** **ВЫКЛ** можно включить или выключить звук касания экрана.

Кнопка «Настройка системного времени» открывает меню настройки даты и времени.


Настройка часов

2018 / 7 / 6

10 : 7 : 10

Выход

Нажав на соответствующее поле можно скорректировать необходимое значение при помощи цифровой клавиатуры:

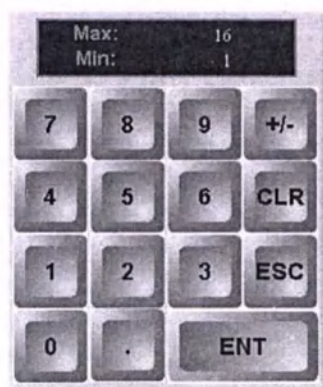

Кнопка **выход** закрывает меню настройки системного времени и открывает основной экран.

Кнопка **«Редактирования списка эндоскопов»** открывает меню создания / редактирования списка эндоскопов. При первом включении этот список пуст:

№ эндоскопа	Название эндоскопа	Серийный № эндоскопа
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

Выберите номер эндоскопа

0

Название эндоскопа

Серийный номер эндоскопа

Ок

Пользователю необходимо внести названия и серийные номера эндоскопов, которые планируется хранить в этом шкафу. Для этого необходимо выбрать № эндоскопа и ввести его название при помощи экранной клавиатуры:

№ эндоскопа	Название эндоскопа	Серийный № эндоскопа
1	OLYMPUS BF-160	12345
2	OLYMPUS GIF-Q180	567890
3	OLYMPUS CF-Q180A	0987654
4	PENTAX EG27 110	1234567890

Выберите номер эндоскопа

12

Название эндоскопа

PENTAX EC-3890TFK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	\$
Z	X	C	V	B	N	M	.	-	
ESC								<-	ENT

и серийный номер эндоскопа:

№ эндоскопа	Название эндоскопа	Серийный № эндоскопа
1	OLYMPUS BF-160	12345
2	OLYMPUS GIF-Q180	567890
3	OLYMPUS CF-Q180A	0987654
4	PENTAX EG27-I10	1234567890
5	PENTAX EG-2990K	098765TYU
6	PENTAX FB-10V	A123DF

Выберите номер эндоскопа

12

Название эндоскопа

PENTAX EC-3890TFK

Серийный номер эндоскопа

WQERT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	\$
Z	X	C	V	B	N	M	.	-	ENT
ESC								<-	

По окончании редактирования списка эндоскопов и возврата в основное меню нажмите кнопку «OK».

8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все работы со шкафом, включая обработку набора для подключения, фильтра соединительных трубок; замену фильтров компрессора и соединительных трубок; очистку и дезинфекцию шкафа; замену бумаги в принтере; замену и обработку ламп бактерицидных необходимо проводить в резиновых перчатках.

Дезинфекция шкафа

Дезинфекция шкафа производится в соответствии с «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения, утв. 30.12.98 г. (№ МУ-287-113)».

Обеззараживание шкафа проводят ручным способом методом протирания всех поверхностей внутри и снаружи ветошью, пропитанной дезинфицирующим средством по режиму, эффективному в отношении бактерий, с отметкой даты в журнале.

Внутренние поверхности отсека хранения, держатели, воздухопроводы тщательно промывают с помощью средств, разрешенных для проведения предстерилизационной очистки медицинских изделий на основе четвертичных аммонийных соединений, третичных аминов, гуанидинов разрешенным для обеззараживания поверхностей приборов (например, АВАНСЕПТ АКТИВ, МИСТРАЛЬ, МИСТРАЛЬ ПЛЮС, ТОТУС и др.). Остатки моющих средств смывают кипяченой питьевой водой, после чего внутренние поверхности, держатели, воздухопроводы двукратно (с выдержкой в течение одного часа после каждой обработки) протирают ветошью, смоченной раствором дезинфицирующего средства по режиму, эффективному в отношении бактерий.

Наружные поверхности шкафа обрабатывают дезинфицирующим средством на основе четвертичных аммонийных соединений, третичных аминов, гуанидинов (например, АВАНСЕПТ АКТИВ, МИСТРАЛЬ, МИСТРАЛЬ ПЛЮС, ТОТУС и др.), разрешенным для обеззараживания поверхностей приборов в соответствии с инструкцией по применению конкретного средства по бактерицидному режиму.

Во время процесса обеззараживания шкаф должен быть обязательно отключен от сети питания.

Обеззараживание отсека для съемных деталей держателя эндоскопов проводится ручным способом методом протирания – 1 раз в день.

Во время данных операций шкаф должен быть обязательно отключен от сети питания.



Внимание

Изучите прилагаемую к дезинфицирующему средству инструкцию по применению.

Замена фильтров

Используйте только оригинальные запасные части, предоставляемые ООО «КЛИНИПАК».

Фильтр компрессора

В процессе работы не подлежит обработке. Должен быть заменен 1 раз в год. Замена фильтра компрессора производится лицами, уполномоченными ООО «КЛИНИПАК»; в рамках проведения ТО.

Фильтр соединительных трубок

В процессе работы подлежит обработке. Срок эксплуатации фильтра – 30 суток.

Не реже 1 раза в 30 дней фильтр подлежит стерилизации. Максимально число циклов стерилизации 10, после проведения 10 циклов стерилизации фильтр должен быть заменен. Фильтр снабжен входным и выходным штуцерами, подключение и отключение фильтра к пневматической системе производится натягиванием или стягиванием эластичных трубок на штуцеры до упора; соответственно, на входной штуцер фильтра натягивается трубка, соединяющая фильтр с общим пневмоколлектором (см рис. 21), а на выходной штуцер - трубка соединительная для

подключения эндоскопа. Соединения являются настолько плотными, что не требуют дополнительного уплотнения стягивающими хомутами. Стрелка на корпусе фильтра, указывающая направление воздушного потока, должны быть обращена вниз.

Стерилизация фильтра соединительных трубок

Фильтр поставляется нестерильным!

Перед использованием необходимо простерилизовать фильтр паровым методом по режиму при температуре 121°C (0,11 МПа), 30 мин.

Перед стерилизацией фильтра не требуется проведение дезинфекции и предстерилизационной очистки.

По окончании процесса стерилизации следует извлечь фильтр из парового стерилизатора и охладить до комнатной температуры ($22 \pm 5^\circ\text{C}$).

Установить фильтр в систему, убедиться, что фильтр закреплен должным образом и изделие установлено в направлении фильтрации.

Максимальное число циклов стерилизации - 10 циклов.

После проведения 10 циклов стерилизации фильтр подлежит замене.

Обработка набора для подключения

В процессе работы набор для подключения подлежит обработке после каждого использования. Набор поставляется нестерильным!

Перед стерилизацией набор для подключения подвергают предстерилизационной очистке, совмещенной с дезинфекцией, в соответствии с Инструкцией по применению средств, разрешенных в установленном порядке для этих целей.

Предстерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией осуществляют:

- механизированным способом с помощью моюще-дезинфицирующих машин с режимом термодезинфекции и использованием щелочных моющих средств и кислотных ополаскивающих средств (например, средств АВАНСЕПТ 22/АВАНСЕПТ 26 и т.п.) или

- ручным способом с применением разрешенных для этих целей средств на основе ферментов, третичных аминов, четвертичных аммонийных соединений, гуанидинов (например, средства дезинфицирующие АВАНСЕПТ АКТИВ, МИСТРАЛЬ, ГЛАВЭНЗИМ, ТОТУС и др.) с использованием специальных приспособлений для беспрепятственного промывания внутренних полостей трубок потоком моюще-дезинфицирующего средства.

При ручном способе обработки набор для подключения подлежит замачиванию в моющем растворе при полном погружении изделий в раствор, мойке каждого изделия в растворе, ополаскиванию проточной питьевой водой, ополаскиванию дистиллированной водой с последующей сушкой.

Стерилизацию набора для подключения осуществляют паровым методом по режиму 121°C, 20 мин (паровые стерилизаторы с вакуумным способом удаления воздуха).

Трубки (соединительные, разделительные, удлинительные) из набора для подключения выдерживают 30 циклов стерилизации. После проведения 30 циклов стерилизации или при визуальном обнаружении дефектов (помутнение трубок, изменение цвета трубок, обнаружение трещин) набор необходимо заменить.

Замена бумаги в принтере

Если в принтере закончилась бумага, до тех пока не будет установлен новый рулон, будет мигать зеленая лампочка.

1. Как показано на Рис. 26 и 27: необходимо отвести ключ и открыть крышку.



Рис. 26. Отведение ключа.



Рис. 27. Открытая крышка принтера.

2. Установить бумагу и слегка подтолкнуть. Устанавливать бумагу следует в правильном направлении.

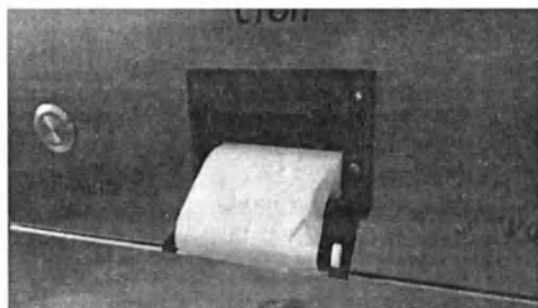


Рис. 28. Установка бумаги в принтер.

3. Закрыть крышку и вернуть ключ в прежнее положение.

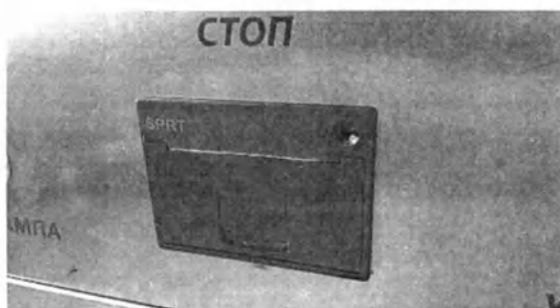


Рис. 29. Закрытый принтер.

4. Оторвать торчащий конец бумаги. Установка бумаги завершена.

Техническое обслуживание Лампа бактерицидная Philips TUV 8W G5

Проводится исключительно лицами, уполномоченными ООО «КЛИНИПАК» и использующими только оригинальные запасные части.

Замена лампы бактерицидной

Периодичность замены - через 8000 часов работы.

В корпусе совместно с лампой бактерицидной размещен электронный таймер, входная линия питания включается одновременно с включением всей электрической схемы, устройство выходной линии - светодиодная двухцветная лампа с держателем. Кнопка красного цвета - кнопка обнуления счетчика времени. Электронный таймер работает по следующей схеме: отсчет времени начинается с первого включения питания. Светодиод начинает мигать зеленым цветом. При выключении счетчик останавливается, запоминая суммарно набранное время работы. Последующее включение продолжает работу таймера. Цветовая индикация осуществляется по следующей схеме: 0-7500 часов - мигание зеленым цветом; 7500-8000 часов - попеременное мигание красным и зеленым цветом; более 8000 часов - непрерывное свечение красным цветом.

Непрерывное свечение красным цветом указывает на полную выработку ресурса работы лампы бактерицидной и необходимость ее замены. После замены лампы бактерицидной, для сброса отчета времени необходимо нажать кнопку обнуления счетчика.

Обработка лампы бактерицидной

- 1 раз в год – протирание поверхностей бактерицидной лампы 3% раствором перекиси водорода или 50% спиртовым раствором;
- 1 раз в год – проведение дезинфекции внутренней полости корпуса 3% раствором перекиси водорода с добавлением моющего раствора.

Плановое техническое обслуживание (ТО)

Плановое техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год.

Сообщение необходимости проведения ТО загорается в правом верхнем углу экрана.

Данное сообщение не является сообщением об ошибке и не блокирует работу шкафа. Сообщение об ошибке исчезнет с экрана только после проведения ТО авторизованным техническим персоналом.

Дату проведения последнего ТО и дату следующего ТО, можно посмотреть в меню «Настройка».

Ремонт

Ремонтные работы по починке неисправных шкафов могут проводиться исключительно лицами, уполномоченными ООО «КЛИНИПАК» и использующими только оригинальные запасные части.

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках общего характера:

- В ходе работы контролируется состояние дверей шкафа. Если одна из них открылась во время работы или персонал забыл закрыть одну из дверей, то через 2 минуты* прозвучит акустическое и визуальное предупреждение. После закрытия двери оповещение об аварии отключится автоматически.

* - время до срабатывания системы оповещения настраивается техником.

Сообщение о программной ошибке:

- В случае ошибки в программировании или при обнаружении сбоя в работе (технической неисправности) шкаф прерывает свою работу и отключается.



Примечание

Сообщение на экране о необходимости проведения ежегодного технического обслуживания не является ошибкой!!!

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выпускаются модели: «2L-S», «2R-S», «3L-S», «3R-S», «4L-S», «4R-S», «5L-S», «5R-S», «6L-S», «6C-S», «6R-S», «7L-S», «7C-S», «7R-S», «8L-S», «8C-S», «8R-S», «9L-S», «9C-S», «9R-S», «10L-S», «10C-S», «10R-S», «12L-S», «12R-S», «14L-S», «14R-S», «15L-S», «15R-S», «16C-S», «2L-C», «2R-C», «3L-C», «3R-C», «4L-C», «4R-C», «5L-C», «5R-C», «6L-C», «6C-C», «6R-C», «7L-C», «7C-C», «7R-C», «8L-C», «8C-C», «8R-C», «9L-C», «9C-C», «9R-C», «10L-C», «10C-C», «10R-C», «12L-C», «12R-C», «14L-C», «14R-C», «15L-C», «15R-C», «16C-C».

Цифра в названии модели обозначает максимальное количество эндоскопов одновременно размещаемых в шкафу.

Буквы «L», «R», «C» после цифры в названии модели обозначают расположение отсека сушки и хранения эндоскопов («левое» (L)/«правое» (R)/ «центральное» (C)) относительно отсека управления шкафа.

Буквы «C», «S» после тире в названии модели обозначают комплектации Complex (C) и Simplex (S). Комплектация Simplex- управление шкафом осуществляется с помощью кнопок на панели управления; комплектация Complex - шкаф оснащен сенсорным экраном, управление шкафом осуществляется с помощью программного обеспечения, при необходимости комплектуется принтером.

№	Наименование параметра	Значение
1	1	2
2	Тип размещения	напольное
3	Количество секций	1 или 2
4	Вид открывания дверей	распашные
5	Исполнение в зависимости от модели: «2L-S», «2R-S», «2L-C», «2R-C», «3L-S», «3R-S», «3L-C», «3R-C», «4L-S», «4R-S», «4L-C», «4R-C», «5L-S», «5R-S», «5L-C», «5R-C», «12L-S», «12R-S», «12L-C», «12R-C», «14L-S», «14R-S», «14L-C», «14R-C», «15L-S», «15R-S», «15L-C», «15R-C», «6L-S», «6C-S», «6R-S», «7L-S», «7C-S», «7R-S», «8L-S», «8C-S», «8R-S», «9L-S», «9C-S», «9R-S», «10L-S», «10C-S», «10R-S», «6L-C», «6C-C», «6R-C», «7L-C», «7C-C», «7R-C», «8L-C», «8C-C», «8R-C», «9L-C», «9C-C», «9R-C», «10L-C», «10C-C», «10R-C», «16C-S», «16C-C».	левое / правое левое / центральное / правое центральное
6	Количество размещаемых эндоскопов: - «2L-S», «2R-S», «2L-C», «2R-C»; - «3L-S», «3R-S», «3L-C», «3R-C»; - «4L-S», «4R-S», «4L-C», «4R-C»; - «5L-S», «5R-S», «5L-C», «5R-C»; - «6L-S», «6C-S», «6R-S», «6L-C», «6C-C», «6R-C»; - «7L-S», «7C-S», «7R-S»; «7L-C», «7C-C», «7R-C» - «8L-S», «8C-S», «8R-S»; «8L-C», «8C-C», «8R-C» - «9L-S», «9C-S», «9R-S»; «9L-C», «9C-C», «9R-C» - «10L-S», «10C-S», «10R-S»; «10L-C», «10C-C», «10R-C» - «12L-S», «12R-S», «12L-C», «12R-C»; - «14L-S», «14R-S», «14L-C», «14R-C»; - «15L-S», «15R-S», «15L-C», «15R-C»; - «16C-S», «16C-C».	2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16
7	Программное обеспечения Версия ПО только для комплектации Complex (C)	1N.0-X, где X – количество размещаемых эндоскопов

8	Положение размещения эндоскопов	вертикальное
9	Габаритные размеры (ширина, глубина, высота)*, мм - «2L-S», «2R-S», «2L-C», «2R-C», «3L-S», «3R-S», «3L-C», «3R-C», «4L-S», «4R-S», «4L-C», «4R-C»; - «5L-S», «5R-S», «5L-C», «5R-C»; - «6L-S», «6L-C», («6C-S», «6C-C»), «6R-S», «6R-C», «7L-S», «7L-C», («7C-S», «7C-C»), «7R-S», «7R-C», «8L-S», «8L-C», («8C-S», «8C-C»), «8R-S», «8R-C»; - «9L-S», «9L-C», («9C-S», «9C-C»), «9R-S», «9R-C», «10L-S», «10L-C», («10C-S», «10C-C»), «10R-S», «10R-C»; - «12L-S», «12R-S», «12L-C», «12R-C»; - «14L-S», «14R-S», «14L-C», «14R-C»; - «15L-S», «15R-S», «15L-C», «15R-C»; - «16C-S», «16C-C».	910x360x2200 1020x360x2200 1410(1380)x360x2200 1600(1630)x360x2200 1880x360x2200 2100x360x2200 2210x360x2200 2350x360x2200
10	Масса конструктивная, кг, не более: - «2L-S», «2R-S», «2L-C», «2R-C»; - «3L-S», «3R-S», «3L-C», «3R-C»; - «4L-S», «4R-S», «4L-C», «4R-C»; - «5L-S», «5R-S», «5L-C», «5R-C»; - «6L-S», «6C-S», «6R-S», «6L-C», «6C-C», «6R-C»; - «7L-S», «7C-S», «7R-S»; «7L-C», «7C-C», «7R-C» - «8L-S», «8C-S», «8R-S»; «8L-C», «8C-C», «8R-C» - «9L-S», «9C-S», «9R-S»; «9L-C», «9C-C», «9R-C» - «10L-S», «10C-S», «10R-S»; «10L-C», «10C-C», «10R-C» - «12L-S», «12R-S», «12L-C», «12R-C»; - «14L-S», «14R-S», «14L-C», «14R-C»; - «15L-S», «15R-S», «15L-C», «15R-C»; - «16C-S», «16C-C».	250 420
11	Время выхода на рабочий режим после включения, мин., не более	10
12	Количество режимов работы	1
13	Расход подаваемого воздуха, м ³ /ч	0,9 - 3,6
14	Время цикла сушки эндоскопов, ч, не более	720
15	Время непрерывной работы, ч, не менее	720
16	Рабочее давление воздуха, кгс/см ²	0,06 - 0,4
17	Класс чистоты подаваемого воздуха, не ниже	3 по ГОСТ 17433
18	Класс загрязнённости сжатого воздуха микроорганизмами	стерильный согласно ГОСТ Р ИСО 8573-1
19	Номинальное напряжение питающей сети, В	220 (однофазная)
20	Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
21	Потребляемая мощность, кВт, не более - «2L-S», «2R-S», «2L-C», «2R-C», «3L-S», «3R-S», «3L-C», «3R-C», «4L-S», «4R-S», «4L-C», «4R-C», «5L-S», «5R-S», «5L-C», «5R-C», «6L-S», «6C-S», «6R-S», «7L-S», «7C-S», «7R-S», «8L-S», «8C-S», «8R-S»; - «9L-S», «9C-S», «9R-S», «10L-S», «10C-S», «10R-S», «6L-C», «6C-C», «6R-C», «7L-C», «7C-C», «7R-C», «8L-C», «8C-C», «8R-C», «9L-C», «9C-C», «9R-C», «10L-C», «10C-C», «10R-C», «12L-S», «12R-S», «12L-C», «12R-C», «14L-S», «14R-S», «14L-C», «14R-C», «15L-S», «15R-S», «15L-C», «15R-C», «16C-S», «16C-C».	0,5 1,0
22	Номинальный потребляемый ток, А, не более	10
23	Группа используемых фильтров	для очистки газовых сред от частиц размером от 0,2 мкм и выше
24	Минимальное усилие для движения держателя эндоскопа, Н, не более	1000

25	Размеры держателя эндоскопа*, ВхШхГ, мм - пластина (кронштейн) держателя эндоскопа - держатель эндоскопа	260x245x45 265x175x40 или 385x160x65 или 1570x190x55
26	Высота крепления держателя эндоскопа от основания шкафа, мм, ± 5%	2080
27	Максимальная длина эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	2050
28	Максимальный диаметр рабочей части эндоскопа, который можно закрепить на держателе, мм	30
29	Предельная нагрузка на держатель эндоскопа, кг, не более	7
30	Принтер Модель Построчная термопечать Буфер памяти печати составляет Бумага для печати: термобумага шириной Входное напряжение: Ток Рабочая температура Параметры печати Скорость печати Габаритные размеры Масса	изготовитель Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd. (SPRT) (Китай) SP-RMD11A да 3 кбайт 57,5±0,5 мм DC5B-9B 3А 0-50°C 8 точек/мм 384 точек/линия 30 мм/с 80x61x36 ±0,5 мм 89 г±5%
31	Бумага для принтера Ширина бумаги для печати Толщина бумаги Диаметр рулона бумаги Загрузка бумаги	изготовитель Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd. (SPRT) (Китай) 57,5±0,5 мм 0,06-0,08 мм 30 мм (внешний, максимум) 16 мм (внутренний, минимум) фронтальная
32	Набор для подключения Стерильность Долговечность Многократность/однократность	перед установкой должен быть простерилизован подлежит обработке после каждого использования максимальное число стерилизации (для трубок соединительных, разделительных, удлинительных из набора для подключения) - 30 многократный, замена после 30 циклов стерилизации (для трубок соединительных, разделительных, удлинительных из набора для подключения)


33	Трубка соединительная воздушного/водного канала (с меткой синего цвета) Внешний диаметр * Внутренний диаметр * Длина *	6 мм 3 мм 1500 мм
34	Трубка соединительная вытяжного канала (с меткой красного цвета) Внешний диаметр * Внутренний диаметр * Длина *	6 мм 3 мм 1500 мм
35	Трубка соединительная биопсийного канала (с меткой зеленого цвета) Внешний диаметр * Внутренний диаметр * Длина *	6 мм 3 мм 1000 мм
36	Трубка соединительная струйного канала (с меткой белого цвета) Внешний диаметр * Внутренний диаметр * Длина *	6 мм 3 мм 1500 мм
37	Трубка разделительная Внешний диаметр * Внутренний диаметр * Длина *	6 мм 3 мм 330 мм
38	Трубка удлинительная Внешний диаметр * Внутренний диаметр * Длина *	6 мм 3 мм 100 мм
39	Коннектор для подключения биопсийного канала Габариты * Масса *	(46 x 19) мм 43 г
40	Коннектор для подключения воздушного/водного канала Габариты * Масса *	(51 x 24) мм 34 г
41	Коннектор для подключения газового (CO ₂) канала Габариты * Масса *	(51 x 33) мм 34 г
42	Заглушка для каналов Габариты * Масса *	(32 x 20) мм 19 г
43	Клапан канальный Габариты * Масса *	(53 x 37 x 25) мм 83 г
44	Фильтр компрессора Размер пор Габаритная высота Высота фильтроэлемента Масса Стерильность Долговечность Многократность/однократность	0,2 мкм 149±1 мм 60 мм ±1 мм 205±10 г нестерильный 1 год работы многократный, замена 1 раз в год
45	Фильтр соединительных трубок Размер пор Габаритная высота Высота фильтроэлемента Масса Стерильность	0,2 мкм 102,5±1 мм 61 ±1 мм 65±5 г перед установкой должен быть простерилизован стерилизация 1 раз в

	Долговечность Многократность/однократность	30 дней, максимальное число циклов стерилизации - 10 многократный, замена после проведения 10 циклов стерилизации
46	Компрессор Модель Мощность Производительность	TECHNO TAKATSUK (Япония, завод- изготовитель - Филип- пины) HP-60 HIBLOW 51 Вт 60 л/мин
47	Лампа бактерицидная Philips TUV 8W G5 Мощность Напряжение Размер (длина/ диаметр) Длина волны	«Signify Netherland B.V.» (Нидерланды, место производства - Польша) 8 Вт 124 В 288,3 мм/ 16 мм 253,7 нм

Степень защиты электрооборудования IP20 по ГОСТ 14254.

Примечания: 1 *Допустимые отклонения размеров – согласно рабочим чертежам, ГОСТ 24643, ГОСТ 25346 и ГОСТ 25347; допустимые отклонения размеров и массы отмеченные знаком «*» $\pm 5\%$.

Сетевой кабель

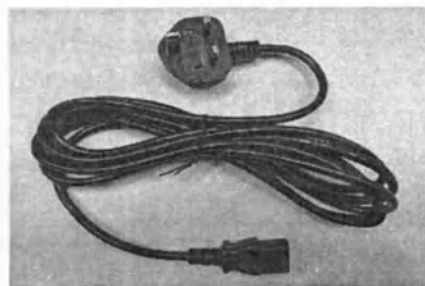


Назначение: подключение шкафа к источнику электропитания.

Изготовитель: JM ELECTRONICS Co. Ltd, Китай.

Длина: (5000 ± 50) мм.

Масса: (370 ± 30) г.

Набор для подключения

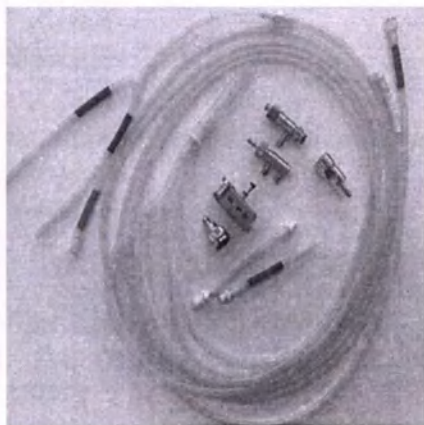

Назначение: подключение эндоскопа к каналам сушки шкафа.

Стерильность: перед установкой должен быть простерилизован.

Долговечность: подлежит обработке после каждого использования максимальное число стерилизации (для трубок соединительных, разделительных, удлинительных из набора для подключения) - 30.

Многократность/однократность: многократный, замена после 30 циклов стерилизации (для трубок соединительных, разделительных, удлинительных из набора для подключения).

Трубка соединительная воздушного/водного канала (с меткой синего цвета)

Внешний диаметр

6 мм $\pm 5\%$

Внутренний диаметр

3 мм $\pm 5\%$

Длина

1500 мм $\pm 5\%$

Трубка соединительная вытяжного канала (с меткой красного цвета)

Внешний диаметр

6 мм $\pm 5\%$

Внутренний диаметр

3 мм $\pm 5\%$

Длина

1500 мм $\pm 5\%$

Трубка соединительная биопсийного канала (с меткой зеленого цвета)

Внешний диаметр

6 мм $\pm 5\%$

Внутренний диаметр

3 мм $\pm 5\%$

Длина

1000 мм $\pm 5\%$

Трубка соединительная струйного канала (с меткой белого цвета)

Внешний диаметр

6 мм $\pm 5\%$

Внутренний диаметр

3 мм $\pm 5\%$

Длина

1500 мм $\pm 5\%$

Трубка разделительная

Внешний диаметр

6 мм $\pm 5\%$

Внутренний диаметр

3 мм $\pm 5\%$

Длина

330 мм $\pm 5\%$

Трубка удлинительная

Внешний диаметр

6 мм $\pm 5\%$

Внутренний диаметр

3 мм $\pm 5\%$

Длина

100 мм $\pm 5\%$


Коннектор для подключения биопсийного канала

Габариты

(46 x 19) мм $\pm 5\%$


Масса

43 г $\pm 5\%$

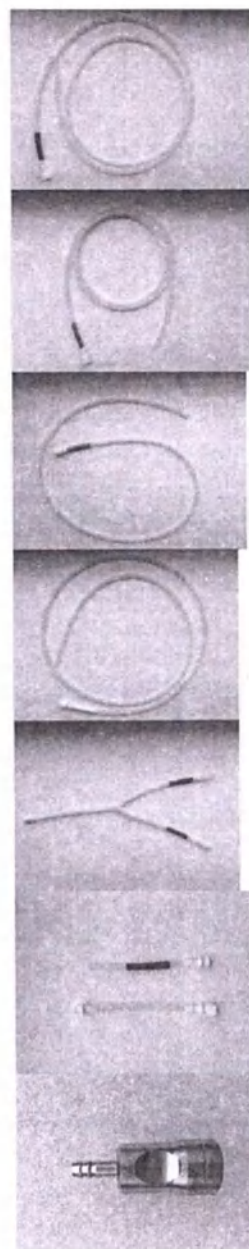

Коннектор для подключения воздушного/водного канала
Габариты
Масса

(51 x 24) мм $\pm 5\%$
34 г $\pm 5\%$



Коннектор для подключения газового (CO₂) канала
Габариты
Масса

(51 x 33) мм $\pm 5\%$
34 г $\pm 5\%$




Заглушка для каналов
Габариты
Масса

(32 x 20) мм $\pm 5\%$
19 г $\pm 5\%$



Клапан канальный
Габариты
Масса

(53 x 37 x 25) мм $\pm 5\%$
83 г $\pm 5\%$



Фильтр компрессора



Назначение: очищение воздушного потока.

Размер пор: 0,2 мкм.

Габаритная высота: (149 $\pm$ 1) мм.

Высота фильтроэлемента: 60 мм.


Масса: (205 $\pm$ 10) г.

Стерильность: нестерильный.

Долговечность: 1 год работы.

Многократность/однократность: многократный, замена 1 раз в год.

Фильтр соединительных трубок

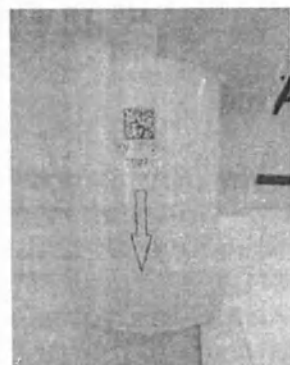

Назначение: очищение воздушного потока.

Размер пор: 0,2 мкм.

Габаритная высота: $(102,5 \pm 1)$ мм.

Высота фильтроэлемента: (61 ± 1) мм.

Масса: (65 ± 5) г.

Стерильность: перед установкой должен быть простерилизован. Стерилизация 1 раз в 30 дней.

Долговечность: максимальное число циклов стерилизации - 10.

Многократность/однократность: многократный, многократный, замена после проведения 10 циклов стерилизации.

Компрессор



Назначение: нагнетание воздуха по воздуховодам в каналы эндоскопов.

Модель: HP-60 HIBLOW.

Изготовитель: TECHNO TAKATSUK, Япония, завод изготовитель - Филиппины.

Мощность: 51 Вт.

Производительность: 60 л/мин.

Принцип работы: в основе работы компрессора лежит принцип электромагнитной вибрации, который позволяет избавиться от скользящих деталей и уменьшить их износ. Кроме того, электромагнитный принцип требует меньше энергии.

Рабочие детали представляют собой приводную штангу, которая располагается на двух вибрирующих резиновых мембранах. Приводит в движение штангу магнитная сила, которая возникает в результате подачи переменного тока на электромагнит. Постоянные магниты на штанге то отталкиваются, то притягиваются, заставляя штангу колебаться с частотой подаваемого электричества 50-60 Гц. Вибрация штанги заставляет пространство между мембраной и головкой мембраны то расширяться, то сжиматься, что приводит к впуску и выпуску воздуха.

Принтер



Назначение: регистрация заданных параметров (дата сушки, время сушки, модель/серийный номер эндоскопа и др.).

Изготовитель: Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd. (SPRT), Китай.

Модель: SP-RMD11A.

Построчная термопечать.

Буфер памяти печати составляет: 3 кбайт.

Бумага для печати: термобумага шириной $(57,5 \pm 0,5)$ мм.
Входное напряжение: DC5B-9B.
Ток: 3А.
Рабочая температура: 0-50°C.
Параметры печати: 8 точек/мм.
Скорость печати: 384 точек/линия, 30 мм/с.
Габаритные размеры: $(80 \times 61 \times 36 \pm 0,5)$ мм.
Масса: 89 г.

Бумага для принтера



Назначение: носитель для фиксации информации, регистрируемой принтером.
Изготовитель: Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd. (SPRT), Китай.
Ширина бумаги для печати: $(57,5 \pm 0,5)$ мм.
Толщина бумаги: 0,06 - 0,08 мм.
Диаметр рулона бумаги: 30 мм (внешний, максимум).
Загрузка бумаги: фронтальная.

Лампа бактерицидная Philips TUV 8W G5



Назначение: обеззараживание воздушного потока.
Изготовитель: «Signify Netherland B.V.» (Нидерланды, место производства - Польша).
Мощность 8 Вт.
Напряжение: 124 В.
Размер (длина/ диаметр): 288,3 мм/ 16 мм.
Длина волны: 253,7 нм.

11. АДРЕС ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Наименование: ООО «КЛИНИПАК»


Адрес: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31

Номера телефонов: +7 (495) 510-29-82

E-mail: info@klinipak.ru


Приложение I:

Схема производственного процесса NEOS

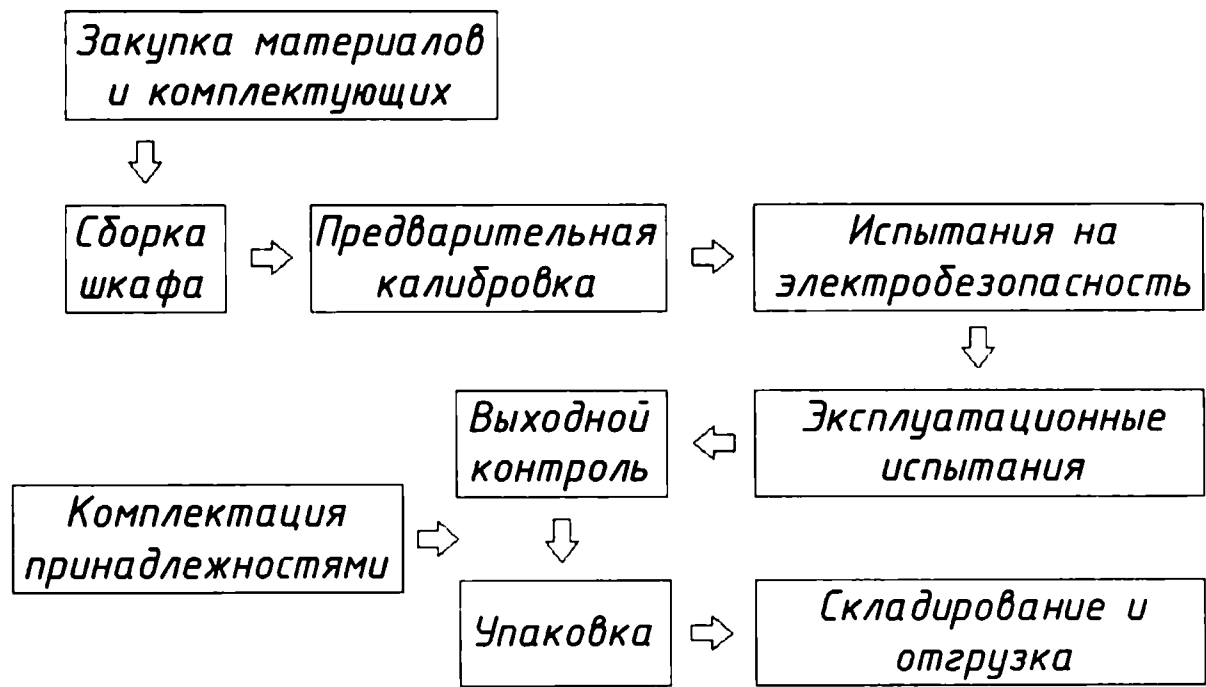

Приложение II:

Вид шкафа (на примере модели 16С-С)

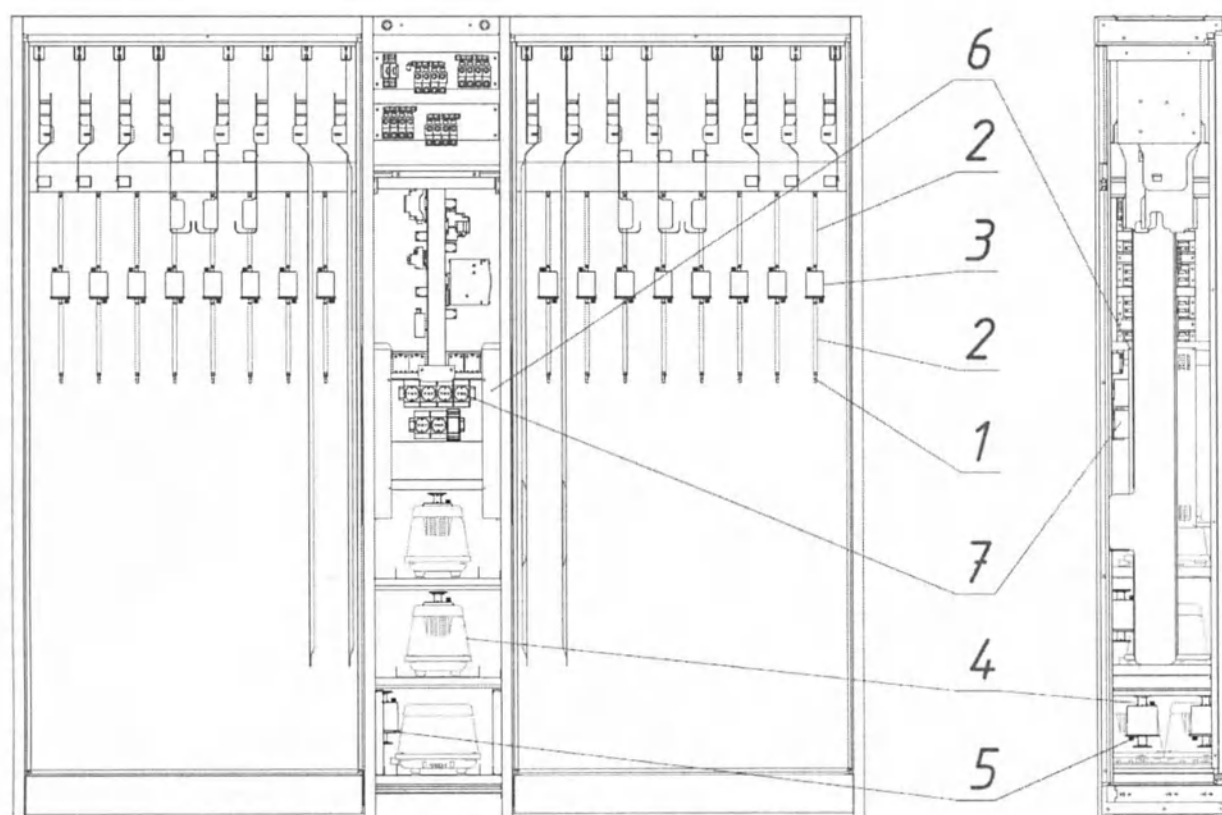

- 1 - Набор для подключения (коннектор)
- 2 - Набор для подключения (трубки: соединительная, разделительная, удлинительная)
- 3 - Фильтр соединительных трубок
- 4 - Компрессор. Обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха через каналы эндоскопа. Включается в блок электрических розеток (7)
- 5 - Фильтр компрессора
- 6 - Лампа бактерицидная Philips TUV 8W G5. Обеззараживает поток воздуха, нагнетаемого компрессором. Подключается к электрической цепи через блок управления
- 7 - Блок электрических розеток

Приложение III:

Материалы

Наименование позиции	Наименование частей у позиции	Материал с маркой	Поставщик/производитель
Шкаф для сушки и хранения эндоскопов	Корпус	Нержавеющая сталь, марка AISI 304	MEGLOBE Co., Ltd, Китай/ или Foshan Vinmay Stainless steel Co., Ltd, Китай/ или Evertek (HK) Stainless steel Co., Ltd, Китай
	Дверь		
	Держатель эндоскопов		
	Кнопка управления		
	Уплотнитель держателя эндоскопов	ПВХ	«XIGTAI KIDE RUBBER PRODUCTS Co. Ltd», Китай
	Остекление двери	Стекло М4 по ГОСТ 111-2014	ООО «Экспо Гласс» (Стекольный завод «Символ»), Россия
	Кнопка аварийная	Пластик АБС	ООО «ТД ОВЕН-К», Россия
	Поверхность сенсорного экрана	Полиамид	ООО «ТД ОВЕН-К», Россия
Сетевой кабель	-	ПВХ	ООО «Телеком кабель», Россия
Набор для подключения:			
-трубка соединительная воздушно-го/водного канала (с меткой синего цвета)	Трубка	Резина силиконовая	ООО ПК «Форвард-Комплект», Россия
	Фитинг белый	Белый нейлон FDA	Colder Products Company, США
	Фитинг полупрозрачный	Натуральный полипропилен FDA	Colder Products Company, США
	Метка синего цвета	Полиолефин с фталоцианиновым пигментом	Yueqing Vancol Import & Export Co., Ltd», Китай
-трубка соединительная вытяжного канала (с меткой красного цвета)	Трубка	Резина силиконовая	ООО ПК «Форвард-Комплект», Россия
	Фитинг белый	Белый нейлон FDA	Colder Products Company, США
	Фитинг полупрозрачный	Натуральный полипропилен FDA	Colder Products Company, США
	Метка красного цвета	Полиолефин с азопигментом	Yueqing Vancol Import & Export Co., Ltd», Китай
-трубка соединительная биопсийного канала (с меткой зеленого цвета)	Трубка	Резина силиконовая	ООО ПК «Форвард-Комплект», Россия
	Фитинг белый	Белый нейлон FDA	Colder Products Company, США
	Фитинг полупрозрачный	Натуральный полипропилен FDA	Colder Products Company, США
	Метка зеленого цвета	Полиолефин с фталоцианиновым пигментом	Yueqing Vancol Import & Export Co., Ltd», Китай

-трубка соединительная струйного канала (с меткой белого цвета)	Трубка	Резина силиконовая	ООО ПК «Форвард-Комплект», Россия
	Фитинг белый	Белый нейлон FDA	Colder Products Company, США
	Фитинг полупрозрачный	Натуральный полипропилен FDA	Colder Products Company, США
	Метка белого цвета	Полиолефин с пигментом - двуокись титана	Yueqing Vancol Import & Export Co., Ltd», Китай
-трубка разделительная	Трубка	Резина силиконовая	ООО ПК «Форвард-Комплект», Россия
	Фитинг белый	Белый нейлон FDA	Colder Products Company, США
	Фитинг полупрозрачный	Натуральный полипропилен FDA	Colder Products Company, США
-трубка удлинительная	Трубка	Резина силиконовая	ООО ПК «Форвард-Комплект», Россия
	Фитинг белый	Белый нейлон FDA	Colder Products Company, США
- коннекторы: - коннектор для подключения биопсийного канала; - коннектор для подключения воздушного/водного канала; - коннектор для подключения газового (CO ₂) канала; - заглушка для каналов; - клапан канальный	-	Нержавеющая сталь, марка AISI 304	MEGLOBE Co., Ltd, Китай/ или Foshan Vinmay Stainless steel Co., Ltd, Китай/ или Evertek (HK) Stainless steel Co., Ltd, Китай
Фильтр компрессора	Корпус	Полипропилен	ООО НПП «Техно-фильтр», Россия
Фильтр соединительных трубок	Корпус	Полипропилен	ООО НПП «Техно-фильтр», Россия
Принтер	Корпус	Полиамид ПА-66	«Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd. («SPRT»)), Китай
Бумага для принтера	-	Термобумага	«Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd. («SPRT»)), Китай

Приложение IV:

Маркировка

На шкафах закреплена табличка по ГОСТ 12971, содержащая сведения, предусмотренные техническими условиями, ГОСТ 26828, ГОСТ 18620 и ГОСТ IEC 61010-1, а именно:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование медицинского изделия: «Шкаф для сушки и хранения эндоскопов "NEOS" с принадлежностями»;
- надпись «Сделано в России» или код страны «RU»;
- условное обозначение шкафа по настоящим техническим условиям (Модель);
- год изготовления (выпуска);
- серийный номер;
- электропитание (В/Гц/А);
- максимальное потребление (кВт);
- клеймо ОТК завода-изготовителя;
- номер настоящих технических условий;
- номер регистрационного удостоверения;
- масса изделия;
- надпись «Техническая поддержка», с указанием контактного номера телефона.
- символ «Клемма защитного проводника» по ГОСТ IEC 61010-1.

На поверхности шкафов, вблизи мест электрических соединений нанесена следующая маркировка:

- символ «Внимание, опасность» по ГОСТ IEC 61010-1;
- символ «Внимание, опасное напряжение» по ГОСТ IEC 61010-1;
- символ «Клемма защитного проводника» по ГОСТ IEC 61010-1.

Возле сетевого разъема нанесена маркировка с обозначением номинального напряжения, силы и частоты тока.

Все маркировки, относящиеся к работе шкафов, должны быть ясно различимы медицинским персоналом или пациентом, стоящим или сидящим на расстоянии 1 м и имеющим остроту зрения, при необходимости скорректированную, равную 1 при освещении 215 лк.

Маркировка, на упаковке фильтра компрессора, фильтра соединительных трубок и набора для подключения содержит следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование изделия;
- месяц и год изготовления;
- серийный номер или партия;
- надпись: «Сделано в России»;
- гарантийный срок хранения;
- номер настоящих технических условий;
- номер регистрационного удостоверения.

Маркировка, выносимая в товаросопроводительную документацию, содержит следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение шкафа по настоящим техническим условиям;
- номер партии;
- массу нетто;
- год изготовления;
- гарантии изготовителя;
- эксплуатационно-технические характеристики;
- штрих-код (при наличии);
- отметку о прохождении технического контроля;
- знак соответствия по электромагнитной совместимости по ГОСТ 28690;
- сведения о сертификации (декларировании), знак по ГОСТ Р 50460 и (или) единый знак обращения на рынке государств – членов Евразийского экономического сообщества.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое, обращаться осторожно», «Верх» и «Беречь от влаги», надписи: «ХРУПКОЕ. НЕ КАНТОВАТЬ».

Рис. М.1
Маркировка на шкафу



ООО «КЛИНИПАК», 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31
телефон: +7 (495) 510-29-82, E-mail: info@klinipak.ru

Шкаф для сушки и хранения эндоскопов «NEOS» с принадлежностями

Технические условия ТУ 32.50.50-008-69745848-2019

Модель	_____	Проверено:	_____
Макс. потребление, кВт	_____	Сделано в России	_____
Электропитание, В/Гц/А	_____		
Серийный номер	_____		
Год изготовления	_____		
Масса, не более, кг	_____		
Техническая поддержка	+7(495)933-31-63		
Регистрационное удостоверение	_____		


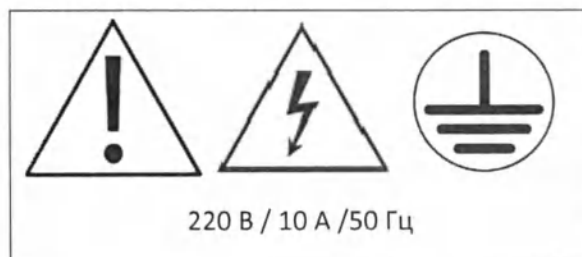


Рис. М.2
Маркировка Фильтра компрессора



ООО «КЛИНИПАК», 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31
телефон: +7 (495) 510-29-82, E-mail: info@klinipak.ru

Фильтр компрессора

к шкафу для сушки и хранения эндоскопов «NEOS»
по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019
с принадлежностями

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____

Гарантийный срок хранения: _____

Регистрационное удостоверение: _____

Сделано в России

Рис. М.3
Маркировка Фильтра соединительных трубок



ООО «КЛИНИПАК», 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31
телефон: +7 (495) 510-29-82, E-mail: info@klinipak.ru

Фильтр соединительных трубок

к шкафу для сушки и хранения эндоскопов «NEOS»
по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019
с принадлежностями

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____

Гарантийный срок хранения: _____

Регистрационное удостоверение: _____

Сделано в России

Рис. М.4
Маркировка Фильтра компрессора



ООО «КЛИНИПАК», 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, комн. 31
телефон: +7 (495) 510-29-82, E-mail: info@klinipak.ru

Набор для подключения

к шкафу для сушки и хранения эндоскопов «NEOS»
по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019
с принадлежностями

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____

Гарантийный срок хранения: _____

Регистрационное удостоверение: _____

Сделано в России

Рис. М.5
Манипуляционные знаки на транспортной упаковке
ХРУПКОЕ. НЕ КАНТОВАТЬ.

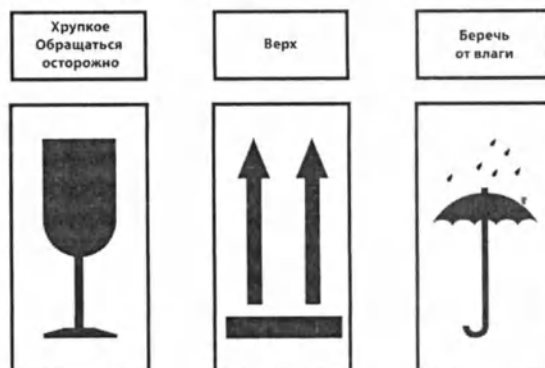


Рис. М.6
Расшифровка символов



Приложение V:

Способ упаковывания, а также массогабаритные характеристики упаковки

Наименование варианта исполнения шкафа	Описание транспортной упаковки	Размеры транспортной упаковки (гофрокороба), мм, $\pm 10\%$	Масса гофрокоробов, кг, $\pm 10\%$	Масса брутто упаковки (вариант исполнения + гофрокороб + поддон), кг, $\pm 10\%$
«2L-S», «2R-S», «2L-C», «2R-C», «3L-S», «3R-S», «3L-C», «3R-C», «4L-S», «4R-S», «4L-C», «4R-C»	Шкаф оборачивается в полимерную пленку (защита внешнего вида); упаковывается в гофрокороб, гофрокороб ставится на поддон.	950x400x2220	3,2	274
«5L-S», «5R-S», «5L-C», «5R-C»	Один из отсеков хранения и сушки эндоскопов отсоединяется и упаковывается отдельно от другой части (второй отсек для сушки и хранения эндоскопов и +отсек управления шкафом). Части шкафа оборачиваются в полимерную пленку (защита внешнего вида); упаковываются в гофрокороба, гофрокороба ставятся на поддоны. Всего 2 короба.	короб 1: 450x400x2220 короб 2: 660x400x2220	2 2,5	295
«6L-S», «6L-C», «6R-S», «6R-C», «7L-S», «7L-C», «7R-S», «7R-C», «8L-S», «8L-C», «8R-S», «8R-C»	Один из отсеков хранения и сушки эндоскопов отсоединяется и упаковывается отдельно от другой части (второй отсек для сушки и хранения эндоскопов и +отсек управления шкафом). Части шкафа оборачиваются в полимерную пленку (защита внешнего вида); упаковываются в гофрокороба, гофрокороба ставятся на поддоны. Всего 2 короба.	короб 1: 450x400x2220 короб 2: 1050x400x2220	2 3,45	296
«6C-S», «6C-C», «7C-S», «7C-C», «8C-S», «8C-C»	Оба отсека хранения и сушки эндоскопов отсоединяется и упаковывается отдельно от отсека управления шкафом. Части шкафа оборачиваются в полимерную пленку (защита внешнего вида); упаковываются в гофрокороба, гофрокороба ставятся на поддоны. Всего 3 короба.	короб 1: 450x400x2220, короб 2: 540x400x2220 короб 3: 540x400x2220	2 2,2 2,2	317,
«9L-S», «9L-C», «9R-S», «9R-C», «10L-S», «10L-C», «10R-S», «10R-C»	Один из отсеков хранения и сушки эндоскопов отсоединяется и упаковывается отдельно от другой части (второй отсек для сушки и хранения эндоскопов и +отсек управления шкафом). Части шкафа оборачиваются в полимерную пленку (защита внешнего вида); упаковываются в гофрокороба, гофрокороба ставятся на поддоны. Всего 2 короба.	короб 1: 450x400x2220 короб 2: 1230x400x2220	2 3,9	296

Наименование варианта исполнения шкафа	Описание транспортной упаковки	Размеры транс- портной упаков- ки (гофрокороб- а), мм, ±10%	Масса гофро- коробов, кг, ±10%	Масса брутто упаковки (ва- риант испол- нения + гофрокороб + поддон), кг, ± 10%
«9C-S», «10C-S»	Оба отсека хранения и сушки эндоскопов отсоединяется и упаковывается отдельно от отсека управления шкафом. Части шкафа оборачиваются в полимерную пленку (защита внешнего вида); упаковываются в гофрокороба, гофрокороба ставятся на поддоны. Всего 3 короба.	короб 1: 450x400x2220 короб 2: 660x400x2220 короб 3: 660x400x2220	2 2,5 2,5	317
«12L-S», «12R-S», «12L-C», «12R-C»	Один из отсеков хранения и сушки эндоскопов отсоединяется и упаковывается отдельно от другой части (второй отсек для сушки и хранения эндоскопов и +отсек управления шкафом). Части шкафа оборачиваются в полимерную пленку (защита внешнего вида); упаковываются в гофрокороба, гофрокороба ставятся на поддоны. Всего 2 короба.	1 короб: 450x400x2220 1 короб: 1510x400x2220	2 4,6	467
«14L-S», «14R-S», «14L-C», «14R-C»	Один из отсеков хранения и сушки эндоскопов отсоединяется и упаковывается отдельно от другой части (второй отсек для сушки и хранения эндоскопов и +отсек управления шкафом). Части шкафа оборачиваются в полимерную пленку (защита внешнего вида); упаковываются в гофрокороба, гофрокороба ставятся на поддоны. Всего 2 короба.	1 короб: 450x400x2220 1 короб: 1730x400x2220	2 5,1	468
«15L-S», «15R-S», «15L-C», «15R-C»	Один из отсеков хранения и сушки эндоскопов отсоединяется и упаковывается отдельно от другой части (второй отсек для сушки и хранения эндоскопов и +отсек управления шкафом). Части шкафа оборачиваются в полимерную пленку (защита внешнего вида); упаковываются в гофрокороба, гофрокороба ставятся на поддоны. Всего 2 короба.	1 короб: 450x400x2220 1 короб: 1840x400x2220	2 5,4	468
«16C-S», «16C-C»	Оба отсека хранения и сушки эндоскопов отсоединяется и упаковывается отдельно от отсека управления шкафом. Части шкафа оборачиваются в полимерную пленку (защита внешнего вида); упаковываются в гофрокороба, гофрокороба ставятся на поддоны. Всего 3 короба.	1 короб: 450x400x2220 1 короб: 1010x400x2220 1 короб: 1010x400x2220	2 3,4 3,4	490

Наименование варианта исполнения	Описание упаковки	Размеры упаковки (мм)	Масса брутто упаковки (г)
Фильтр компрессора	Первичная упаковка: пакет само- запечатывающийся (бума- га/пленка) плоский «Клинипак» для медицинской паровой, газовой, плазменной стерилизации по ТУ 9398-001-69745848-2011	(200 x 330) ±5%	74 ± 10%
	Вторичная упаковка: короб из кар- тона гофрированного	(210 x 160 x 110) ±5%	127 ± 10%
Фильтр соединитель- ных трубок	Первичная упаковка: пакет само- запечатывающийся (бума- га/пленка) плоский «Клинипак» для медицинской паровой, газовой, плазменной стерилизации по ТУ 9398-001-69745848-2011	(150 x 200) ±5%	206 г ± 10%
	Вторичная упаковка: короб из кар- тона гофрированного	(250 x 108 x 200) ±5%	313 ± 10%
Набор для подключе- ния	Первичная упаковка: пакет само- запечатывающийся (бума- га/пленка) плоский «Клинипак» для медицинской паровой, газовой, плазменной стерилизации по ТУ 9398-001-69745848-2011	(250 x 410) ± 5%	285 ±10%
	Вторичная упаковка: короб из кар- тона гофрированного	(450 x 258 x 55) ± 5%	526 ± 5%

Приложение VI:

Сведения о нормативной документации

Номер стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ Р 50444 – 2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ IEC 61010 – 1 – 2014	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119 – 2000	Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 – 93	Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению
ГОСТ 28195-89	Оценка качества программных средств. Общие положения
ГОСТ Р 51188-98	Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство
ГОСТ Р МЭК 62366 – 1 – 2023	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
ГОСТ Р ИСО 15223-1 - 2023	«Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»
ГОСТ IEC 62304 – 2022	«Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла»
ГОСТ Р МЭК 61326 – 1 – 2014	«Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ 14254 – 2015	«Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»
ГОСТ Р ИСО 9127 – 94	«Системы обработки информации. Документация по эксплуатации и информация на упаковке для потребительских программных пакетов»

Приложение VII:

Электромагнитная совместимость

Показатель	Диапазон значений	Наименование стандарта	Класс
Электромагнитное излучение	30 МГц до 1 ГГц	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014	A
Кондуктивные помехи	150 кГц до 30 МГц	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014	A

Показатель	Наименование стандарта	Значения	Критерии	Заключение
Электростатический заряд	ГОСТ 30804.4.2-2013	4 кВ, 8 кВ	B	Полы должны быть из дерева, бетона или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не ниже 30 %
Радиочастотные электромагнитные поля	ГОСТ 30804.4.3-2013	10 В/м (80 МГц до 1 ГГц) 3 В/м (1,4 ГГц до 2 ГГц) 1 В/м (2 ГГц до 2,7 ГГц)	A A A	Радиочастотное излучение очень низко и вероятность помех близлежащему электронному оборудованию мало
Электрические быстрые переходные процессы (пачки)	ГОСТ IEC 61000-4-4-2016	± 2 кВ/5 кГц	B	Качество линий электропитания должно соответствовать требованиям для помещений коммерческого и медицинского назначения
Выброс напряжения	ГОСТ IEC 61000-4-5-2017	± 2 кВ	B	
Электромагнитная совместимость	ГОСТ IEC 61000-4-6-2016	150 кГц - 80 МГц 3В	A	
Провал напряжения электропитания	ГОСТ 30804.4.11-2013	30% 25/30 период 60% 10/12 период 100% 1 период	C C B	
Прерывание напряжения электропитания		100%, 5 с	C	

Пропнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

58 (пятьдесят
восемь)
Генеральный
директор _____

Руденко А.В.

